
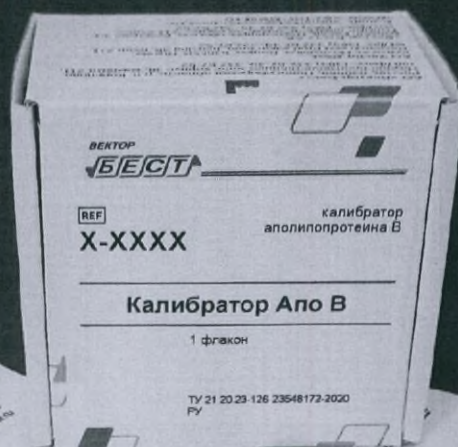


Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
2020 г.

й директор
-Бест»

Хусаинов М.Д.

2020 г.



Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Колыбель, Научно-производственная зона, корпус 36, п. 211. Ю. Власович
www.becor.ru
shvabing@yandex.ru

Калибратор
Ано В
258 10100
11.8 мм (45/100)
2021-09

Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492

Принимаем тел: (383) 27-66-30,
факс (383) 330-94-44

ПАСПОРТ № 942-20
Калибратор Ано В
Калибратор аполоитрономы В

33-126-23548-172-2020

температура от 2 до 8 °C
температура от 2 до 8 °C
температура при
более 10 суток

Номер серии
Дата изготовления
Дата выдачи паспорта
Срок годности изделия

ВВЕДЕНИЕ

ВЕКТОР

БЕКОР

Принимая: тел. (385) 227-80-30
факс (385) 352-84-44

ПАСПОРТ № 242-20
Калибратор Апо В
Калибратор аполипротеина В

Хранить при температуре от 2 до 8 °С.
Транспортировать при температуре от 2 до 8 °С. Допускается транспортирование при температуре до 26 °С не более 10 суток.

Калибратор, серия 1	Состав
Примос	

Показатель	
Скорость калибровки	мин.
Температура воды	°C
Соответствие кони-	%
калитратора аттестации	
Поправки на погрешности	

Соответствие концентрац разведениях калибратора теоретическому значению	
---	--

Инструкция
(Кодировка А-100)

1. НАЗНАЧЕНИЕ
В (Казимир)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.2. Кан

2. **ХАРАКТЕРИСТИКА КАЛИБРАТОРА**
 Калибратор изготовлен на основе импортной комплектующей (0,0003 мм), заводской маркировкой В (или В) в паспорте и представляет собой блок, состоящий из корпуса, выполненного из нержавеющей стали, и фланца, выполненного из алюминия. Калибратор предназначен для измерения диаметра отверстий в деталях с номинальной величиной от 0 до 10 мм.

[illegible]

Проектируемость
в калибраторе
АО «Вектор-Бест»
выполнен
представляет собой
в калибраторе
1,0 мм калибратора
размера сварочных
калораторов

3.1. Потенциально-
РФ от 06.06.2011 г.

3.2. МЕРЫ ПРЕДОУМОШЛИВЛЕНИЯ

3.2. Калибратор

безопасности к лабораторной деятельности

Материалы, посвященные диагностике для профессионалов

не содержит антигены и

Приведены в соответствие с требованиями ГОСТ Р 52905-2007

и вирус гепатита С и HBsAg

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

del. [unclear]
reunione di 20.8


1977

10

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ





2020 г.

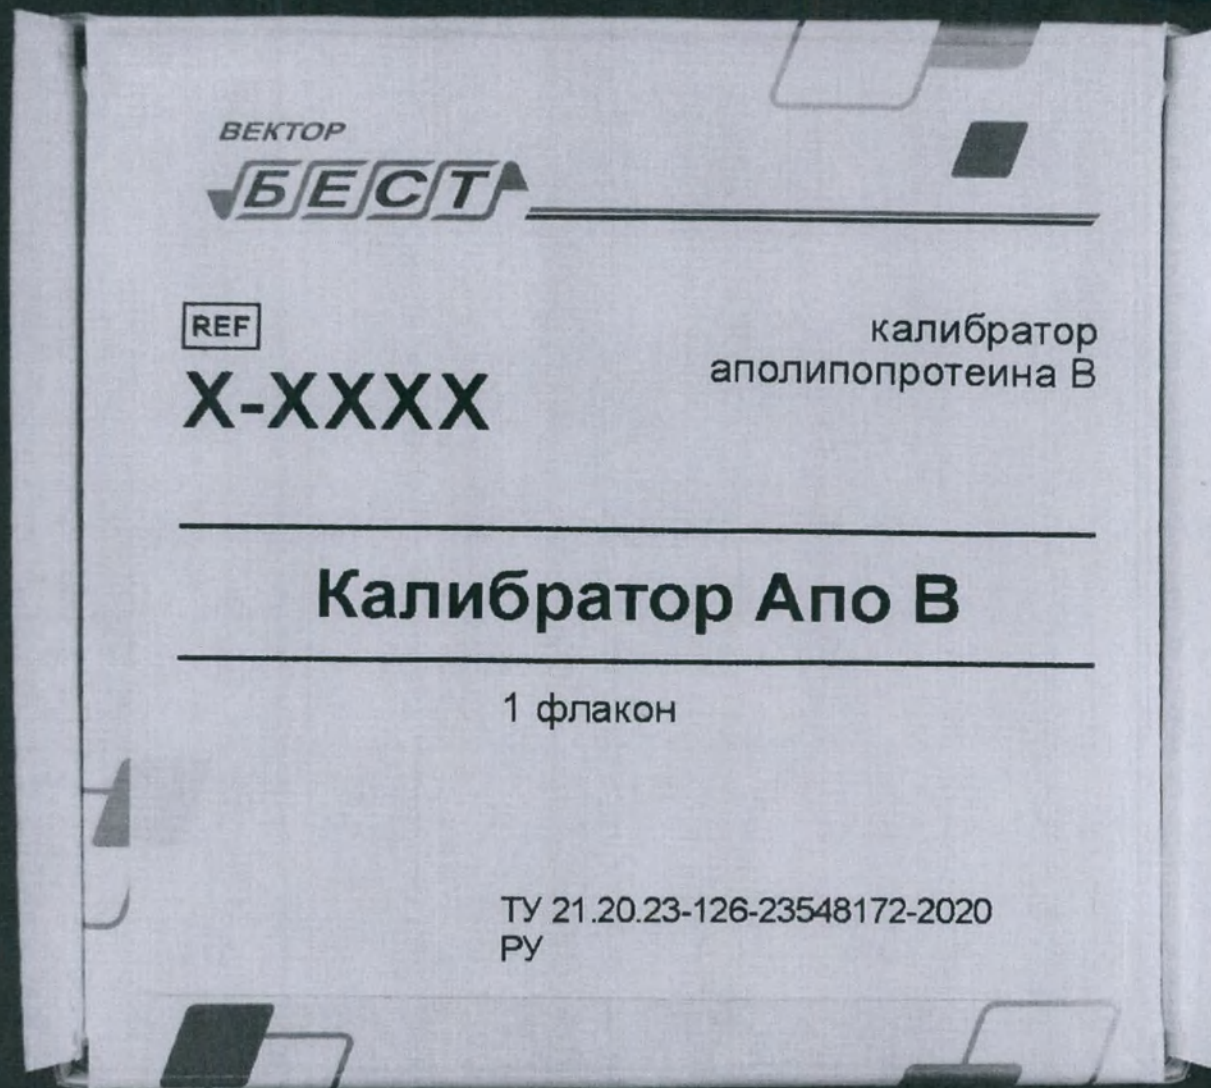



REF X-XXXX LOT 1
2020-03
2021-09

Калибратор Апо В



Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Калибратор аполипопротеина В (Калибратор Апо В)» № 1 (серия 1)

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «30» 04 2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Калибратор аполипопротеина В (Калибратор Апо В)» № 2 (серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.


2020 г.





Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Калибратор аполипопротеина В (Калибратор Апо В)» (серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.

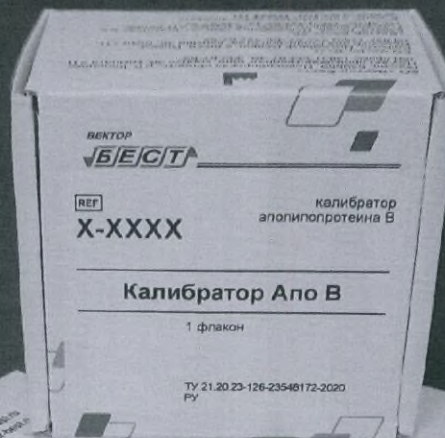

Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Колыцово, Научно-производственная зона, корпус-39, п. 211, АО «Вектор-Бест»
Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 462
Тел: (383) 221-60-30, факс: (383) 550-64-44
www.vektorbest.ru

ТУ 21.20.23-126-22548-172-2020
Хранить при температуре от 2 до 8 °С.
Транспортировать при температуре от 2 до 8 °С. Допускается транспортирование при температуре до 26 °С не более 10 суток.

ПАСПОРТ № 128-20
Калибратор аполипопротеина В

Калибратор аполипопротеина В

Калибратор, серия 2

Растворимость калибратора в дистиллированной воде до 26 °С, мин. не более

Соответствие концентрации калибратора аттестованным пределам, %

Соответствие концентрации разведений калибратора теоретическому значению



ИНСТРУКЦИЯ
по применению калибратора аполипопротеина В (Калибратор Апо В)

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Калибратор аполипопротеина В (Калибратор Апо В) предназначен для преобразования калибровочных значений иммуноферментных анализов в концентрацию аполипопротеина В (Апо В) в сыворотке и плазме крови человека.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЛИБРАТОРА
2.1. Калибратор изготовлен на основе индустриальной сыворотки человека, содержит глицерин (0,003%), антифазулюс-1 флакон флакона и в паспорте и представляет собой стандартное вещество для калибровки многократных измерений, выполняемых с использованием набора реагентов производства АО «Вектор-Бест».

Концентрация калибратора в 1,0 мл калибратора составляет 1,0 мг аполипопротеина В в калибраторе.


Потенциальный риск применения калибратора - класс 2 (Риск МД).

РФ от 06.06.2012 № 40.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
3.1. Калибратор предназначен для профессионального применения в клинической лабораторной диагностике обученным персоналом. Калибратор не следует применять для изготовления калибратора, индикатора и не следует применять к ВПЧ 1,2 и вирус гепатита С и HBsAg.



3.2. Калибратор должен храниться в оригинальной упаковке при температуре от 2 до 8 °С. Срок годности калибратора - 12 месяцев.

6.1. Калибратор калибратора аполипопротеина В (Калибратор Апо В) должен храниться в оригинальной упаковке при температуре от 2 до 8 °С. Срок годности калибратора - 12 месяцев.

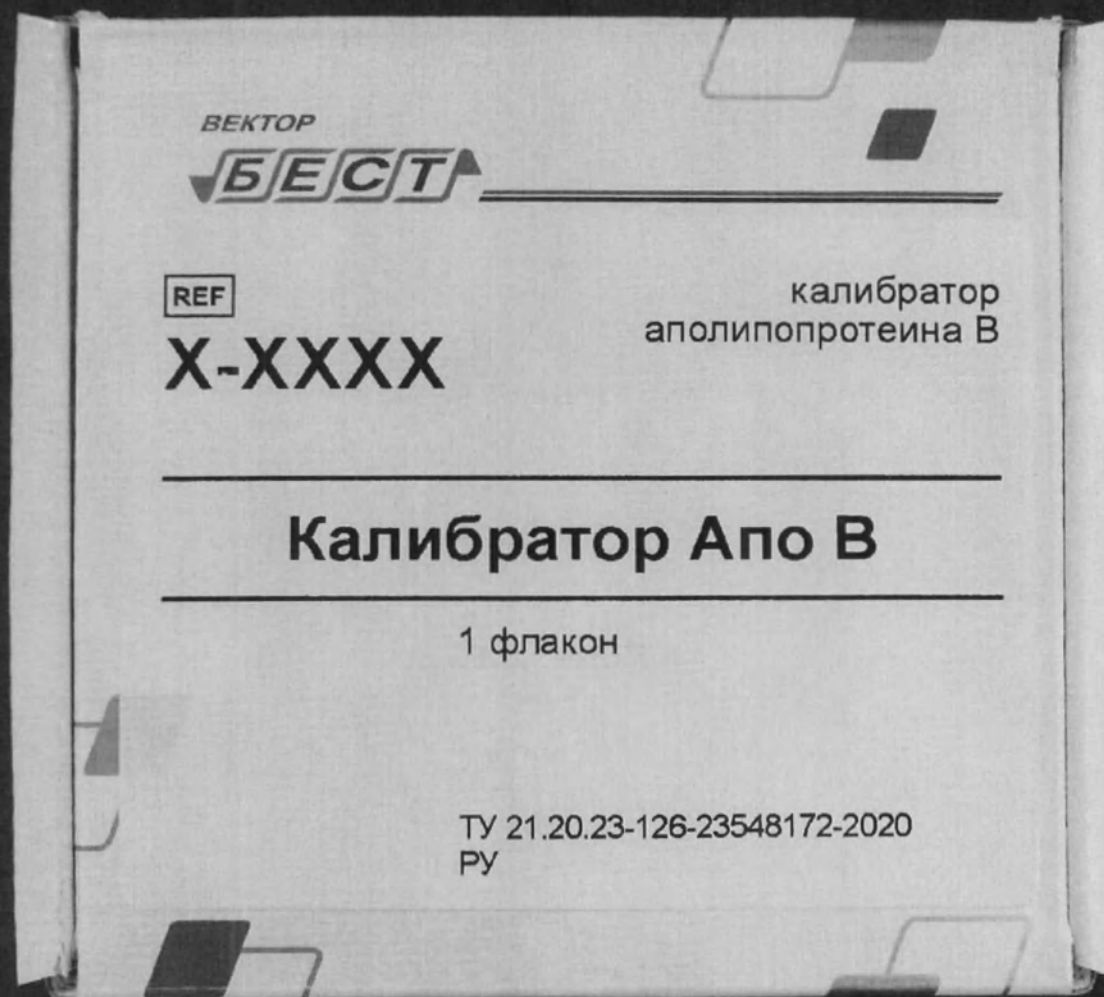

REF LOT 2
X-XXXX 2020-04
2021-10

Калибратор Апо В



Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Калибратор аполипопротеина В (Калибратор Апо В)» № 1 (серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
«30» _____ 2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Калибратор аполипопротеина В (Калибратор Апо В)» № 2 (серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
«30» _____ 2020 г.

