

Руководитель

Отдела по управлению качеством ООО "ФИЛИПС"


Бахвалова О.В.


«27» декабря 2017г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

**«Система комбинированной позитронно-эмиссионной томографии и компьютерной томографии
Vereos PET/CT с принадлежностями».**

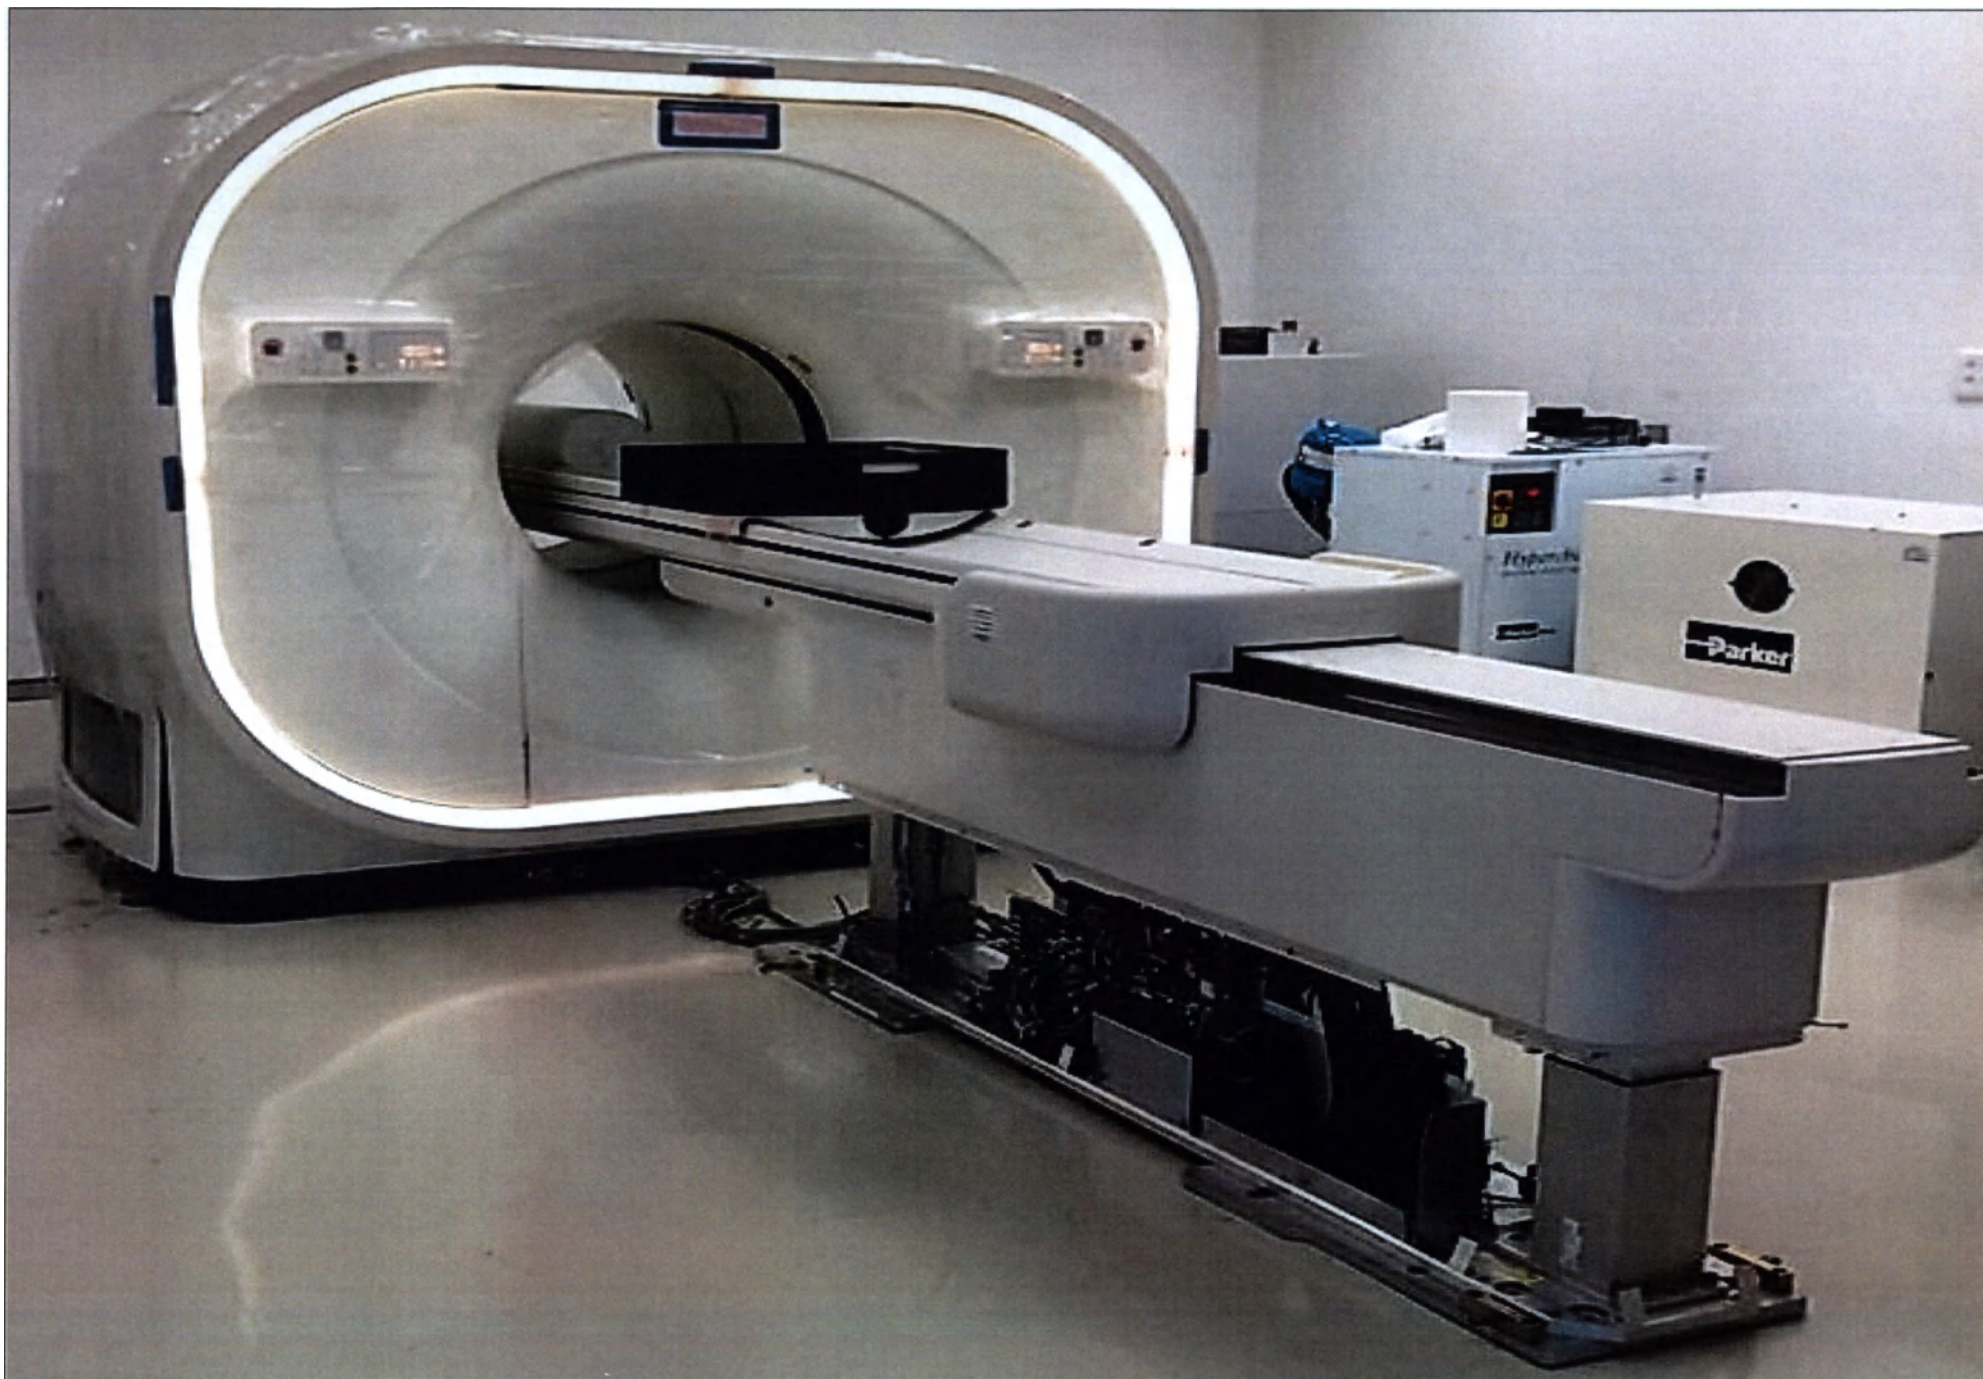


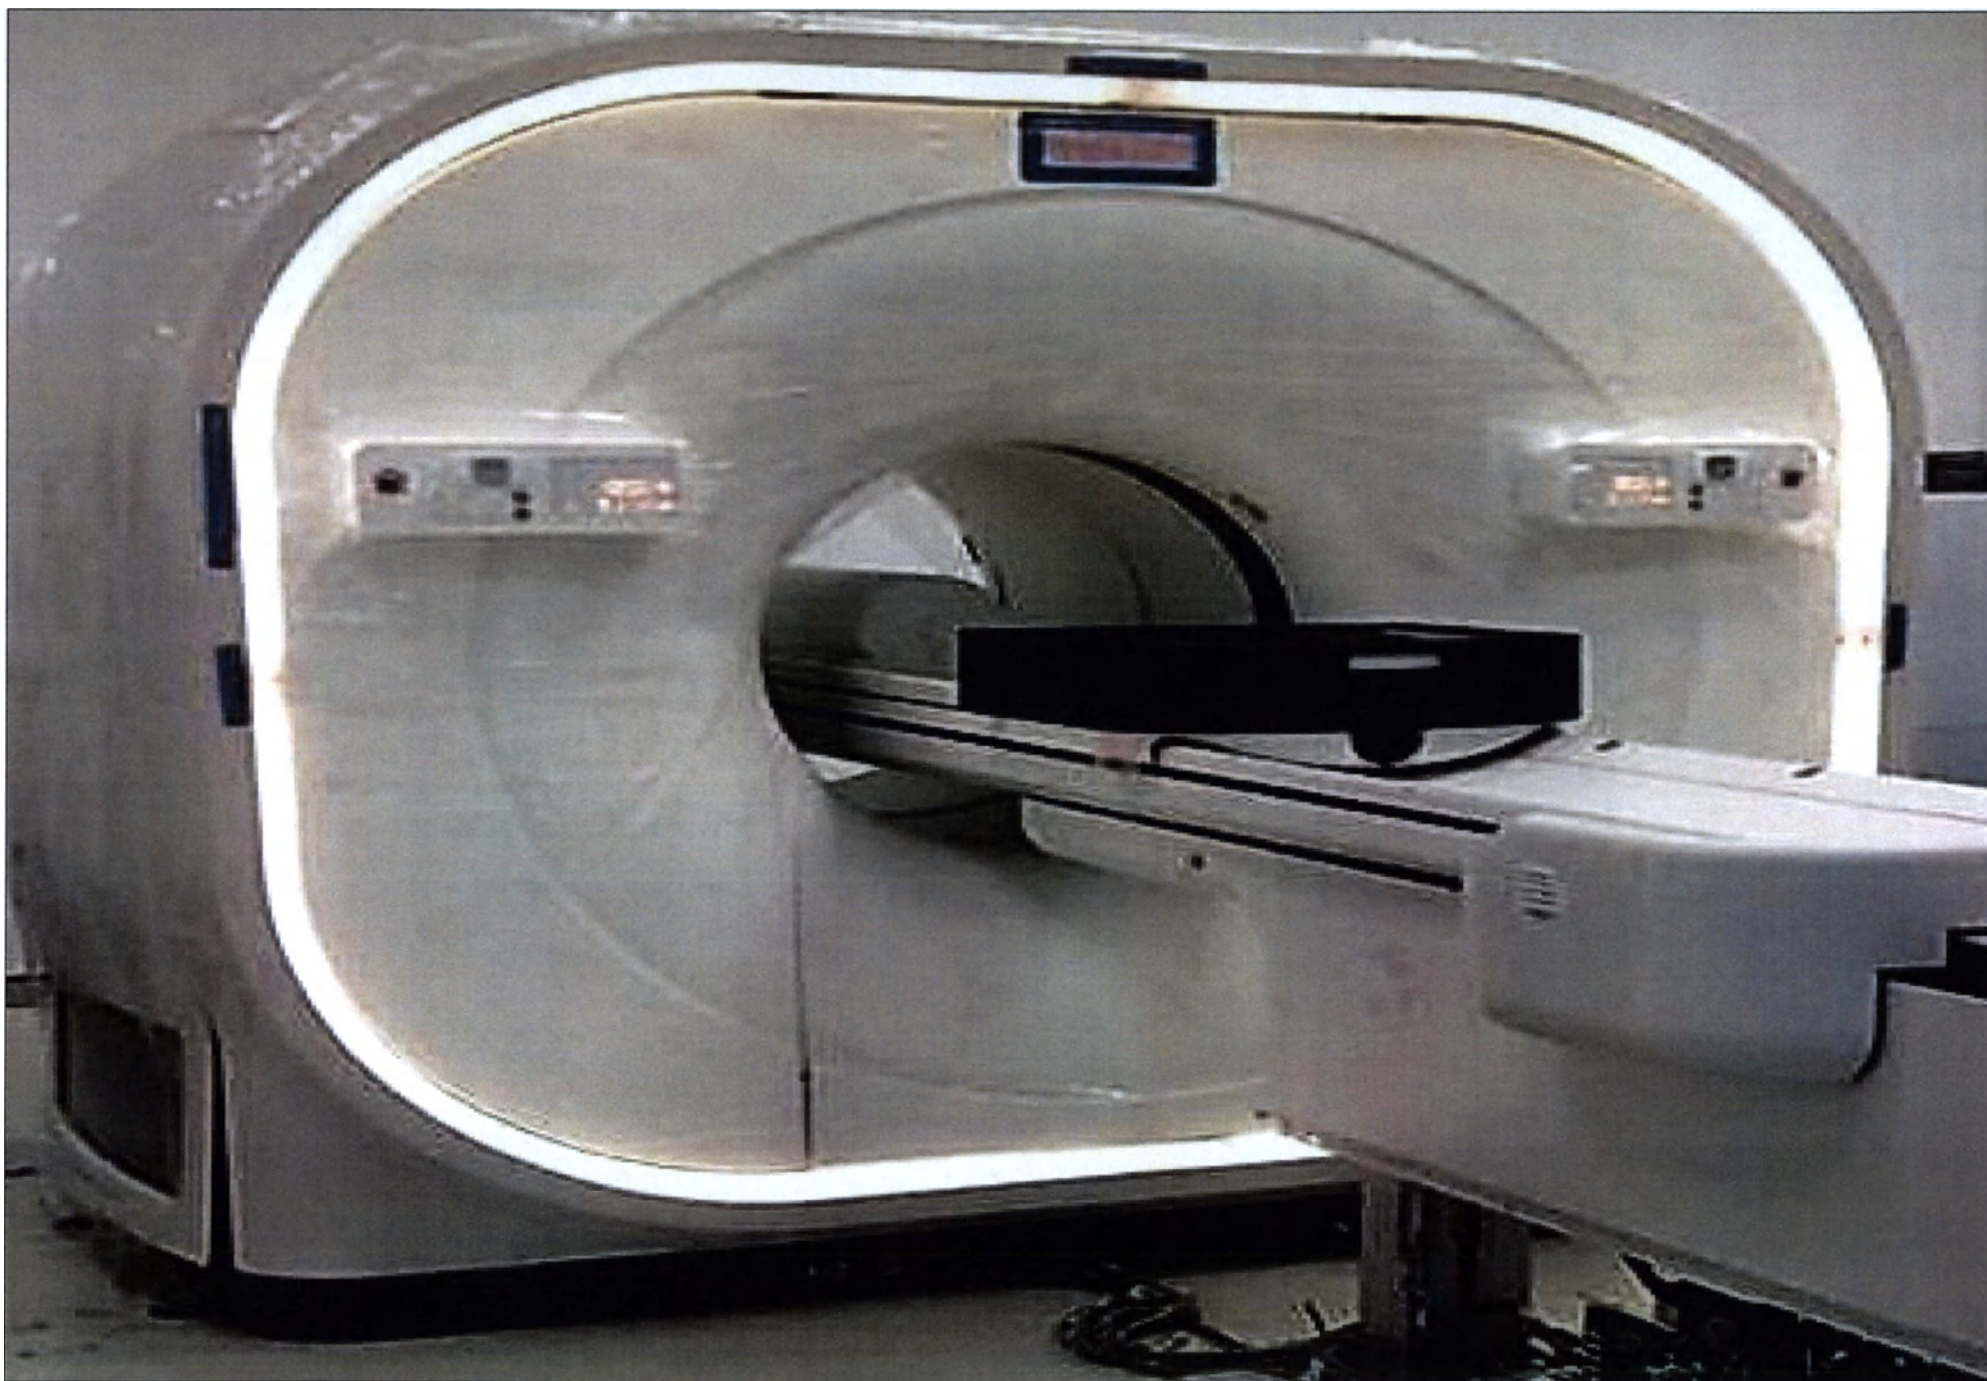


1. Генри ПЭТ/КТ встроенный.

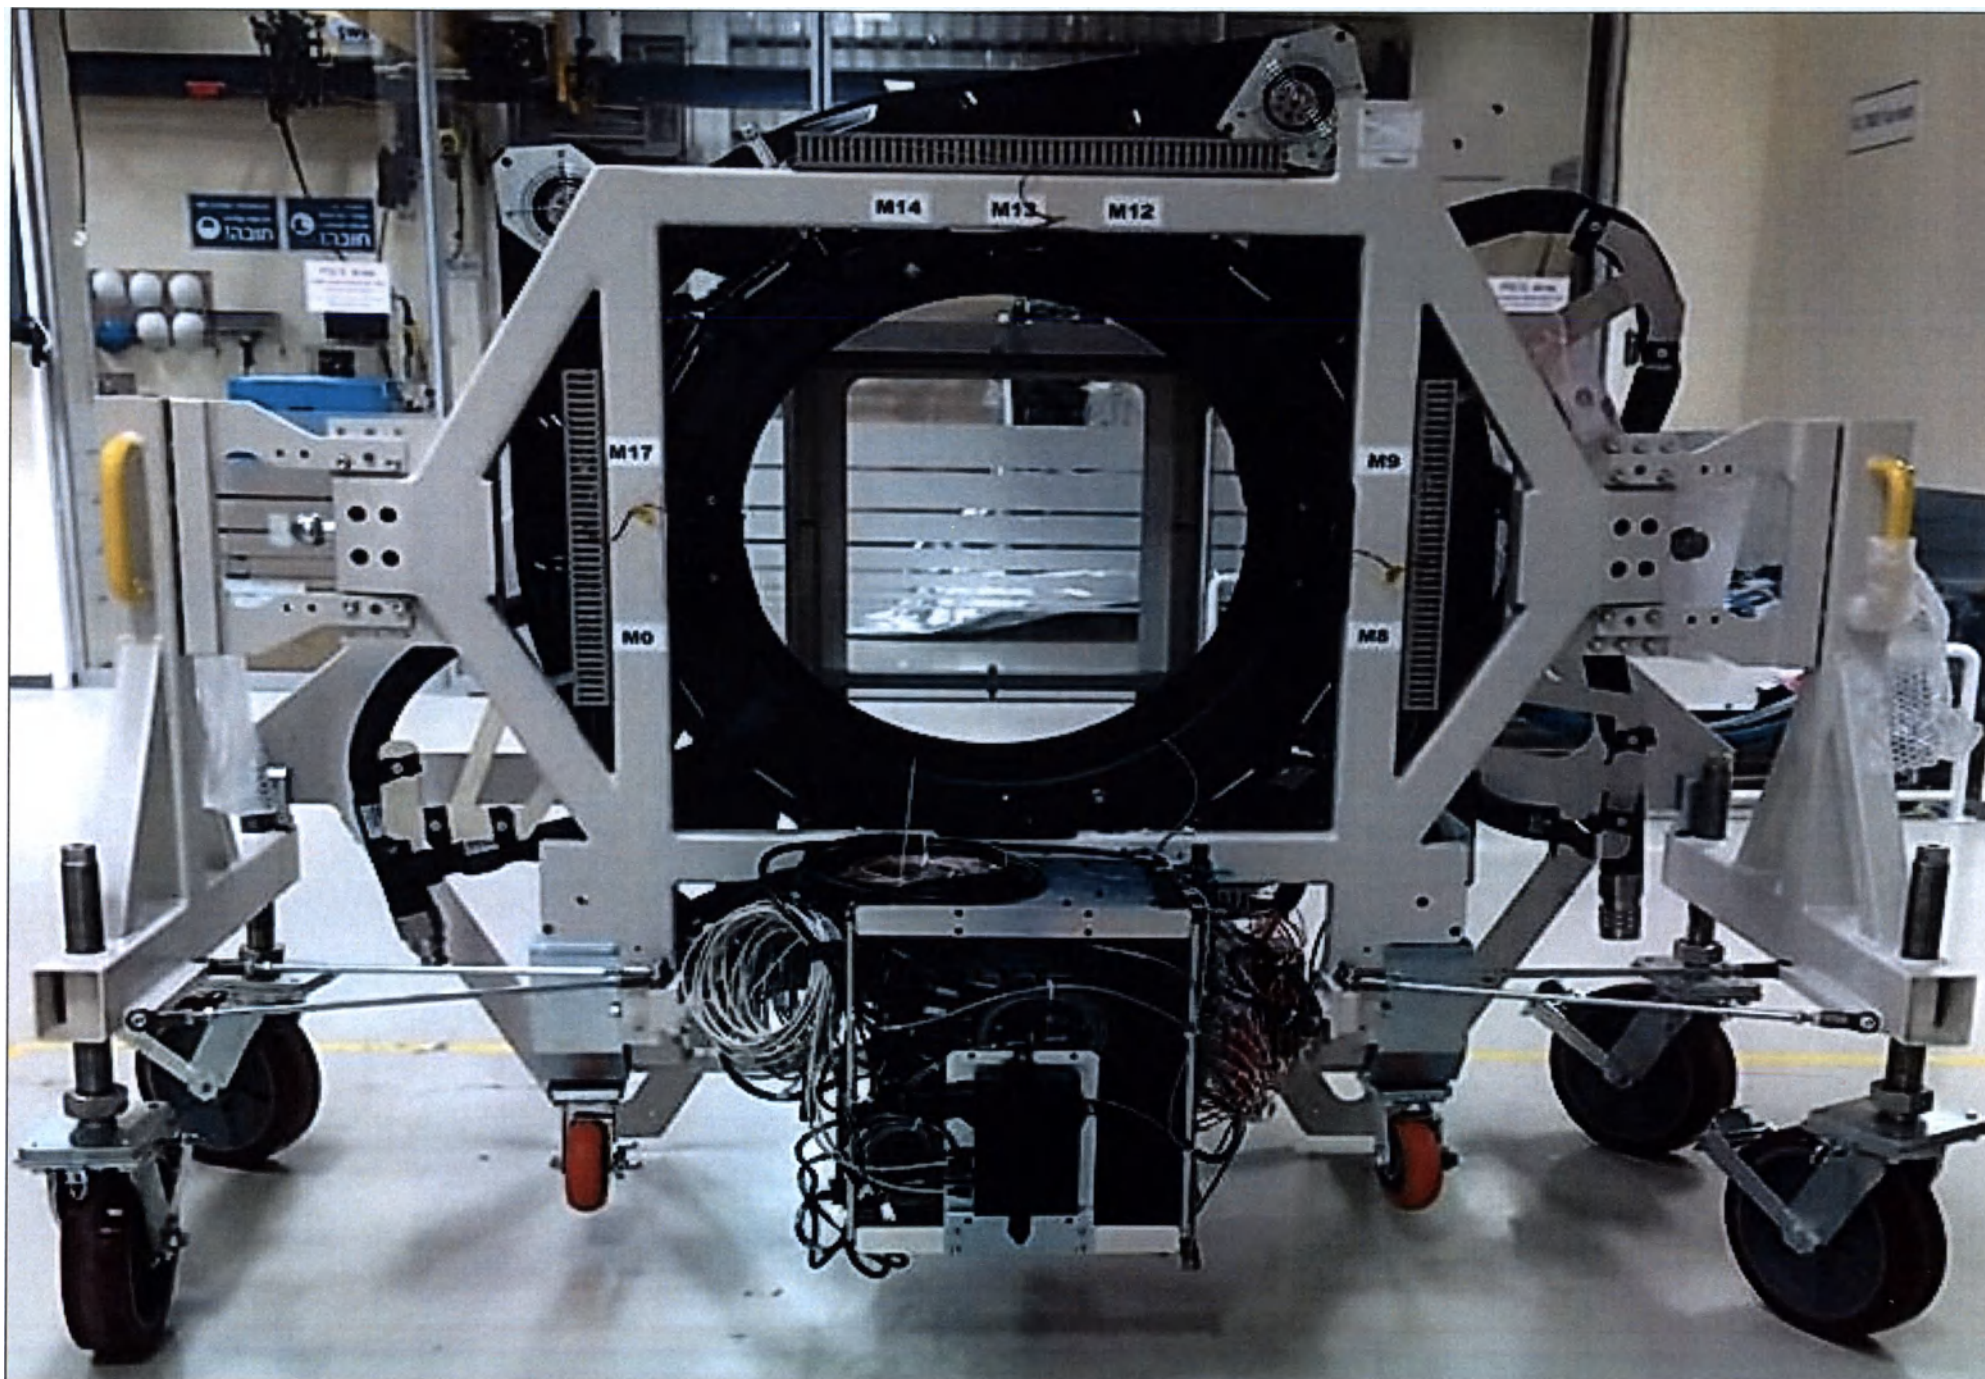


2а. Гентри ПЭТ/КТ встроенный (без корпуса).

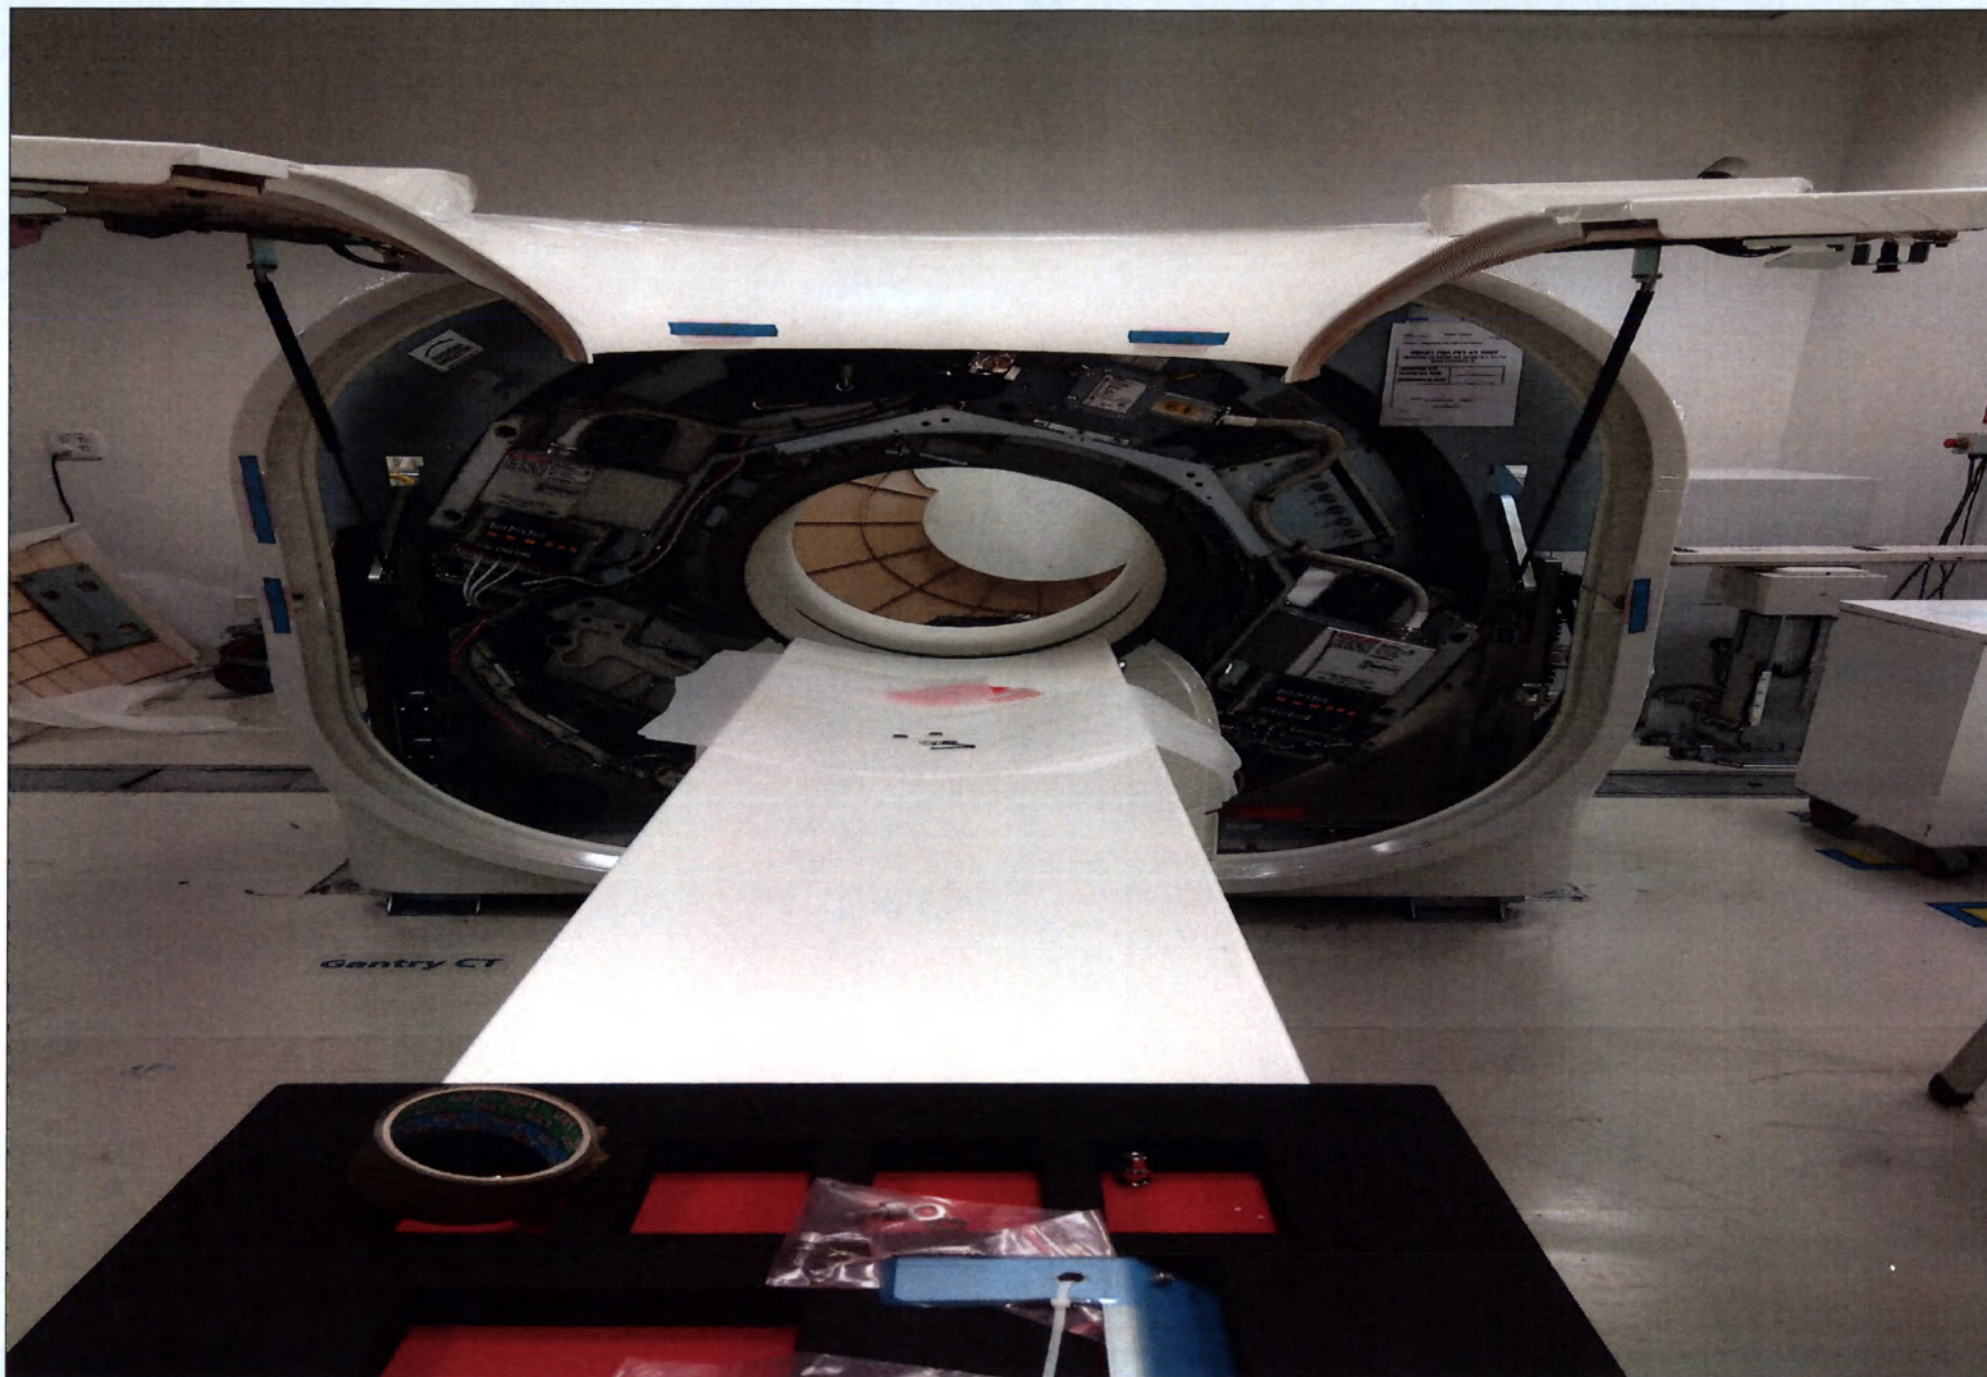


2б. Гентри ПЭТ/КТ встроенный (без корпуса).

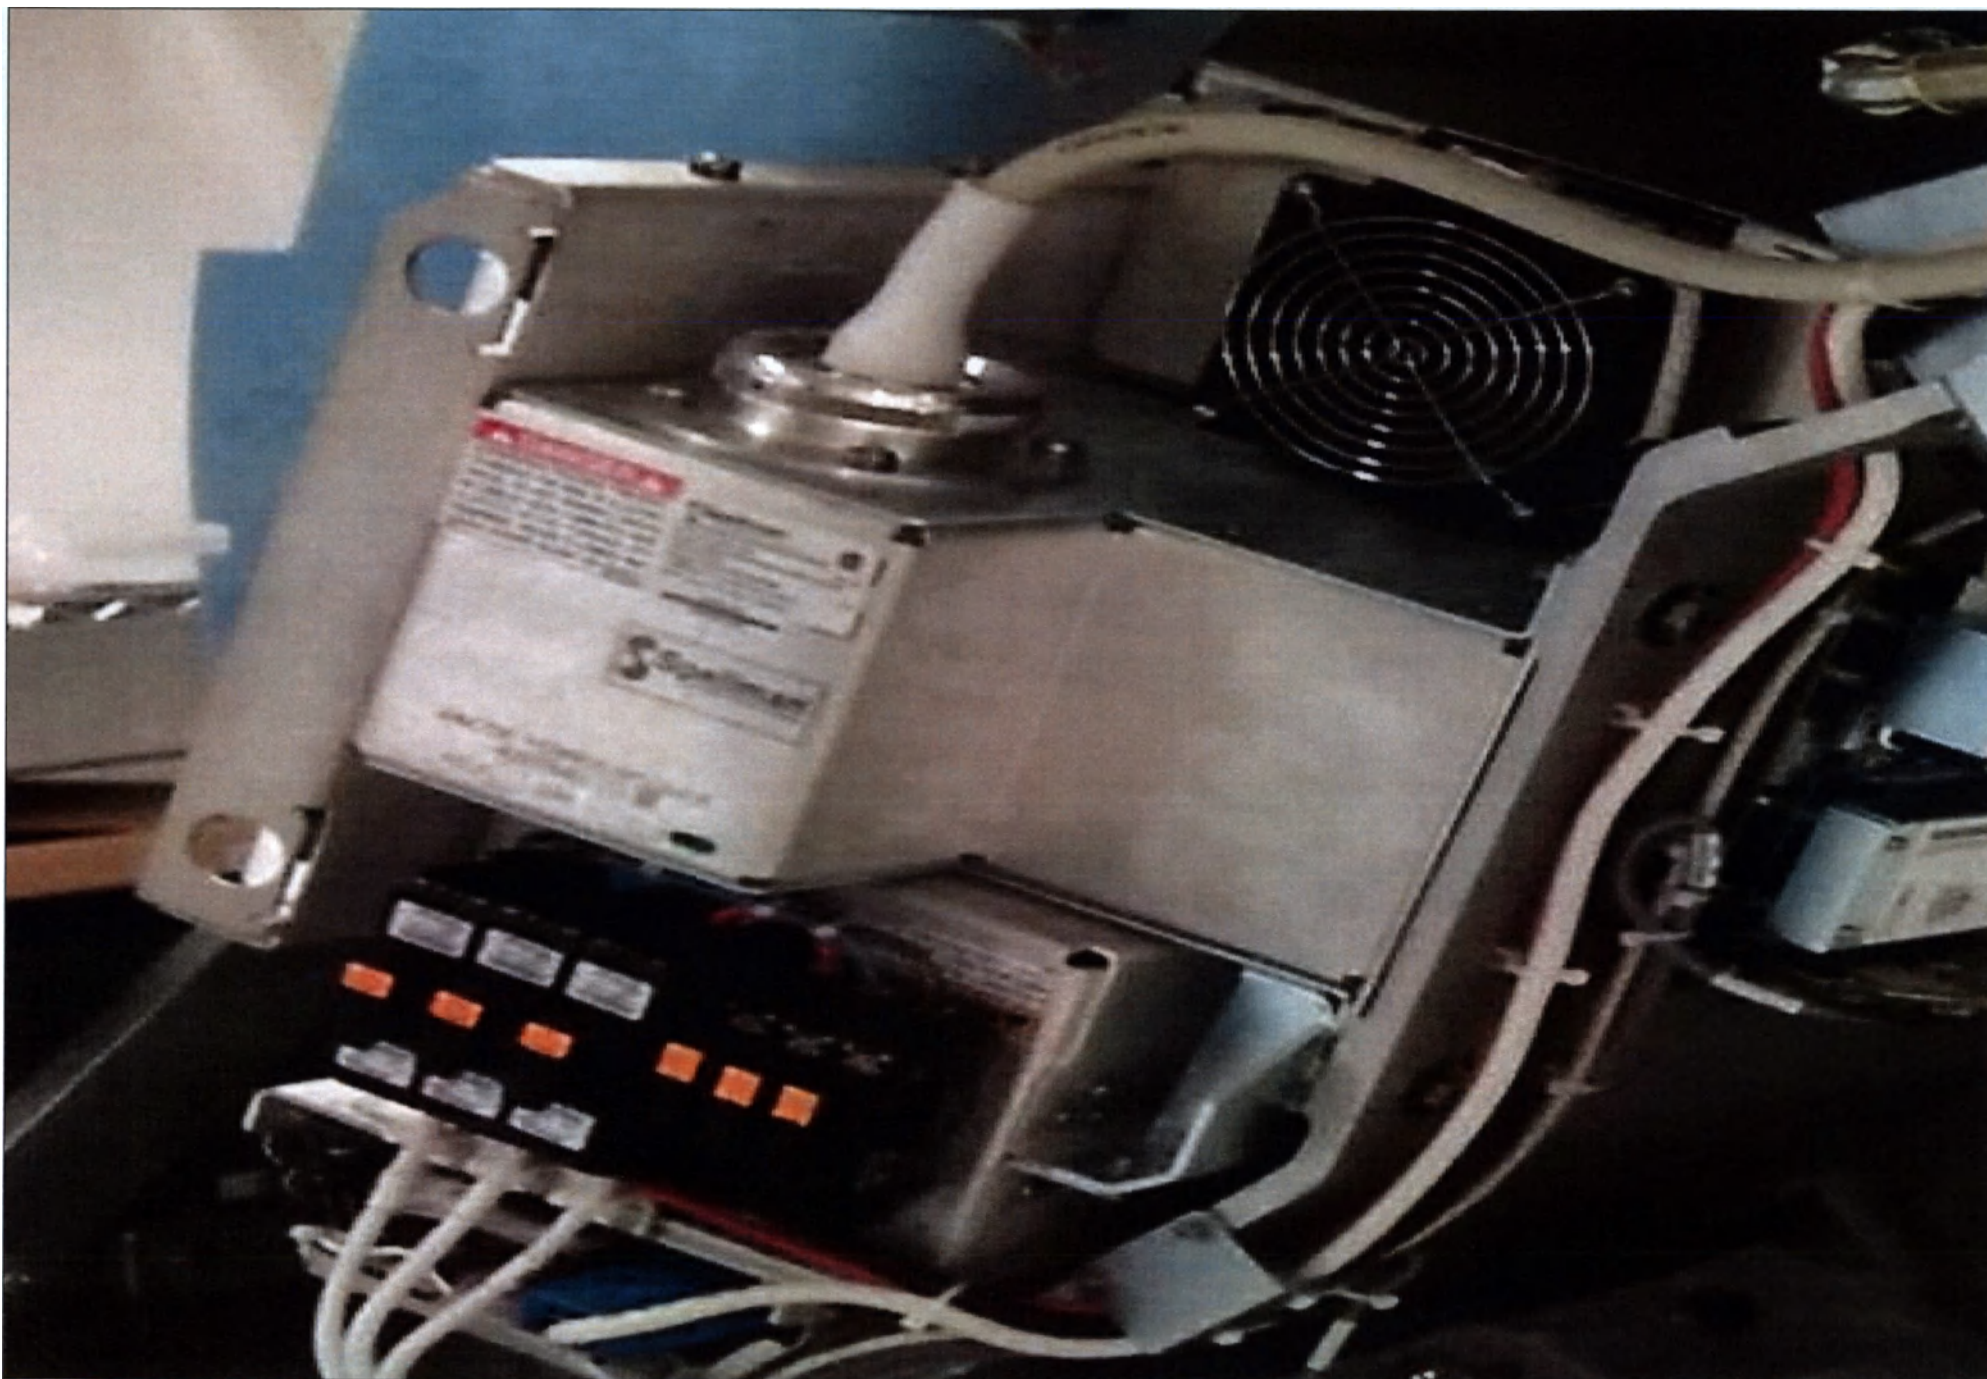

3. Генератор

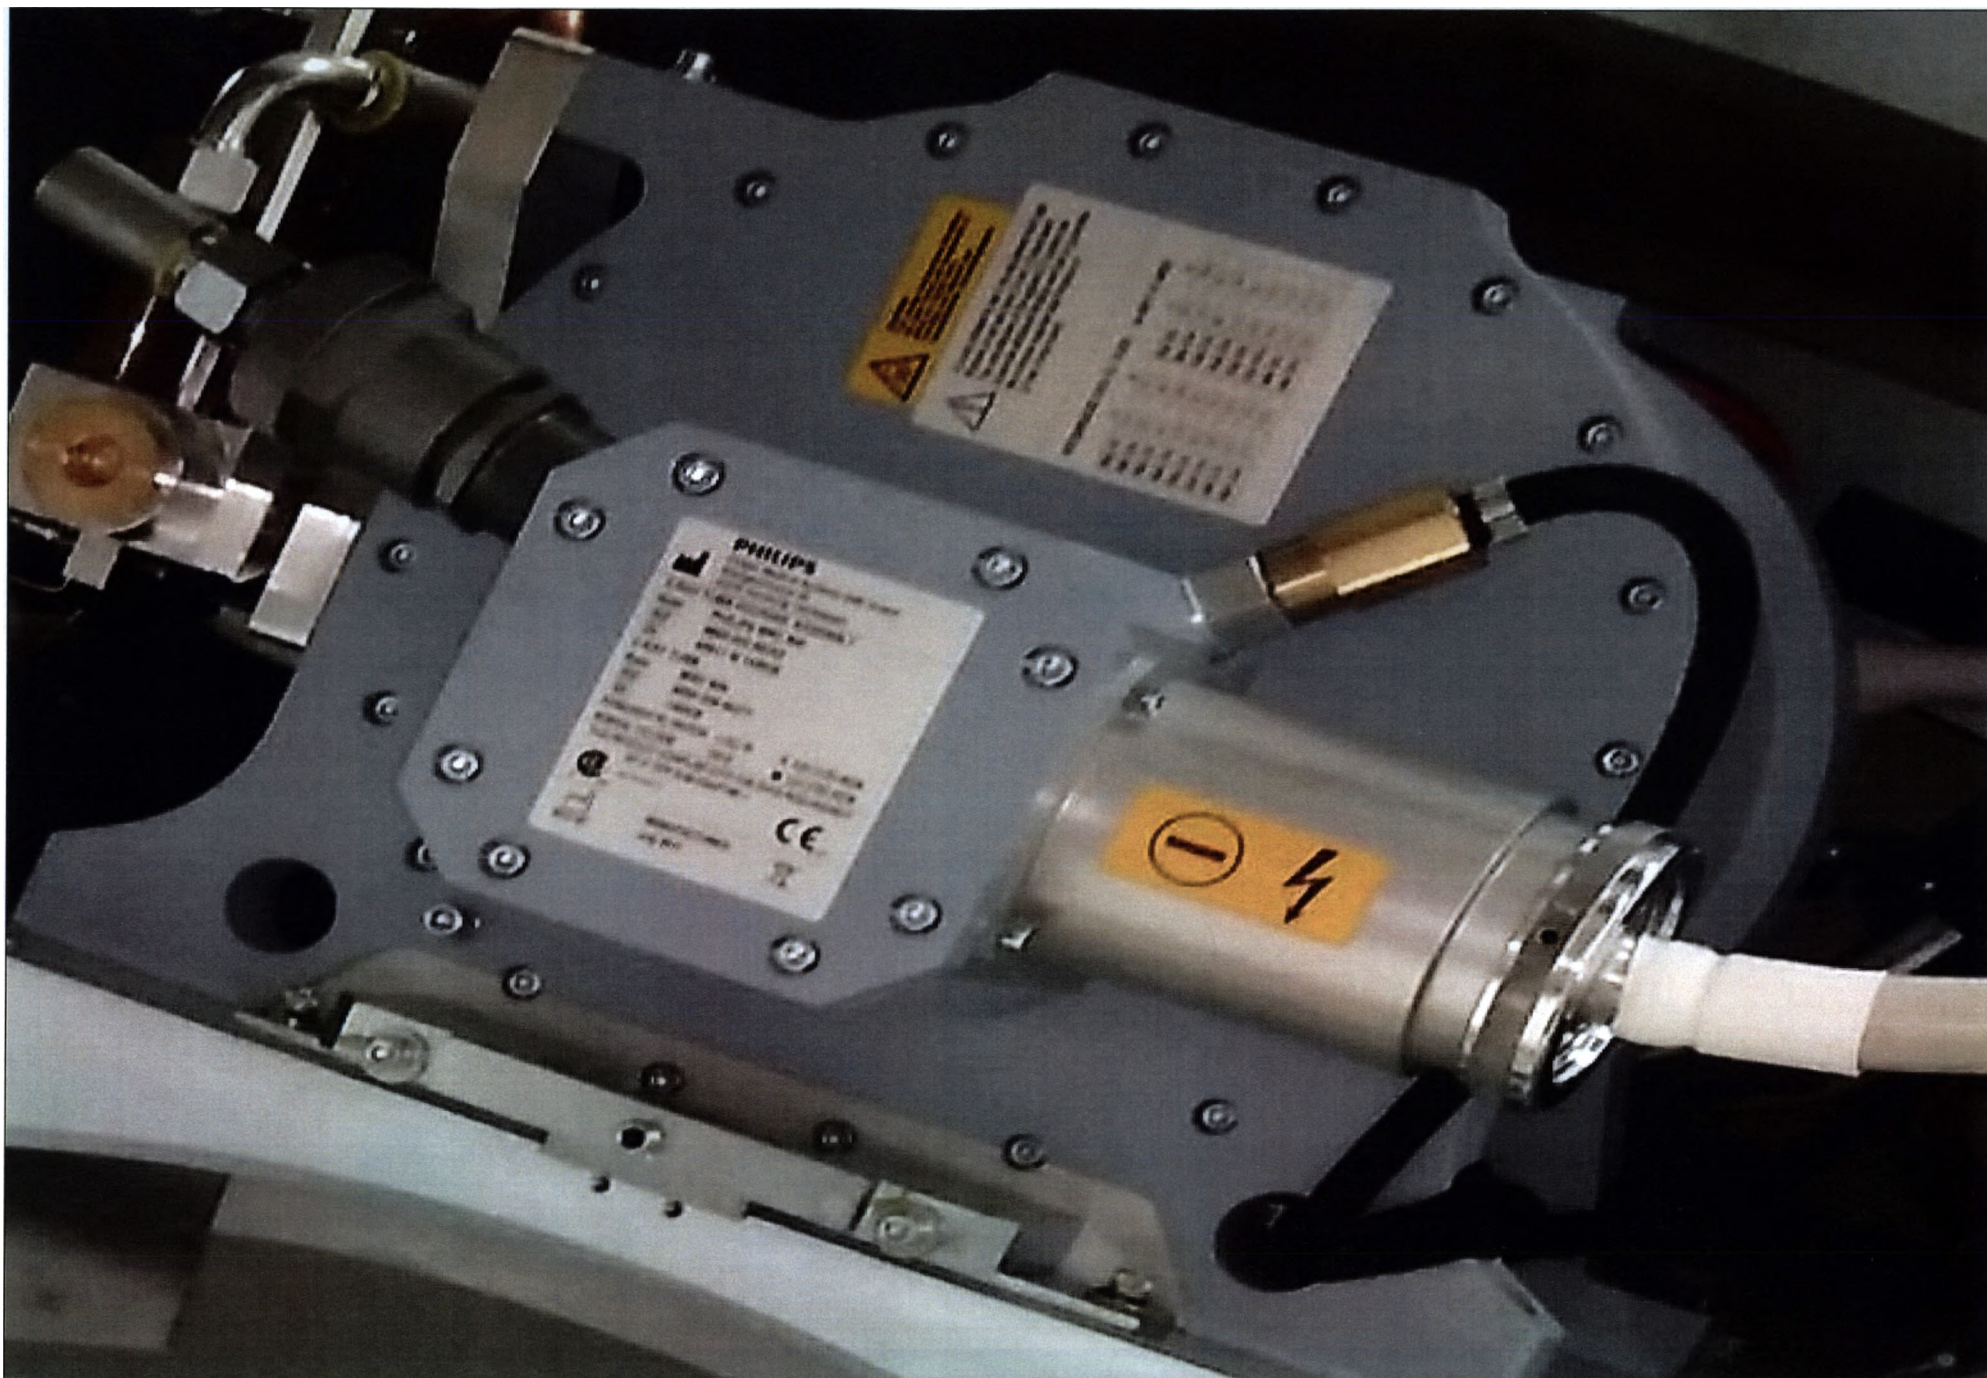


4. Рентгеновская трубка.

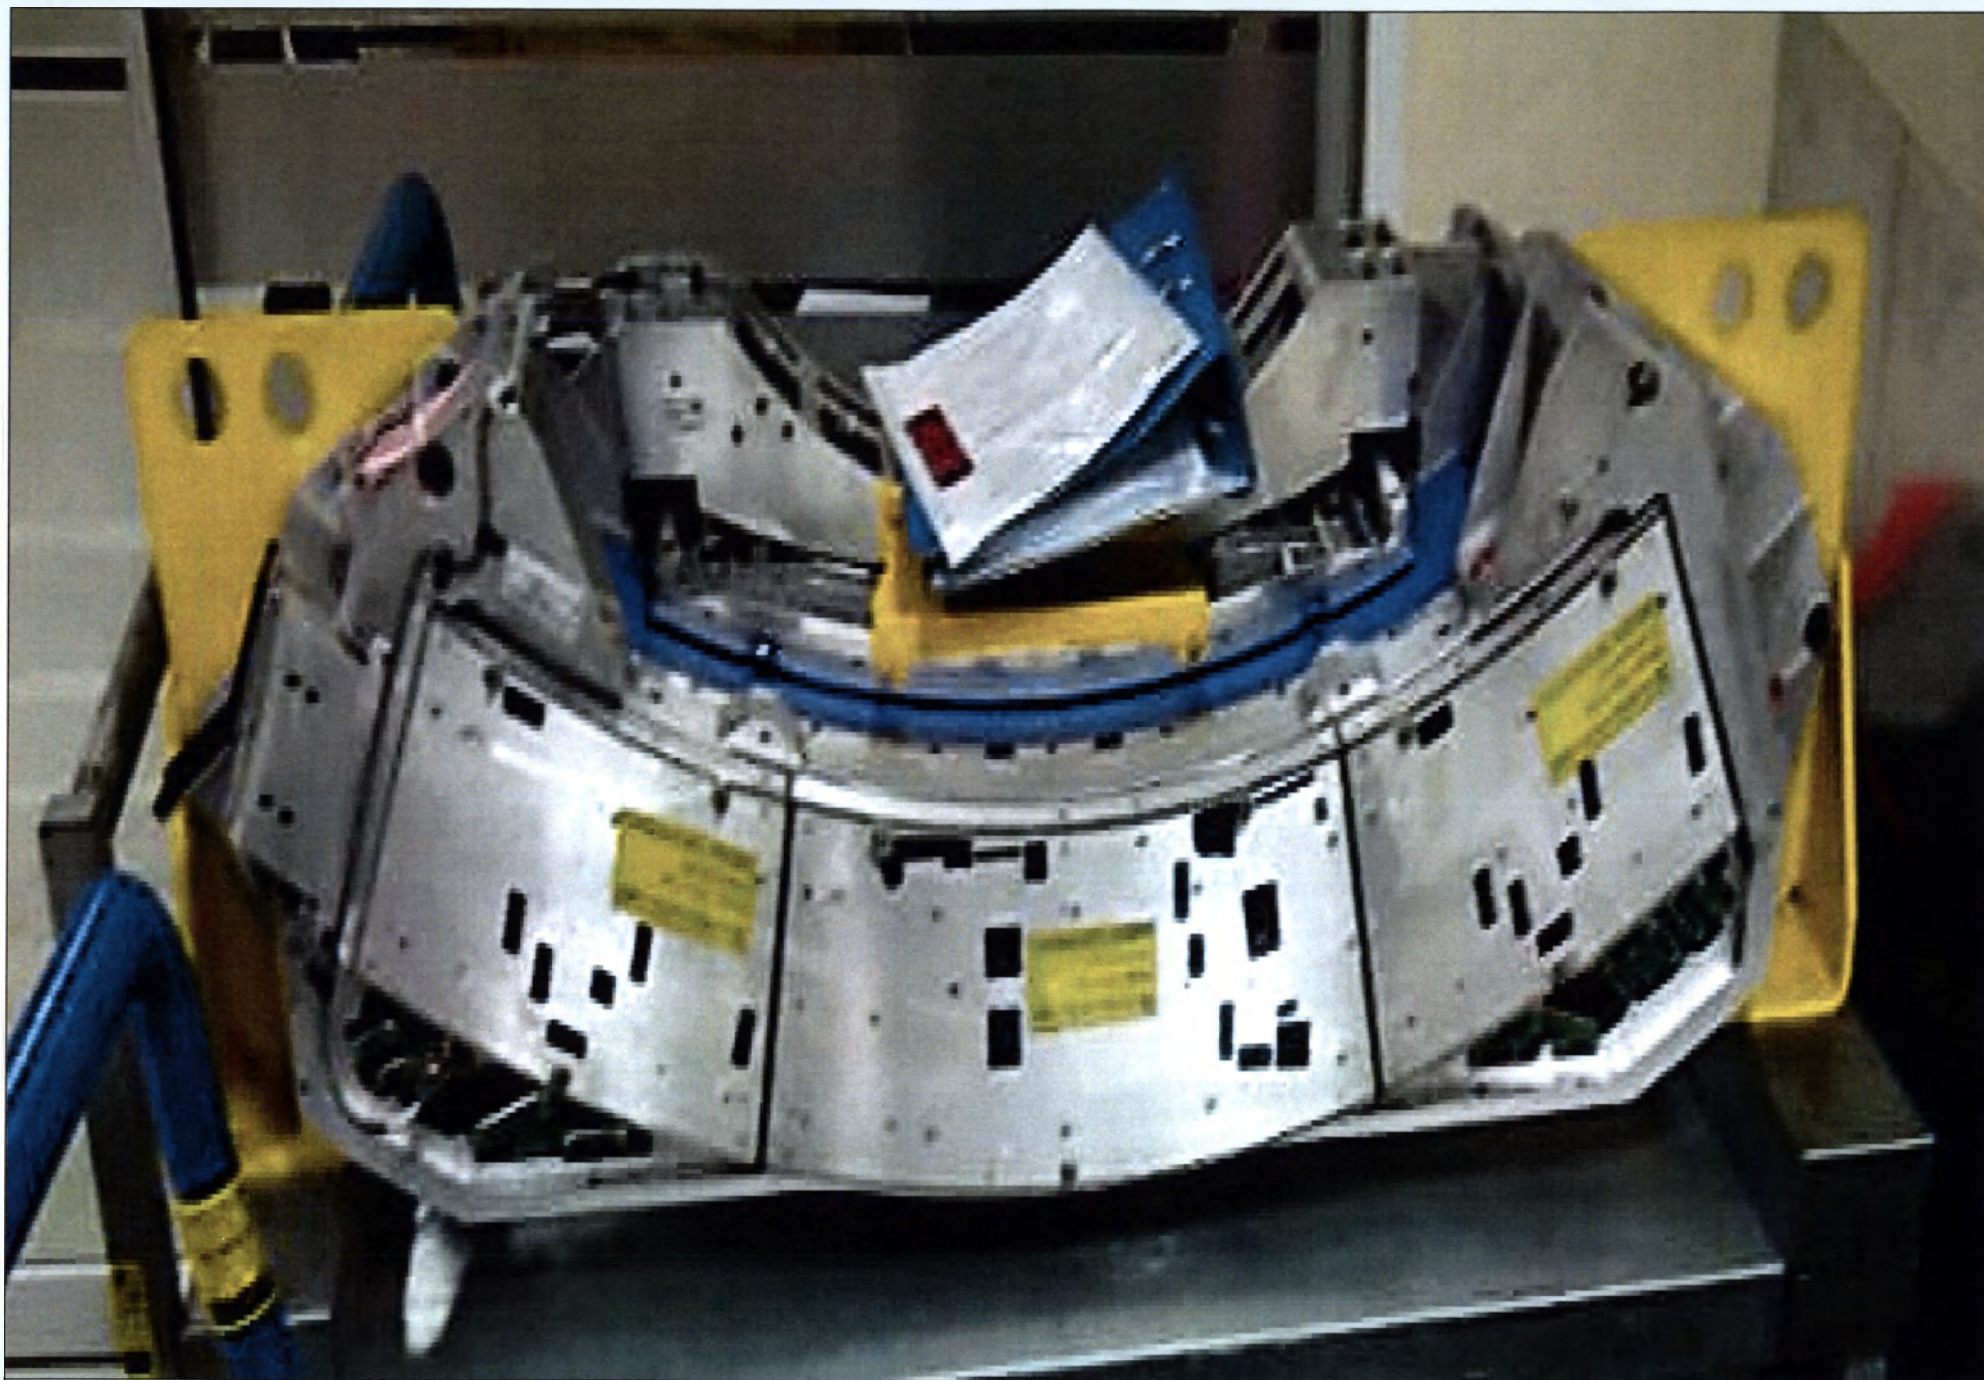


5а. Детектор КТ



5б. Детектор КТ

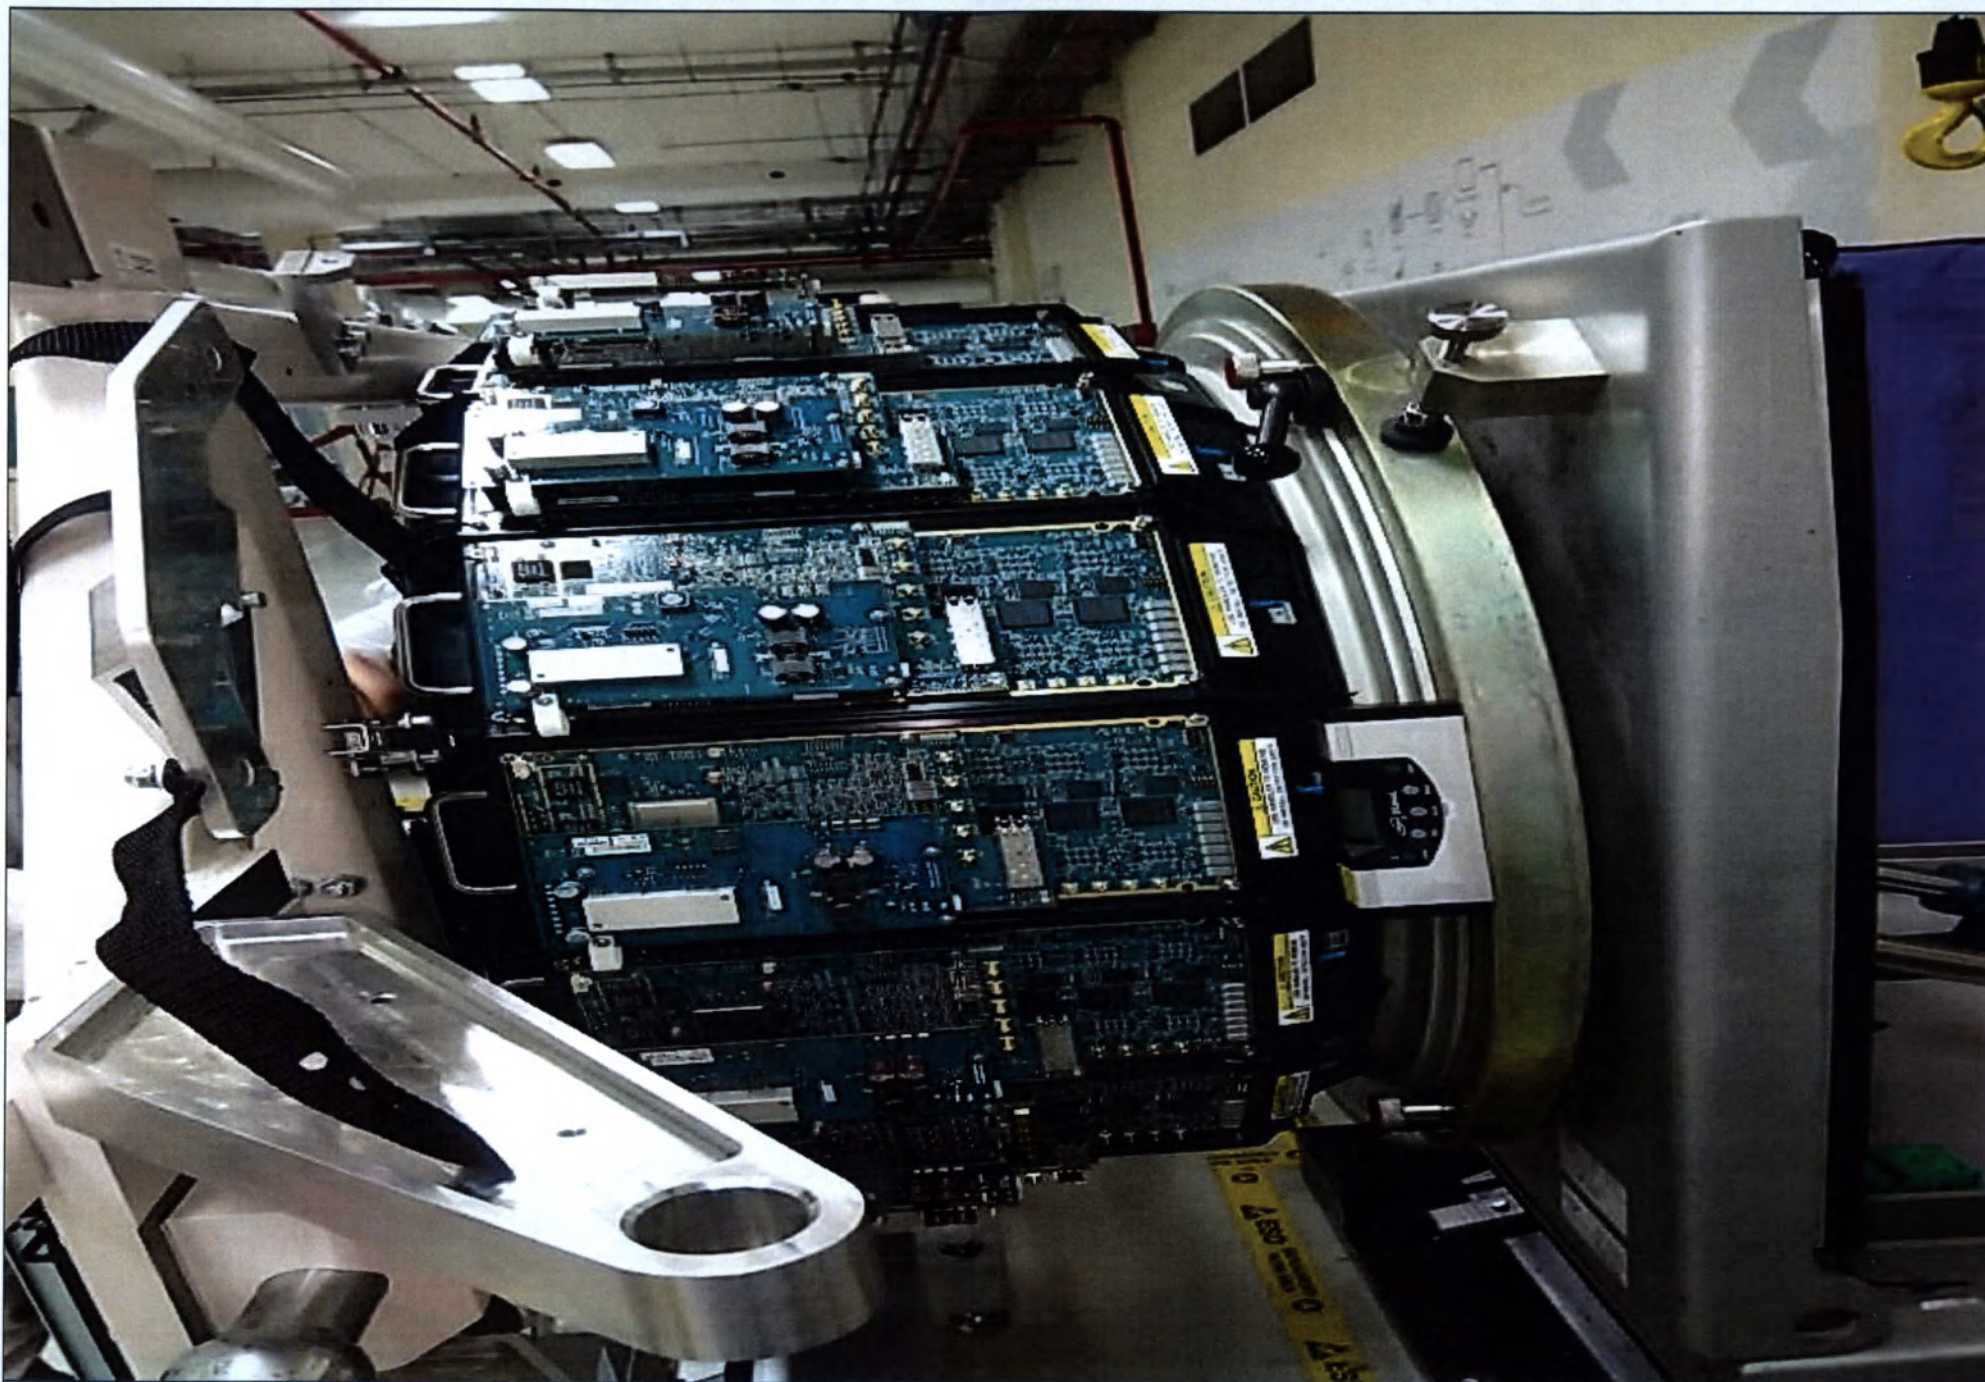


6а. Детектор ПЭТ

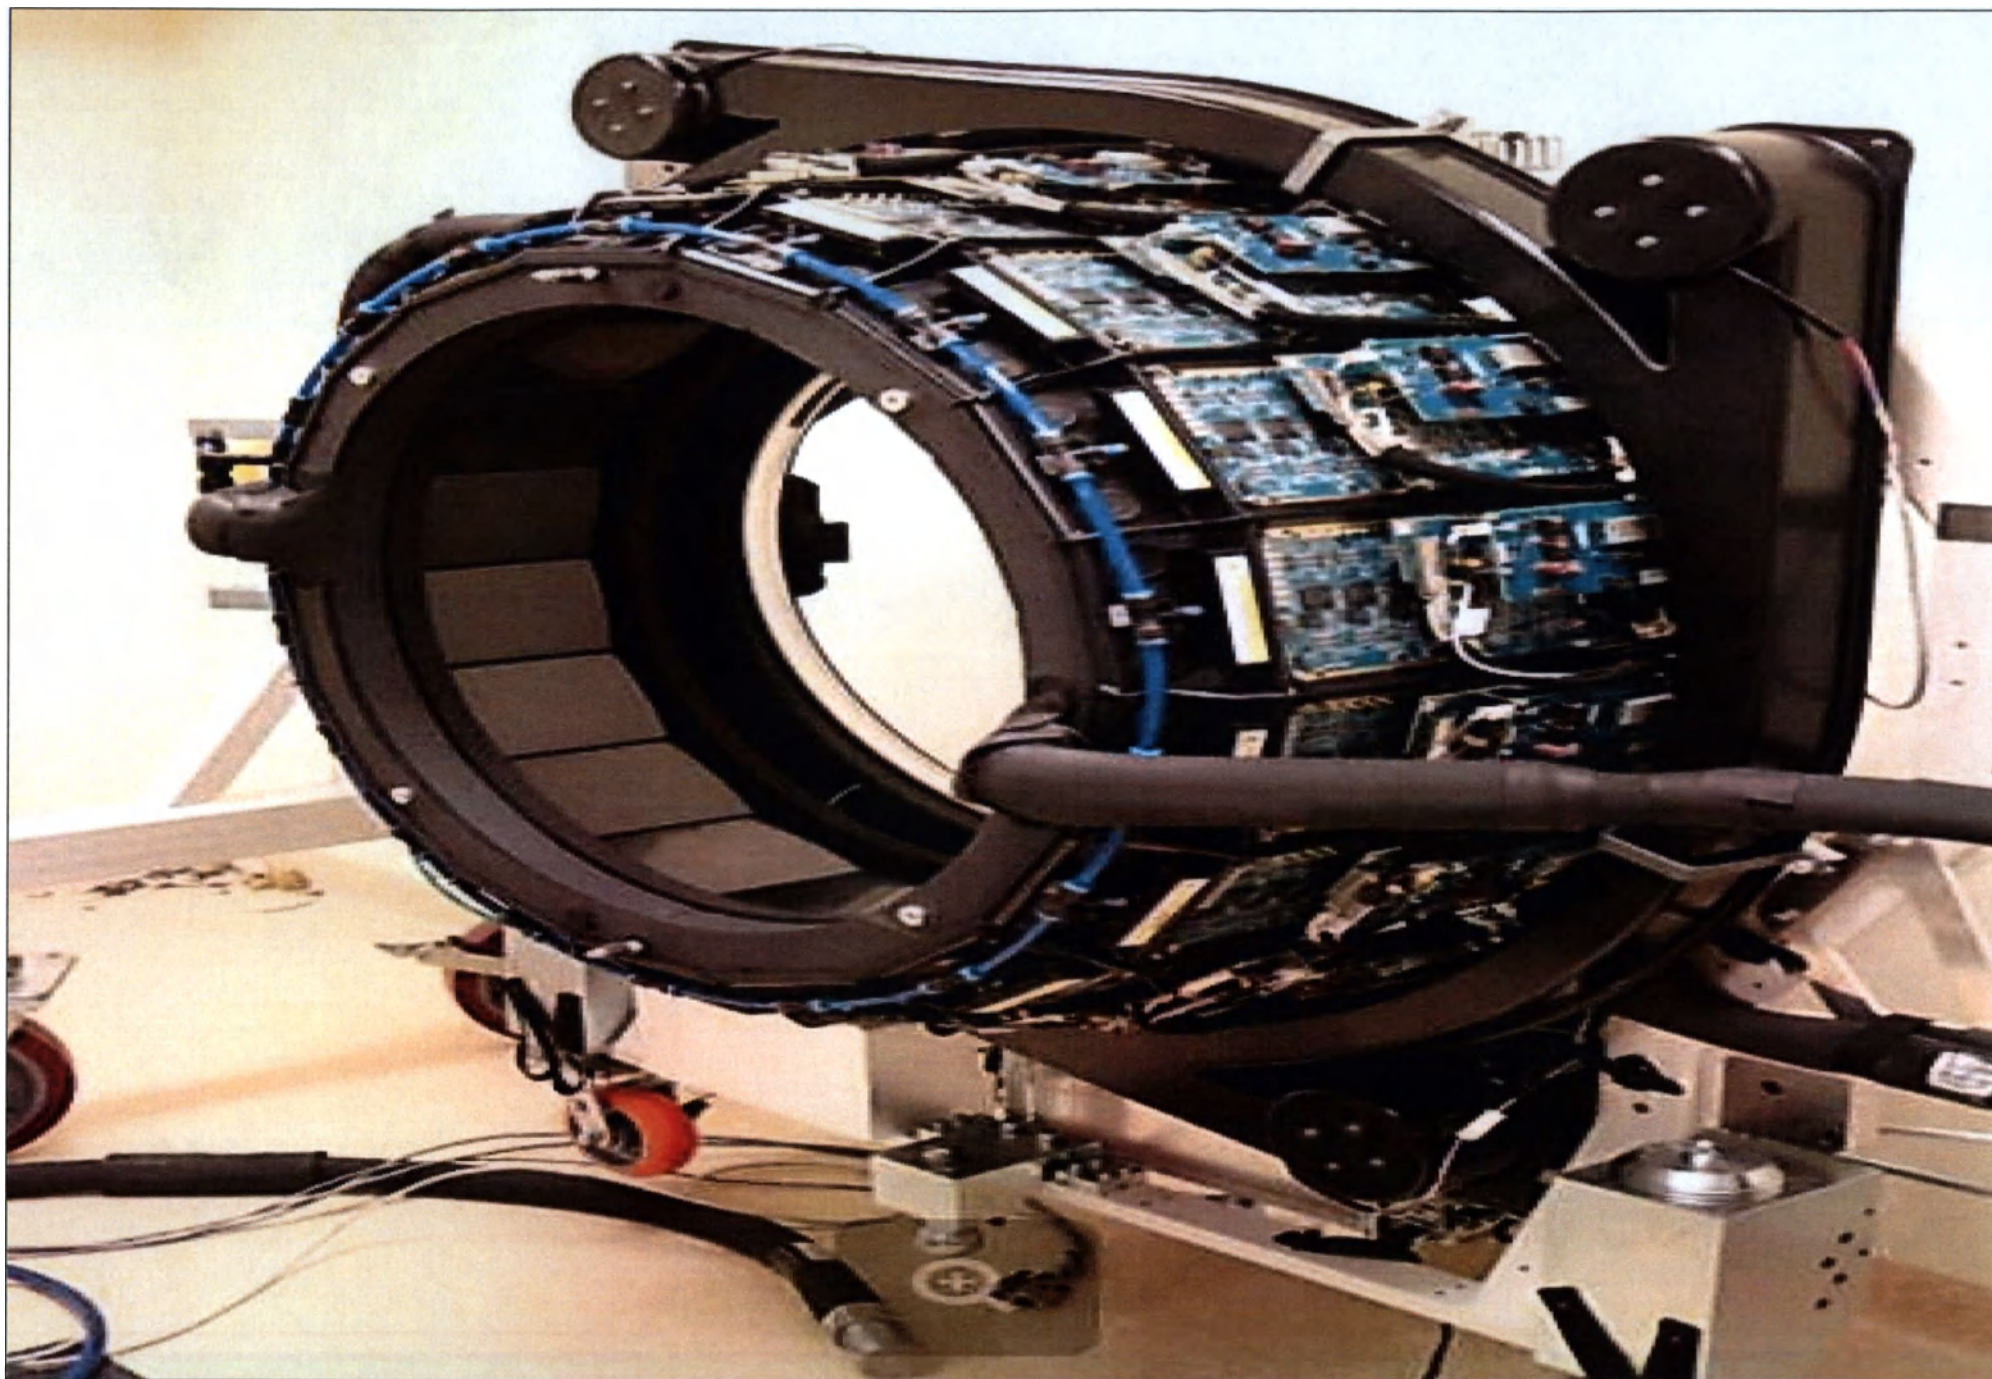


6b. Детектор ПЭТ



7а. Платы управления

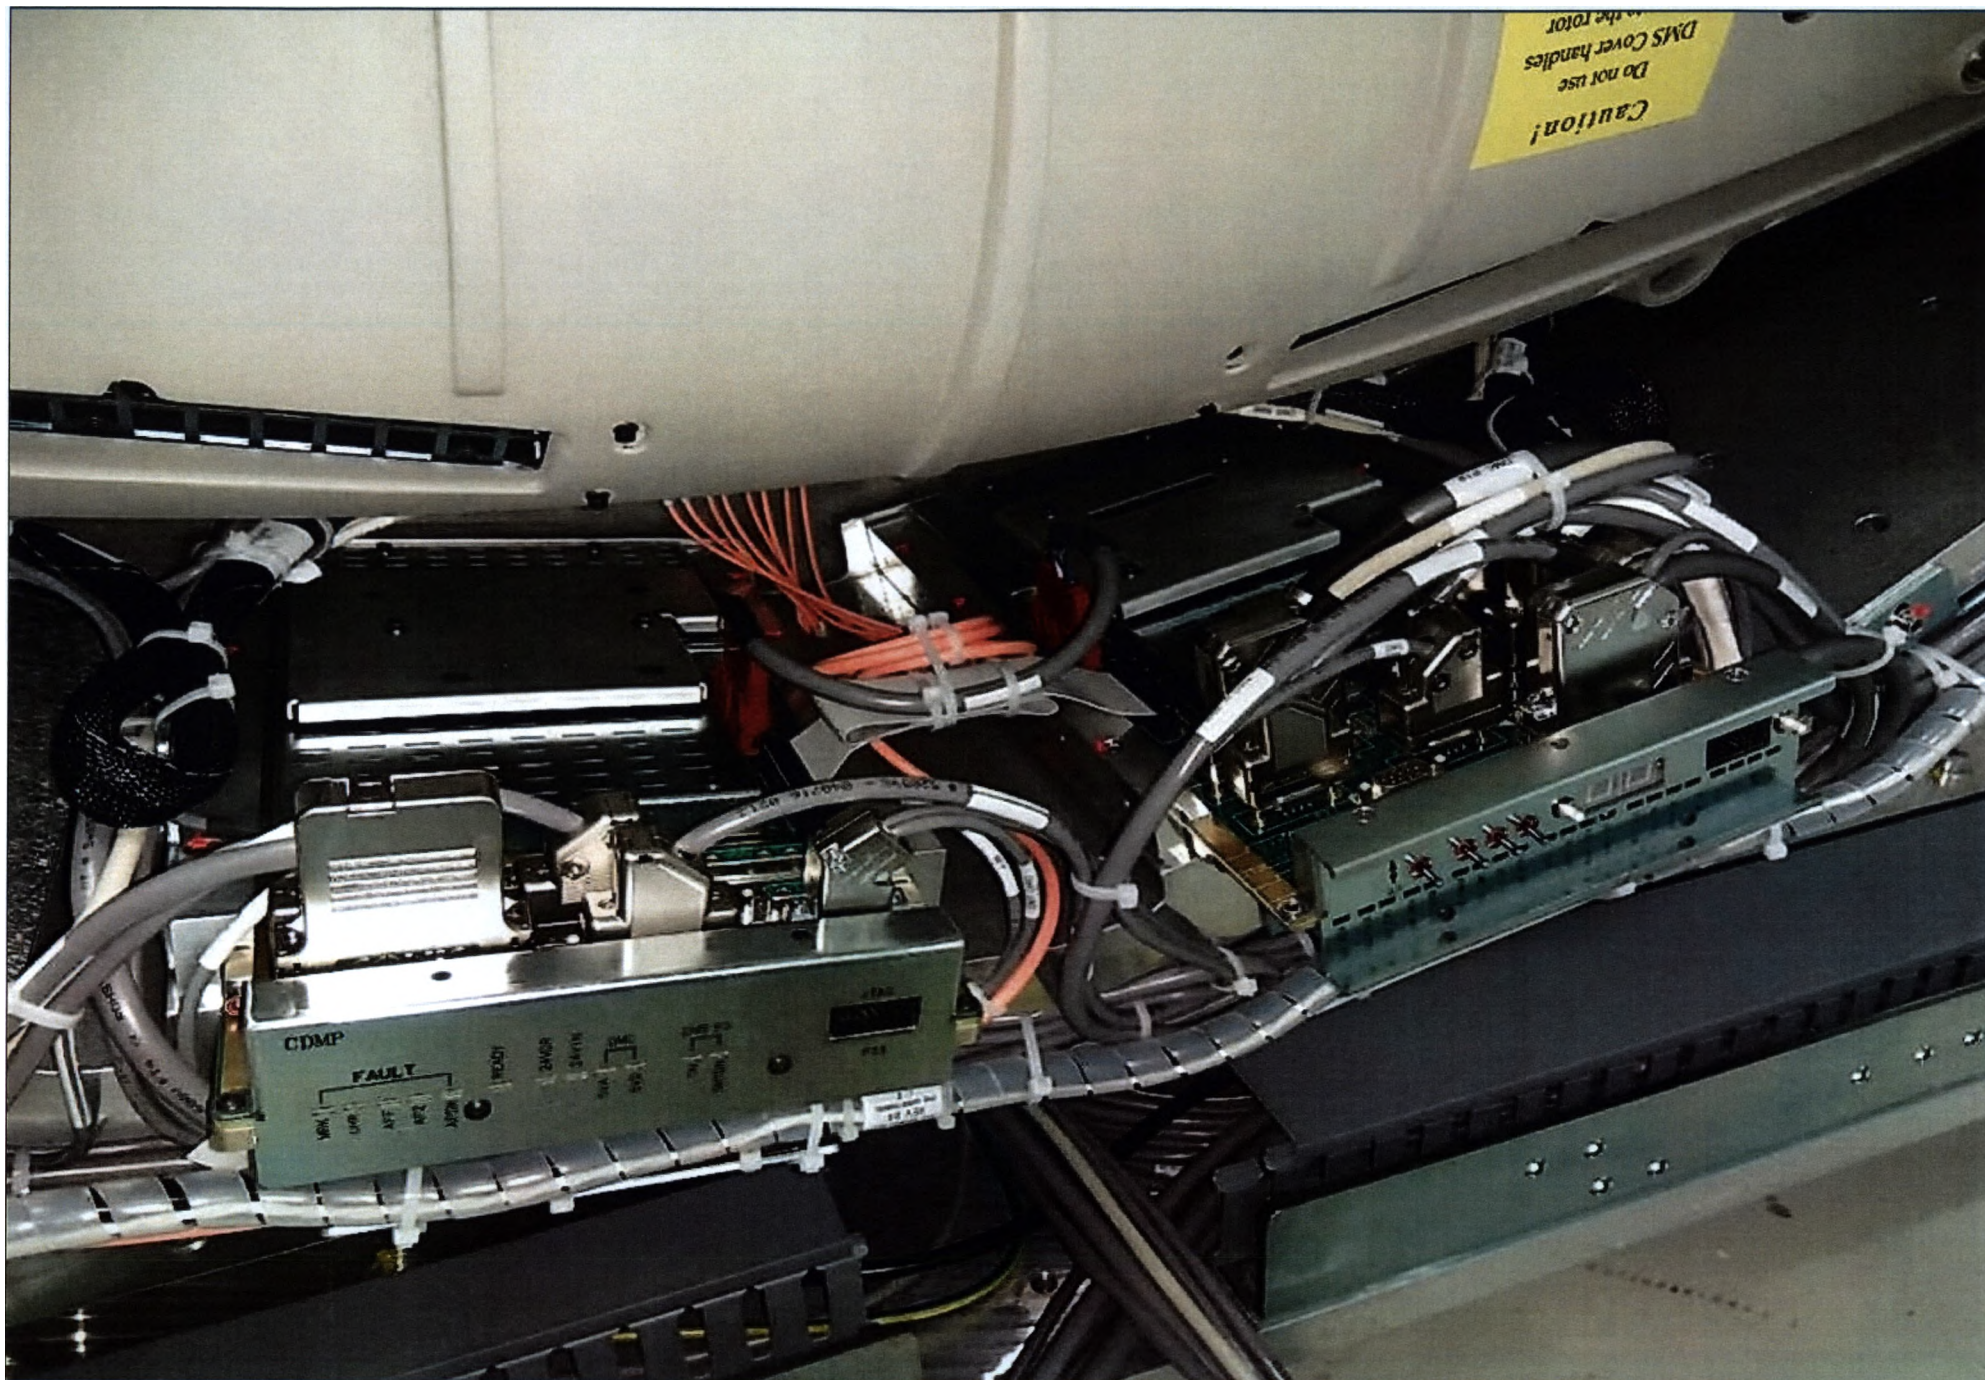


7b. Платы управления

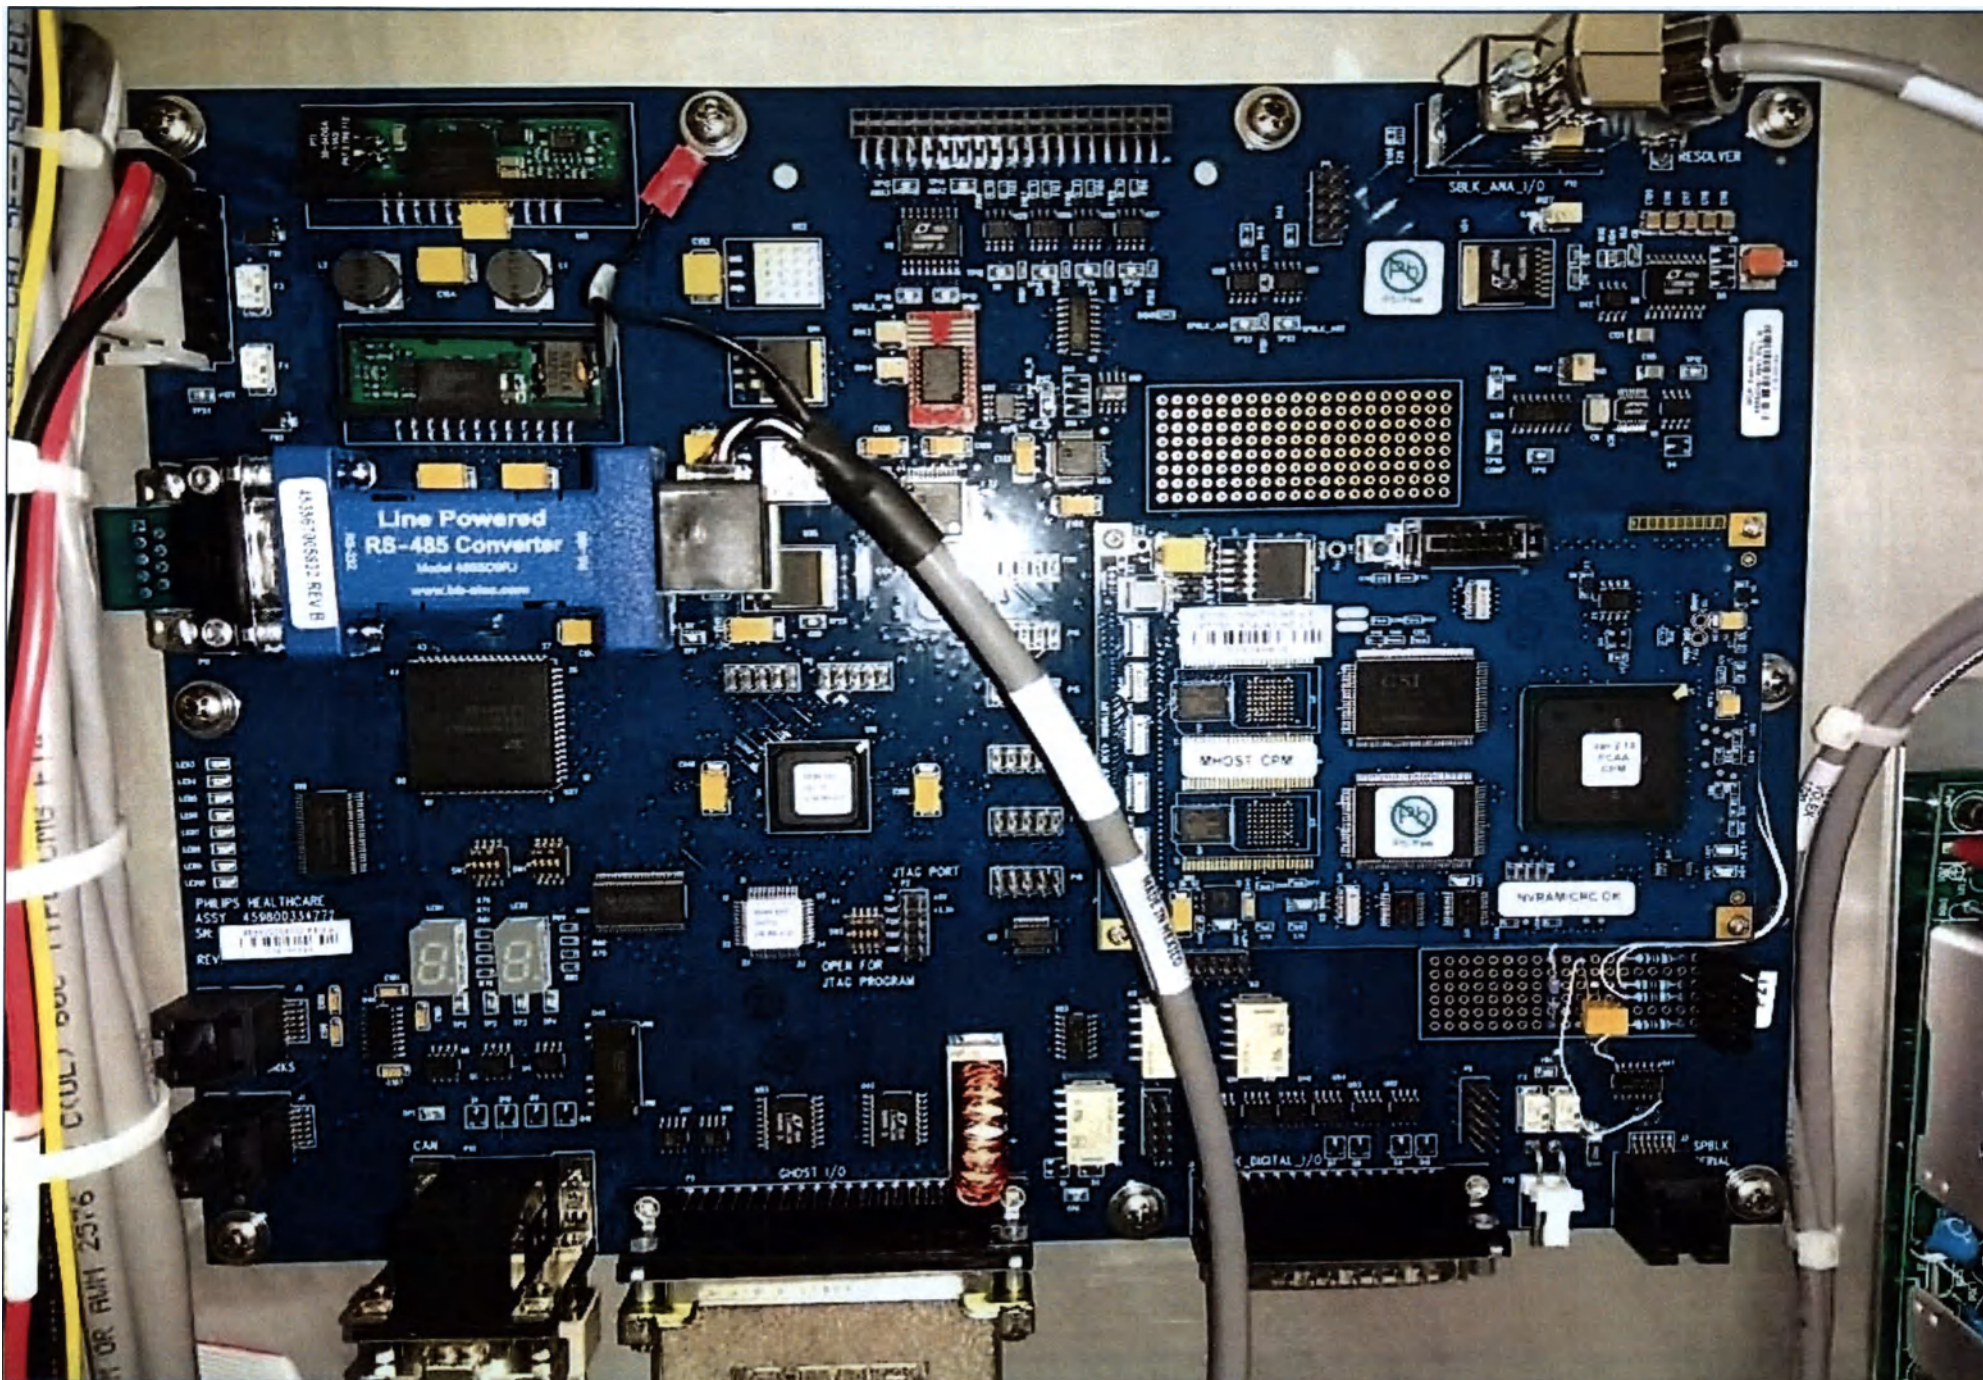


7с. Платы управления




8а. Блок реконструкции.

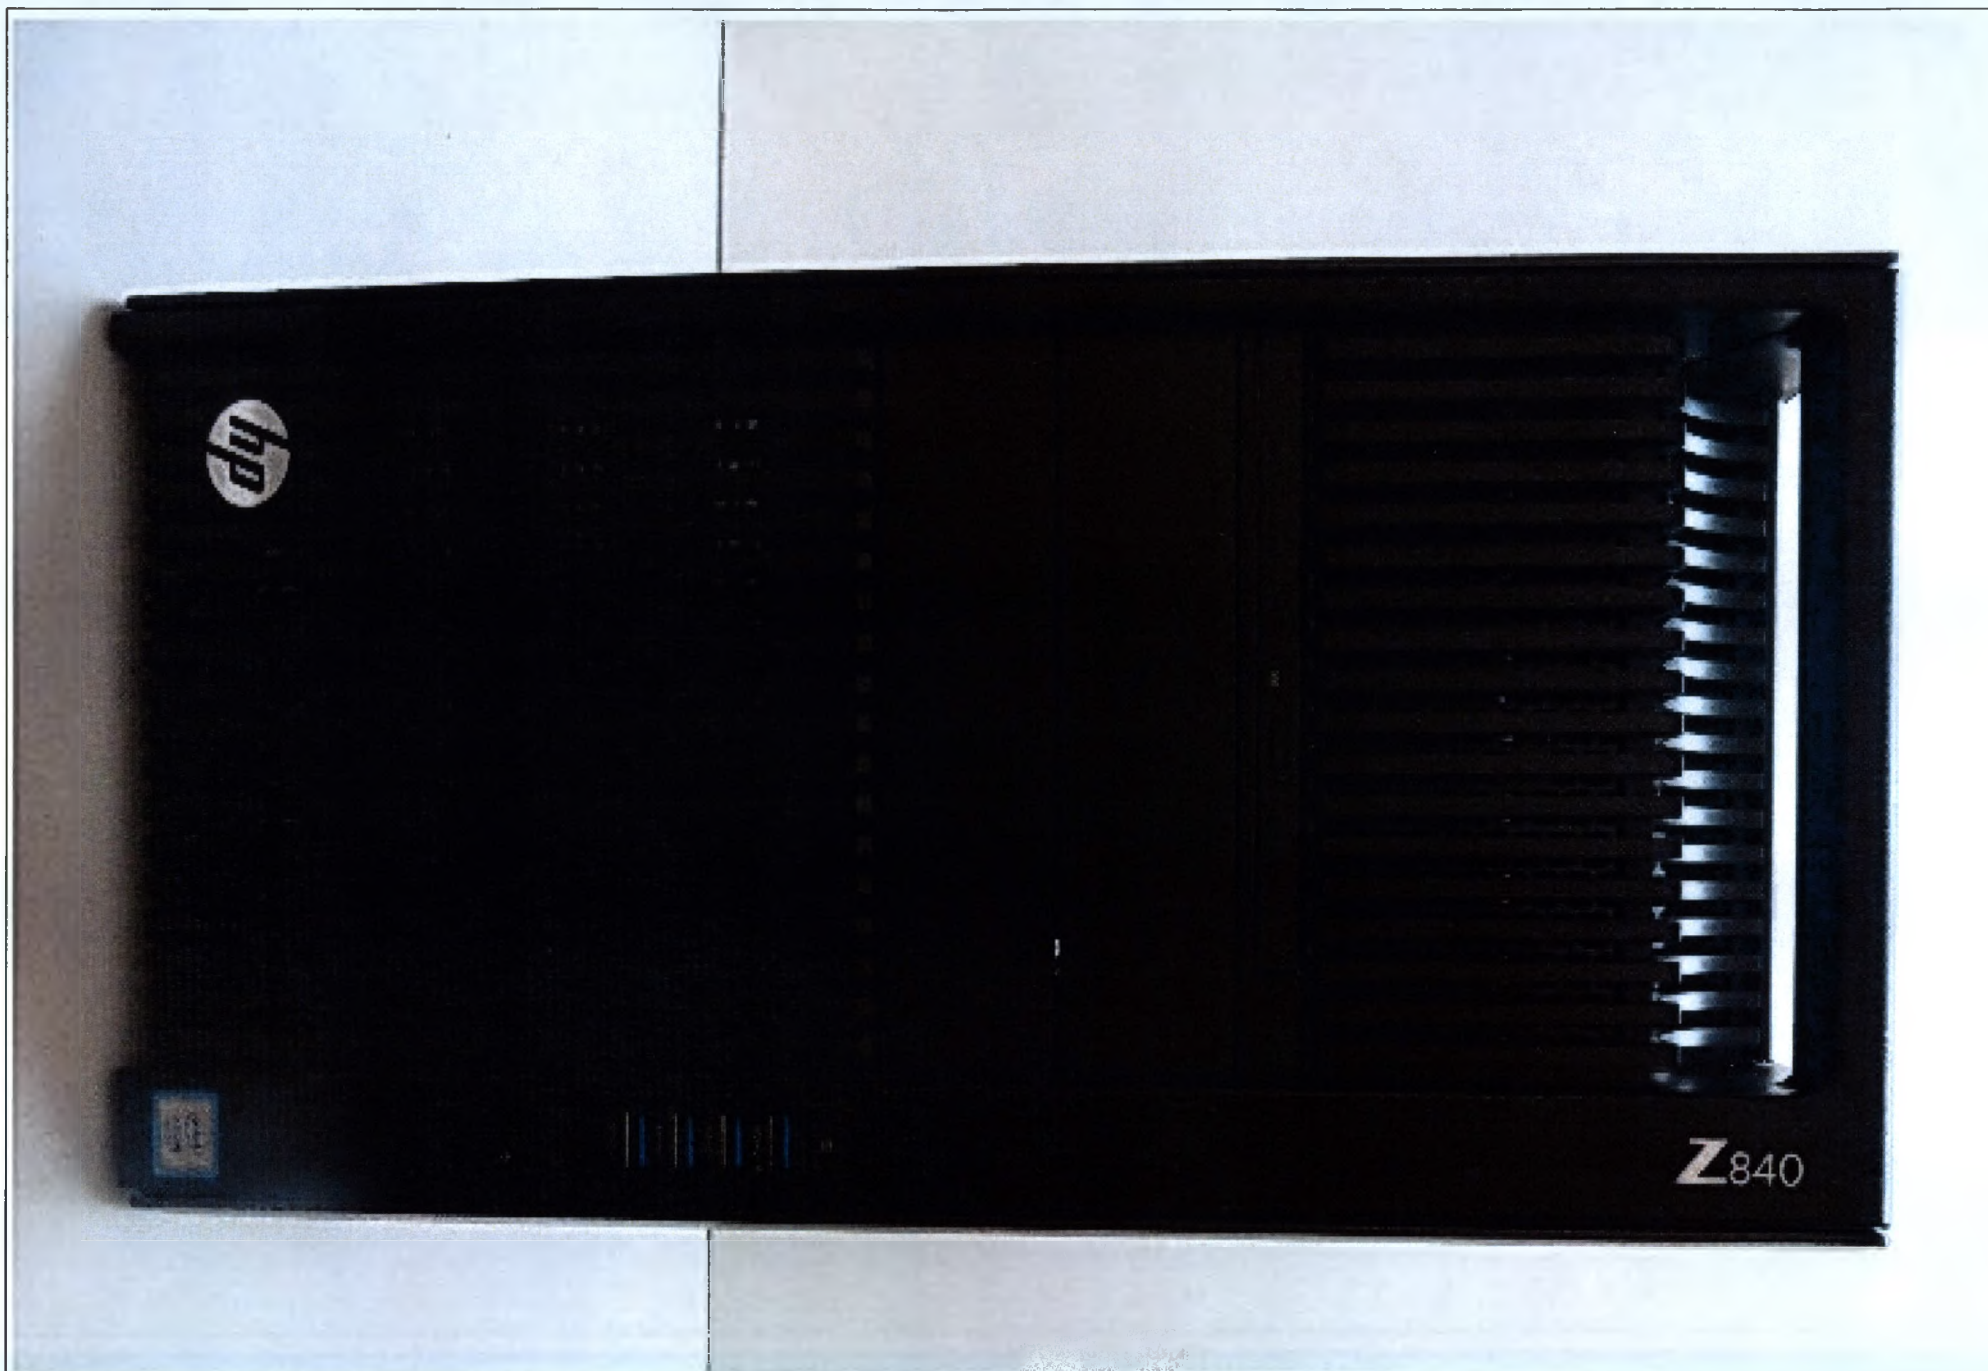


8в. Блок реконструкции.

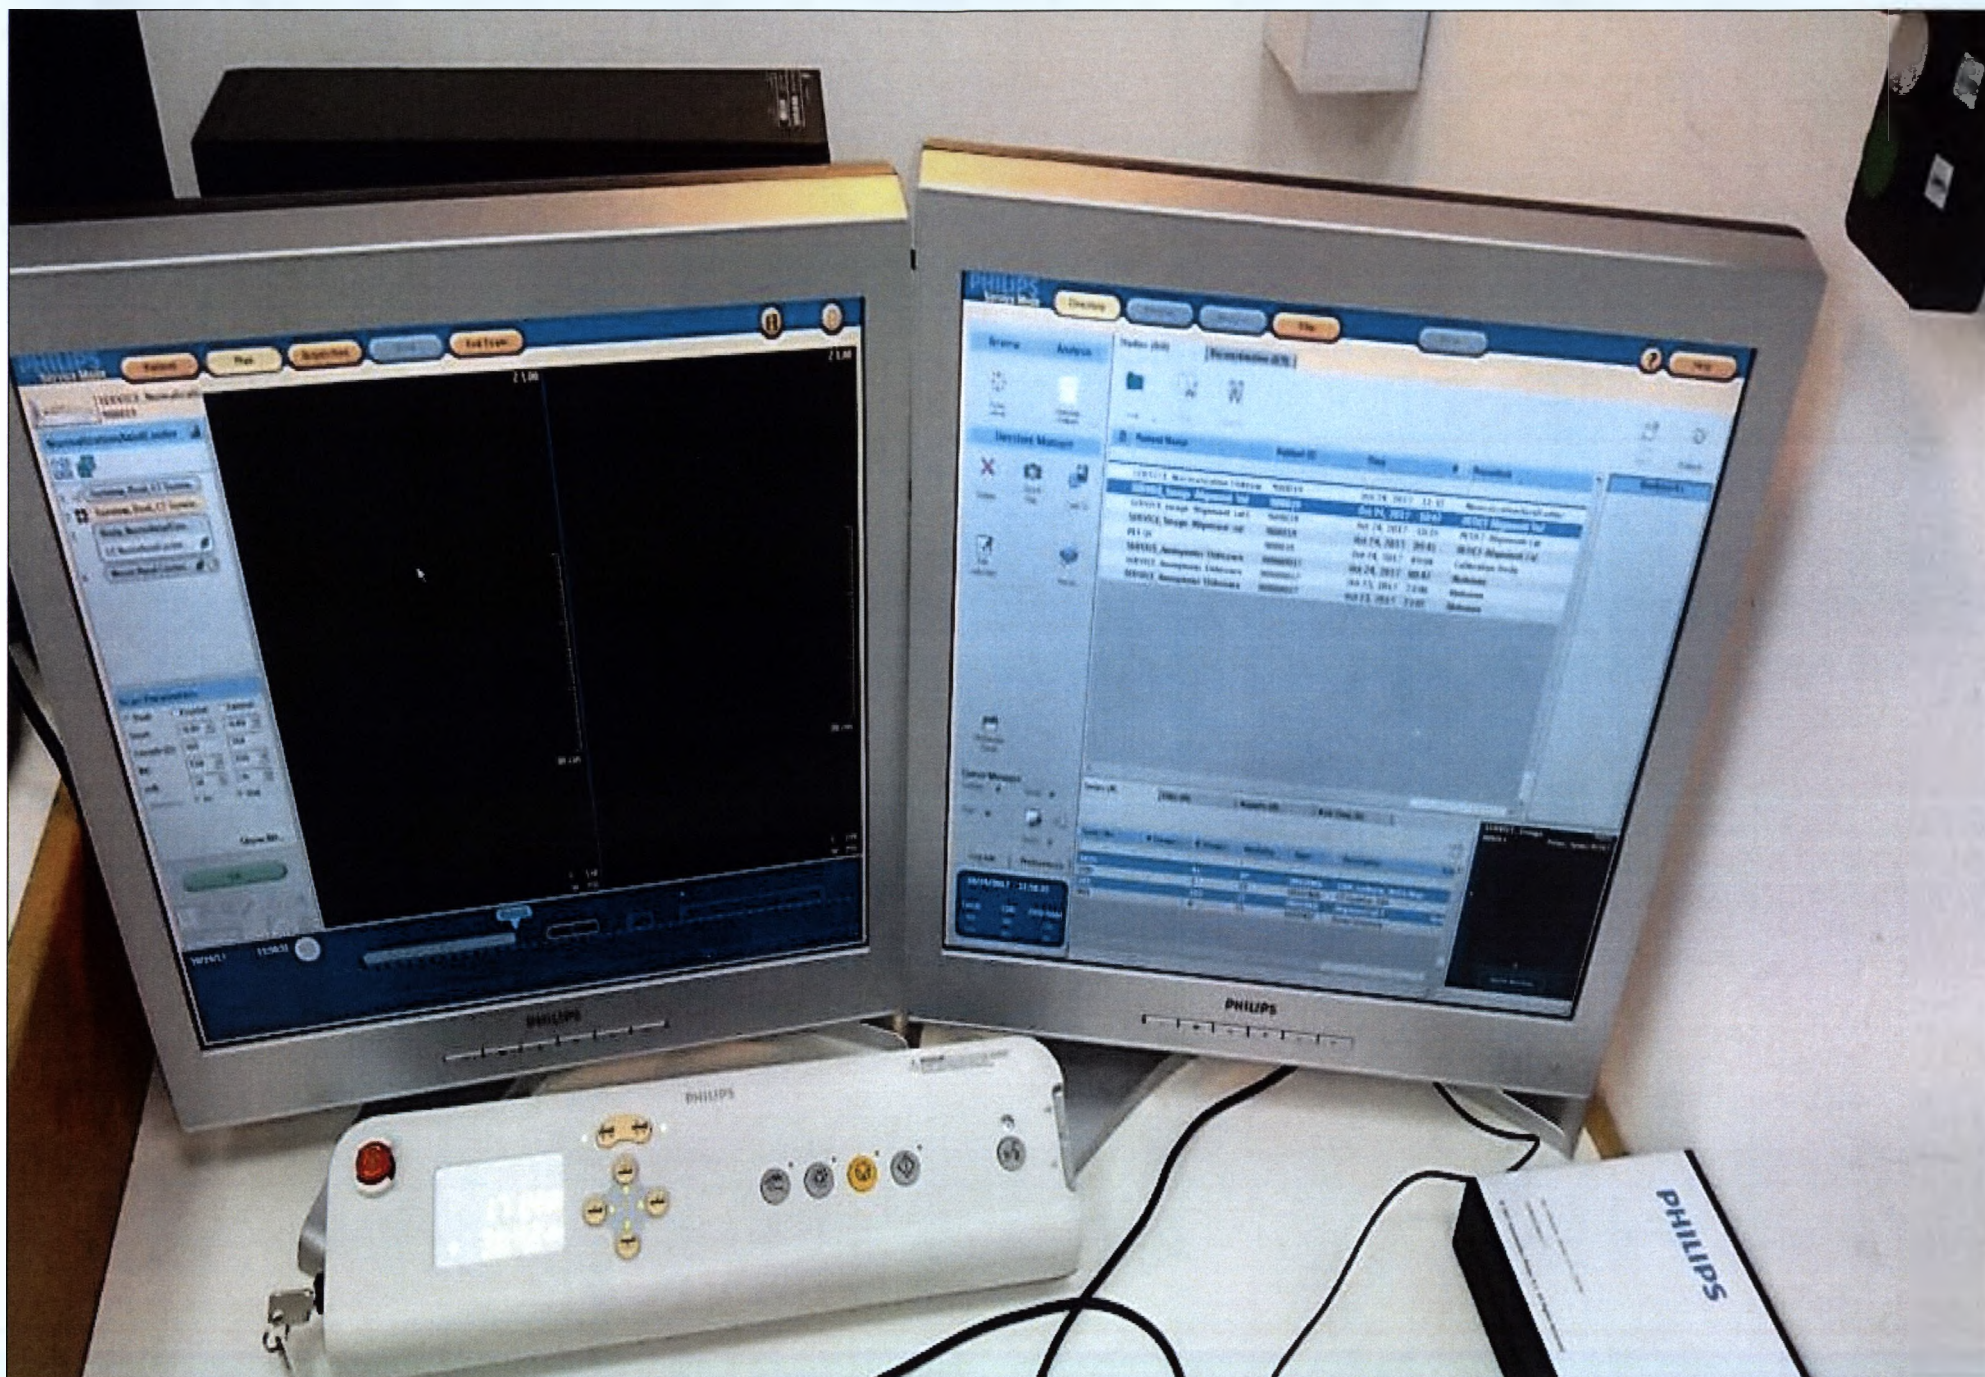


9а. Рабочая станция сбора и обработки данных.

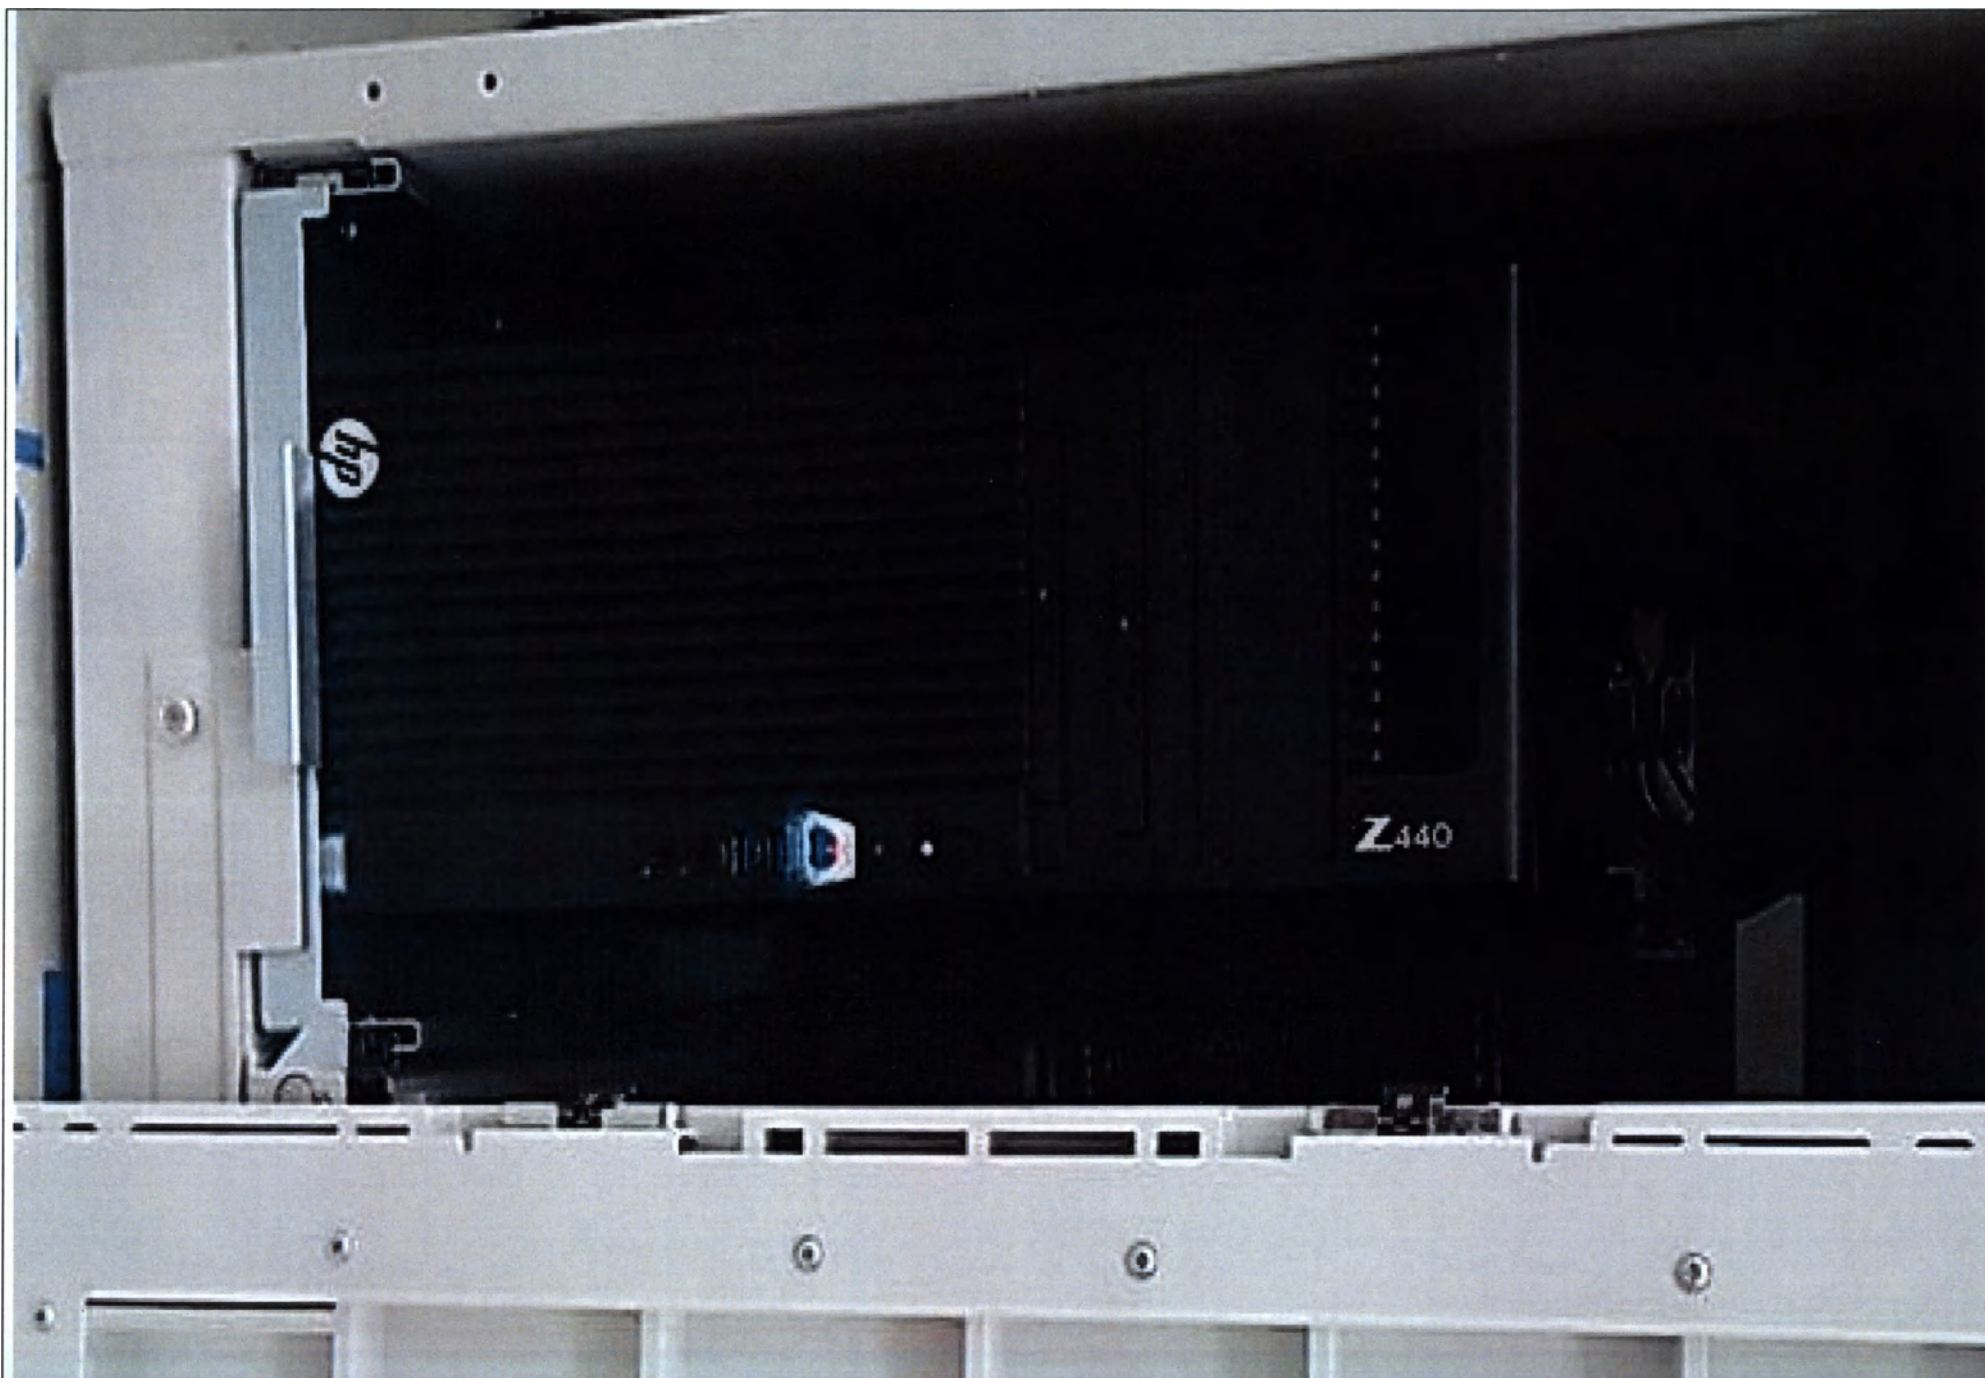


9б. Рабочая станция сбора и обработки данных: компьютер.

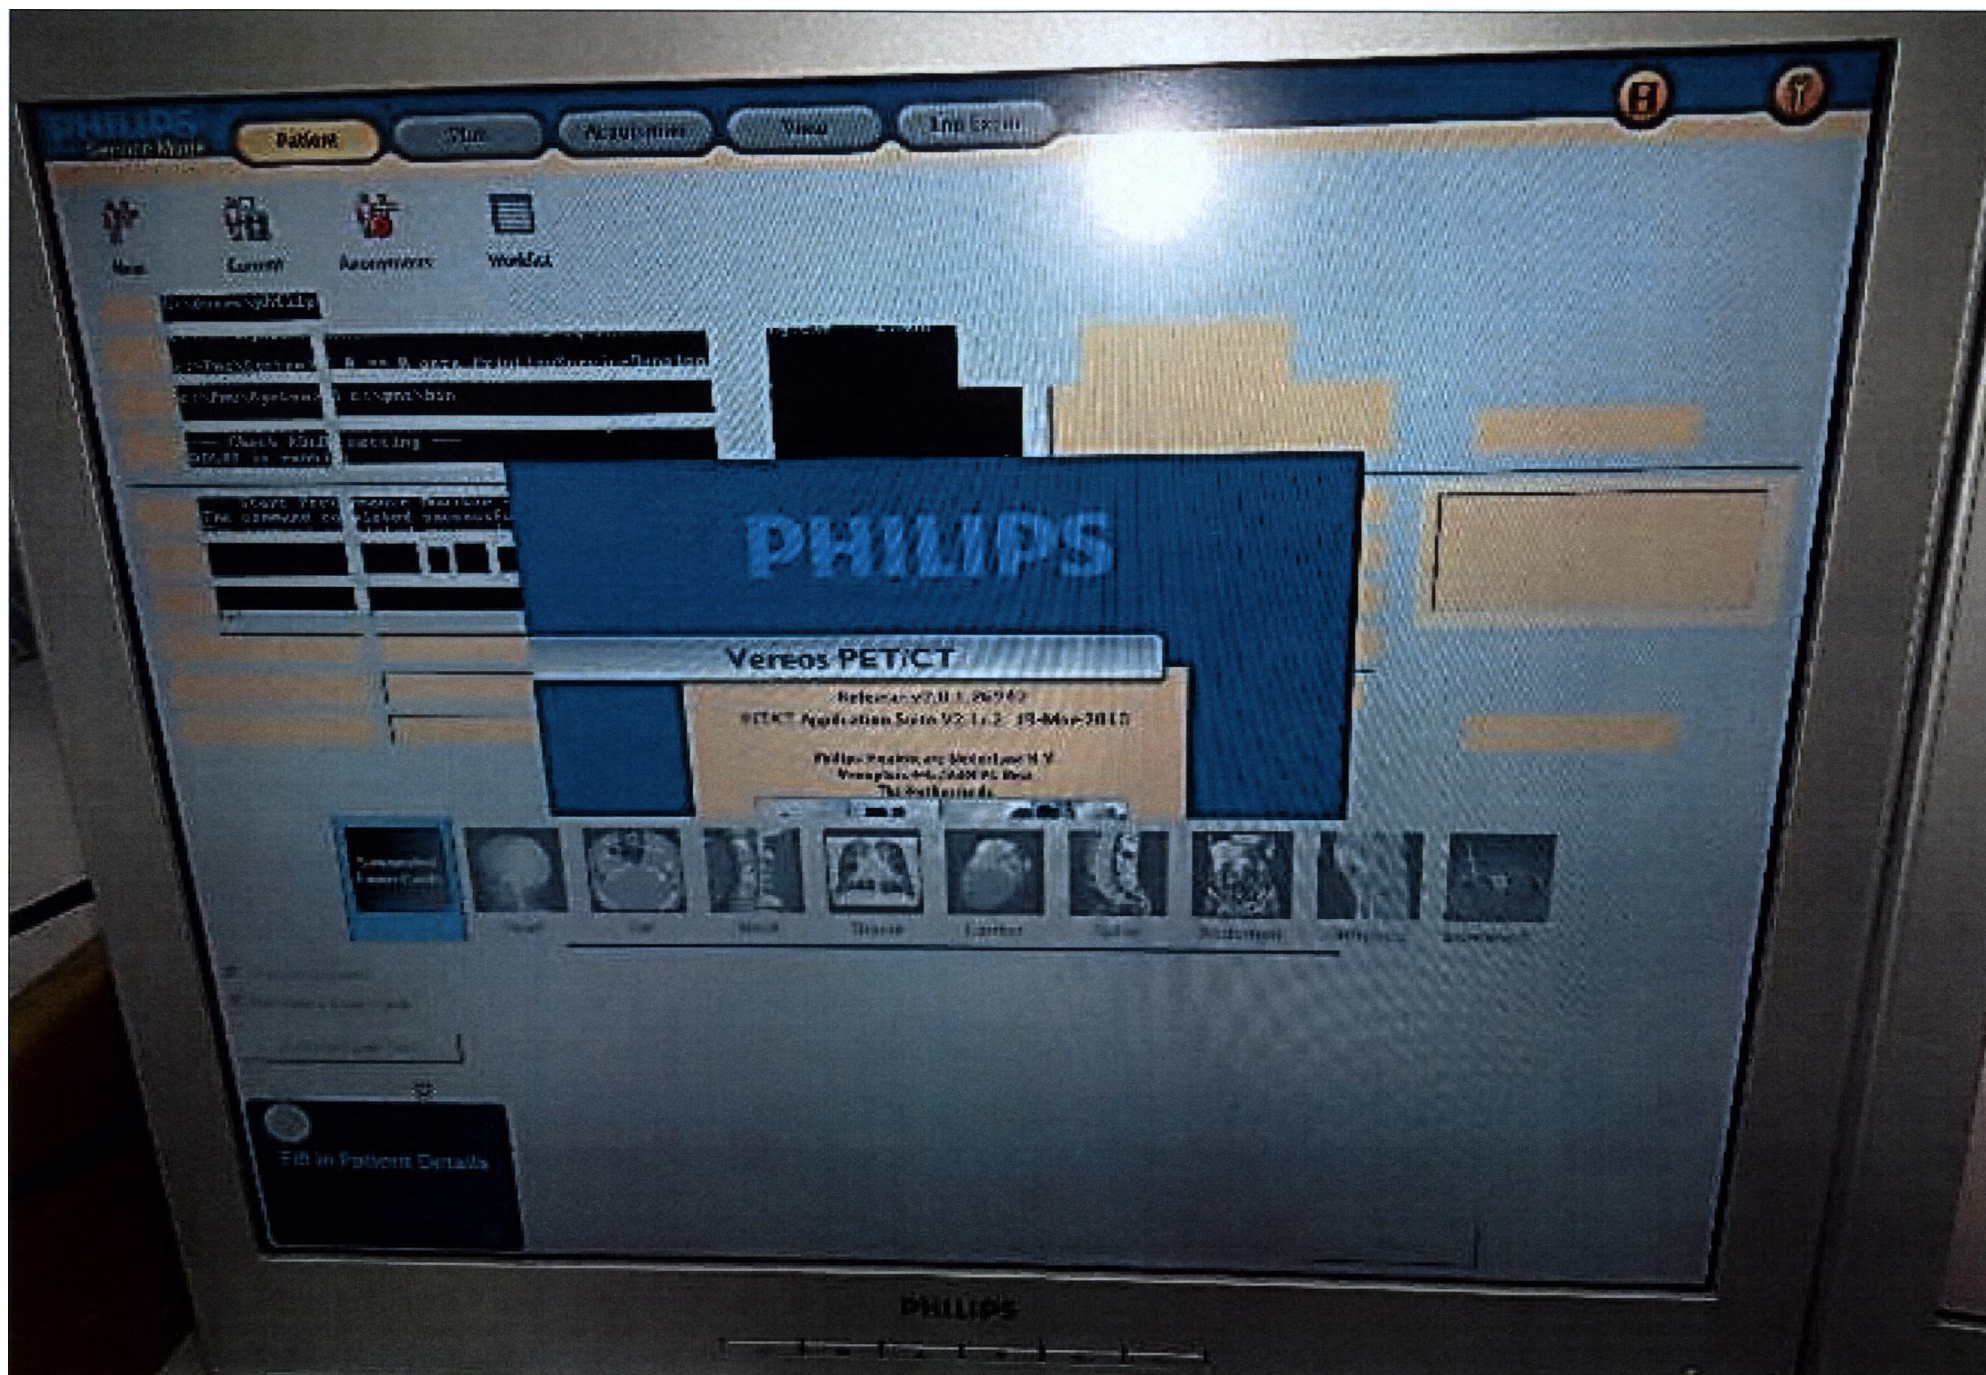


9с. Рабочая станция сбора и обработки данных: монитор с ПО ПЭТ/КТ.

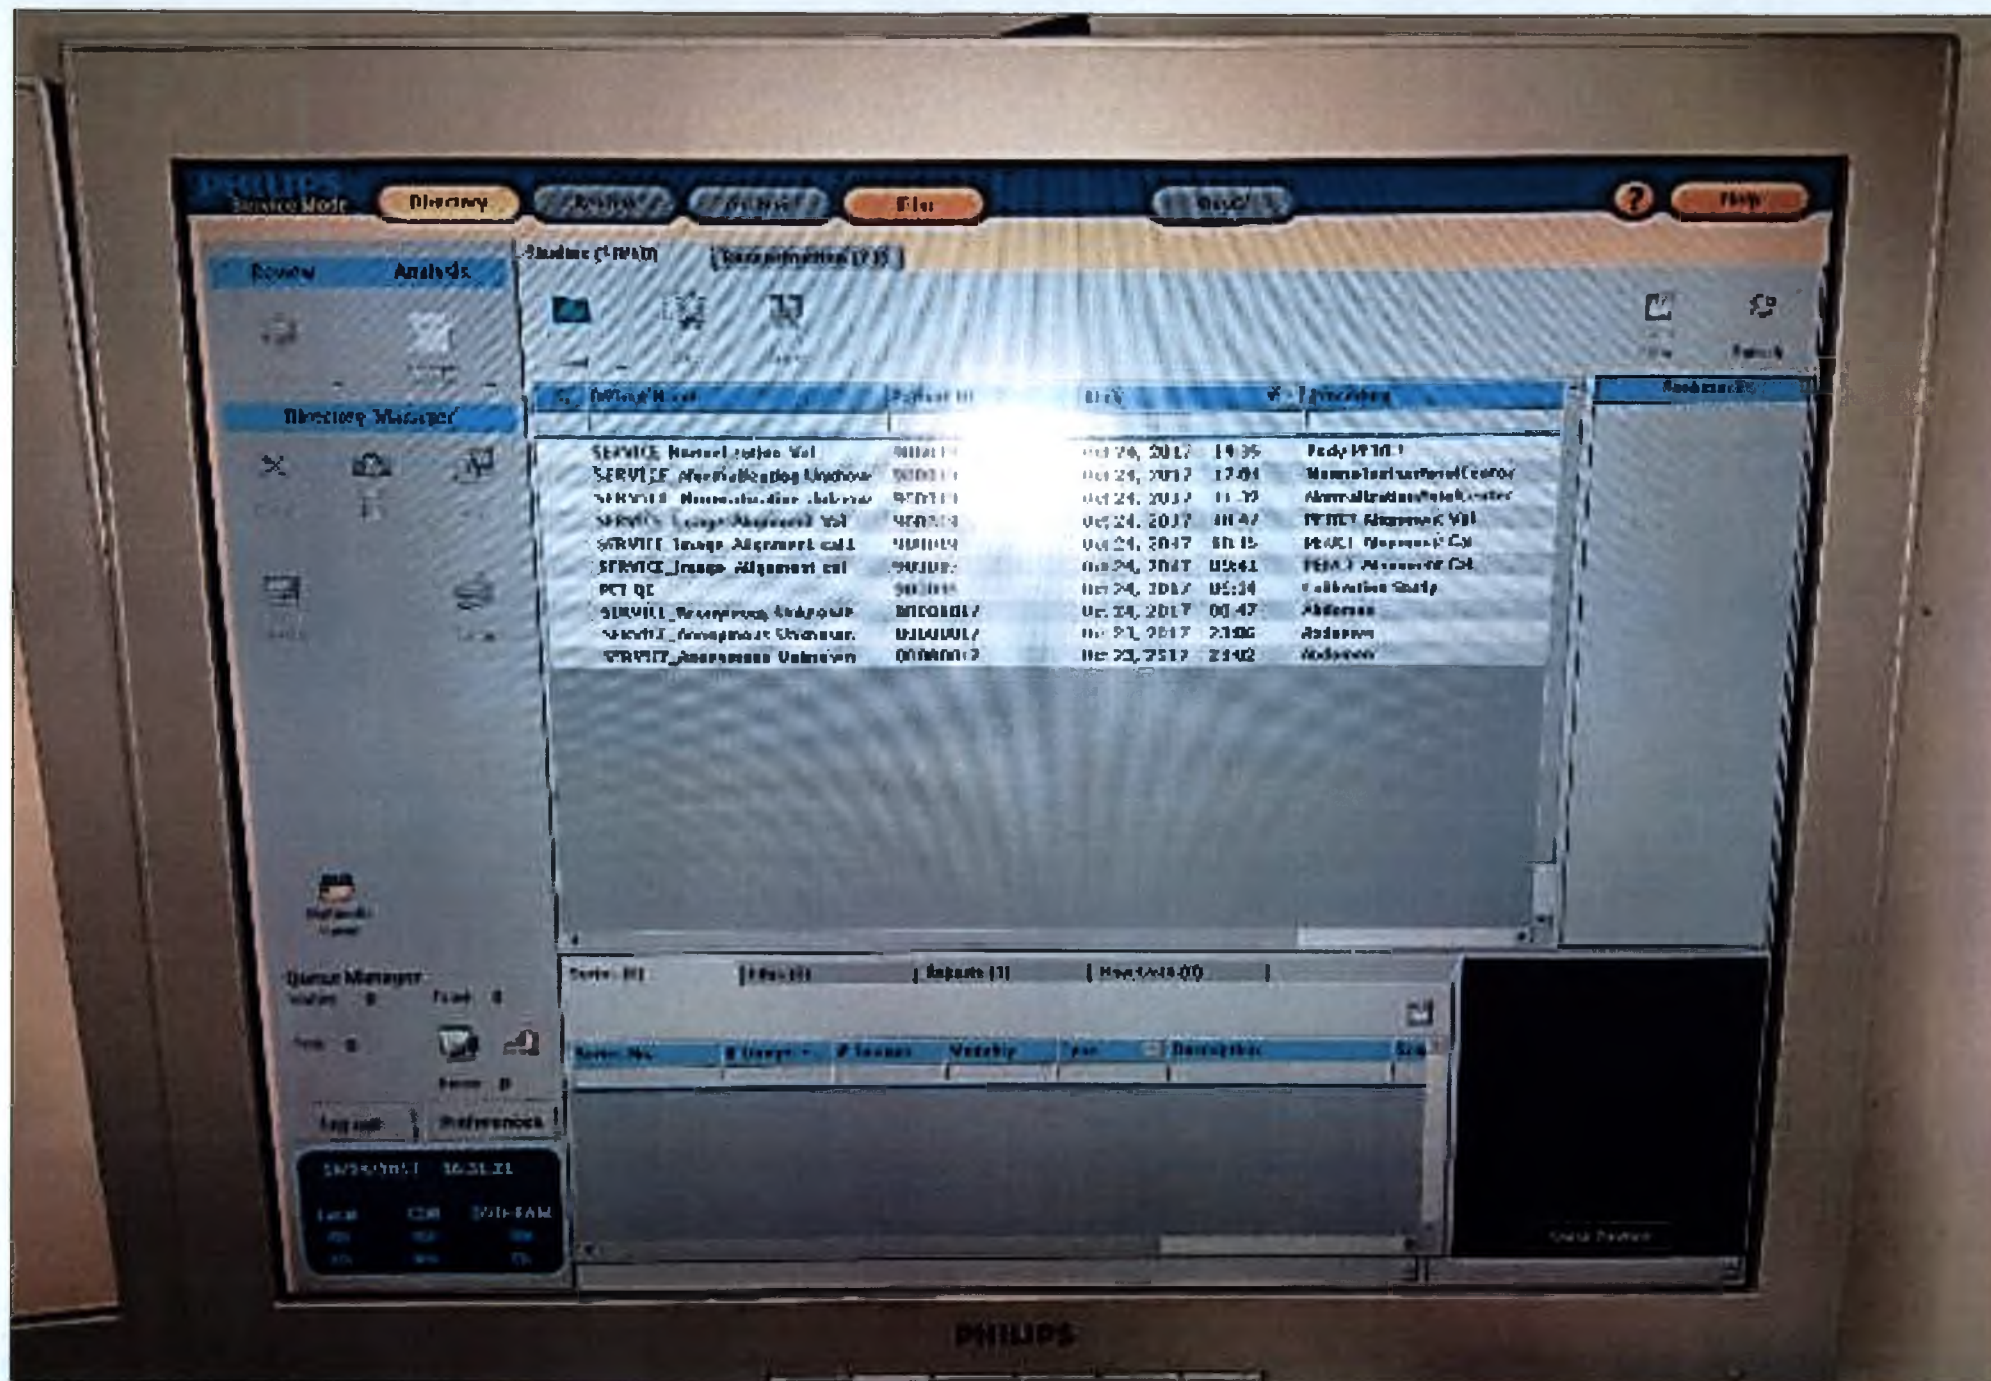

9d. Рабочая станция сбора и обработки данных: монитор с ПО ПЭТ/КТ.

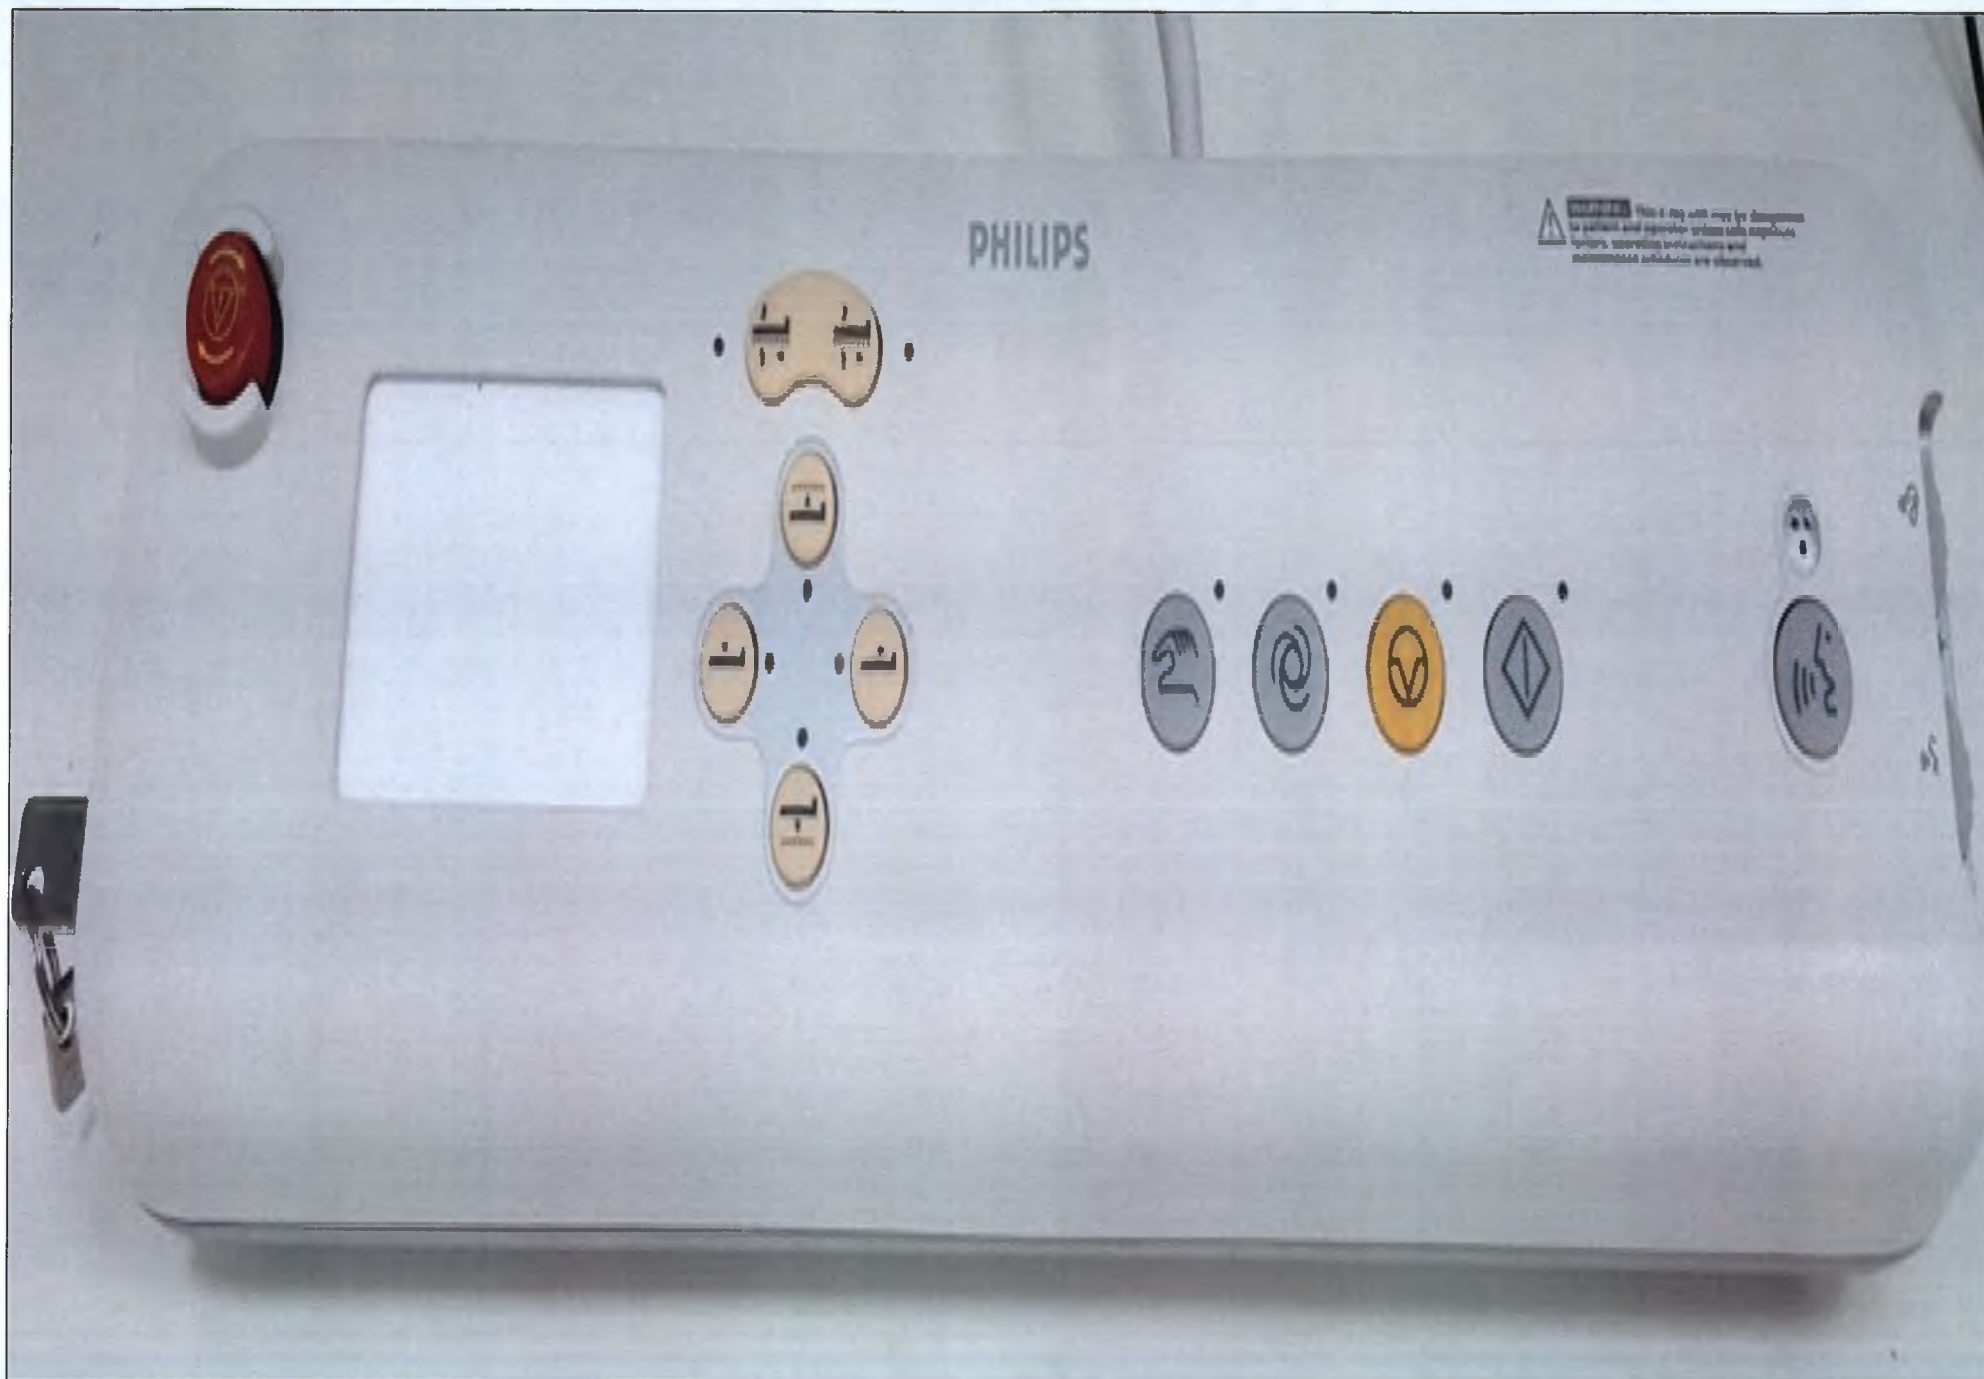


9е. Рабочая станция сбора и обработки данных: пульт управления сканированием.

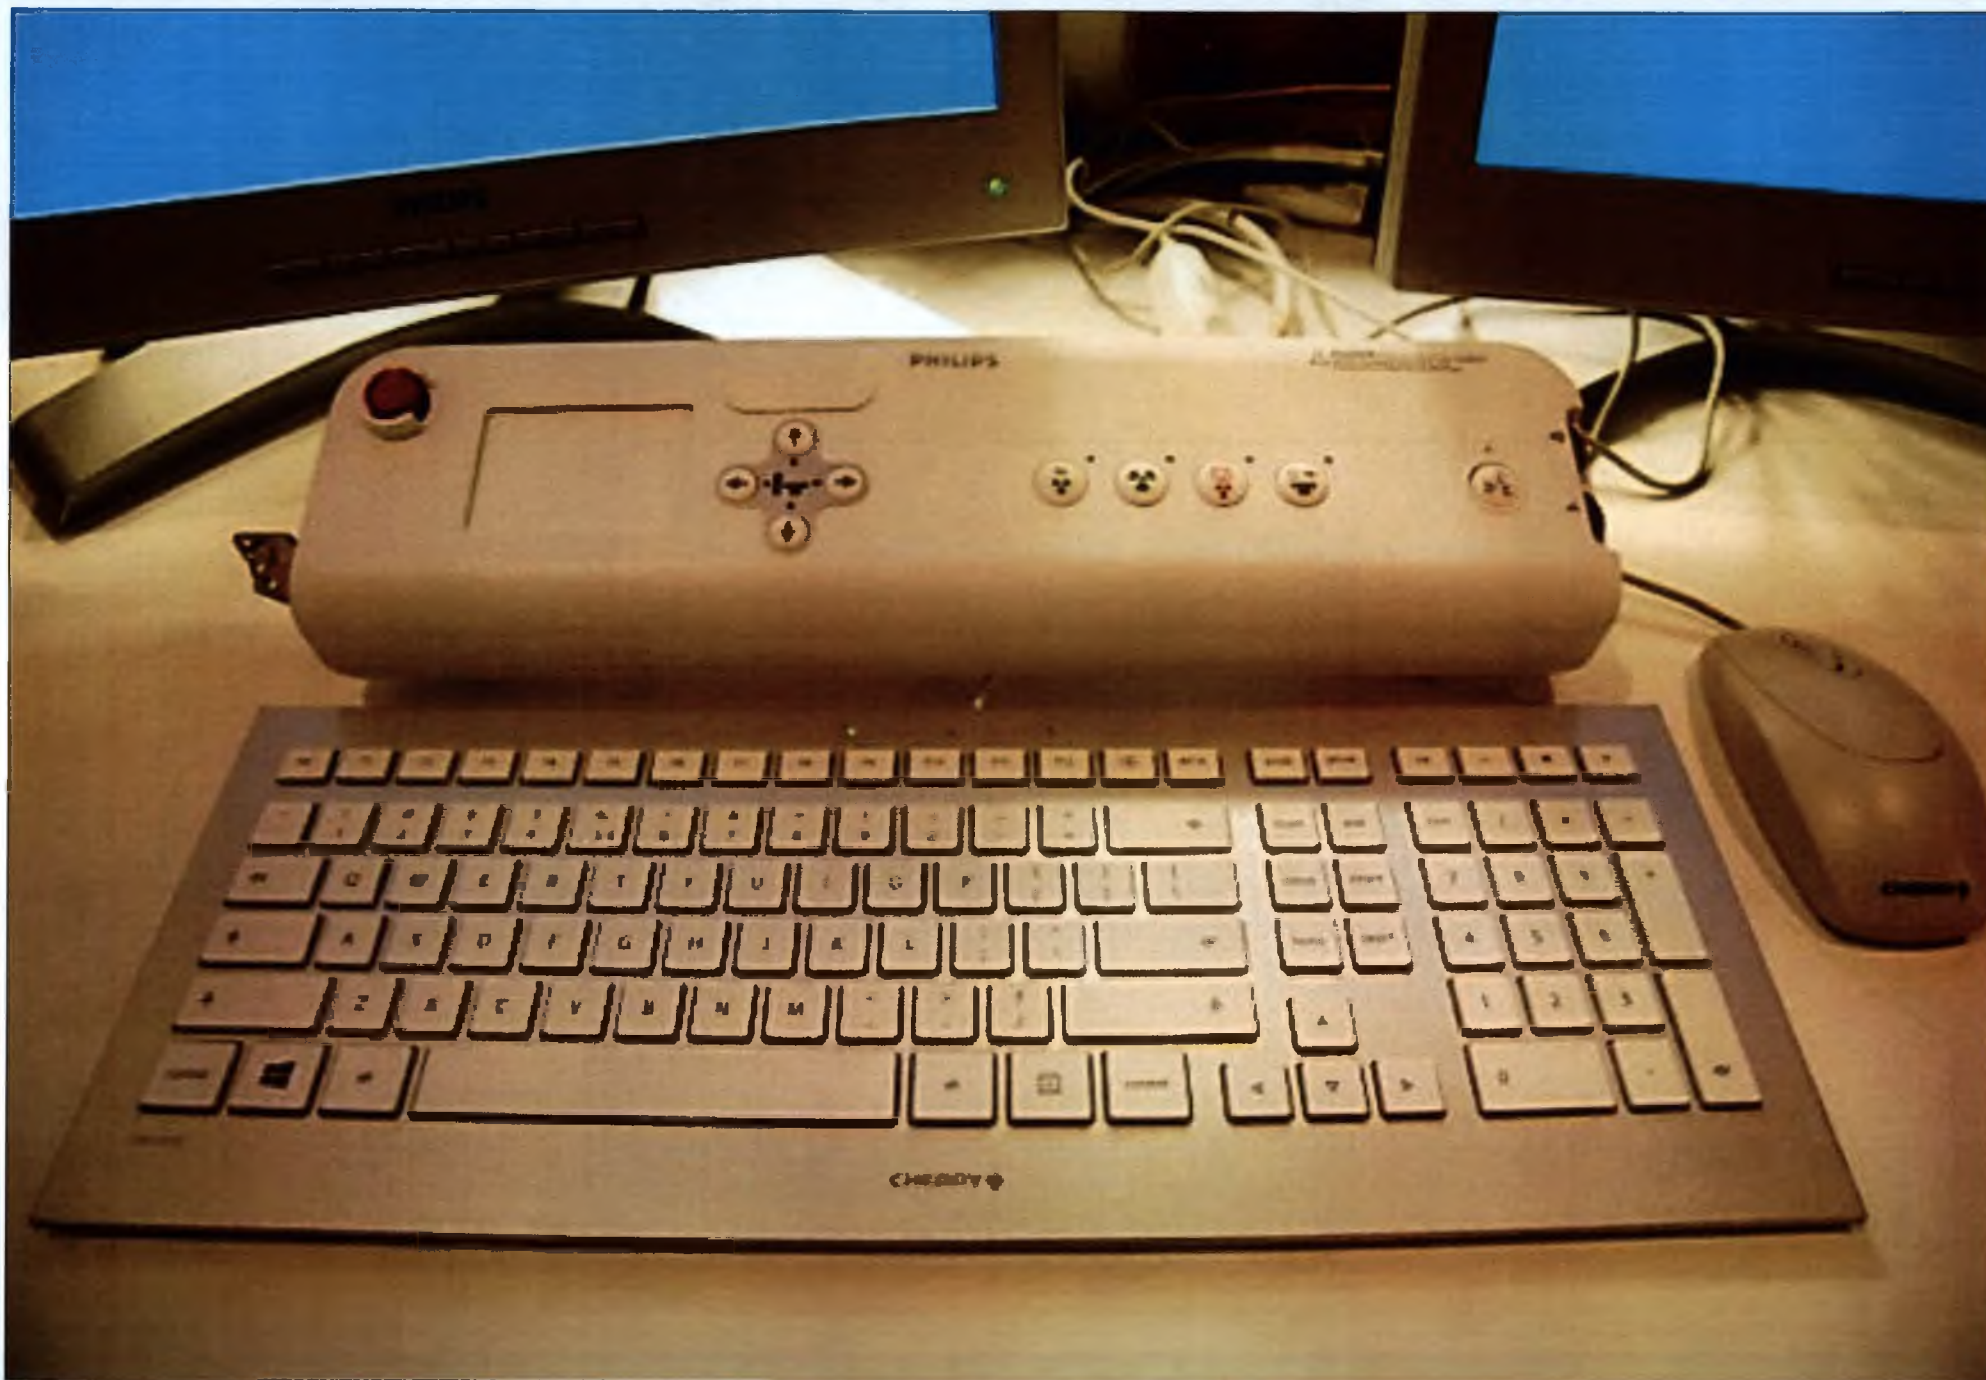


9f. Рабочая станция сбора и обработки данных: клавиатура.



9г. Рабочая станция сбора и обработки данных: мышь.

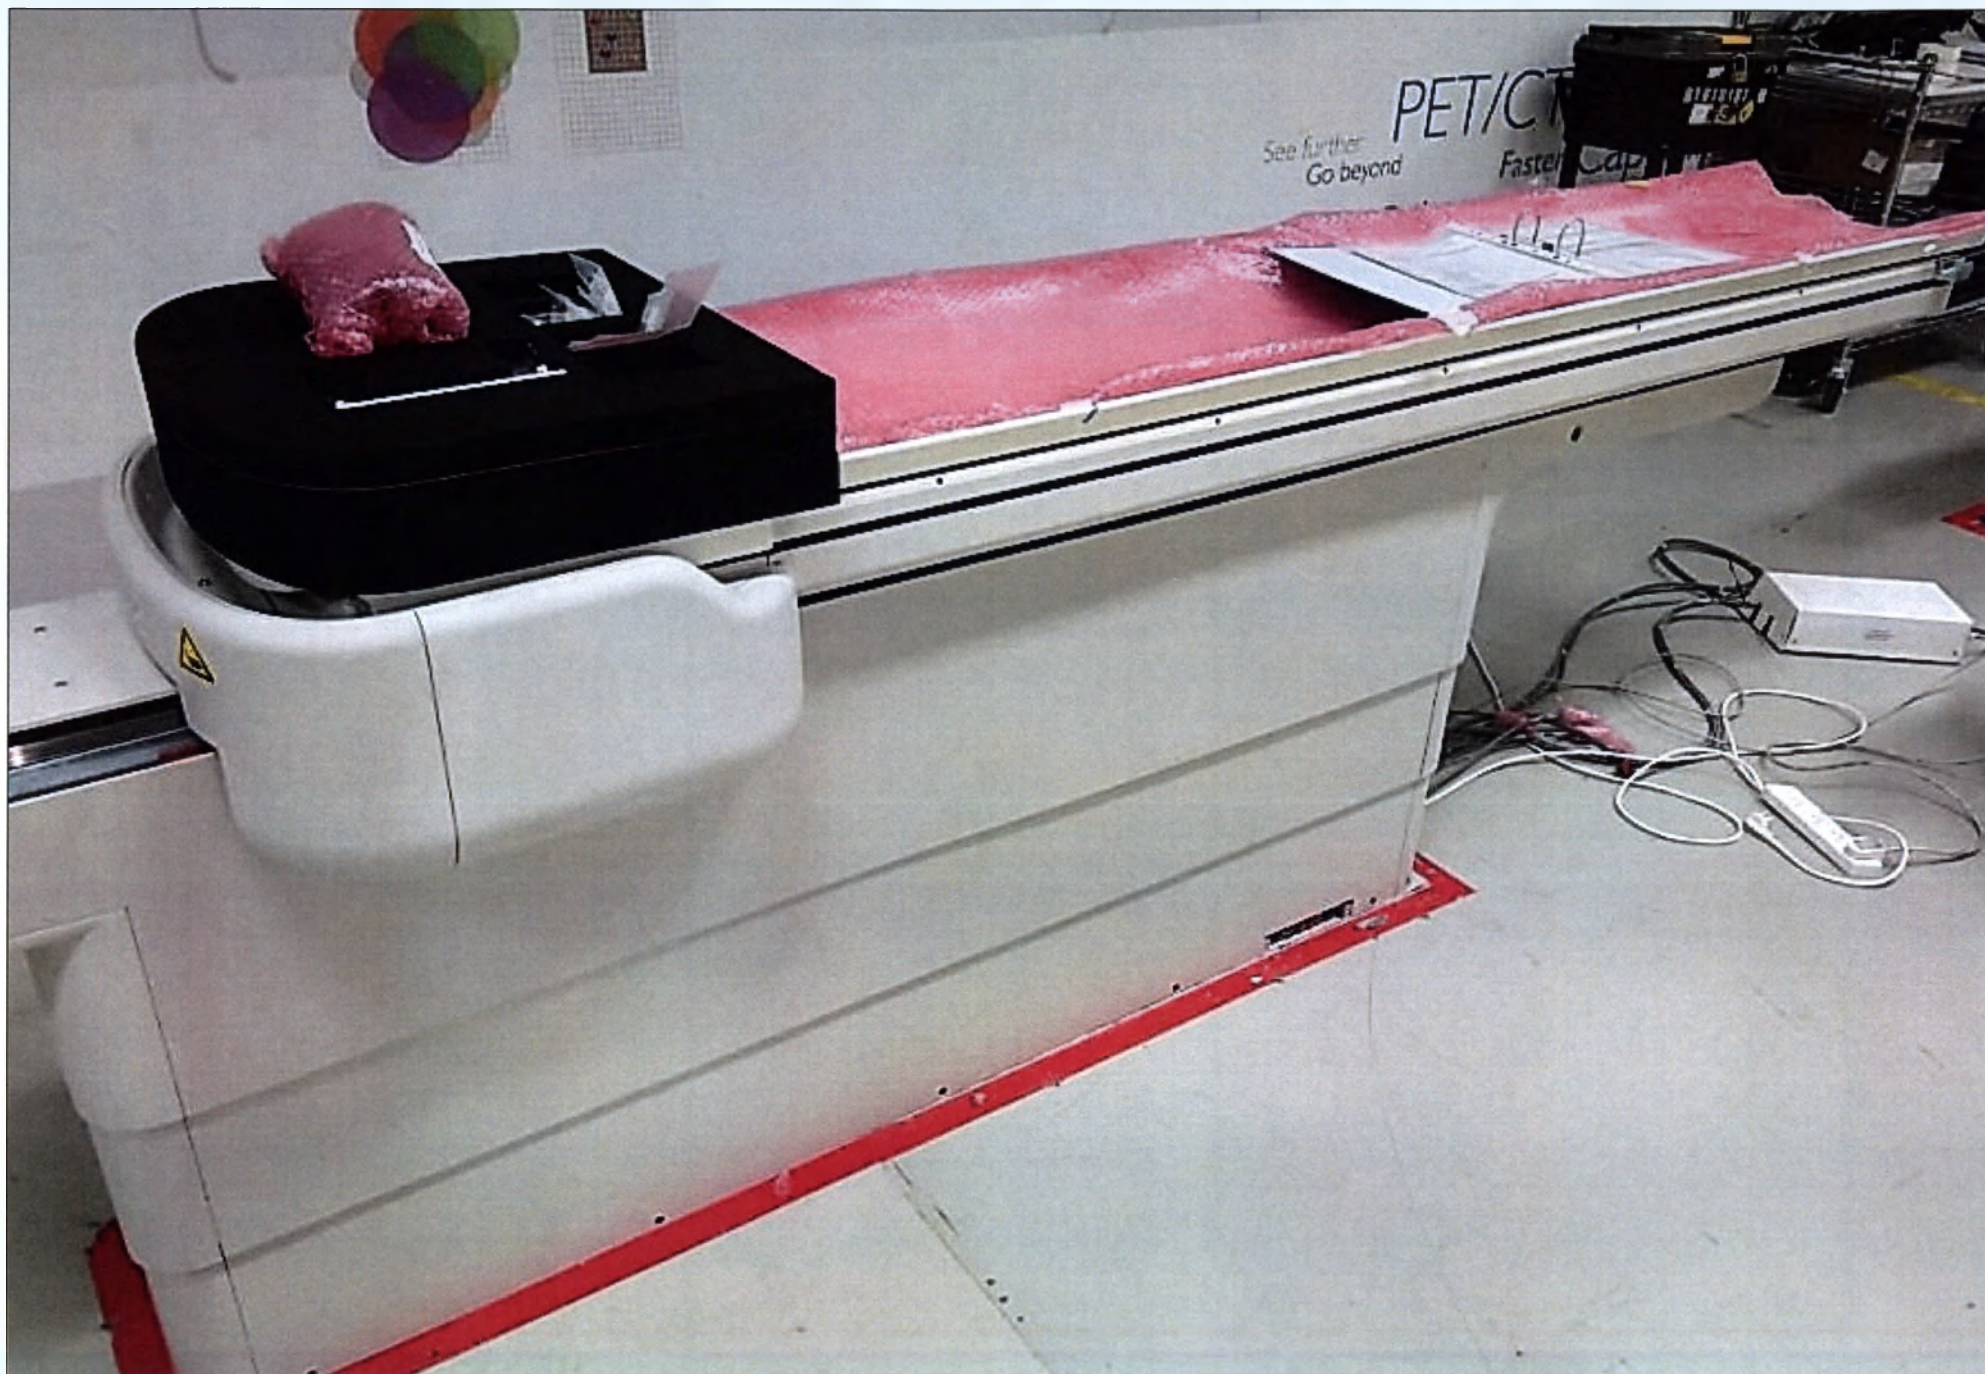

10а. Стол пациента.

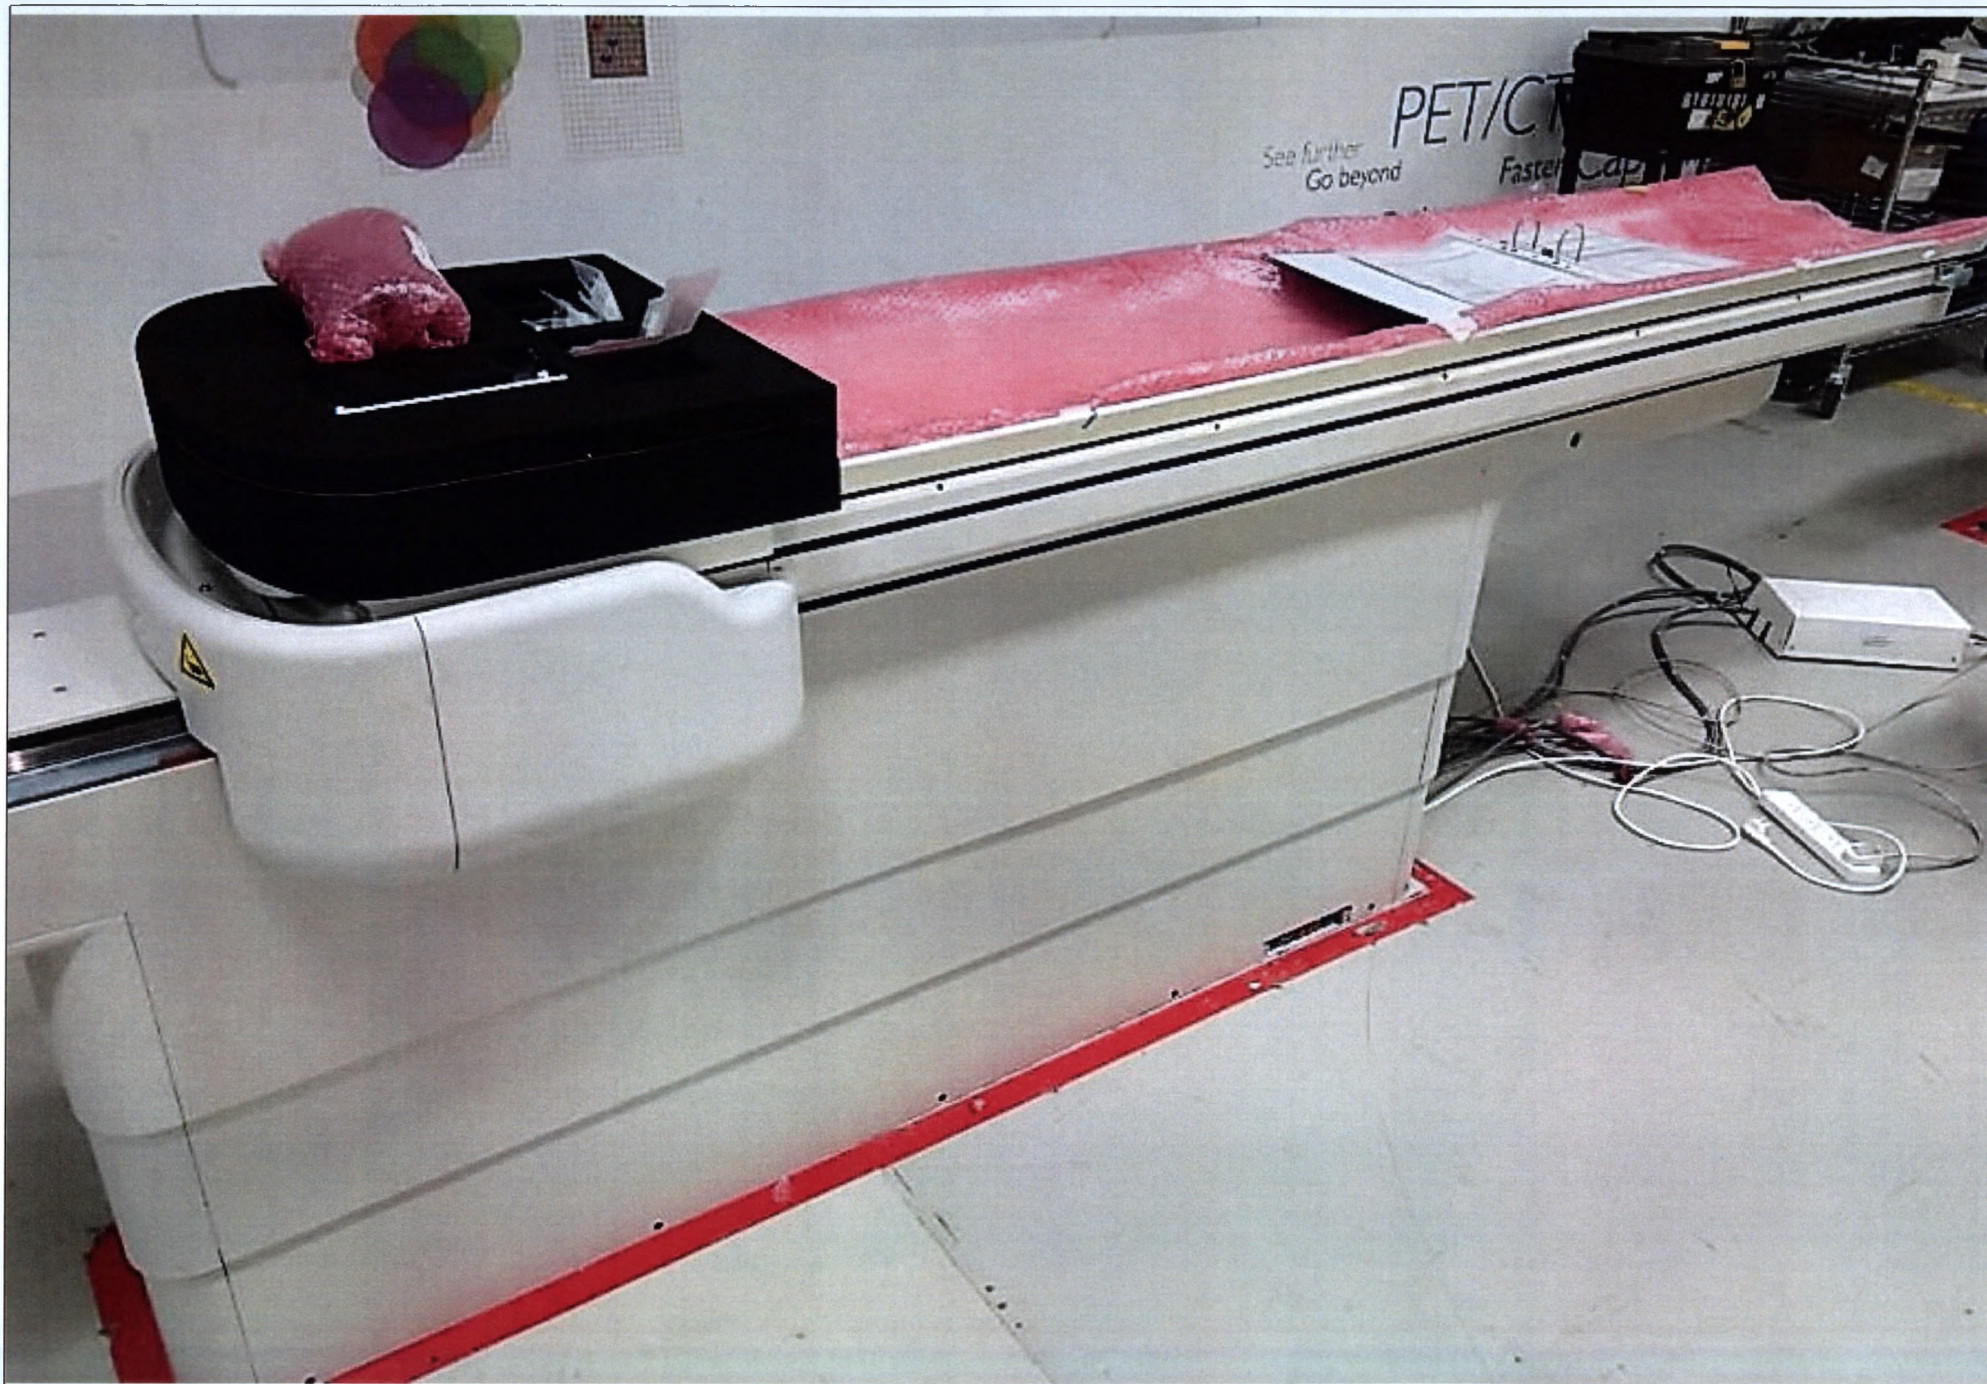


10б. Стол пациента.



11. Держатель для стола пациента.




12а. Блок распределения питания.

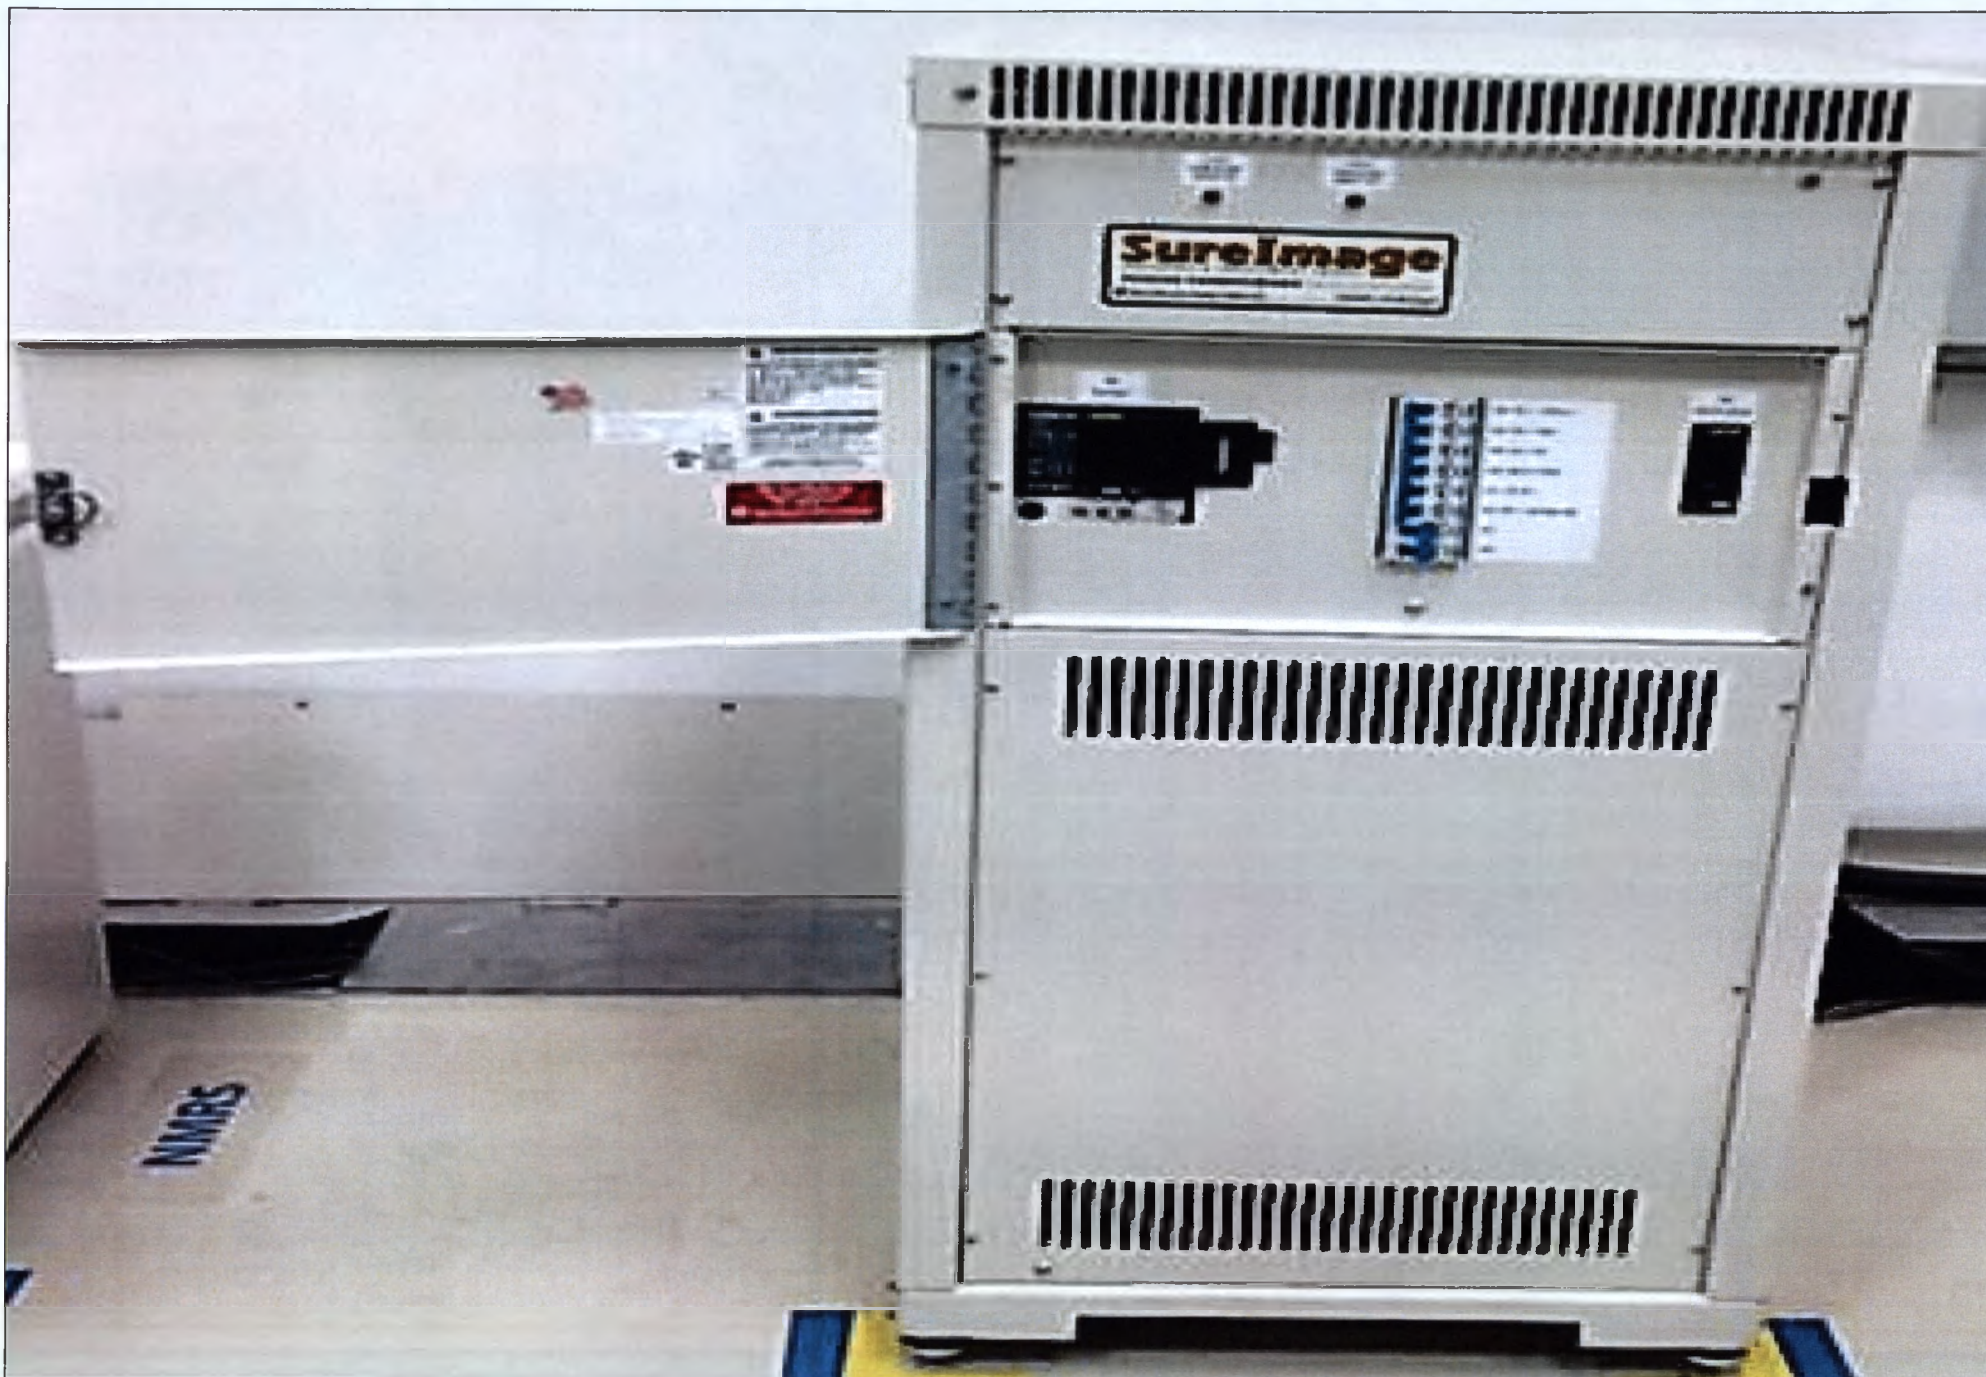

12в. Блок распределения питания.




13. Общая система защиты питания.

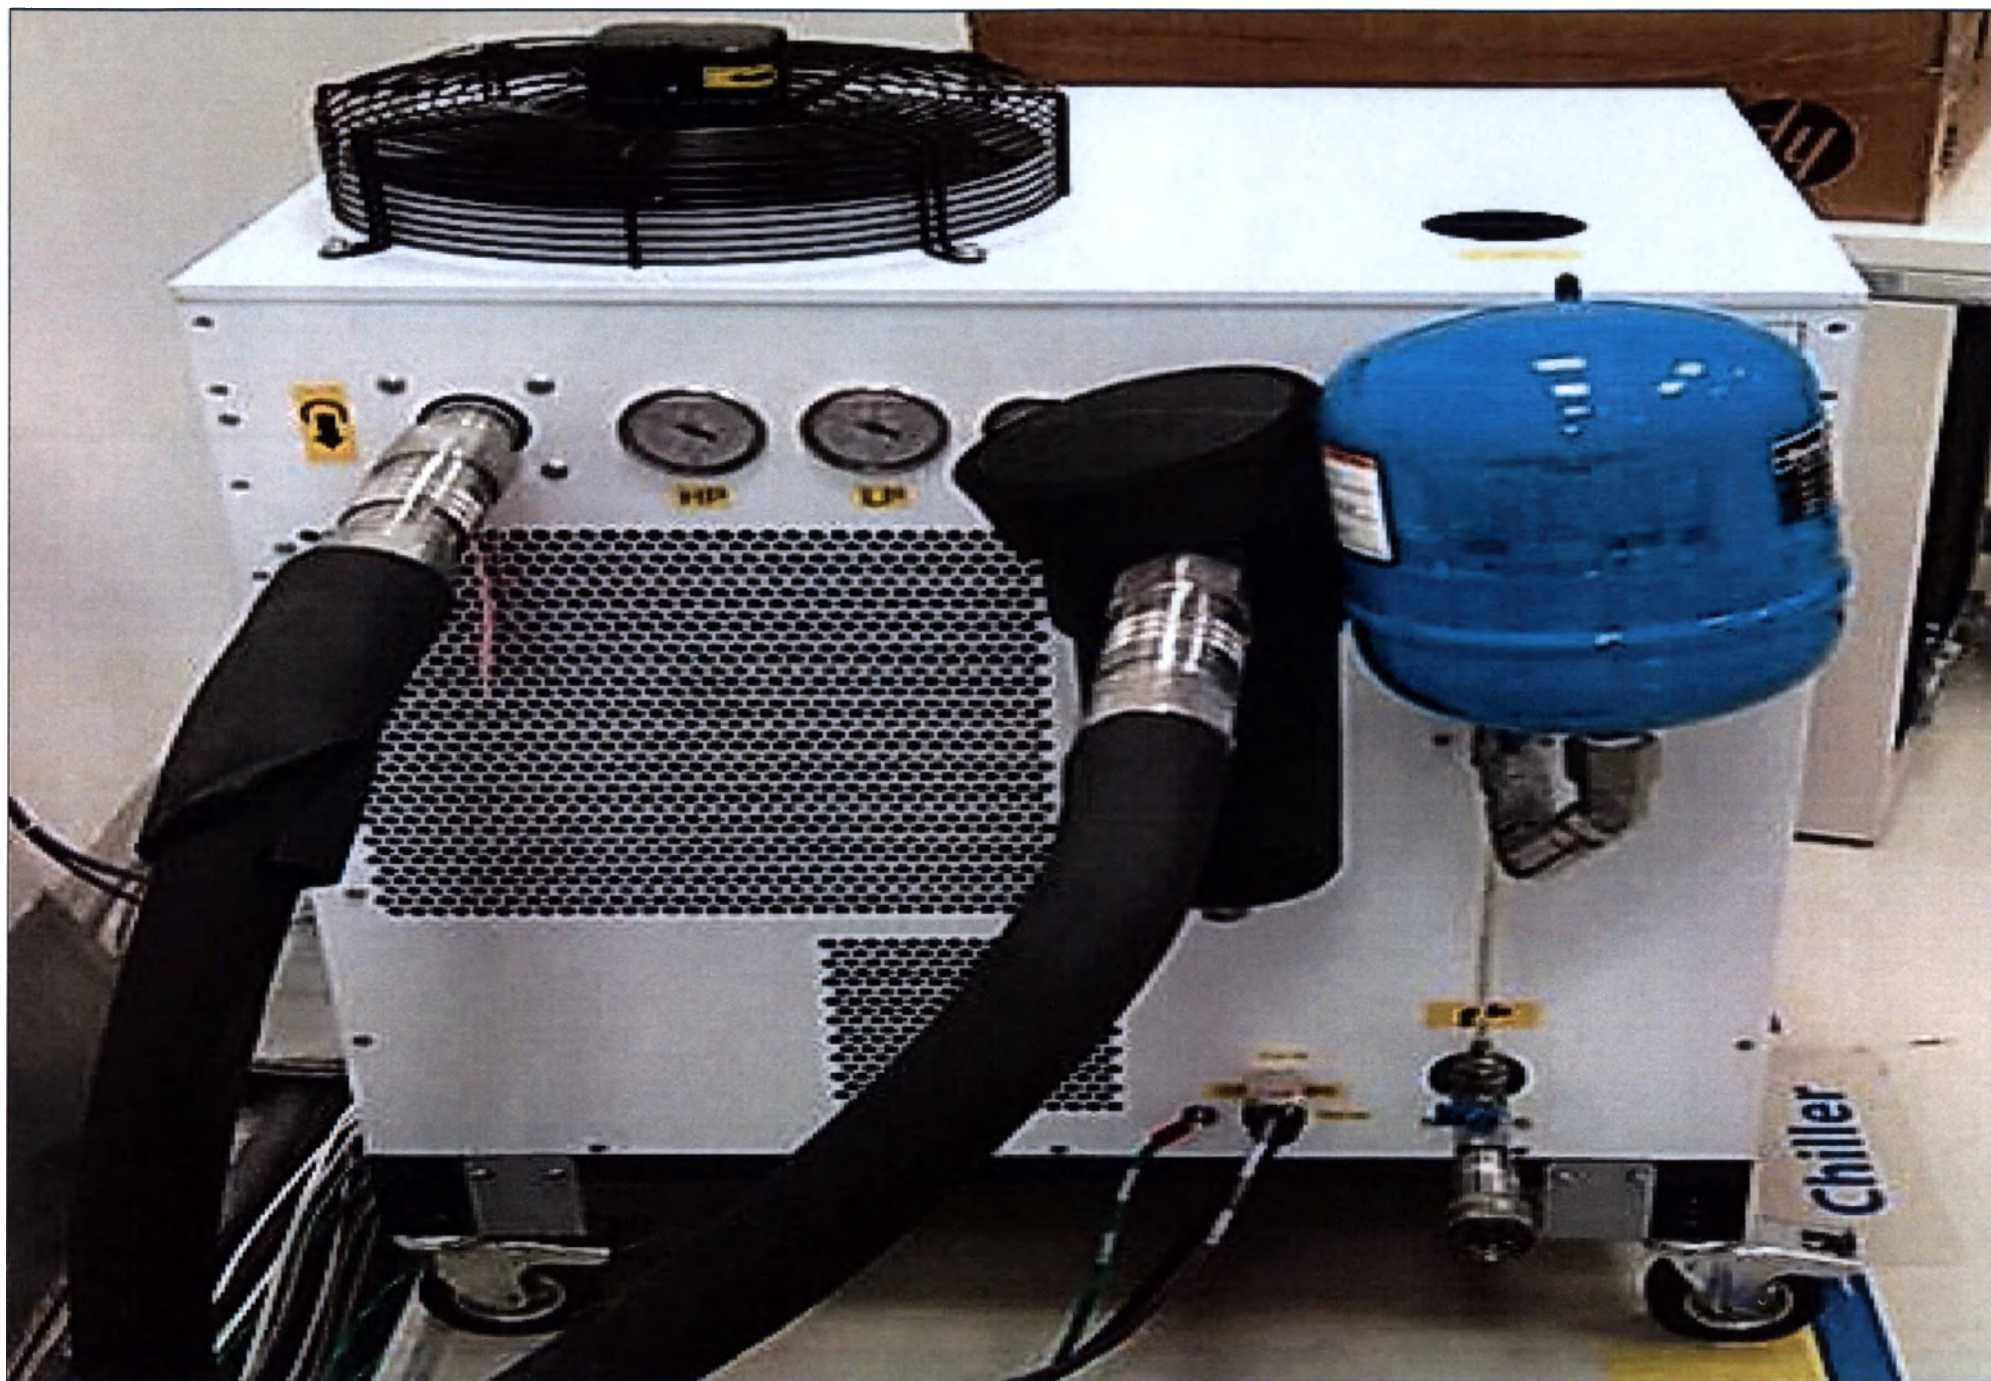


14а. Система охлаждения.



14б. Система охлаждения.

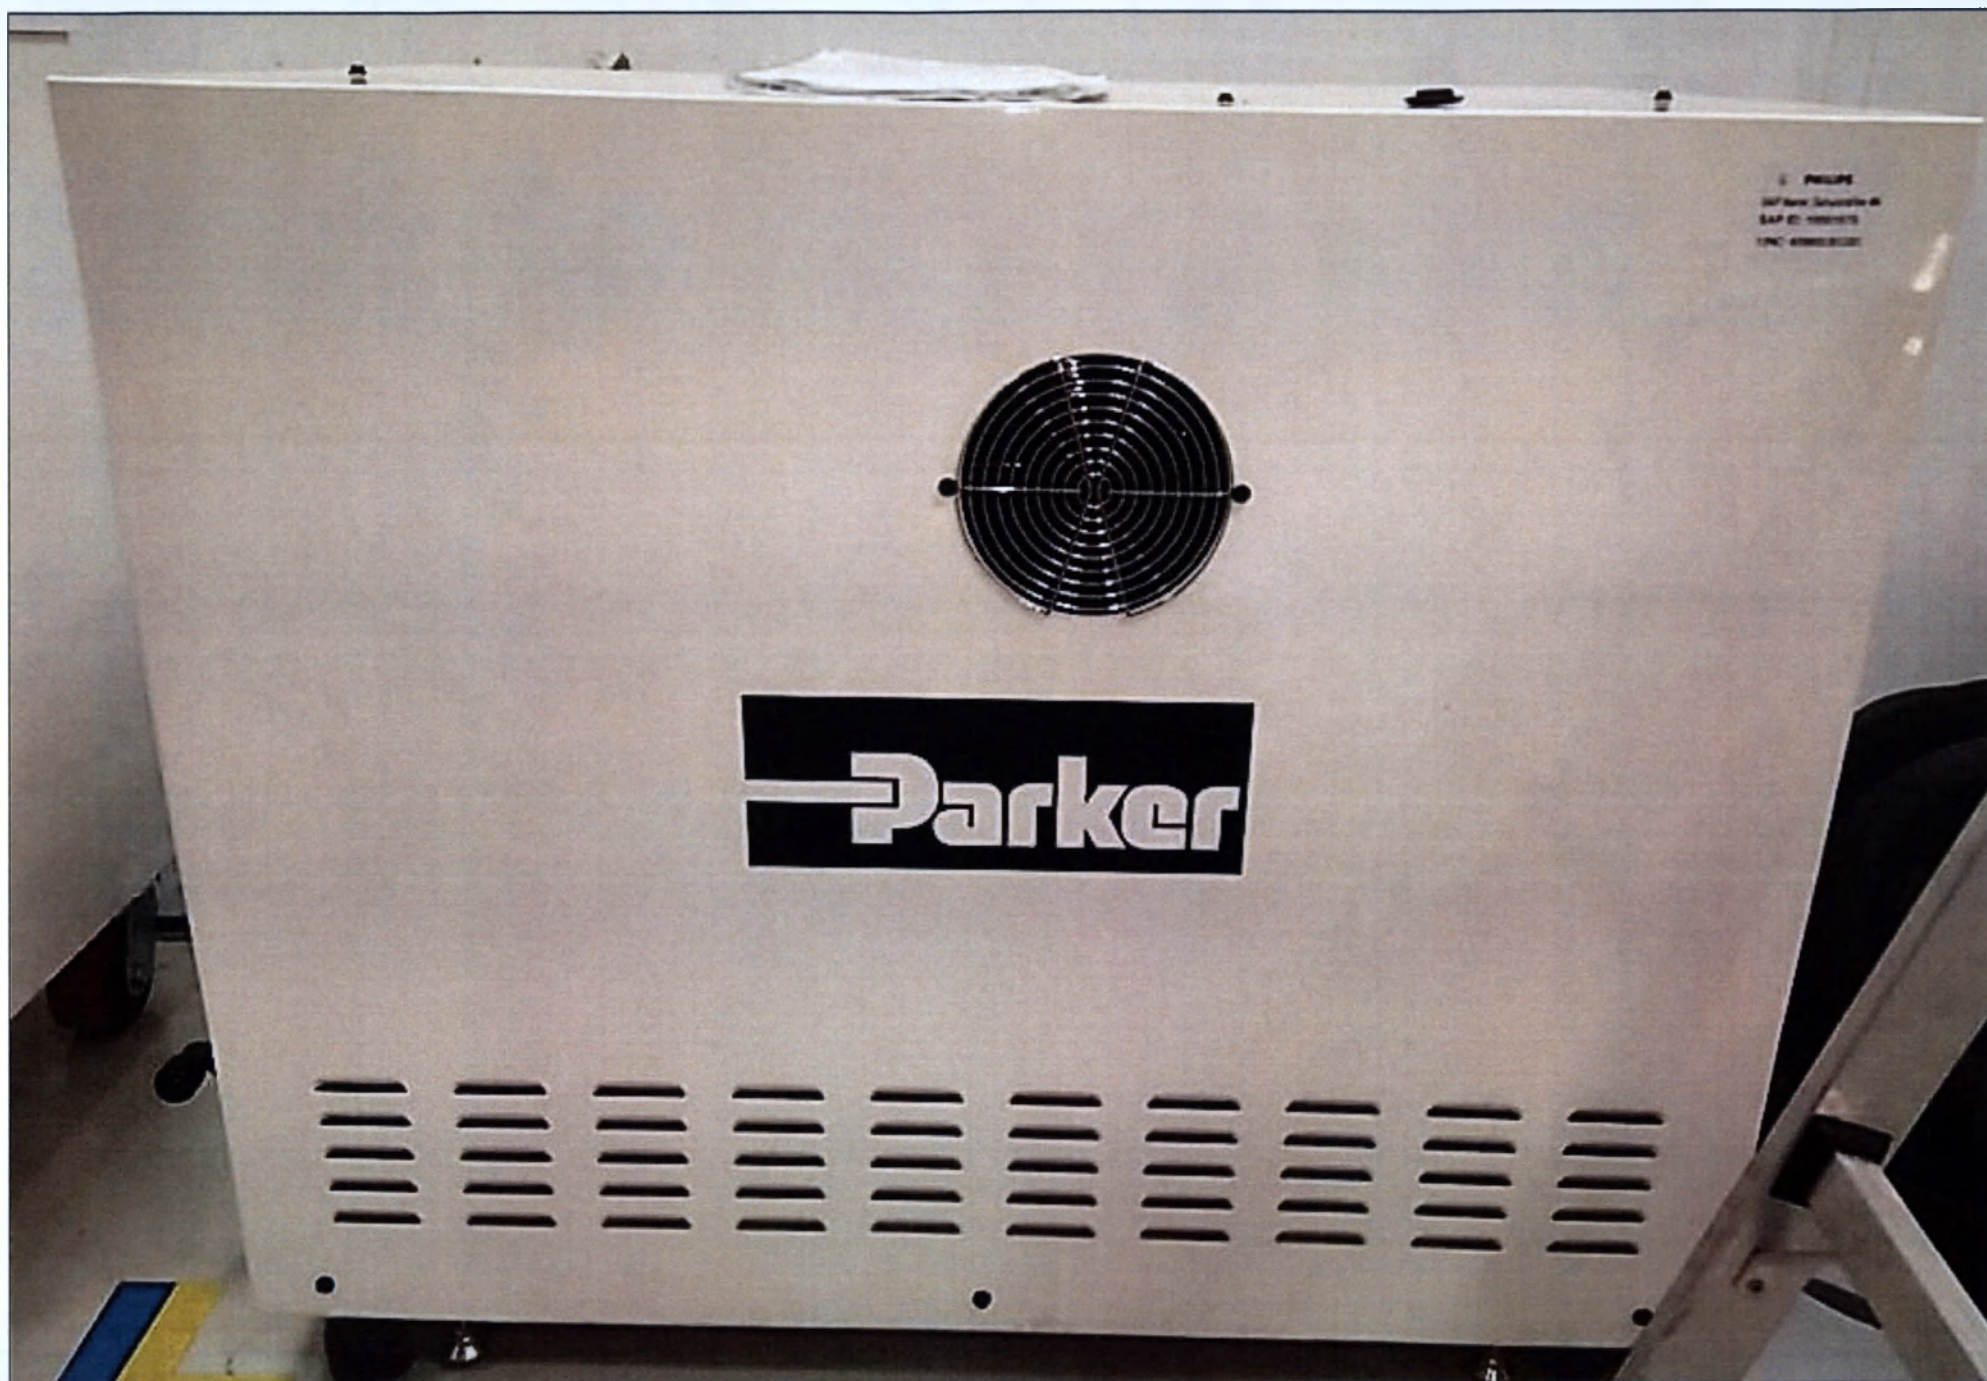


15.осушитель.

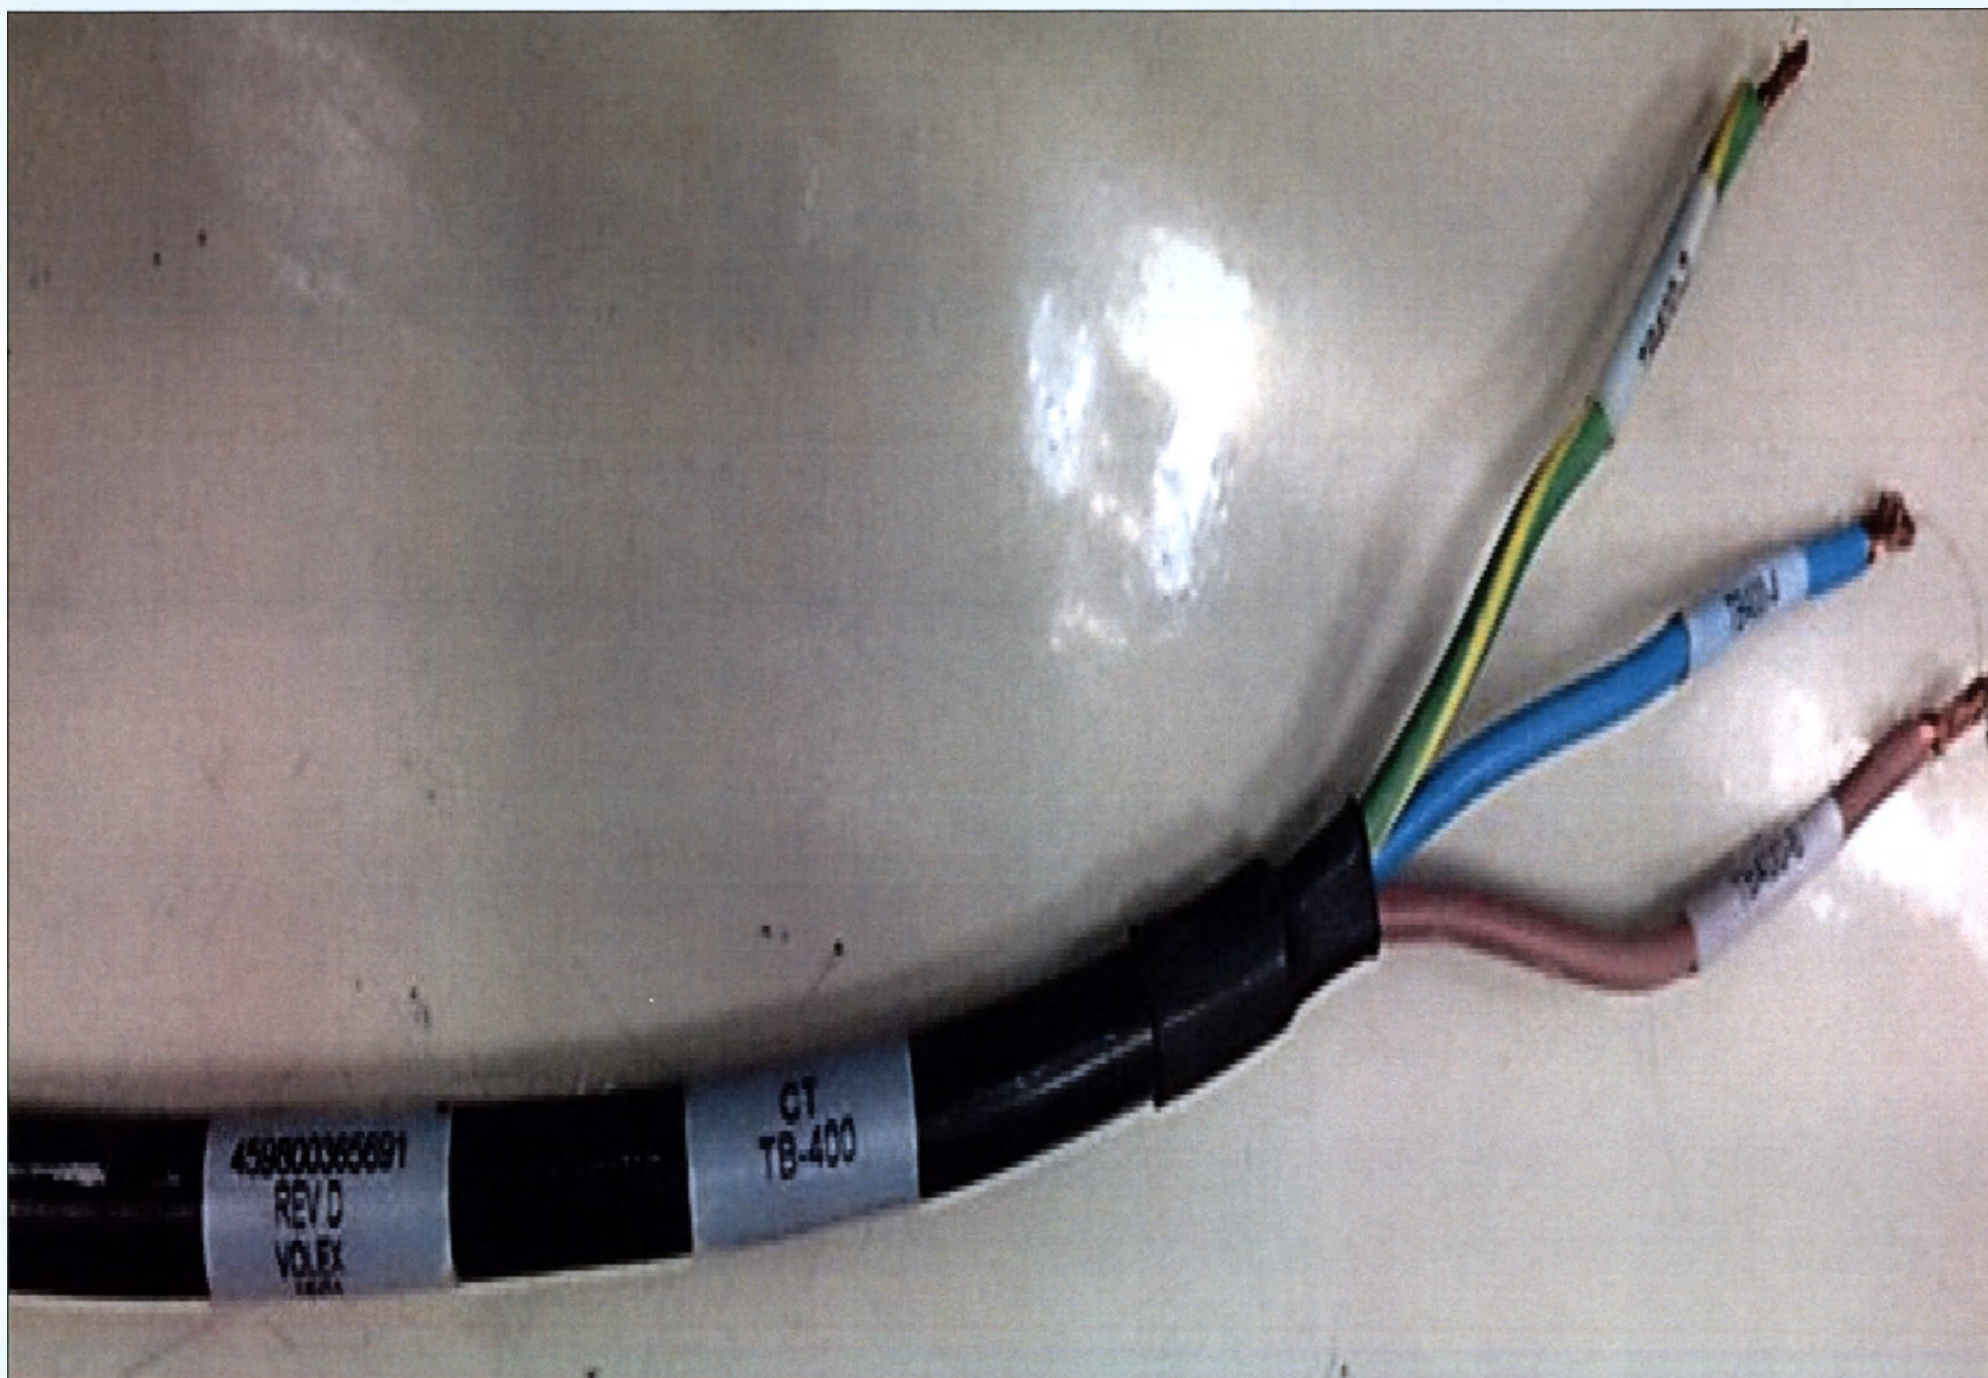

16а. Кабели силовые.



16b. Кабели силовые.

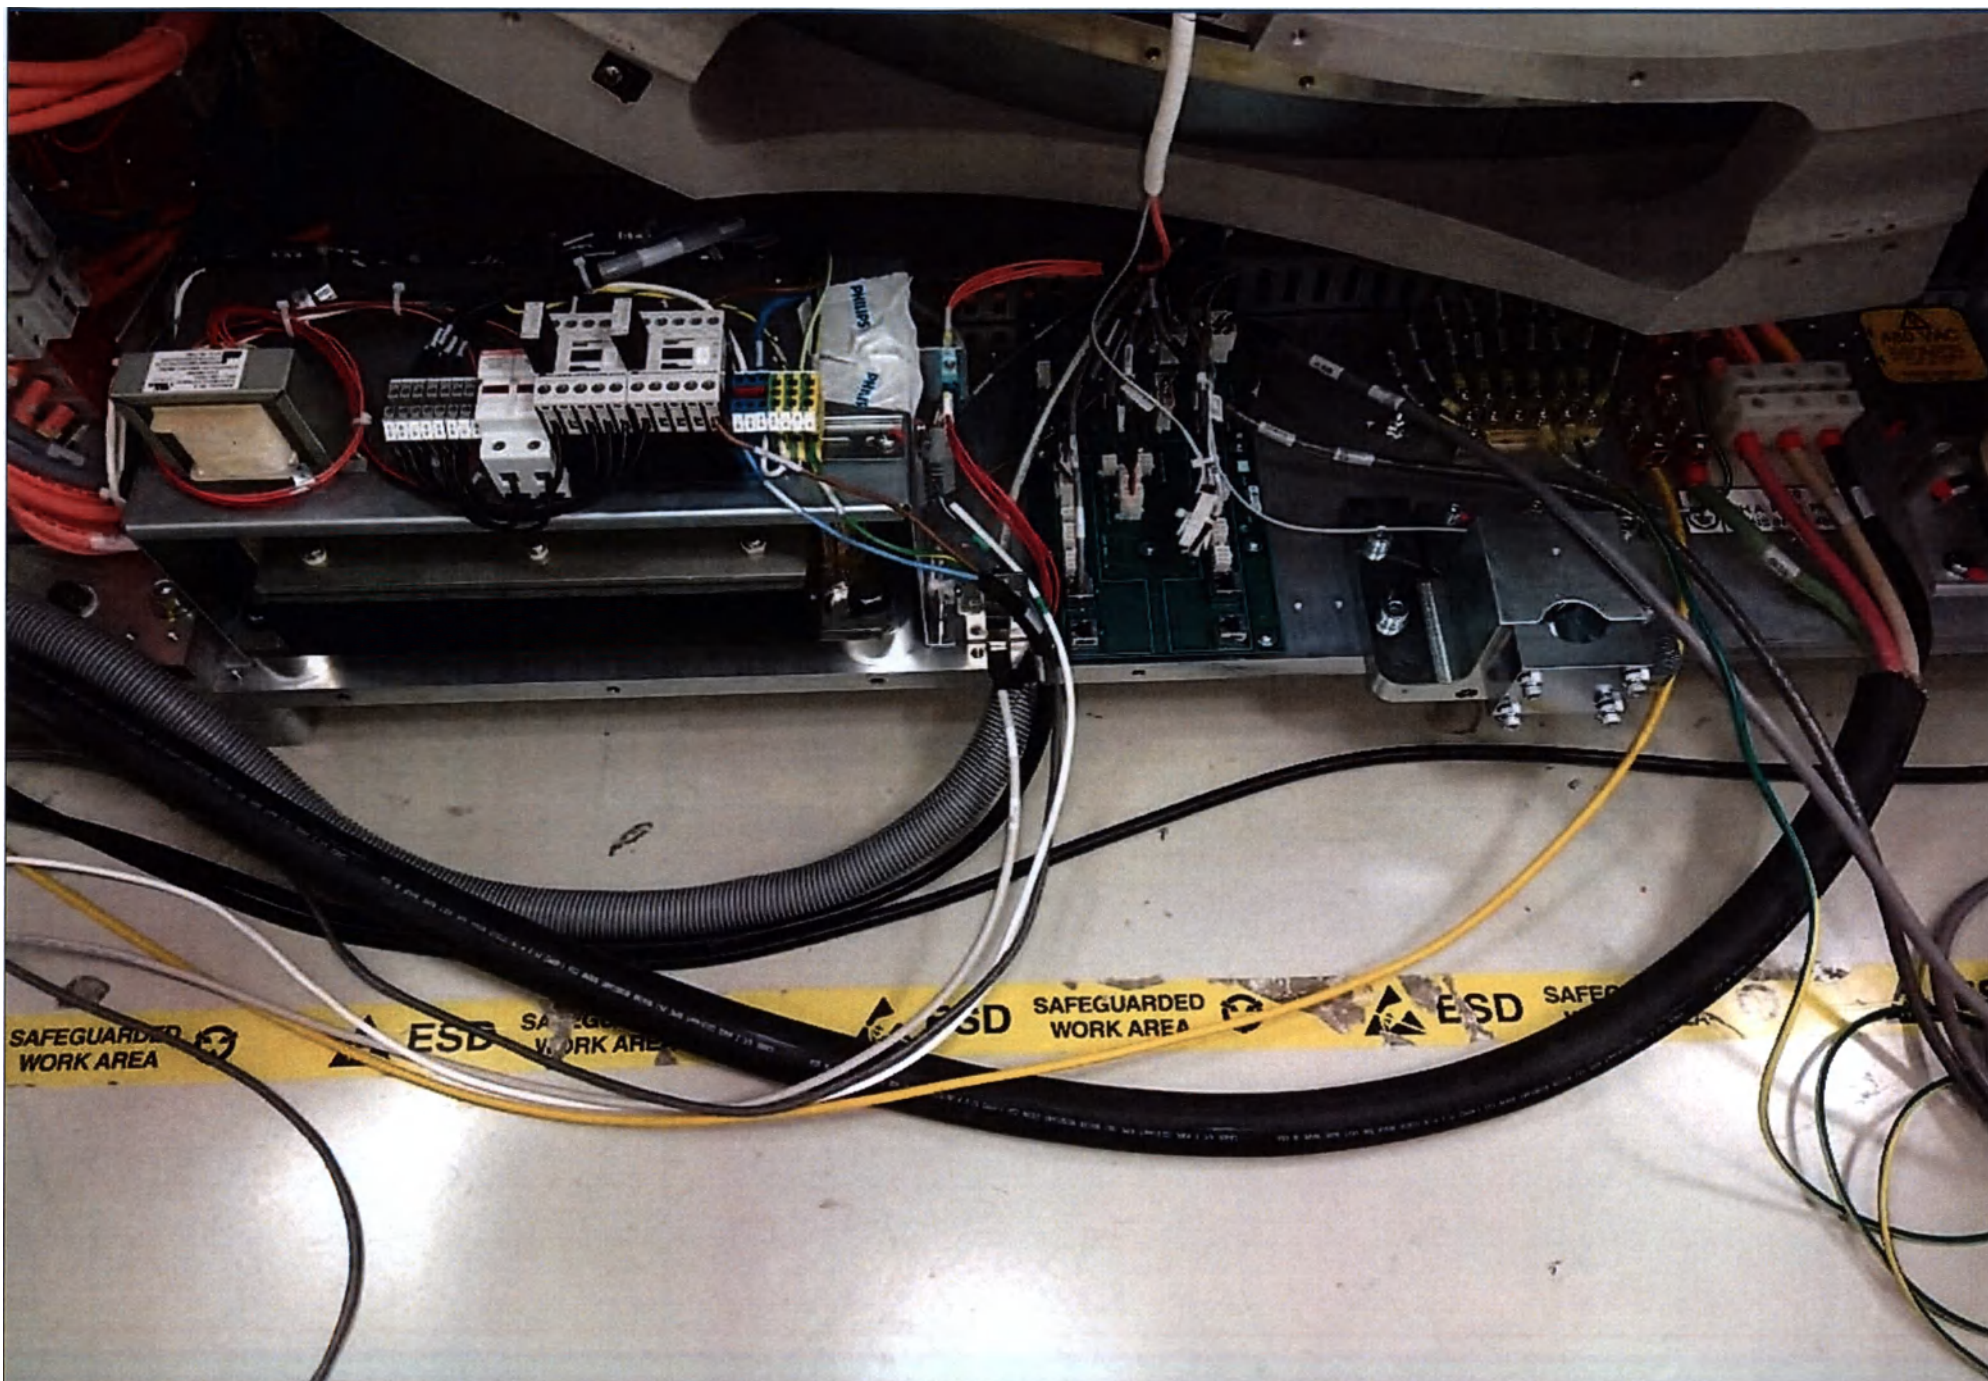

17. Кабели соединительные.



20. Интерактивная система контроля задержки дыхания для четырехмерного пульмонологического сканирования, в составе мембранный датчик, базовый блок датчика, дыхательные мониторы, 3 шт., монтажные кронштейны.



20б. Интерактивная система контроля задержки дыхания для четырехмерного пульмонологического сканирования, в составе мембранный датчик, базовый блок датчика, дыхательные мониторы, монтажные кронштейны.



20с. Интерактивная система контроля задержки дыхания для четырехмерного пульмонологического сканирования, в составе мембранный датчик, базовый блок датчика, дыхательные мониторы, монтажные кронштейны.



19d. Интерактивная система контроля задержки дыхания для четырехмерного пульмонологического сканирования, в составе мембранный датчик, базовый блок датчика, дыхательные мониторы, монтажные кронштейны.



20е. Интерактивная система контроля задержки дыхания для четырехмерного пульмонологического сканирования, в составе мембранный датчик, базовый блок датчика, дыхательные мониторы, монтажные кронштейны.

PROPERTY OF CT/AMI VALIDATION

Breath Hold™ ES *by Anemox* **ENGINEERING MATERIAL**
● ● ● ● ● ● ● ●
MONITOR SYSTEM, PATIENT DISPLAY

20f. Интерактивная система контроля задержки дыхания для четырехмерного пульмонологического сканирования, в составе мембранный датчик, базовый блок датчика, дыхательные мониторы, монтажные кронштейны.



20g. Интерактивная система контроля задержки дыхания для четырехмерного пульмонологического сканирования, в составе мембранный датчик, базовый блок датчика, дыхательные мониторы, монтажные кронштейны.

Справочное
руководство

Русский

459801377181_A




Vereos PET/CT System

PHILIPS

21. Эксплуатационная документация на бумажных и электронных носителях.

Принадлежности

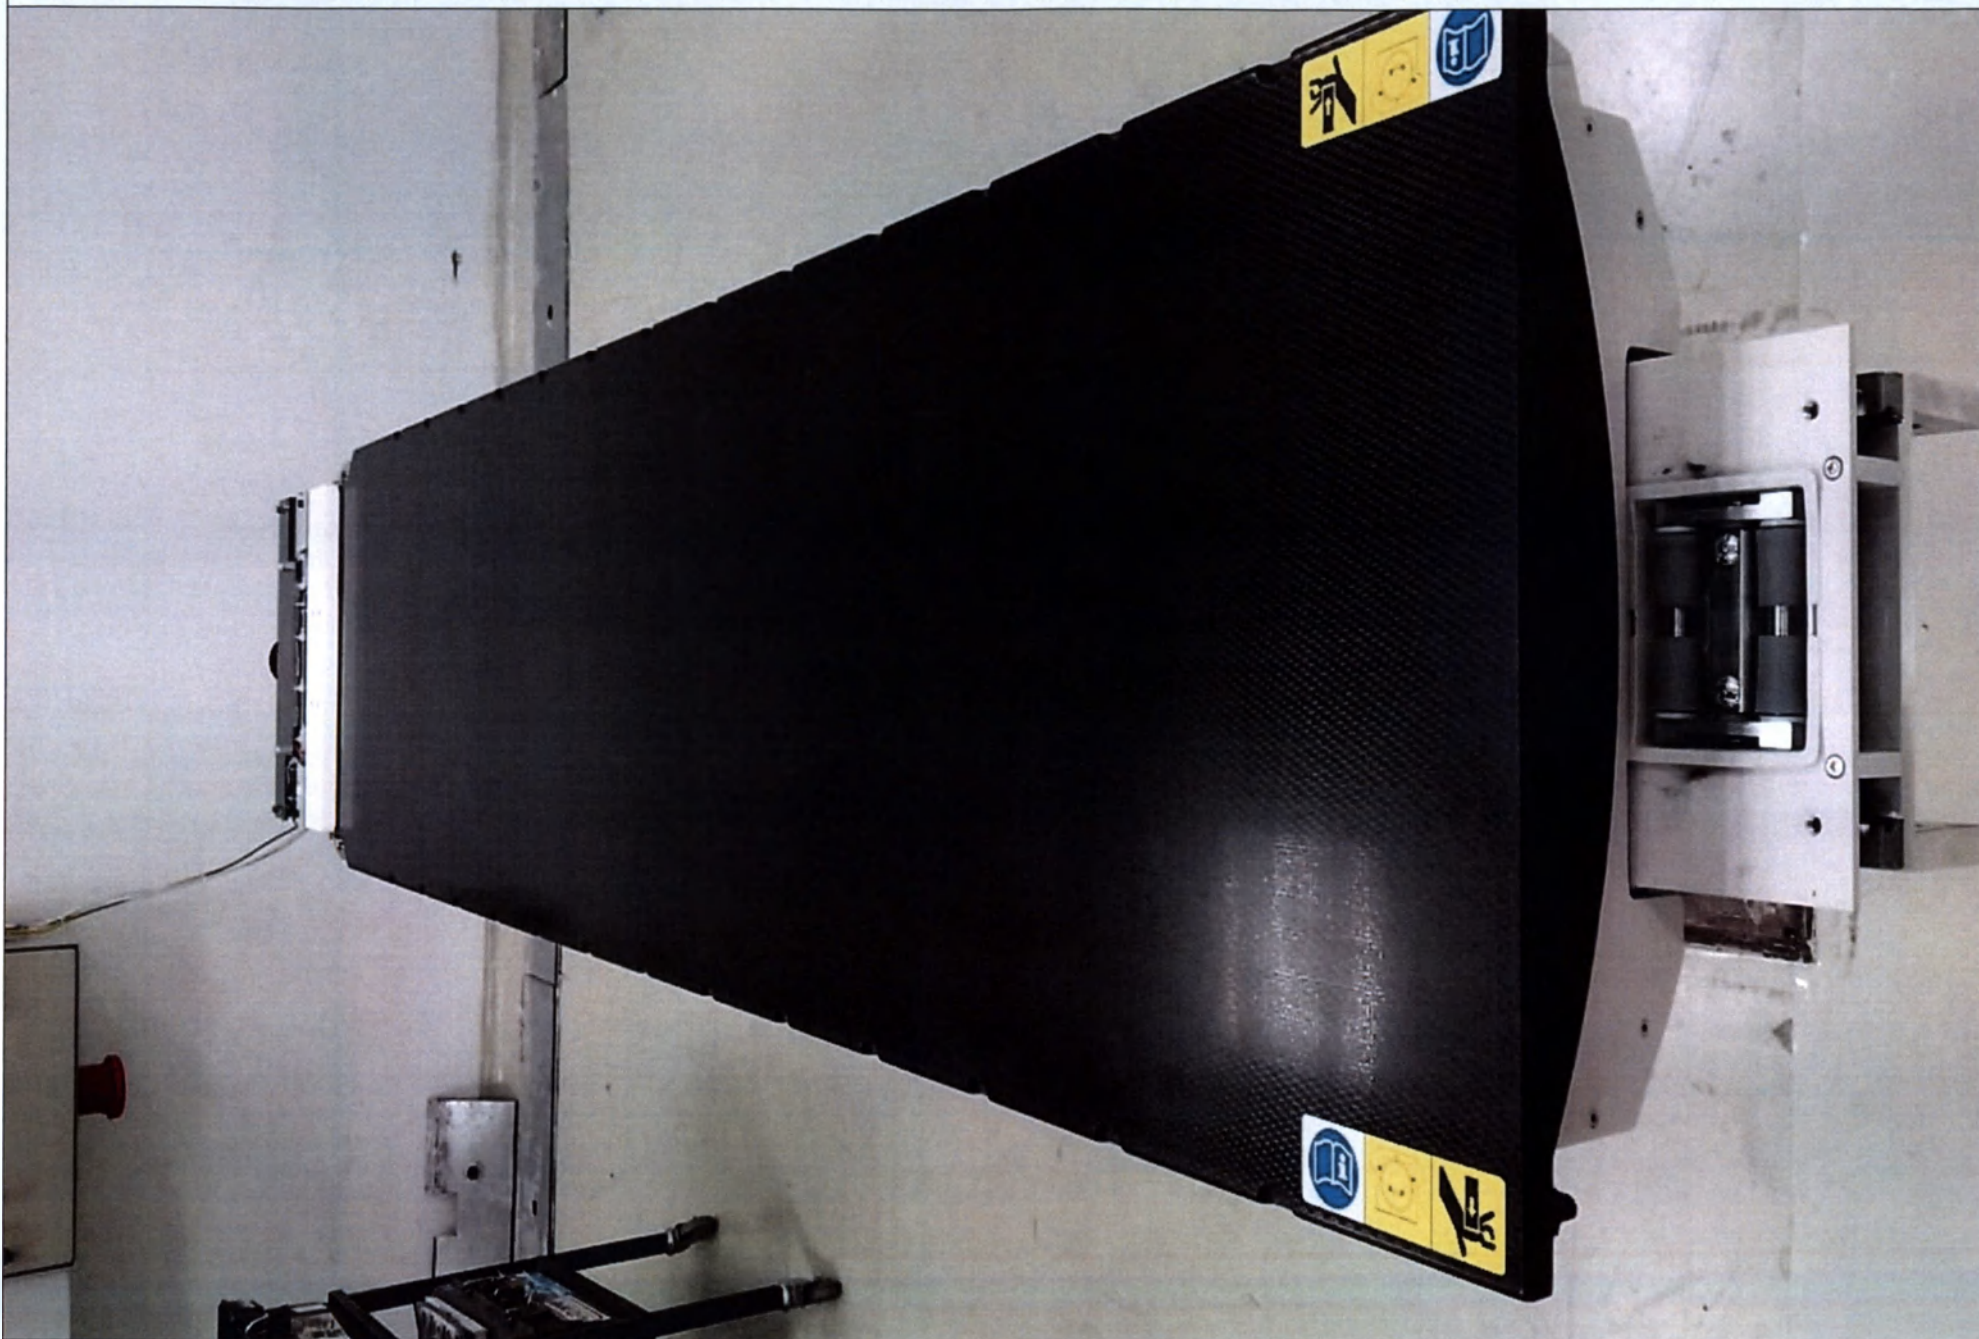

1. Плоский паллет для стола пациента.



2а. Источник бесперебойного питания.



2б. Источник бесперебойного питания.



2с. Источник бесперебойного питания.



2д. Источник бесперебойного питания.



Terminal Hardware Torque:
5.5 Nm $\pm$ 5%
Retorque: @ 80%

3. Батареи аккумуляторные.



4а. Приспособления для удобства пациента: матрацы для стола пациента.



4б. Приспособления для удобства пациента: матрацы для стола пациента.



4е. Приспособления для удобства пациента: матрацы для стола пациента.



4f. Приспособления для удобства пациента: прокладки для колена/стопы



4g. Приспособления для удобства пациента: прокладки для колена/стоны



4h. Приспособления для удобства пациента: прокладки для руки/плеча



4i. Приспособления для удобства пациента: прокладки для руки/плеча



4j. Приспособления для удобства пациента: подголовник.




4к. Приспособления для удобства пациента: подголовник.



41. Приспособления для удобства пациента: подлокотники.



4т. Приспособления для удобства пациента: подлокотники.

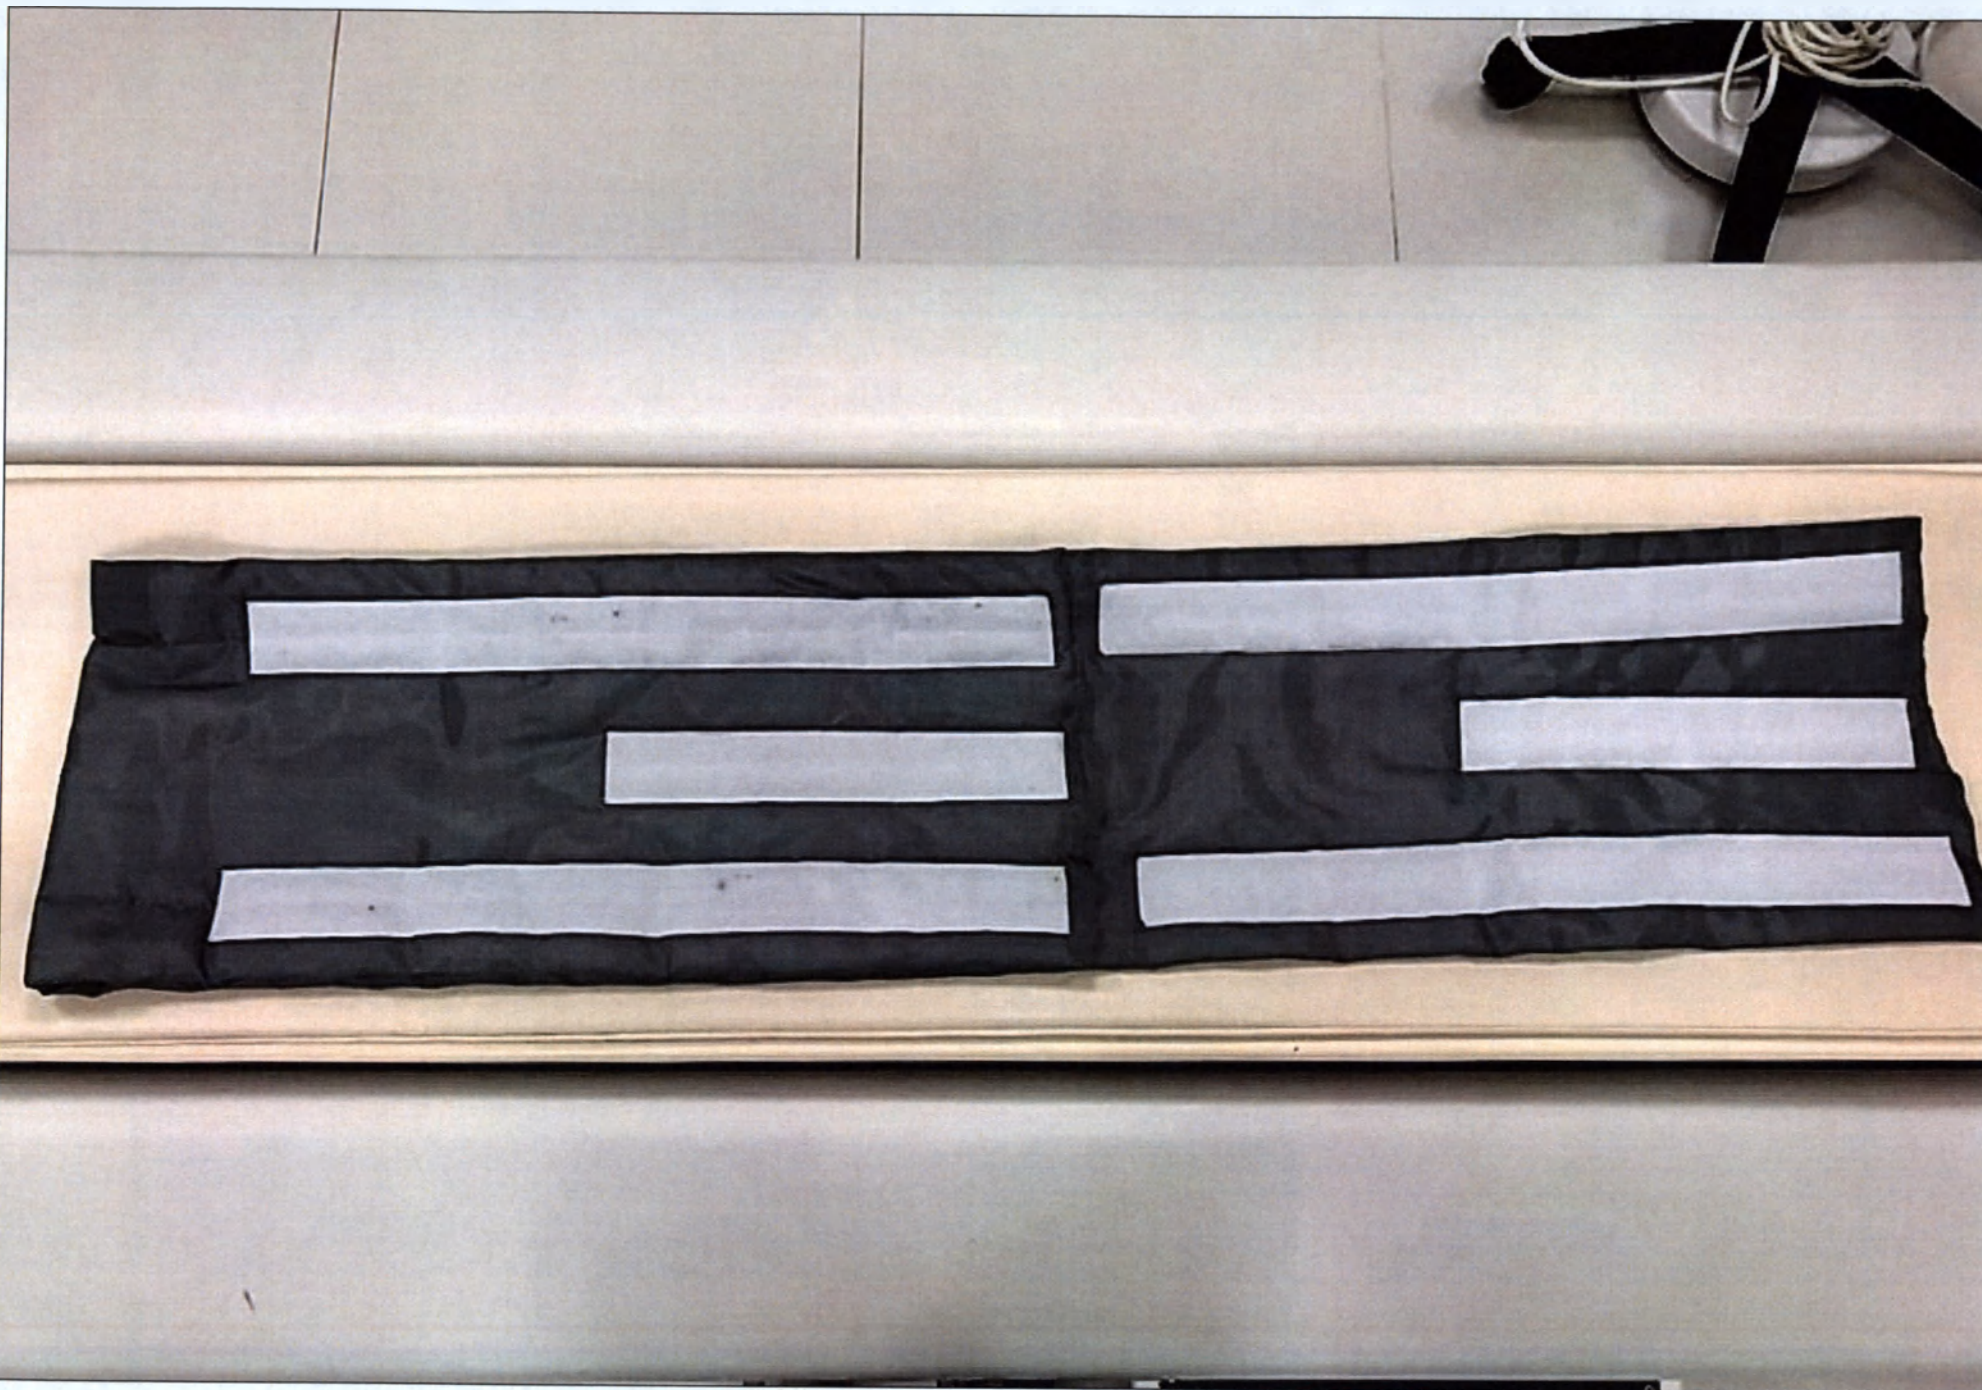

4п. Приспособления для удобства пациента: ремень для фиксации рук.




4о. Приспособления для удобства пациента: ремень для фиксации рук.




4р. Приспособления для удобства пациента: ремень для фиксации тела.




4г. Приспособления для удобства пациента: ремень для фиксации тела.

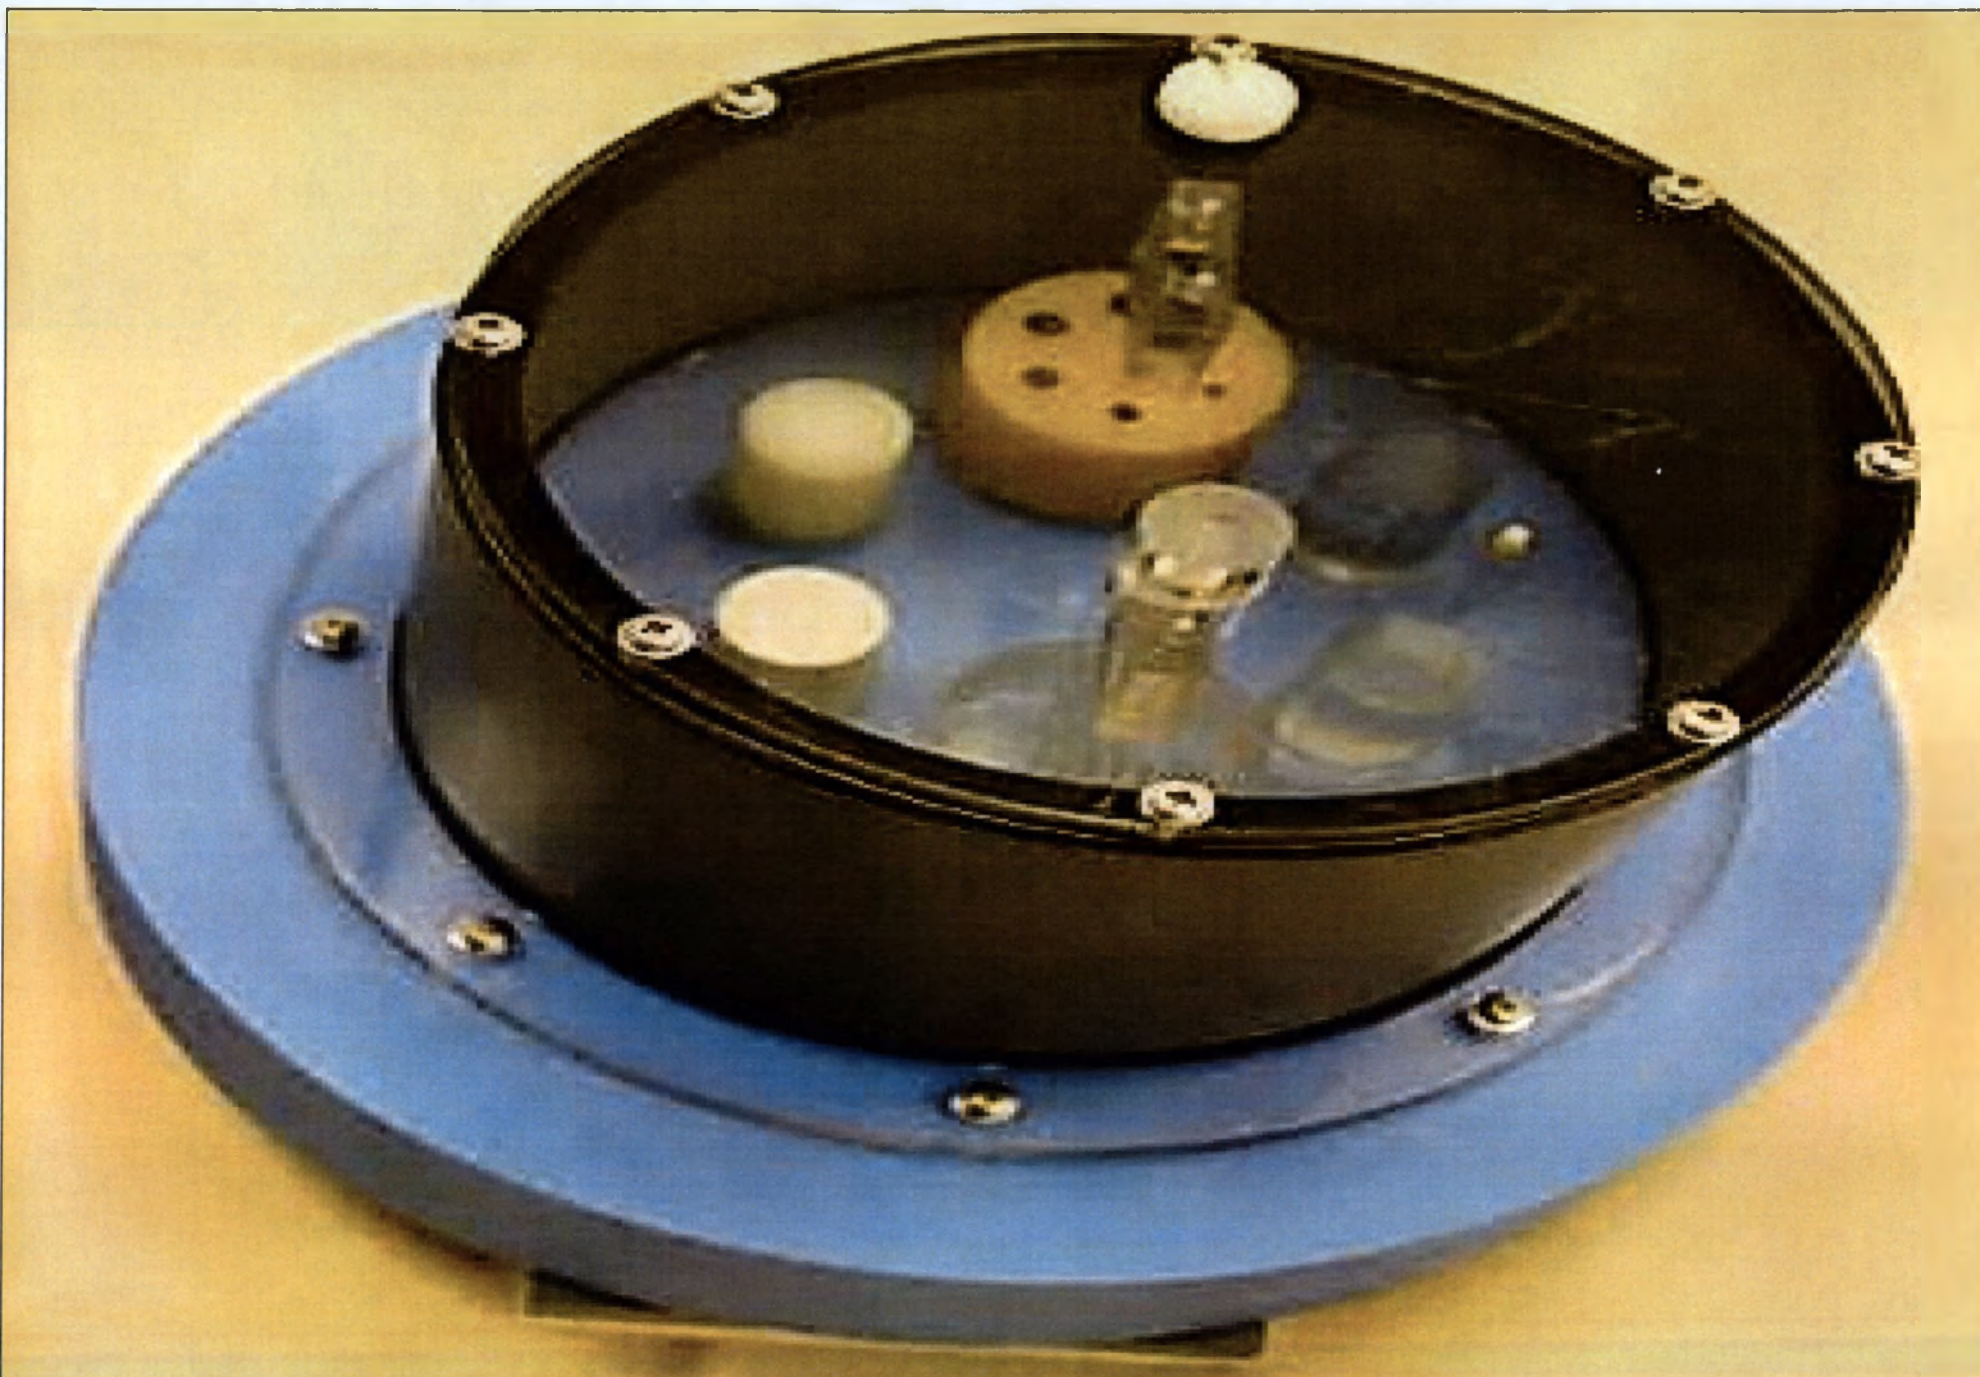


5а. Фантомы калибровочные, для проверки качества изображений

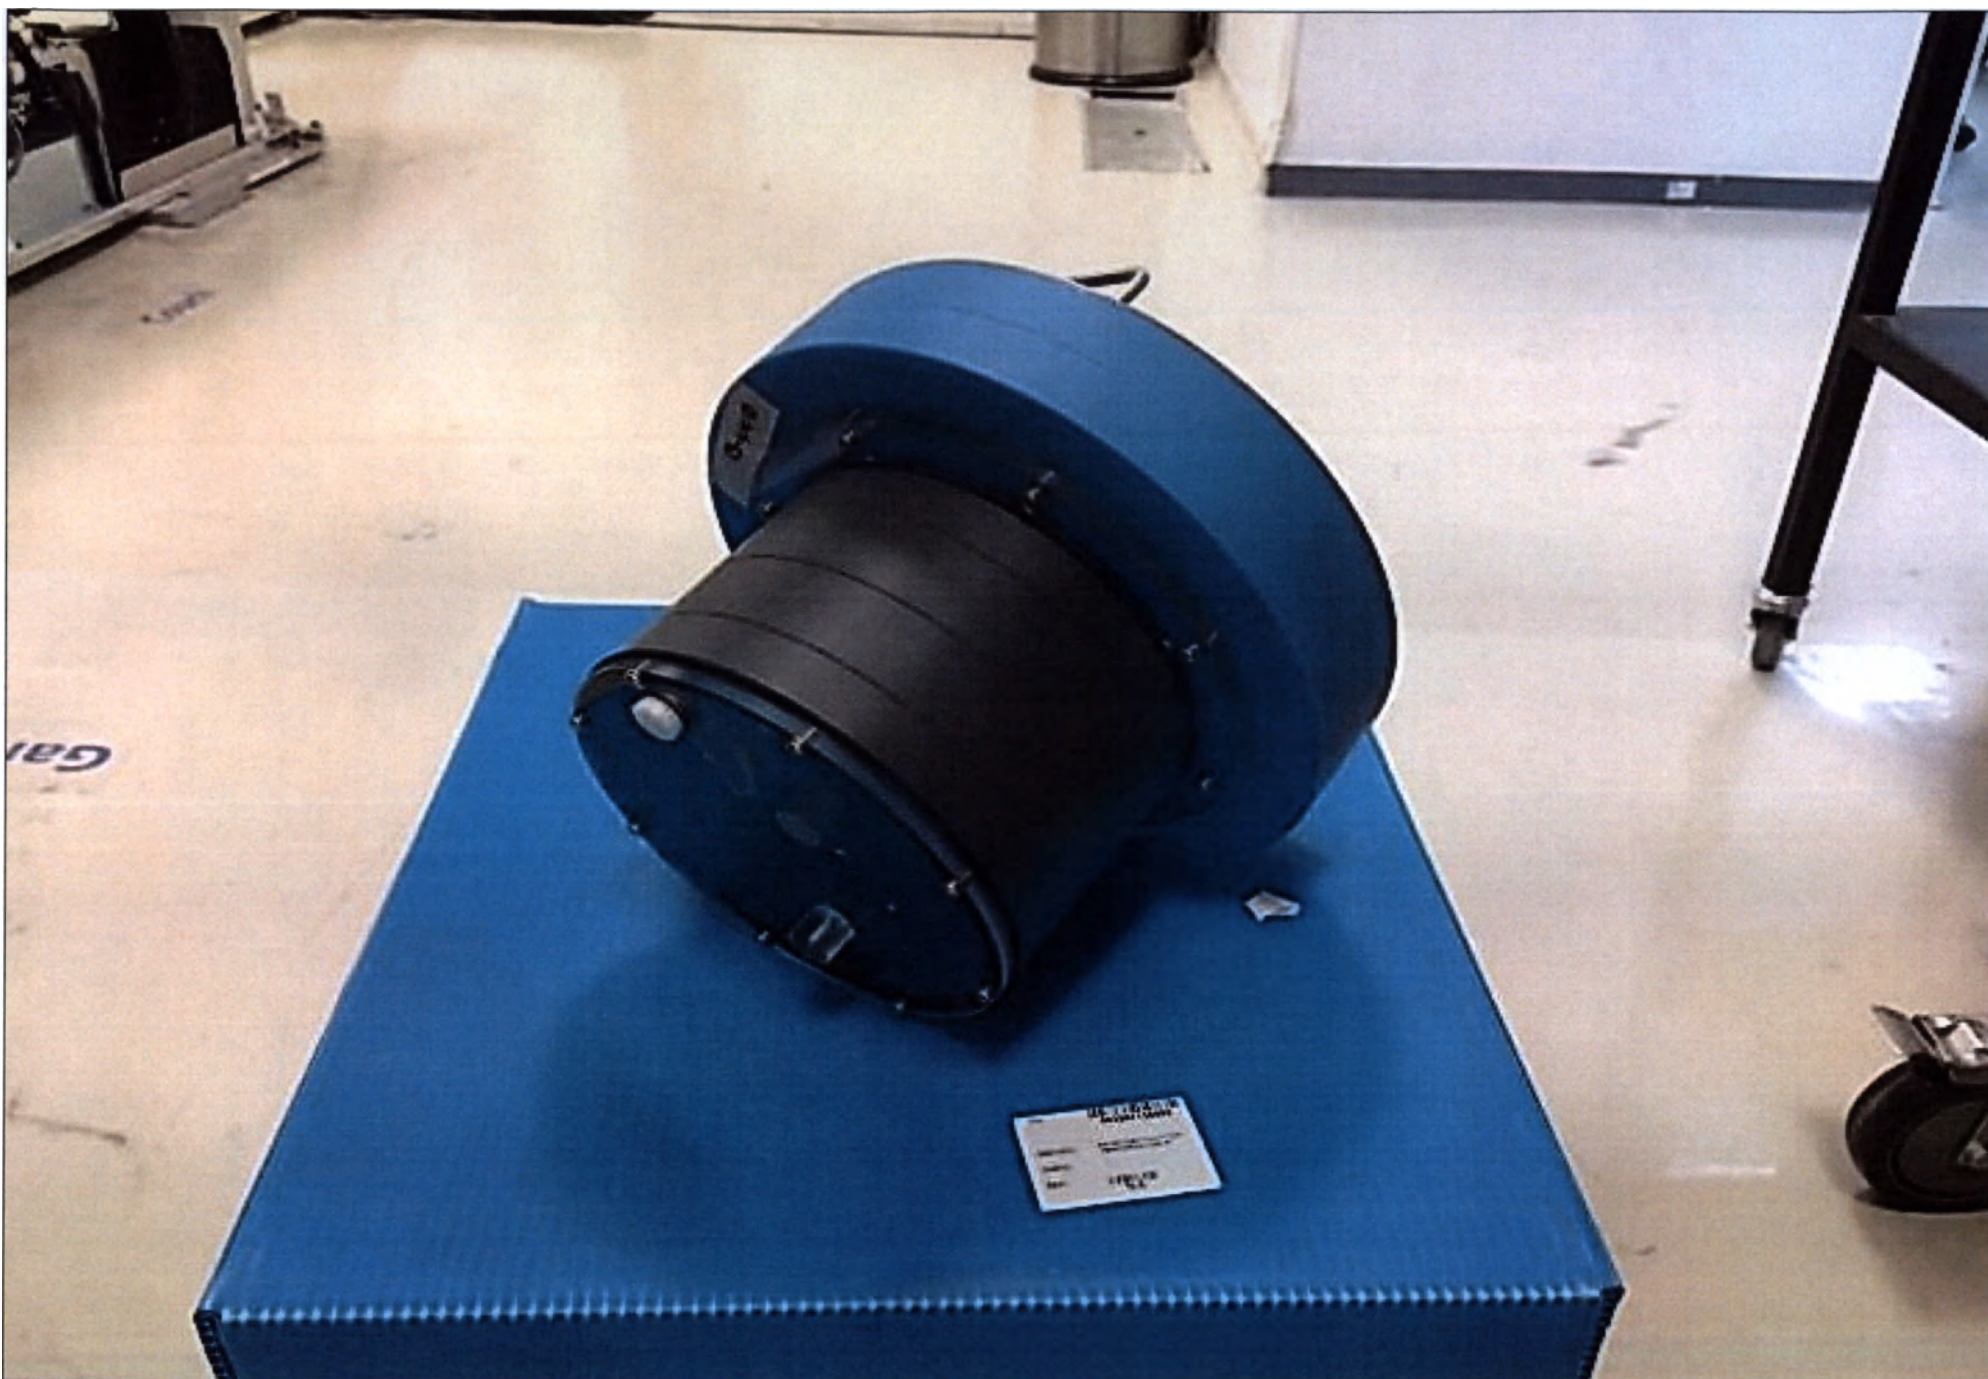


5б. Фантомы калибровочные, для проверки качества изображений

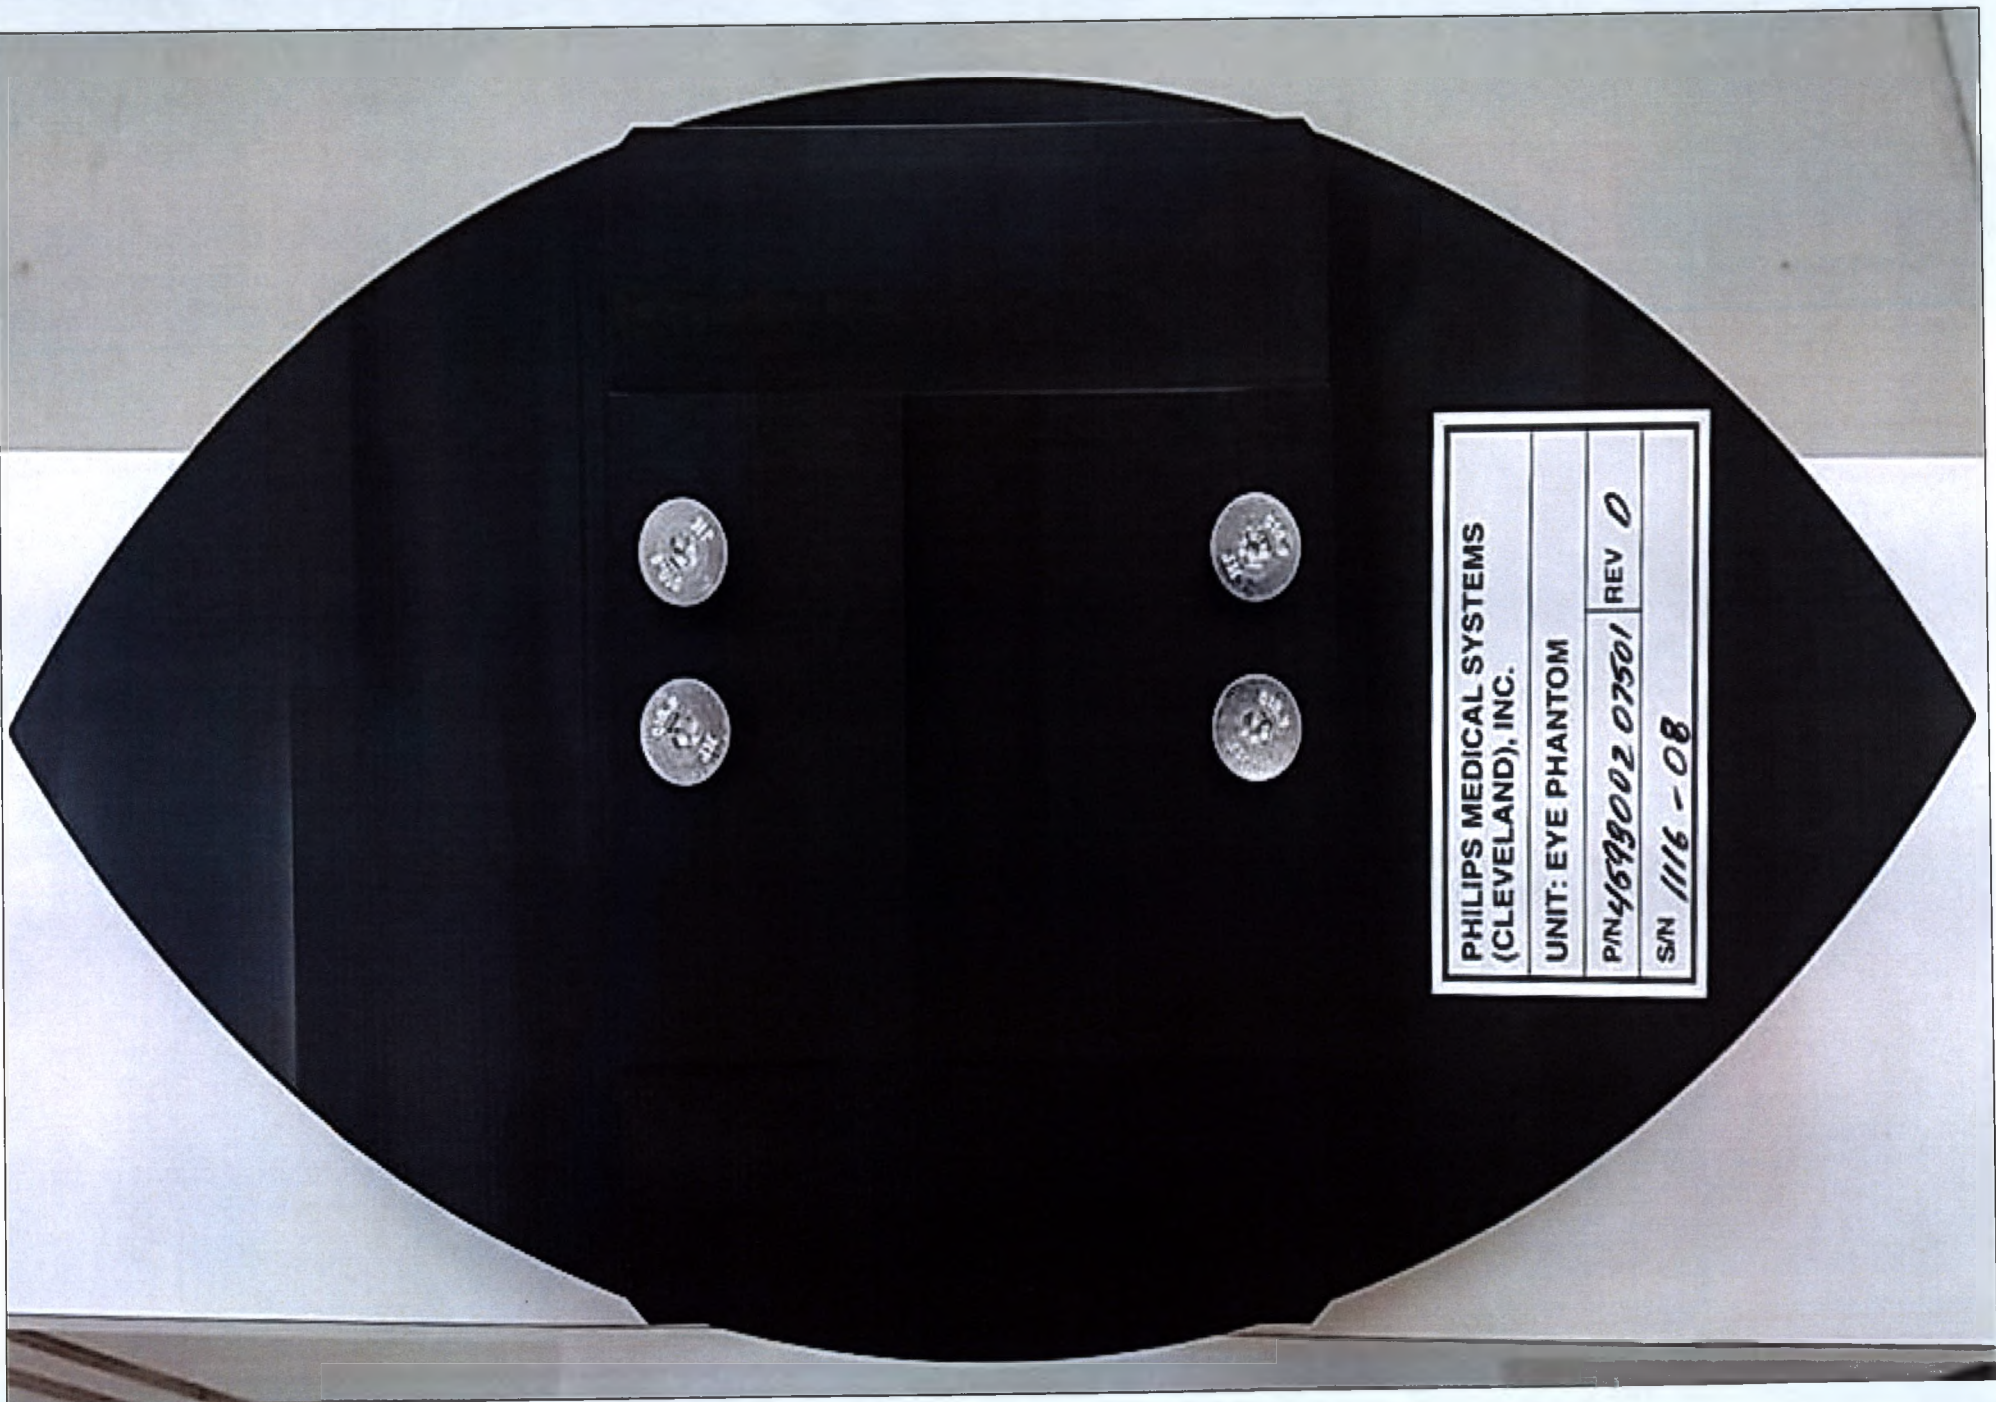


5с. Фантомы калибровочные, для проверки качества изображений

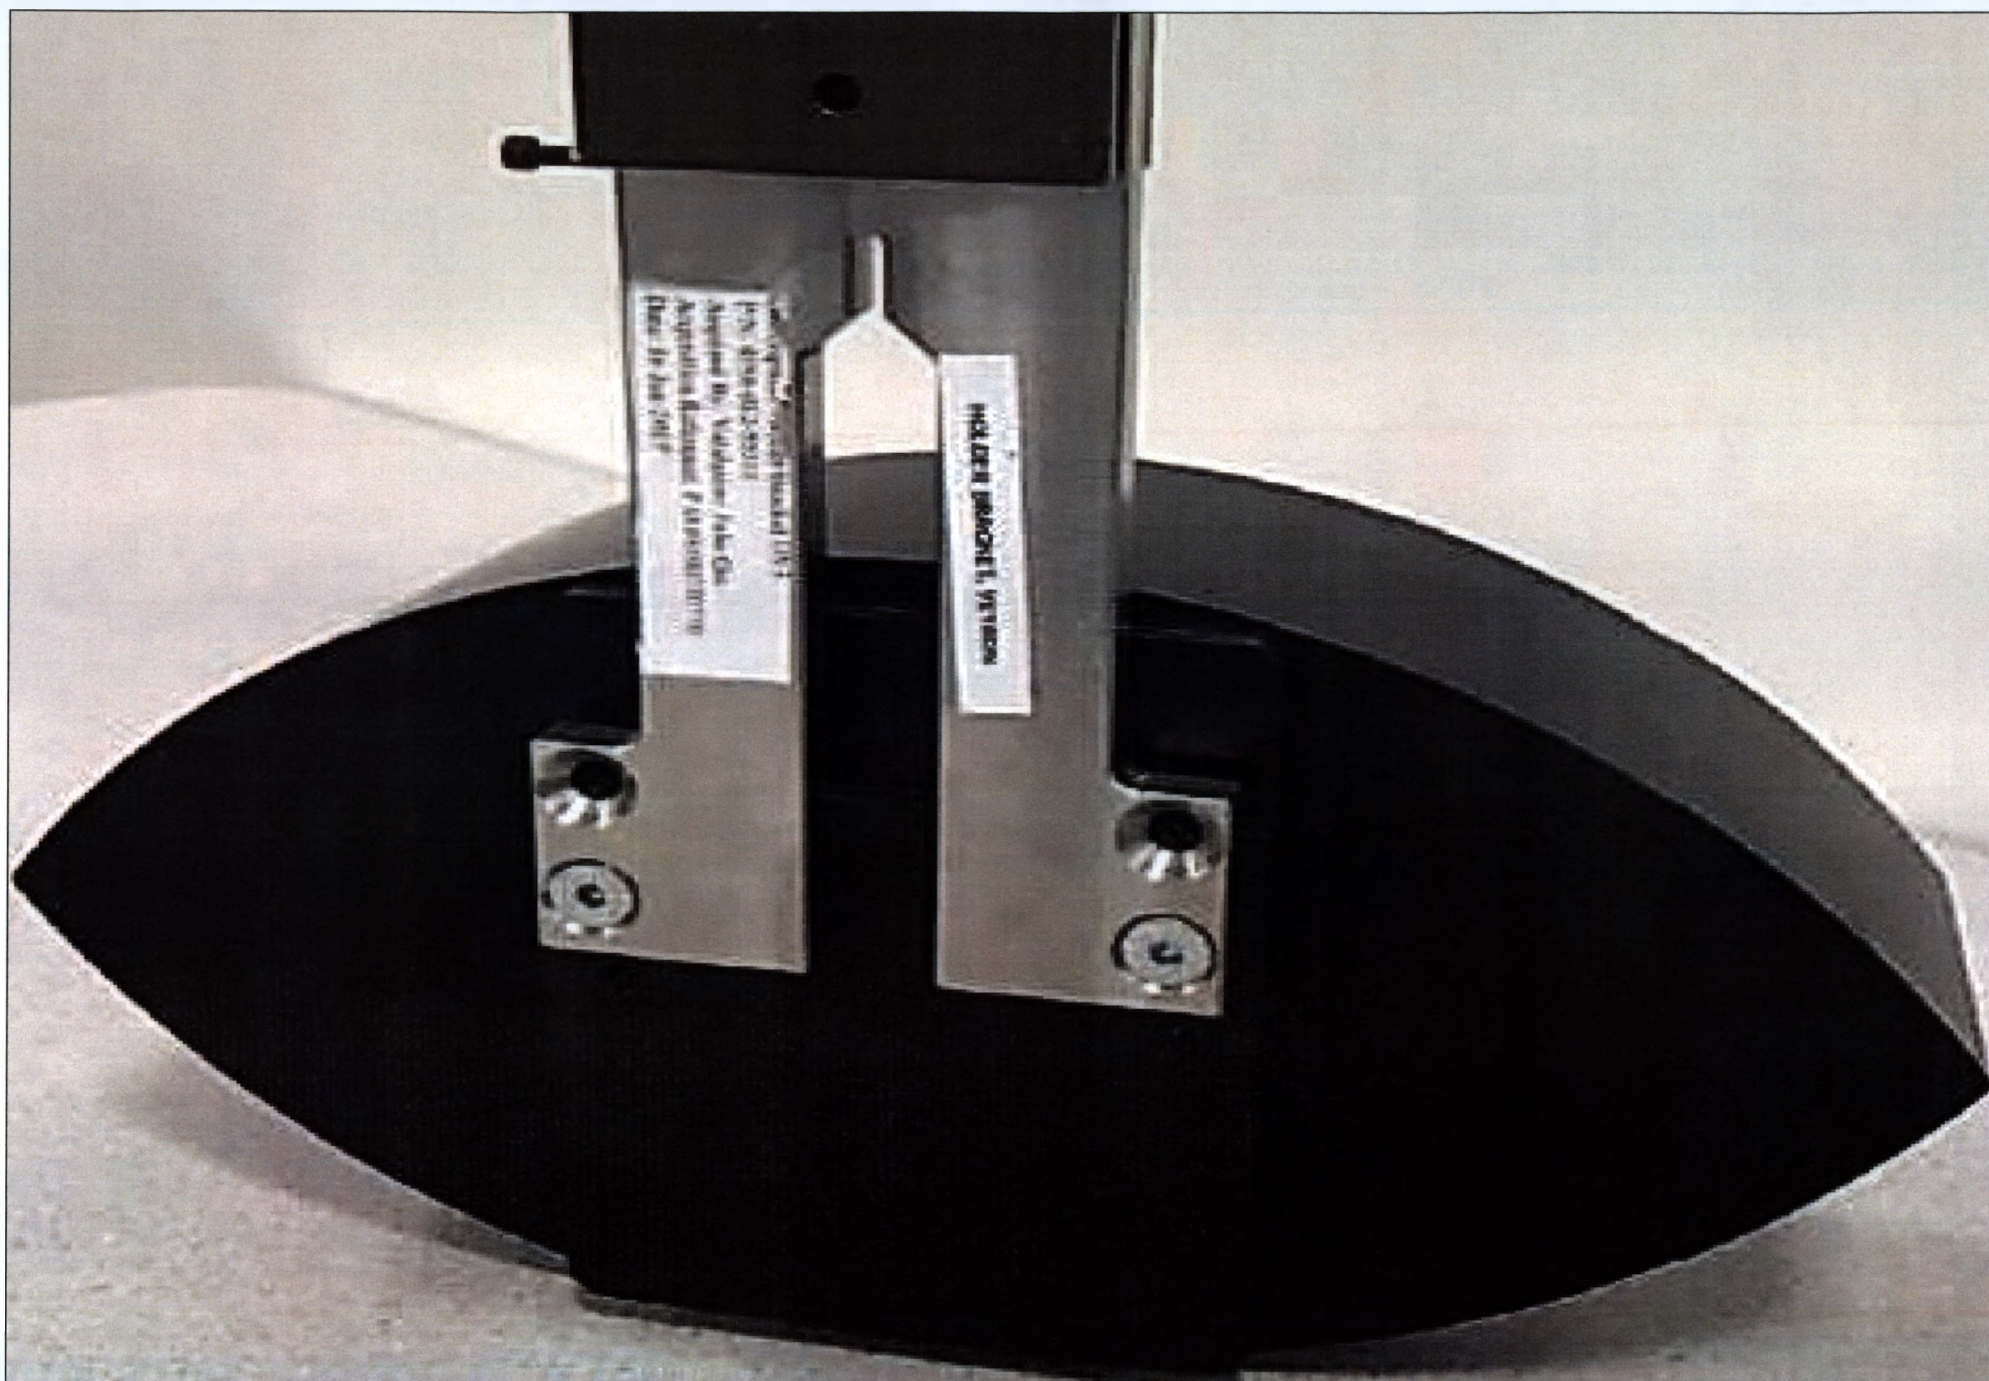


5d. Фантомы калибровочные, для проверки качества изображений

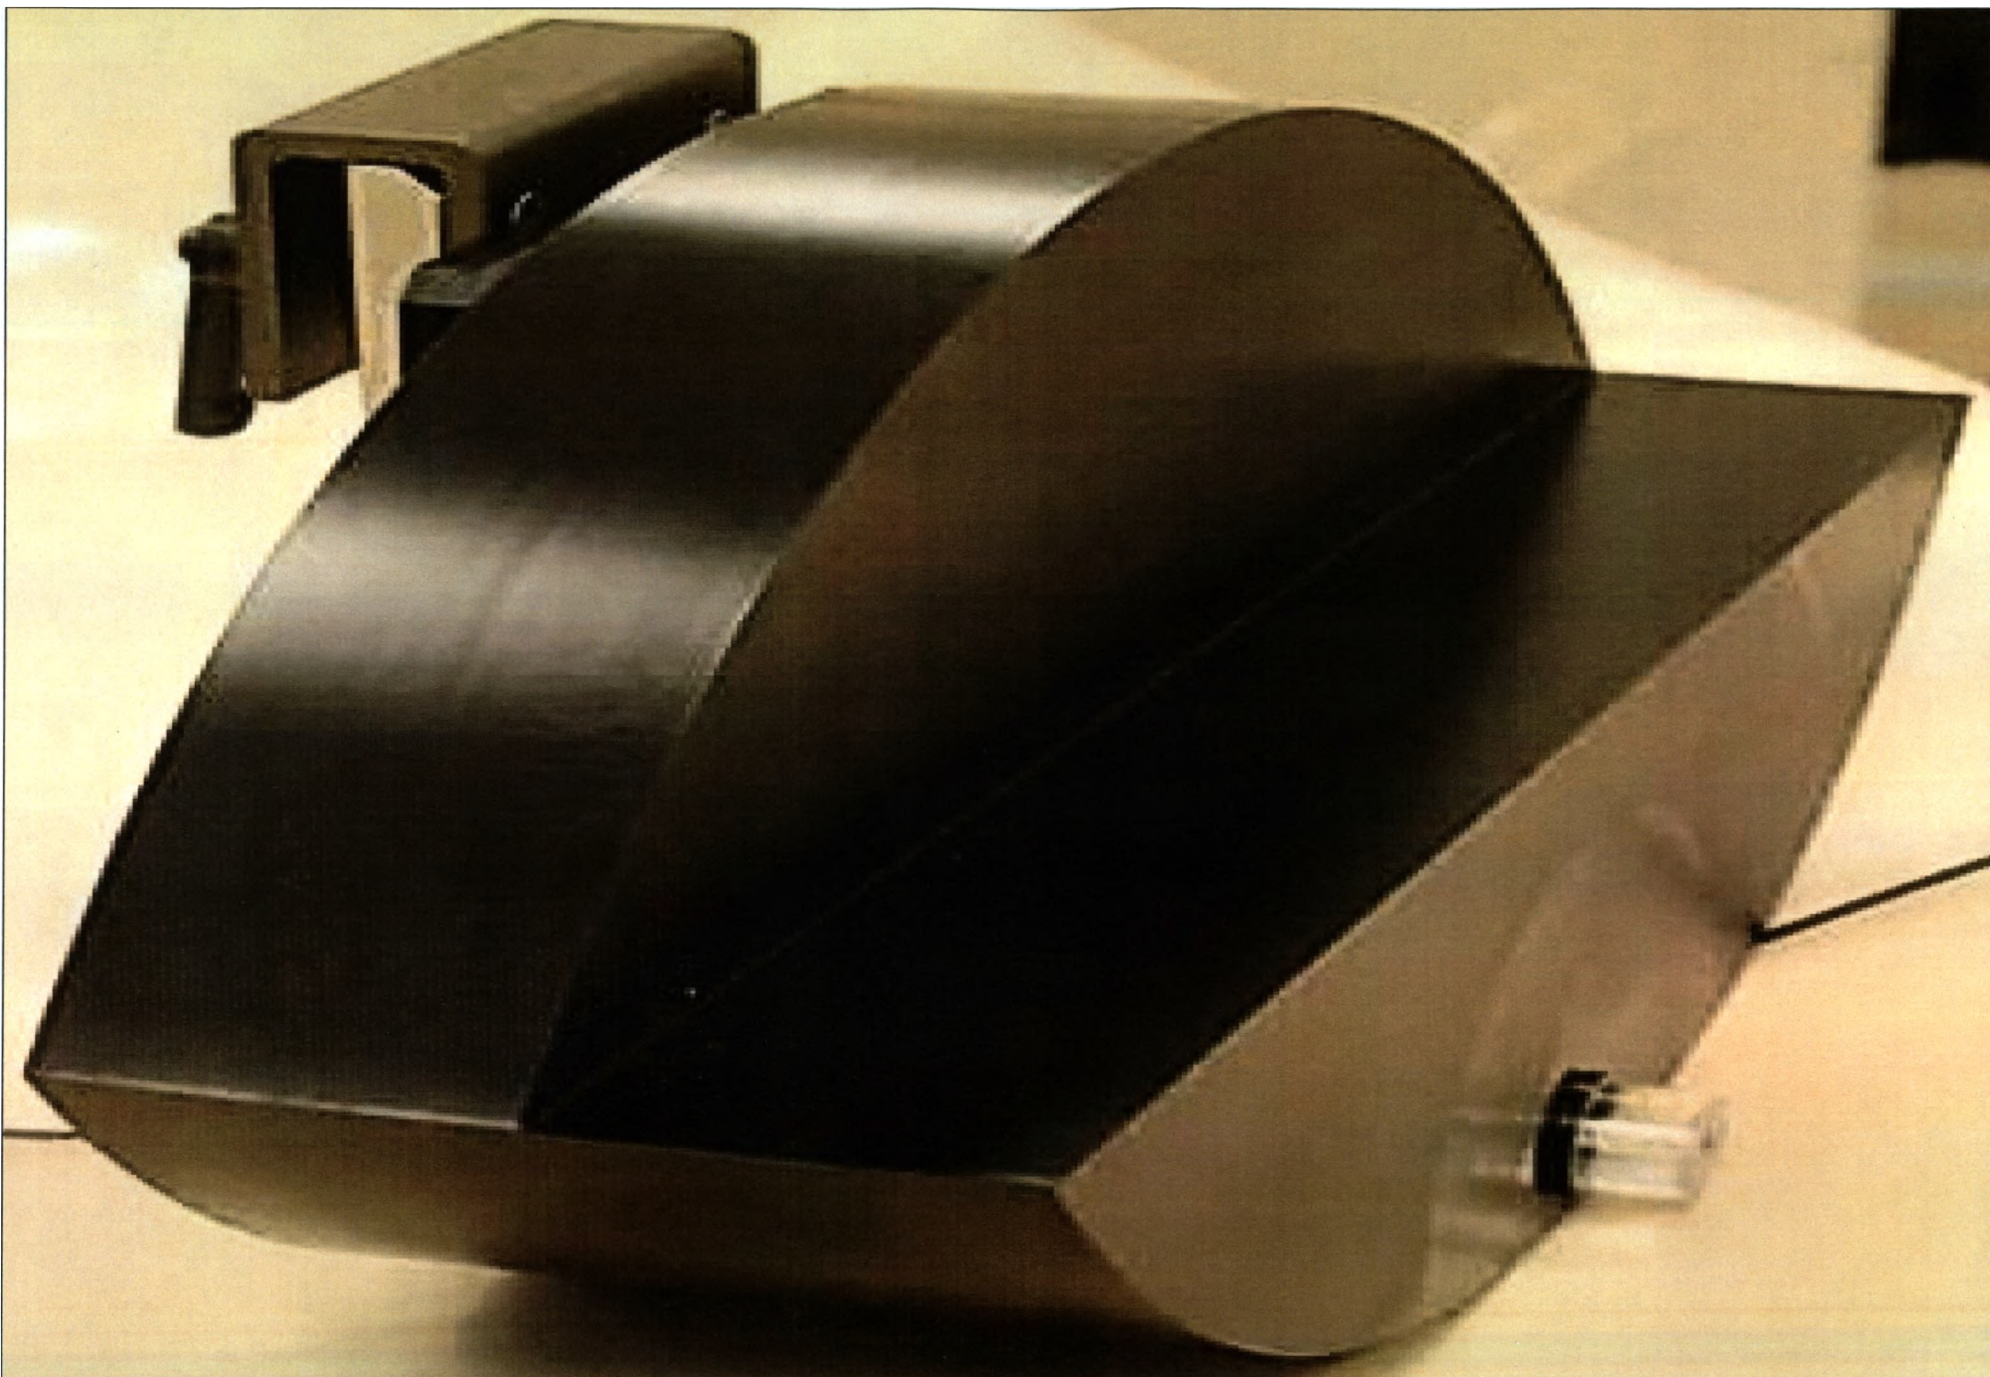


5е. Фантомы калибровочные, для проверки качества изображений

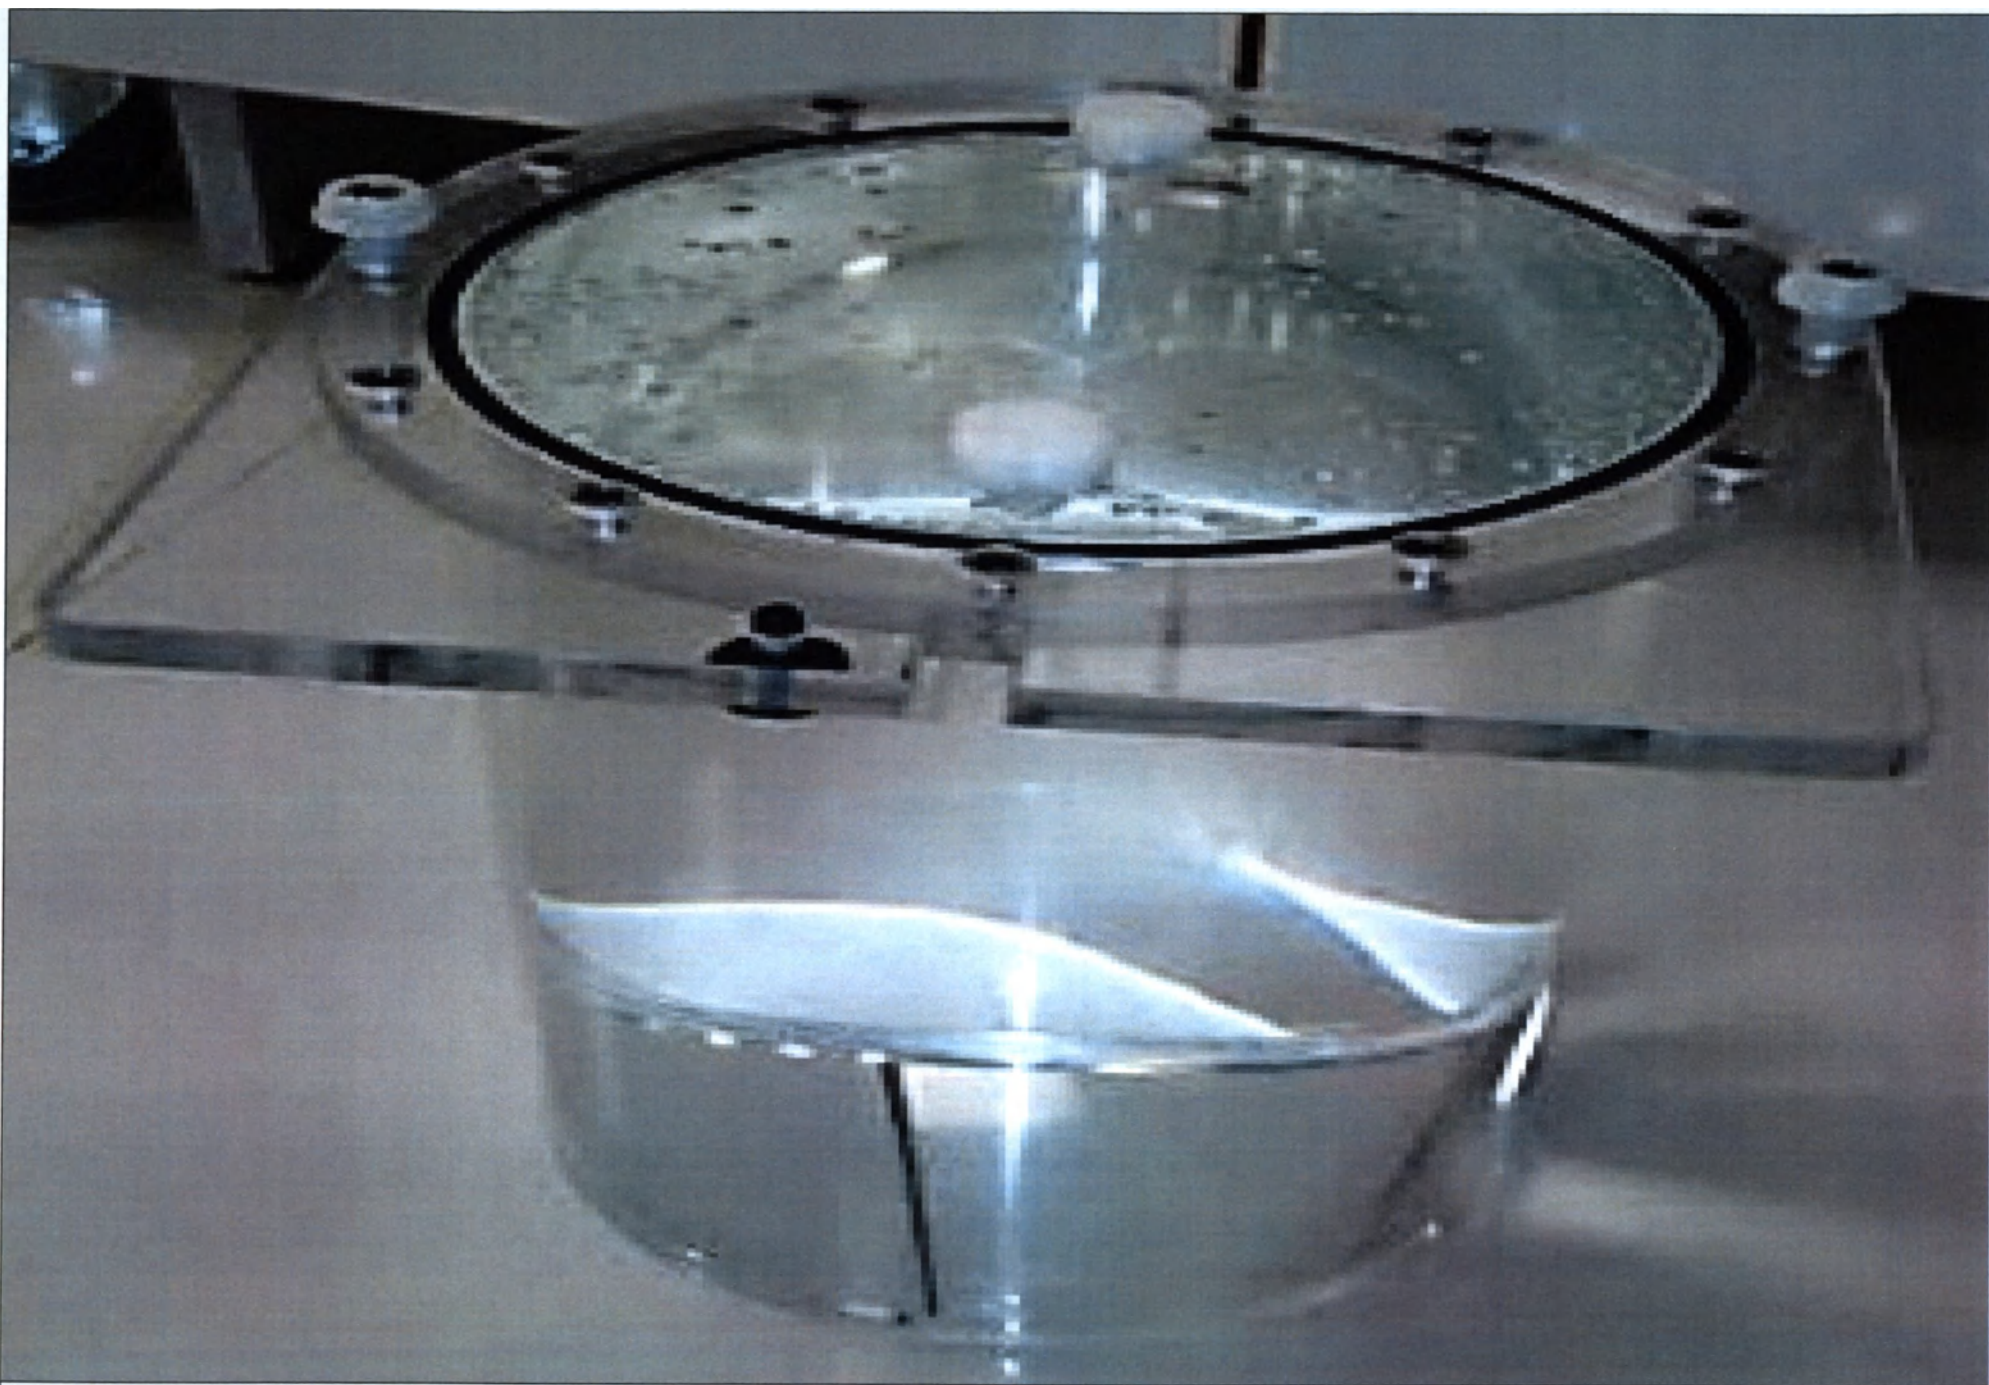


5f. Фантомы калибровочные, для проверки качества изображений

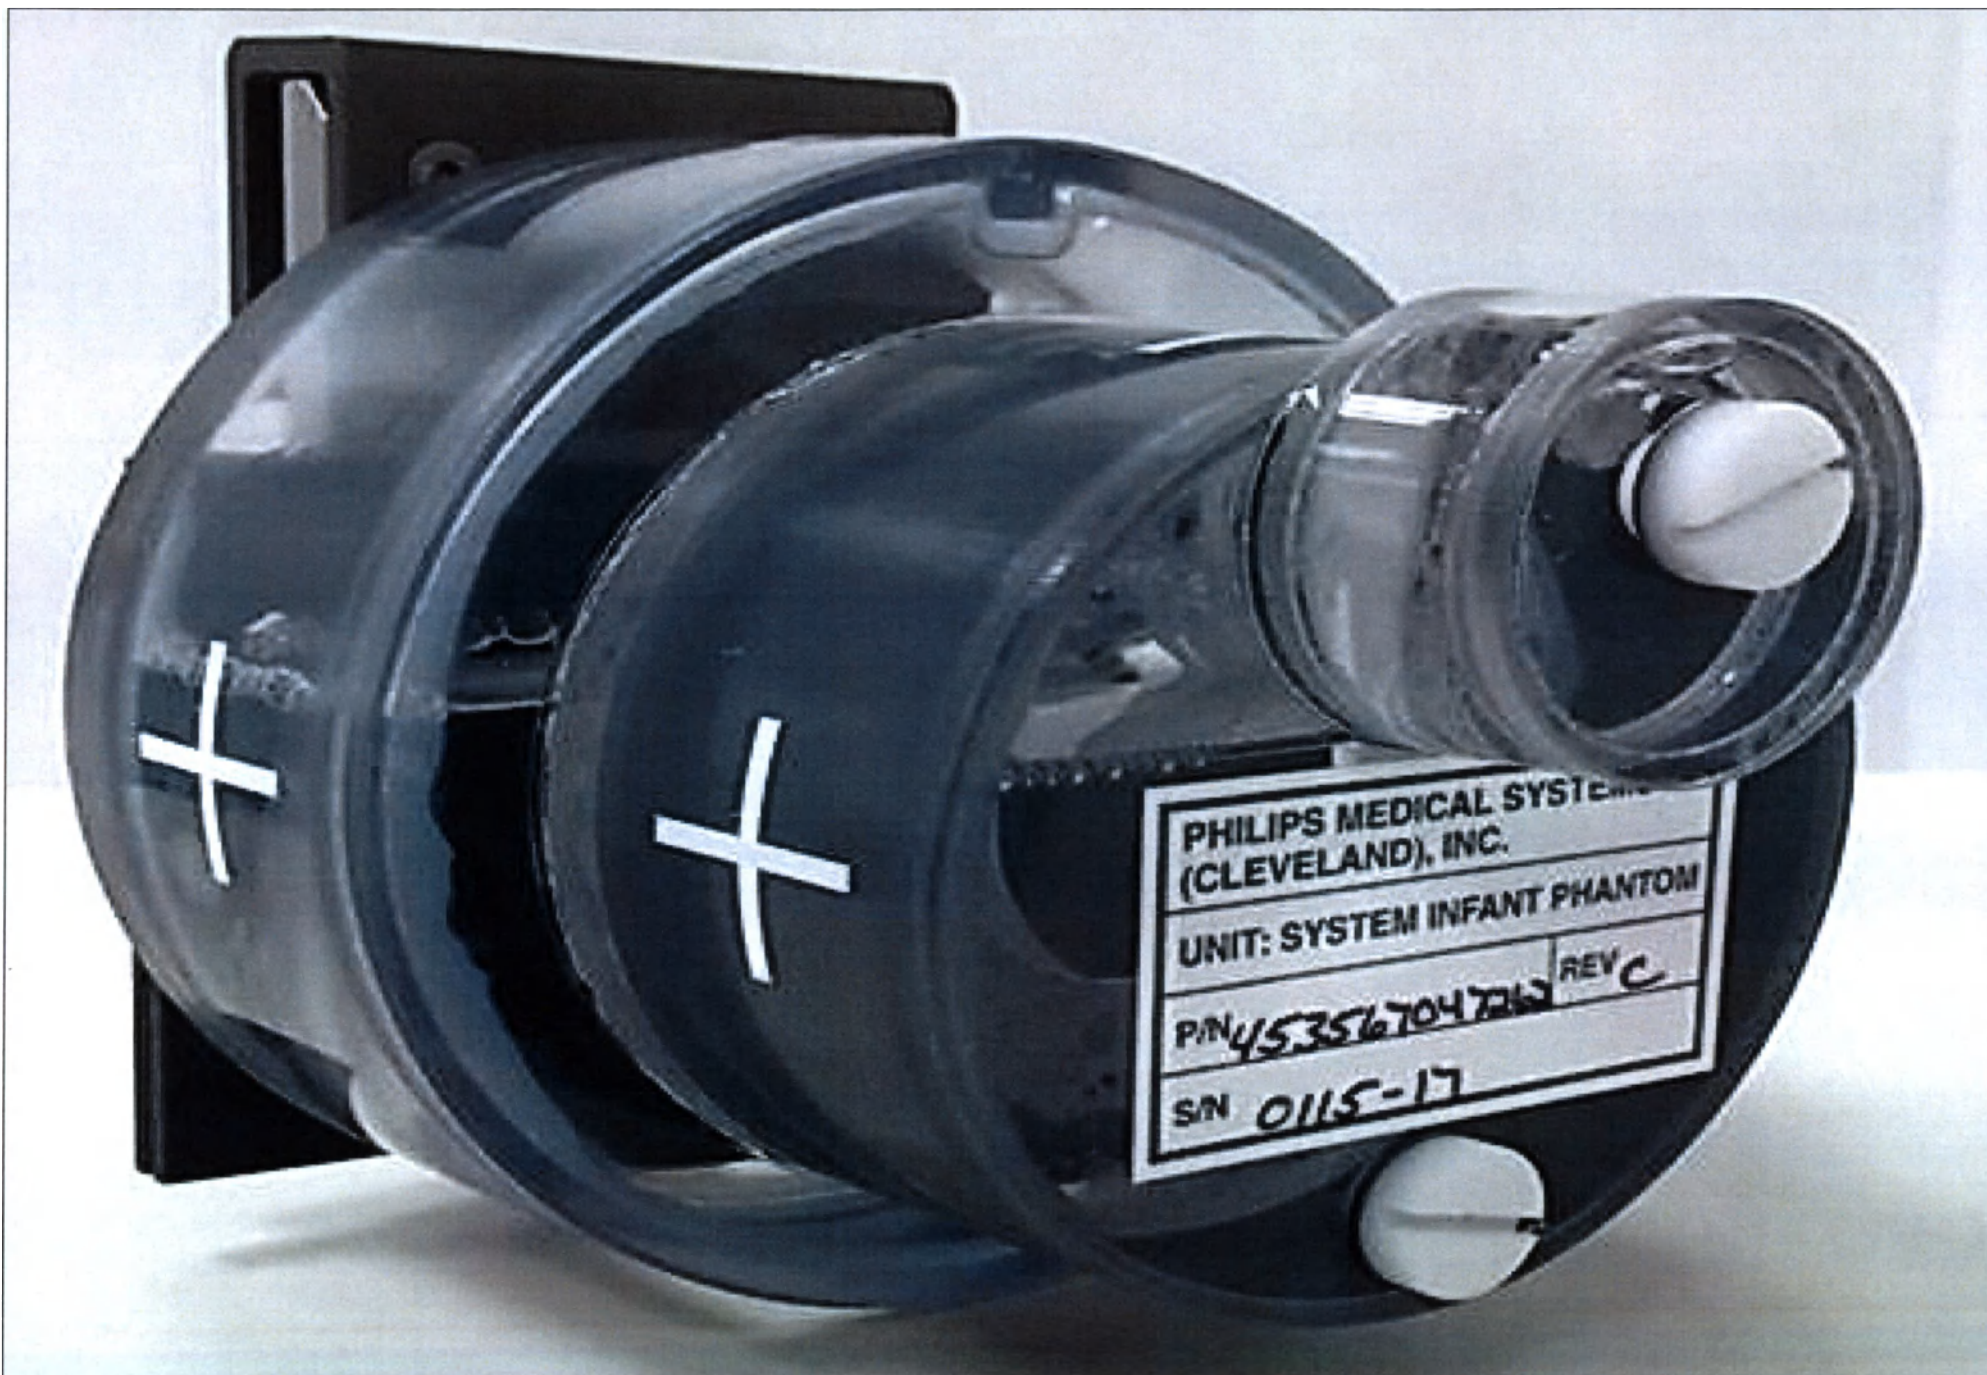


5г. Фантомы калибровочные, для проверки качества изображений

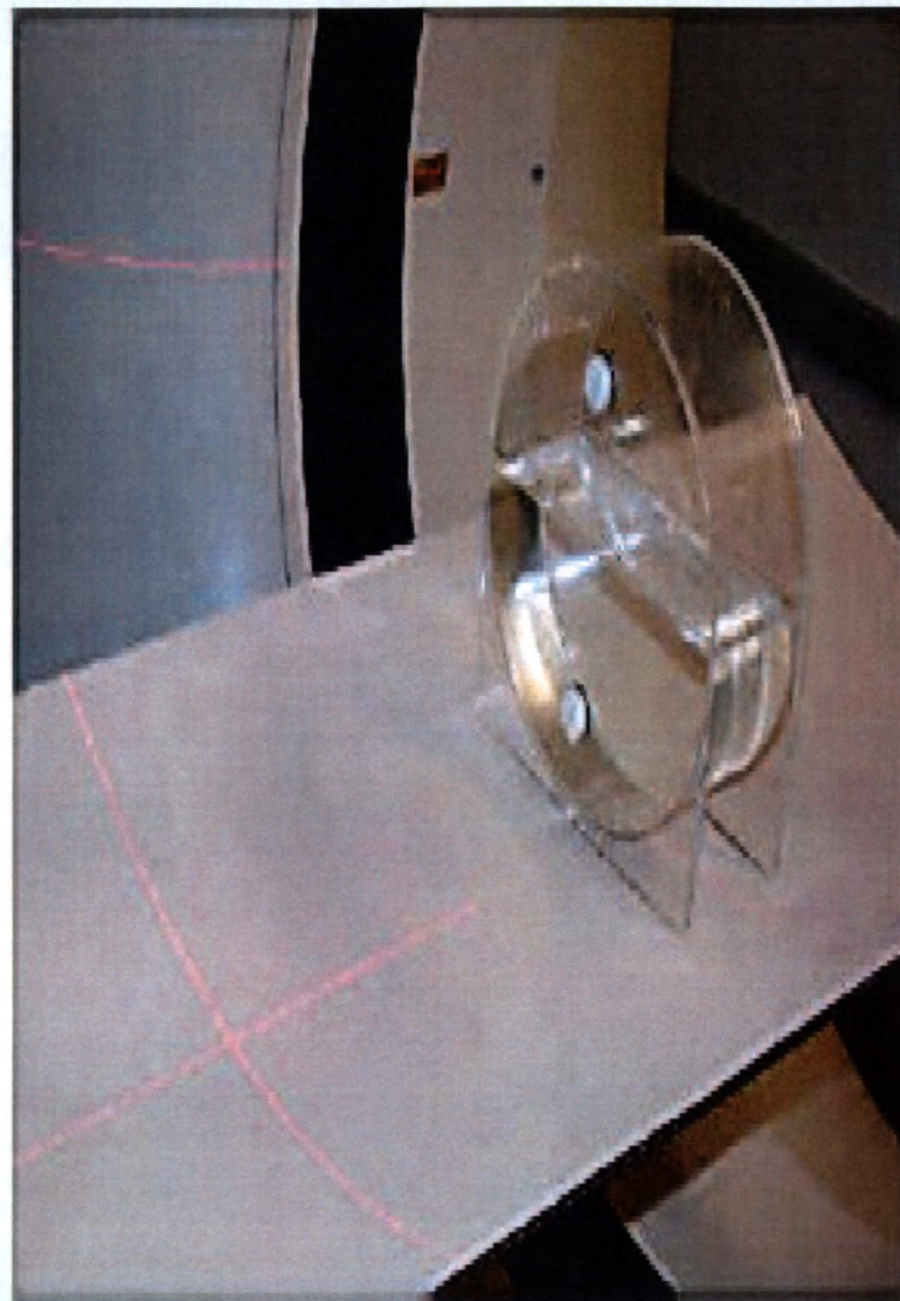


5h. Фантомы калибровочные, для проверки качества изображений

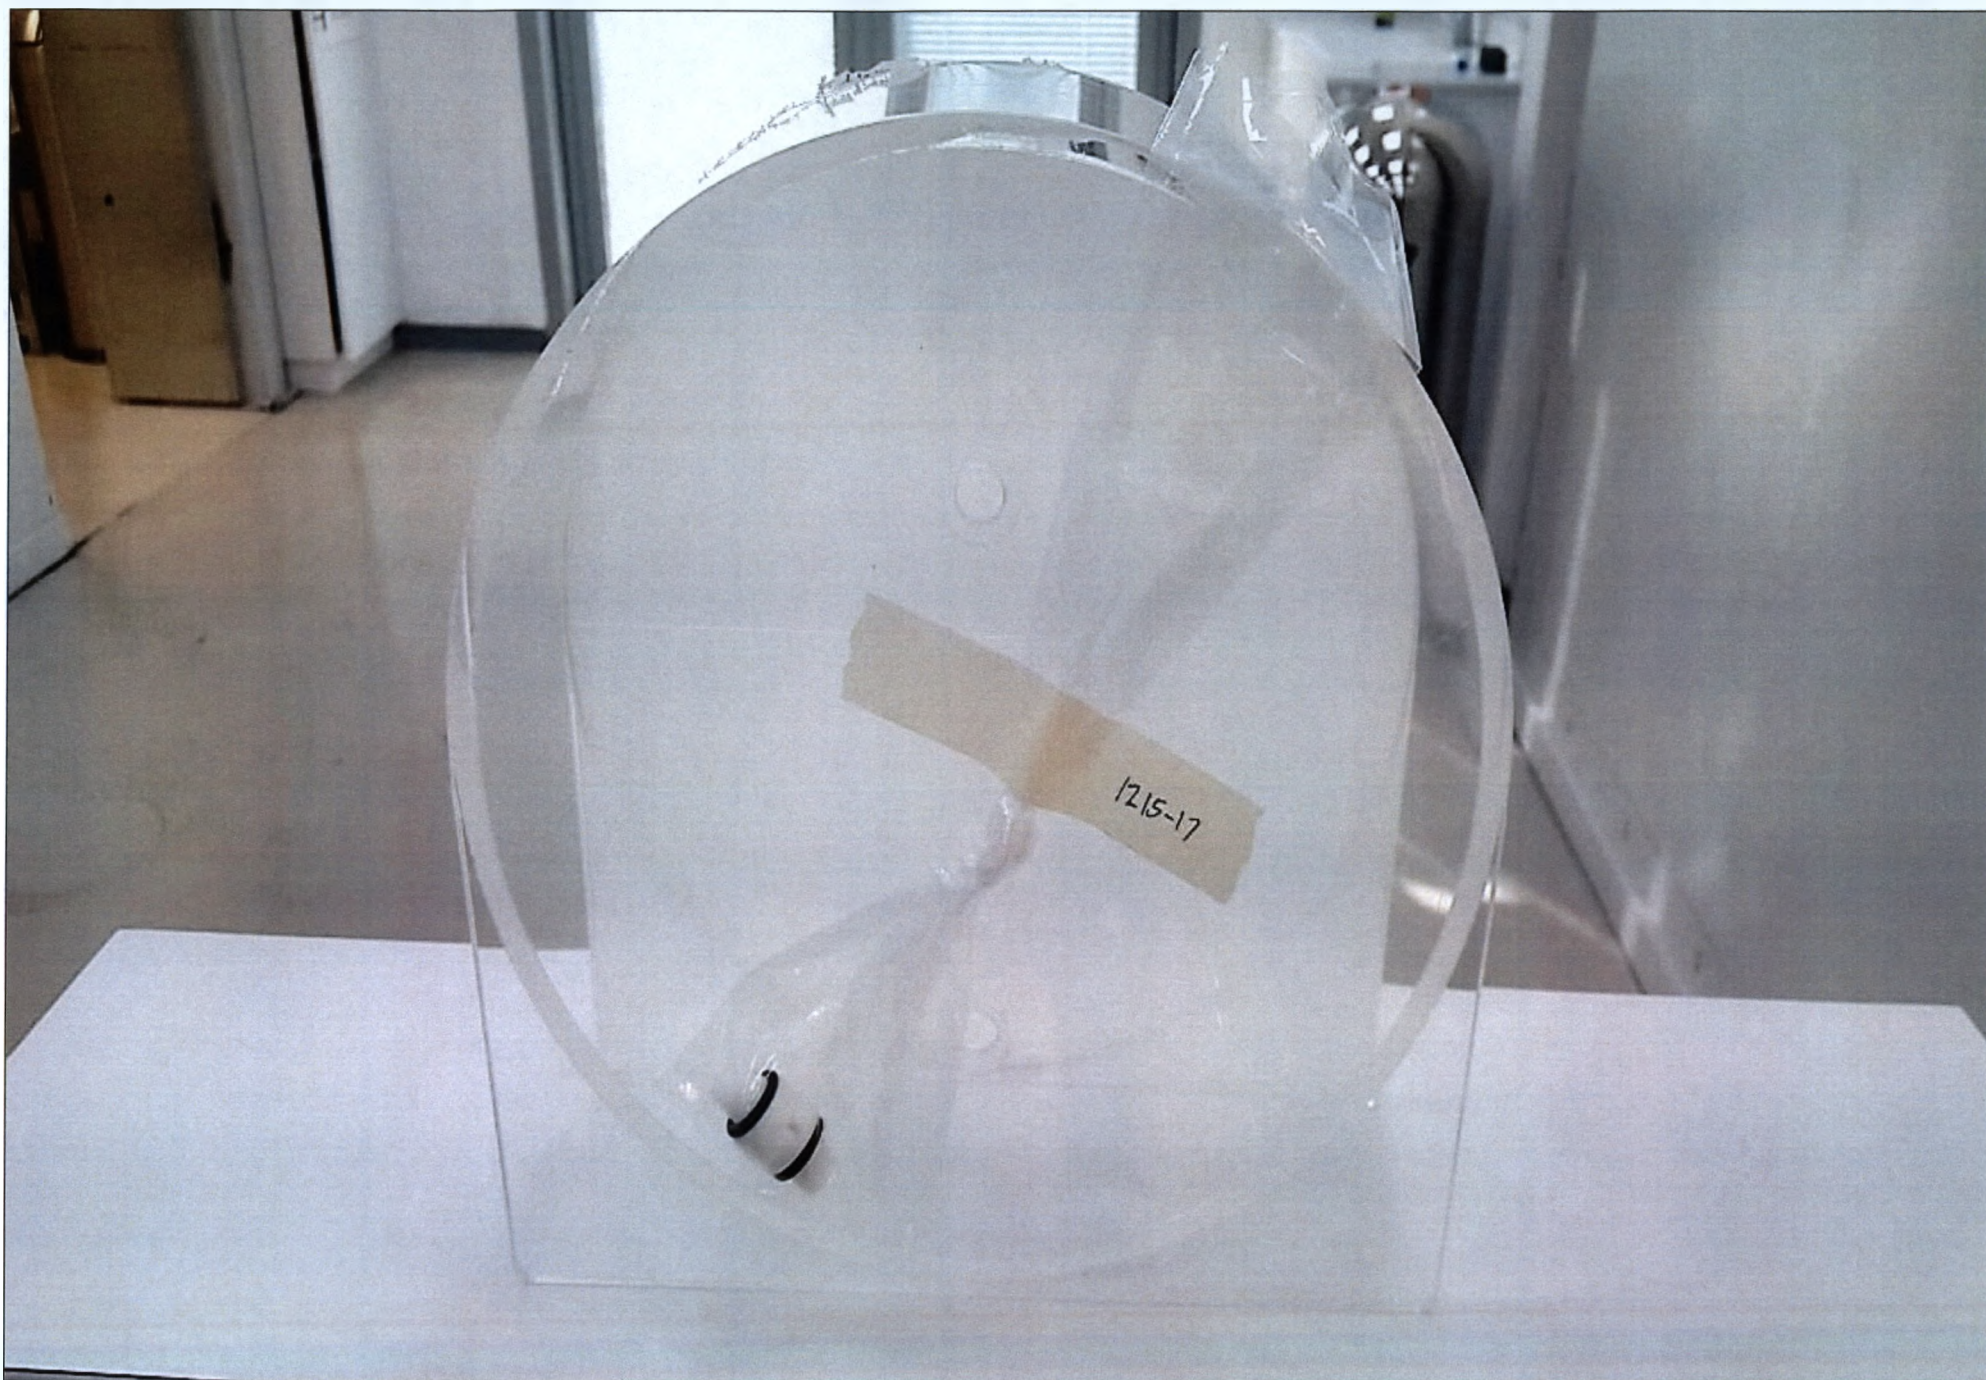


5i. Фантомы калибровочные, для проверки качества изображений

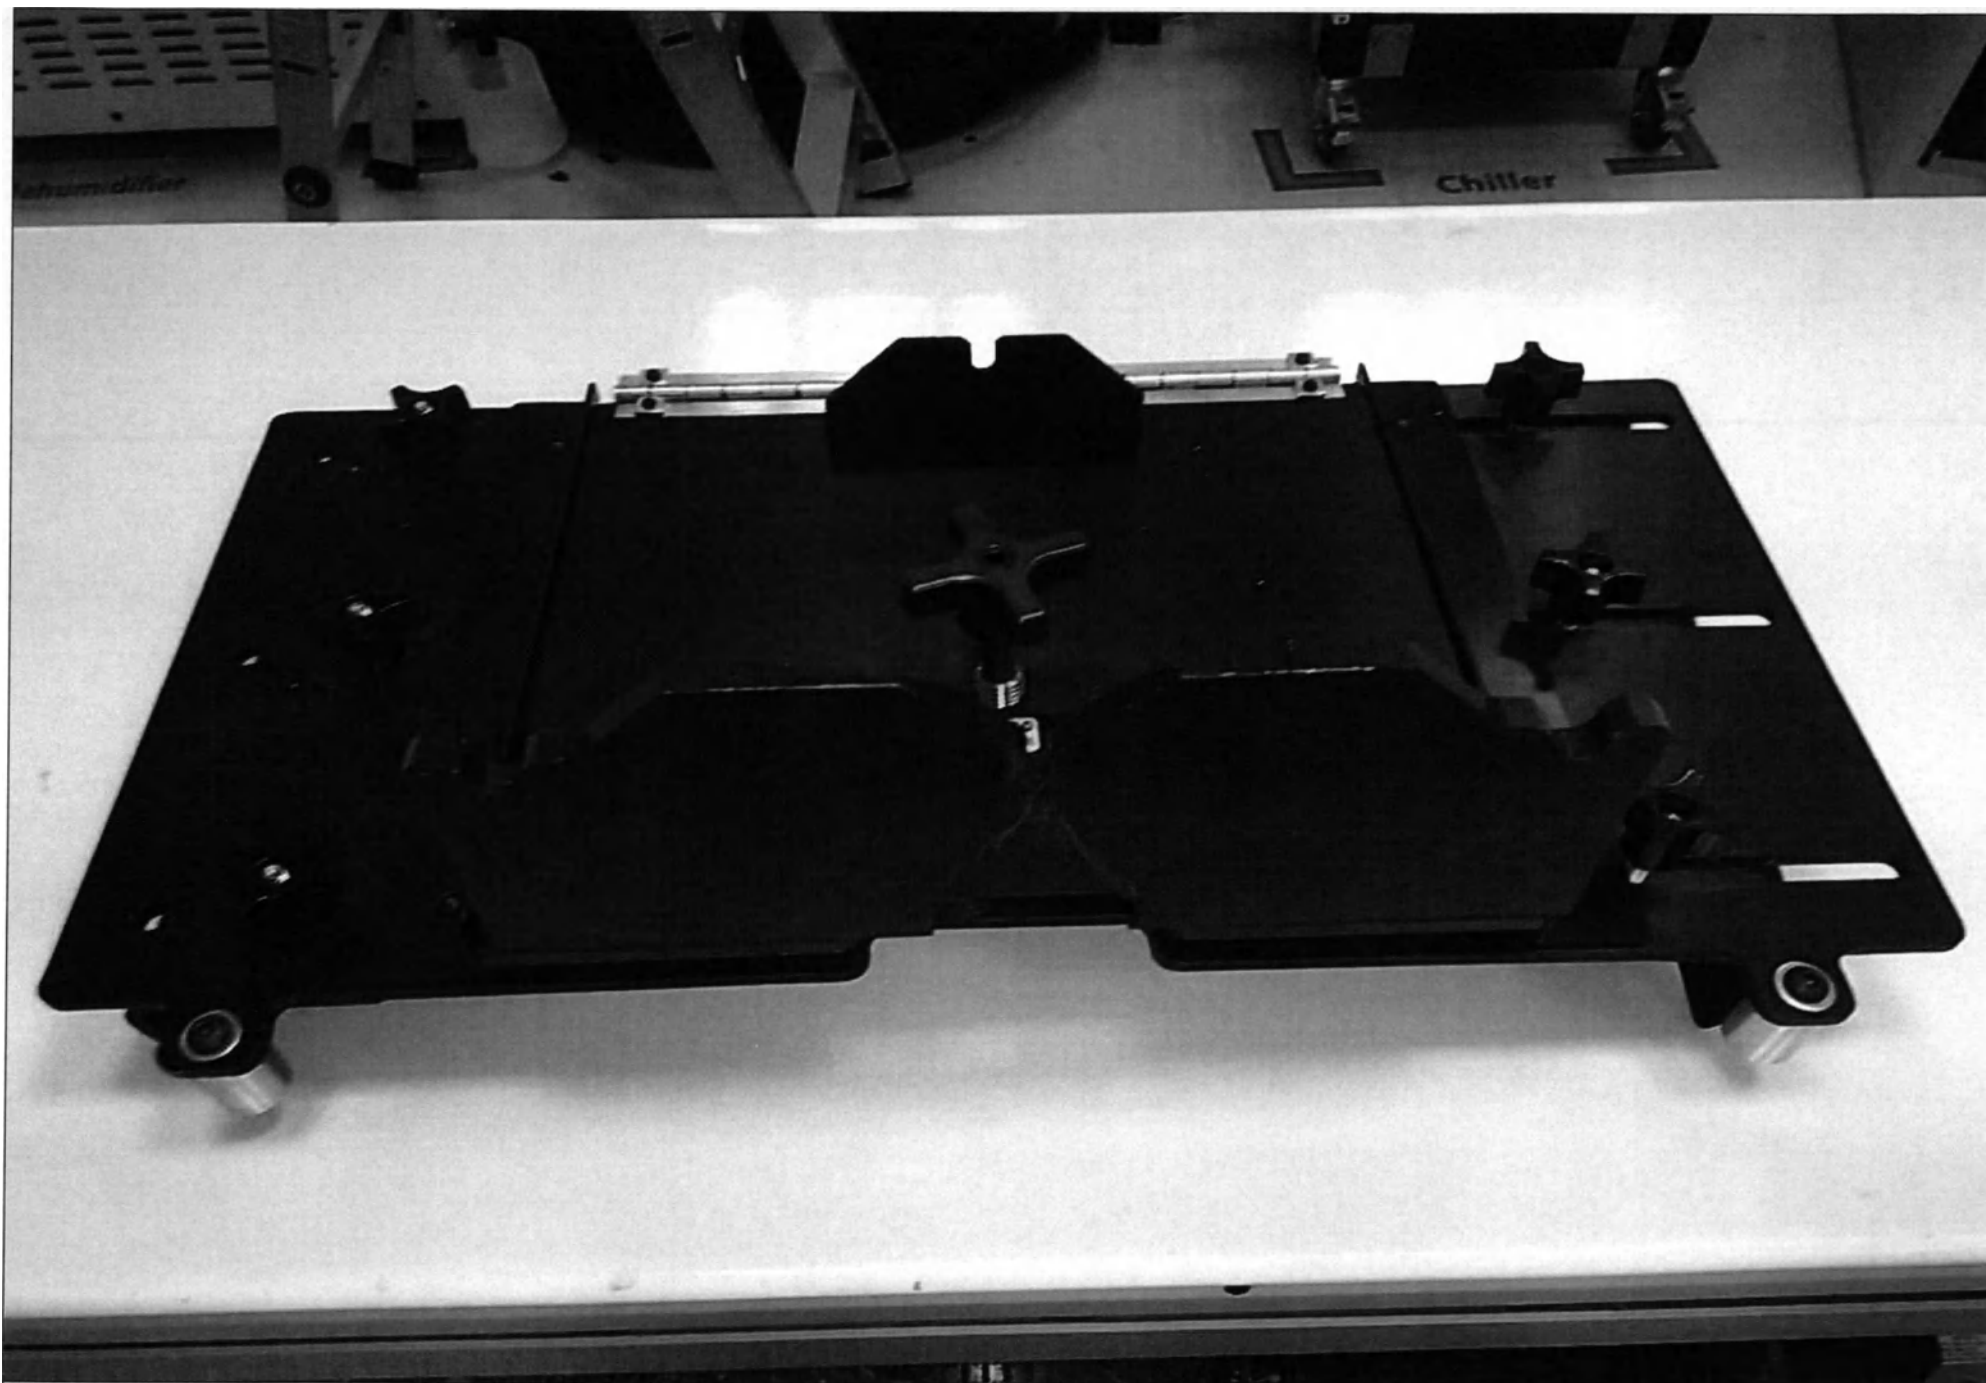


6а. Держатели для фантомов

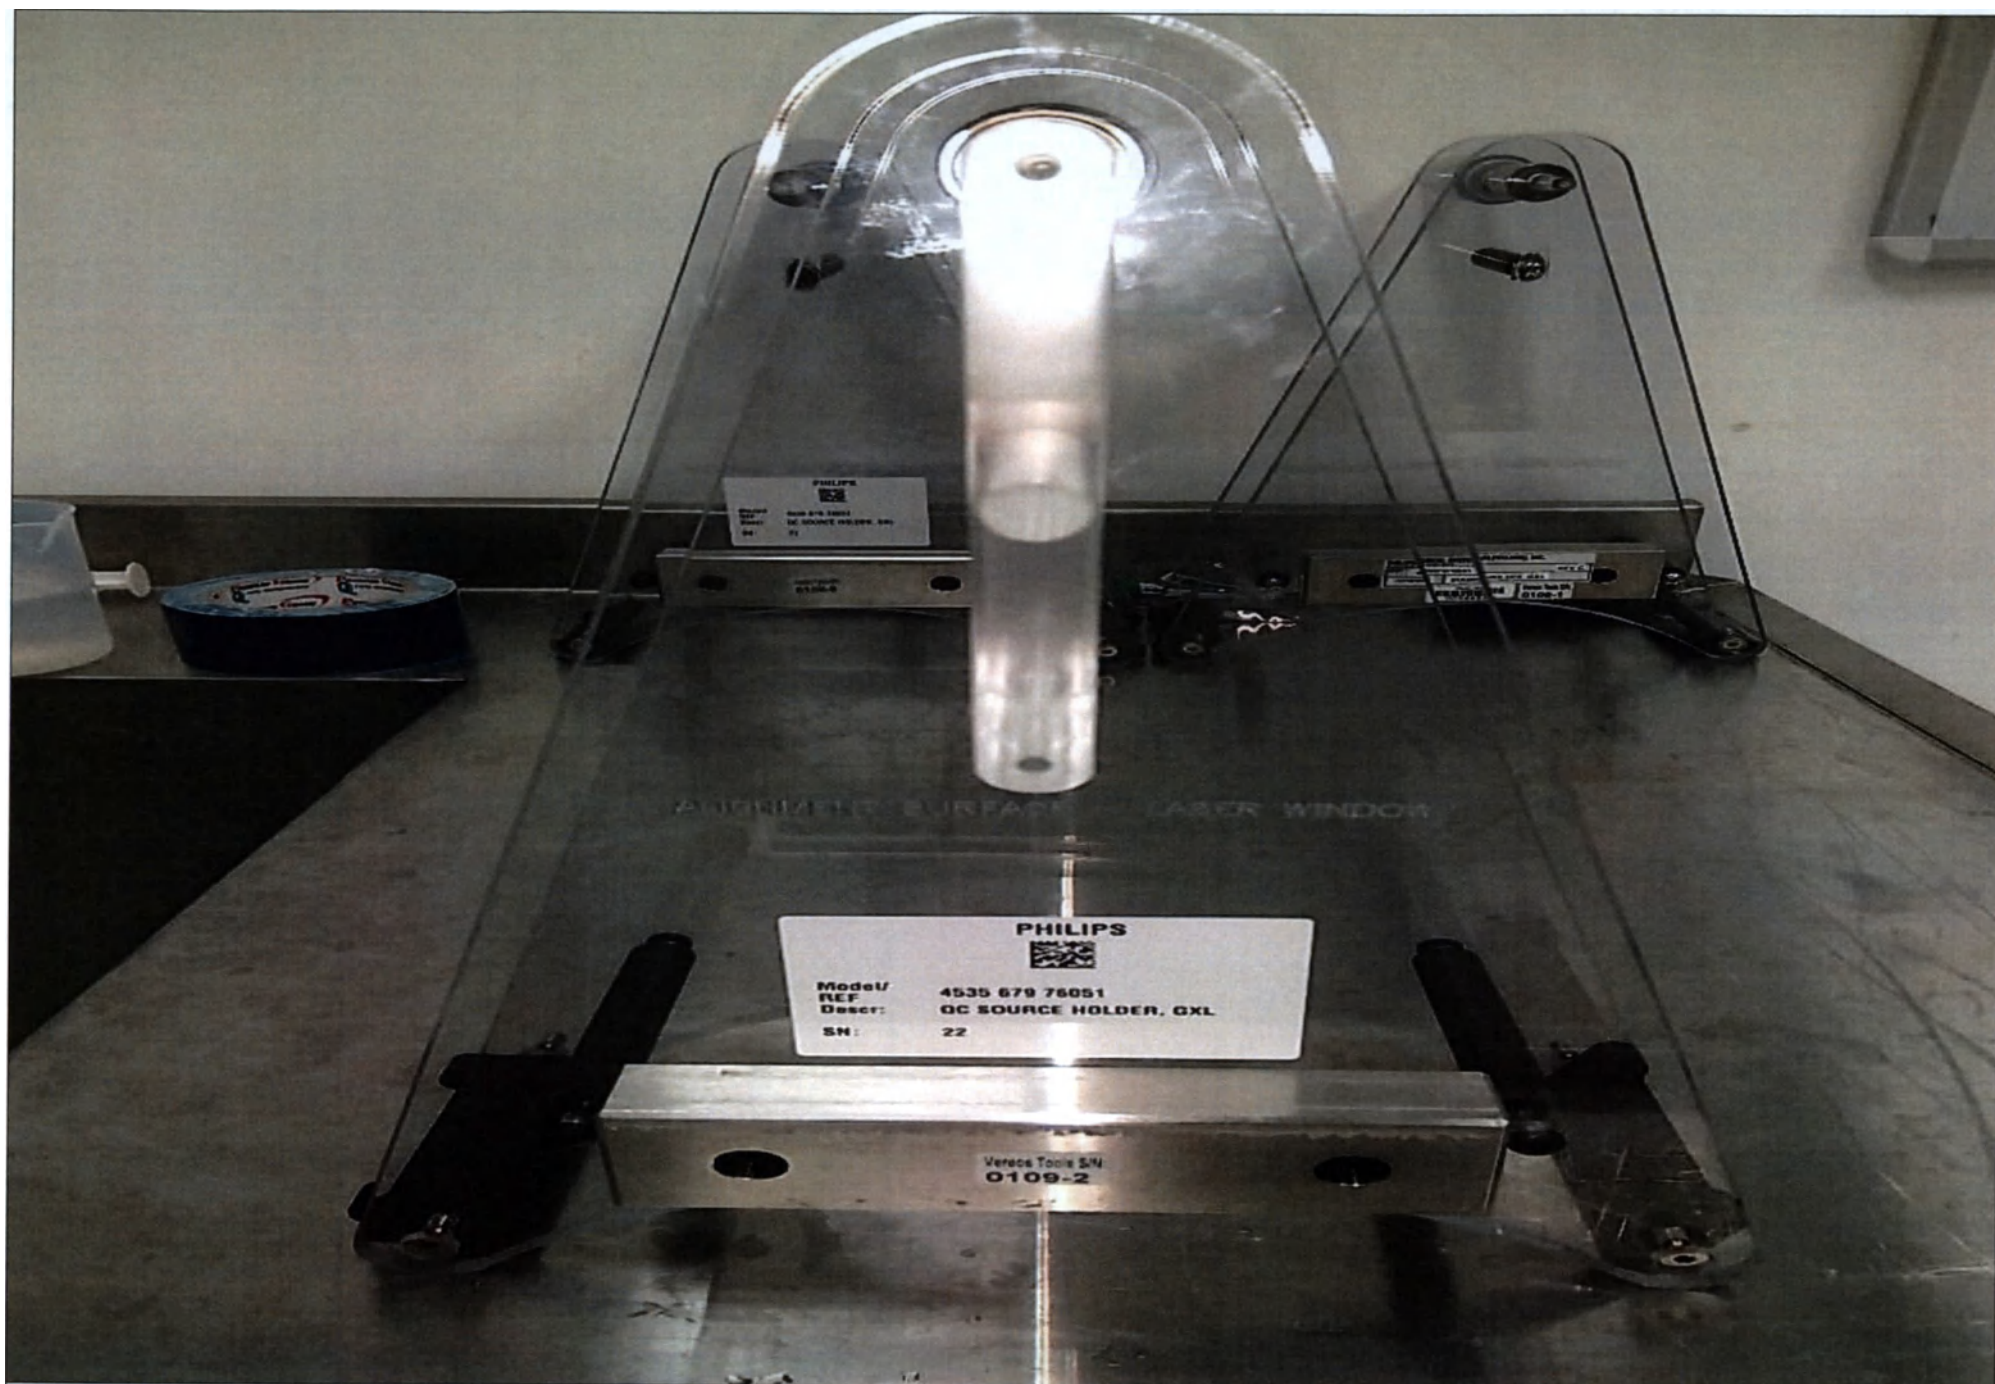


6b. Держатели для фантомов

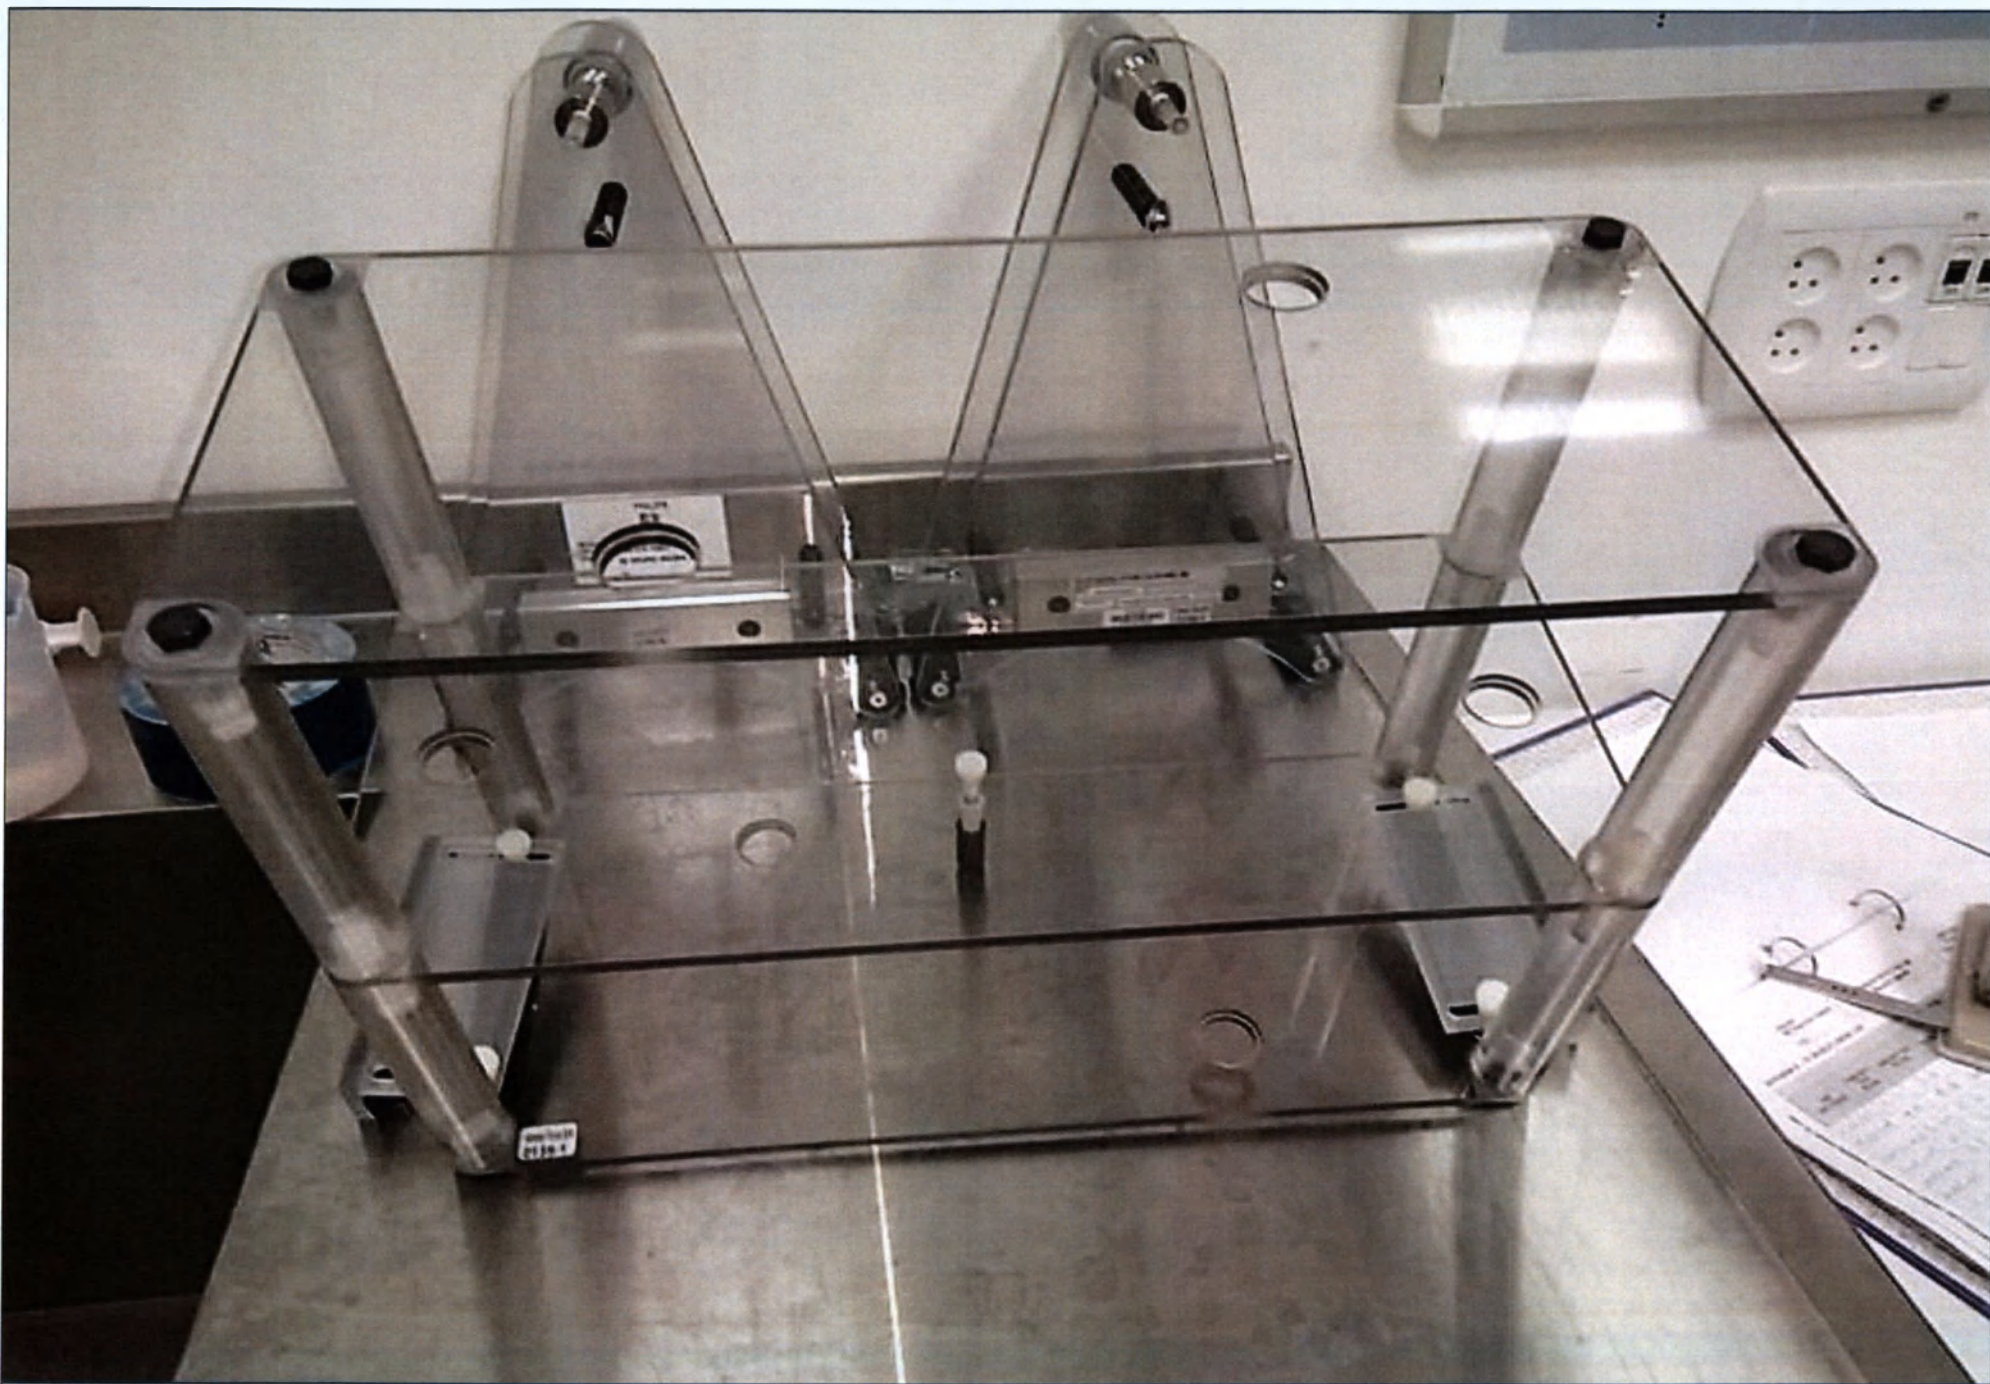


6с. Держатели для фантомов

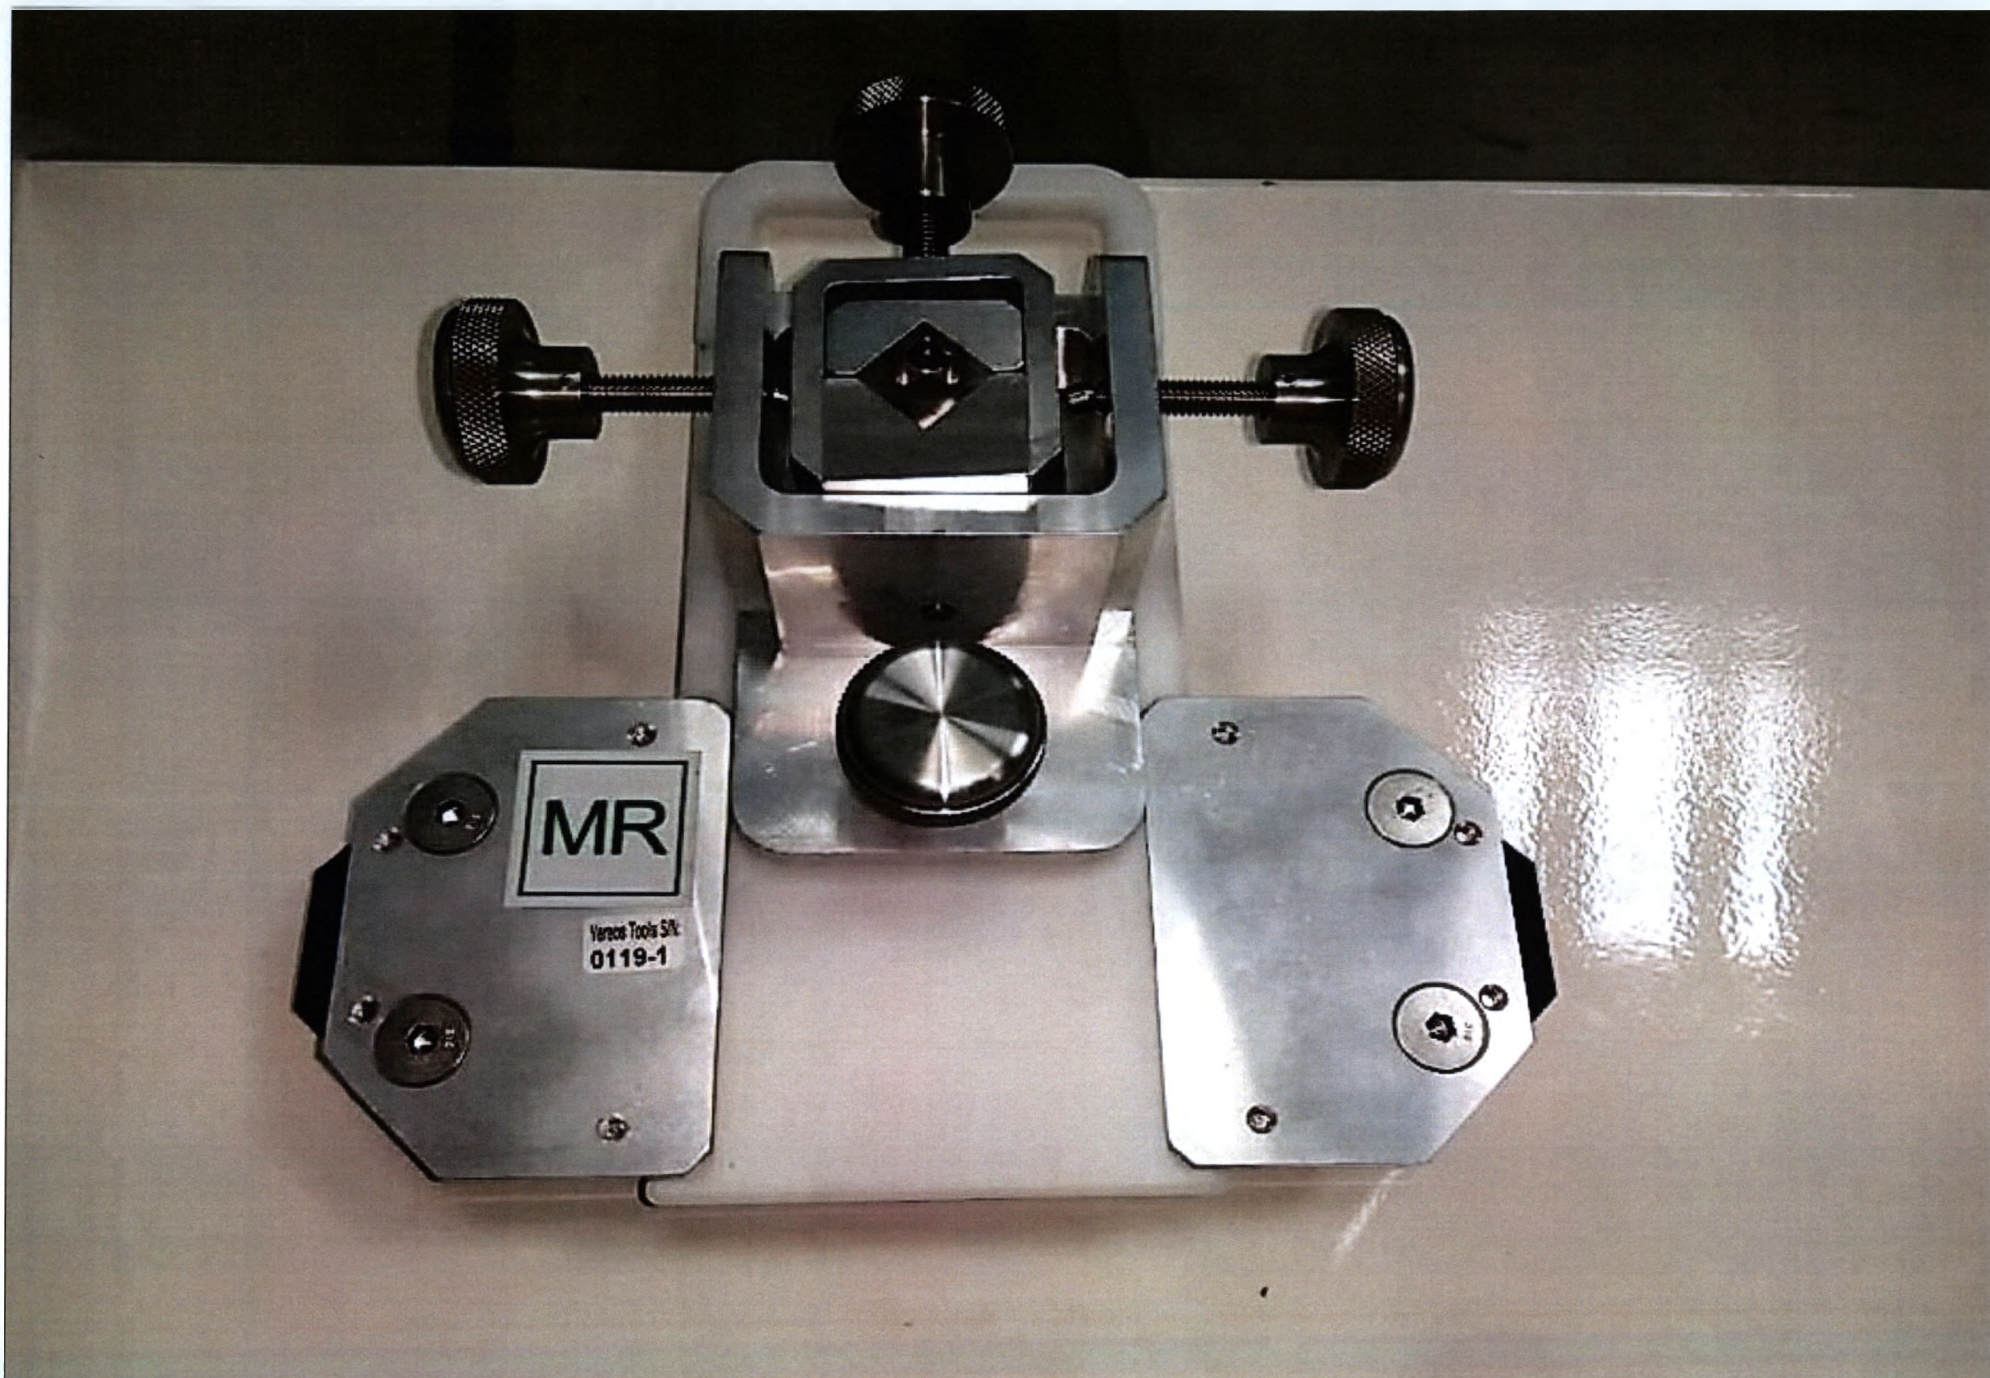


6d. Держатели для фантомов

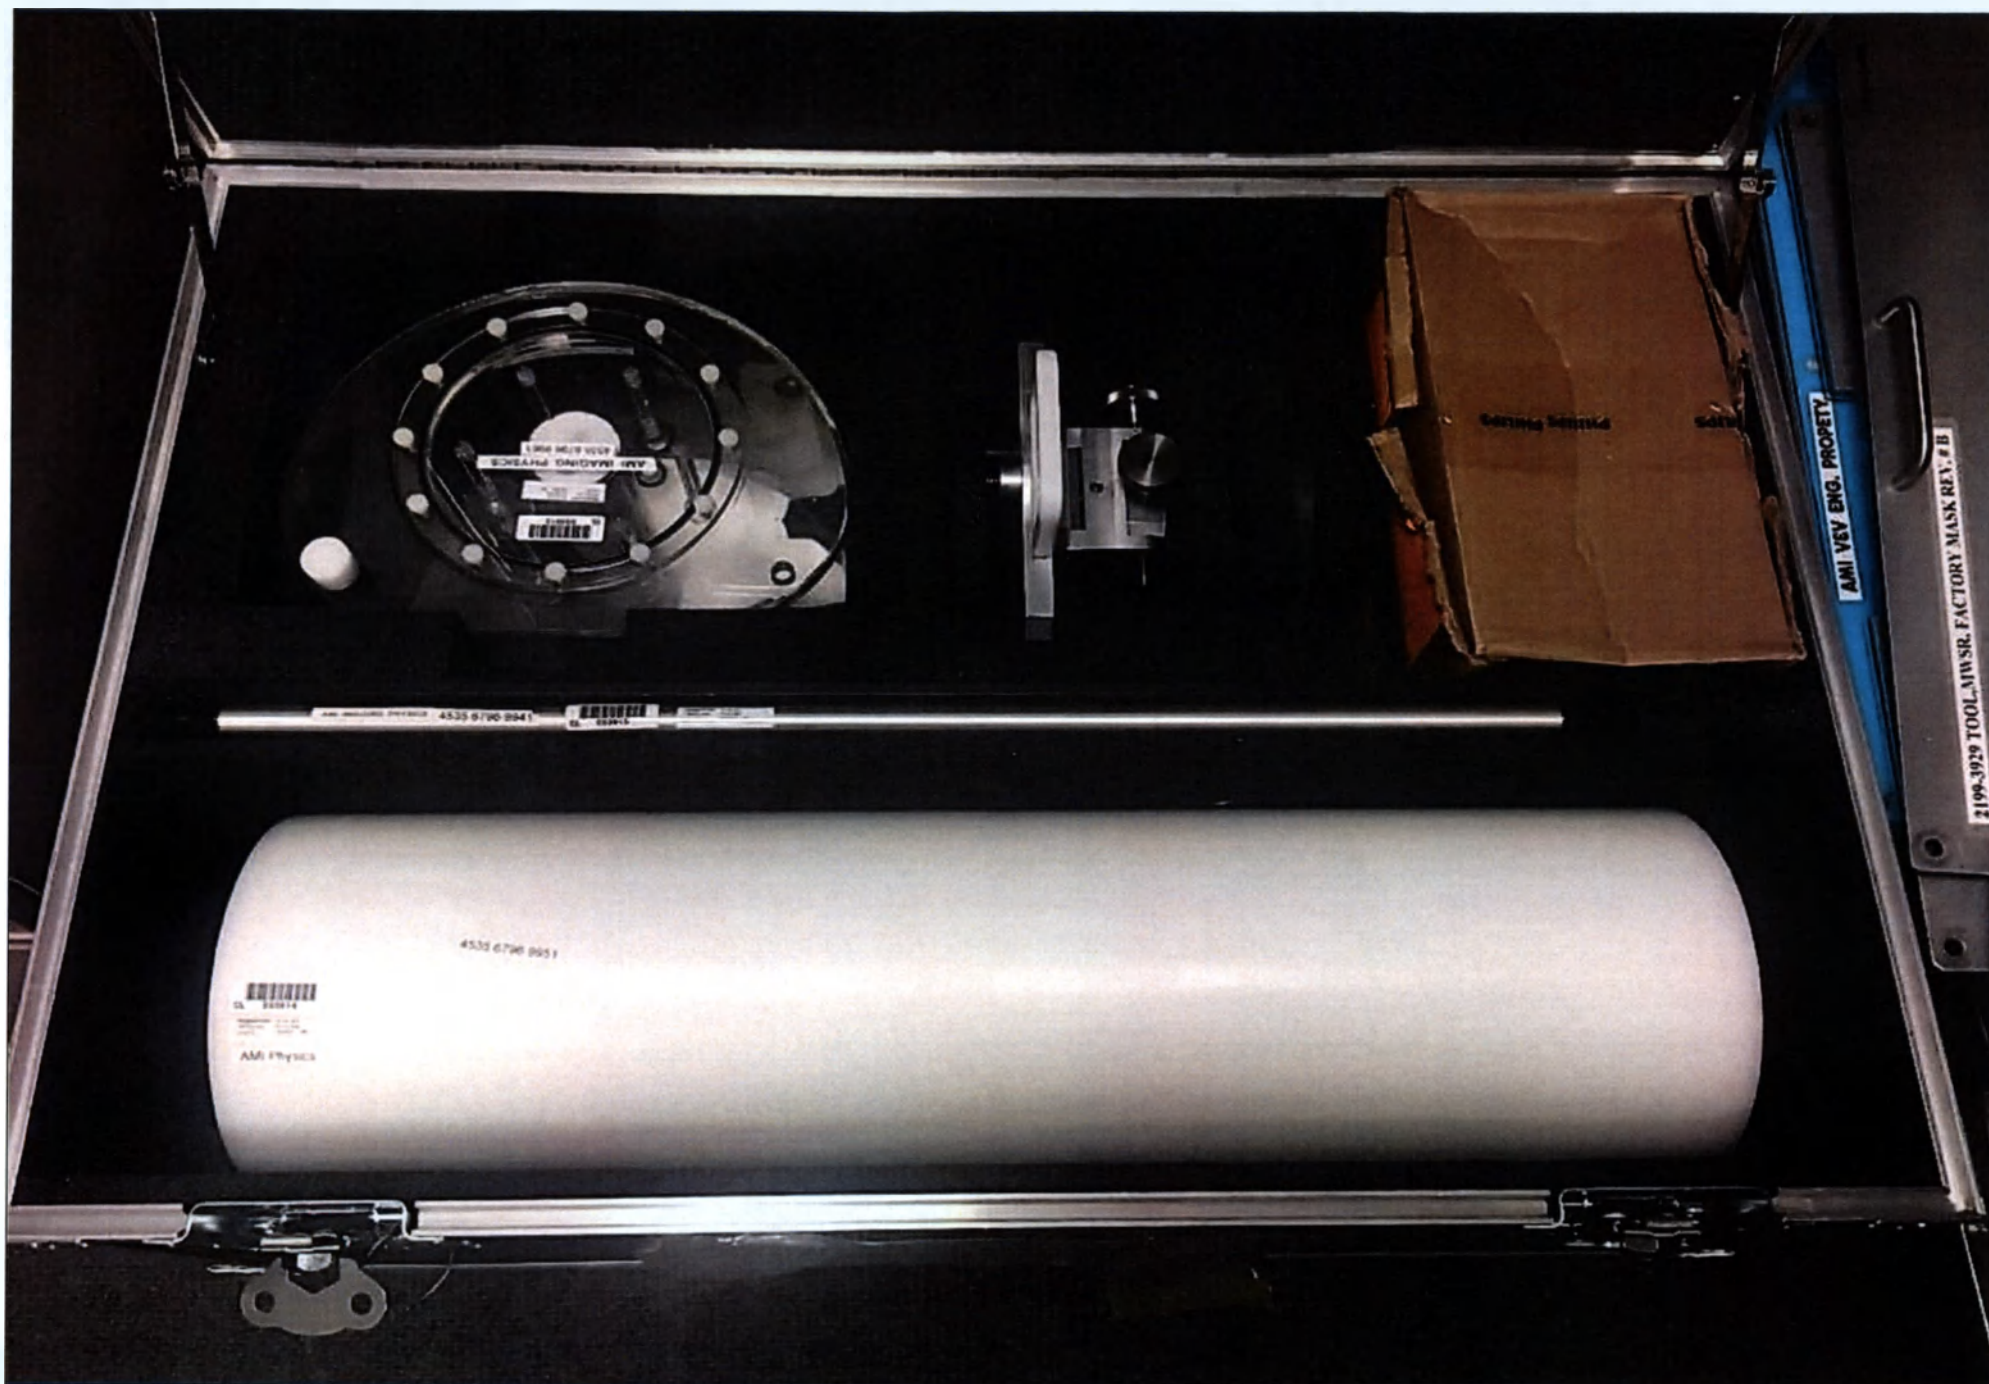

7а. Тестовый комплект фантомов NEMA.

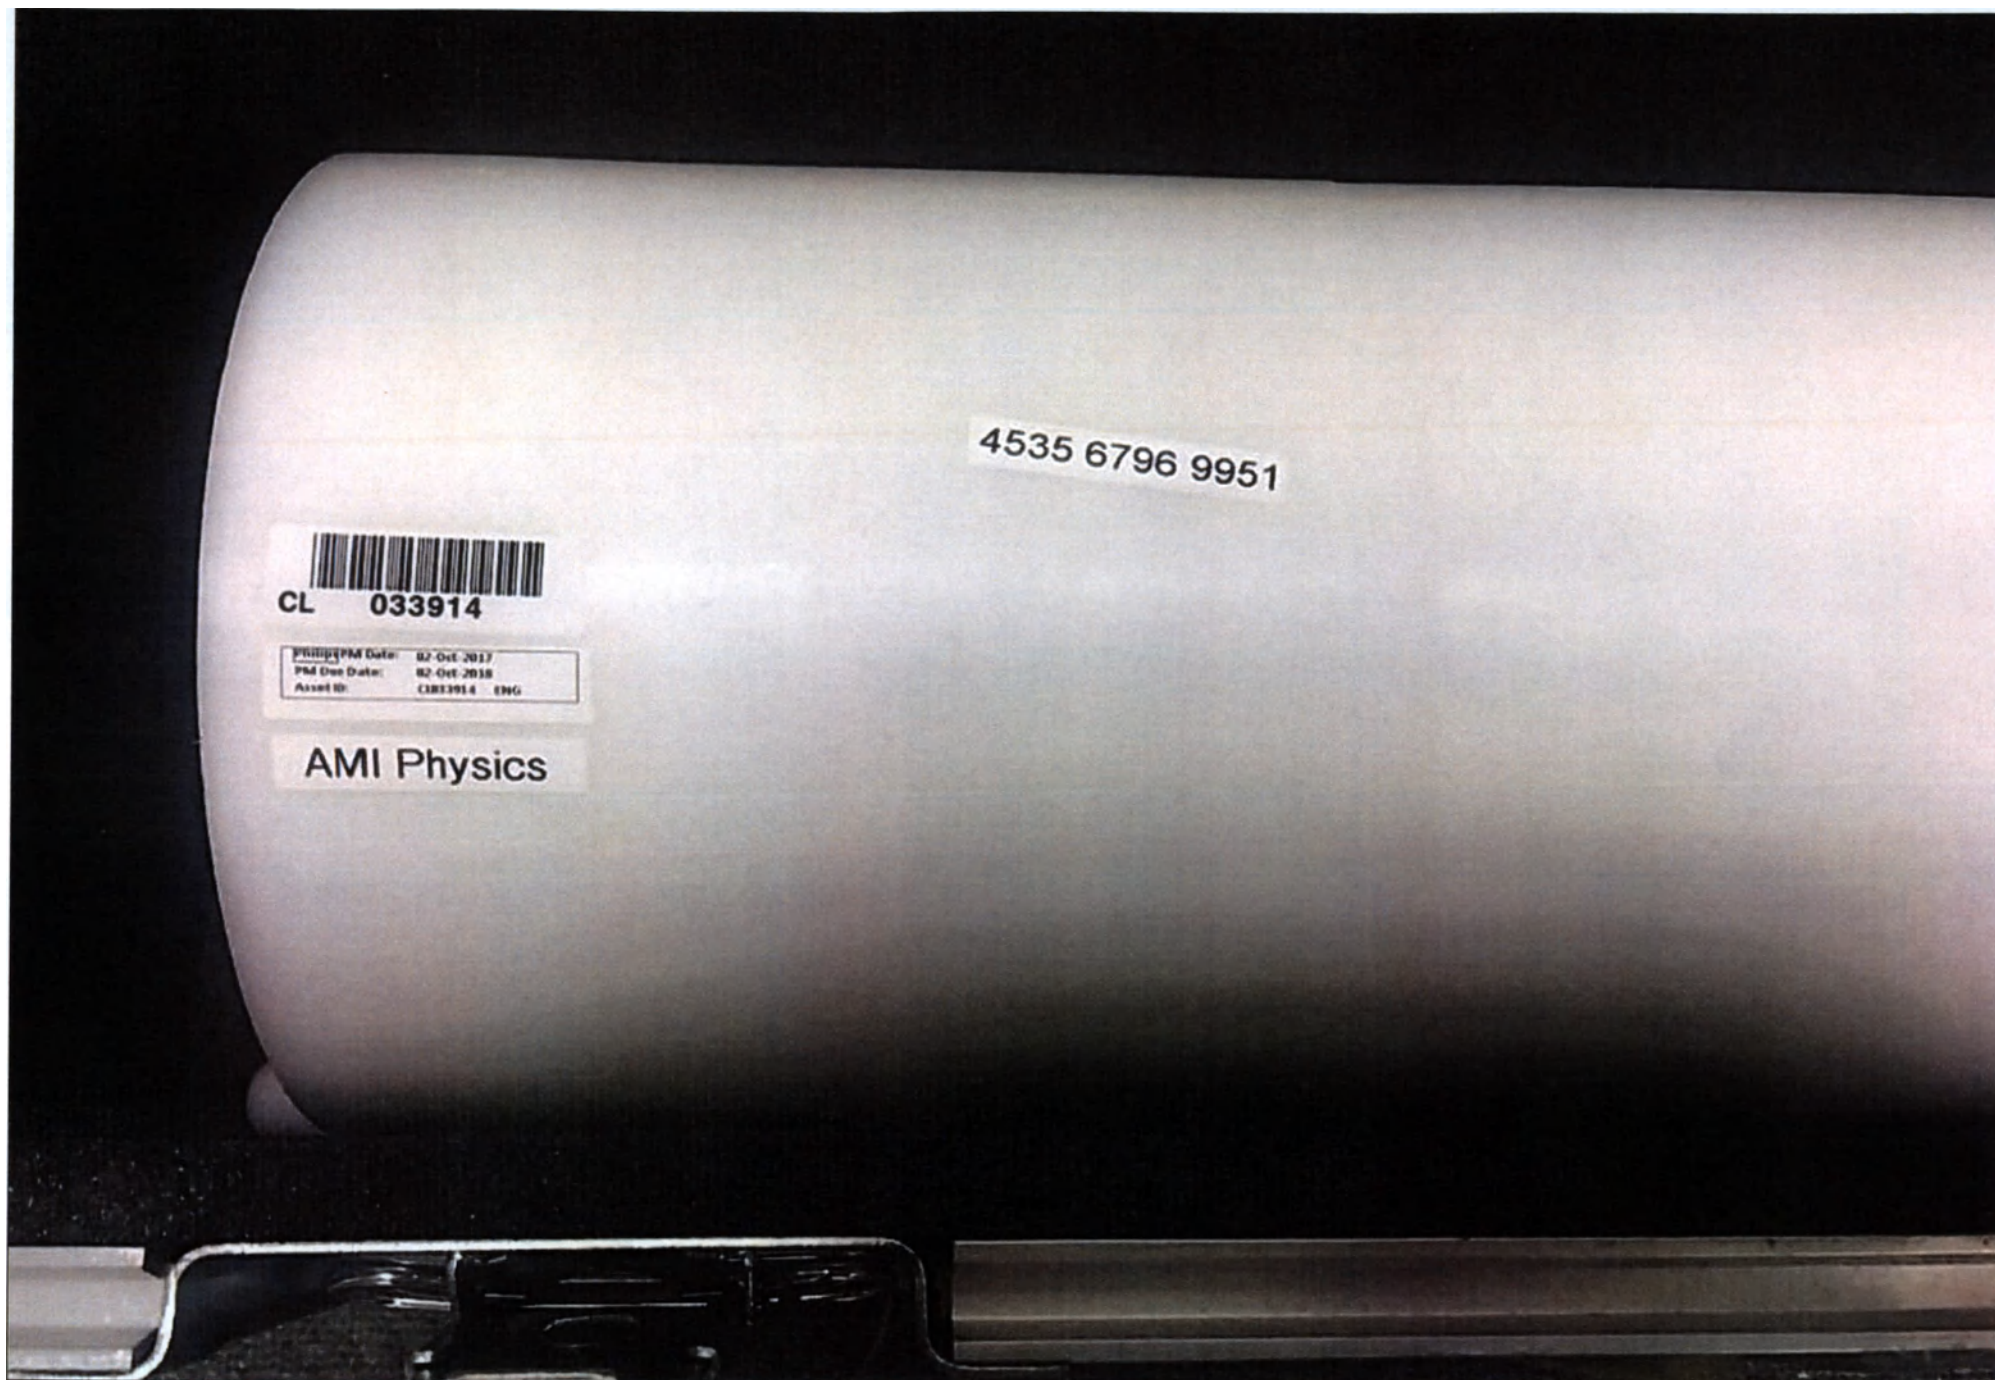


7b. Тестовый комплект фантомов NEMA .

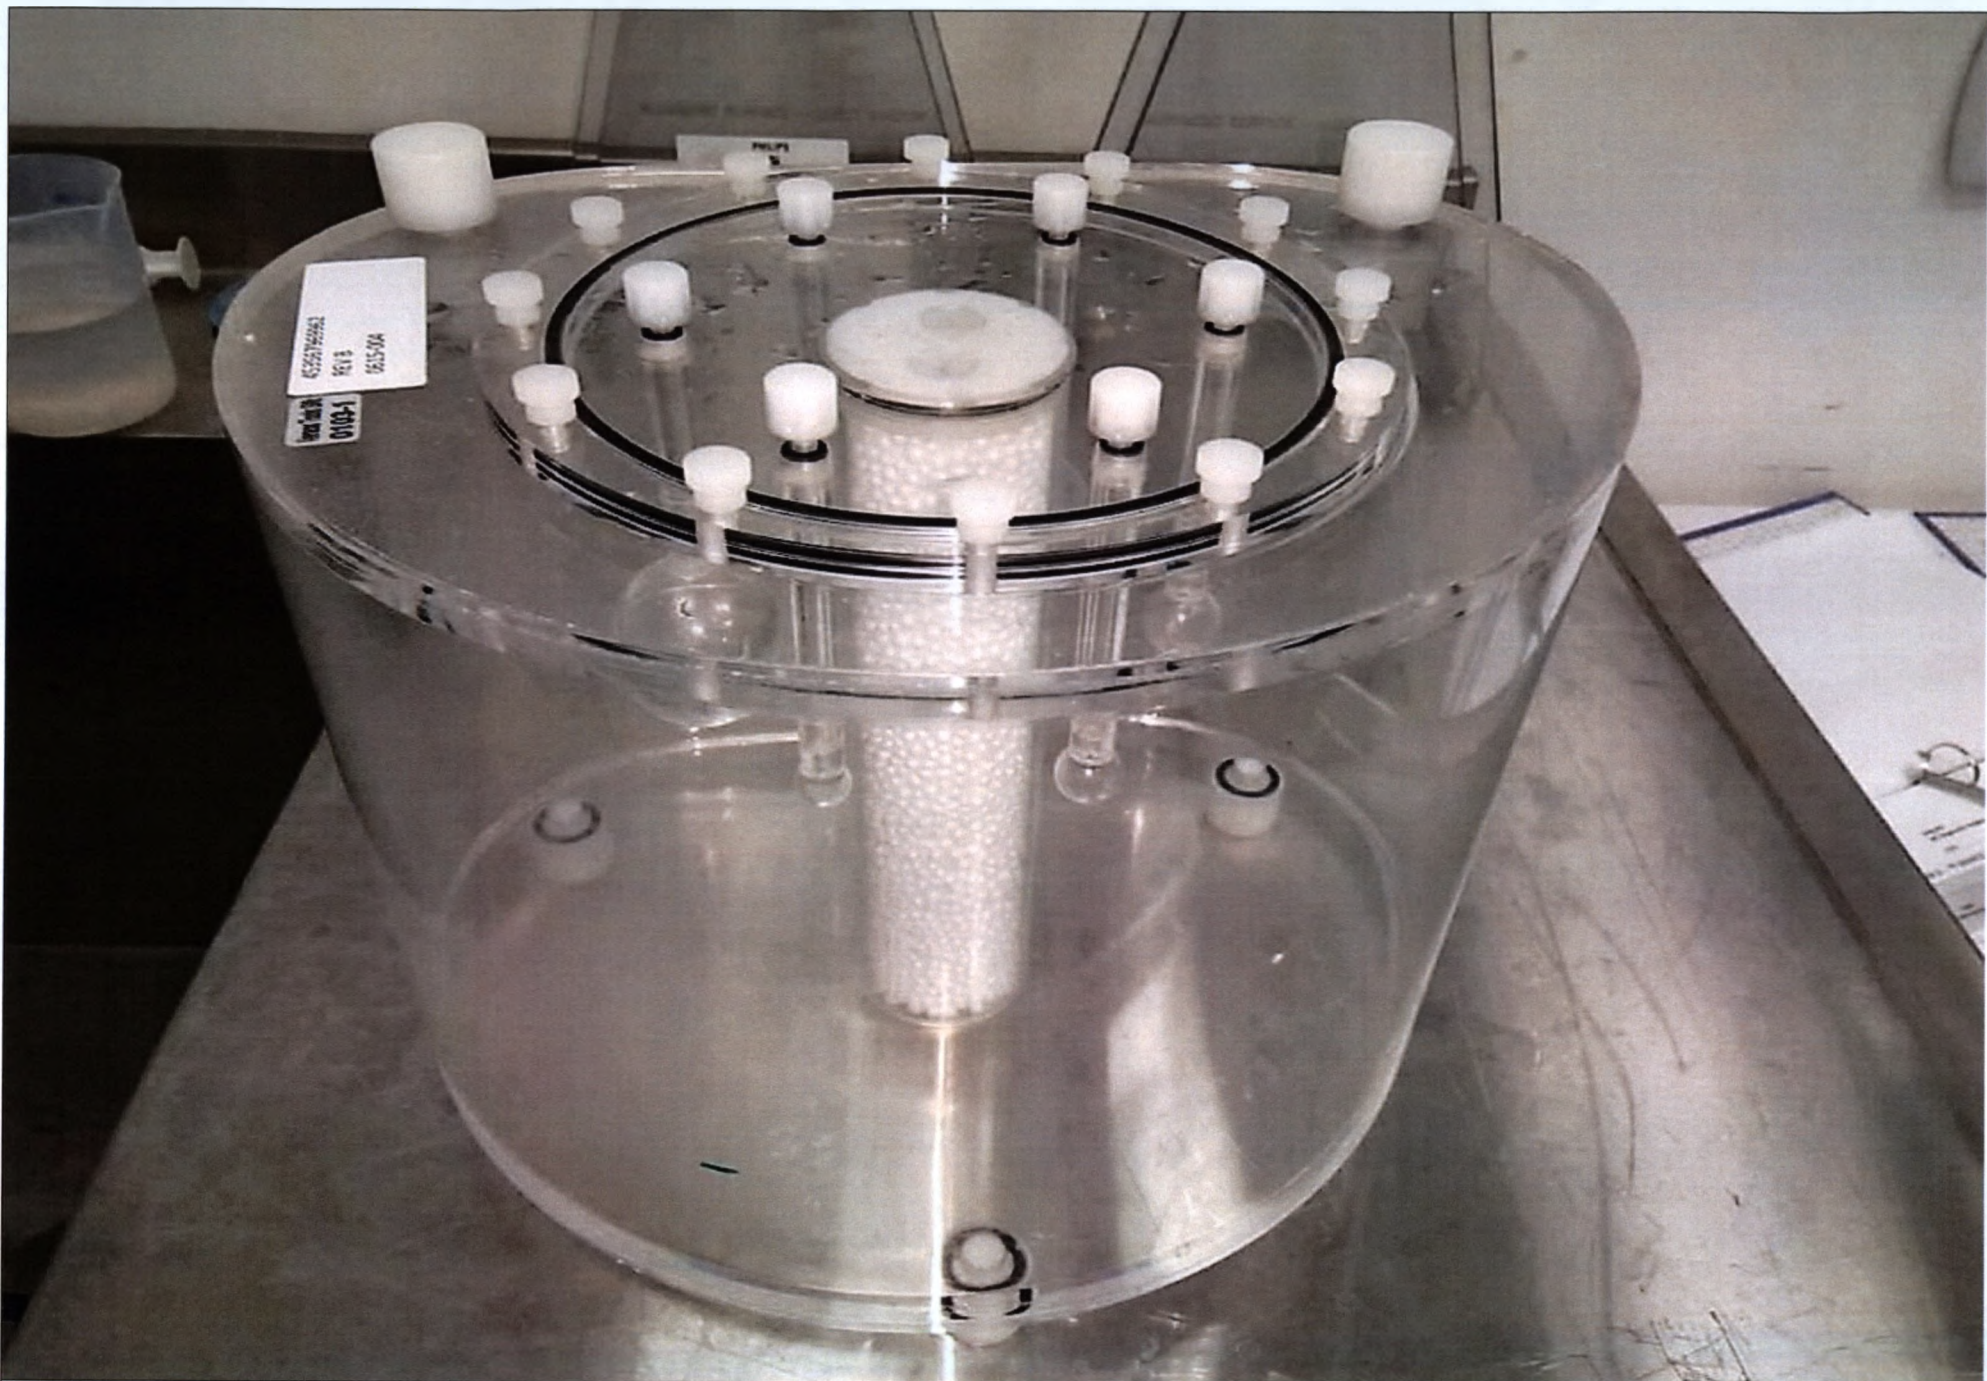

7с. Тестовый комплект фантомов NEMA.



7d. Тестовый комплект фантомов NEMA .

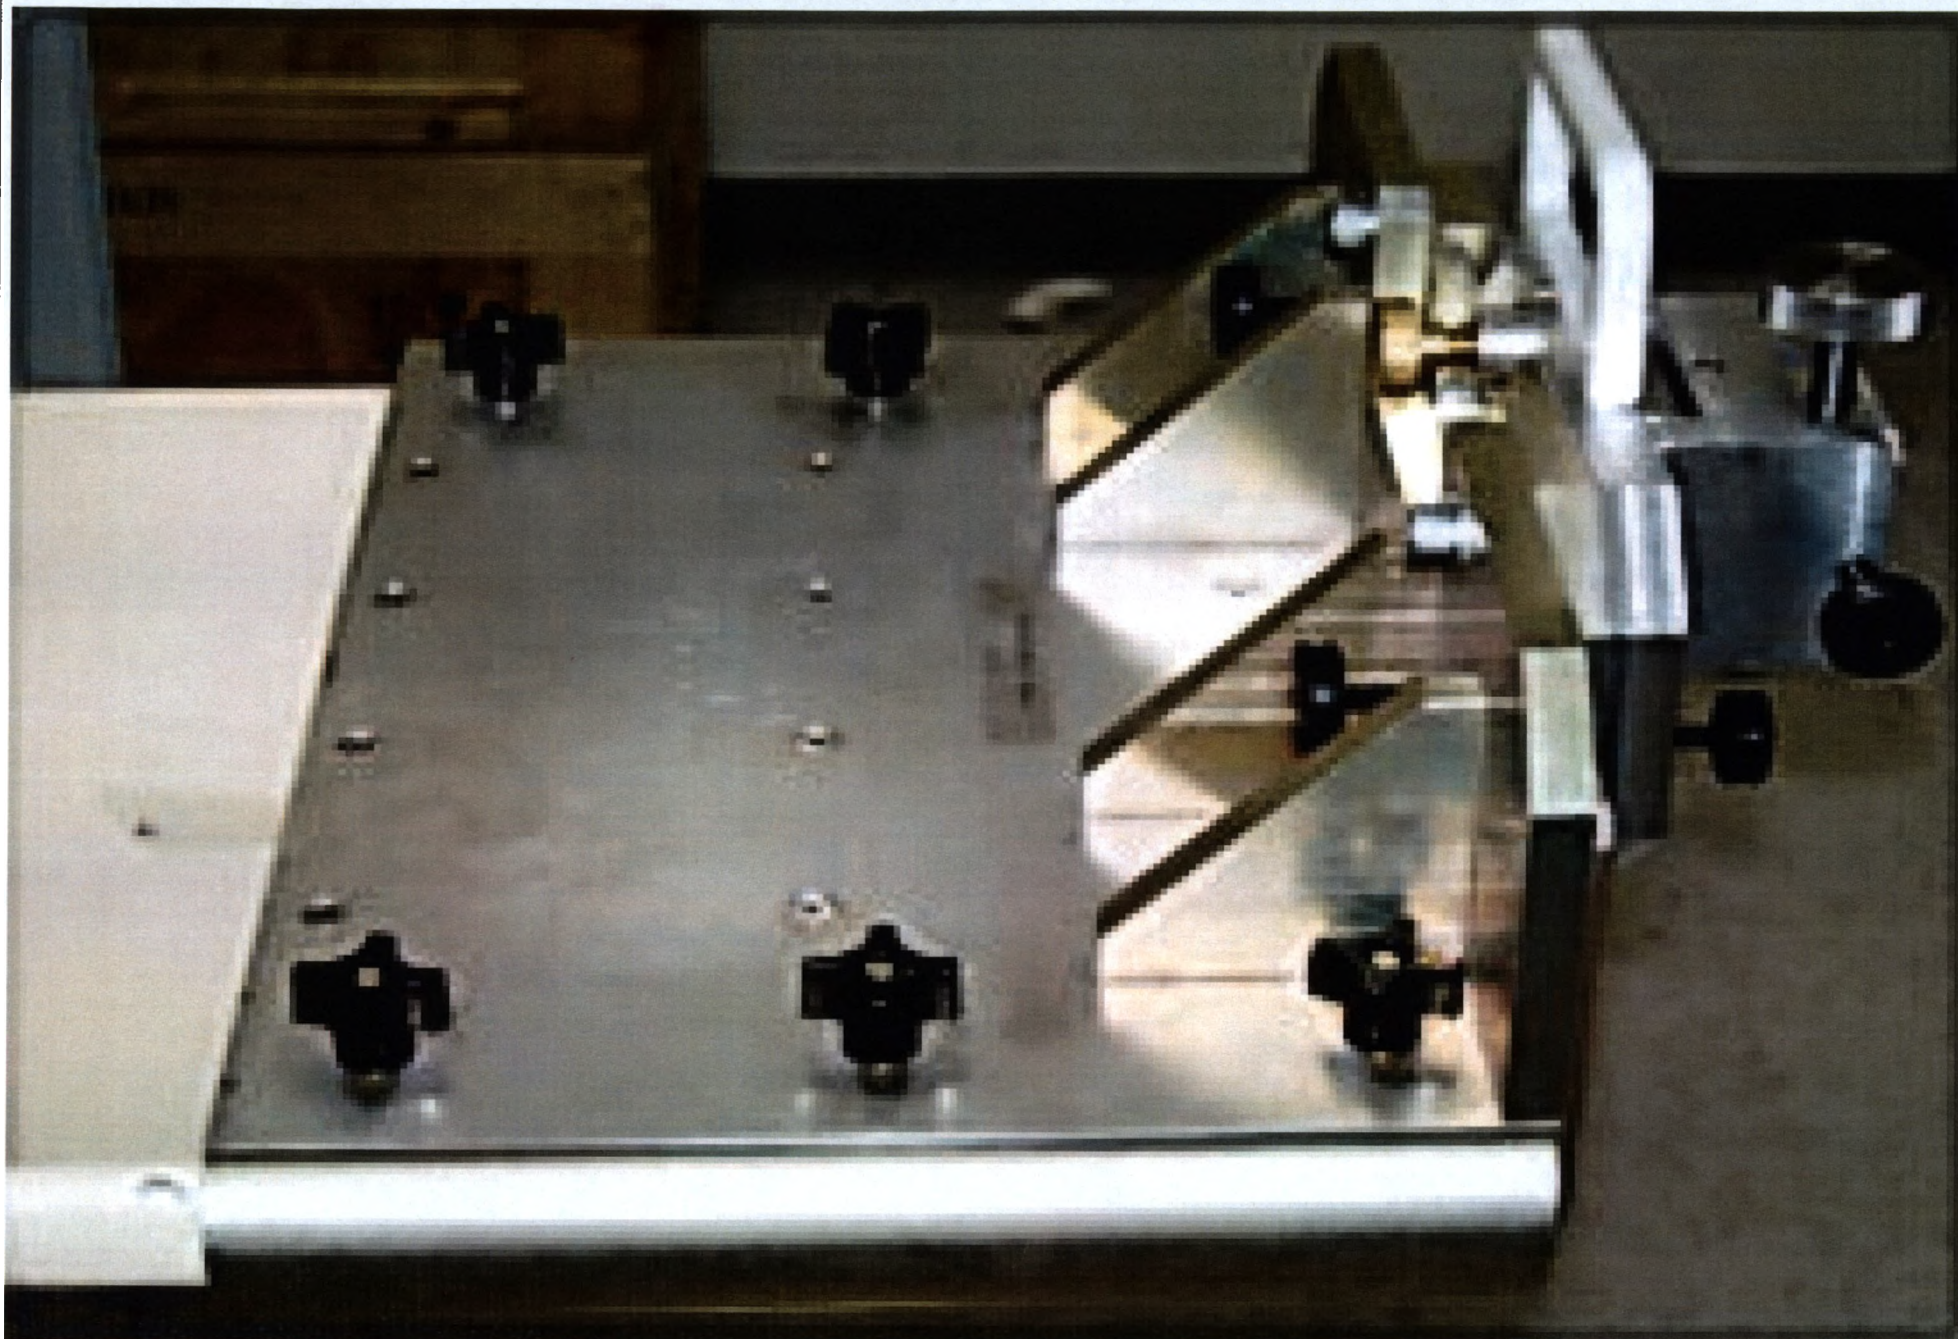


7е. Тестовый комплект фантомов NEMA.



8. Внешнее запоминающее устройство.



9а. Сервер реконструкции.

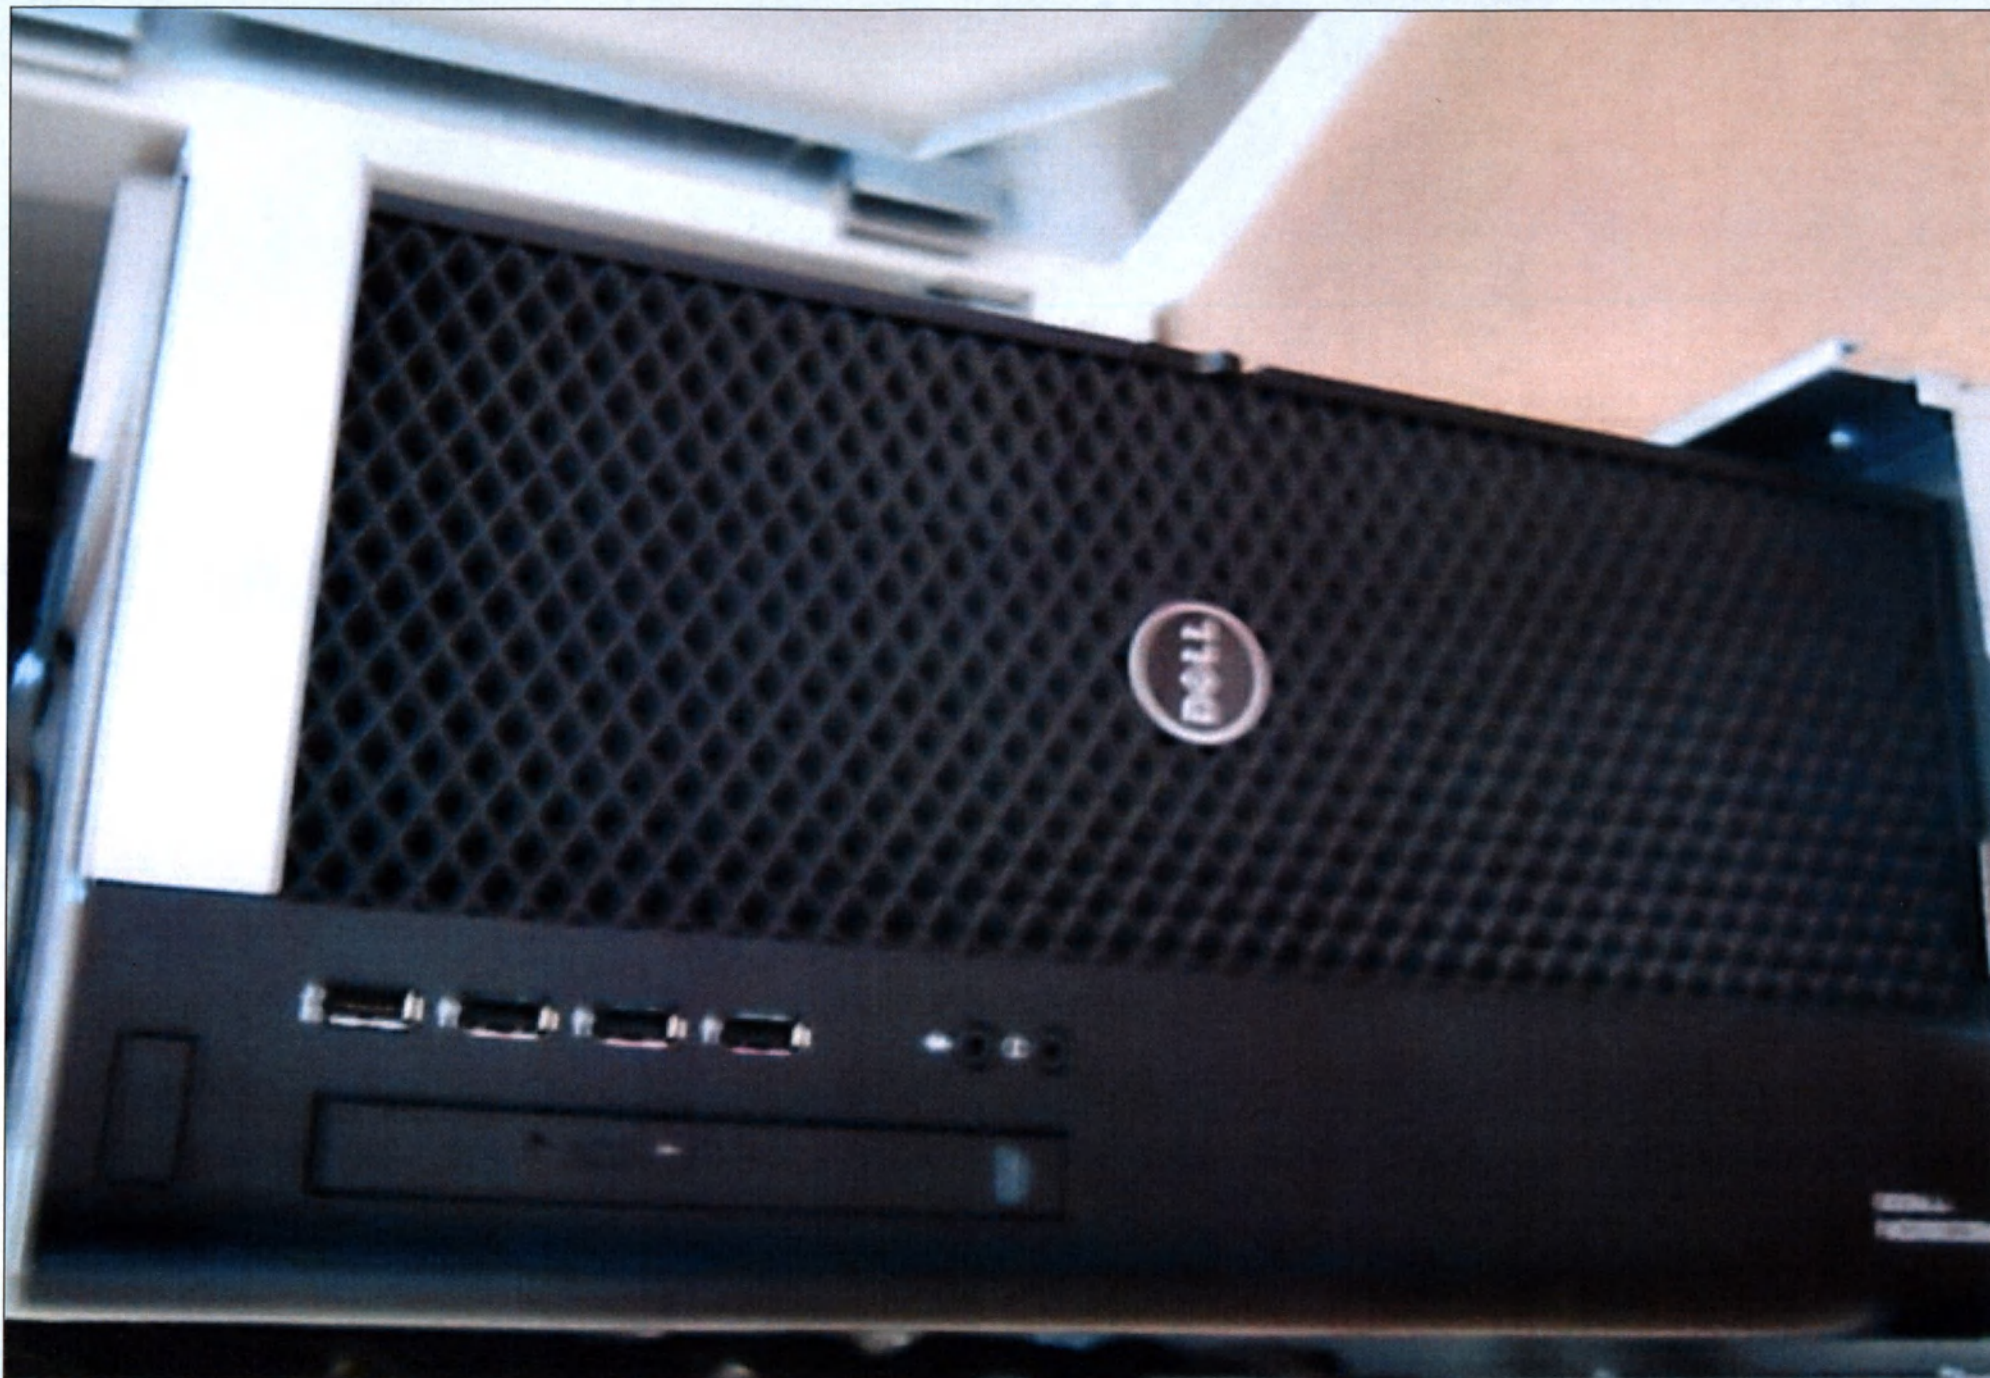


9б. Сервер реконструкции.




10. Монитор специальный.




11. Тележка для монитора

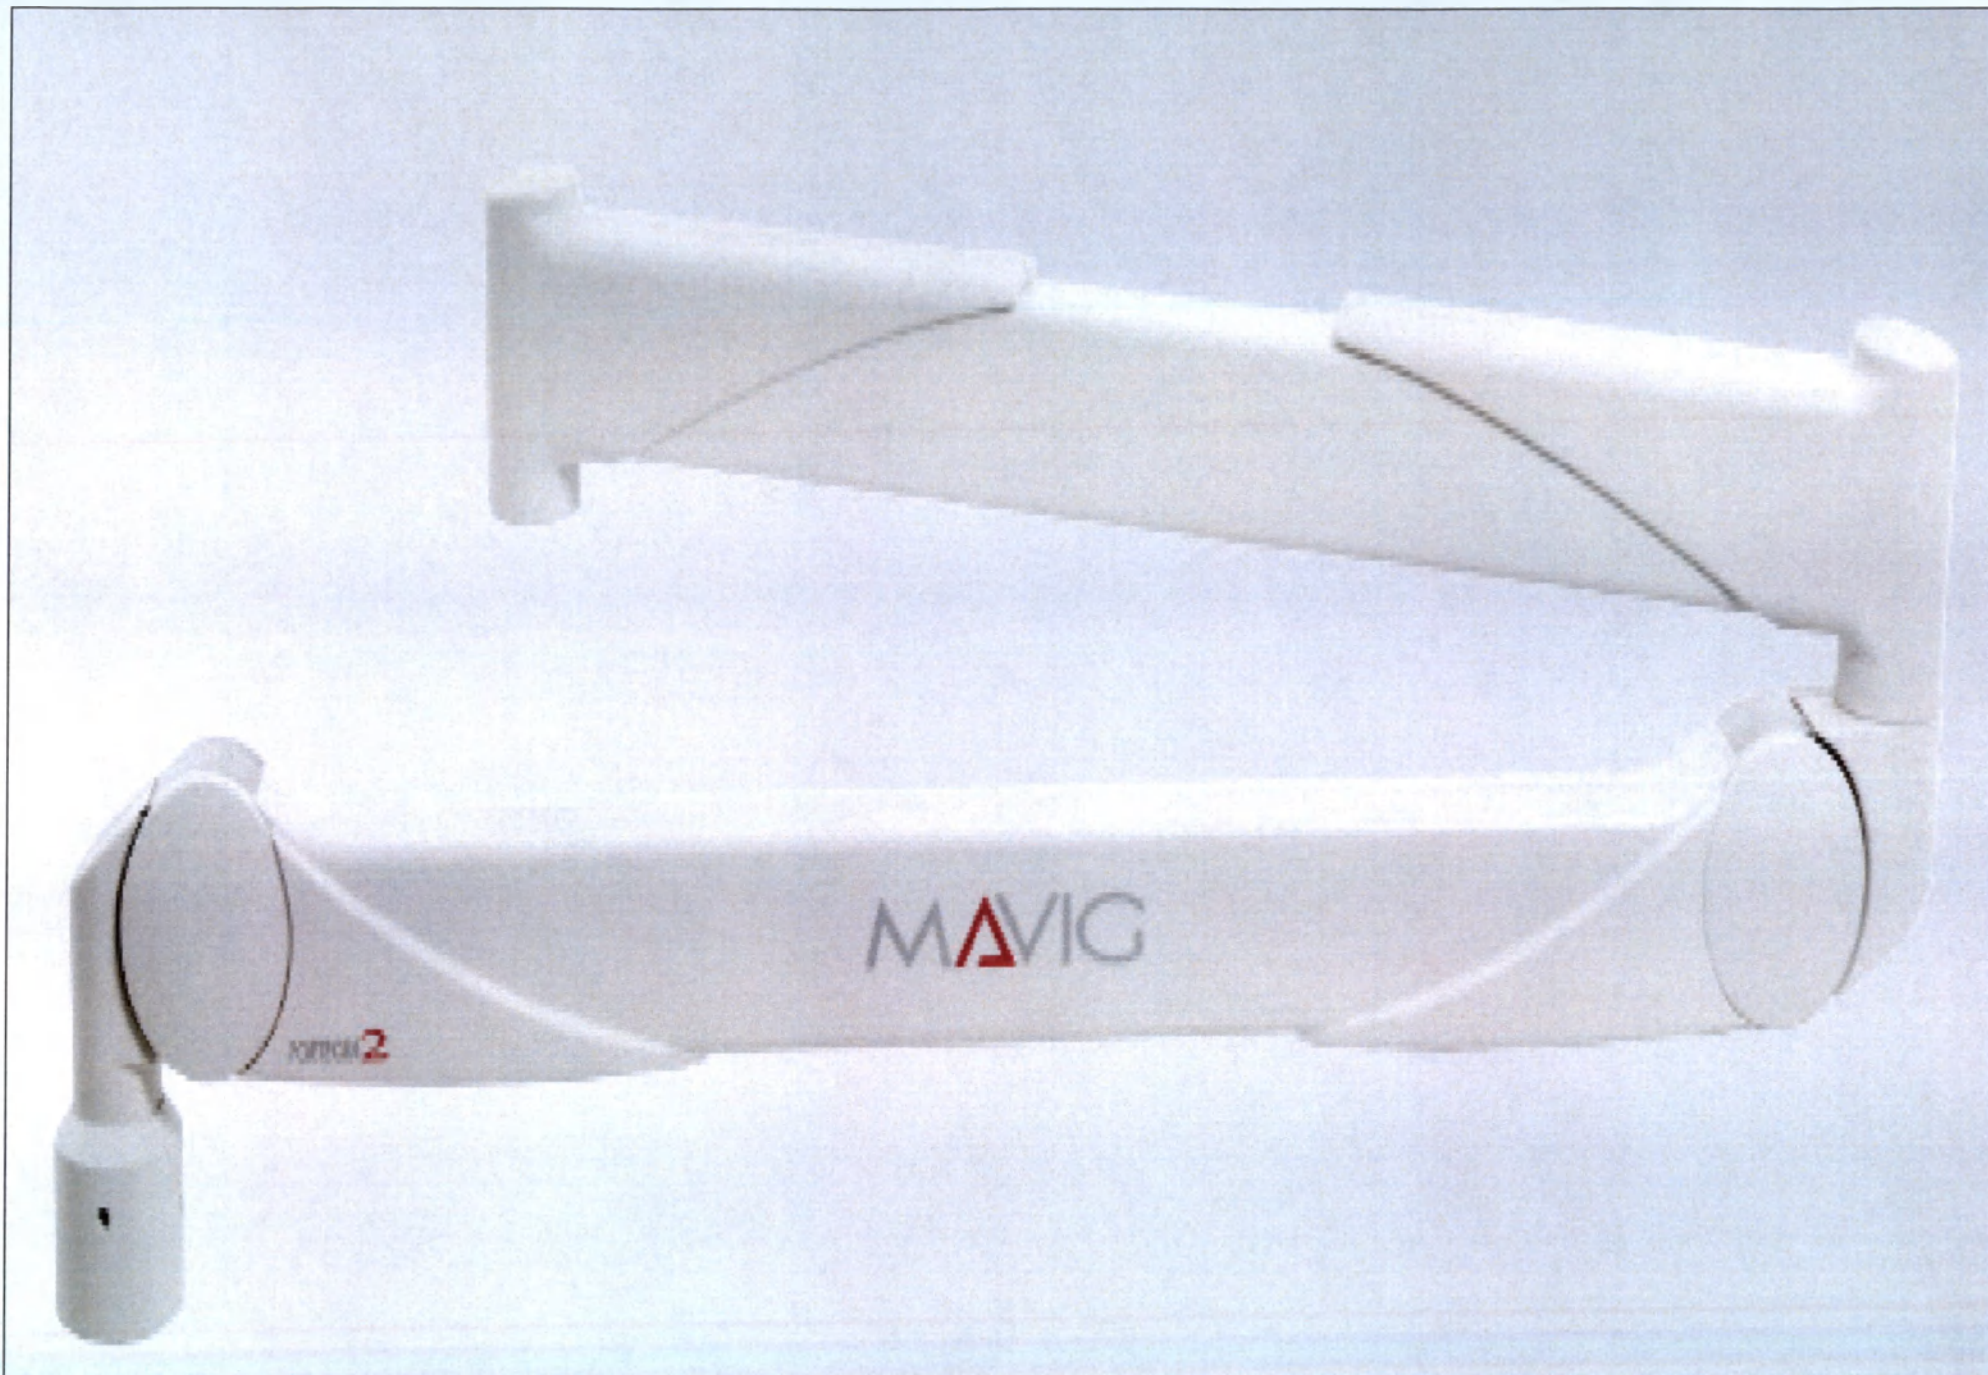


12. Кронштейн потолочный для монитора.

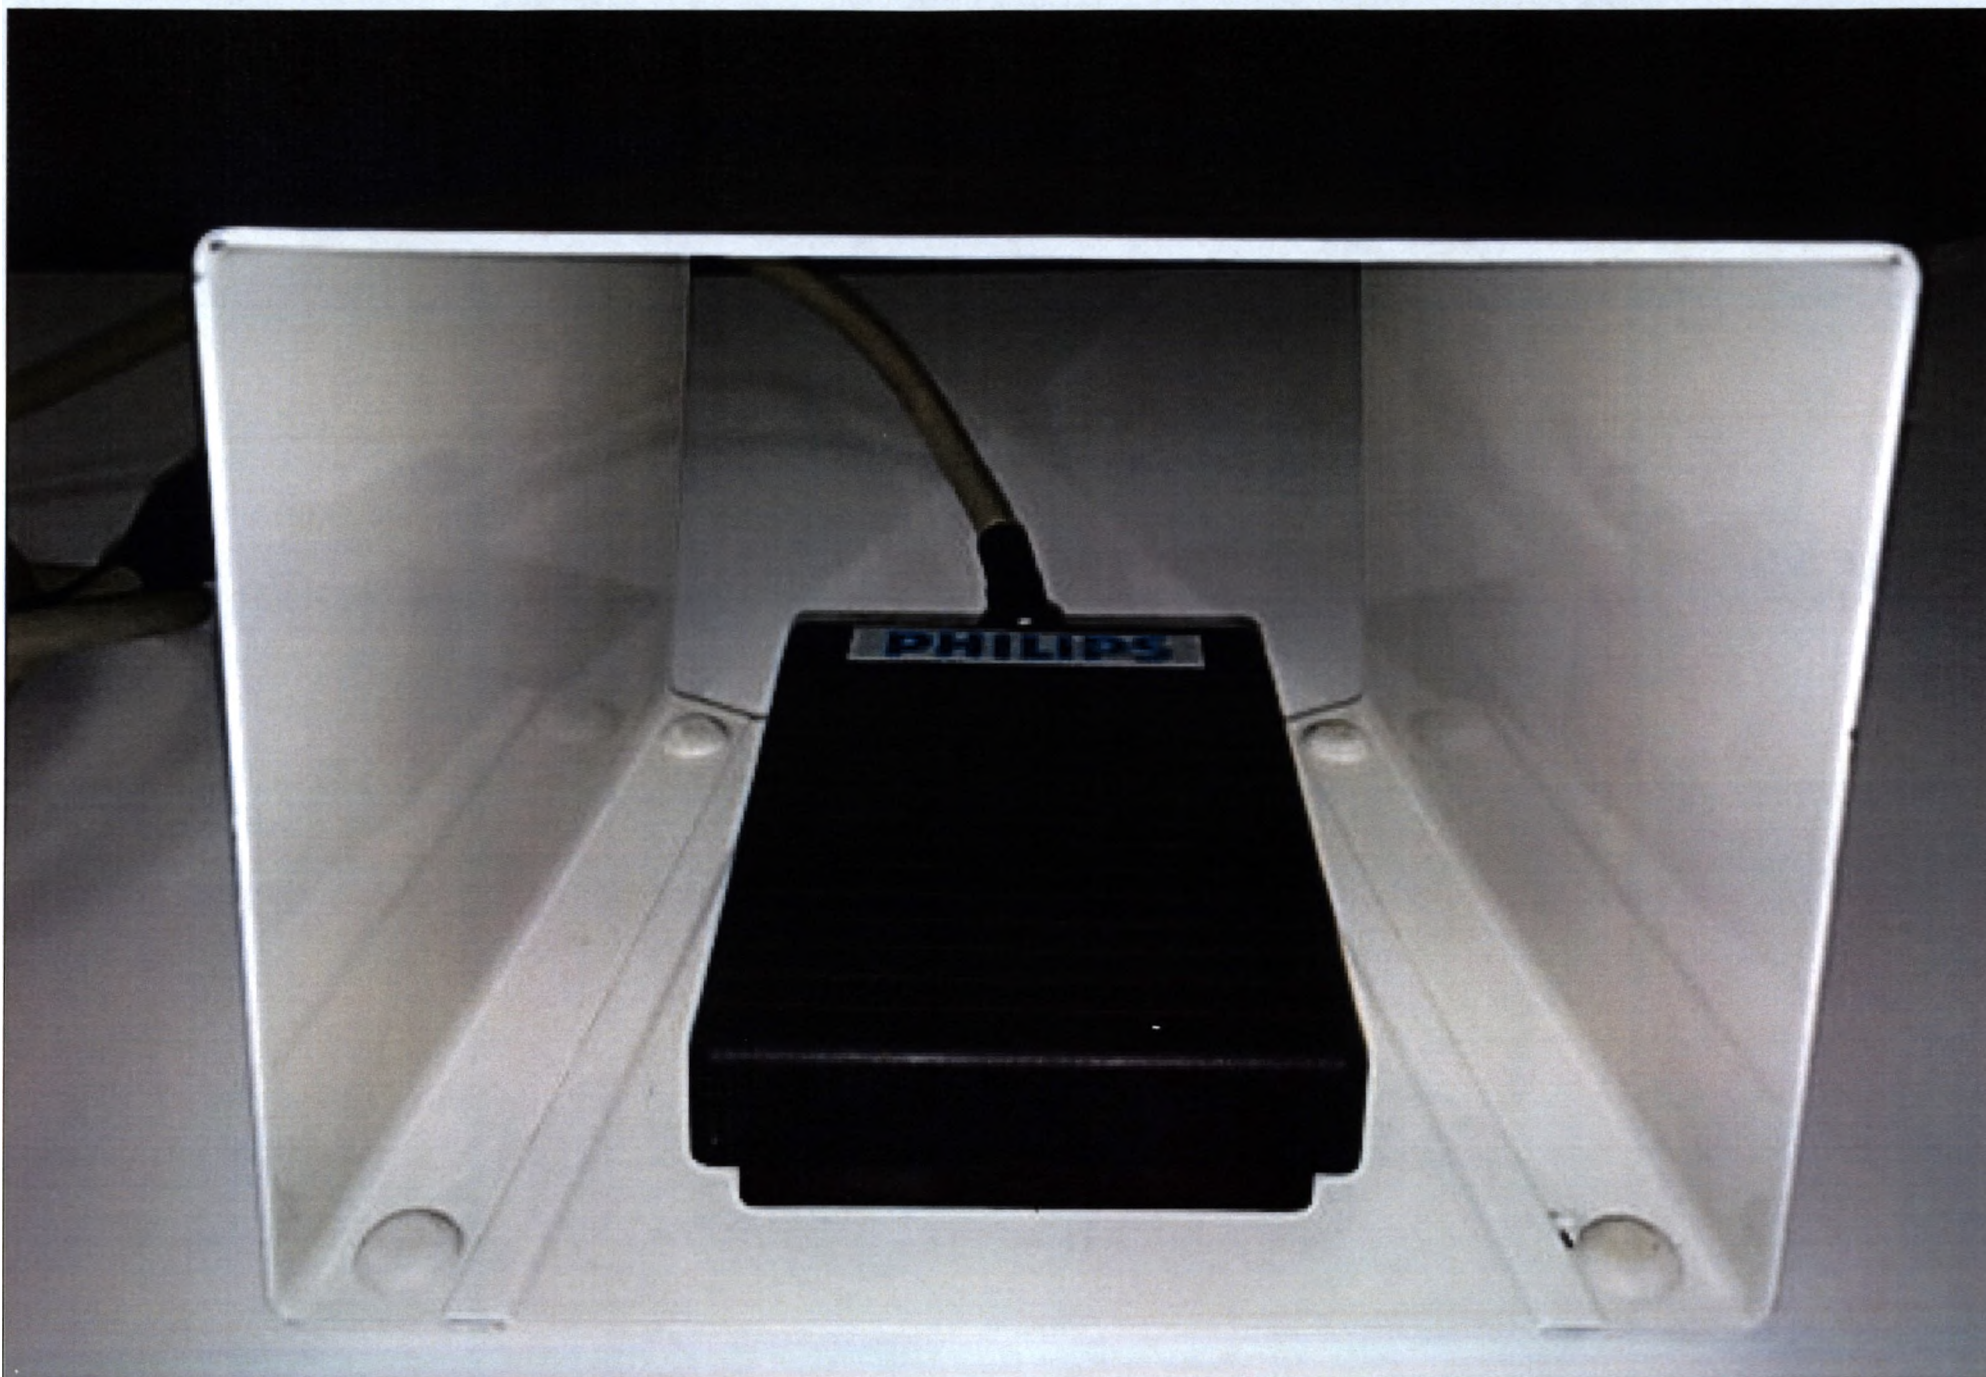


13. Ножная панель для активации сканирования.

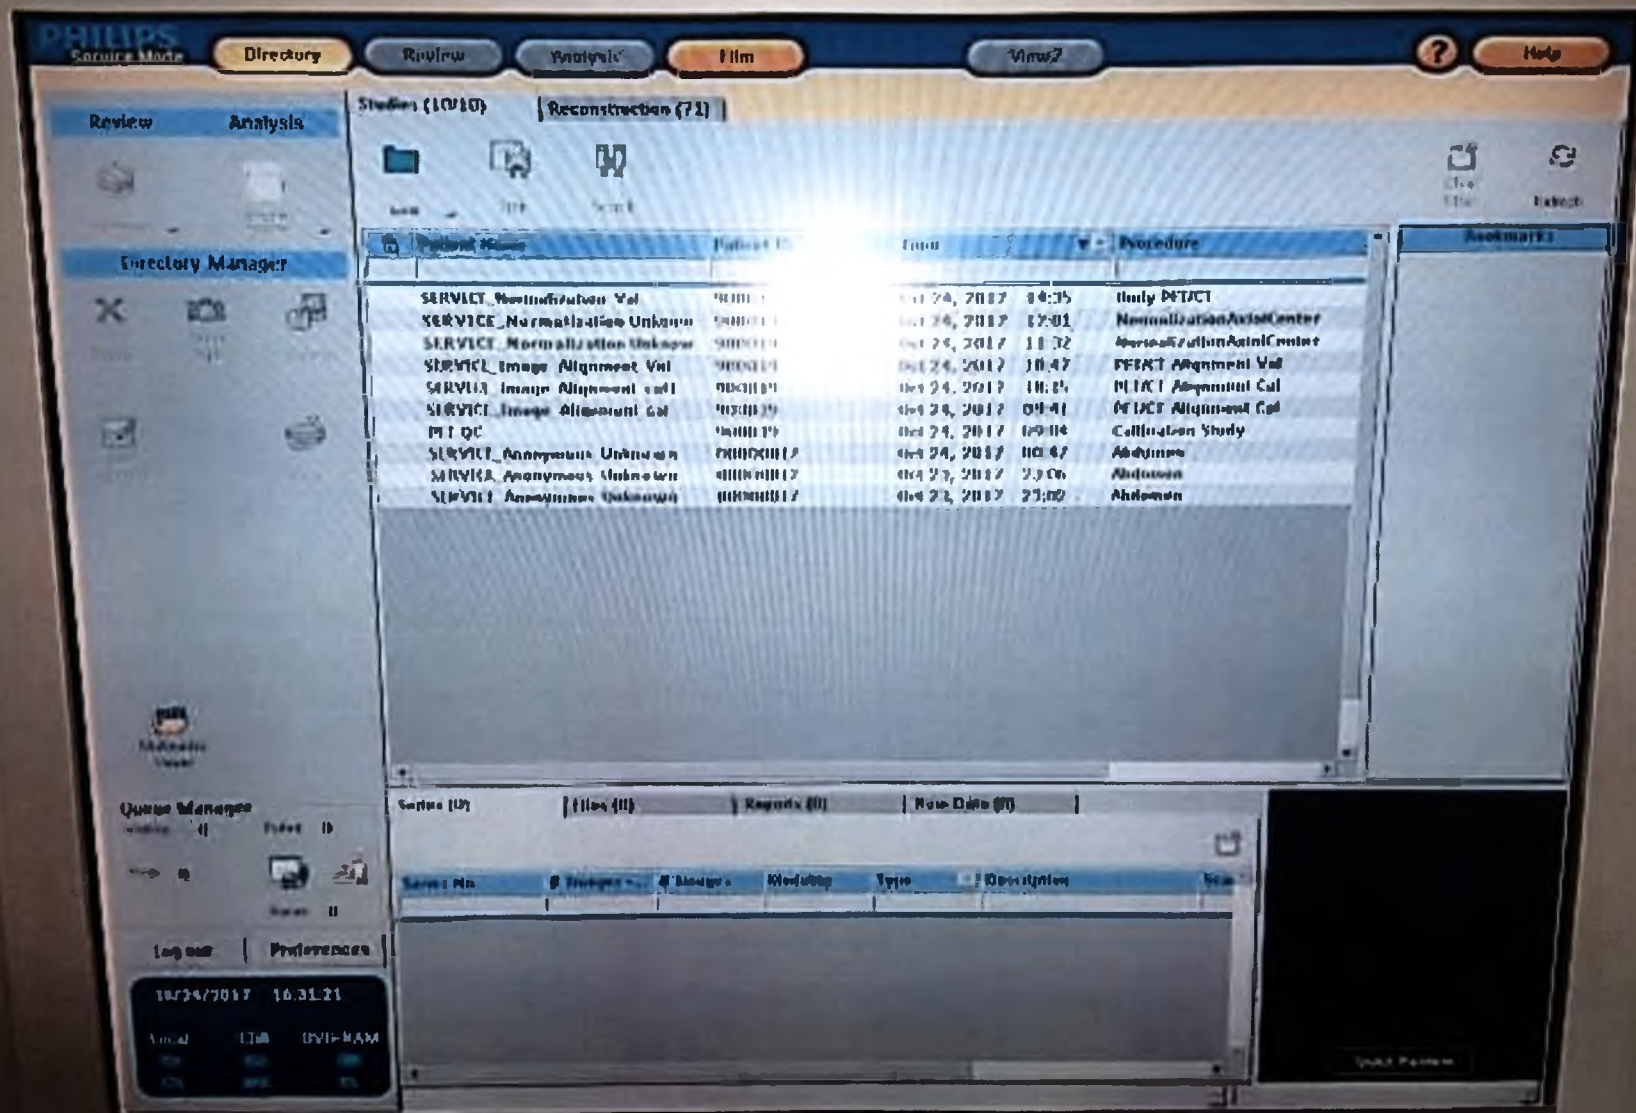


14. Ключи лицензионные для активации программных приложений ПЭТ/КТ системы.

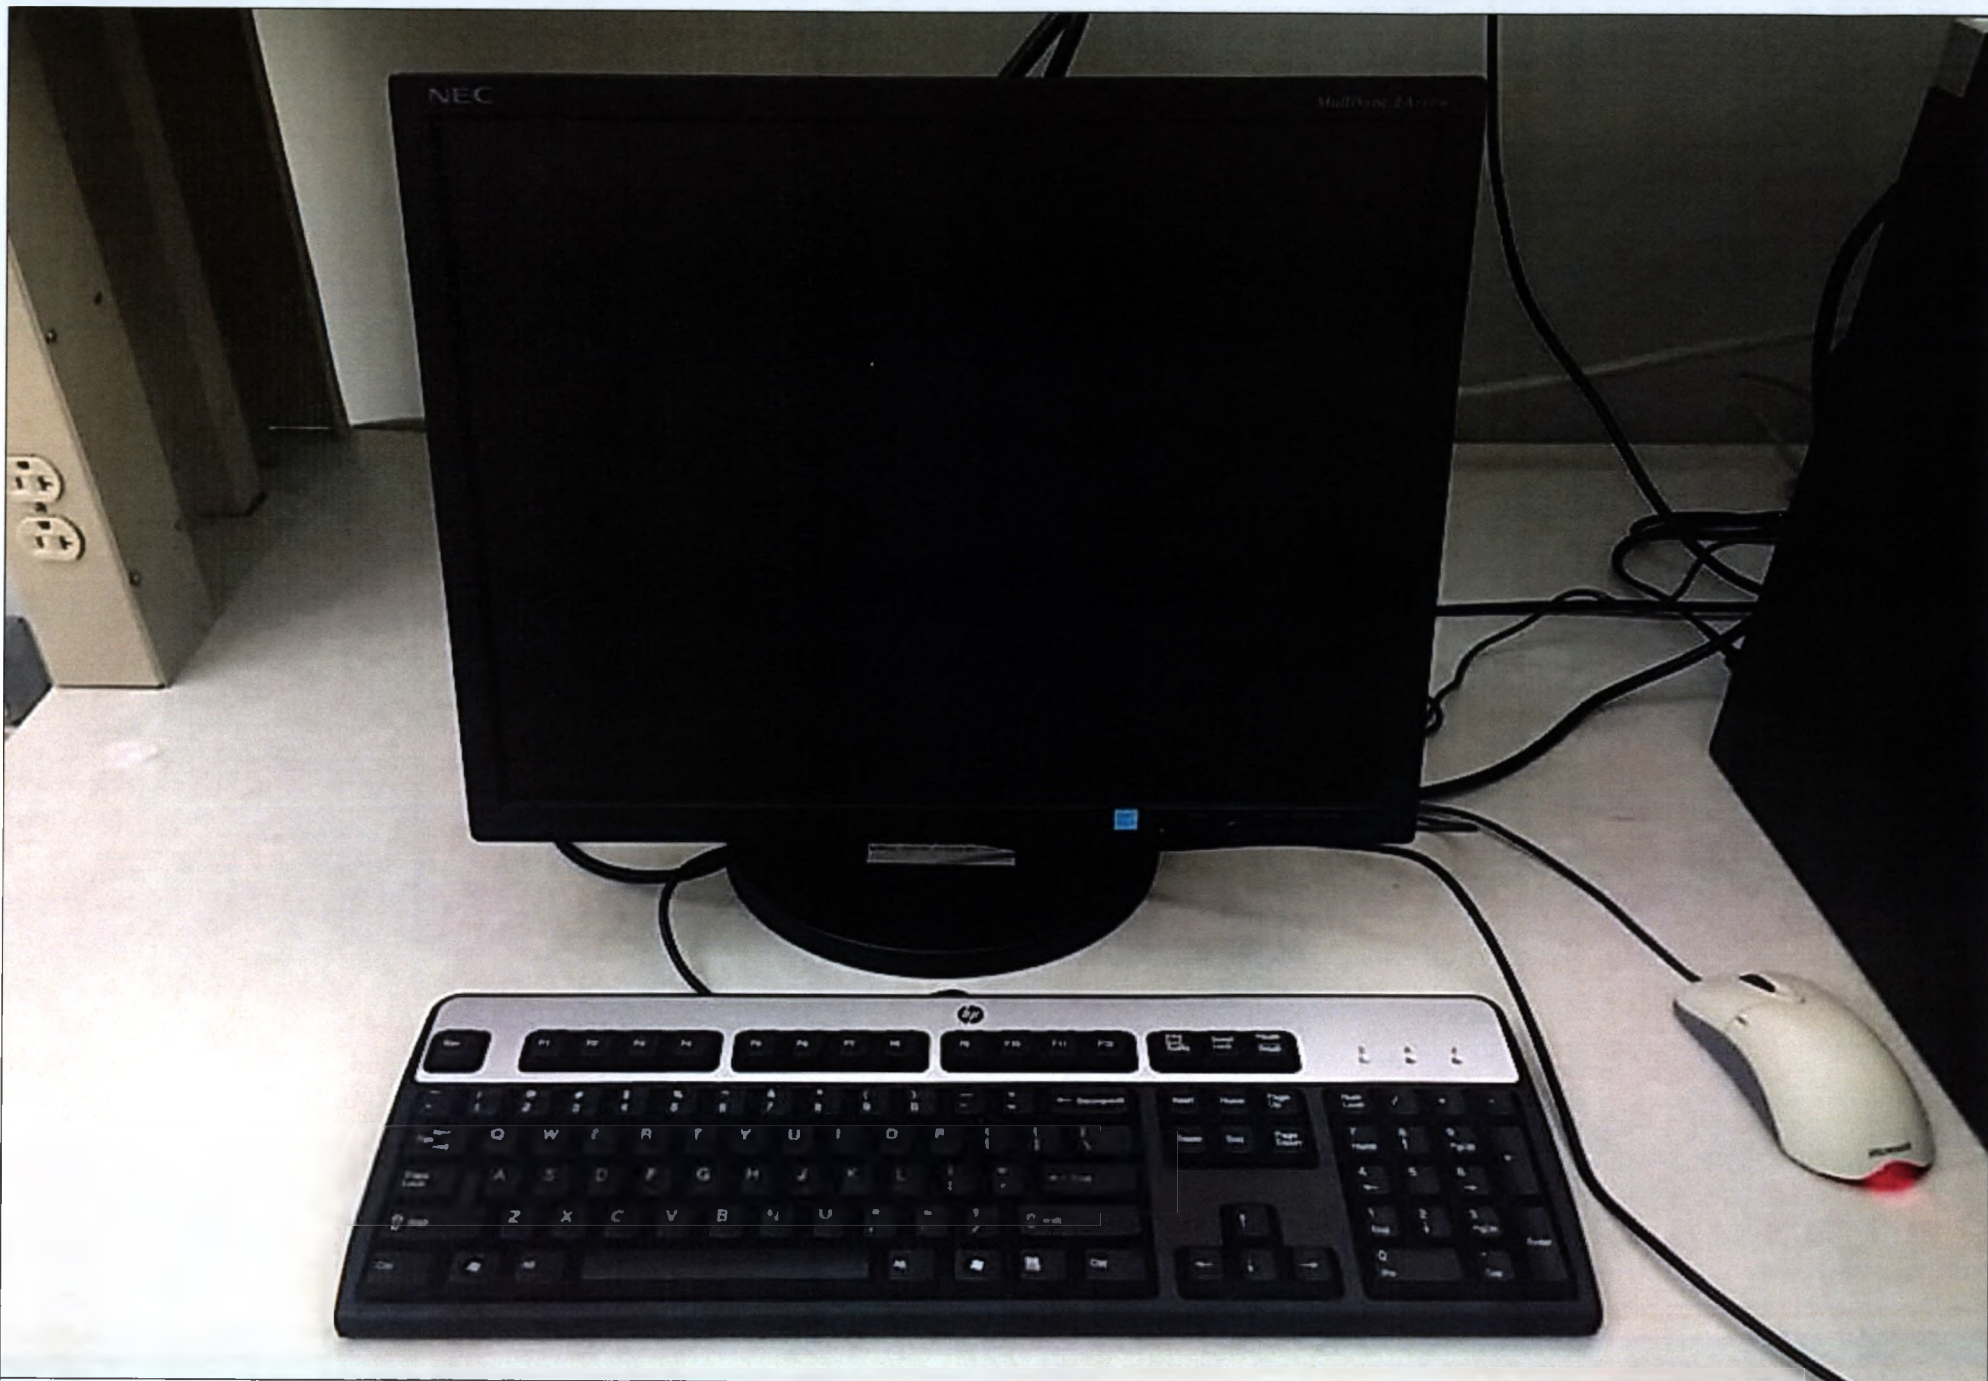


15. Компьютерные рабочие станции для обработки, просмотра, архивации данных исследований, симуляции и планирования терапии.

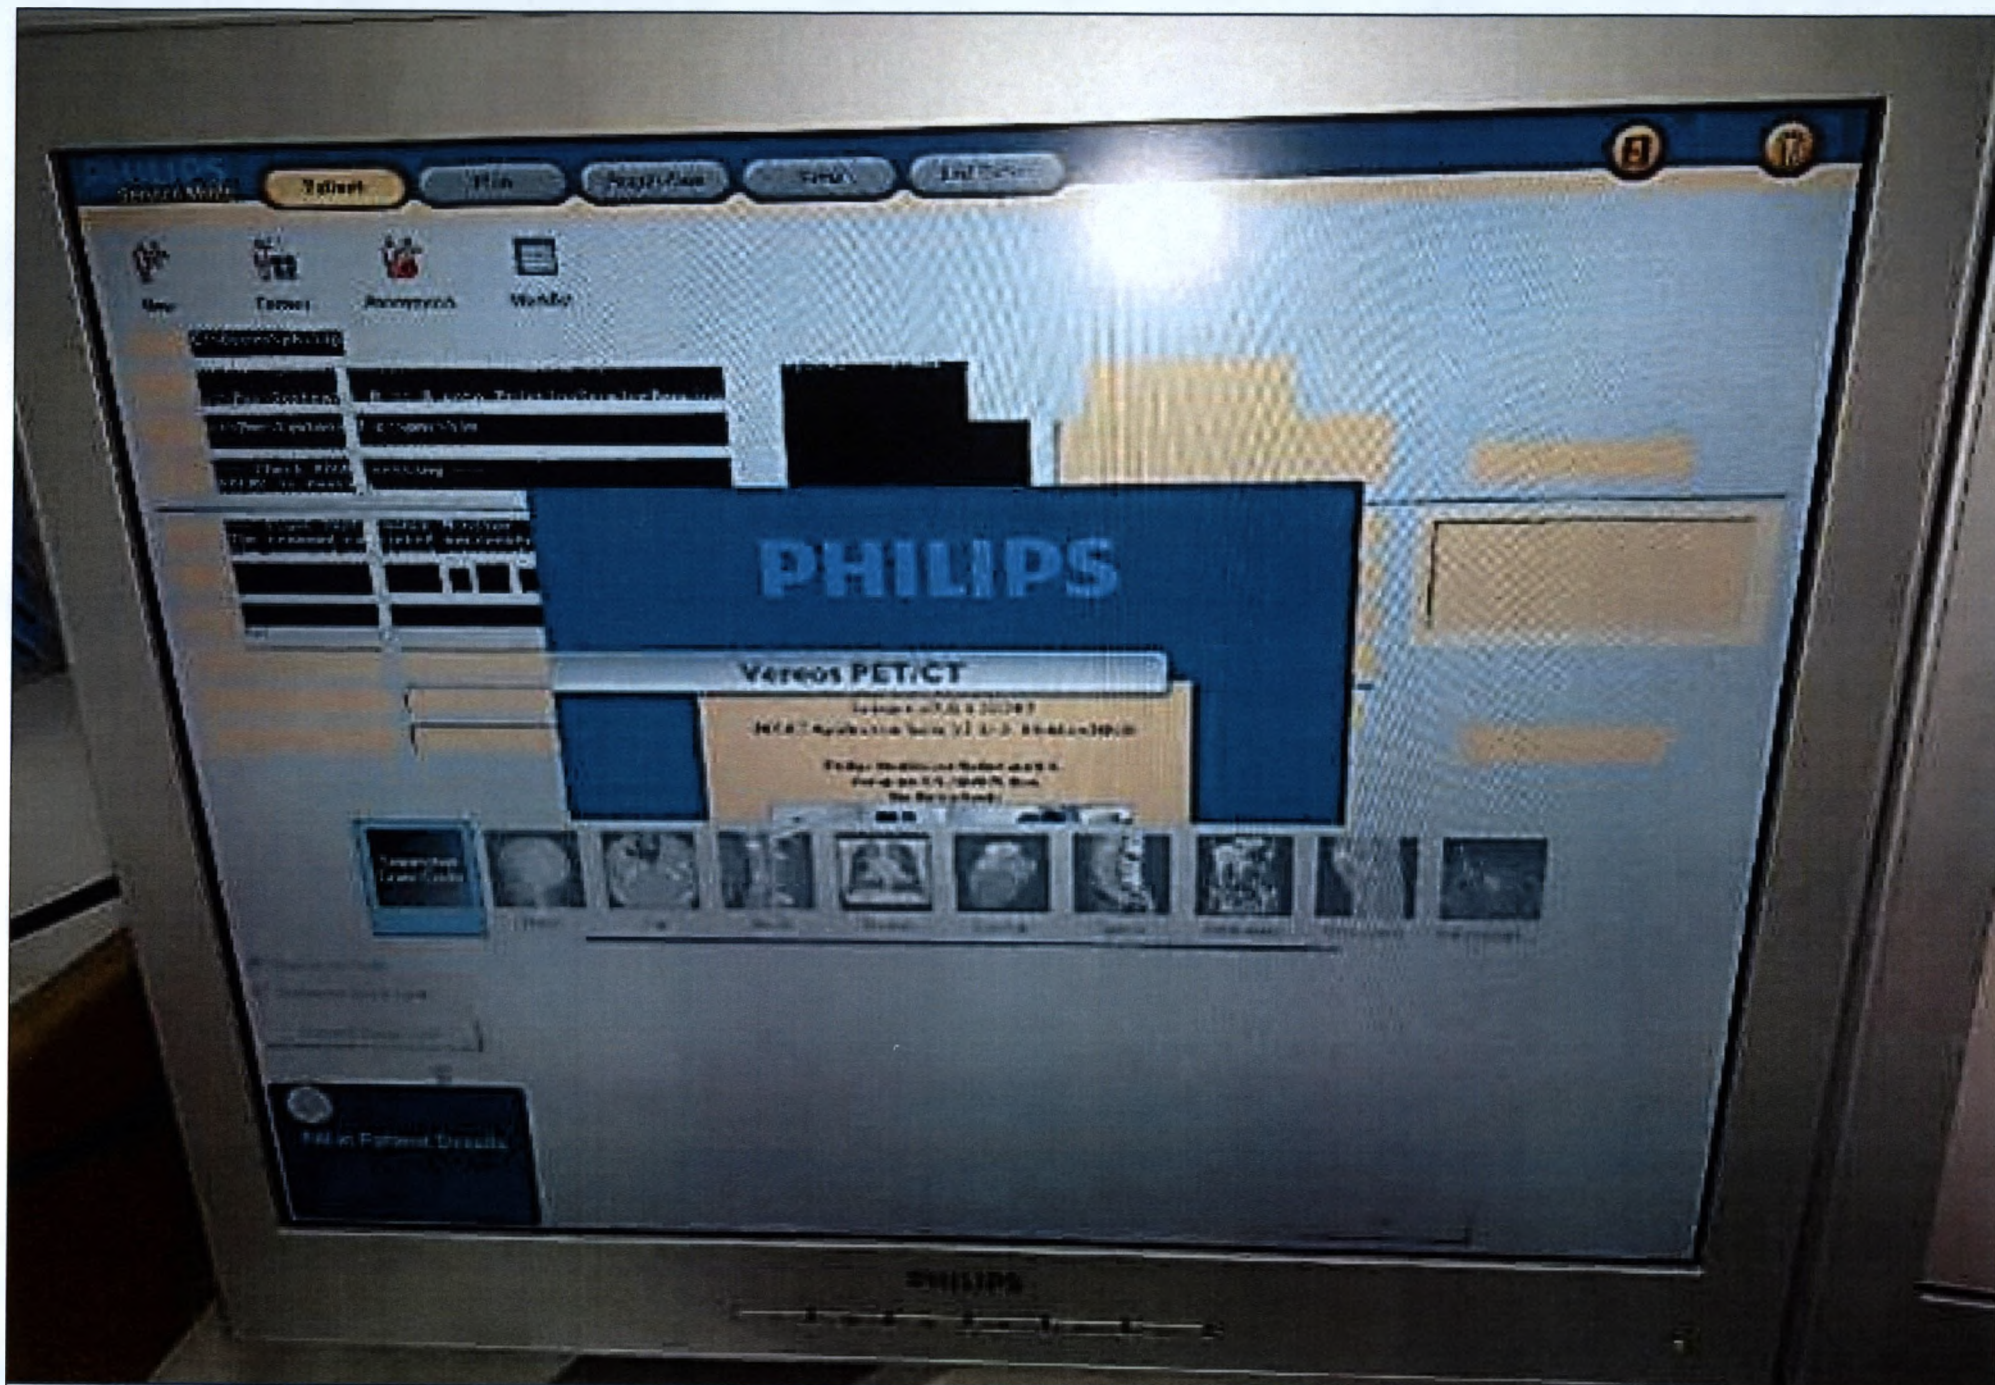


16а. Программные приложения для компьютерных рабочих станций для обработки, просмотра, архивации данных исследований, симуляции и планирования терапии на оптических или электронных носителях.

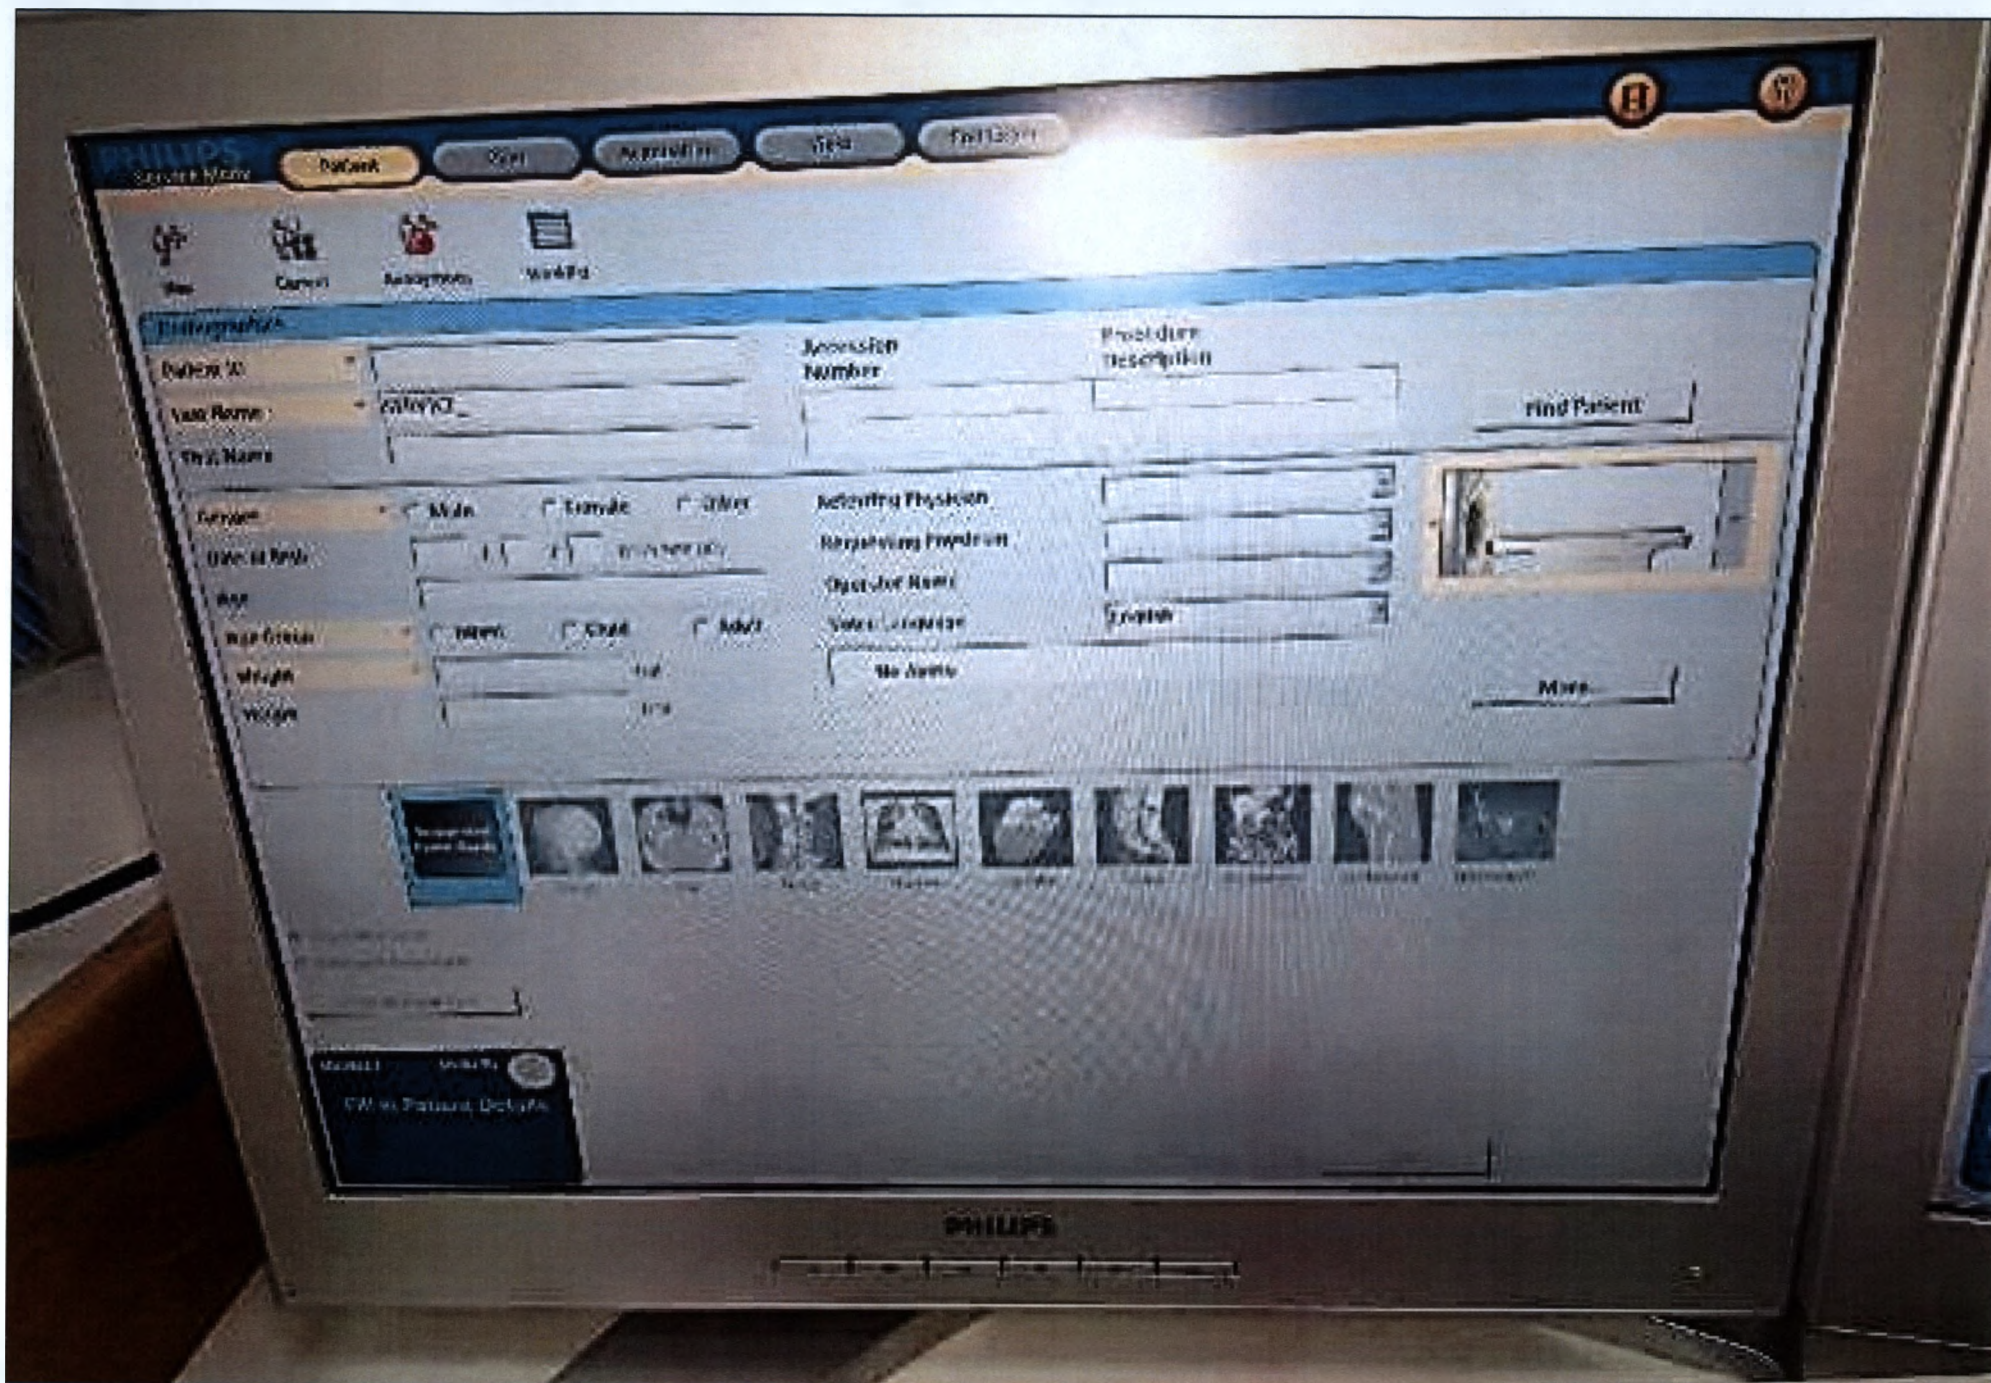

16с. Программные приложения для компьютерных рабочих станций для обработки, просмотра, архивации данных исследований, симуляции и планирования терапии на оптических или электронных носителях.

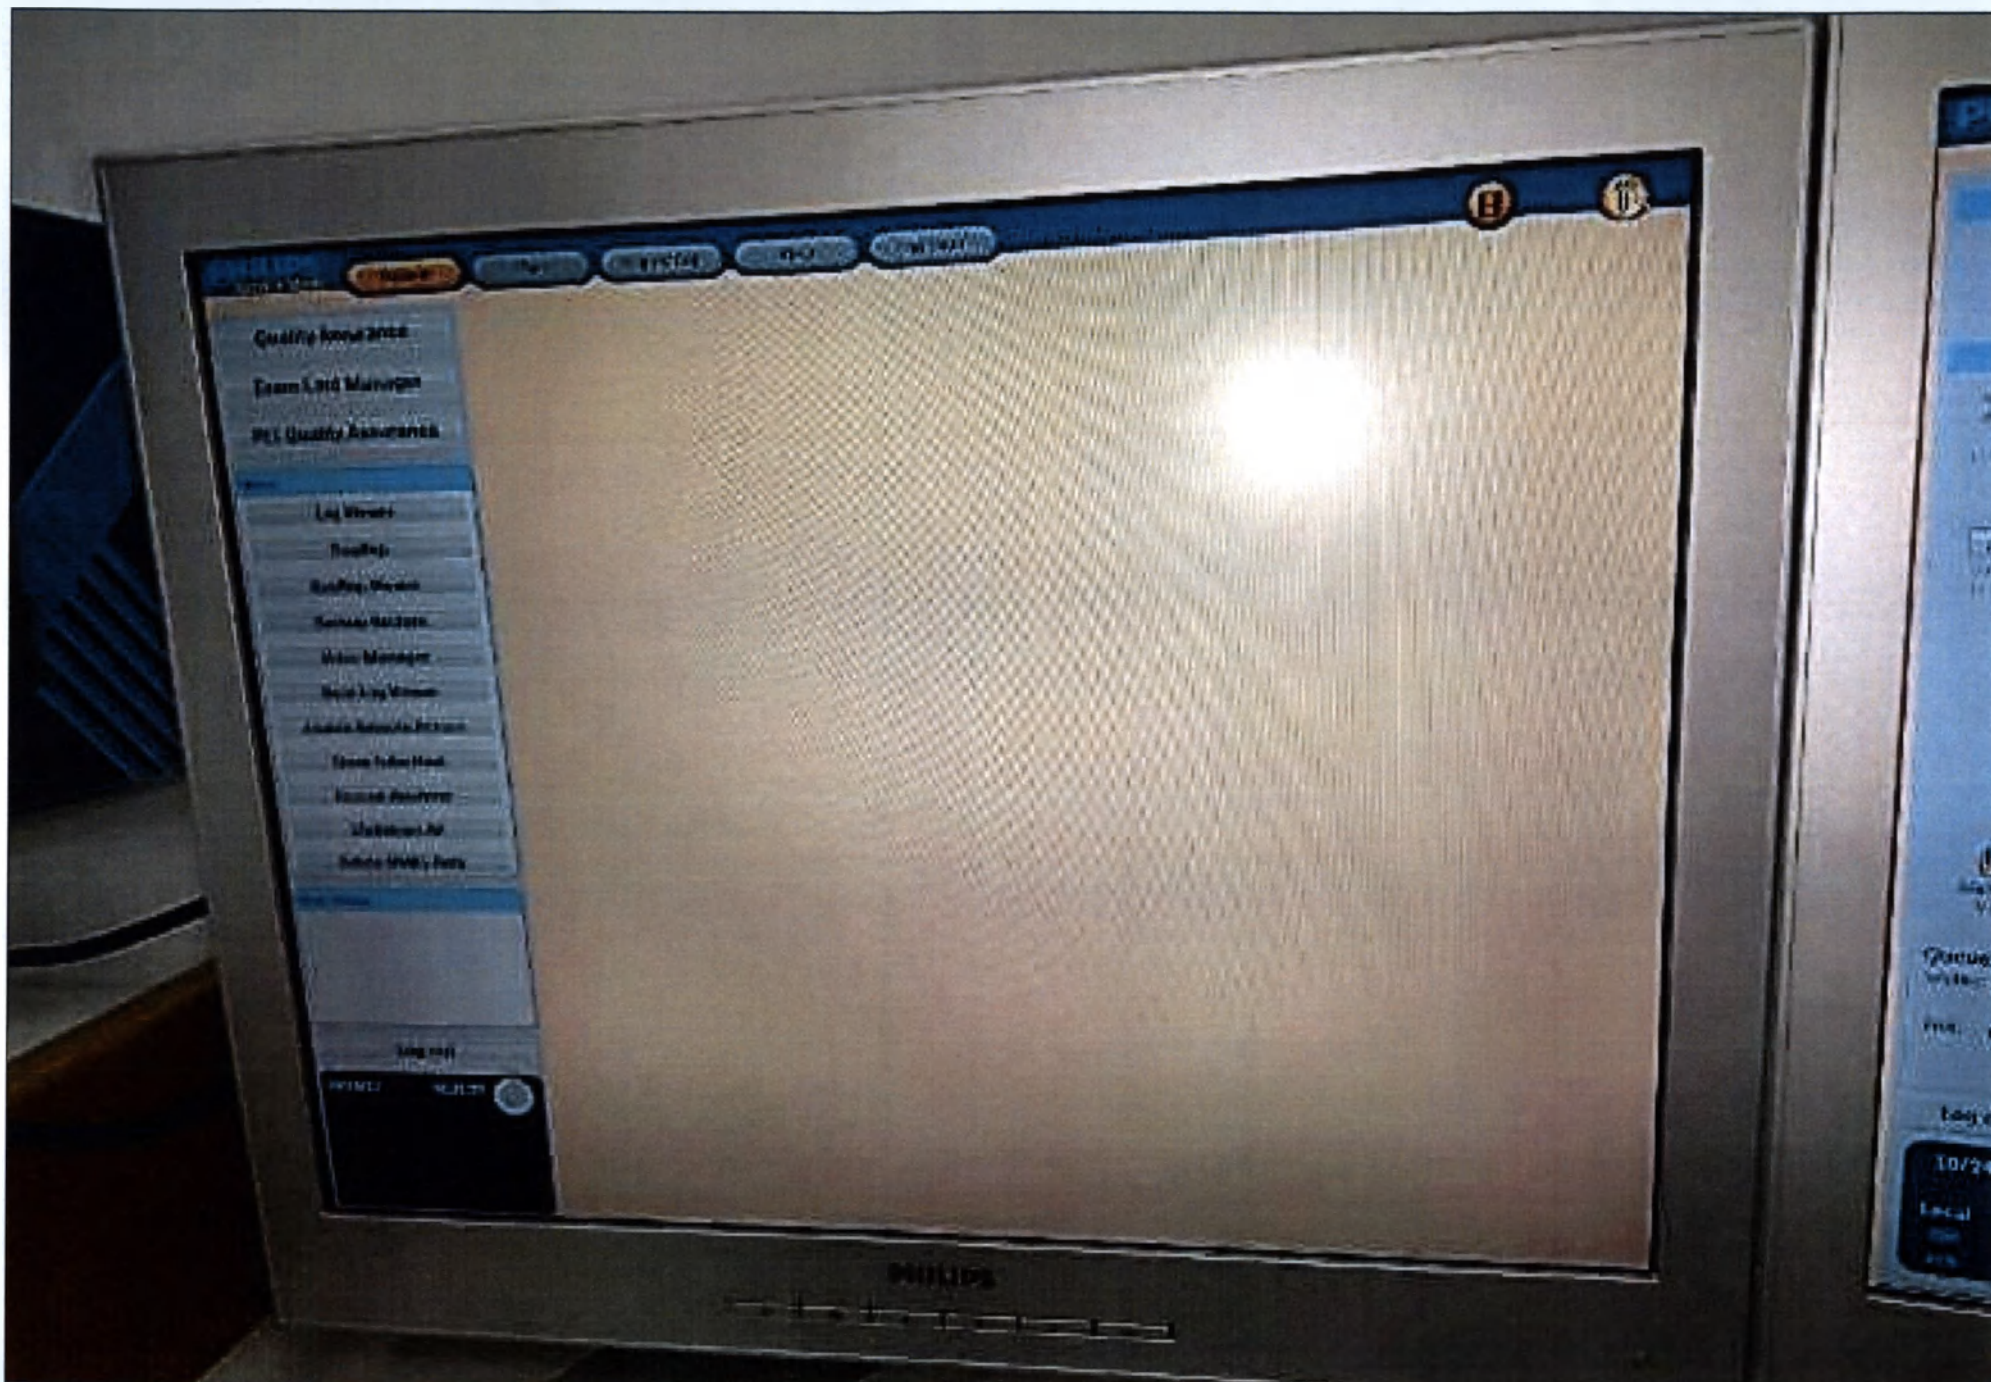


16d. Программные приложения для компьютерных рабочих станций для обработки, просмотра, архивации данных исследований, симуляции и планирования терапии на оптических или электронных носителях.

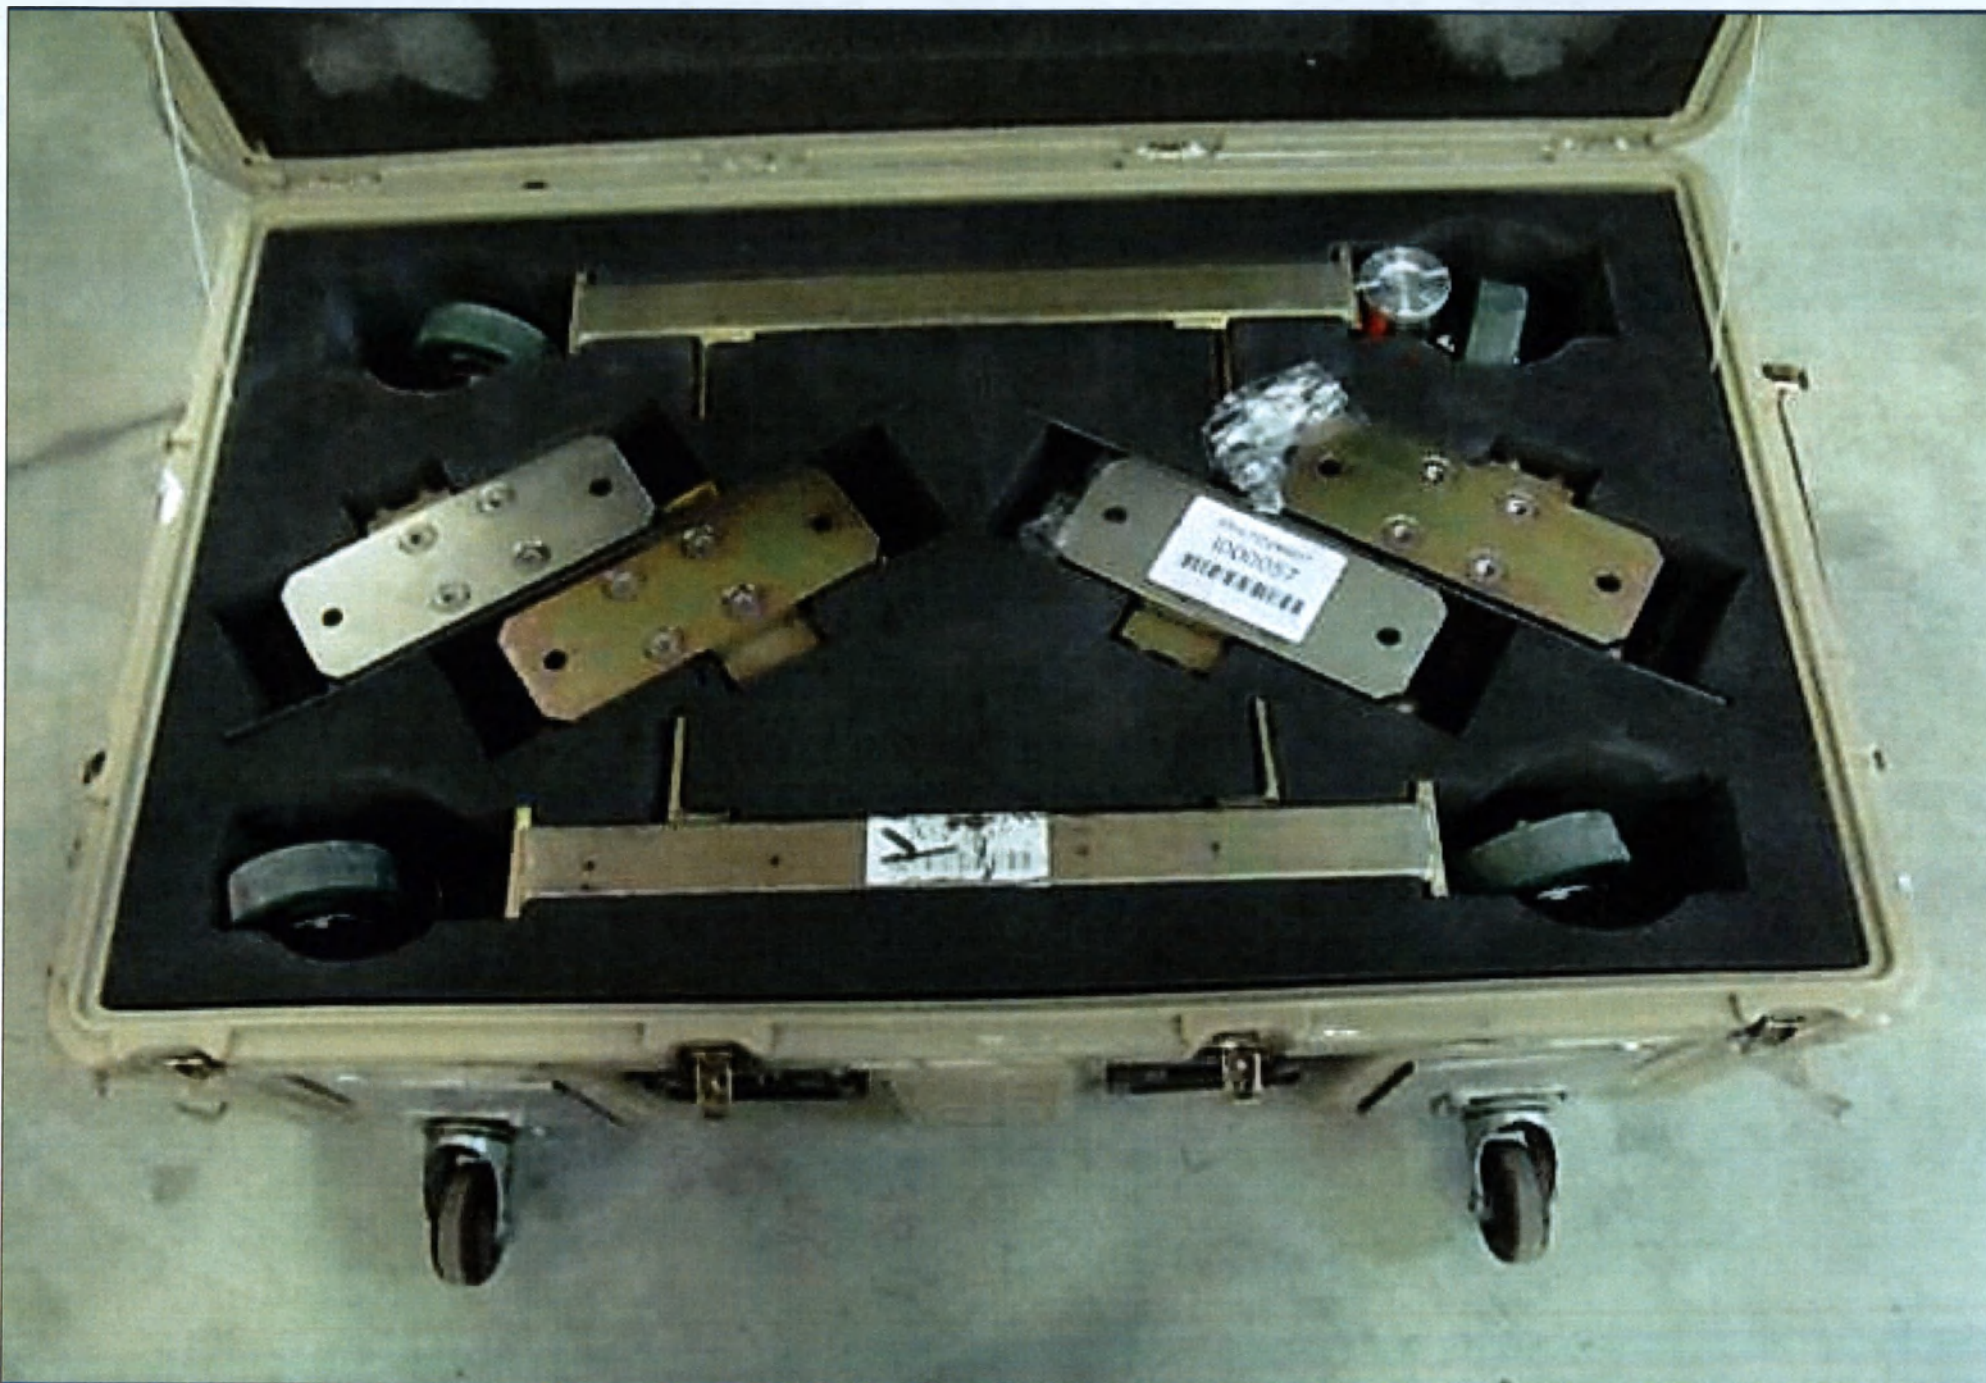


17а. Приспособления для монтажа системы.




17б. Приспособления для монтажа системы.

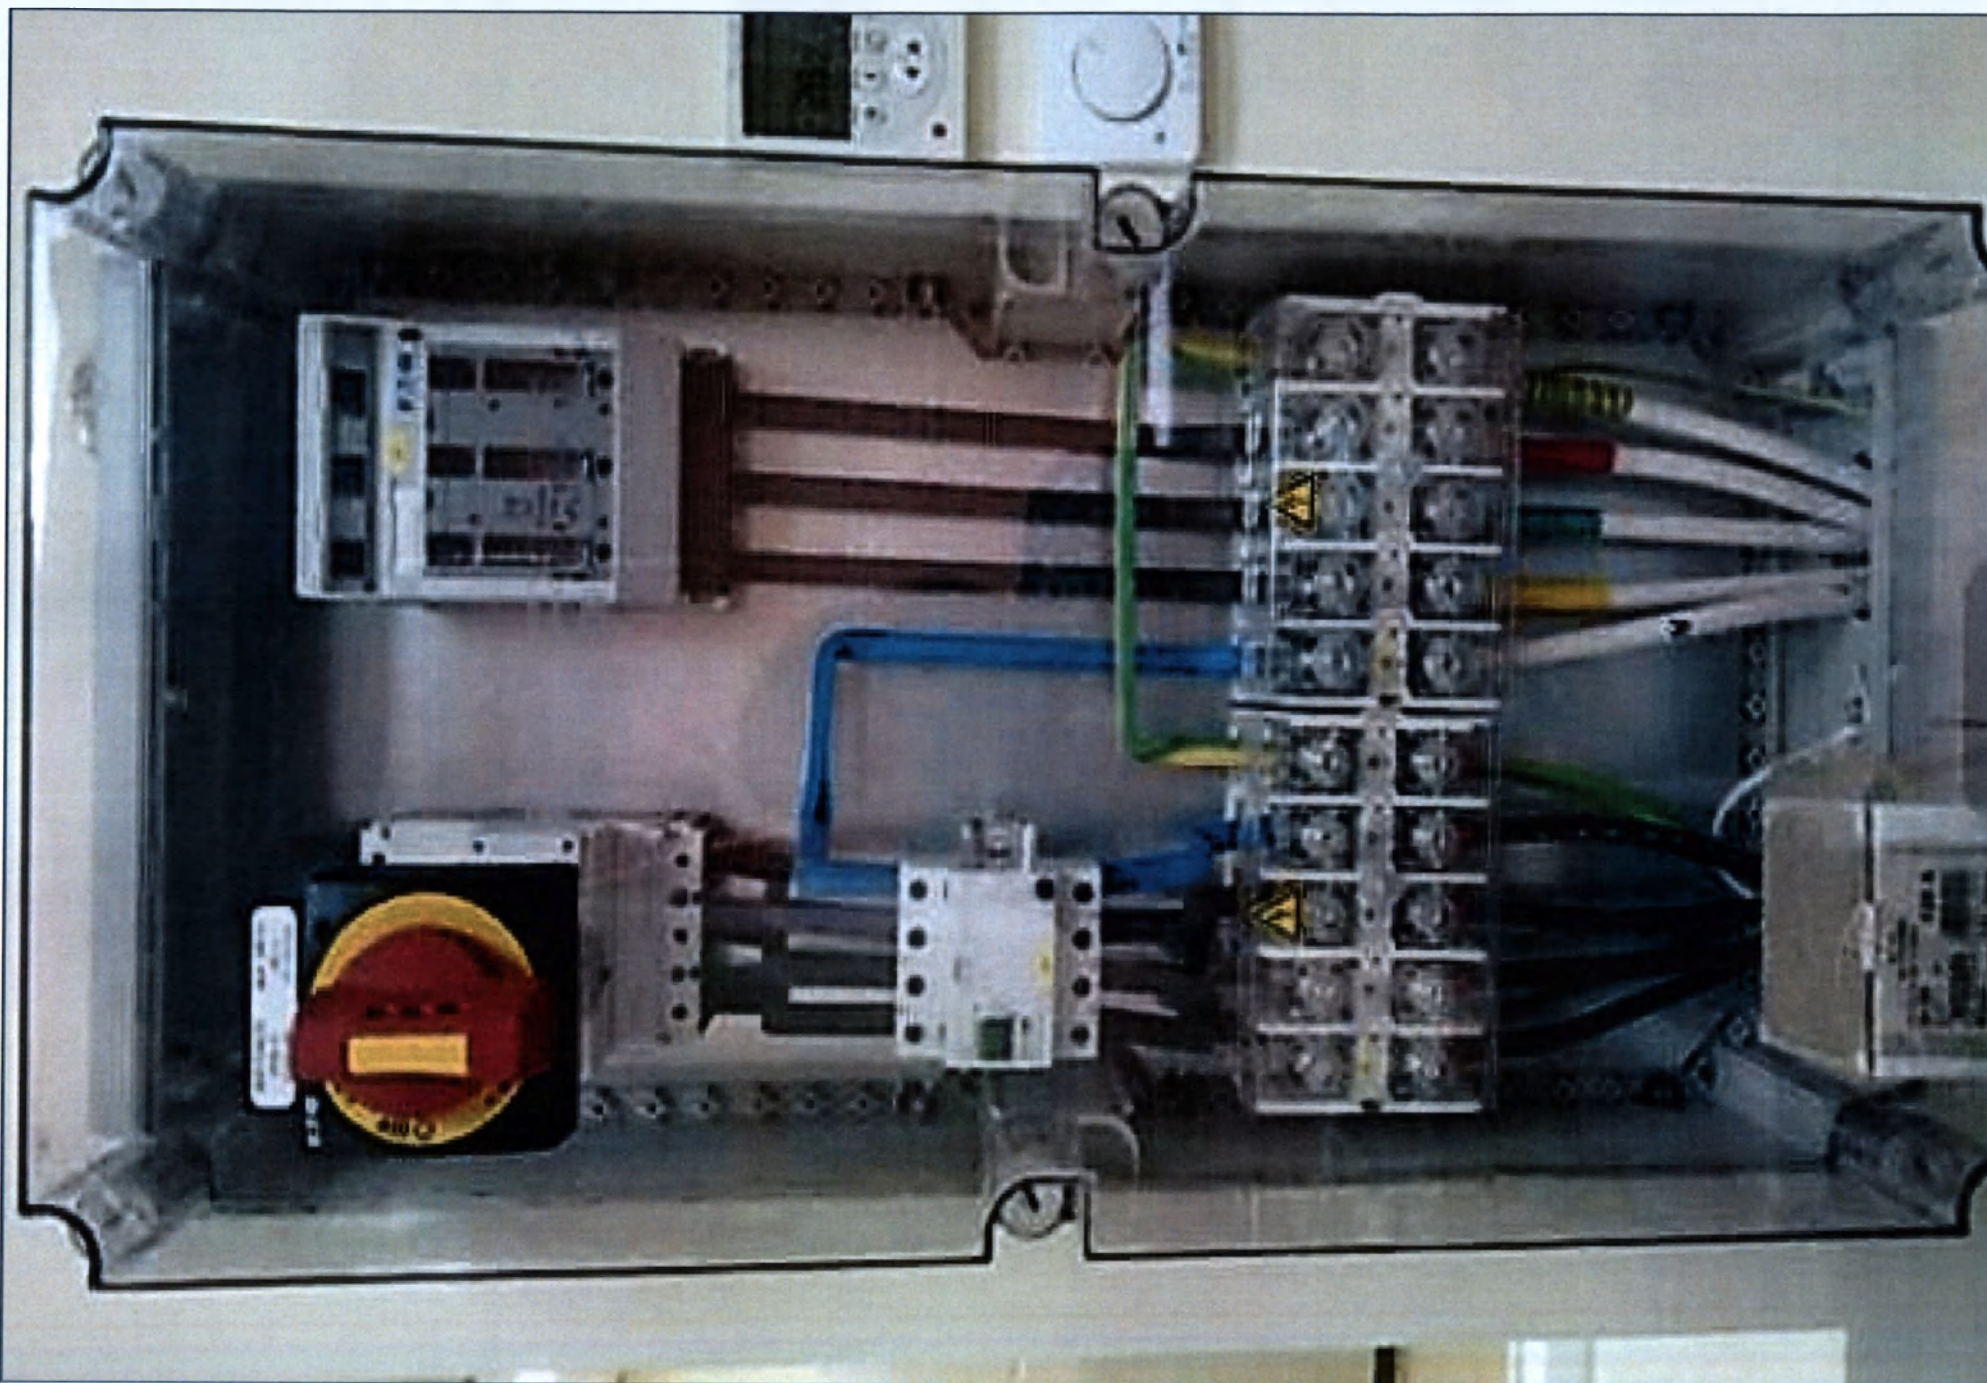


18а. Рубильник включения электропитания.

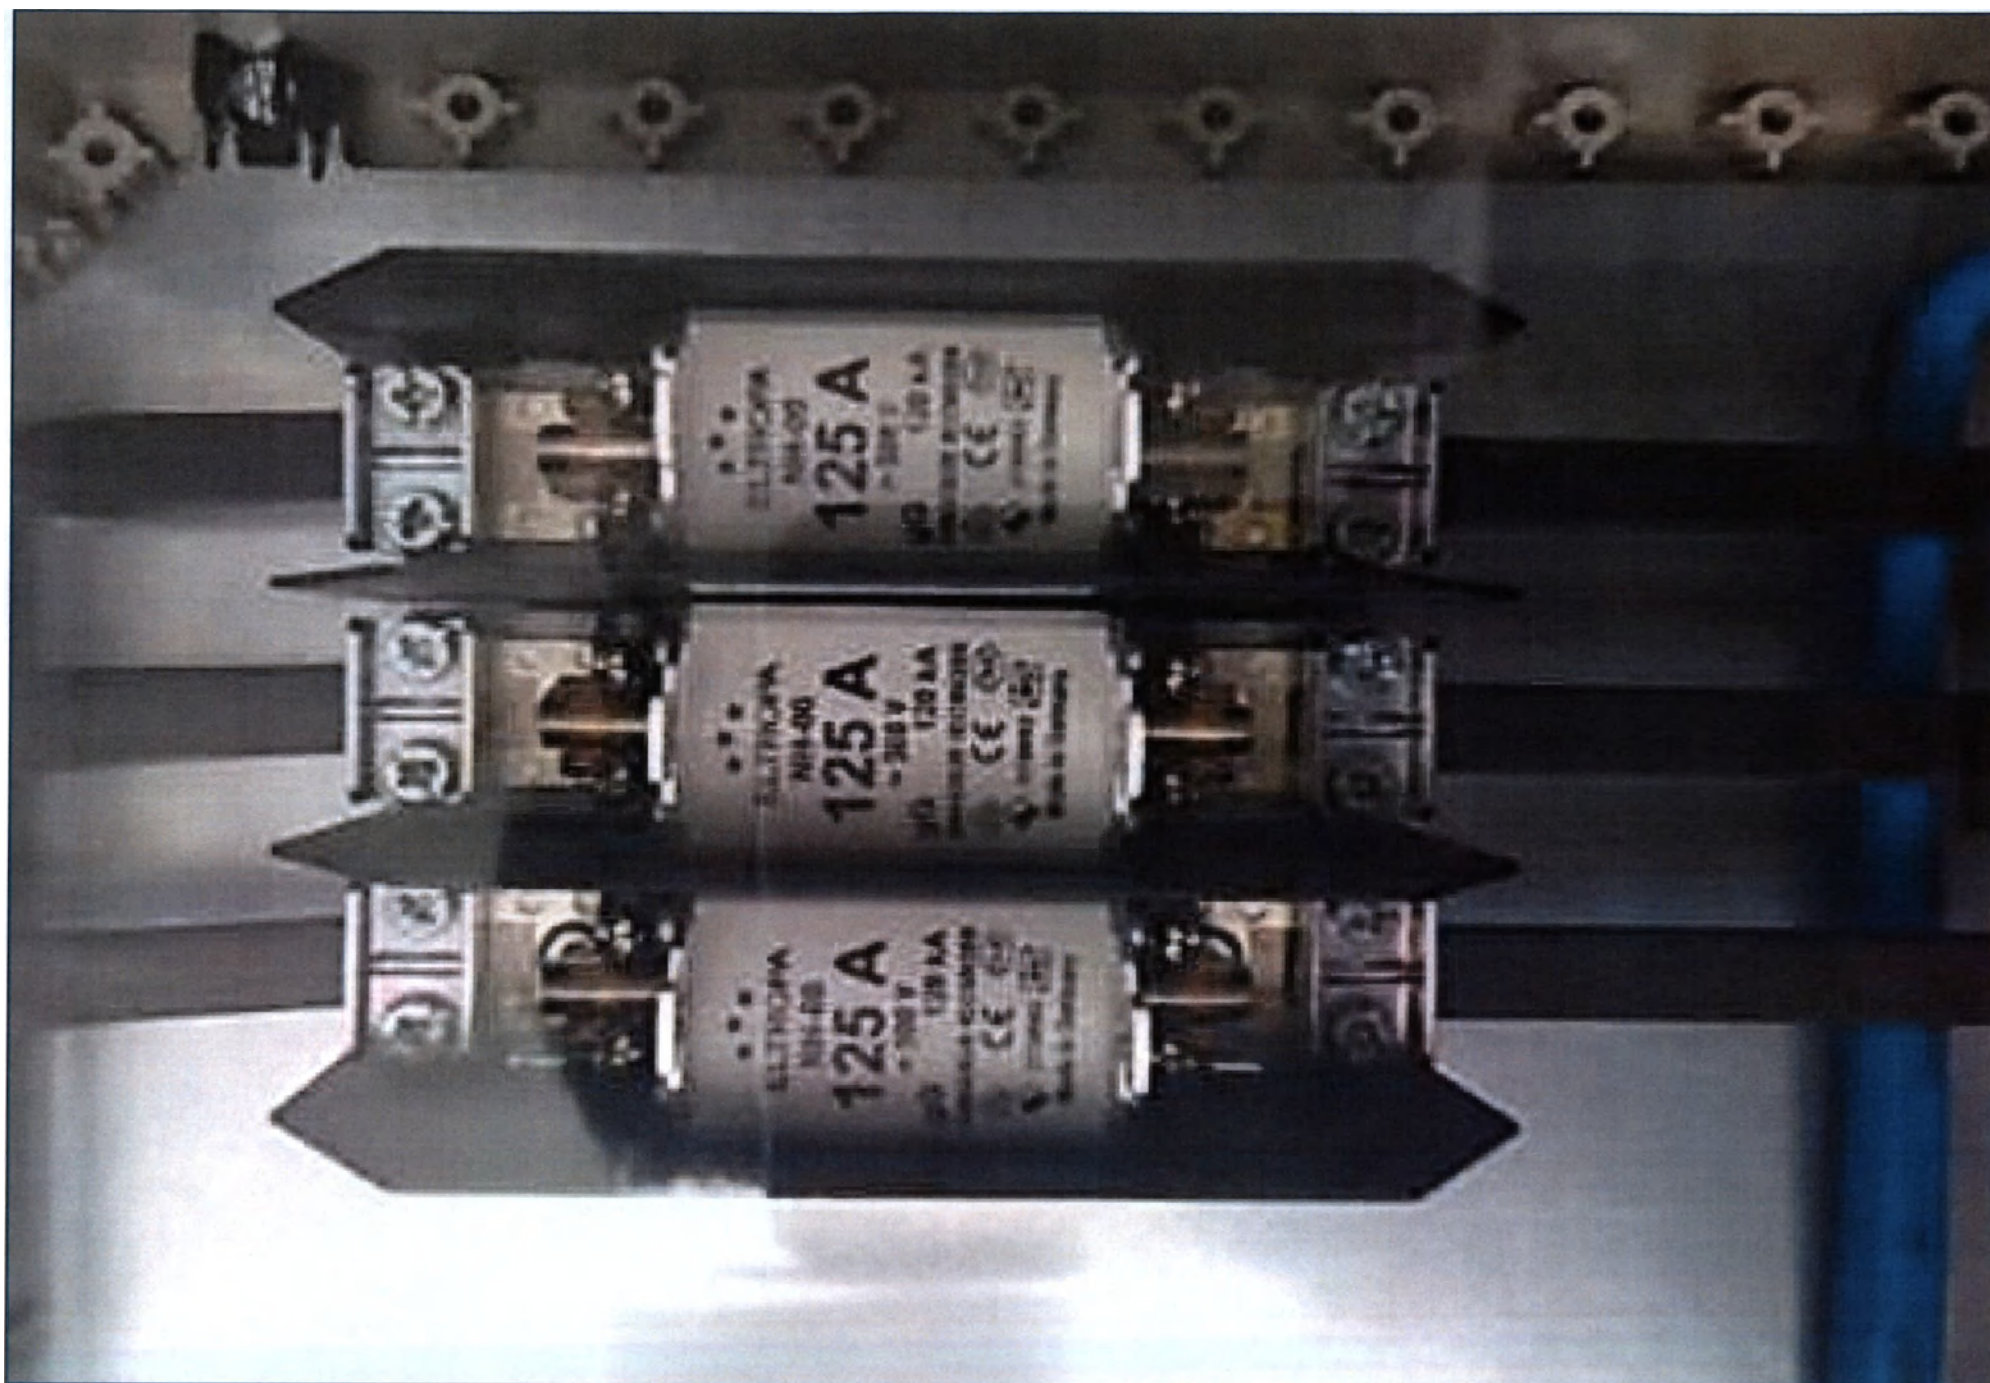

18b. Рубильник включения электропитания.

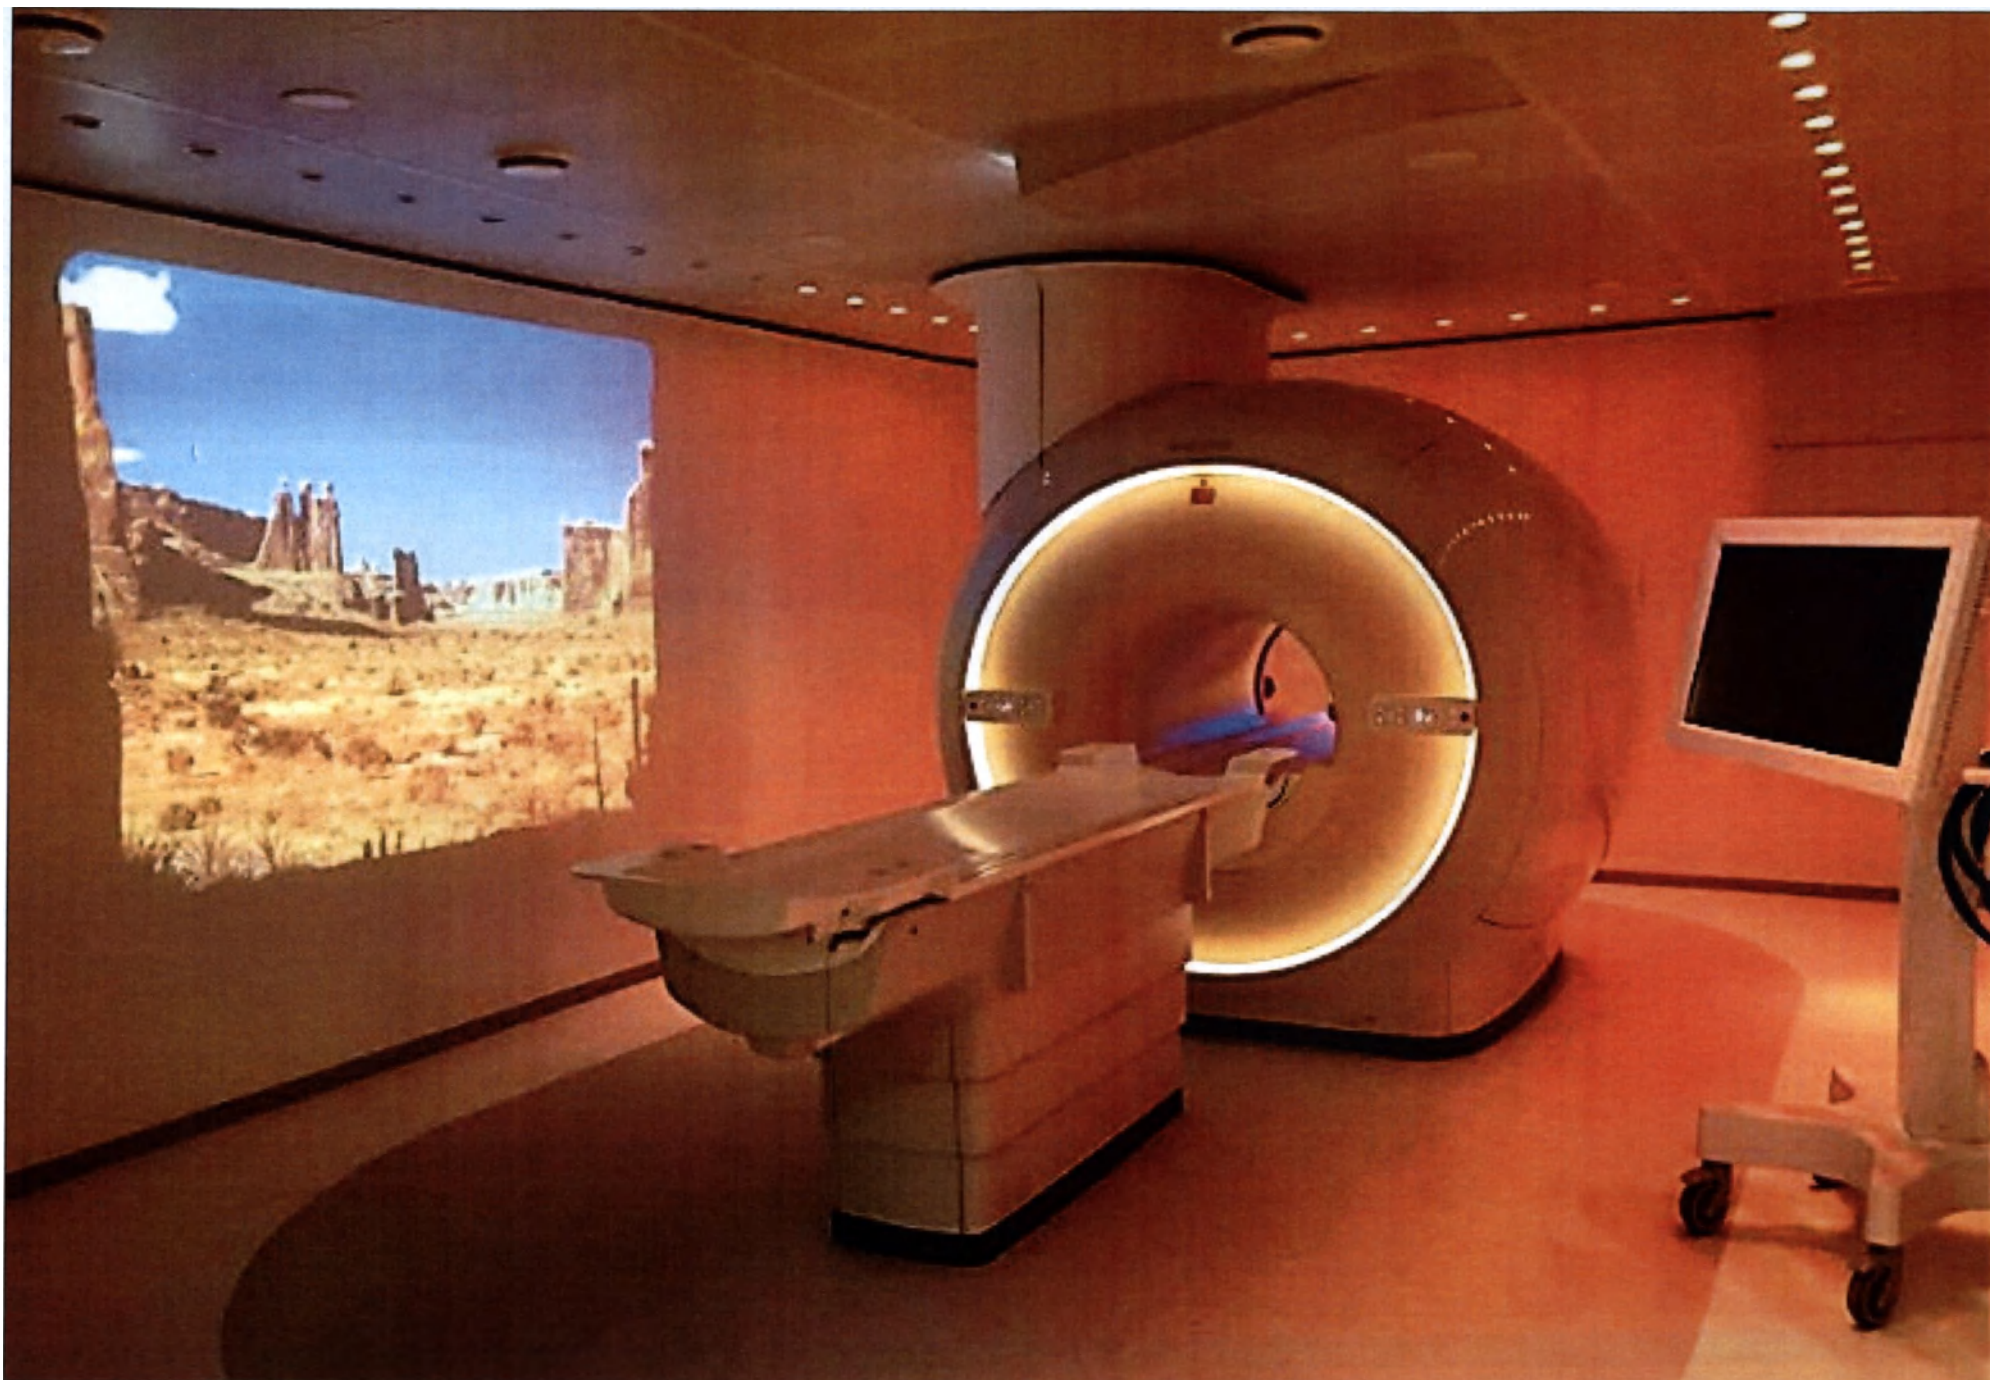


19a. Система звукового и видео-сопровождения Ambient Experience.

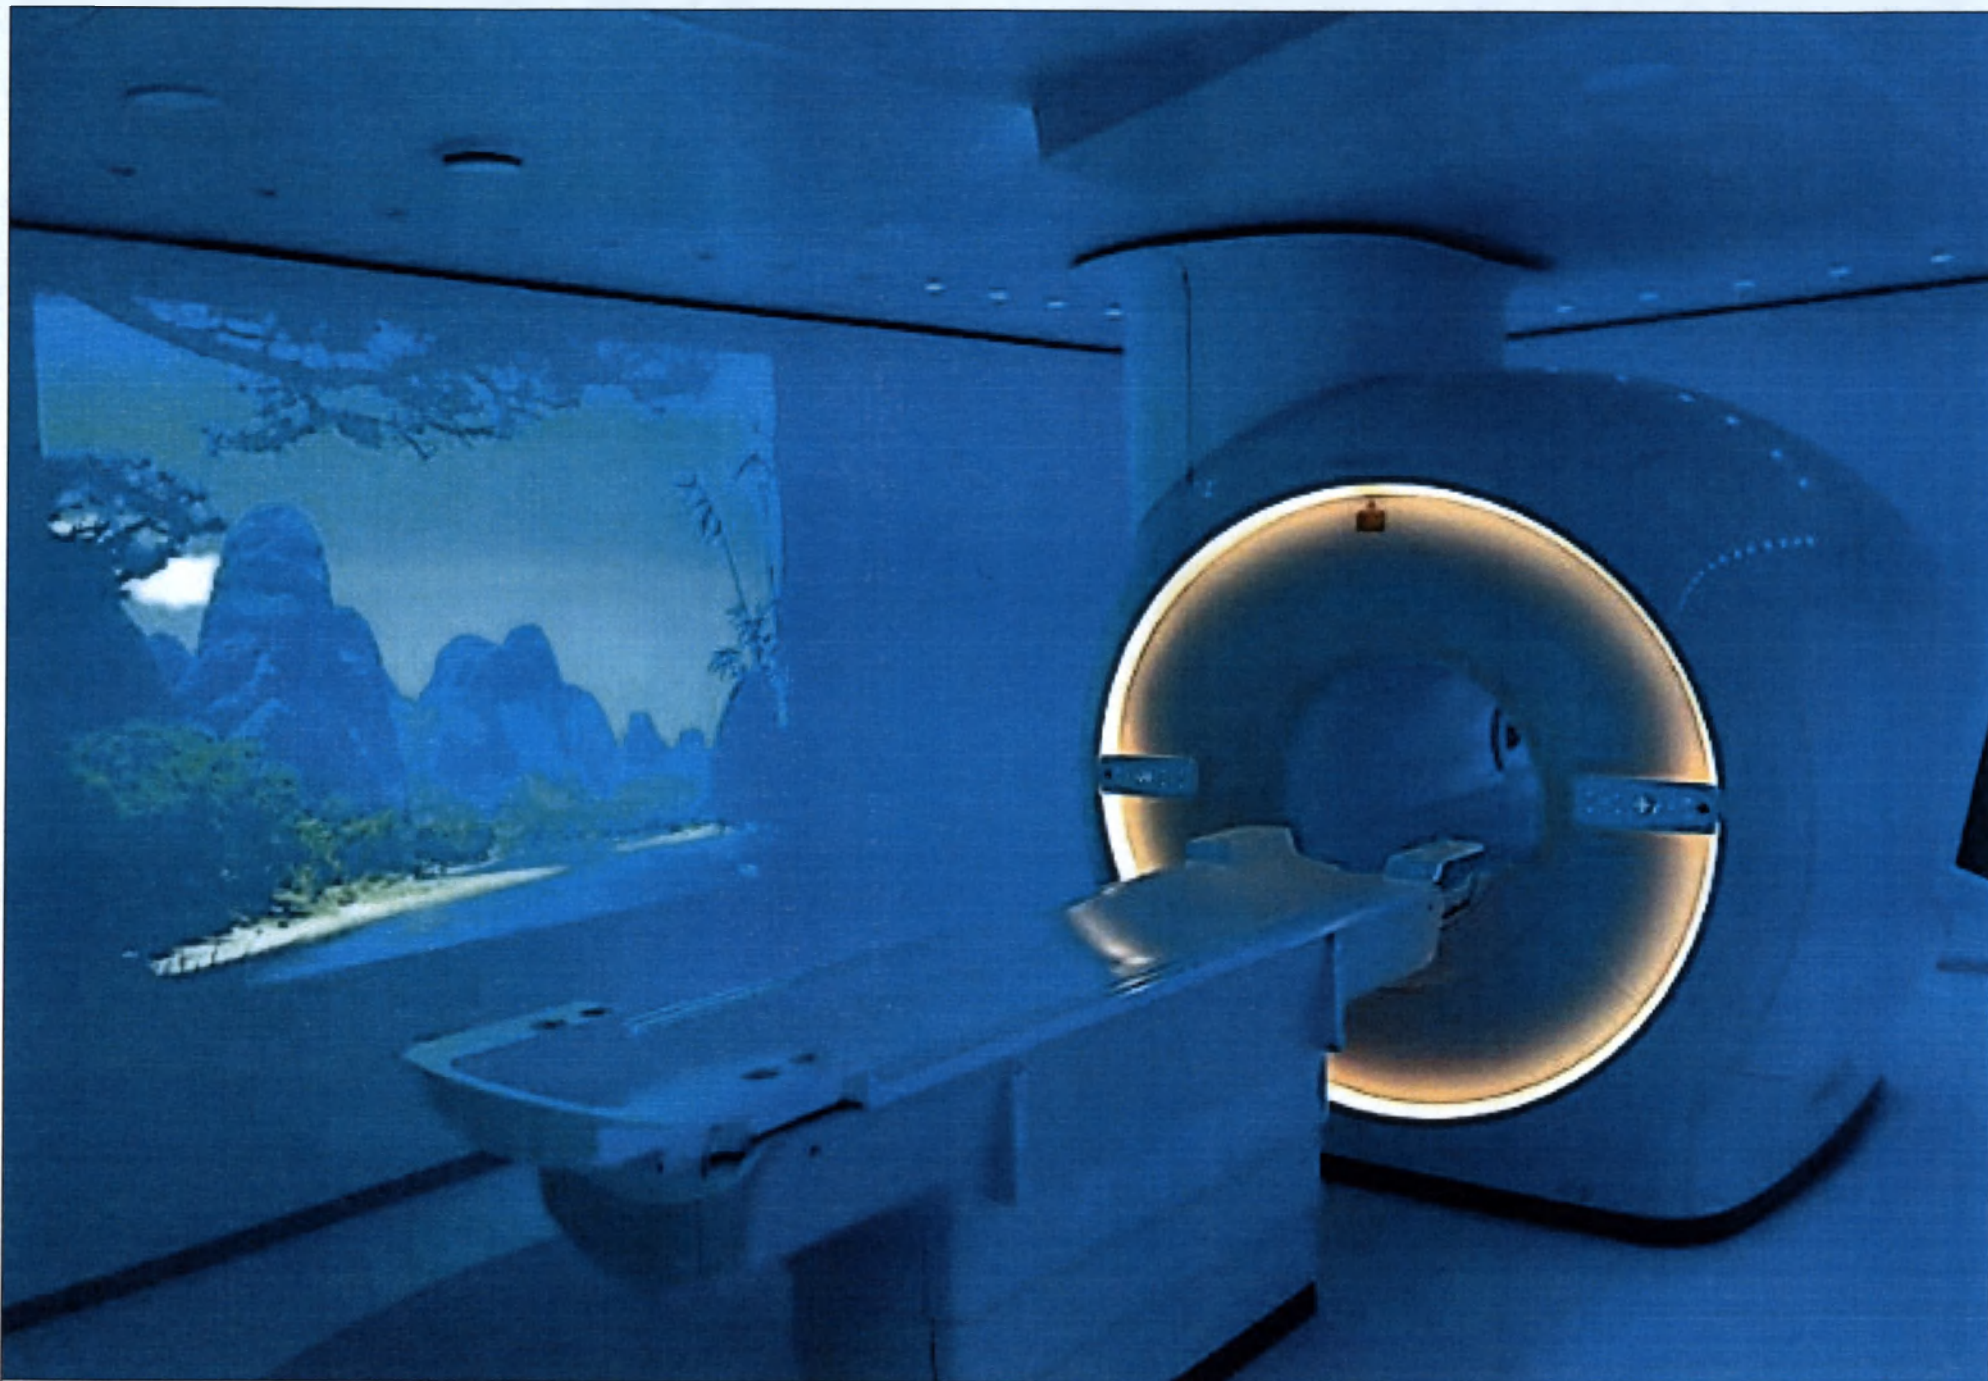

19b. Система звукового и видео-сопровождения Ambient Experience.



19с. Система звукового и видео-сопровождения *Ambient Experience*.

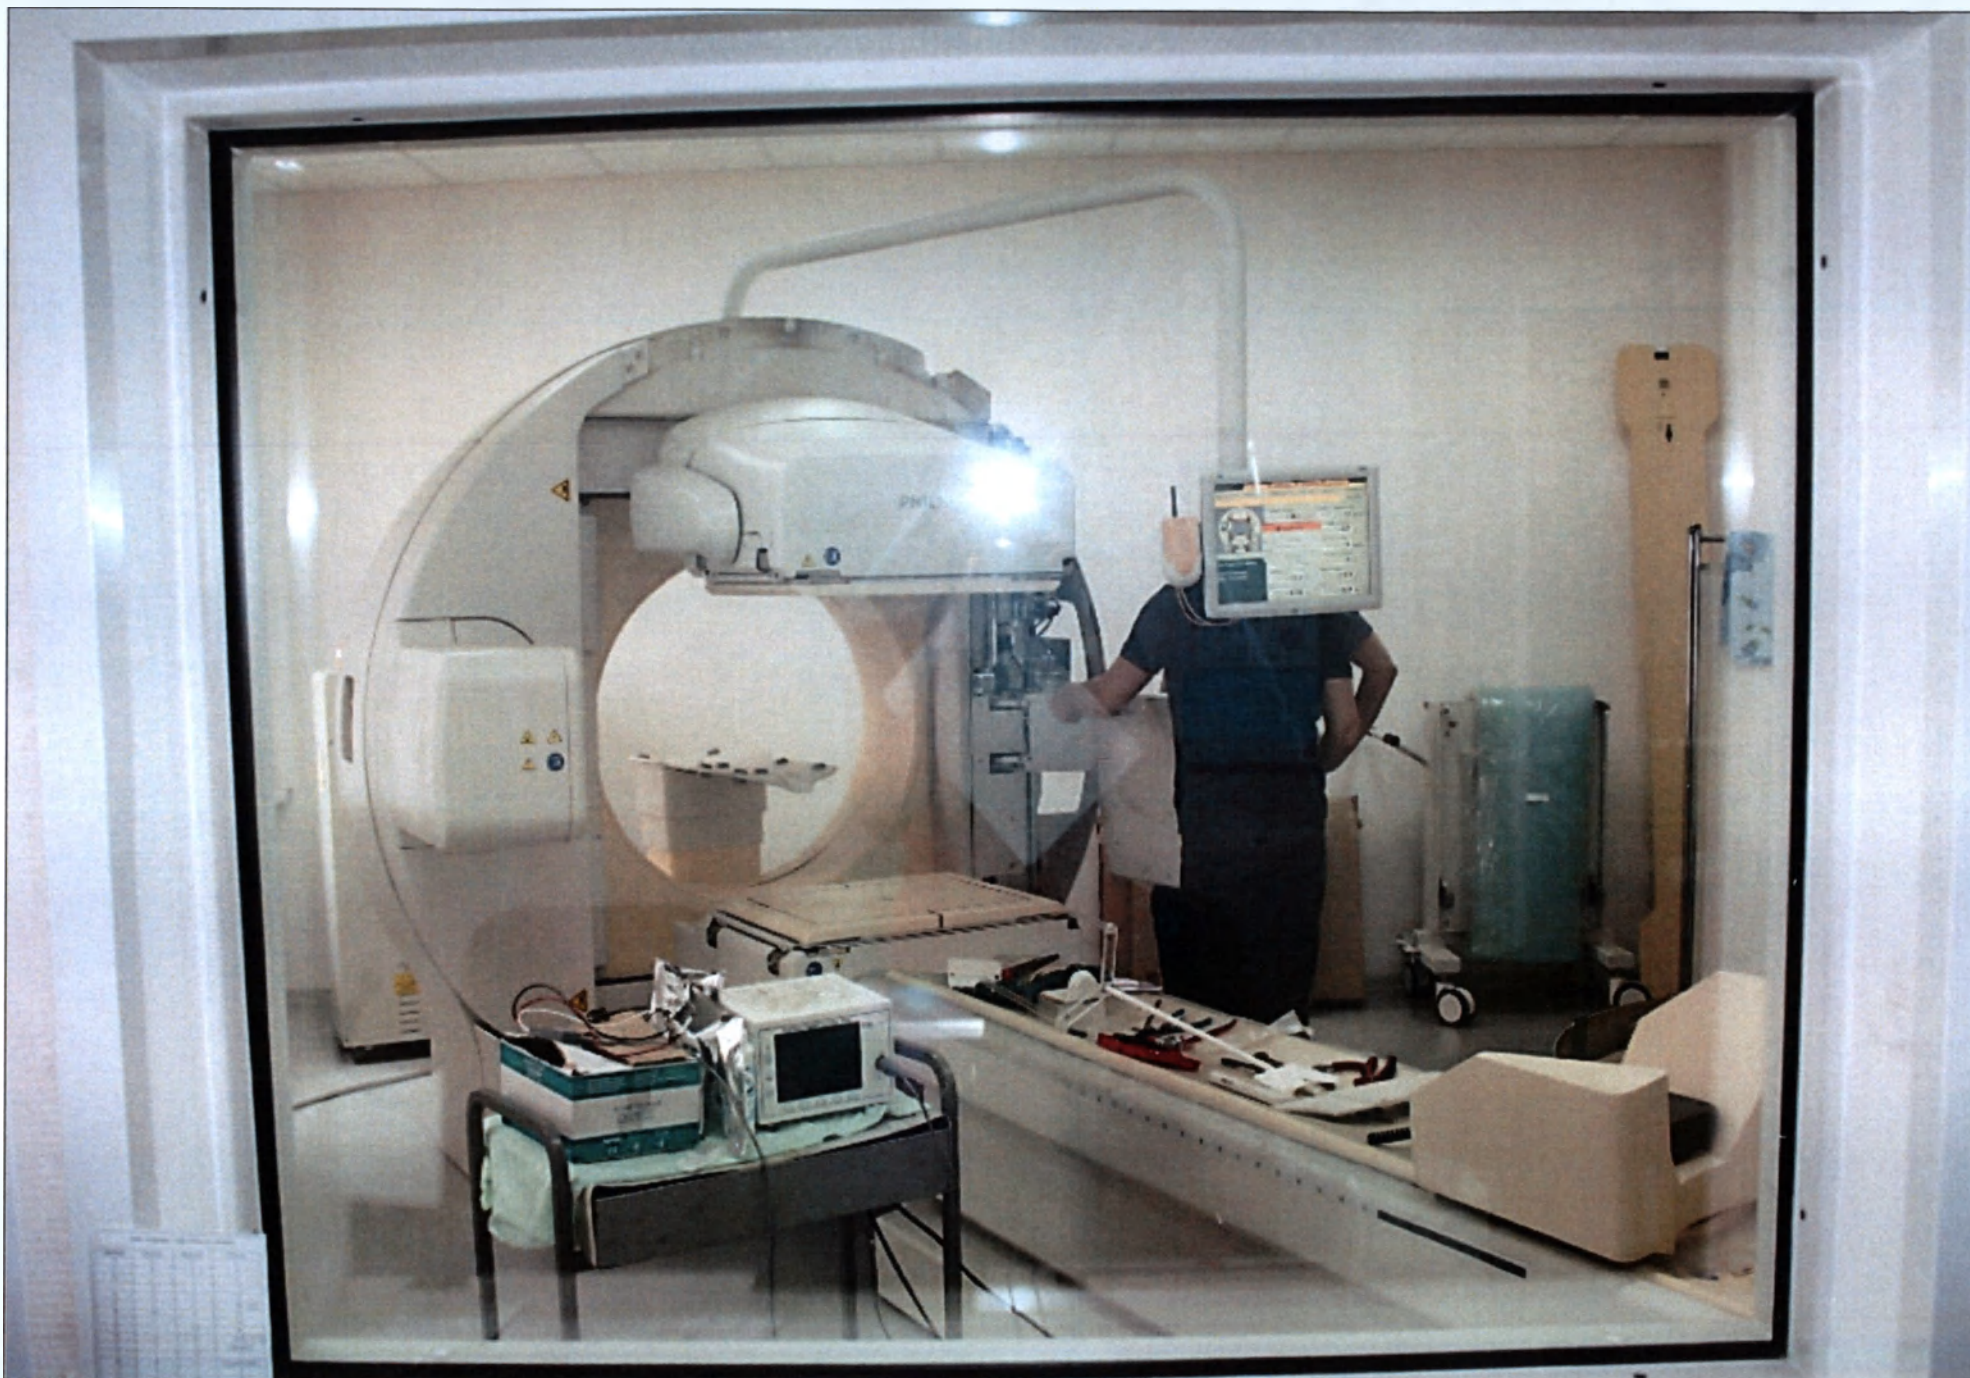

20а. Стекло рентгеназщитное просвинцованное.



20б. Стекло рентгенозащитное просвинцованное.

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
листа (ов) *102*

