

Фотографические изображения

Тест на мутации cobas PIK3CA Mutation Test для качественного обнаружения и идентификации 17 мутаций в экзонах 2, 5, 8, 10 и 21 гена каталитической субъединицы альфа фосфо-инозитид-3-киназы (PIK3CA) в ДНК методом ПЦР в реальном времени для использования в системе cobas 4800 для диагностики *in vitro*, в составе

Тест на мутации cobas PIK3CA Mutation Test для качественного обнаружения и идентификации 17 мутаций в экзонах 2, 5, 8, 10 и 21 гена каталитической субъединицы альфа фосфо-инозитид-3-киназы (PIK3CA) в ДНК методом ПЦР в реальном времени для использования в системе cobas 4800 для диагностики in vitro, в составе (общий вид)












Мастермикс РІКЗСА ММХ-2 во флаконе, объем 0,48 мл, 2 шт.

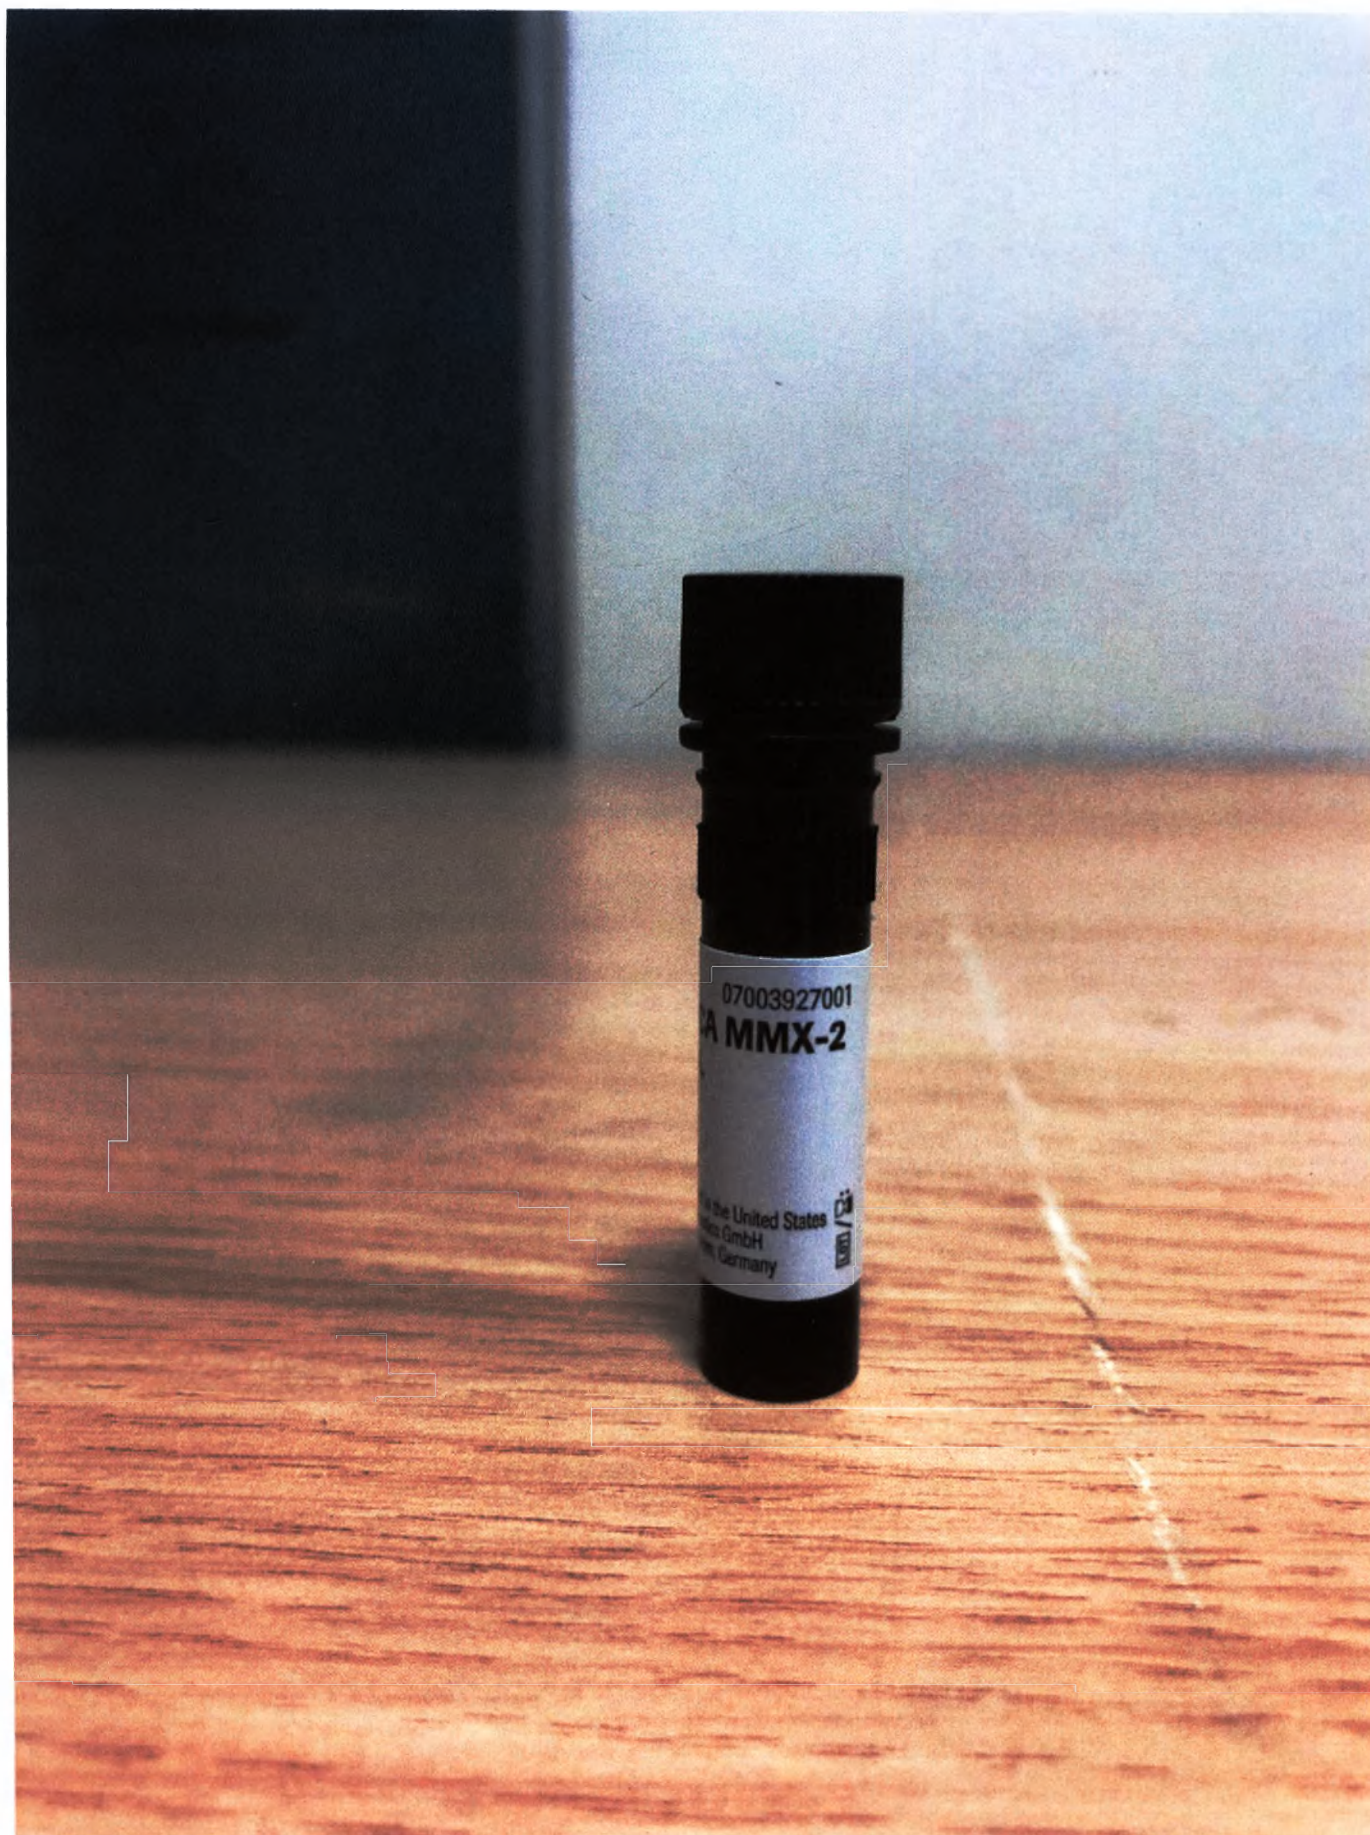

Мастермикс РІКЗСА ММХ-2 во флаконе, об'єм 0,48 мл, 2 шт.





Мастермикс РІКЗСА ММХ-3 во флаконе, объем 0,48 мл, 2 шт




Мастермикс РІКЗСА ММХ-3 во флаконе, объем 0,48 мл, 2 шт



Ацетат магния MGAC во флаконе, объем 0,20 мл, 6 шт.



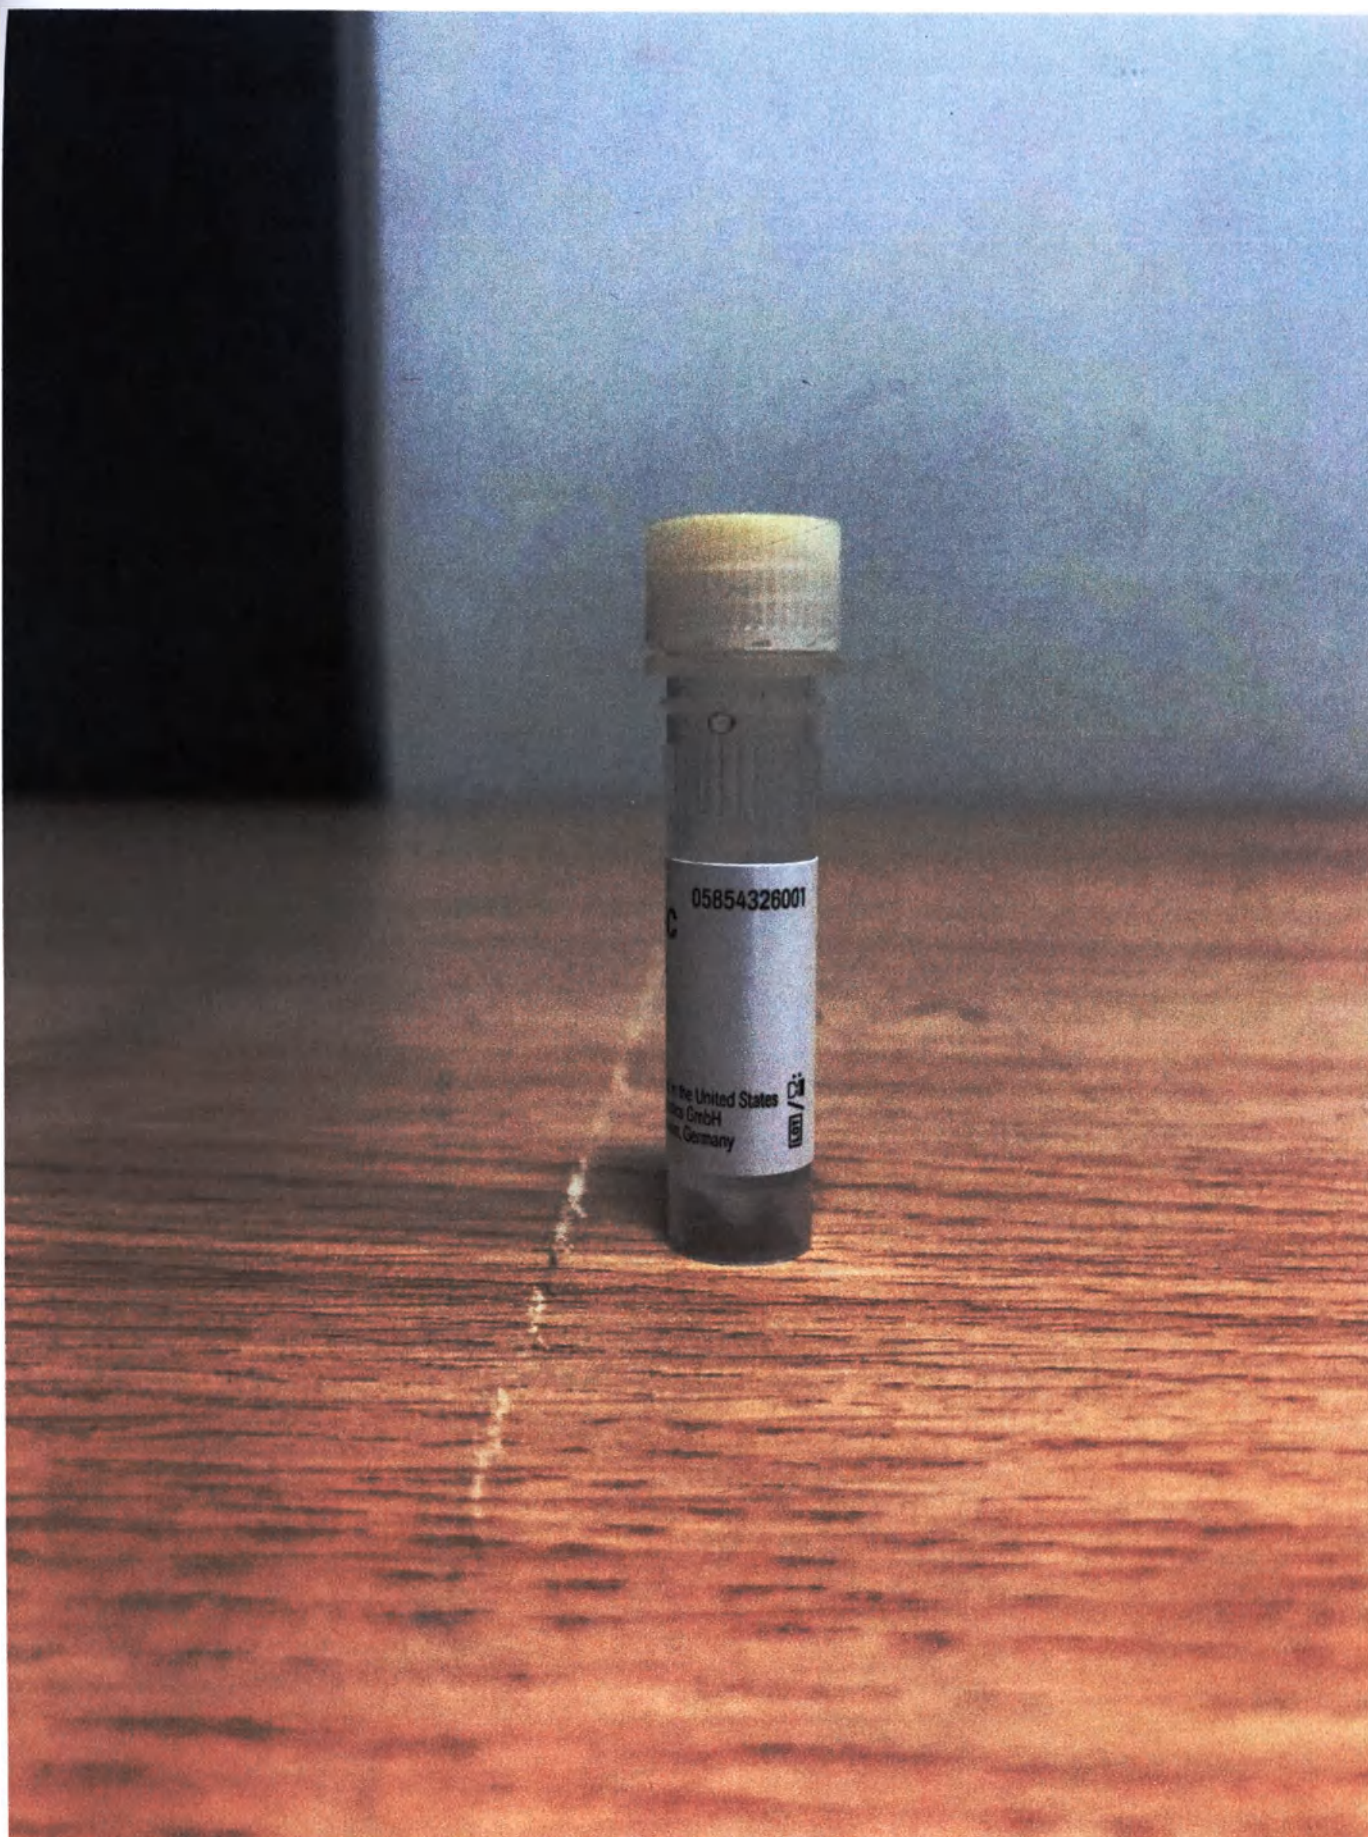


Ацетат магния МГАС во флаконе, объем 0,20 мл, 6 шт.




Мутантный контроль PIK3CA MC во флаконе, объем 0,10 мл, 6 шт.



Мутантный контроль РІКЗСА МС во флаконе, объем 0,10 мл, 6 шт.

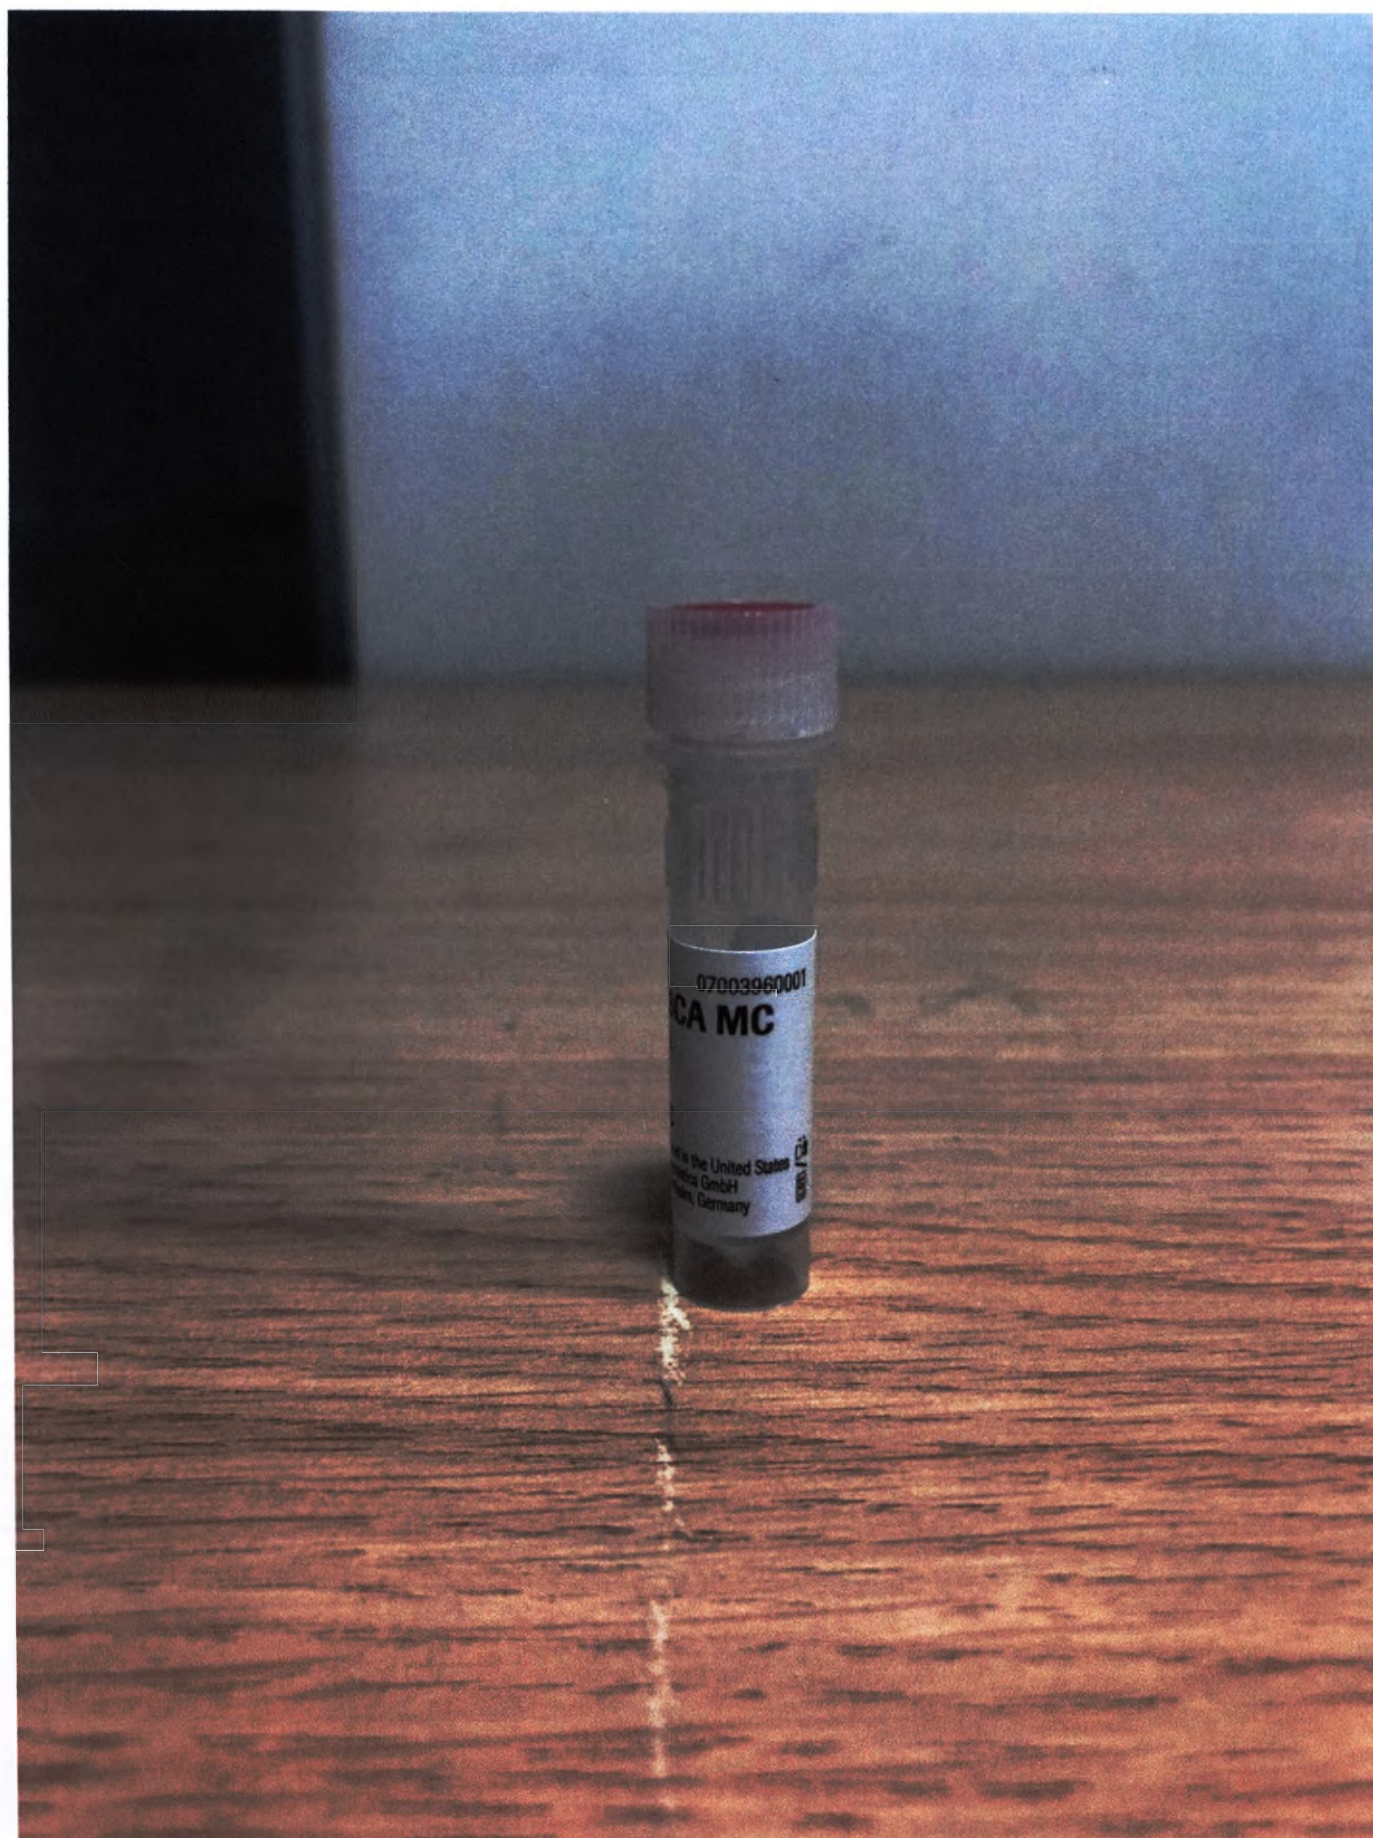

Мутантный контроль РИЗСА МС во флаконе, объем 0,10 мл, 6 шт.

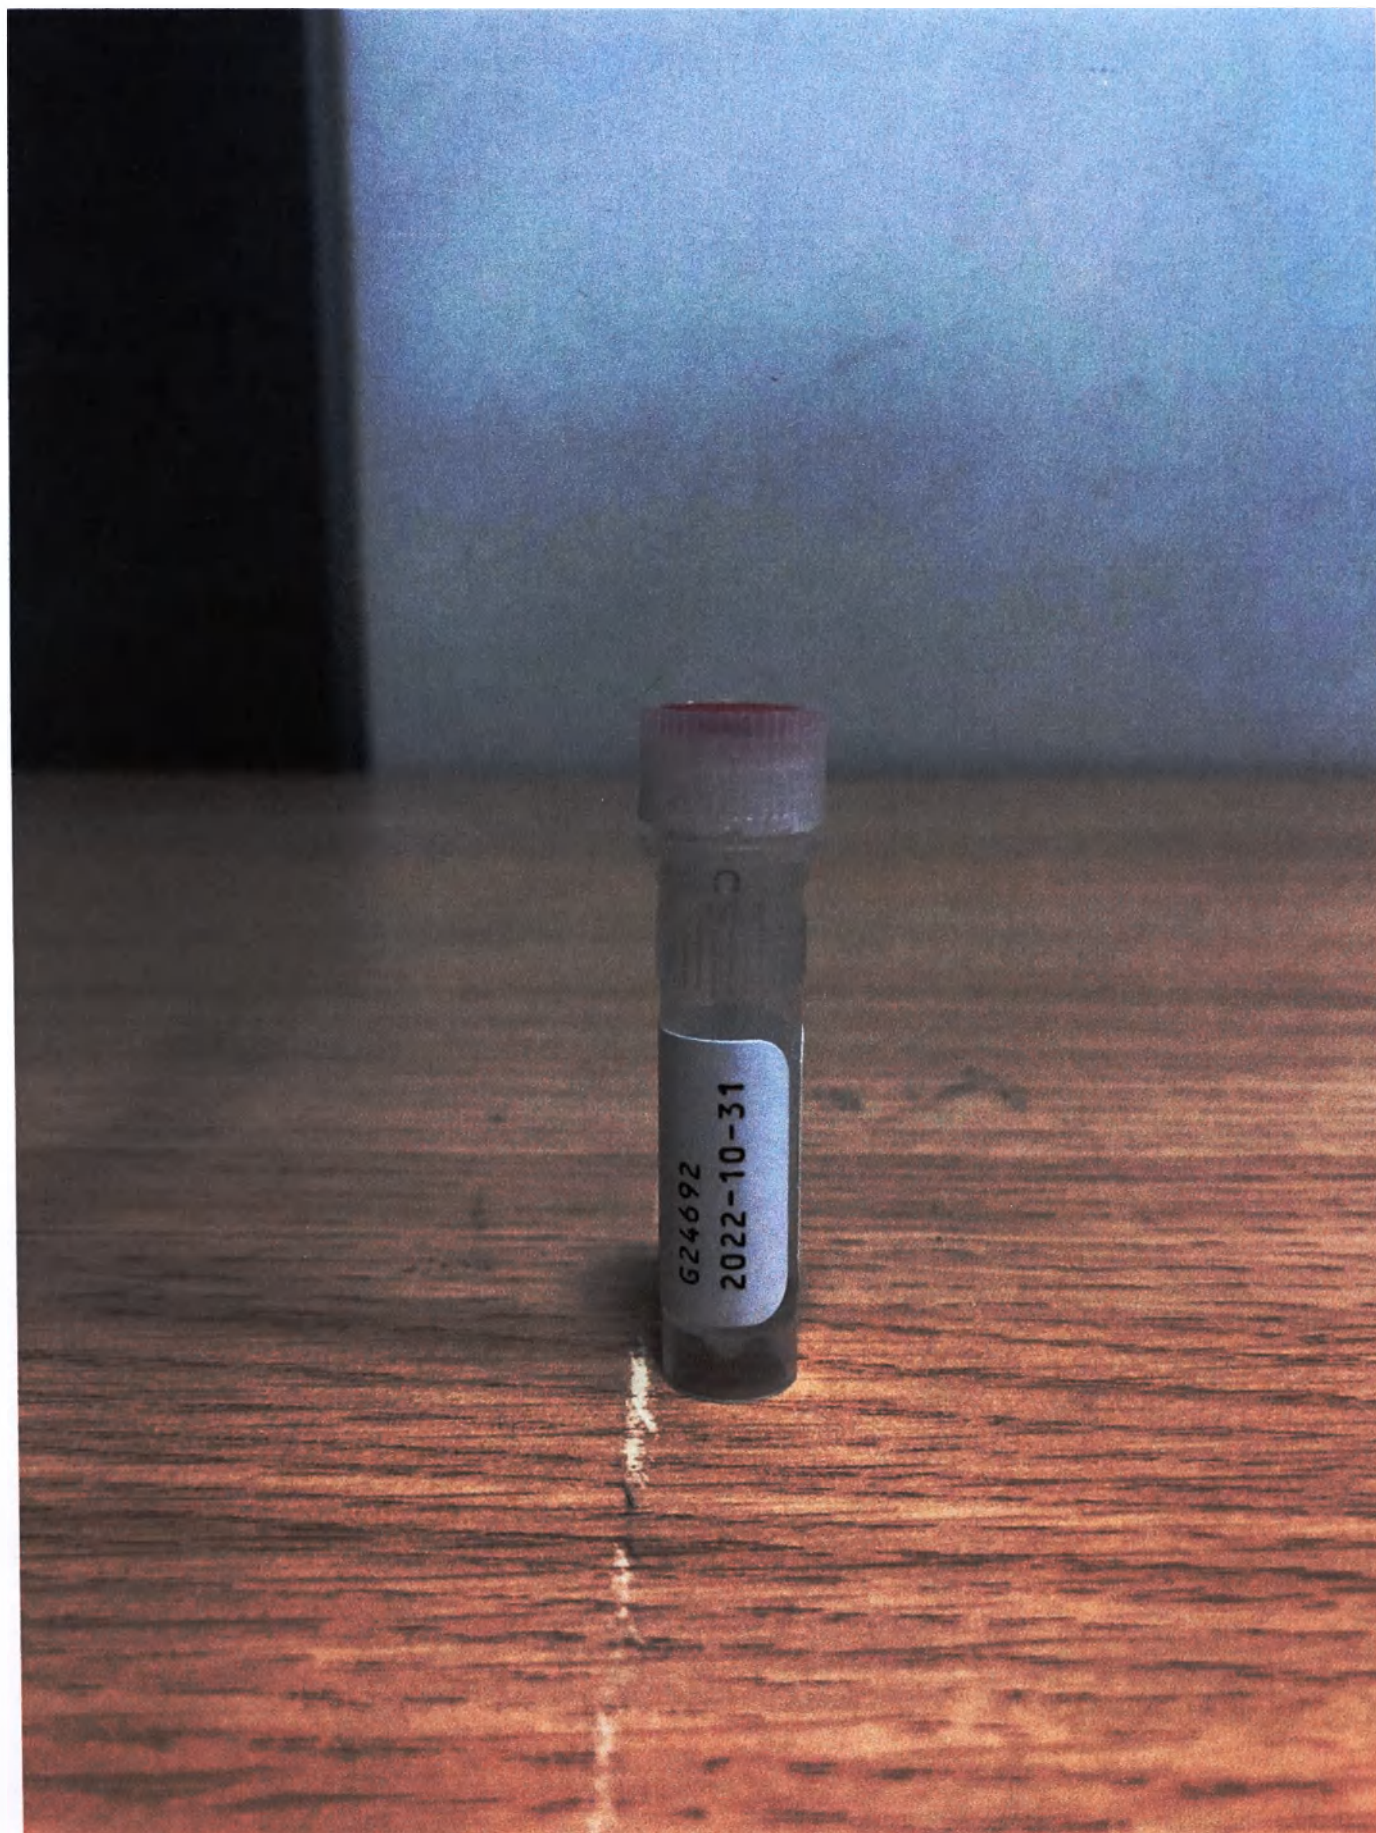

Дилуэнт для образцов ДНК (DNA SD) во флаконе, объем 3,5 мл, 2 шт.



Дилуэнт для образцов ДНК (DNA SD) во флаконе, объем 3,5 мл, 2 шт.



cobas® PIK3CA Mutation Test

PIK3CA

IVD

KIT **LOT** G24722

LOT

PIK3CA MMX-1	G24670
PIK3CA MMX-2	G24691
PIK3CA MMX-3	G24690
PIK3CA MC	G24692
MGAC	G25597
DNA SD	G25599



cobas® 4800 system
PIK3CA P1 Version 1.0 or higher
Assay Specific Analysis Package (ASAP)
cobas® 4800 system Application Software Version 2.2 or higher



FA1G247229M002E

Non-USA:



website: <http://e-labdoc.roche.com>
Method Sheet Catalog No.: 07003966190 Doc Rev. 1.0

Please contact your local Roche affiliate if you require a printed copy free of charge or need technical support to access the package insert. / Bei Ihrer zuständigen Roche-Vertretung erhalten Sie einen kostenfreien Ausdruck oder technische Unterstützung für den Zugriff auf die Packungsbeilage. / Veuillez contacter votre société Roche locale pour obtenir un exemplaire papier gratuit ou une assistance technique pour accéder à la notice. / Contattare il rappresentante Roche locale per ottenere gratuitamente una copia stampata o richiedere istruzioni per reperire il foglio illustrativo. / Póngase en contacto con su filial local de Roche si necesita una copia impresa gratuita o ayuda del servicio técnico para acceder al boletín técnico. / Se desejar uma cópia impressa gratuita ou necessitar de assistência técnica para aceder ao folheto informativo, entre em contacto com o representante local de Roche. / Kontakt den lokale Roche-representant, hvis du ønsker en gratis skriftlig kopi eller har brug for teknisk support for at få adgang til indlægssedlen. / Kontakta din Roche-representant om du vill ha en pappersversion kostnadsfritt eller om du behöver teknisk support för att komma åt bipacksedeln. / Aby otrzymać darmową drukowaną wersję lub jeśli zaistniały problemy techniczne z dostępem do ulotki dołączonej do opakowania, należy skontaktować się z miejscowym oddziałem firmy Roche. / Ak potrebujete bezplatnú vyšečenú kópiu alebo ak potrebujete technickú pomoc ohľadne prístupu k príbalovému letákom, obráťte sa na miestne zastúpenie spoločnosti Roche.


Manufactured in the United States



Roche Diagnostics GmbH
Bockleimer Strasse 110
68305 Mannheim, Germany

07003966190-02

cobas® PIK3CA Mutation Test



PIK3CA

cobas®

Тест на мутации cobas PIK3CA Mutation Test для качественного обнаружения и идентификации 17 мутаций в экзонах 2, 5, 8, 10 и 21 гена каталитической субъединицы альфа фосфо-инозитид-3-киназы (PIK3CA) в ДНК методом ПЦР в реальном времени для использования в системе cobas 4800 для диагностики in vitro, в составе (маркировка)

Cont.

PIK3CA MMX-1	2 x 0.48 mL
PIK3CA MMX-2	2 x 0.48 mL
PIK3CA MMX-3	2 x 0.48 mL
MGAC	6 x 0.20 mL
PIK3CA MC	6 x 0.10 mL
DNA SD	2 x 3.5 mL

Тест на мутации cobas PIK3CA Mutation Test для качественного обнаружения и идентификации 17 мутаций в экзонах 2, 5, 8, 10 и 21 гена каталитической субъединицы альфа фосфо-инозитид-3-киназы (PIK3CA) в ДНК методом ПЦР в реальном времени для использования в системе cobas 4800 для диагностики *in vitro*, в составе (маркировка)

cobas® PIK3CA Mutation Test

REF P/N: 07003986190

IVD

Σ 24

8°C
2°C

Rx Only

PIK3CA

cobas®

Тест на мутации cobas PIK3CA Mutation Test для качественного обнаружения и идентификации 17 мутаций в экзонах 2, 5, 8, 10 и 21 гена каталитической субъединицы альфа фосфо-инозитид-3-киназы (PIK3CA) в ДНК методом ПЦР в реальном времени для использования в системе cobas 4800 для диагностики in vitro, в составе (маркировка)

Manufactured in the United States



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany



Roche Diagnostics (Schweiz) AG
Industriestrasse 7
6343 Rotkreuz, Switzerland

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

Roche Diagnostics, SL
Avda. Generalitat, 171-173
E-08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona, Spain

Roche Diagnostics
201, boulevard Armand-Frappier
H7V 4A2 Laval, Québec, Canada
(For Technical Assistance call:
Pour toute assistance technique,
appeler le: 1-877-273-3433)

Roche Diagnostics
2, Avenue du Vercors
38240 Meylan, France

Distributore in Italia:
Roche Diagnostics S.p.A.
Viale G. B. Stucchi 110
20052 Monza, Milano, Italy

Distribuidor em Portugal:
Roche Sistemas de Diagnósticos Lda.
Estrada Nacional, 249-1
2720-413 Amadora, Portugal

Roche Diagnostica Brasil Ltda.
Av. Engenheiro Billings, 1729
Jaguari, Building 10
05321-010 São Paulo, SP Brazil

Roche Diagnostics
9115 Hague Road
Indianapolis, IN 46250-0457 USA
(For Technical Assistance call the
Roche Response Center
toll-free: 1-800-526-1247)

COBAS is a trademark of Roche. ©2017 Roche Molecular Systems, Inc.

Тест на мутации cobas PIK3CA Mutation Test для качественного обнаружения и идентификации 17 мутаций в экзонах 2, 5, 8, 10 и 21 гена каталитической субъединицы альфа фосфо-инозитид-3-киназы (PIK3CA) в ДНК методом ПЦР в реальном времени для использования в системе cobas 4800 для диагностики in vitro, в составе (маркировка)

Тест на мутации cobas PIK3CA Mutation Test для качественного обнаружения и идентификации 17 мутаций в экзонах 2, 5, 8, 10 и 21 гена каталитической субъединицы альфа фосфо-инозитид-3-киназы (PIK3CA) в ДНК методом ПЦР в реальном времени для использования в системе cobas 4800 для диагностики *in vitro*, в составе (маркировка)



07003978001-01

Тест на мутации cobas PIK3CA Mutation Test для качественного обнаружения и идентификации 17 мутаций в экзонах 2, 5, 8, 10 и 21 гена каталитической субъединицы альфа фосфо-инозитид-3-киназы (PIK3CA) в ДНК методом ПЦР в реальном времени для использования в системе cobas 4800 для диагностики in vitro, в составе (маркировка)

1. Мастермикс PIK3CA MMX-1 во флаконе, объем 0.48 мл, 2 шт.
2. Мастермикс PIK3CA MMX-2 во флаконе, объем 0.48 мл, 2 шт.
3. Мастермикс PIK3CA MMX-3 во флаконе, объем 0.48 мл, 2 шт.
4. Адаптер маркер MGAS во флаконе, объем 0.20 мл, 6 шт.
5. Мутационный контроль PIK3CA MC во флаконе, объем 0.10 мл, 6 шт.
6. ДНК-экстракт для образца ДНК (DNA SO) во флаконе, объем 3.0 мл, 2 шт.
7. Информационный картончик, 1 шт.

Регистрационный номер: 07003978001-01

Каталожный номер: 07003978001

Срок годности см. на упаковке. Дату производства см. на упаковке

Температуру хранения см. на упаковке. Номер лота см. на упаковке

Производитель: Roche Diagnostics GmbH, Bendorfer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany

Модель: предназначена только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «РосДиагностика Рус» (ООО «РосДиагностика Рус») Адрес: 107031, Москва,

Трубинная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-66, факс: +7 495 229-62-64

E-mail: marketing_ru@roche.com

Ссылка для получения инструкции по использованию: www.roche.com



Тест на мутации cobas PIK3CA Mutation Test для качественного обнаружения и идентификации 17 мутаций в экзонах 2, 5, 8, 10 и 21 гена каталитической субъединицы альфа фосфо-инозитид-3-киназы (PIK3CA) в ДНК методом ПЦР в реальном времени для использования в системе cobas 4800 для диагностики in vitro, в составе (маркировка)

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

25 листа (ов)

по доверенности
от 04.02.2021

(Ермишко, Д.В.)

