

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
А.Г.Плехов



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набор реагентов для определения концентрации альбумина
в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом
с бромкрезоловым зеленым
«АЛЬБУМИН-ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-089-94568735-2021**

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.102

Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым



Реагент №1: 2 x 50 мл
Калибратор: 1 x 1,0 мл

ТУ 21.20.23-089-94568735-2021
РЗН 2021/15947 от 07.12.2021

LOT Серия: 0346 Дата выпуска: 2023.06 Годен до: 2025.06
только для in vitro диагностики
UK ALBUMIN-VITAL R1: 2 x 50 ml Calibrator: 1 x 1,0 ml
Vital Development Corporation
Дорога в Каменку, дом 56, литера А
St. Petersburg, Russia
LOT 0346 2025.06

KZ АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-089-94568735-2021
07.12.2021 ж. РЗН 2021/15947

Қан сарысуында (плазмада) альбуминнің концентрациясын унификацияланған колориметриялық әдіспен анықтауға арналған бромкрезолды жасыл бар реагенттер жинағы

Реагент №1 : 2 x 50 мл
Калибратор: 1 x 1,0 мл

Сериясы: 0346
Шығарылған күні: 2023.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

Vital Development Corporation
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А



21322108270327

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.102
REF B 21.12

РЕАГЕНТ 1

50 мл
монореагент
LOT 0346



Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.102
REF B 21.12

РЕАГЕНТ 1

50 мл
монореагент
LOT 0346



Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

1,0 мл

60 г/л

LOT 0347



Годен до: 2025.12
Дейн жарамды: 2025.12


только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.02

Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым



Реагент №1: 2 x 100 мл
Калибратор: 2 x 1,0 мл

ТУ 21.20.23-089-94568735-2021
РЗН 2021/15947 от 07.12.2021

LOT Серия: 0346



Дата выпуска: 2023.06



Годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 55, литера А

UK ALBUMIN-VITAL

R1: 2 x 100 ml

Calibrator: 2 x 1,0 ml

LOT 0346



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 55 A 194356
St. Petersburg, Russia

IVD

2025.06

ECIREP

EVERGO EUROPE
Pharmaceutical 20 2514 AP
The Hague, The Netherlands

KZ АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-089-94568735-2021
07.12.2021 ж. РЗН 2021/15947


Қан сарысуында (плазмада) альбуминнің концентрациясын унификацияланған колориметриялық әдіспен анықтауға арналған бромкрезолды жасыл бар реагенттер жинағы

Реагент №1 : 2 x 100 мл
Калибратор: 2 x 1,0 мл

Сериясы: 0346
Шығарылған күні: 2023.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", АО "Витал"
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 55, литера А



21022306440346

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.02

РЕАГЕНТ 1

100 мл

монореагент

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики



CE



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.02

РЕАГЕНТ 1

100 мл

монореагент

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики



CE



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

1,0 мл
60 г/л

LOT 0347

Годен до: 2025.12
Дейн жарамды: 2025.12

только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики



CE



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

1,0 мл
60 г/л

LOT 0347

Годен до: 2025.12
Дейн жарамды: 2025.12

только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики




CE



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.12

Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым



Реагент №1: 5 x 50 мл
Калибратор: 1 x 1,0 мл

ТУ 21.20.23-089-94568735-2021
РЗН 2021/15947 от 07.12.2021

LOT Серия: 0346



Дата выпуска: 2023.06



Годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK ALBUMIN-VITAL

R1: 5 x 50 ml

Calibrator: 1 x 1,0 ml

LOT 0346



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenskuyu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

2025.06

IVD

K2 АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-089-94568735-2021
07.12.2021 ж. РЗН 2021/15947

Қан сарысуында (плазмада) альбуминнің концентрациясын унификацияланған колориметриялық әдіспен анықтауға арналған бромкрезолды жасыл бар реагенттер жинағы

Реагент №1 . 5 x 50 мл
Калибратор: 1 x 1,0 мл

Сериясы: 0346
Шығарылған күні: 2023.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АО Россия,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А



21122108270327

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
REF B 21.102
REF B 21.12
50 мл
монореагент
LOT 0346
Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06
только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики үшін
Vital Development

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
REF B 21.102
REF B 21.12
50 мл
монореагент
LOT 0346
Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06
только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики үшін
Vital Development

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
REF B 21.102
REF B 21.12
50 мл
монореагент
LOT 0346
Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06
только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики үшін
Vital Development

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
REF B 21.102
REF B 21.12
50 мл
монореагент
LOT 0346
Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06
только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики үшін
Vital Development

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
REF B 21.102
REF B 21.12
50 мл
монореагент
LOT 0346
Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06
только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики үшін
Vital Development

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
1,0 мл
60 г/л
LOT 0347
Годен до: 2025.12
Дейн жарамды: 2025.12
только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики үшін
Vital Development

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.22

Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым



Реагент №1: 5 x 100 мл
Калибратор: 3 x 1,0 мл

ТУ 21.20.23-089-84568735-2021
РЗН 2021/15947 от 07.12.2021

LOT Серия: 0346



Дата выпуска: 2023.06



Годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 58, литера А

UK ALBUMIN-VITAL

LOT 0346



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuk, 58 A, 194356
St. Petersburg, Russia

R1: 5 x 100 ml

Calibrator: 3 x 1,0 ml

IVD

2025.06

KZ АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

ТШ 21.20.23-089-84568735-2021
07.12.2021 ж. РЗН 2021/15947

Қан сарысуында (плазмада) альбуминнің концентрациясын унификацияланған колориметриялық әдіспен анықтауға арналған бромкрезолды жасыл бар реагенттер жинағы

Реагент №1 : 5 x 100 мл
Калибратор: 3 x 1,0 мл

Сериясы: 0346

Шығарылған күні: 2023.06

Дейін жарамды: 2025.06

Тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 58, литера А



21222108270327

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.22

100 мл

монореагент

LOT 0346

2°C 8°C

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.22

100 мл

монореагент

LOT 0346

2°C 8°C

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.22

100 мл

монореагент

LOT 0346

2°C 8°C

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.22

100 мл

монореагент

LOT 0346

2°C 8°C

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.22

100 мл

монореагент

LOT 0346

2°C 8°C

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

1,0 мл

60 г/л

LOT 0347

2°C 8°C

Годен до: 2025.12
Дейін жарамды: 2025.12

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

1,0 мл

60 г/л

LOT 0347

2°C 8°C

Годен до: 2025.12
Дейін жарамды: 2025.12

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

1,0 мл

60 г/л

LOT 0347

2°C 8°C

Годен до: 2025.12
Дейін жарамды: 2025.12

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



REF B 21.72-1.150

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым

Реагент №1: 4 x 36 мл
Калибратор: 2 x 1,0 мл

ТУ 21.20.23-089-94568735-2021
РЗН 2021/15947 от 07.12.2021

LOT Серия: 0346 Дата выпуска: 2023.06 Годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия 194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, д. 56, лит. А

UK ALBUMIN-VITAL

R1: 4 x 36 ml
Calibrator: 2 x 1,0 ml

LOT 0346

IVD 2025.06

KZ АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-089-94568735-2021
07.12.2021 ж. РЗН 2021/15947

Қан сарысуында (плазмада) альбуминнің концентрациясын унификацияланған колориметриялық әдіспен анықтауға арналған бромкрезолды жасыл бар реагенттер жинағы

Реагент №1 : 4 x 36 мл
Калибратор: 2 x 1,0 мл

Сериясы: 0346
Шығарылған күні: 2023.06
Дейін жарамды: 2025.06

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
д. 56, лит. А



80022008020185

КАЛИБРАТОР АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

1,0 мл
60 г/л

LOT 0347

Годен до: 2025.12
Дейін жарамды: 2025.12

только для in vitro диагностики тек in vitro диагностикасы үшін



КАЛИБРАТОР АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

1,0 мл
60 г/л

LOT 0347

Годен до: 2025.12
Дейін жарамды: 2025.12

только для in vitro диагностики тек in vitro диагностикасы үшін



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.72-1.150

РЕАГЕНТ 1

36 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.72-1.150

РЕАГЕНТ 1

36 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.72-1.150

РЕАГЕНТ 1

36 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.72-1.150

РЕАГЕНТ 1

36 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

REF B 21.712-1.150

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым

Реагент №1: 8 x 36 мл
Калибратор: 3 x 1,0 мл

ТУ 21.20.23-089-94568735-2021
РЗН 2021/15947 от 07.12.2021

LOT Серия: 0346 Дата выпуска: 2023.06 Годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
д. 56, лит. А

UK ALBUMIN-VITAL

R1: 8 x 36 ml
Calibrator: 3 x 1,0 ml

LOT 0346

IVD 2025.06

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenku 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

KZ АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-089-94568735-2021
07.12.2021 ж. РЗН 2021/15947

Қан сарысуында (плазмада) альбуминнің концентрациясын унификацияланған колориметриялық әдіспен анықтауға арналған бромкрезолды жасыл бар реагенттер жинағы

Реагент №1 : 8 x 36 мл
Калибратор: 3 x 1,0 мл

Сериясы: 0346
Шығарылған күні: 2023.06
Дейін жарамды: 2025.06

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
56-й, лит. А



80022008020185

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.712-1.150

РЕАГЕНТ 1

36 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.712-1.150

РЕАГЕНТ 1

36 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.712-1.150

РЕАГЕНТ 1

36 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.712-1.150

КАЛИБРАТОР

1,0 мл

60 г/л

LOT 0347

Годен до: 2025.12
Дейін жарамды: 2025.12

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.712-1.150

РЕАГЕНТ 1

36 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.712-1.150

РЕАГЕНТ 1

36 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



REF B 21.72-1.200

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым

Реагент №1: 6 x 18 мл
Калибратор: 2 x 1,0 мл

ТУ 21.20.23-089-94568735-2021
РЗН 2021/15947 от 07.12.2021

LOT

Серия: 0346



Дата выпуска: 2023.06



Годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
д. 56, лит. А

UK ALBUMIN-VITAL

R1: 6 x 18 мл

Calibrator: 2 x 1,0 ml

LOT

0346

IVD

2025.06

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenku 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

KZ АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-089-94568735-2021
07.12.2021 ж. РЗН 2021/15947

Қан сарысуында (плазмада) альбуминнің концентрациясын унификацияланған колориметриялық әдіспен анықтауға арналған бромкрезолды жасыл бар реагенттер жинағы

Реагент №1 : 6 x 18 мл
Калибратор: 2 x 1,0 мл

Сериясы: 0346
Шығарылған күні: 2023.06
Дейін жарамды: 2025.06

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
д. 56, лит. А



80022008020185

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

18 мл

REF B 21.72-1.200

LOT

0346

Годен до: 2025.06

Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

18 мл

REF B 21.72-1.200

LOT

0346

Годен до: 2025.06

Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

18 мл

REF B 21.72-1.200

LOT

0346

Годен до: 2025.06

Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

18 мл

REF B 21.72-1.200

LOT

0346

Годен до: 2025.06

Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

18 мл

REF B 21.72-1.200

LOT

0346

Годен до: 2025.06

Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

18 мл

REF B 21.72-1.200

LOT

0346

Годен до: 2025.06

Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР

1,0 мл

60 г/л

LOT

0347

Годен до: 2025.12

Дейін жарамды: 2025.12

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР

1,0 мл

60 г/л

LOT

0347

Годен до: 2025.12

Дейін жарамды: 2025.12

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін



REF В 21.712-1.200

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым

Реагент №1: 12 x 18 мл
Калибратор: 3 x 1,0 мл

ТУ 21.20.23-089-84568736-2021
РЗН 2021/15947 от 07.12.2021

LOT Серия: 0346 Дата выпуска: 2023.06 Годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194366 Санкт-Петербург, Дорога в Канони, А. 55, лит. А

UK ALBUMIN-VITAL

R1: 12 x 18 ml
Calibrator: 3 x 1,0 ml

LOT 0346

IVD

2023.06

KZ АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-089-84568736-2021
07.12.2021 г. РЗН 2021/15947

Қан сарысуында (плазмада) альбуминнің концентрациясын унификацияланған колориметриялық әдіспен анықтауға арналған бромкрезолды жасыл бар реагенттер жинағы

Реагент №1: 12 x 18 мл
Калибратор: 3 x 1,0 мл

Сертификат: 0346
Шығарылған күні: 2023.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия



80022008020165

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1 18 МЛ REF В 21.712-1.200

LOT 0346

годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1 18 МЛ REF В 21.712-1.200

LOT 0346

годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1 18 МЛ REF В 21.712-1.200

LOT 0346

годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1 18 МЛ REF В 21.712-1.200

LOT 0346

годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1 18 МЛ REF В 21.712-1.200

LOT 0346

годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1 18 МЛ REF В 21.712-1.200

LOT 0346

годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1 18 МЛ REF В 21.712-1.200

LOT 0346

годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1 18 МЛ REF В 21.712-1.200

LOT 0346

годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1 18 МЛ REF В 21.712-1.200

LOT 0346

годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1 **18 мл** REF В 21.712-1.200
 LOT 0346
 Годен до: 2025.06
 Дейн жарамды: 2025.06
 только для in vitro диагностики
 Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
 "Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1 **18 мл** REF В 21.712-1.200
 LOT 0346
 Годен до: 2025.06
 Дейн жарамды: 2025.06
 только для in vitro диагностики
 Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
 "Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1 **18 мл** REF В 21.712-1.200
 LOT 0346
 Годен до: 2025.06
 Дейн жарамды: 2025.06
 только для in vitro диагностики
 Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
 "Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР **1,0 мл**
60 г/л
 LOT 0347
 Годен до: 2025.12
 Дейн жарамды: 2025.12
 только для in vitro диагностики
 Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
 "Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР **1,0 мл**
60 г/л
 LOT 0347
 Годен до: 2025.12
 Дейн жарамды: 2025.12
 только для in vitro диагностики
 Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
 "Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР **1,0 мл**
60 г/л
 LOT 0347
 Годен до: 2025.12
 Дейн жарамды: 2025.12
 только для in vitro диагностики
 Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
 "Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

REF B 21.72-1.300

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым

Реагент №1: 4 x 45 мл
Калибратор: 2 x 1,0 мл

Серия: 0346
Дата выпуска: 2023.06
Годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, д. 56, лит. А

UK ALBUMIN-VITAL

R1: 4 x 45 ml
Calibrator: 2 x 1,0 ml

IVD 2025.06

KZ АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

ТШ 21.20.23-089-94568735-2021
07.12.2021 ж. РЗН 2021/15947

Қан сарысуында (плазмада) альбуминнің концентрациясын унификацияланған колориметриялық әдіспен анықтауға арналған бромкрезолды жасыл бар реагенттер жинағы

Реагент №1 : 4 x 45 мл
Калибратор: 2 x 1,0 мл

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
56-й лит. А



80022008020185

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

REF B 21.72-1.300

45 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейин жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

REF B 21.72-1.300

45 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейин жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР

1,0 мл

60 г/л

LOT 0347

Годен до: 2025.12
Дейин жарамды: 2025.12

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР

1,0 мл

60 г/л

LOT 0347

Годен до: 2025.12
Дейин жарамды: 2025.12


только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

REF B 21.712-1.300

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым



Реагент №1: 8 x 45 мл
Калибратор: 3 x 1,0 мл

ТУ 21.20.23-089-04568736-2021
РЗН 2021/15947 от 07.12.2021

LOT Серия: 0346



Дата выпуска: 2023.06



Годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каневку,
д. 58, лит. А

UK ALBUMIN-VITAL

R1: 8 x 45 ml
Calibrator: 3 x 1,0 ml

LOT 0346



2025.06

K2 АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-089-04568736-2021
07.12.2021 г. РЗН 2021/15947

Қан сарысуында (плазмада) альбуминнің концентрациясын унификацияланған колориметриялық әдіспен анықтауға арналған бромкрезолды жасыл бар реагенттер жиыны

Реагент №1 : 8 x 45 мл
Калибратор: 3 x 1,0 мл

Сериялы: 0346
Шығарылған күні: 2023.06
Дейін жарамды: 2025.06

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Ресей
Санкт-Петербург, Дорога в Каневку, д. 58, лит. А



80022008020185

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

REF B 21.712-1.300

45 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Ресей



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

REF B 21.712-1.300

45 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Ресей



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

REF B 21.712-1.300

45 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Ресей



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

REF B 21.712-1.300

45 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Ресей



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

REF B 21.712-1.300

45 мл


LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Ресей



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

REF B 21.712-1.300

45 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Ресей



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

[REF] В 21.712-1.300

РЕАГЕНТ 1

45 мл

[LOT] 0346

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

[REF] В 21.712-1.300

РЕАГЕНТ 1

45 мл

[LOT] 0346

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

1,0 мл

60 г/л

[LOT] 0347

Годен до: 2025.12
Дейн жарамды: 2025.12

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

1,0 мл

60 г/л

[LOT] 0347

Годен до: 2025.12
Дейн жарамды: 2025.12

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

1,0 мл

60 г/л

[LOT] 0347

Годен до: 2025.12
Дейн жарамды: 2025.12

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



REF B 21.72-1.420

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым

Реагент №1: 3 x 65 мл
Калибратор: 2 x 1,0 мл

ТУ 21.20.23-089-94568735-2021
РЗН 2021/15947 от 07.12.2021

LOT Серия: 0346

Дата выпуска: 2023.06

Годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
д. 56, лит. А

UK ALBUMIN-VITAL

R1: 3 x 65 ml
Calibrator: 2 x 1,0 ml

LOT 0346

IVD

2025.06

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

K2 АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-089-94568735-2021
07.12.2021 ж. РЗН 2021/15947

Қан сарысуында (плазмада) альбуминнің концентрациясын унификацияланған колориметриялық әдіспен анықтауға арналған бромкрезолды жасыл бар реагенттер жинағы

Реагент №1 : 3 x 65 мл
Калибратор: 2 x 1,0 мл

Сериясы: 0346
Шығарылған күні: 2023.06
Дейін жарамды: 2025.06

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
д. 56, лит. А



80022008020185

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.72-1.420

РЕАГЕНТ 1

65 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.72-1.420

РЕАГЕНТ 1

65 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.72-1.420

РЕАГЕНТ 1

65 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

1,0 мл

60 г/л

LOT 0347

Годен до: 2025.12
Дейін жарамды: 2025.12

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

1,0 мл

60 г/л

LOT 0347

Годен до: 2025.12
Дейін жарамды: 2025.12

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



REF B 21.712-1.420

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым

Реагент №1: 6 x 65 мл
Калибратор: 3 x 1,0 мл

ТУ 21.20.23-089-94568735-2021
РЗН 2021/15947 от 07.12.2021

LOT Серия: 0346



Дата выпуска: 2023.06



Годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
д. 56, лит. А

UK ALBUMIN-VITAL

R1: 6 x 65 ml

Calibrator: 3 x 1,0 ml

LOT 0346

IVD

2025.06

KZ АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-089-94568735-2021
07.12.2021 ж. РЗН 2021/15947

Қан сарысуында (плазмада) альбуминнің концентрациясын унификацияланған колориметриялық әдіспен анықтауға арналған бромкрезолды жасыл бар реагенттер жинағы

Реагент №1 : 6 x 65 мл
Калибратор: 3 x 1,0 мл

Сериясы: 0346
Шығарылған күні: 2023.06
Дейін жарамды: 2025.06

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
д. 56, лит. А



80022008020185

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.712-1.420

РЕАГЕНТ 1

65 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.712-1.420

РЕАГЕНТ 1

65 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.712-1.420

РЕАГЕНТ 1

65 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.712-1.420

РЕАГЕНТ 1

65 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

1,0 мл

60 г/л

LOT 0347

Годен до: 2025.12
Дейн жарамды: 2025.12

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

1,0 мл

60 г/л

LOT 0347

Годен до: 2025.12
Дейн жарамды: 2025.12

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

1,0 мл

60 г/л

LOT 0347

Годен до: 2025.12
Дейн жарамды: 2025.12

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.712-1.420

РЕАГЕНТ 1

65 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.712-1.420

РЕАГЕНТ 1

65 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

REF B 21.72-2.200

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым

Реагент №1: 6 x 36 мл

ТУ 21.20.23-089-94568735-2021

Калибратор: 2 x 1,0 мл

РЗН 2021/15947 от 07.12.2021

Серия: 0346
Дата выпуска: 2023.06
Годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
д. 56, лит. А

UK ALBUMIN-VITAL

R1: 6 x 36 ml

Calibrator: 2 x 1,0 ml

LOT 0346

IVD 2025.06

K2 АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-089-94568735-2021
07.12.2021 ж. РЗН 2021/15947

Қан сарысуында (плазмада) альбуминнің концентрациясын унификацияланған колориметриялық әдіспен анықтауға арналған бромкрезолды жасыл бар реагенттер жинағы

Реагент №1 : 6 x 36 мл

Калибратор: 2 x 1,0 мл

Сериясы: 0346
Шығарылған күні: 2023.06
Дейін жарамды: 2025.06

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
д. 56, лит. А



80022008020185



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.72-2.200

РЕАГЕНТ 1

36 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.72-2.200

РЕАГЕНТ 1

36 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.72-2.200

РЕАГЕНТ 1

36 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.72-2.200

РЕАГЕНТ 1

36 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

1,0 мл

60 г/л

LOT 0347

Годен до: 2025.12
Дейін жарамды: 2025.12

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

1,0 мл

60 г/л

LOT 0347

Годен до: 2025.12
Дейін жарамды: 2025.12

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.72-2.200

РЕАГЕНТ 1

36 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.72-2.200

РЕАГЕНТ 1

36 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

REF В 21.72-2.300

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым

Реагент №1: 6 x 40 мл
Калибратор: 2 x 1,0 мл

ТУ 21.20.23-089-94568735-2021
РЗН 2021/15947 от 07.12.2021

LOT Серия: 0346 Дата выпуска: 2023.06 Годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, д. 56, лит. А

UK ALBUMIN-VITAL

R1: 6 x 40 ml
Calibrator: 2 x 1,0 ml

LOT 0346

IVD 2025.06

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenku 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

KZ АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

ТШ 21.20.23-089-94568735-2021
07.12.2021 ж. РЗН 2021/15947

Қан сарысуында (плазмада) альбуминнің концентрациясын унификацияланған колориметриялық әдіспен анықтауға арналған бромкрезолды жасыл бар реагенттер жинағы

Реагент №1 : 6 x 40 мл
Калибратор: 2 x 1,0 мл

Сериясы: 0346
Шығарылған күні: 2023.06
Дейін жарамды: 2025.06

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
56 А, лит. А



80022008020185



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF В 21.72-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF В 21.72-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF В 21.72-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF В 21.72-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF В 21.72-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF В 21.72-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

1,0 мл

60 г/л

LOT 0347

Годен до: 2025.12
Дейін жарамды: 2025.12

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

1,0 мл

60 г/л

LOT 0347

Годен до: 2025.12
Дейін жарамды: 2025.12

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

REF В 21.712-2.300

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым

Реагент №1: 10 x 40 мл
Калибратор: 3 x 1,0 мл

ТУ 21.20.23-089-94568735-2021
РЗН 2021/15947 от 07.12.2021

LOT Серия: 0346 Дата выпуска: 2023.06 Годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
д. 56, лит. А

UK ALBUMIN-VITAL

R1: 10 x 40 ml
Calibrator: 3 x 1,0 ml

LOT 0346

IVD 2025.06

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenku 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

KZ АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-089-94568735-2021
07.12.2021 ж. РЗН 2021/15947

Қан сарысуында (плазмада) альбуминнің концентрациясын унификацияланған колориметриялық әдіспен анықтауға арналған бромкрезолды жасыл бар реагенттер жинағы

Реагент №1 : 10 x 40 мл
Калибратор: 3 x 1,0 мл

Сериясы: 0346
Шығарылған күні: 2023.06
Дейін жарамды: 2025.06

тек in vitro диагностикасы үшін



80022008020185

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF В 21.712-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF В 21.712-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF В 21.712-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF В 21.712-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF В 21.712-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF В 21.712-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF В 21.712-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF В 21.712-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF В 21.712-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF В 21.712-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0346

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

1,0 мл

60 г/л

LOT 0347

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

только для in vitro диагностики тек in vitro диагностикасы үшін

Vital Development

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

1,0 мл

60 г/л

LOT 0347

только для in vitro диагностики тек in vitro диагностикасы үшін

Vital Development

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

1,0 мл

60 г/л

LOT 0347

Годен до: 2025.12
Дейін жарамды: 2025.12

только для in vitro диагностики тек in vitro диагностикасы үшін

Vital Development

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 18 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
А.Г.Плехов
25 сентября 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Набор реагентов для определения концентрации альбумина
в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом
с бромкрезоловым зеленым
«АЛЬБУМИН-ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-089-94568735-2021

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.102

Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым

2 °C 8 °C

Реагент №1: 2 x 50 мл
Калибратор: 1 x 1,0 мл

ТУ 21.20.23-069-94568735-2021
РУ

LOT Серия:
0012



Дата выпуска:
2020.05



Годен до:
2022.05

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK ALBUMIN-VITAL

LOT 0012




Vital Development Corporation
Doroga - Kamensk, 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

R1: 2 x 50 ml

Calibrator: 1 x 1,0 ml

IVD

2022.05



21022108270327



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

REF B 21.02

Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым

2 °C 8 °C

Реагент №1: 2 x 100 мл
Калибратор: 2 x 1,0 мл

ТУ 21.20.23-089-94568735-2021
ру

LOT

Серия: 0012



Дата выпуска: 2020.05



Годен до: 2022.05

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 5Б, литера А

UK ALBUMIN-VITAL

LOT

0012



Витал Девелопмент Корпорэйшн
Дорога в Каменку 5Б А, 194356
St. Petersburg, Russia

R1: 2 x 100 ml
Calibrator: 2 x 1,0 ml




2022.05

EC REP

EMERGO SURGIE
Prinsengracht 120, 2514 AA
The Hague, The Netherlands



4 567 119 610 67 8








21022108270327

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
REF B 21.02
100 мл
монореагент
LOT 0012 2 °C 8 °C
Годен до: 2022.05
только для in vitro диагностики
CE Vital

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
REF B 21.02
100 мл
монореагент
LOT 0012 2 °C 8 °C
Годен до: 2022.05
только для in vitro диагностики
CE Vital



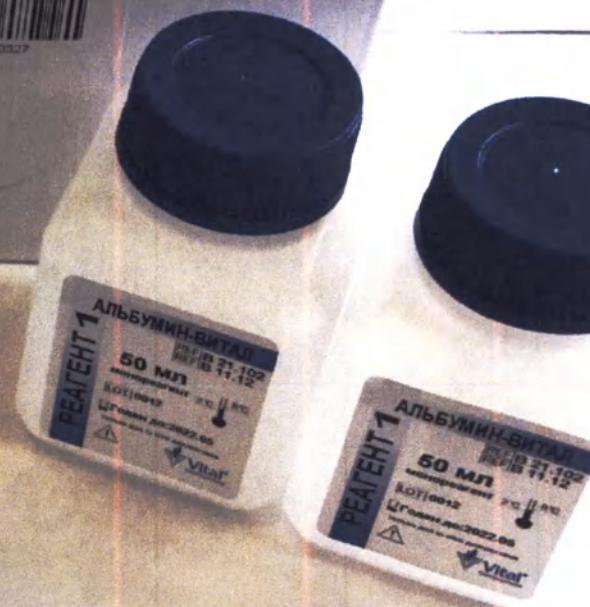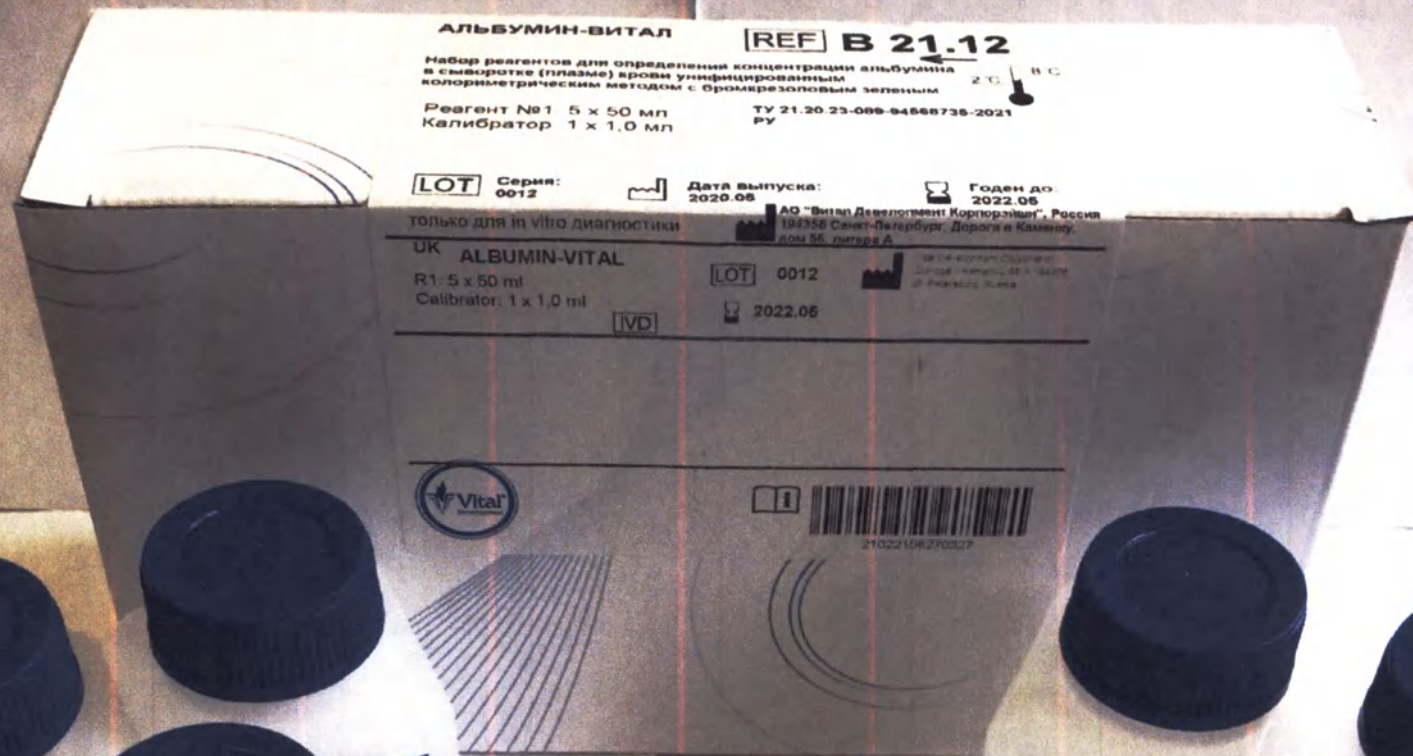

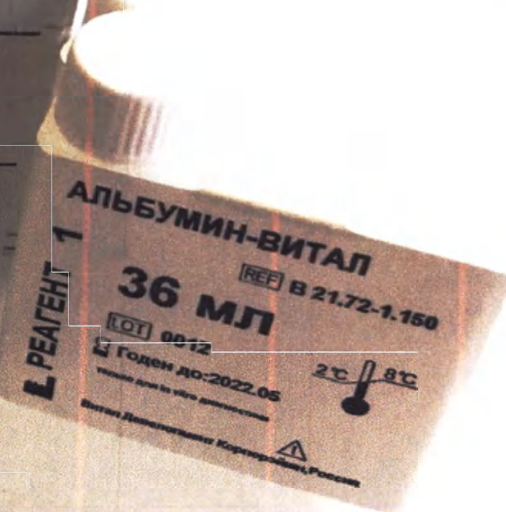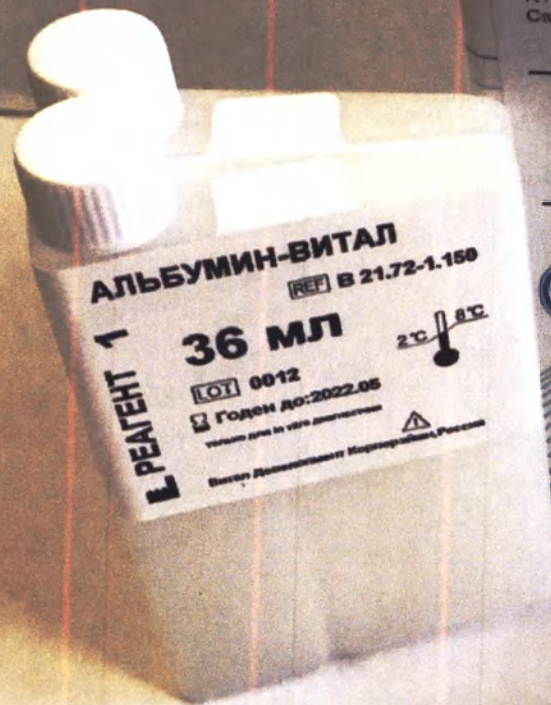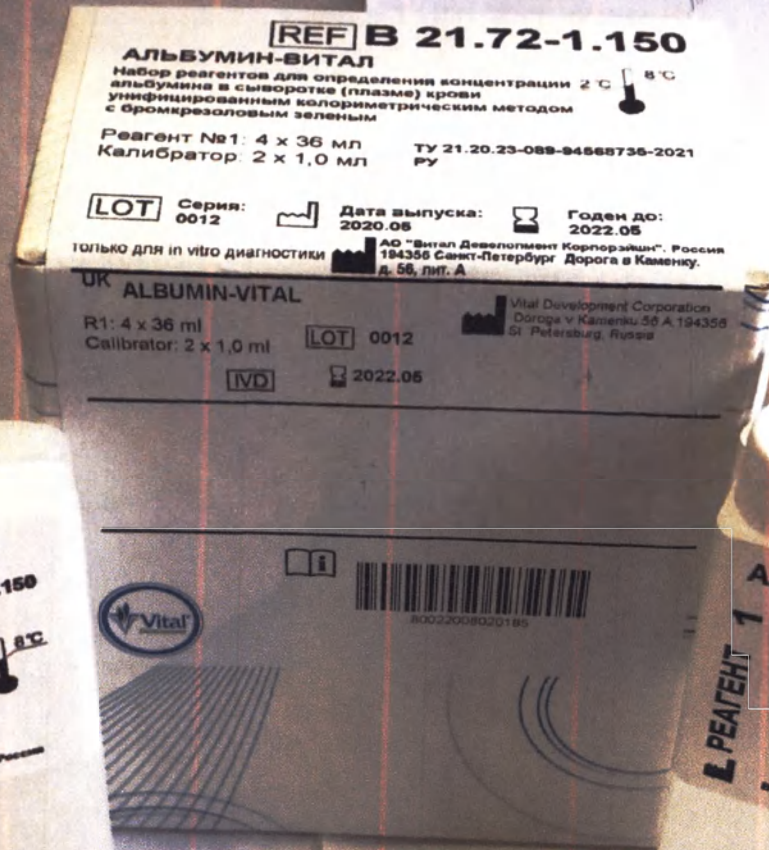

[REF] В 21.712-1.150
АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
 Набор реагентов для определения концентрации
 альбумина в сыворотке (плазме) крови
 иммунофлуоресцентным колориметрическим методом
 с бромкрезоловым зеленым

Реагент №1 8 x 36 мл
 Калибратор: 3 x 1,0 мл

ТУ 21.20.23-089-94668736-2021
 РУ

LOT Серия: 0012
 Дата выпуска: 2020.05
 Годен до: 2022.05

только для in vitro диагностики
 АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
 194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
 д. 66, пнт. А

UK ALBUMIN-VITAL

R1: 8 x 36 мл
 Calibrator: 3 x 1,0 мл

LOT 0012

IVD 2022.05

Vital Development Corporation
 Doroga v Kamenu 56 A, 194356
 St. Petersburg, Russia

1



80022008020186



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
[REF] В 21.712-1.150

36 МЛ

LOT 0012

Годен до: 2022.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
[REF] В 21.712-1.150

36 МЛ

LOT 0012

Годен до: 2022.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия



REF В 21.72-1.200
АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым

Реагент №1: 6 x 18 мл
Калибратор: 2 x 1,0 мл

ТУ 21.20.23-089-94568735-2021
РУ

LOT Серия: 0012



Дата выпуска: 2020.05



Годен до: 2022.05

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
д. 56, лит. А

UK ALBUMIN-VITAL

R1: 6 x 18 ml
Calibrator: 2 x 1,0 ml

LOT 0012

IVD

2022.05

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia




80022008020185

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
18 мл
РЕАГЕНТ №1
0012
годен до: 2022.05
только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
18 мл
РЕАГЕНТ №1
0012
годен до: 2022.05
только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



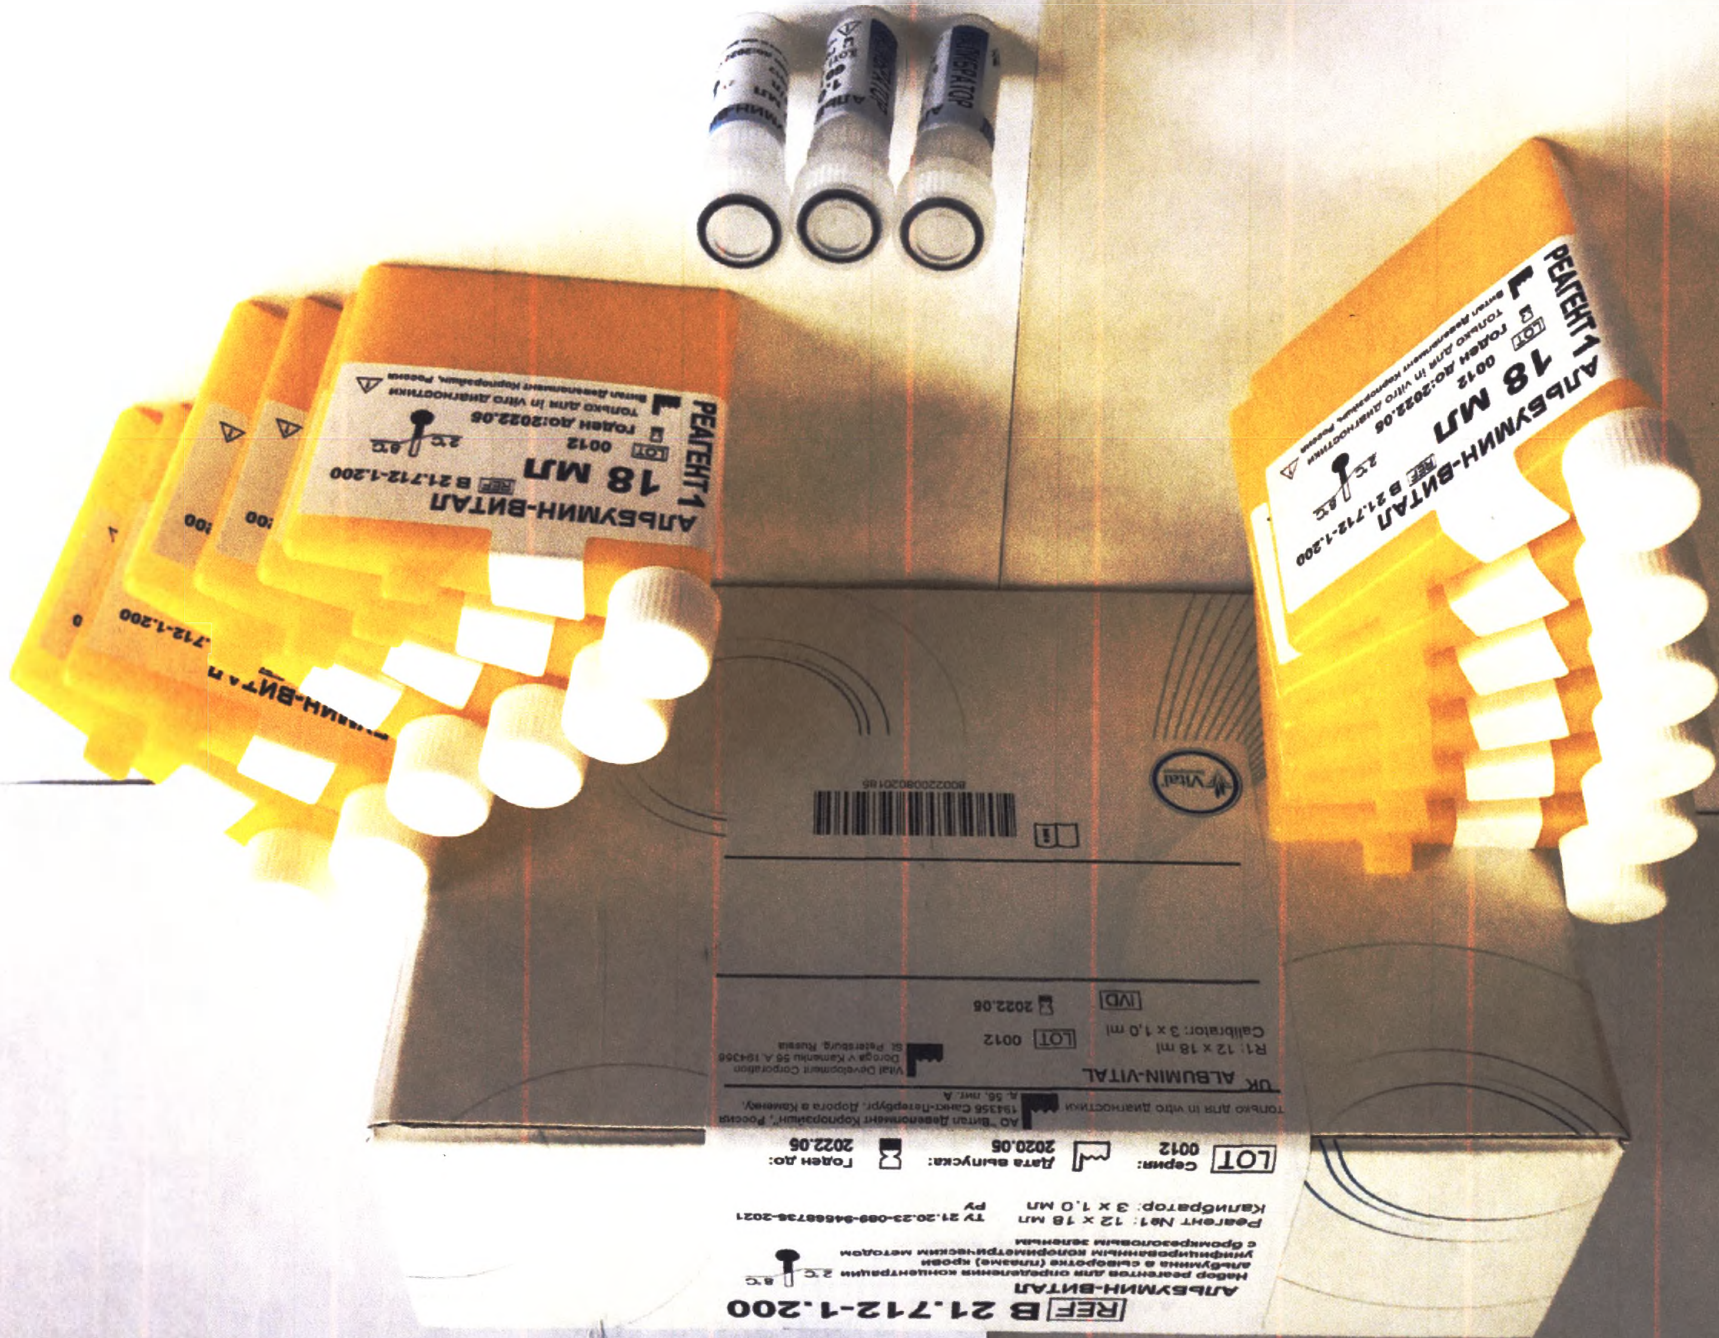

REF B 21.72-1.300

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым

Реагент №1: 4 x 45 мл
Калибратор: 2 x 1,0 мл

ТУ 21.20.23-089-94568735-2021
РУ

LOT Серия: 0012



Дата выпуска: 2020.05



Годен до: 2022.05

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
д. 56, лит. А

UK ALBUMIN-VITAL

R1: 4 x 45 ml
Calibrator: 2 x 1,0 ml

LOT 0012

IVD

2022.05

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia



80022008020185



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
REF B 21.72-1.300

45 МЛ

LOT 0012

Годен до: 2022.05

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
REF B 21.72-1.300

45 МЛ

LOT 0012

Годен до: 2022.05

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



[REF] В 21.712-1.300

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым

Реагент №1 8 x 45 мл
Калибратор 3 x 1,0 мл

ТУ 21.20.23-089-94668735-2021
ру

LOT

Серия:
0012



Дата выпуска:
2020.05



Годен до:
2022.05

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194358 Санкт-Петербург, Дорога в Камчатку,
д. 56, лит. А

UK ALBUMIN-VITAL

R1: 8 x 45 ml

Calibrator: 3 x 1,0 ml

LOT 0012



Vital Development Corporation
Doroga V Kamchatku, 56 A 194358
St. Petersburg, Russia

IVD

2022.05



80022008020185



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
[REF] В 21.712-1.300
45 МЛ
LOT 0012
Годен до: 2022.05
только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

РЕАГЕНТ 1

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
[REF] В 21.712-1.300
45 МЛ
LOT 0012
Годен до: 2022.05
только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

РЕАГЕНТ 1



[REF] В 21.72-1.420

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
альбумина в сыворотке (плазме) крови
унифицированным колориметрическим методом
с бромкрезоловым зеленым

Реагент №1: 3 x 65 мл
Калибратор: 2 x 1,0 мл

ТУ 21.20.23-089-94665735-2021
РУ

LOT

Серия:
0012



Дата выпуска:
2020.05



Годен до
2022.05

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн" Россия
194356 Санкт-Петербург Дорго в Каменку
д. 56, лит. А

UK ALBUMIN-VITAL

R1: 3 x 65 ml

Calibrator: 2 x 1,0 ml

LOT

0012

IVD

2022.05



Vital Development Corporation
Doroga v Kamensk 56 A 194356
St. Petersburg, Russia



60022006020185

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
[REF] В 21.72-1.420

65 мл

LOT 0012

Годен до: 2022.05

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

РЕАГЕНТ 1

REF B 21.712-1.420
АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым
Реагент №1 6 x 65 мл
Калибратор: 3 x 1,0 мл

LOT 0012 **Серия:** **Дата выпуска:** 2020.06 **Годен до:** 2022.06

только для in vitro диагностики **АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия**
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каленку, д. 56, лит. А

UK ALBUMIN-VITAL
R1: 6 x 65 ml
Calibrator: 3 x 1,0 ml **LOT** 0012 **Годен до:** 2022.06



РЕАГЕНТ 1
АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
REF B 21.712-1.420
65 МЛ
LOT 0012
Годен до: 2022.06
только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

РЕАГЕНТ 1
АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
REF B 21.712-1.420
65 МЛ
LOT 0012
Годен до: 2022.06
только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

Альб
1,0
65
мл
LOT 0012
Годен до:

REF B 21.72-2.200
АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
Набор реагентов для определения концентрации 2 °C 5 °C
альбумина в сыворотке (плазма) крови
унифицированным колориметрическим методом
с бромкрезоловым зеленым
Реагент №1: 6 x 36 мл
Калибратор: 2 x 1,0 мл
ТУ 21.20.23-089-94565735-2021
РФ

LOT Серия: 0012  Дата выпуска: 2020.05  Годен до: 2022.05
только для in vitro диагностики  АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
д. 56, лит. А

UK ALBUMIN-VITAL
R1: 6 x 36 ml
Calibrator: 2 x 1,0 ml **LOT** 0012
IVD  2022.05
 Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A.194356
St. Petersburg, Russia


80022008020185

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
REF B 21.72-2.200
РЕАГЕНТ 1
36 МЛ
LOT 0012
Годен до: 2022.05
только для in vitro диагностики
 Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
REF B 21.72-2.200
РЕАГЕНТ 1
36 МЛ
LOT 0012
Годен до: 2022.05
только для in vitro диагностики
 Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

АЛЬБУМИН
1,0 МЛ
60 т/л
LOT 0012
Годен до: 2022.05

REF В 21.712-2.300

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым

Реагент №1 10 x 40 мл
Калибратор 3 x 1,0 мл

ТУ 21.20.23-089-94566735-2021

РУ

LOT

Серия: 0012



Дата выпуска: 2020.05



Годен до: 2022.05

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорация", Россия
194358 Санкт-Петербург, Дорога в Кашанку,
д. 58, лит. А

UK ALBUMIN-VITAL

R1: 10 x 40 ml
Calibrator: 3 x 1,0 ml

LOT 0012

2022.05

IVD

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenku 58 A, 194358
St. Petersburg, Russia



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
REF В 21.712-2.300
40 мл
2°C / 8°C
LOT 0012
Годен до: 2022.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорация
Россия

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
REF В 21.712-2.300

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
REF В 21.712-2.300
40 мл
2°C / 8°C
LOT 0012
Годен до: 2022.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорация
Россия



REF В 21.72-2.300

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации 2°C 8°C
альбумина в сыворотке (плазме) крови
унифицированным колориметрическим методом
с бромкрезоловым зеленым

Реагент №1: 6 x 40 мл
Калибратор: 2 x 1,0 мл

ТУ 21.20.23-089-94688736-2021
РУ

LOT

Серия:
0012



Дата выпуска:
2020.05



Годен до:
2022.05

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
д. 56, лит. А

UK ALBUMIN-VITAL

R1: 6 x 40 ml
Calibrator: 2 x 1,0 ml

LOT

0012

IVD

2022.05

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia



21022308020185



АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
REF В 21.72-2.300

40 мл
2°C 8°C

LOT 0012

Годен до: 2022.05

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия

АЛЬБУМИН-ВИТАЛ
REF В 21.72-2.300

40 мл

LOT 0012 2°C 8°C

Годен до: 2022.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия



Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 16 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.

