

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Мегатехника»



В. Г. Фомин

10 июня 2021 г.

**Фотографические изображения
общего вида медицинского изделия
«Индикаторы химические комбинированные с биологическими
одноразового применения для контроля стерилизации, обеззараживания «MGtest Bio»
по ТУ 32.50.50-011-49003903-2021**

Megatechnica

Индикатор химический комбинированный с биологическим для применения для контроля пищевой стерилизации

Magnetochromismus

Индикатор химической концентрации с биологическим однократного применения для контроля паровой стерилизации, обеззараживания
«MGtest Bio» (110°C - 137°C) (все режимы) 5 класс;

Megatechnica

Индикаторы химические комбинированные
с биологическими одноразового применения
для контроля стерилизации, обеззараживания
MCtest Bio по ТУ 32.50.50-011-49003903-2021


Индикатор химический комбинированный
с биологическим одноразового применения
для контроля паровой стерилизации, обеззараживания

«MGtest Bio ПАР 110°C-137°C (все режимы) 5 класс»

[illegible]

EY-M

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "Малекс-Ойл".
Общество с ограниченной ответственностью "Малекс-Ойл"
111002, Санкт-Петербург, ул. Разъездная, д. 5, лит. А, пом. 001
www.malexcoils.com e-mail: info@malexcoils.com t/fax: +7 (812) 434-41-41



Фотографическое изображение

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИИ
Индикатор химический комбинированный с биологическим
применения для контроля воздушной стерилизации

ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ

Индикатор химический комбинированный с биологическим однократного применения
для контроля воздушной стерилизации
«MGtest Bio BOLD 160°C-200°C (по режиму) 5 класс»

Индикаторы химические комбинированные
с биологическими одноразового применения
для контроля стерилизации, обеззараживания
MGtest Bio по ТУ 32.50.50-011-49003903-2021

[illegible]

1994

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "Медатехника".
Общество с ограниченной ответственностью "Медатехника"
191002, Санкт-Петербург, ул. Рублевская, д. 2, лит. А, пом. 8Н
www.medatechnica-medical.ru, тел. +7 (812) 614-41-41

ООО ЦРПМ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Индикатор химический комбинированный с биологическим
применения для контроля этиленоксидной стерилизации
«MGtest Bio ЭО (все режимы) 5 класс»


Индикатор химический комбинированный с биологическим одноразового применения для контроля этиленовой стерилизации
«Mylux Pro 30 (все размеры)» 5 классов

Индикаторы химические комбинированные
с биологическими одноразового применения
для контроля стерилизации, обеззараживания
MGtest Bio по ТУ 32.50.50-011-49003903-2021

«MGtest Bio 30 (все режимы) 5 класс»

[illegible]

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "Медатеchnica".
Общество с ограниченной ответственностью "Медатеchnica".
ПРИКОЗ, Санкт-Петербург, ул. Раильская, д. 3, лит. А, пом. 80
www.medatechnica-medical.ru, т/ф: +7 (812) 816-41-41



Megatechnica

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Индикатор химический комбинированный с биологическим
применения для контроля перекисидной (плазменной)

Magister

Индуктор иммунный комбинированный с биологическим однократного применения

Megatechnica

Индикаторы химические комбинированные
с биологическими одноразового применения
для контроля стерилизации, обеззараживания
Mqtest Bio по ТУ 32.50.50-011-49003903-2021

«MGtest Bio ПЕР (все режимы) 5 класс»

[illegible]

PV 10

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "Медiatechnika".
Общество с ограниченной ответственностью "Медiatechnika"
119102, Санкт-Петербург, ул. Разъезжий, д. 5, лит. А, пом. 41
www.mediatechnika-medical.ru, t8c: +7 (812) 414-41-41

 ООО ЦИПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Индикатор химический комбинированный с биологическим одноразового применения для контроля пероксидной (плазменной) стерилизации
«MGtest Bio ПЕР (все режимы) 5 класс»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Индикатор химический комбинированный с биологическим
применения для контроля перекисидной (плазменной)
«МС fast Bio PER (для перекиси) 5 мл/мл»

ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ
Индикатор химический комплексобразующий с биологическим однократного применения
для контроля перекисной (глютаминной) стерилизации
«MGBest Bio PER (исп. реневый) 5 класс»

Индикаторы химические комбинированные
с биологическими одноразового применения
для контроля стерилизации, обеззараживания
MGtest Bio по ТУ 32.50.50-011-49003903-2021

Индикатор химический комбинированный
с биологическим однократного применения
для контроля пероксидной (плазменной) стерилизации
«MGtest Bio ПЕР (все режимы) 5 класс»

[illegible]

РУР

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "Мегатехника",
Общество с ограниченной ответственностью "Мегатехника",
170101, Санкт-Петербург, ул. Раваля, д. 5, лит. А, пом. 811
ИНН/ОГРН по месту регистрации: 78-07-0707884-04



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Мегатехника»

В. Г. Фомин

[illegible]

Исследования и биологические
факторы стрессов

журнал обеззараживания патогенных биологических агентов; журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава); журнал контроля работы стерилизатора перексидного (плазменного); журнал контроля работы этиленоксидного стерилизатора; бирка; имитатор полной загрузки


Фотографическое изображение

Индикатор химический комбинированный с биологическим одноразового применения для контроля воздушной стерилизации «MGtest Bio ПАР 110°C -137°C (все режимы) 5 класс»



Фотографическое изображение

Вид маркировки потребительской упаковки на примере упаковки индикатора химического комбинированного с биологическим одноразового применения для контроля воздушной стерилизации «MGtest Bio ВОЗД 160°C -200°C (все режимы) 5 класс»

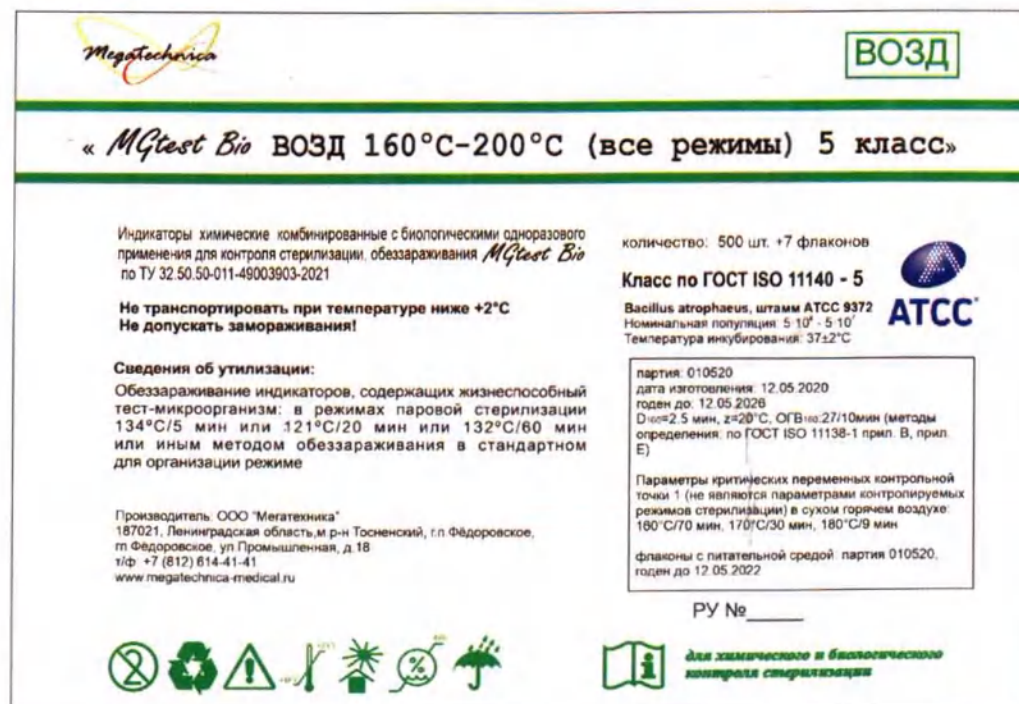

Пронумеровано и прошнуровано

9 (два)

Листа/ов

Ген. директор

[Signature]

В.И. Фомин

