

УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный директор
ООО «РУМЭКС Медикал»**



Макарова Н.В.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

**Система для стерилизации Стерлинк в вариантах исполнения Sterlink
Mini, Sterlink FPS-15s Plus**

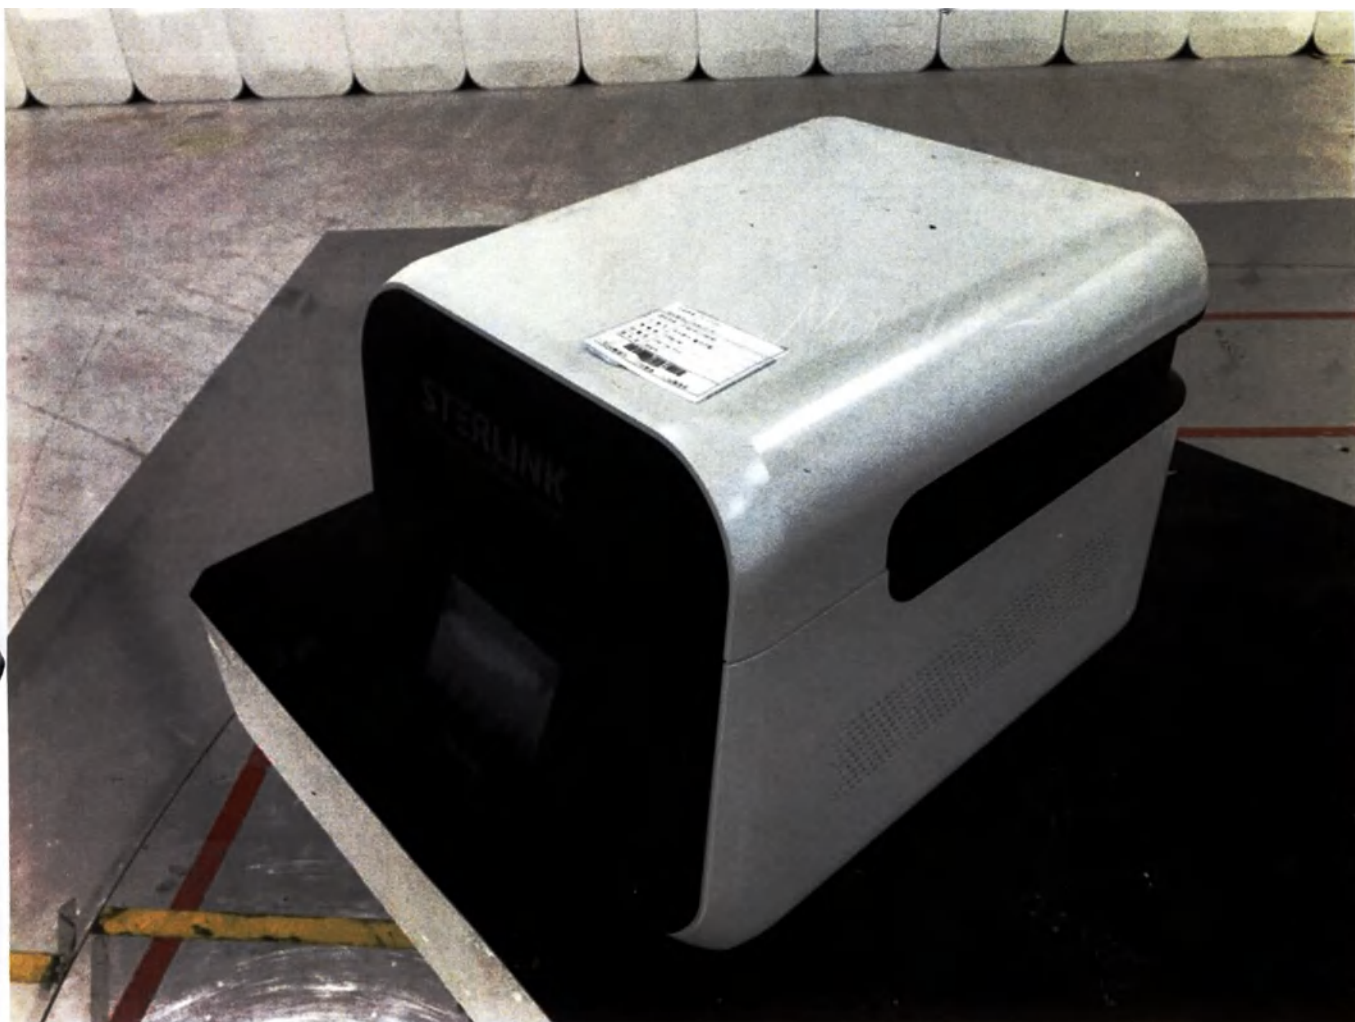


Рисунок 1 – Стерилизатор Sterlink FPS-15s Plus



Рисунок 2 – Стерилизатор Sterlink Mini

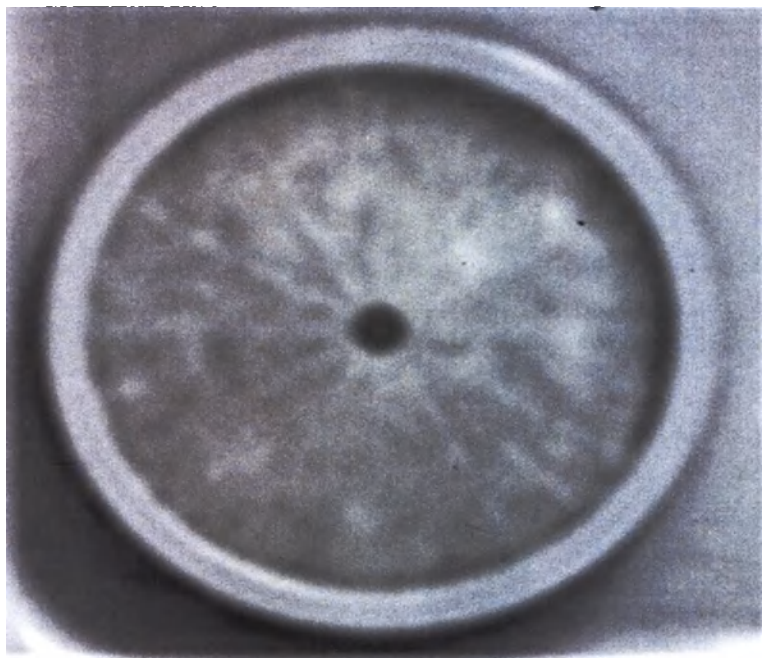


Рисунок 3 – Фильтр HEPA

Рисунок 4 – Фильтр ОЗ






Рисунок 5 – Сетевой кабель

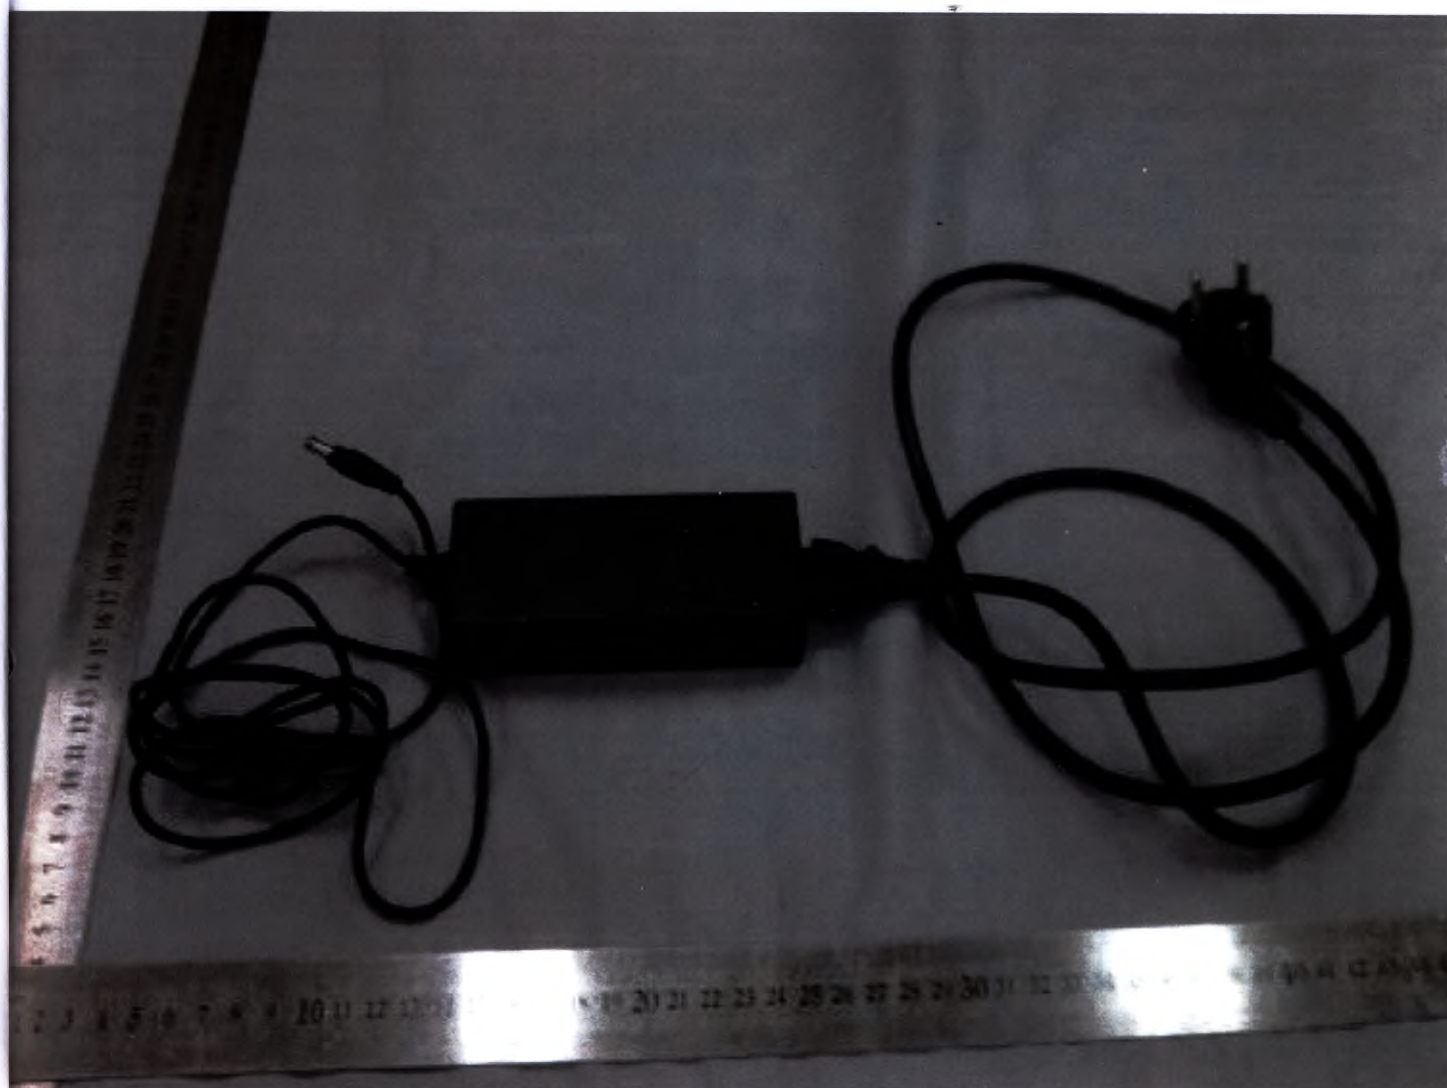


Рисунок 6 – Адаптер для принтера

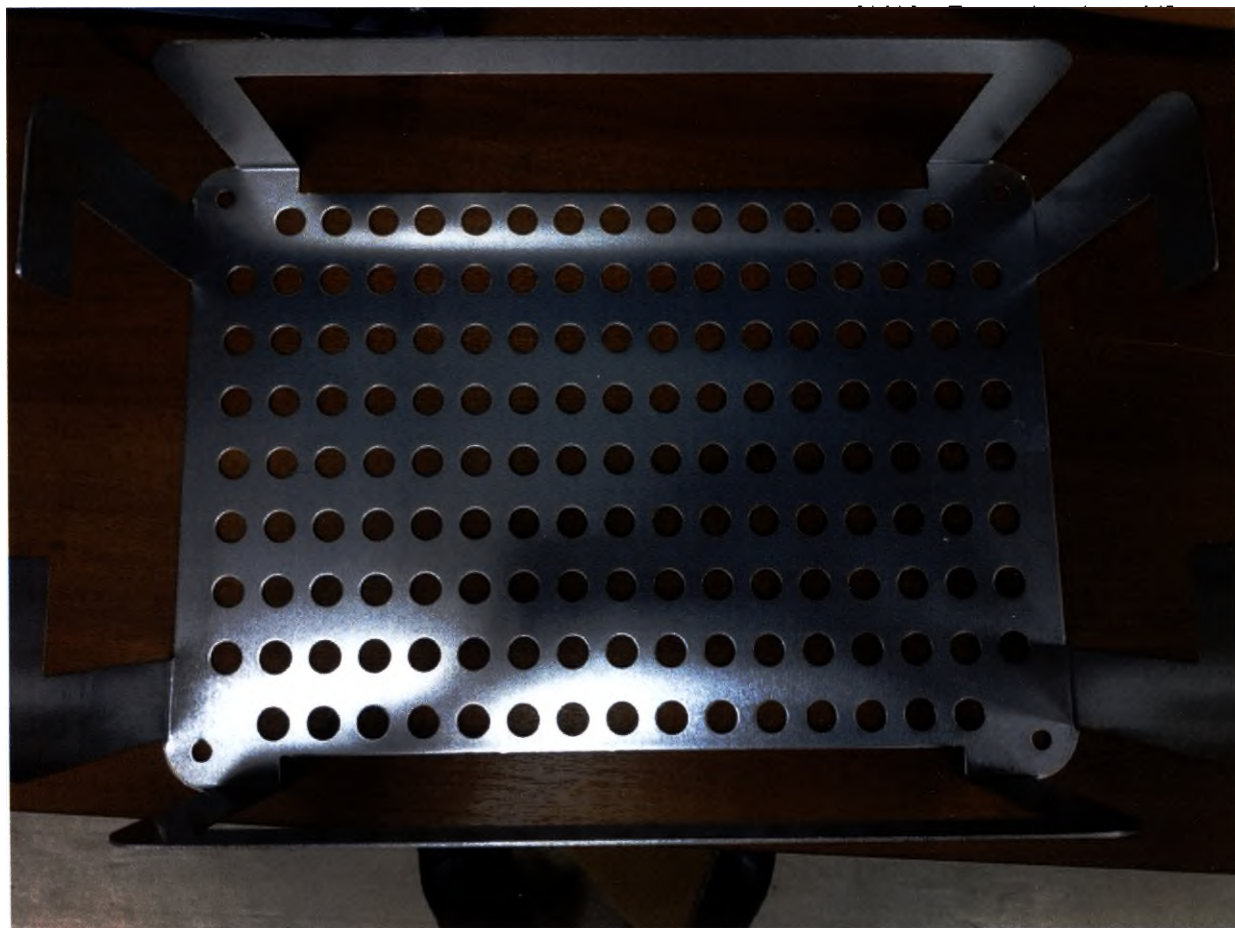


Рисунок 7 – Лоток открытый



Рисунок 8 – Лоток закрытый

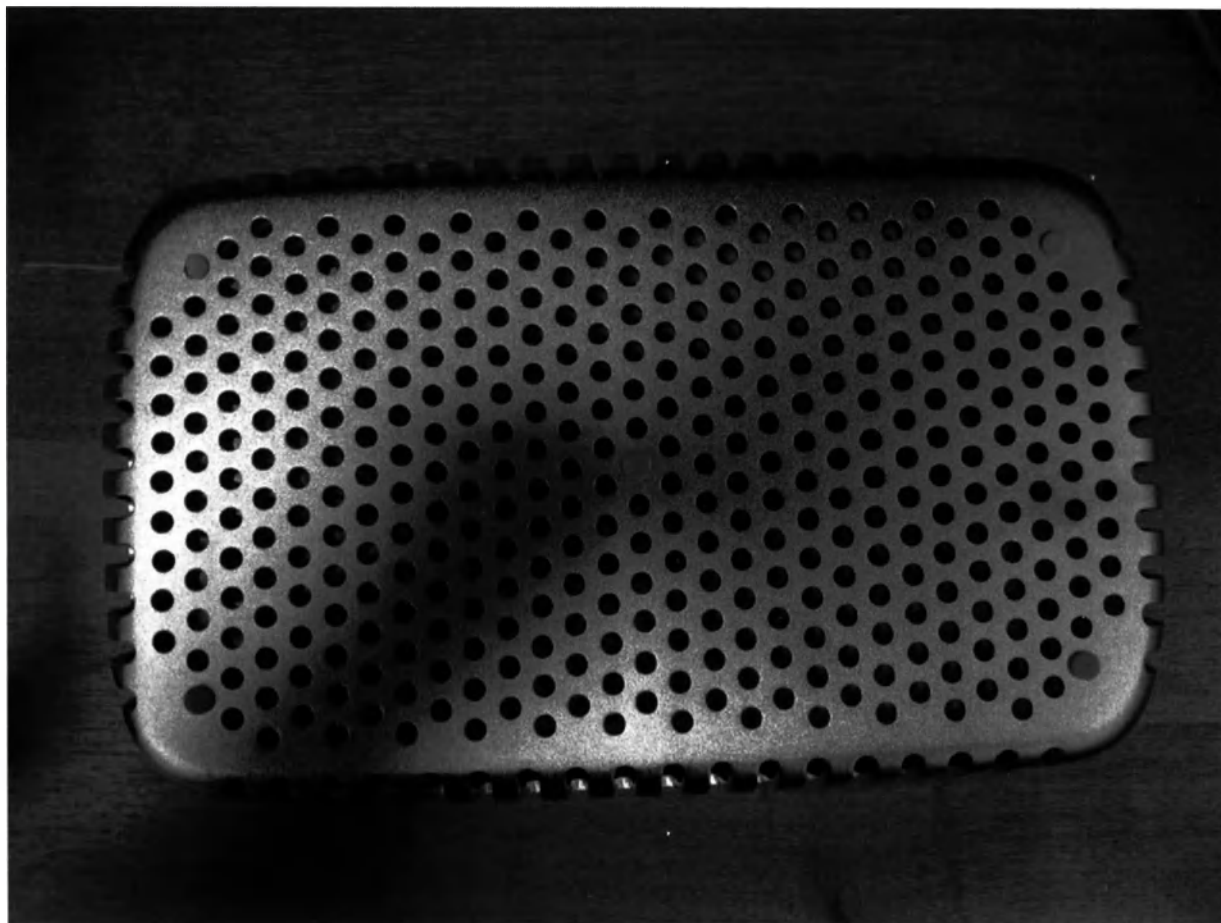


Рисунок 9 – Лоток закрытый удлиненный



Рисунок 10 – Тележка



Рисунок 11 – Принтер



Рисунок 12 – Сумка

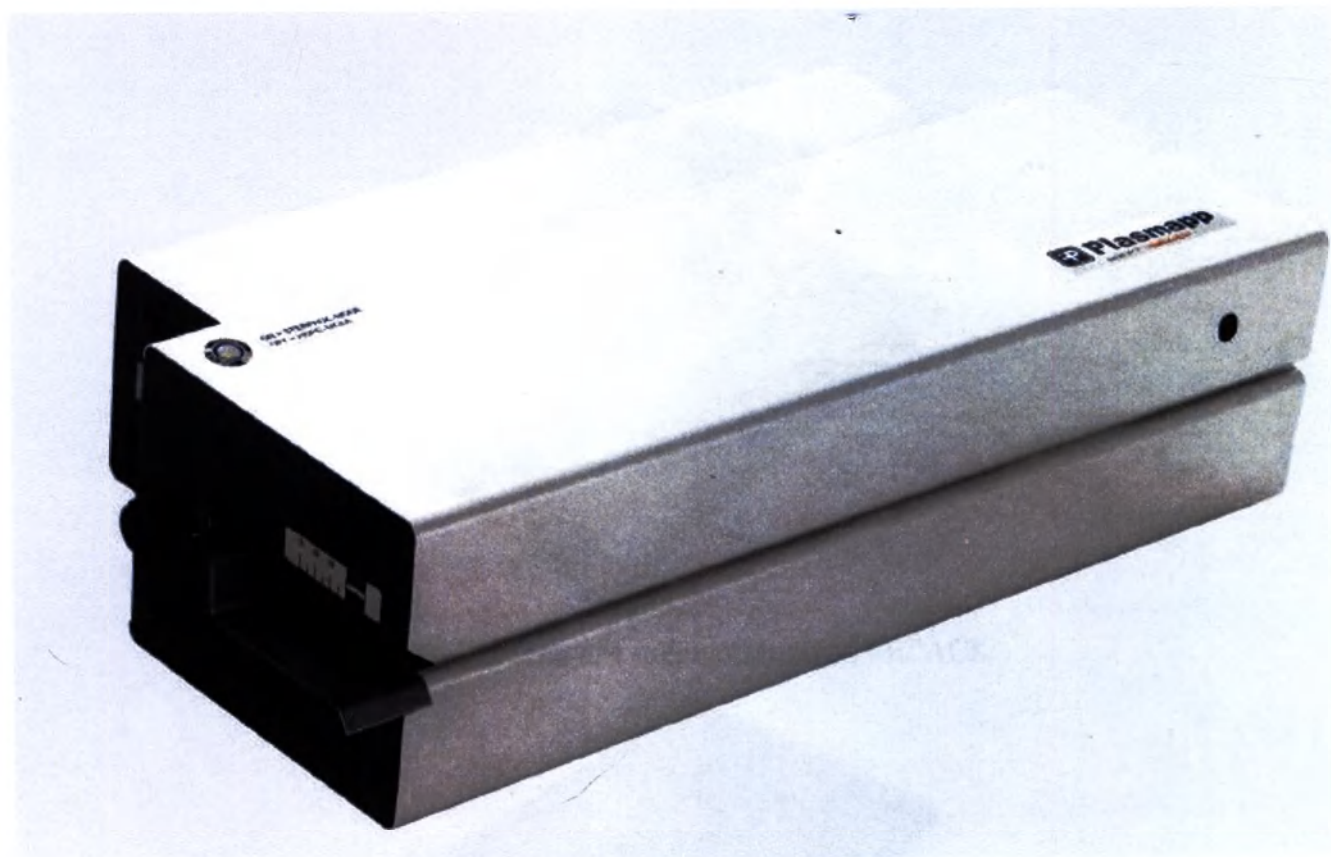


Рисунок 13 – Упаковочная машина



Рисунок 14 – Кассеты для стерилизации STERPACK

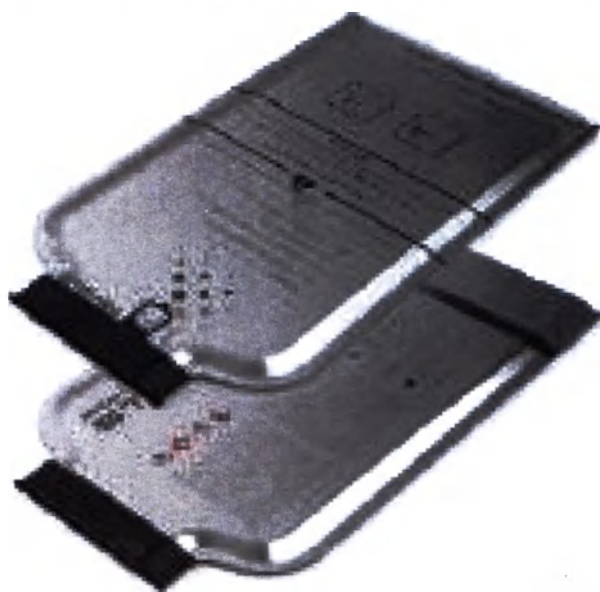


Рисунок 15 – Кассеты для стерилизации STERPACK Plus

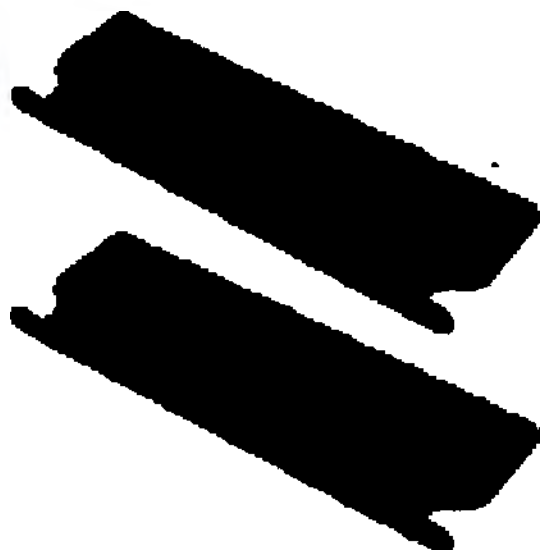


Рисунок 16 – Кассеты для стерилизации STERLOAD



Рисунок 17 – Пакеты для стерилизации маленькие



Рисунок 18 – Пакеты для стерилизации средние

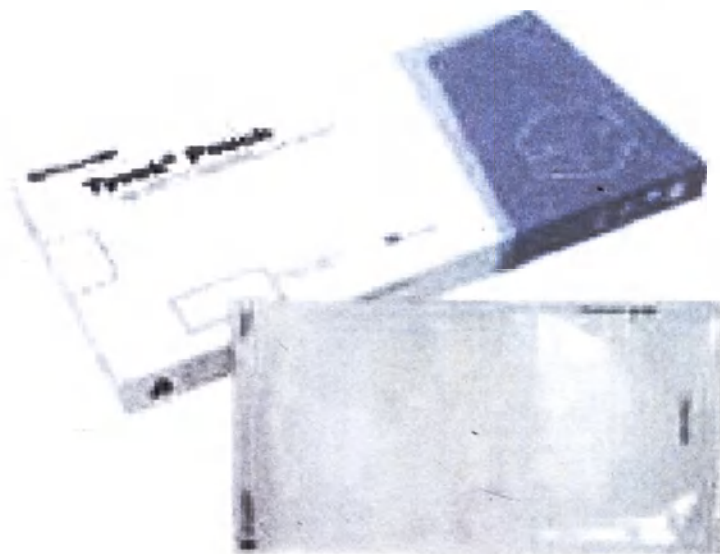


Рисунок 19 – Пакеты для стерилизации большие



Рисунок 20 – Клейкая бумага для принтера



Рисунок 21 – Химическая индикаторная лента



Рисунок 22 – Химические индикаторные полоски

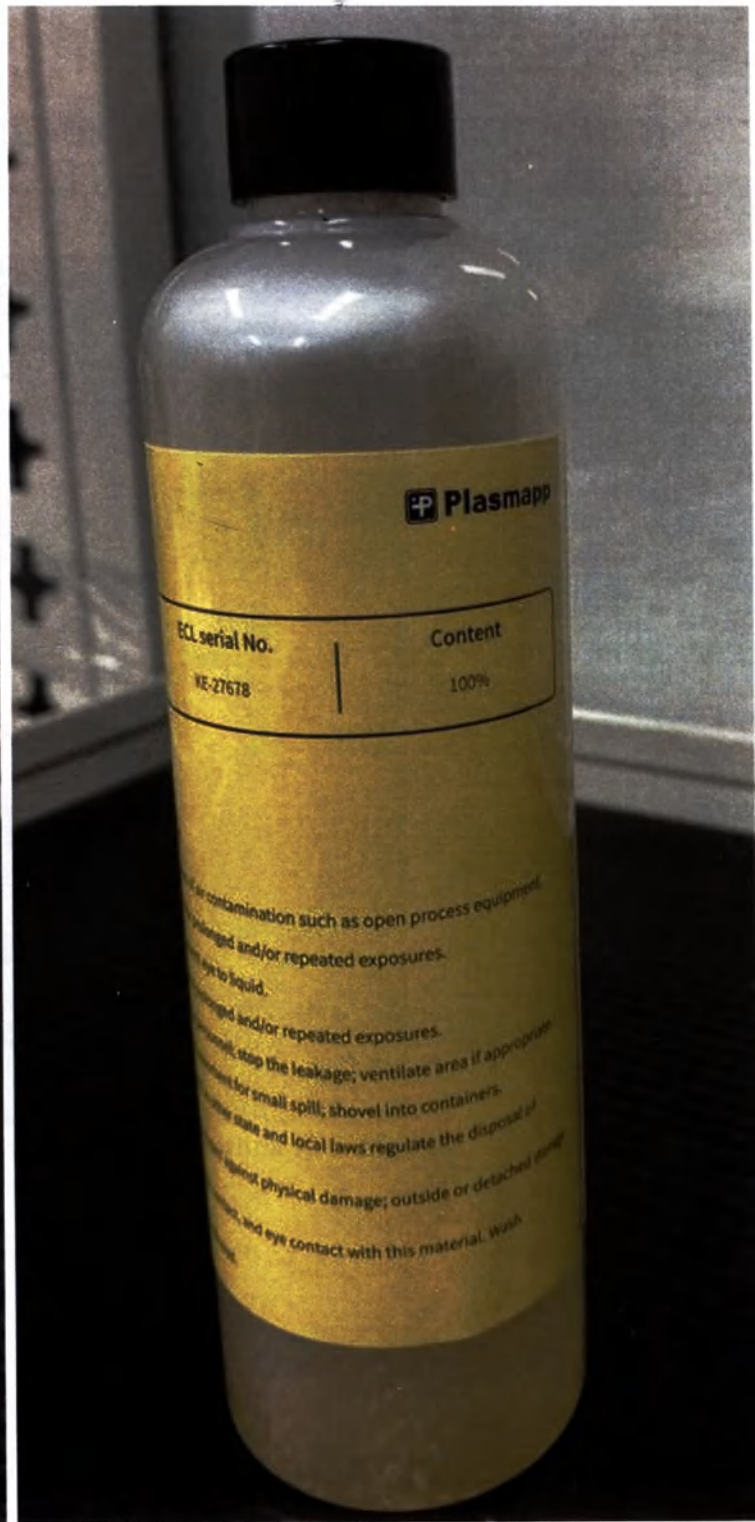
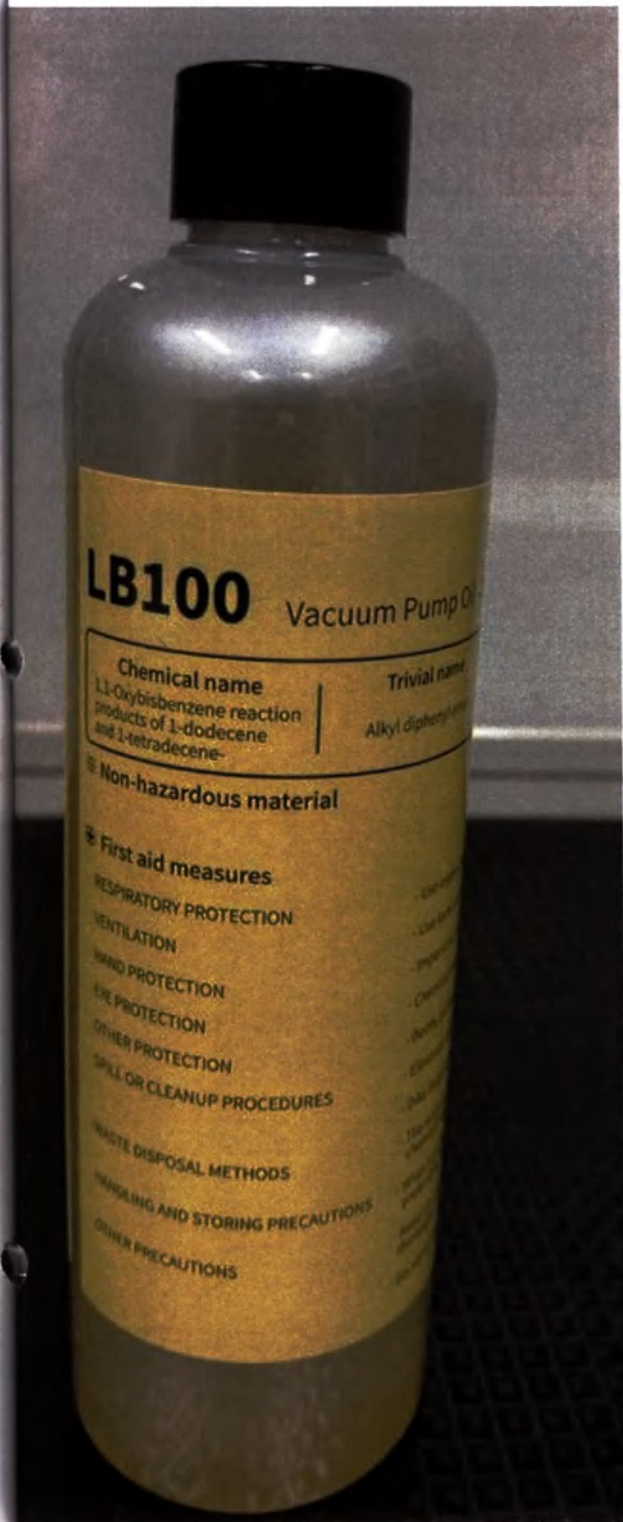


Рисунок 23 – Масло

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МАРКИРОВКИ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

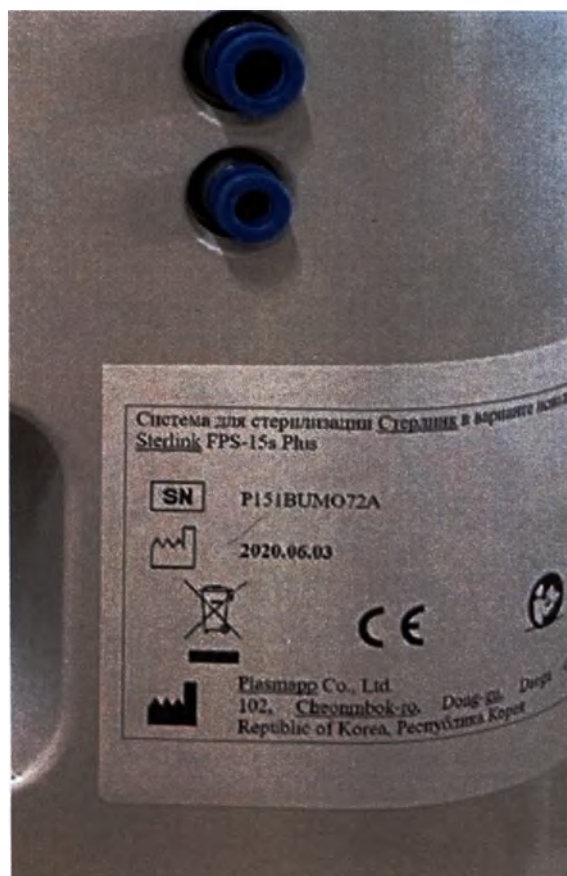


Рисунок 1 – Стерилизатор Sterlink FPS-15s Plus

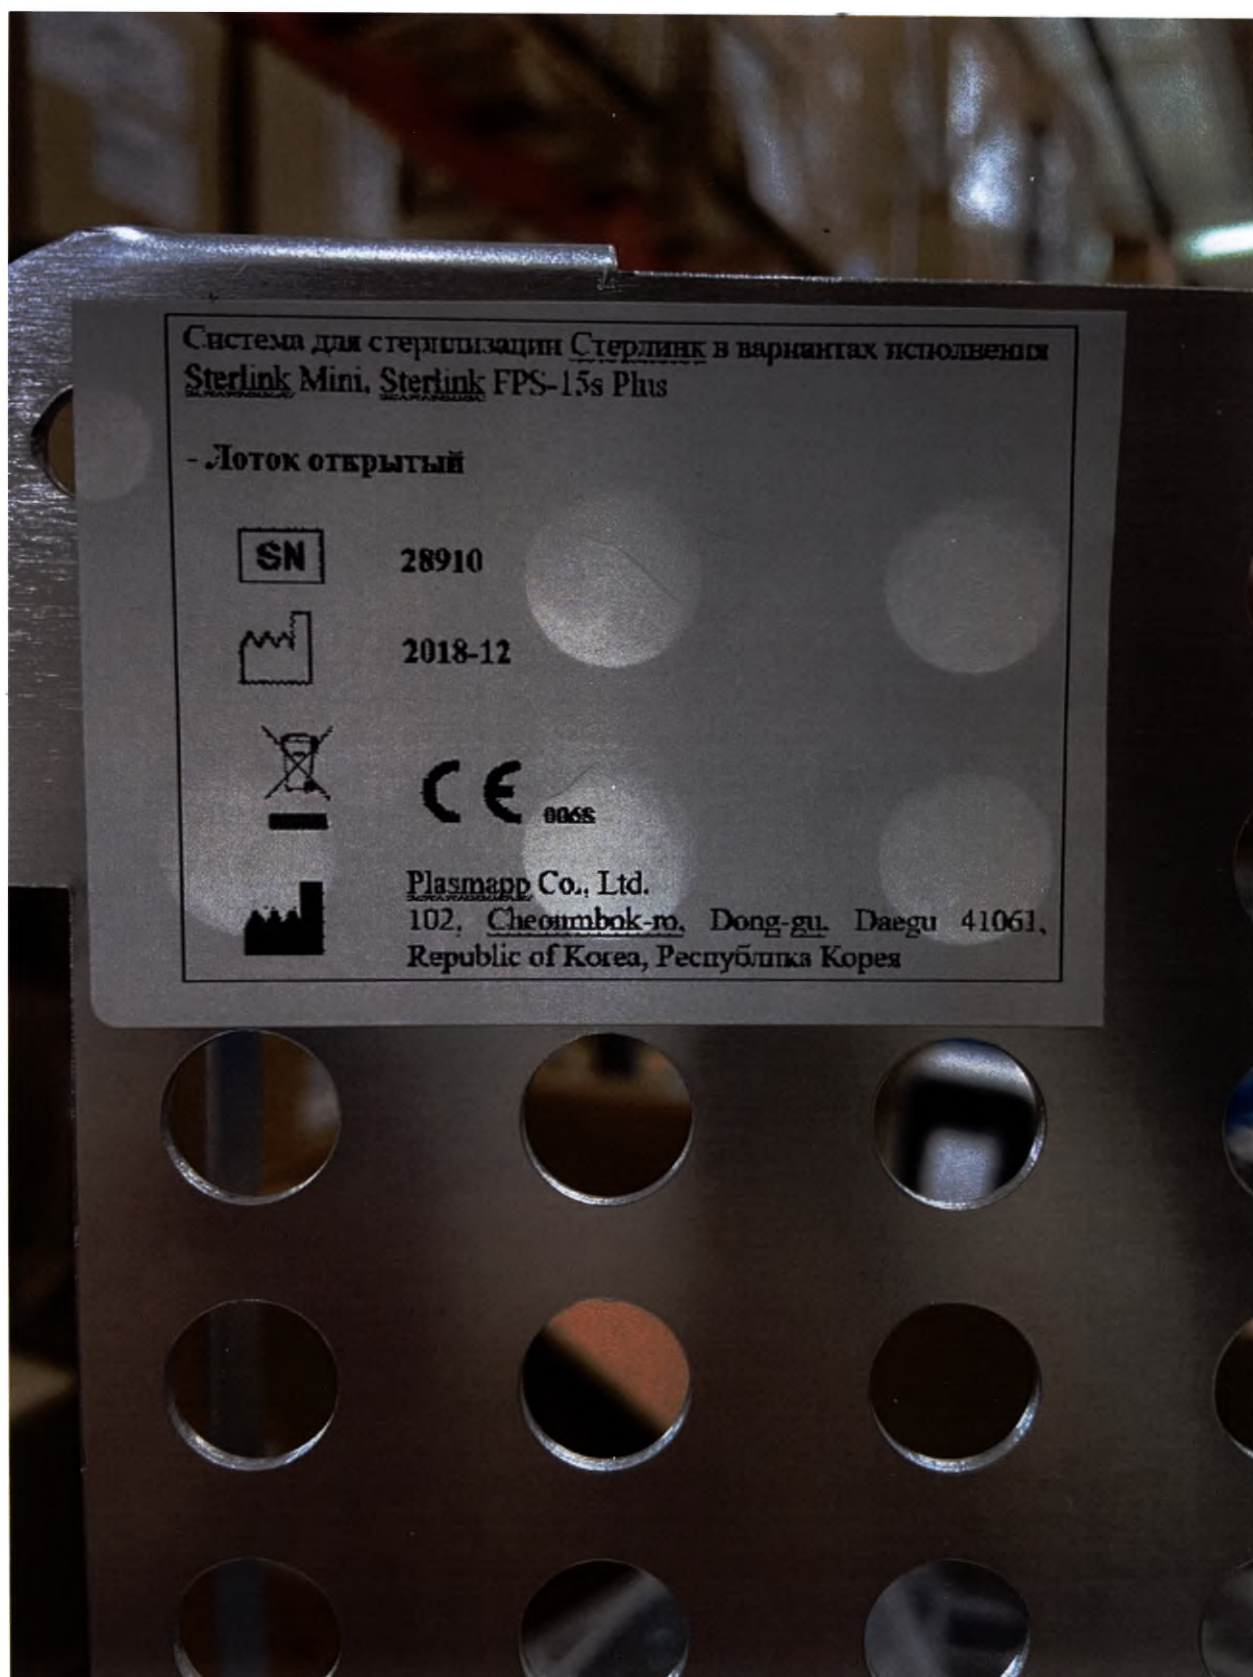


Рисунок 2 - Лоток открытый


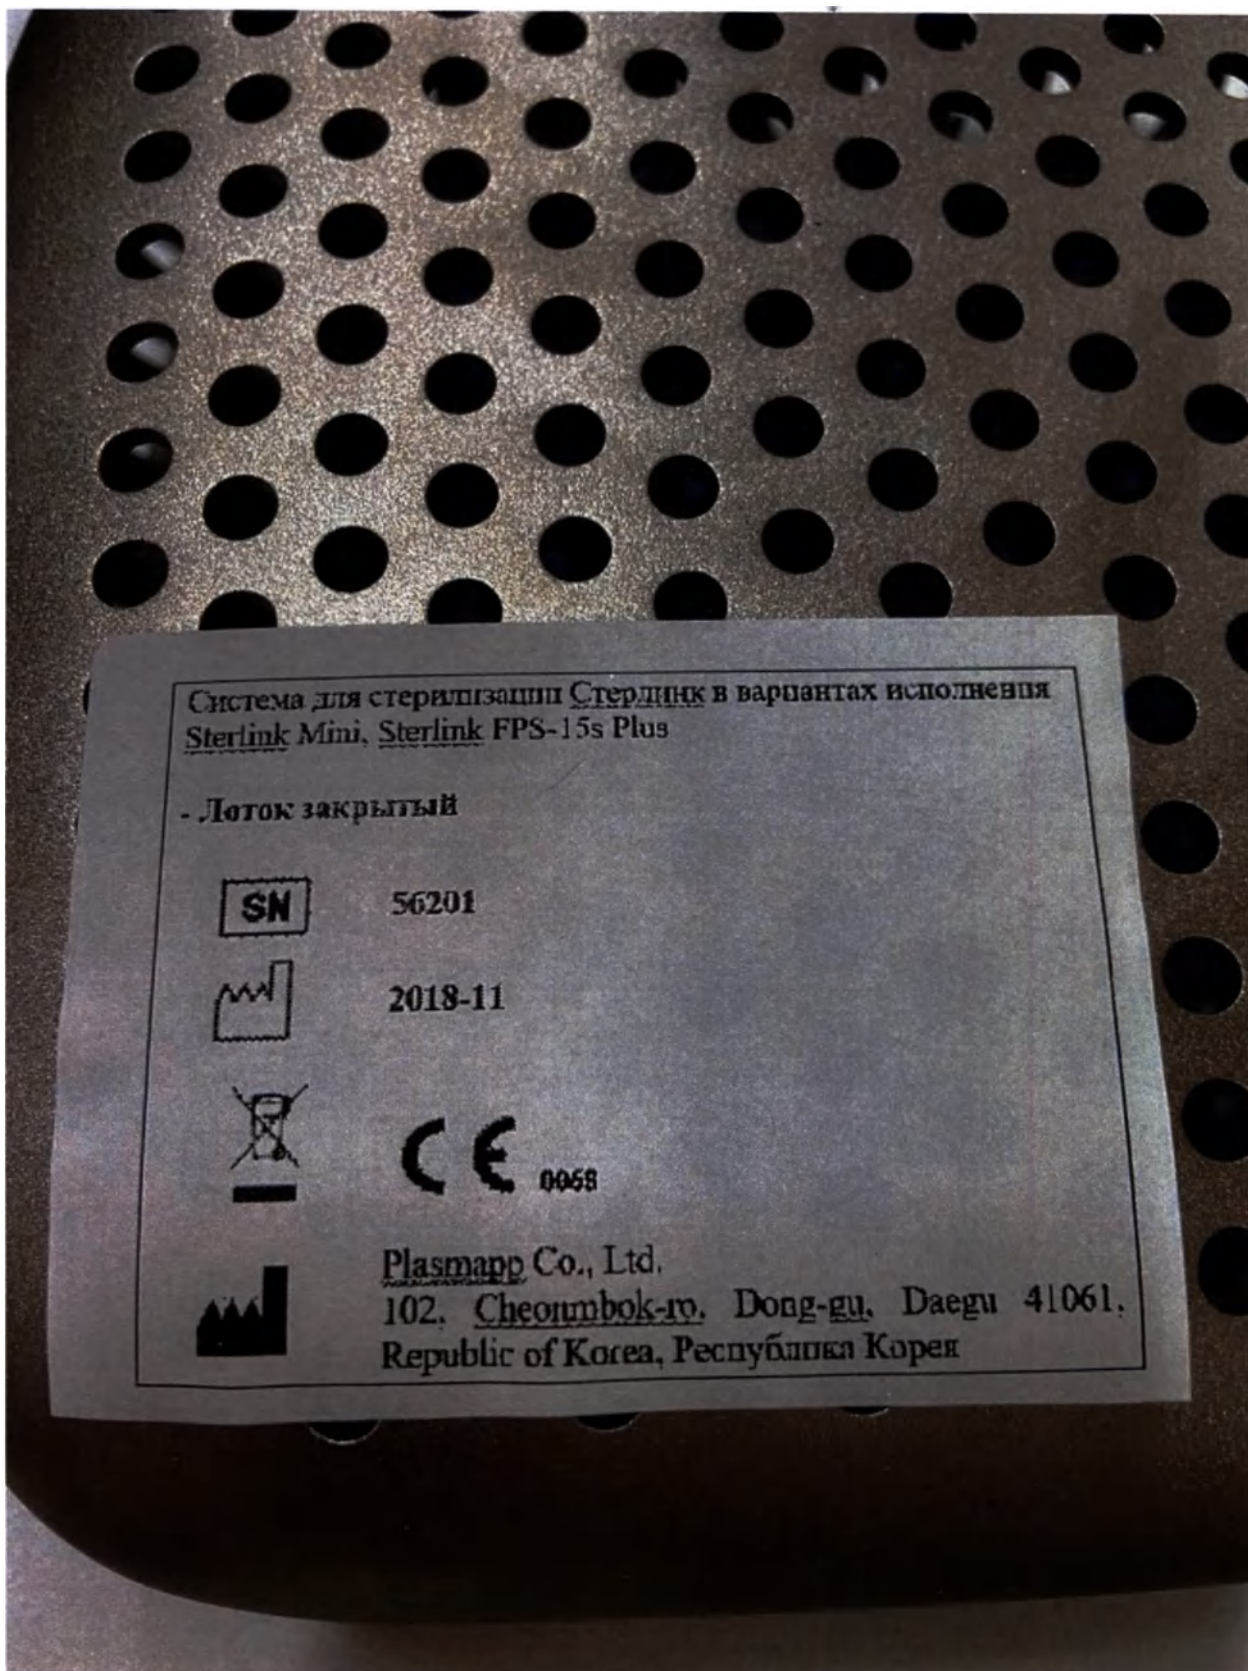


Рисунок 3 - Лоток закрытый

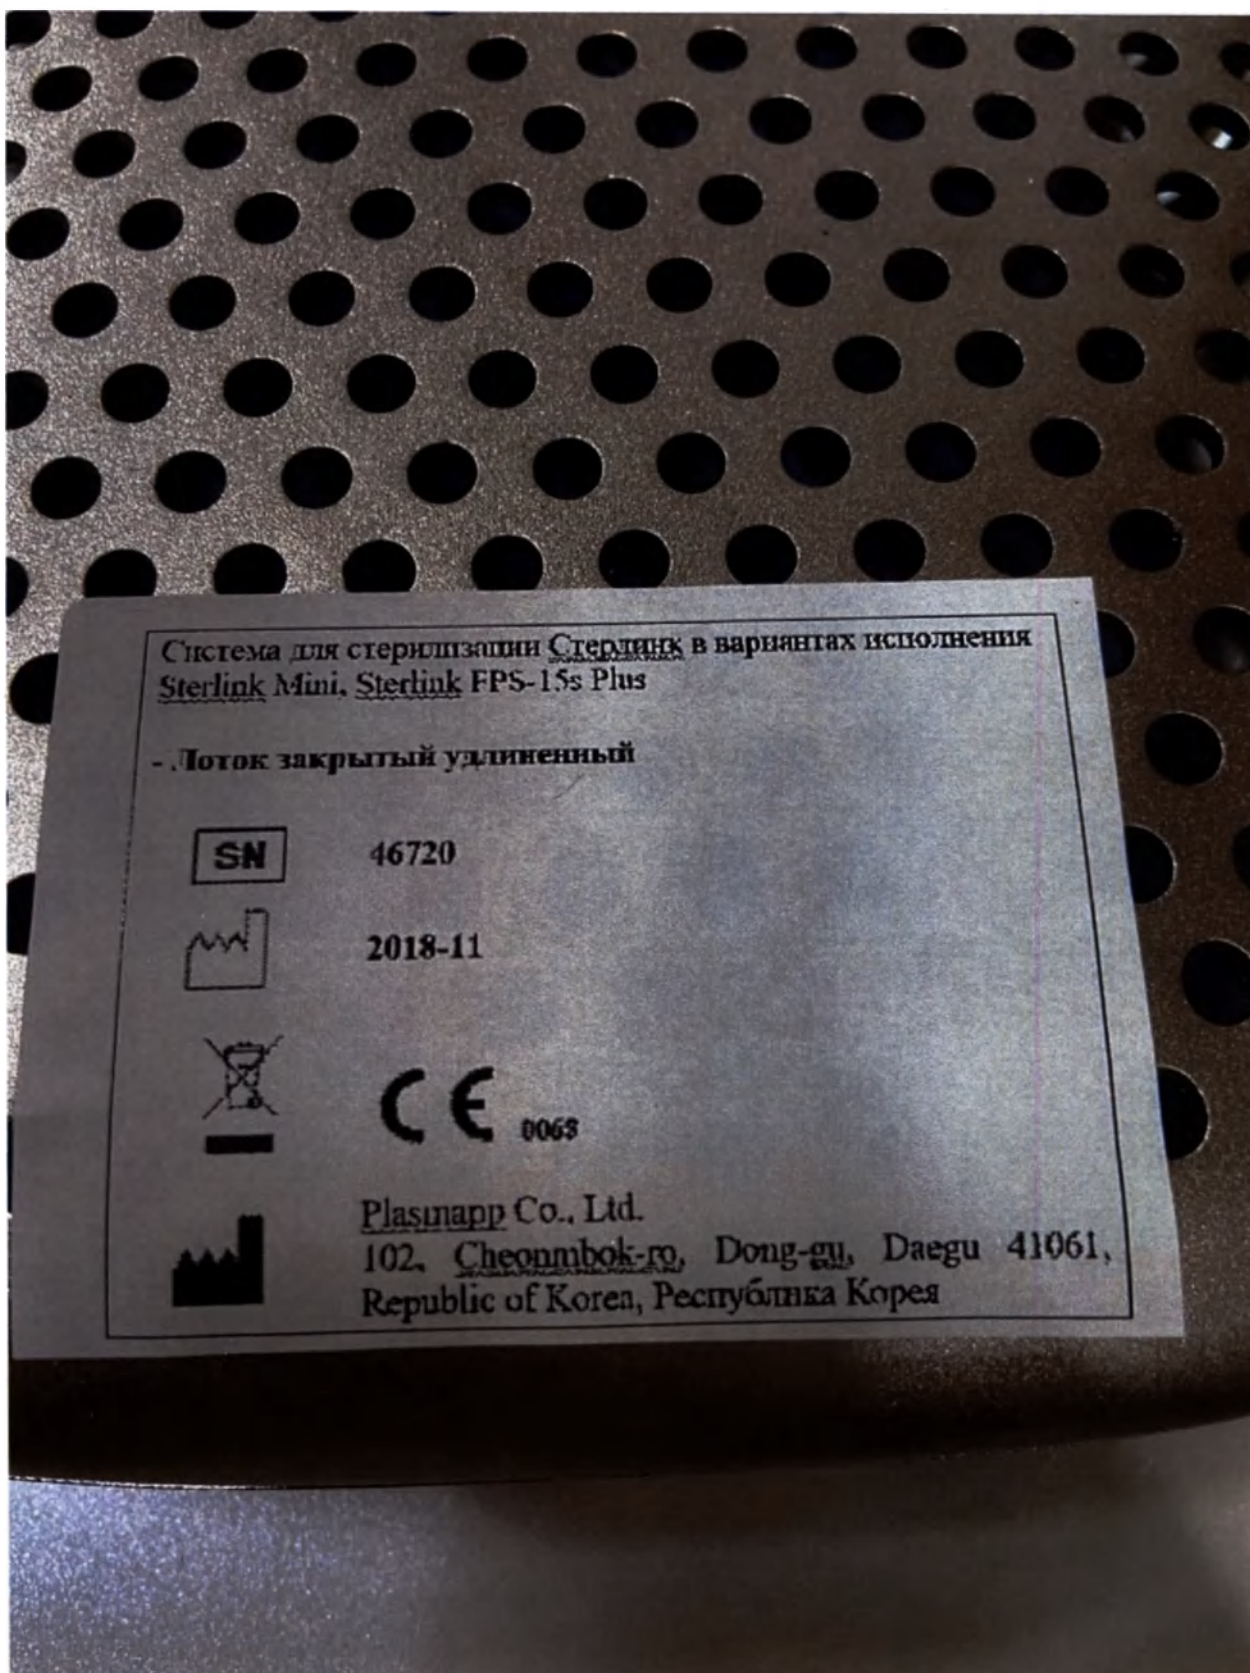

Система для стерилизации Стерлинк в вариантах исполнения
Sterlink Mini, Sterlink FPS-15s Plus

- Лоток закрытый удлиненный

SN

46720



2018-11



CE 0063



Plasinapp Co., Ltd.

102, Cheonmbok-ro, Dong-gu, Daegu 41061,
Republic of Korea, Республика Корея

Рисунок 4 - Лоток закрытый удлиненный

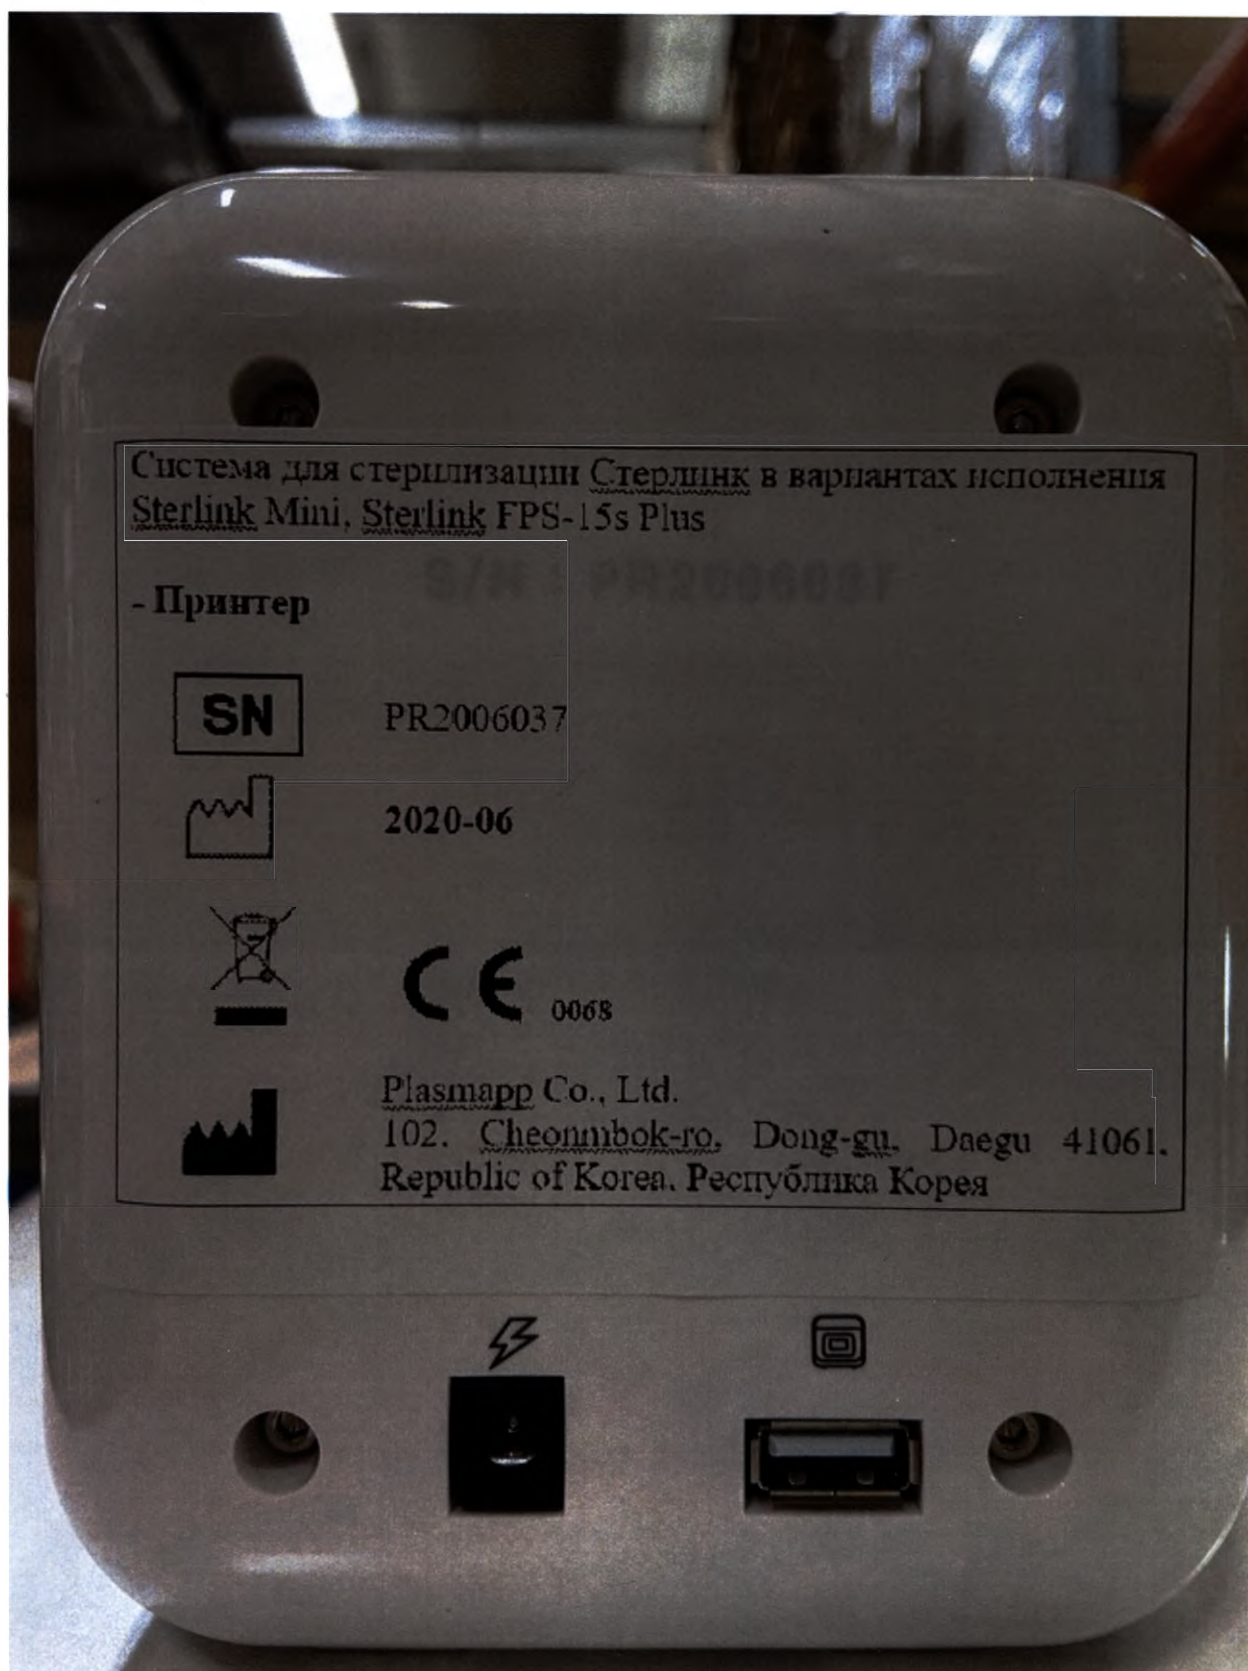


Рисунок 5 — Принтер

Рисунок 6 - Сумка



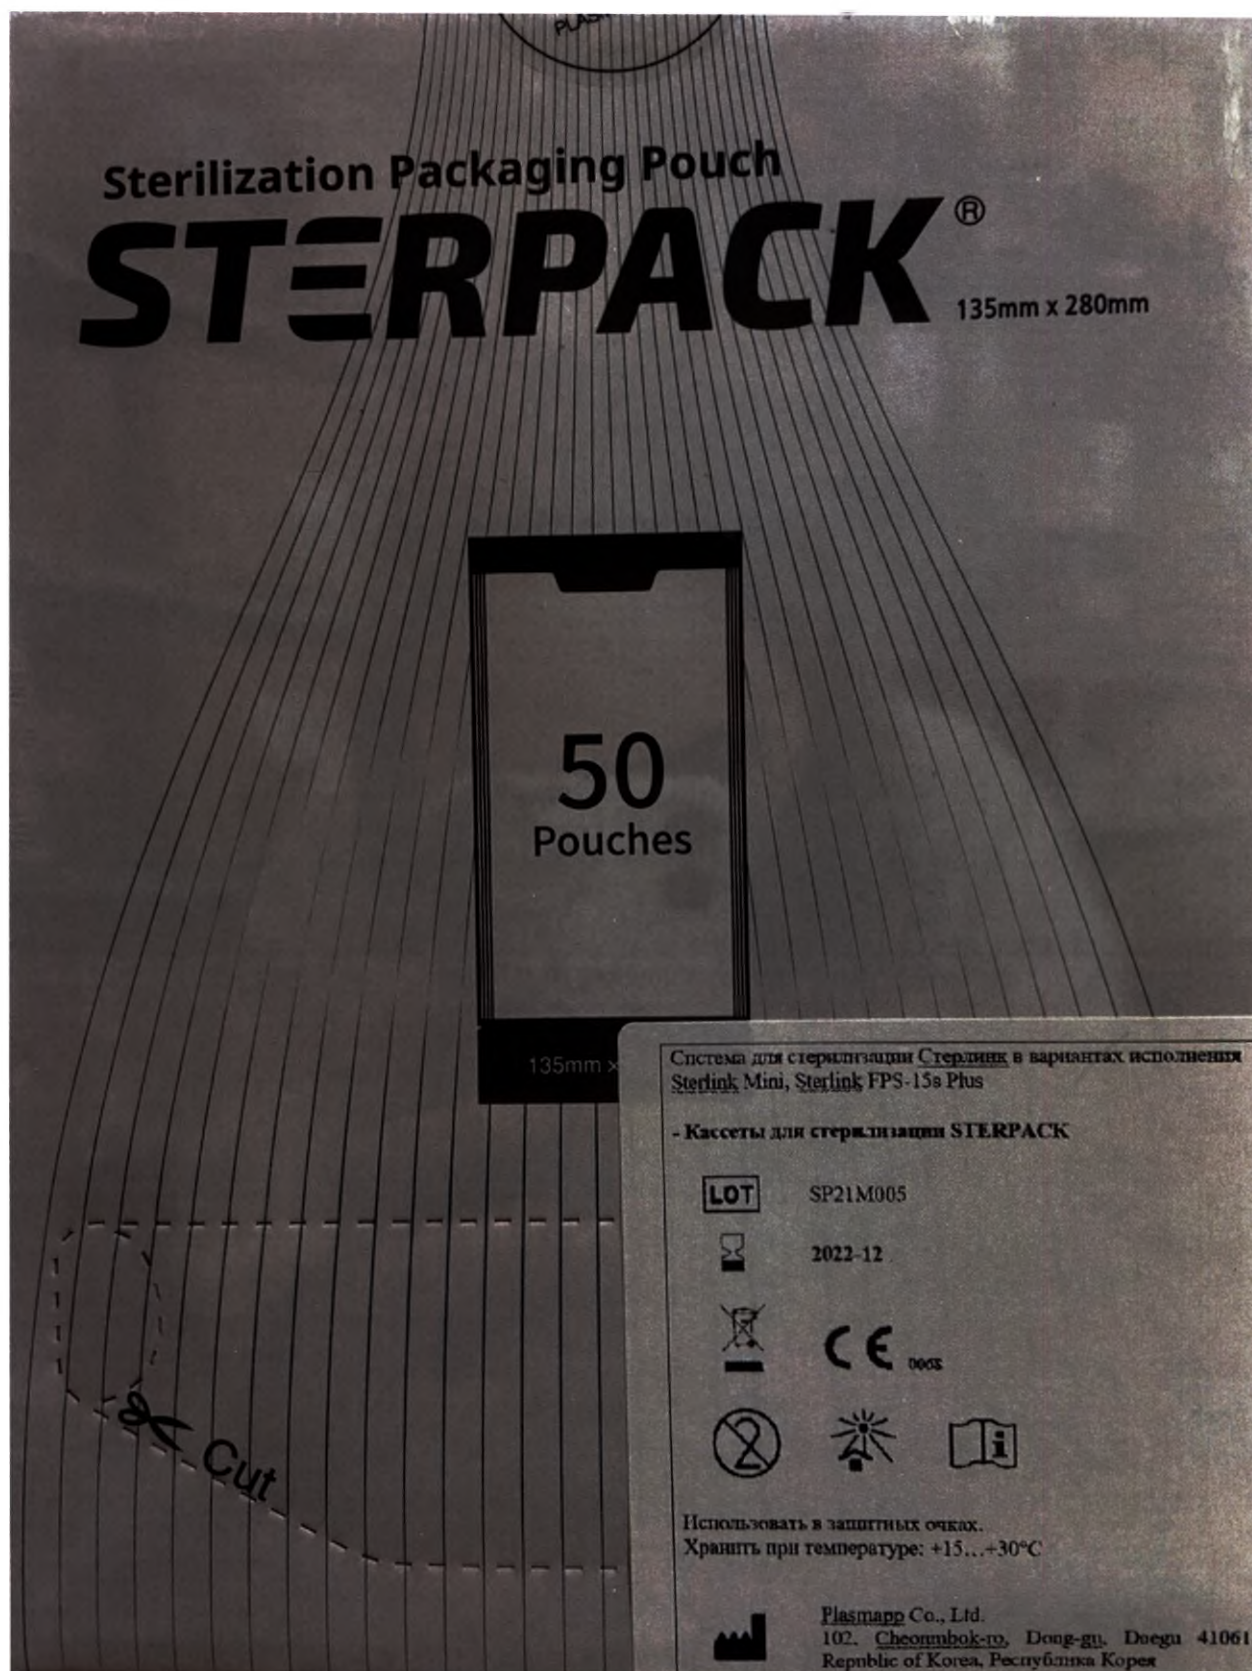


Рисунок 7 - Кассеты для стерилизации STERPACK

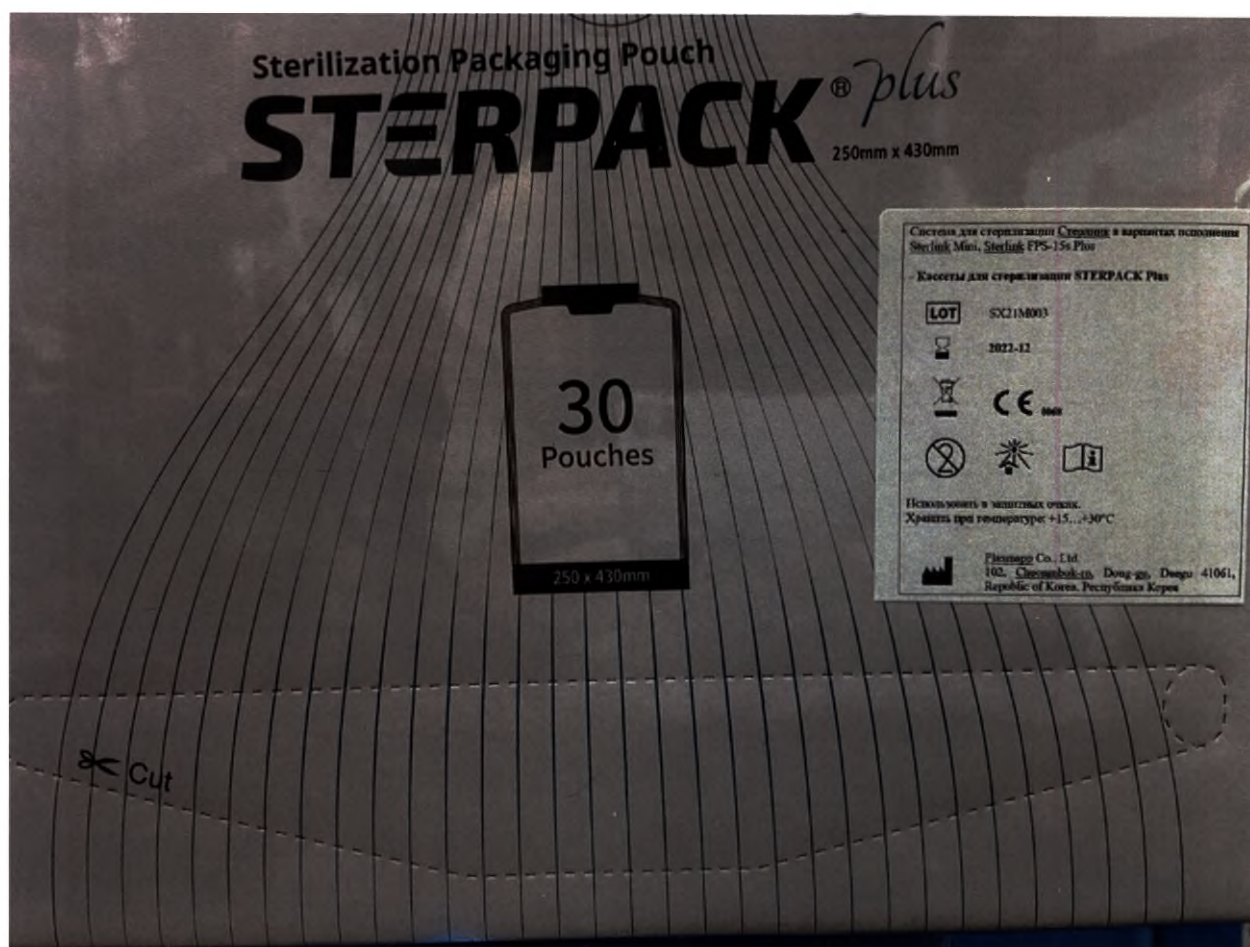


Рисунок 8 - Кассеты для стерилизации STERPACK Plus

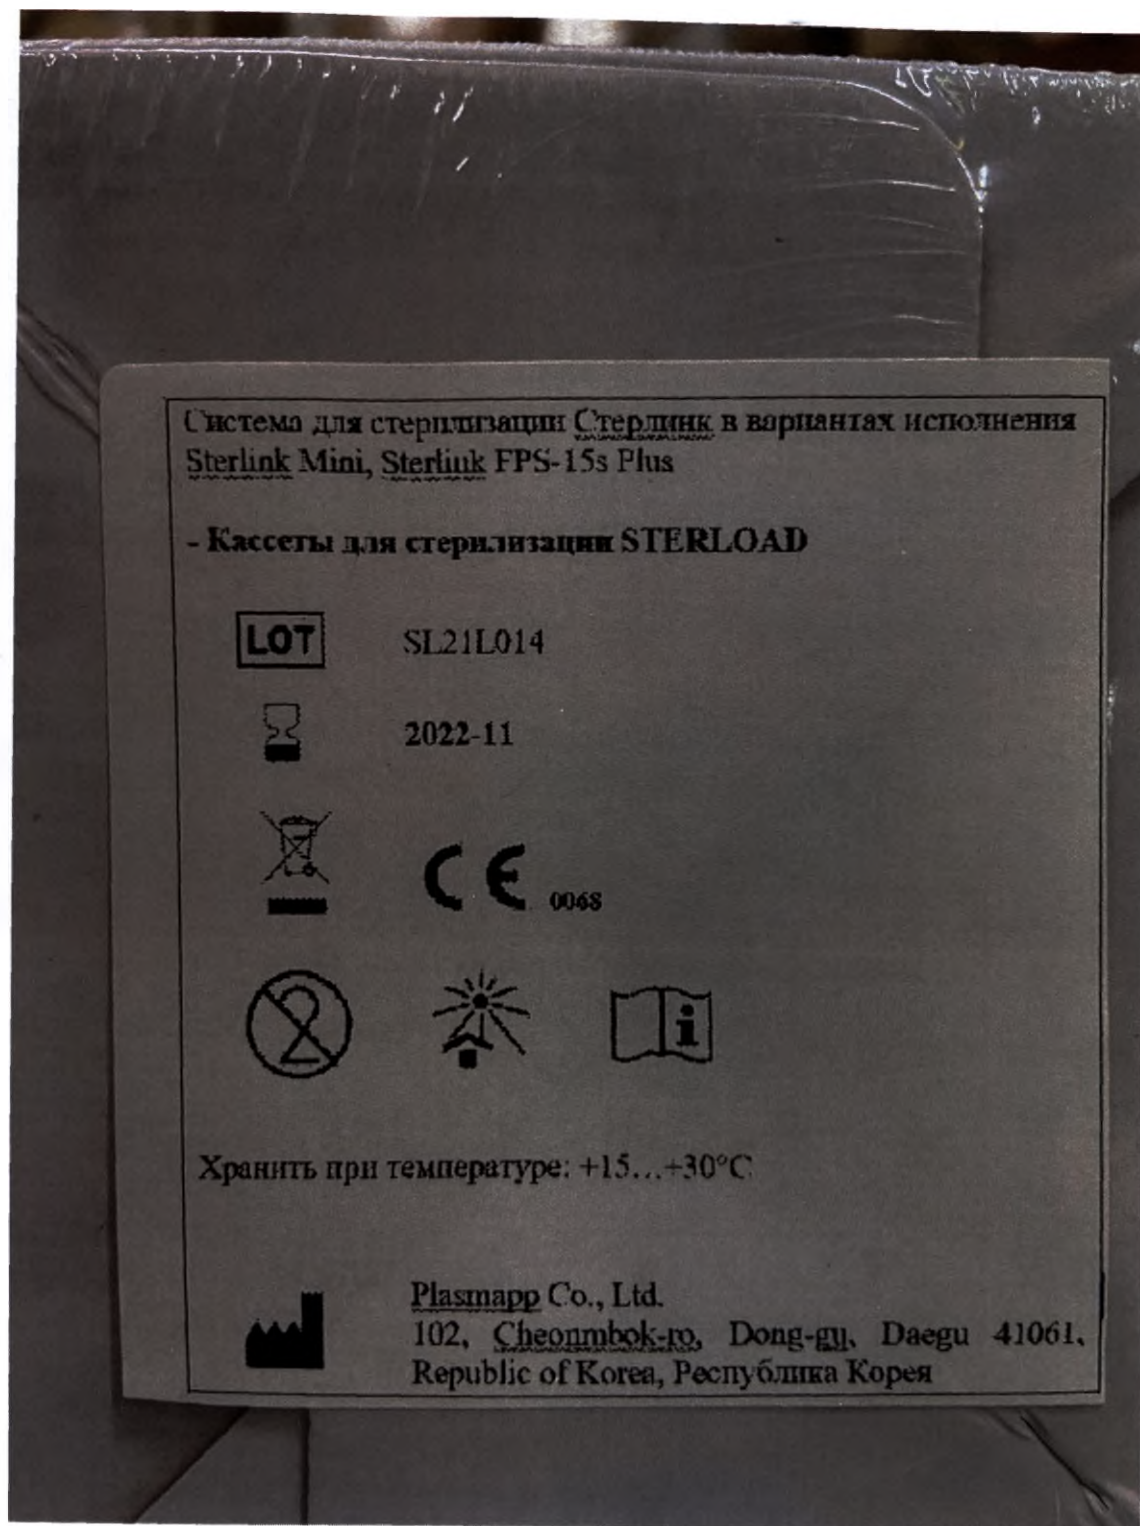


Рисунок 9 - Кассеты для стерилизации STERLOAD

Система для стерилизации Стерлинк в вариантах исполнения
Sterlink Mini, Sterlink FPS-15s Plus

- Пакеты для стерилизации маленькие
Размер: 100x400 мм

LOT

TY20A001



2020-12



CE 0069



Plasmapp Co., Ltd.

102, Cheonmbok-ro, Dong-gu, Daegu 41061,
Republic of Korea, Республика Корея

Рисунок 10 - Пакеты для стерилизации маленькие



Рисунок 11 - Химическая индикаторная лента


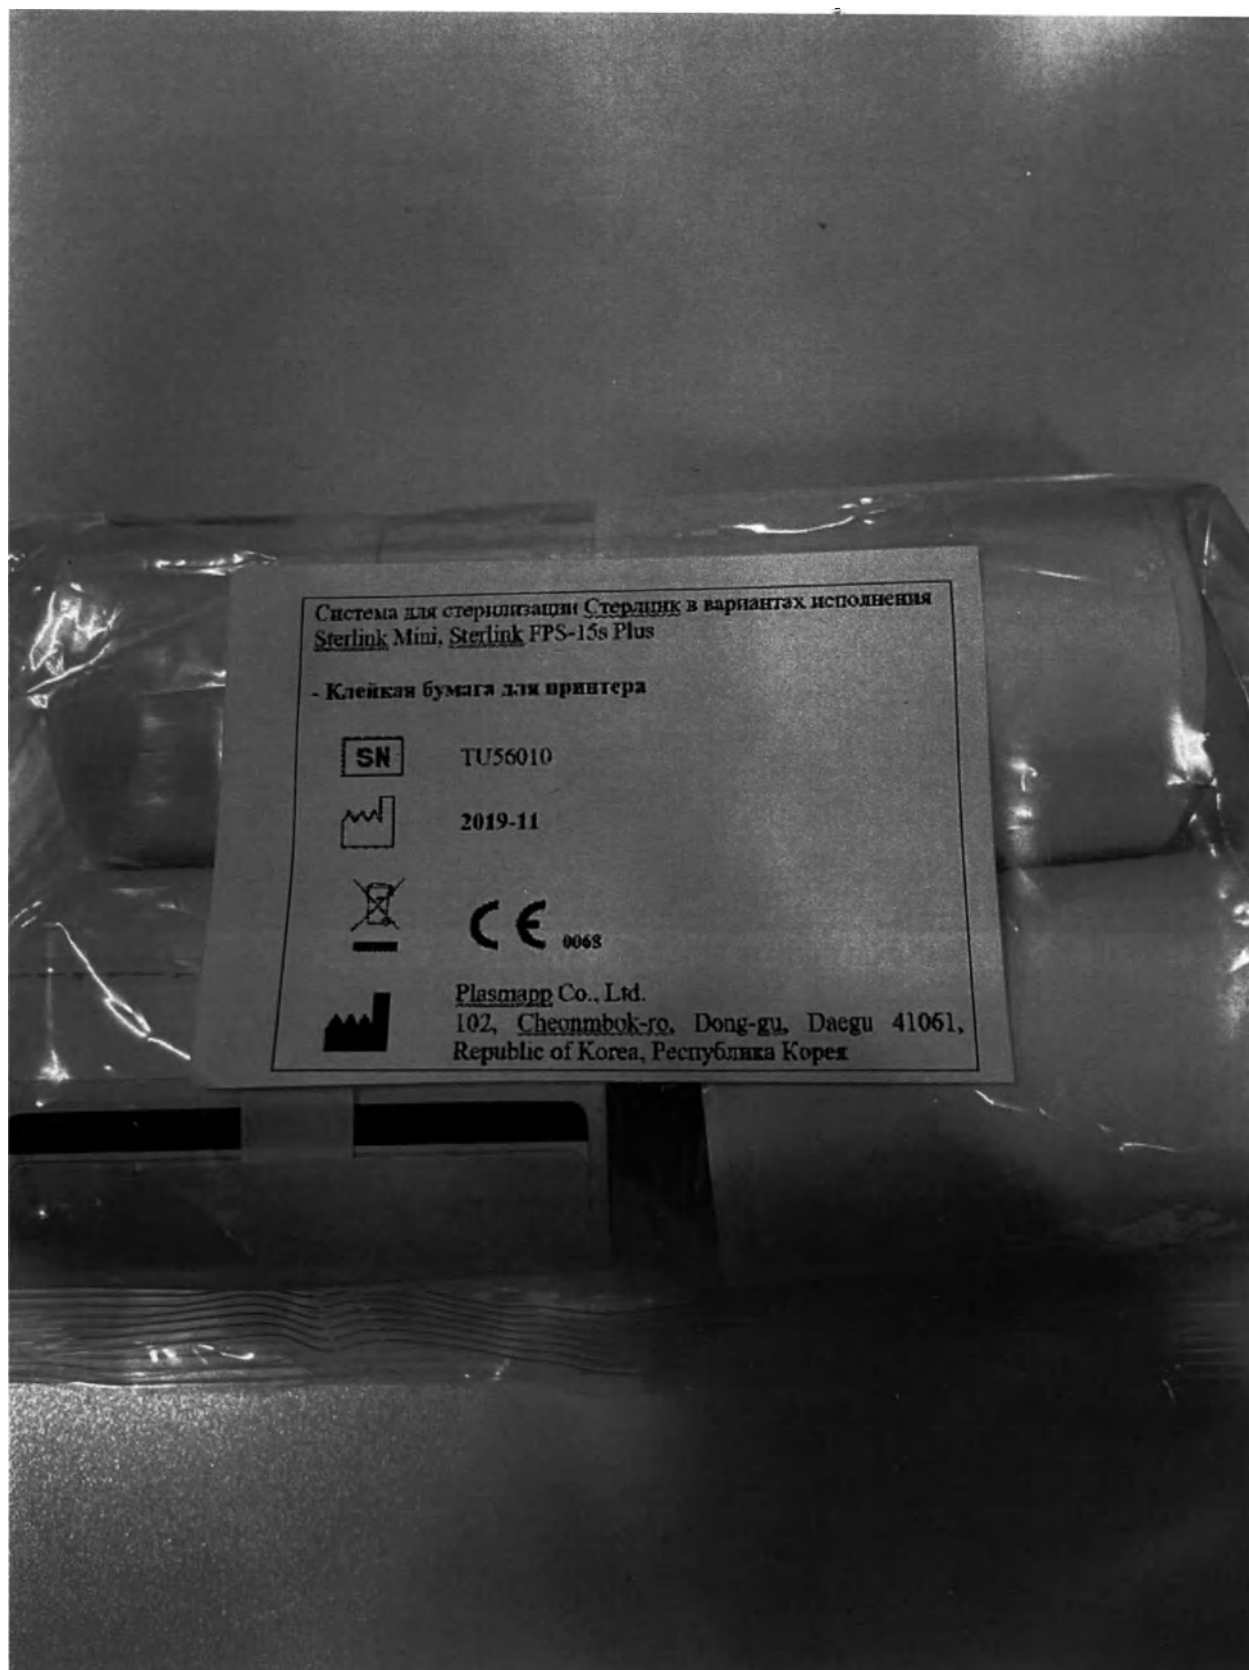


Рисунок 12 - Клейкая бумага для принтера

riasmapp

Tyvek® Pouch WITH CI

for STERLINK®



300 mm x 400 mm
11.8 in. x 15.7 in.

60 Pouches

Система для стерилизации Sterilink® в вертикальном положении
Sterilink Mini, Sterilink FPS-150 Plus
• Пакеты для стерилизации большие
Размер: 300x400 мм

LOT TY20A001
2019-12
CE
Pacemag Co., Ltd.
190, Chosunhobok-ro, Dong-gu, Daegu 41061,
Republic of Korea, Pechenyina Korea



Рисунок 13 - Пакеты для стерилизации большие

riasmapp

Tyvek® Pouch

for STERLINK®



100 mm x 400 mm
3.9 in. x 15.7 in.

120 Pouches

Система для стерилизации Sterilink® в вертикальном положении
Sterilink Mini, Sterilink FPS-150 Plus
• Пакеты для стерилизации маленькие
Размер: 100x400 мм

LOT TY20A001
2019-12
CE
Pacemag Co., Ltd.
190, Chosunhobok-ro, Dong-gu, Daegu 41061,
Republic of Korea, Pechenyina Korea

Рисунок 14 - Пакеты для стерилизации маленькие


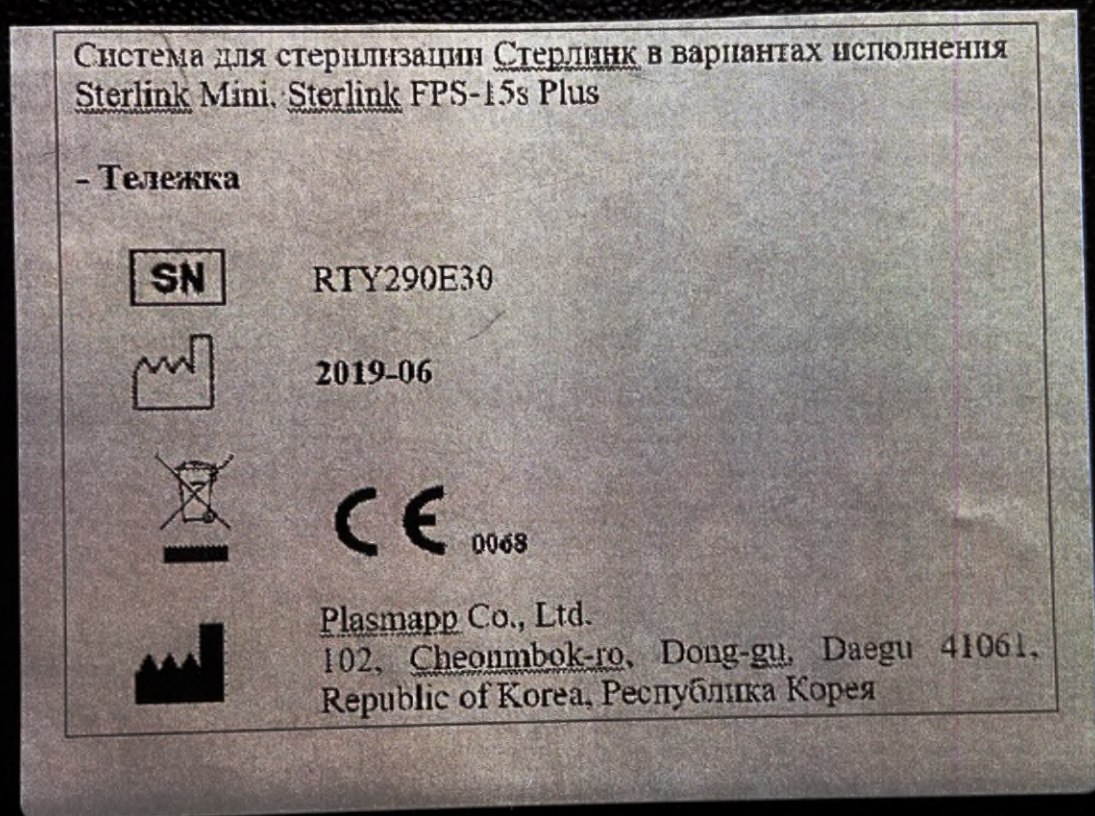


Рисунок 15 - Тележка

Система для стерилизации Стерлинк в вариантах исполнения
Sterlink Mini, Sterlink FPS-15s Plus

- Упаковочная машина



512036



2018-11



Plasmap Co., Ltd.

102, Cheonmbok-ro, Dong-gu, Daegu 41061,
Republic of Korea, Республика Корея

Рисунок 16 - Упаковочная машина

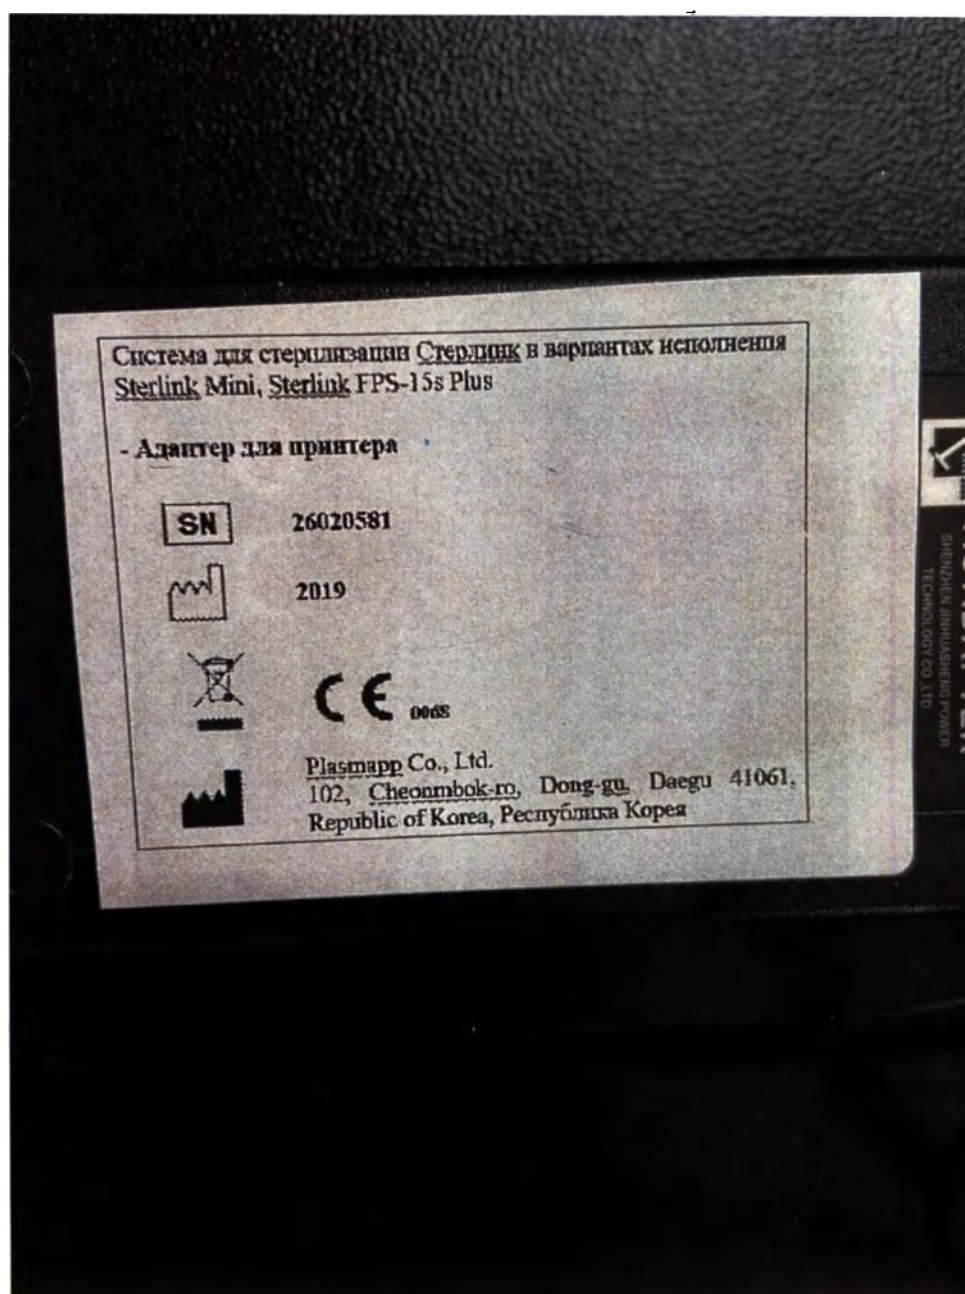


Рисунок 17 – Адаптер для принтера



Рисунок 19 - Сетевой кабель

Прошито, пронумеровано
39 (тридцать девять)

лист (а/об)

Скреплено печатью.

