

Руководитель группы по регистрации продукции
для in vitro диагностики, биохимия и
портативные системы в диагностике,

Тышкунова Е.С.

Е.С. Тышкунова
«20» марта

2024 г.



Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор калибраторов специфических белков для анализаторов биохимических серии
Atellica (Atellica CH Liquid Specific Protein Calibrators (Atellica CH LSP CAL))



Рисунок 1. Набор калибраторов специфических белков для анализаторов биохимических серии Atellica (Atellica CH Liquid Specific Protein Calibrators (Atellica CH LSP CAL)): общий вид изделия

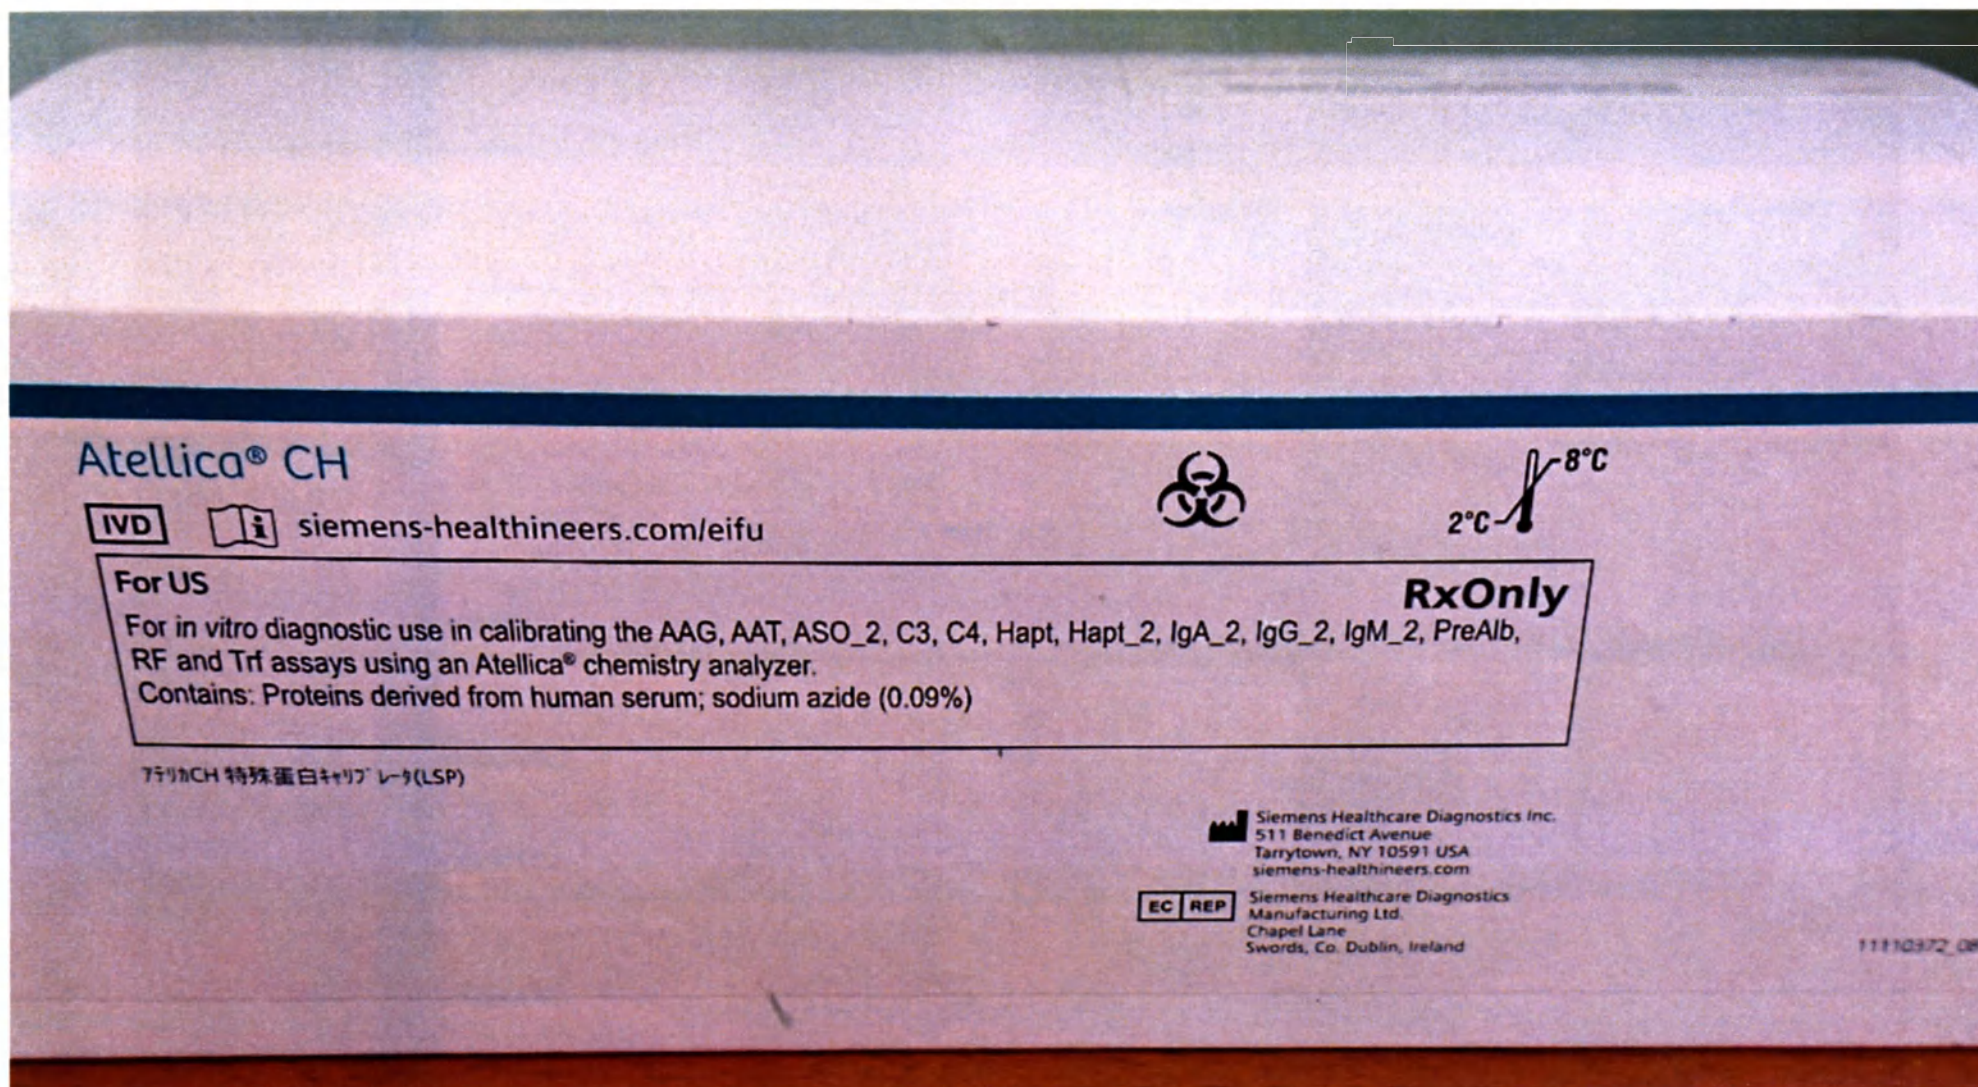


Рисунок 2. Набор калибраторов специфических белков для анализаторов биохимических серии Atellica (Atellica CH Liquid Specific Protein Calibrators (Atellica CH LSP CAL)): маркировка медицинского изделия



LSP CAL

CAL LOT VAL
REVISION 1
MATERIAL LSP CAL
MATERIAL ID 24

LOT 622000
2025-09-28
REF 11099434

1

	LOT	CAL 1	CAL 2	CAL 3	CAL 4	CAL 5	CAL 6
	3101T	3111T	3121T	3131T	3141T	3151T	
AAG	mg/dL	0.00	27.81	74.99	162.59	324.09	658.16
	g/L	0.00	0.28	0.75	1.63	3.24	6.58
ASO_2	IU/mL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	672.85
C3	mg/dL	0.00	27.77	58.65	122.73	260.96	528.48
	g/L	0.000	0.278	0.587	1.227	2.610	5.285
C4	mg/dL	0.00	8.11	17.07	35.17	72.42	146.44
	g/L	0.000	0.081	0.171	0.352	0.724	1.464
AAT	mg/dL	0.00	10.82	55.59	136.38	273.35	555.60
	g/L	0.00	0.11	0.56	1.36	2.73	5.56
Hapt	mg/dL	0	20	46	91	189	384
	g/L	0.00	0.20	0.46	0.91	1.89	3.84
Hapt_2	mg/dL	0	58	91	182	365	778
	g/L	0.00	0.58	0.91	1.82	3.65	7.78
IgA_2	mg/dL	0	29	77	159	311	635
	g/L	0.00	0.29	0.77	1.59	3.11	6.35
IgG_2	mg/dL	0	208	436	886	1806	3654
	g/L	0.00	2.08	4.36	8.86	18.06	36.54
IgM_2	mg/dL	0	21	45	95	199	400
	g/L	0.00	0.21	0.45	0.95	1.99	4.00

Рисунок 4 Набор калибраторов специфических белков для анализаторов биохимических серии Atellica (Atellica CH Liquid Specific Protein Calibrators (Atellica CH LSP CAL)): лист значений параметров серии калибратора

11099434

Набор калибраторов специфических белков для анализаторов
биохимических серии Atellica (Atellica CH Liquid Specific Protein
Calibrators (Atellica CH LSP CAL))

Информация о производителе и стране производства:

см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2022/16799 от 01.04.2022

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Rev. 03

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:
ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 5 Русскоязычная маркировка медицинского изделия

Всего прошито и пронумеровано
6 листа (ов).

ООО «Сиенс Здоровоохранение»

