



ООО «БиСиКей-Эм»

119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 41, стр. 1, офис 704

т/ф: (495) 646-89-23

e-mail: info@bck-m.ru

www.bck-m.ru

Генеральный директор
ООО «БиСиКей-Эм»

М.Ю. Васильева



М.П.

11 октября 2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Аппарат ультразвуковой офтальмологический диагностический HiScan Touch в вариантах исполнения


2021 г.

I. Аппарат ультразвуковой офтальмологический диагностический HiScan Touch Basic, в составе:


1. Блок основной – 1 шт.



2. Кабель питания – 1 шт.

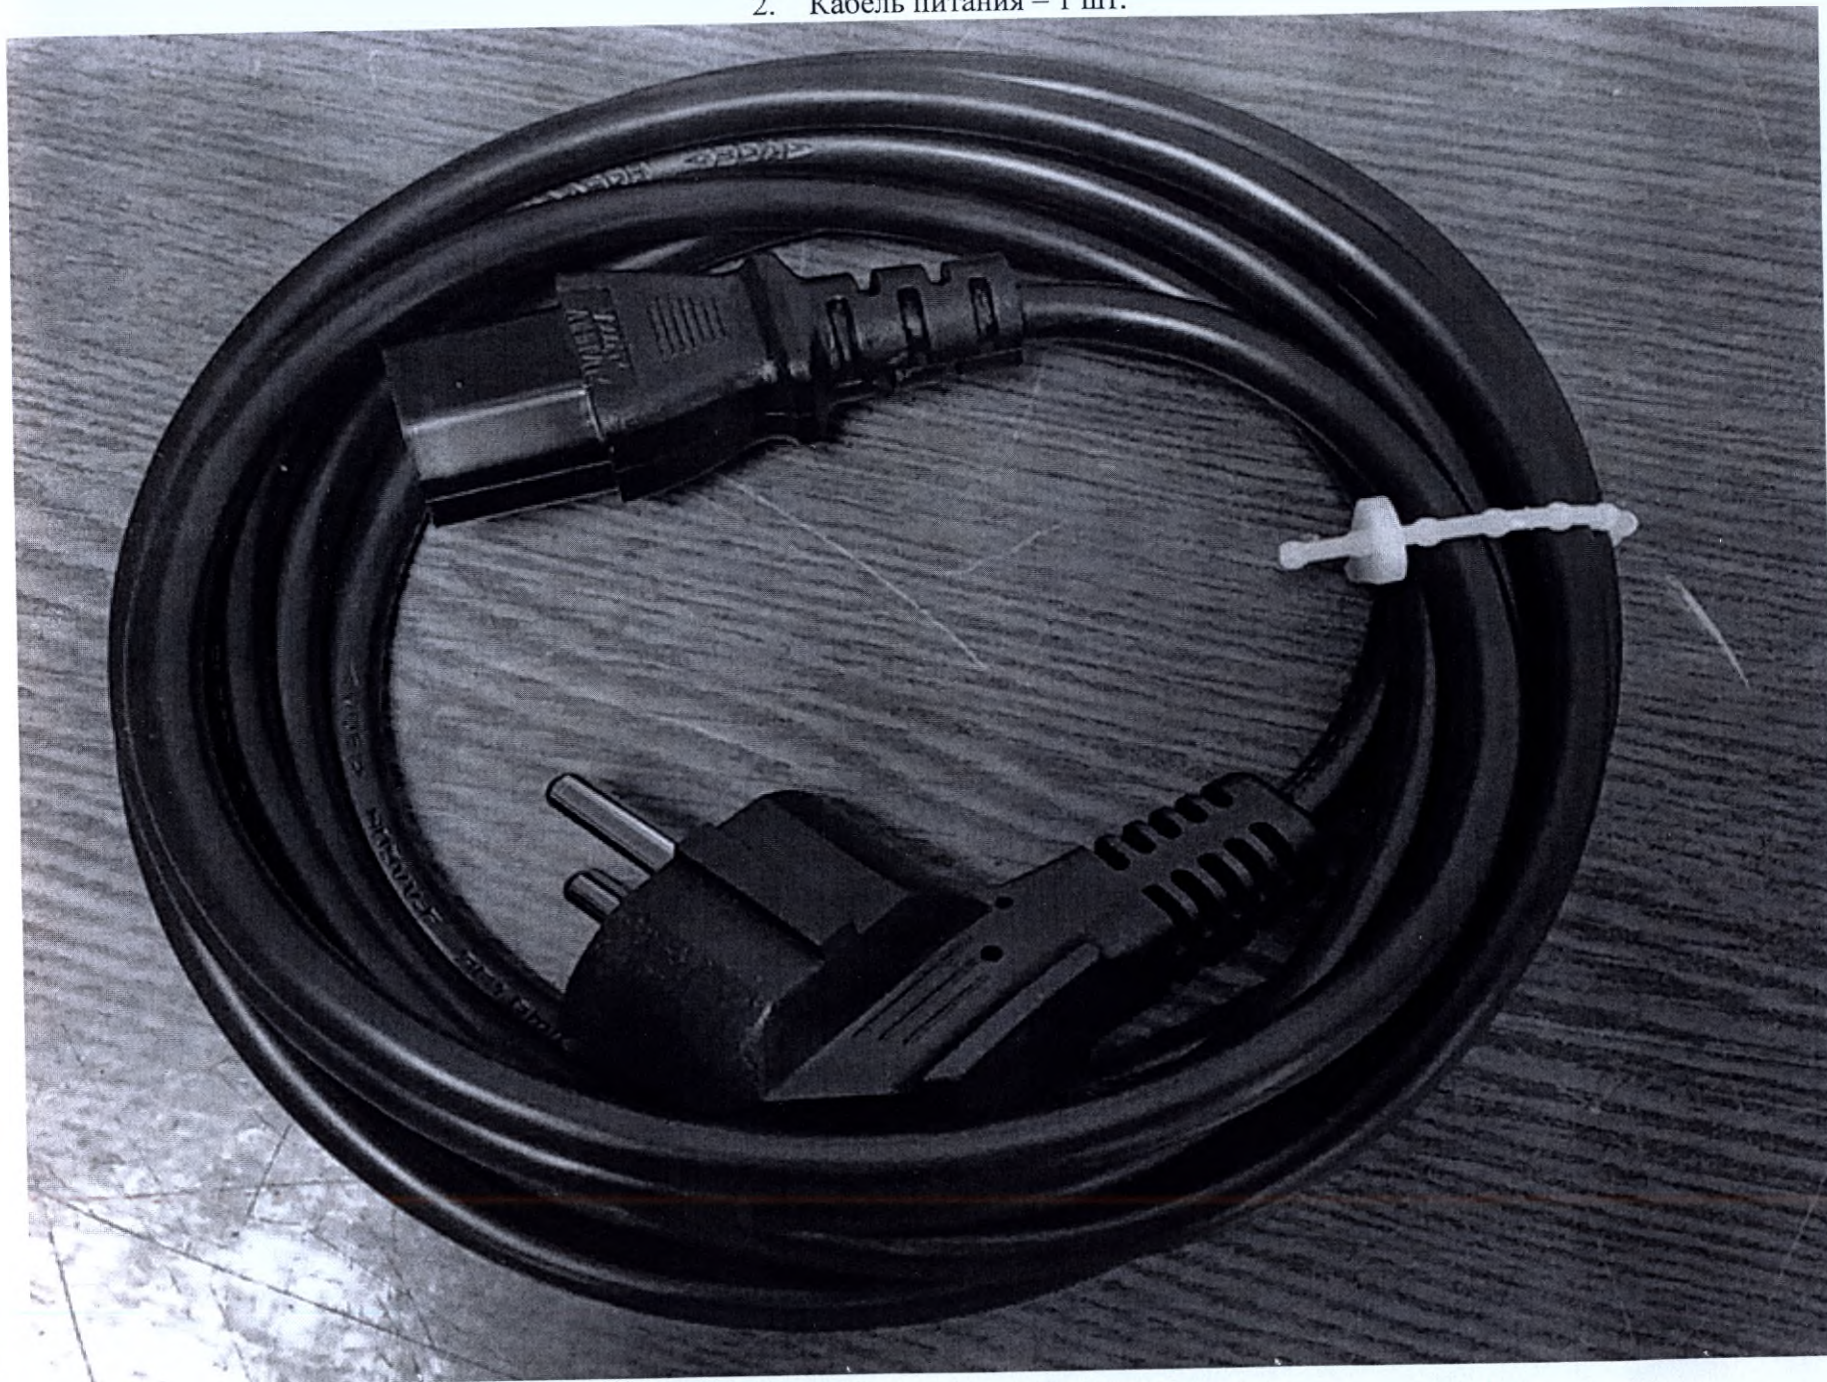


3. Педаль ножная – 1 шт.

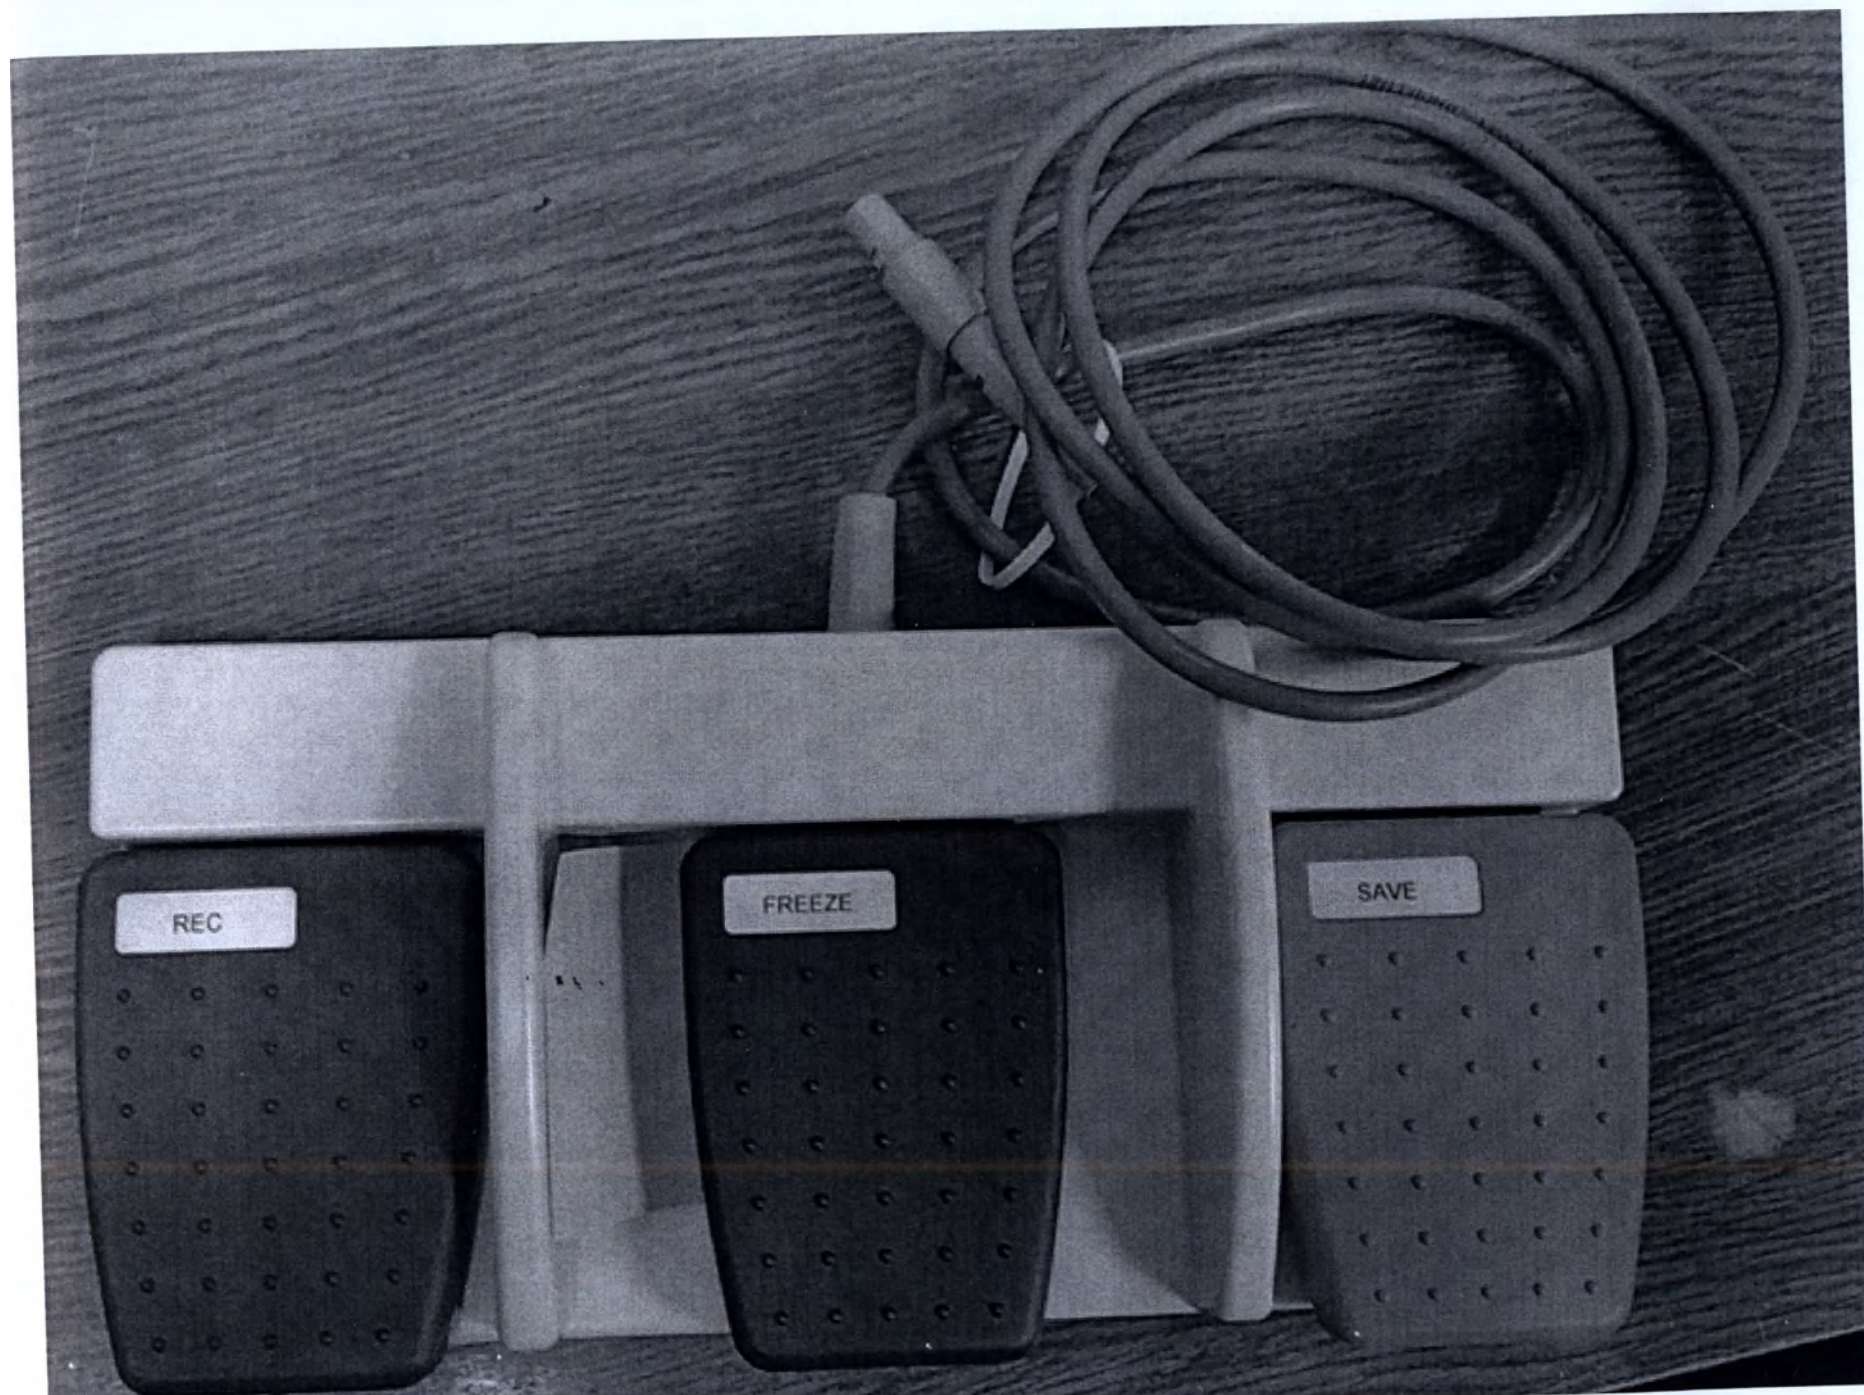


4. Предохранитель— 2 шт.




5. Чехол защитный – 1 шт.

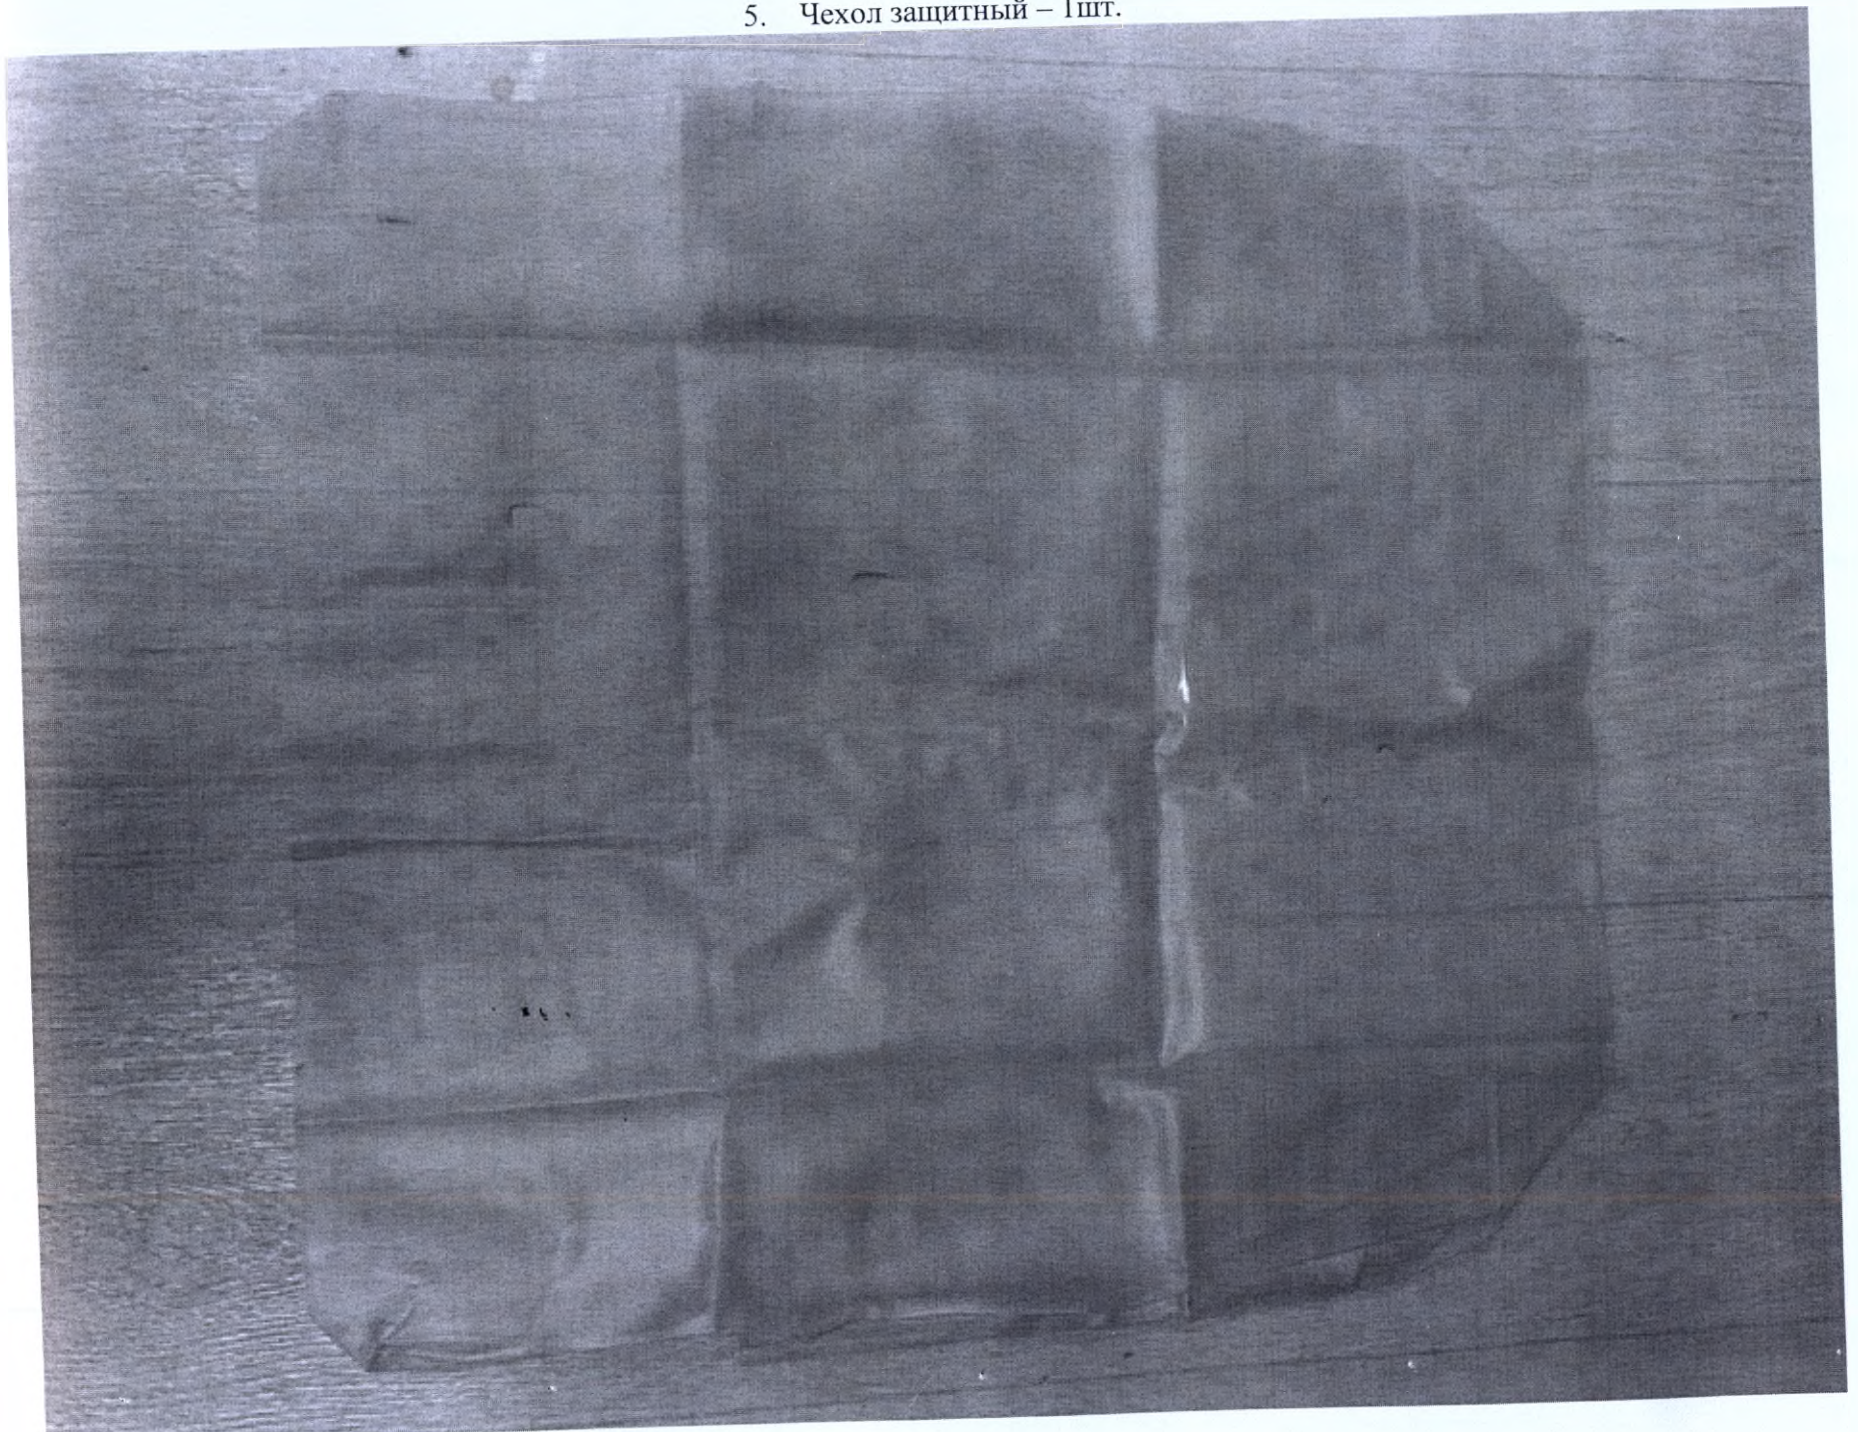

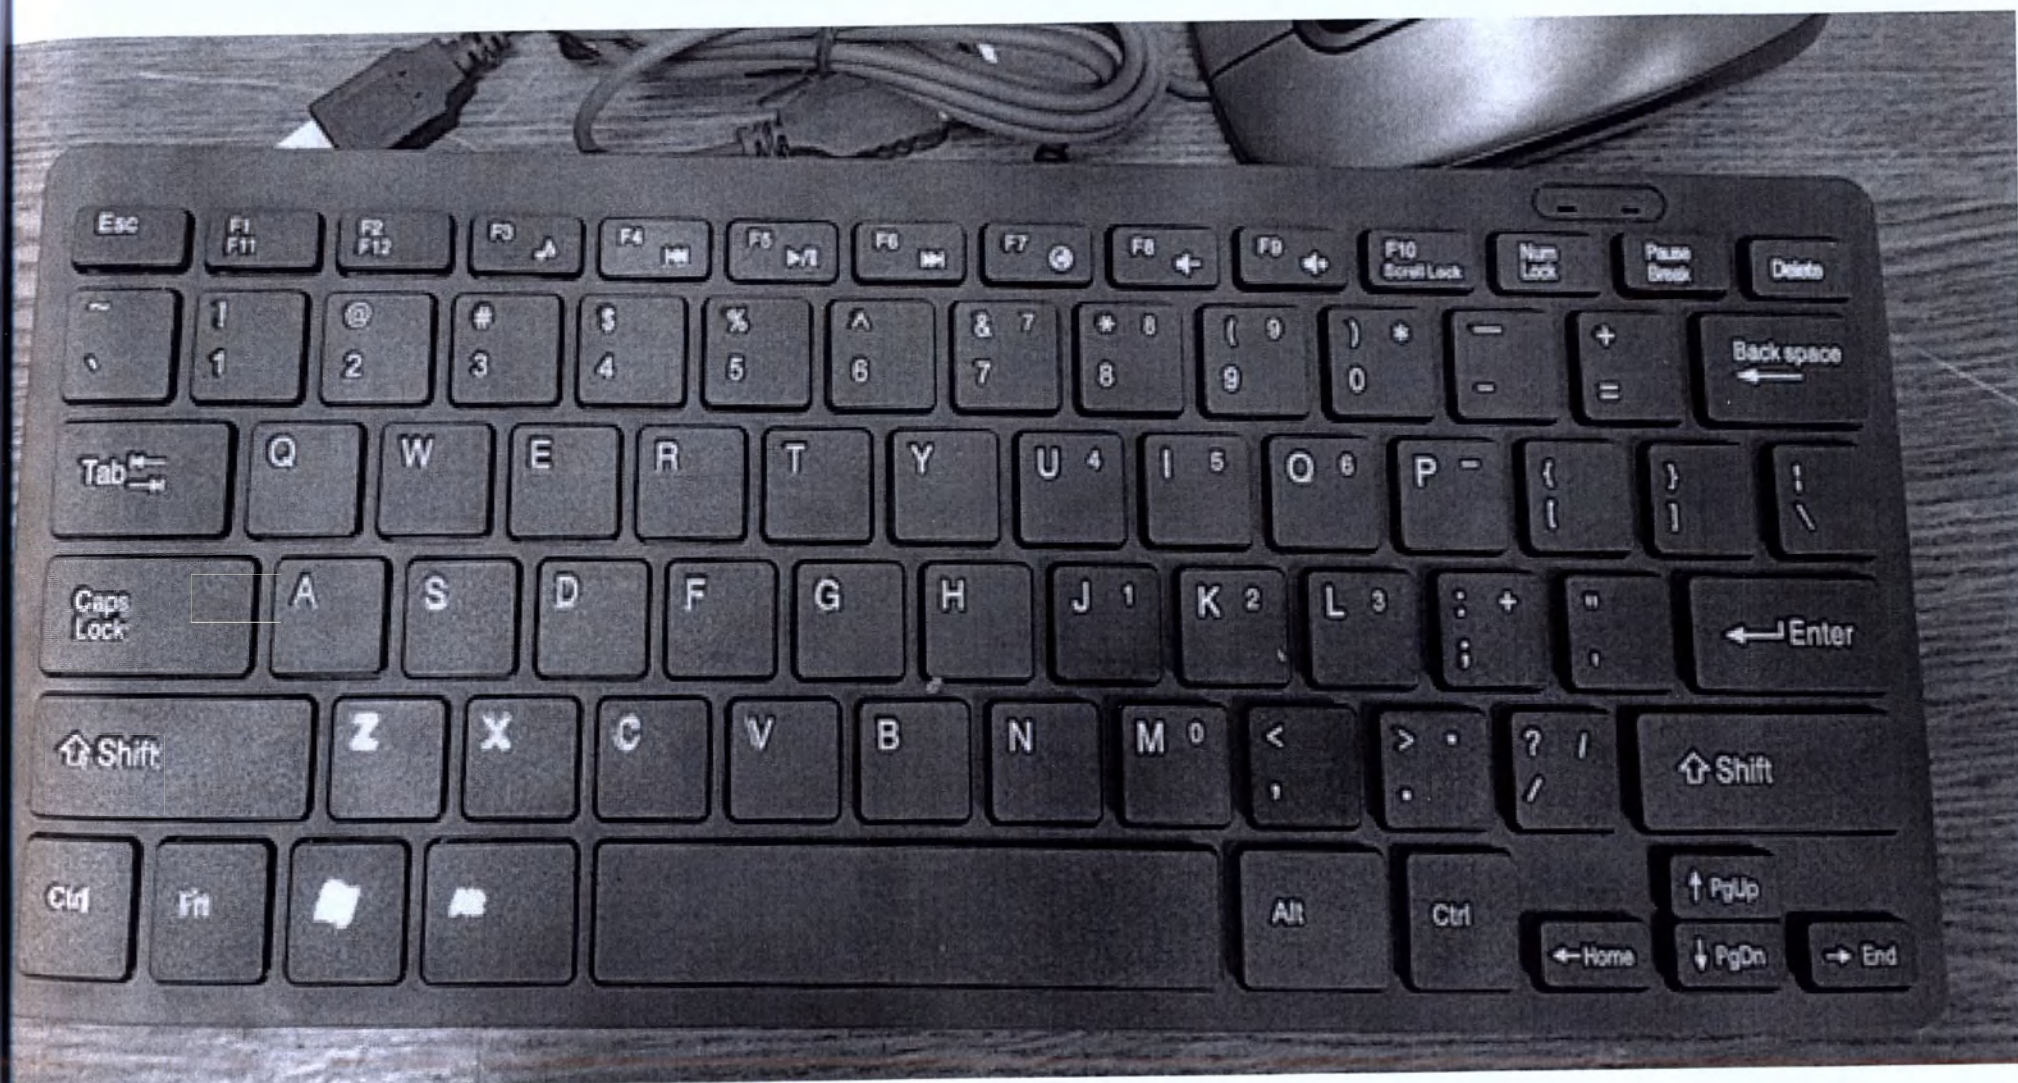

7. Мышь – 1 шт.

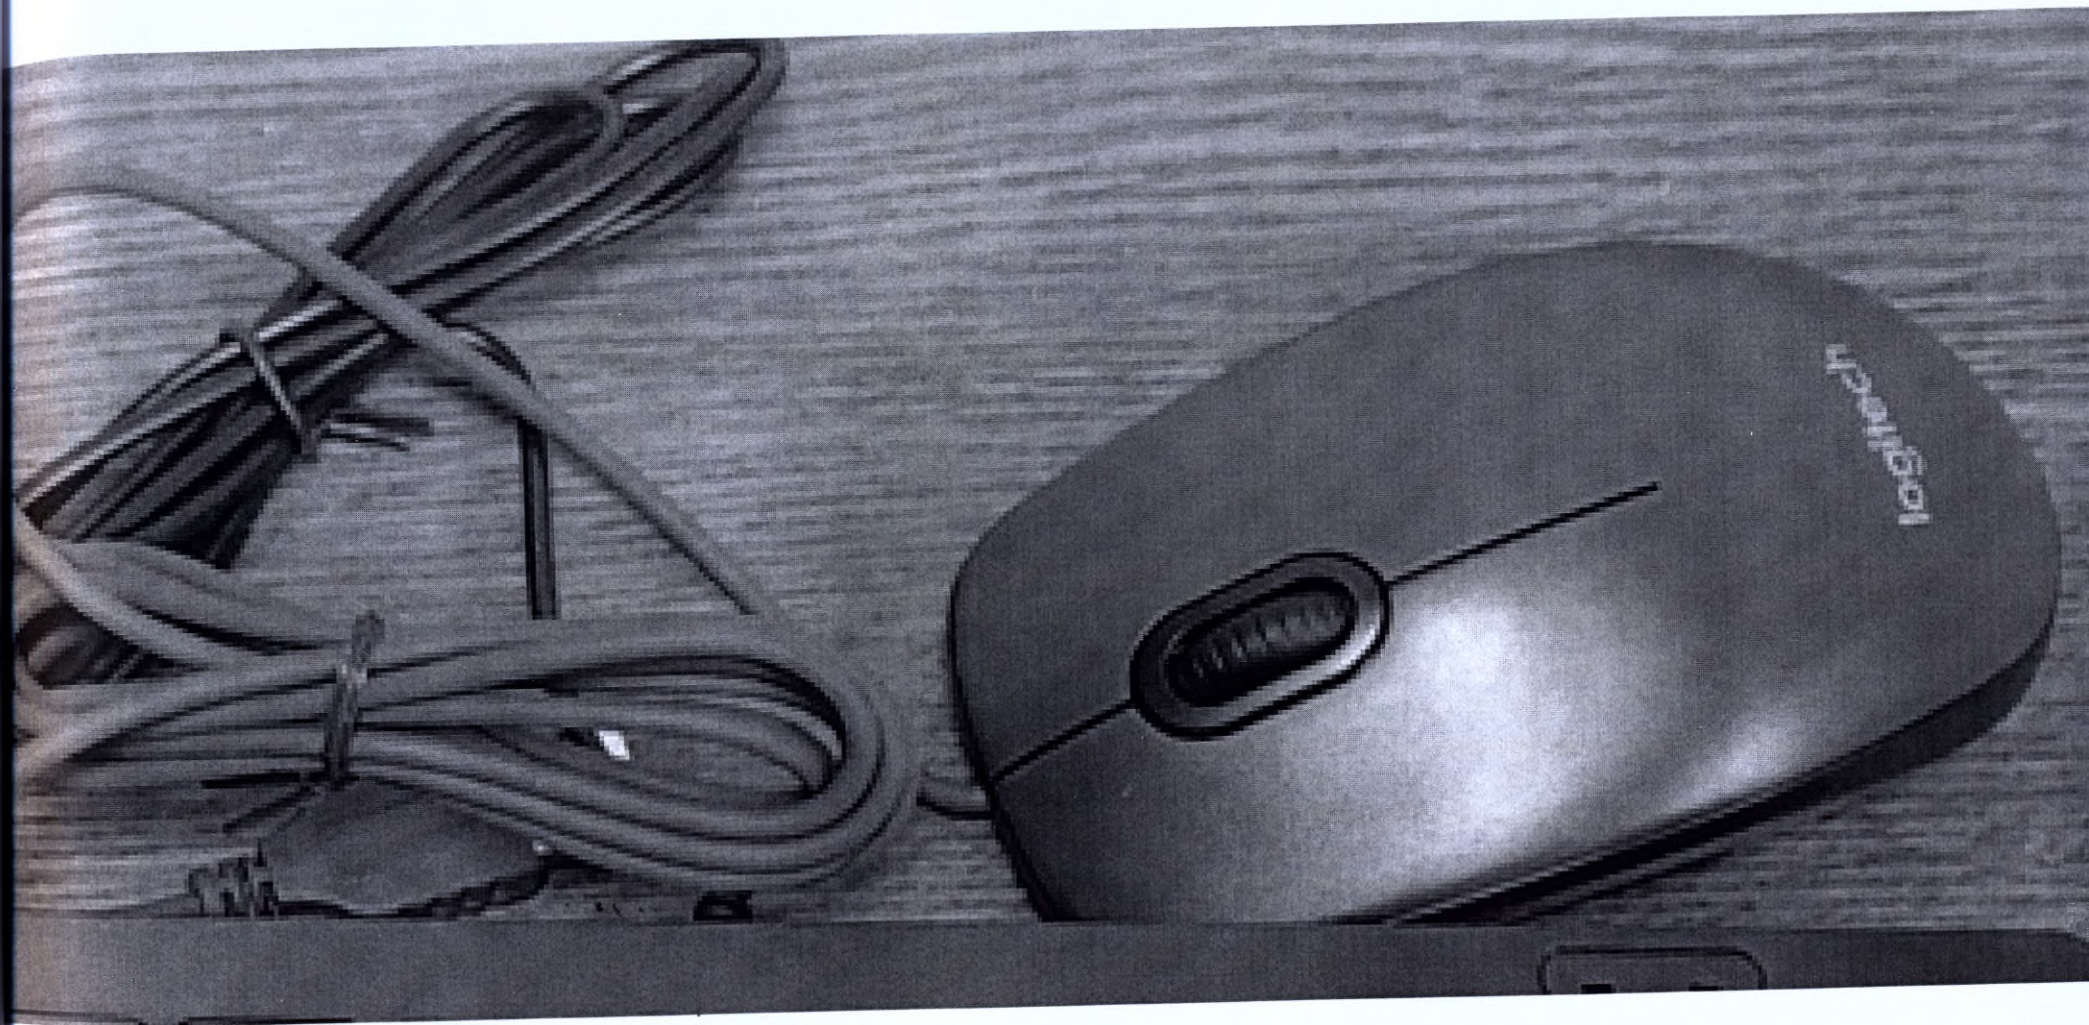

Cod 14101XEN
2018-08-24 Rev.D

С Е
0051




HiScan Touch


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АППАРАТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ HiSCAN TOUCH В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

ОПТИКОН 2000 С.п.А.


9. Рукоятка для биометрии – 1шт. (при необходимости)

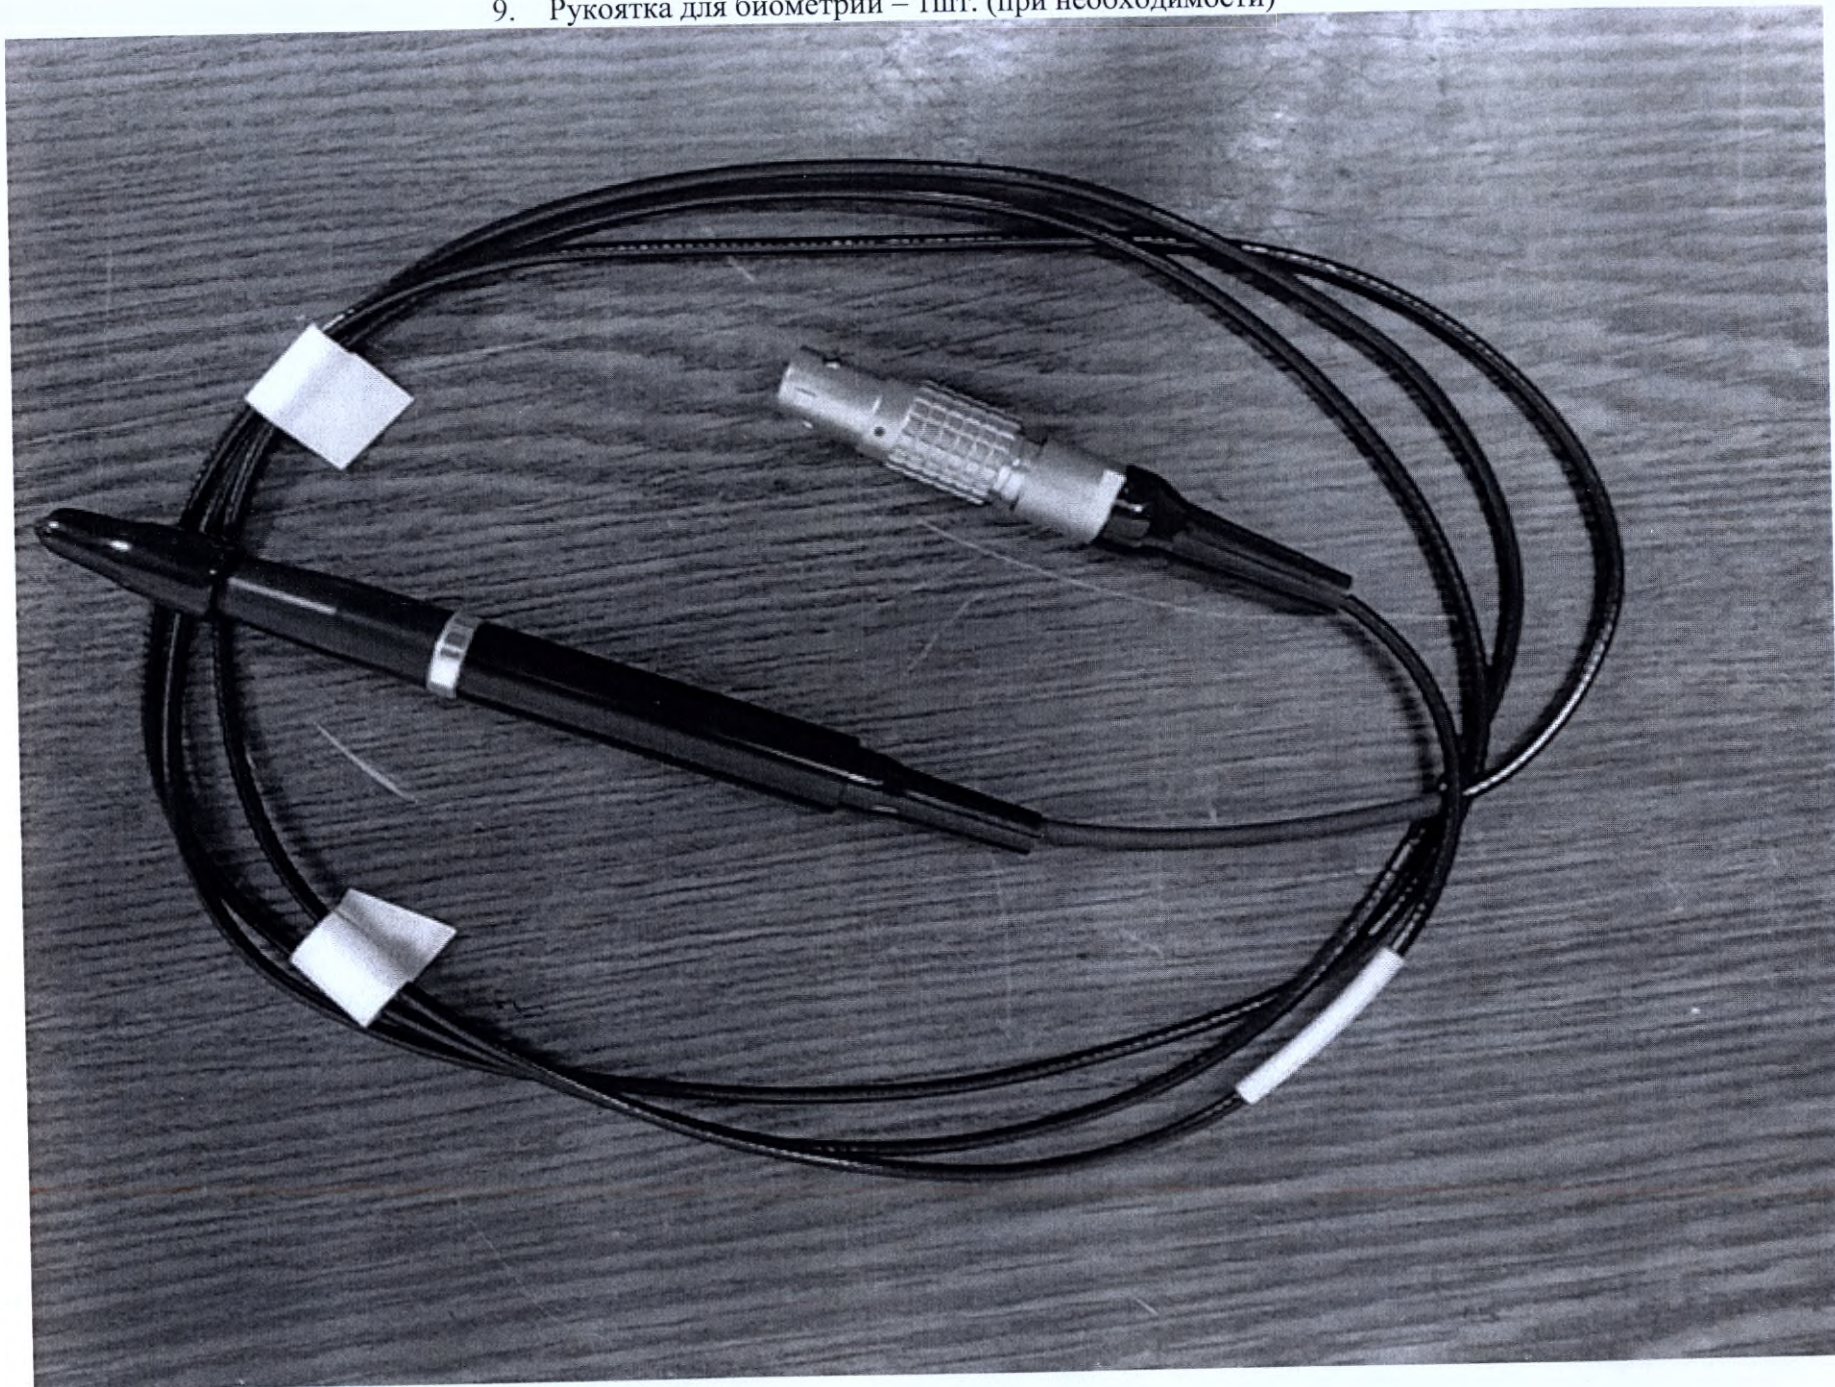


10. А-скан рукоятка диагностическая – 1 шт. (при необходимости)

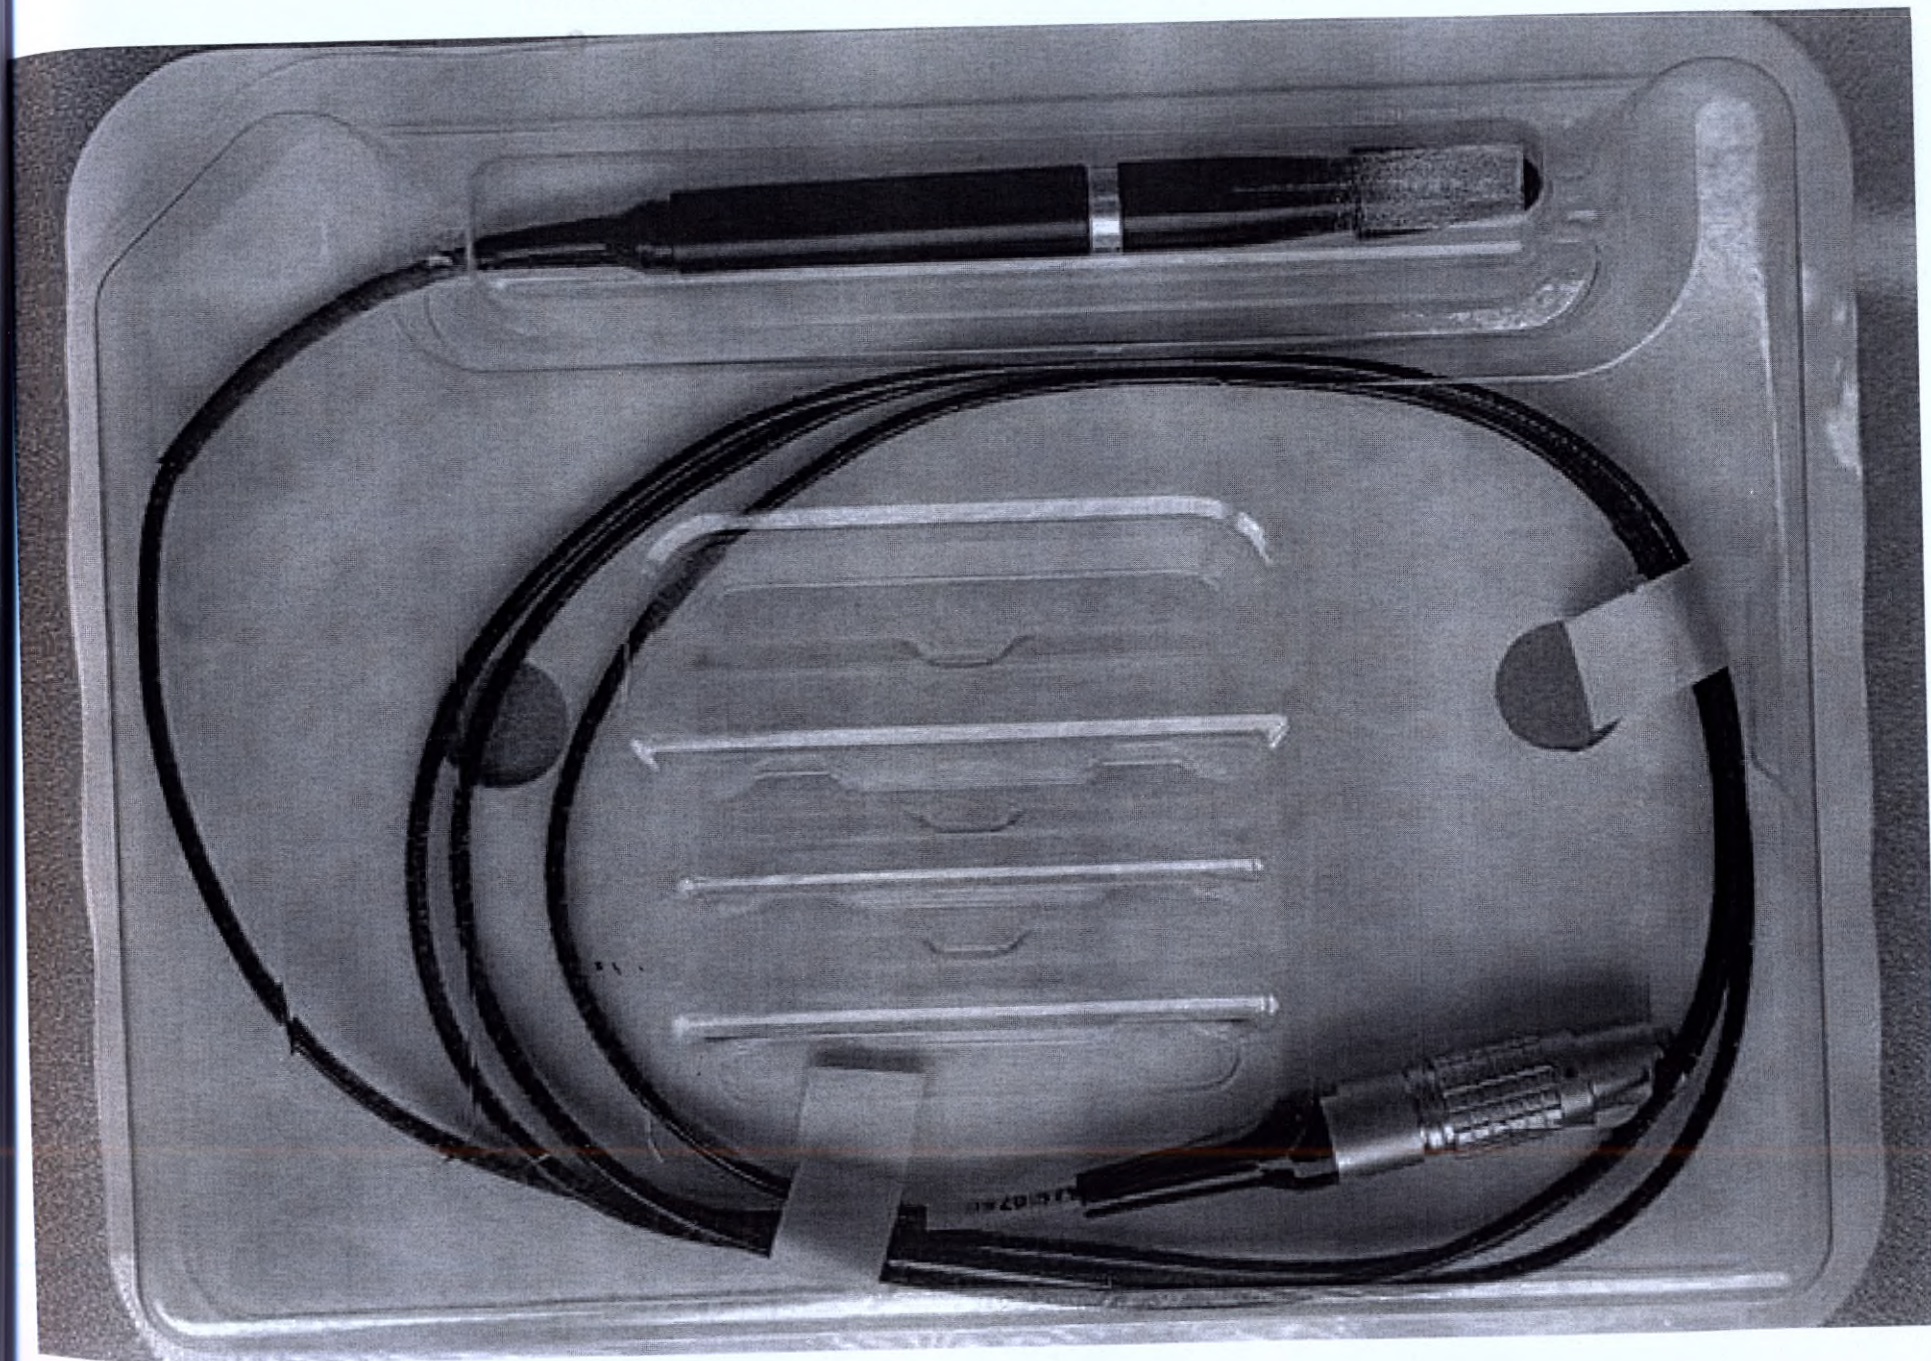

11. Кабель соединительный для Б-скан рукоятки – 1 шт. (при необходимости)

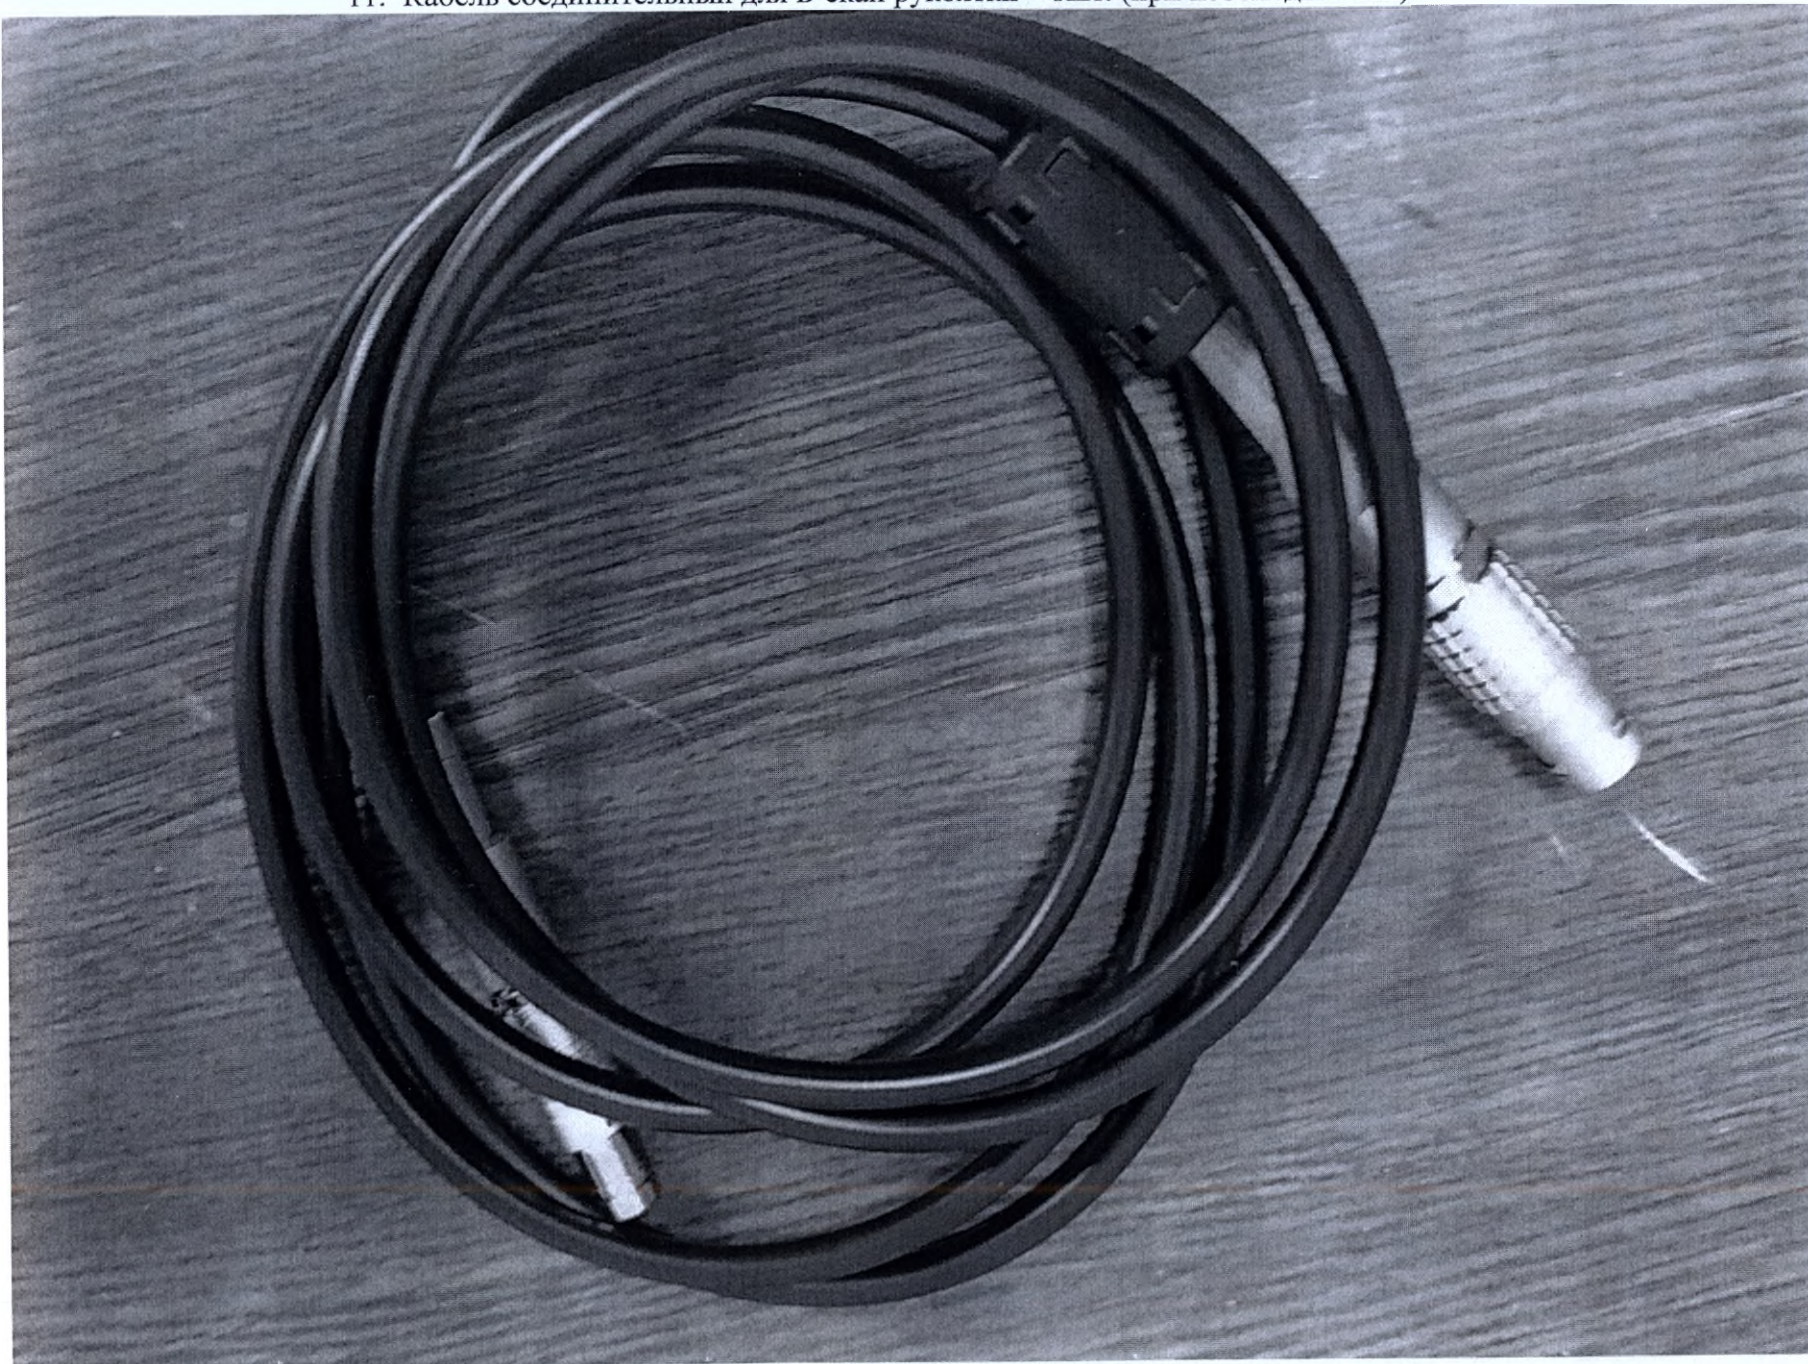

12. Б-скан рукоятка, 12 МГц – 1 шт. (при необходимости)

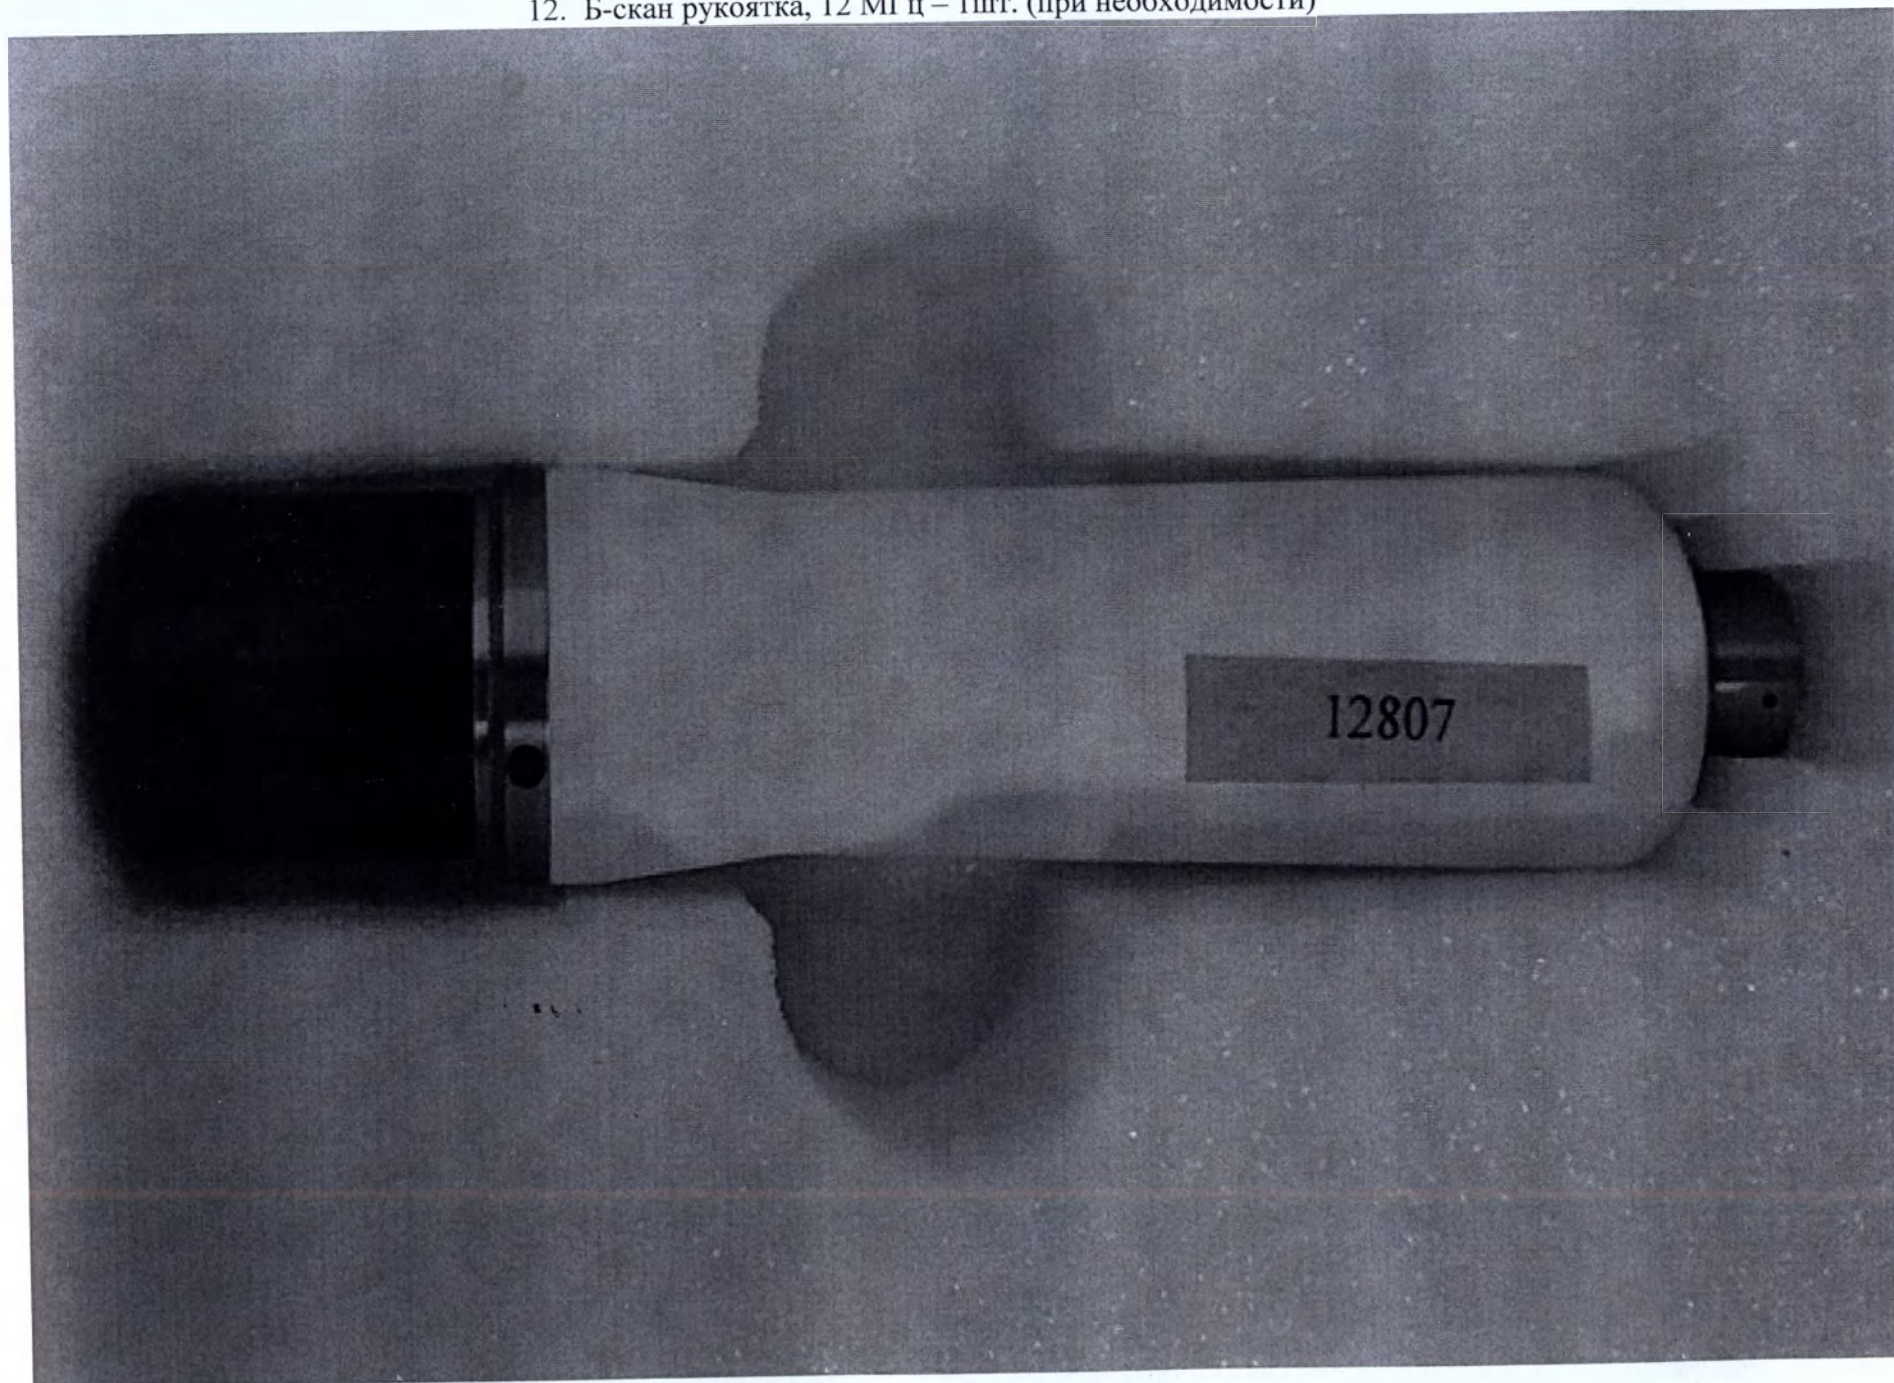

13. Б-скан рукоятка, 20 МГц – 1 шт. (при необходимости)




14. Стол передвижной с трансформатором изолирующим – 1 шт. (при необходимости)




15. Тестер биометрии – 1 шт. (при необходимости)

20.8 mm


16. Чашка для иммерсионной биометрии диаметром 14 мм – 1 шт. (при необходимости)

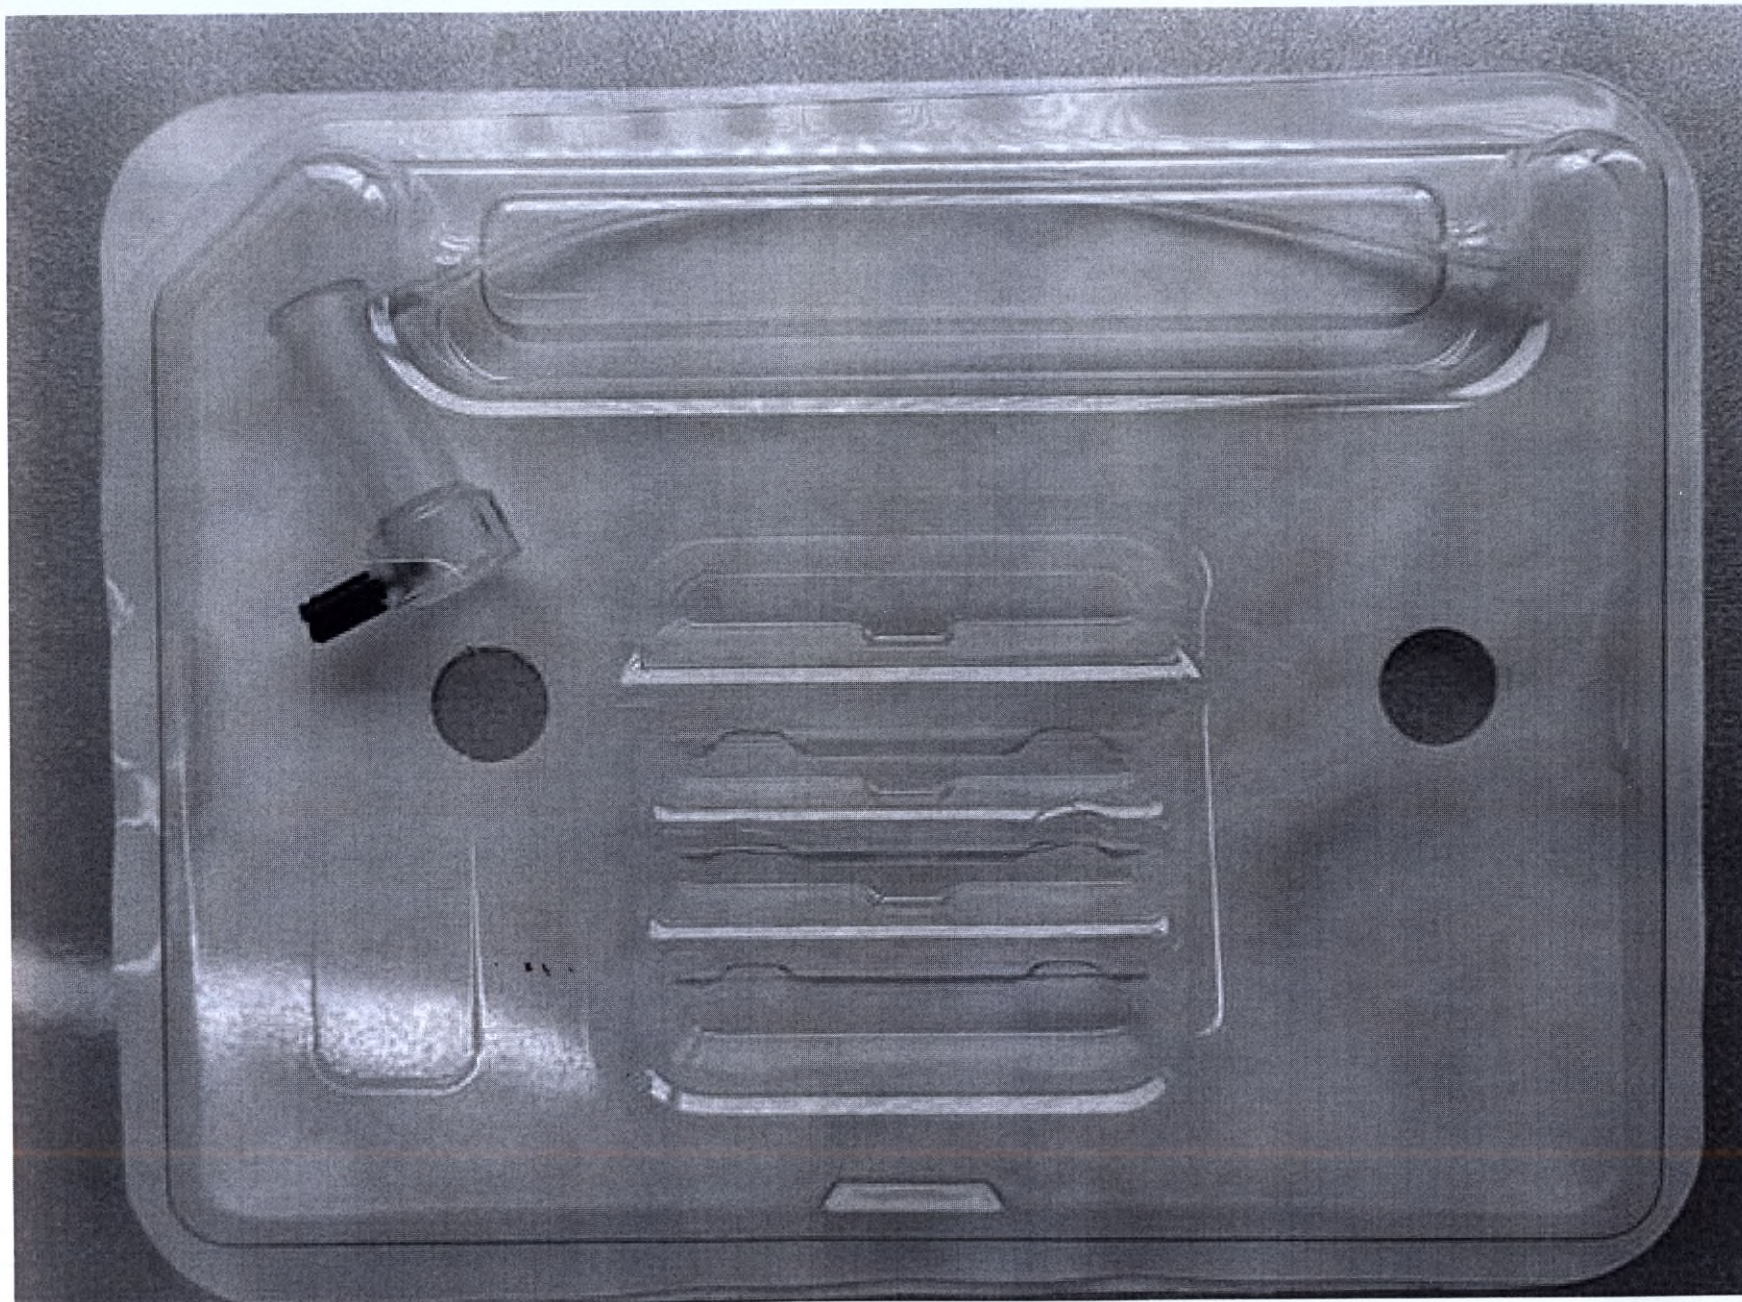

17. Чашка для иммерсионной биометрии диаметром 18 мм – 1 шт. (при необходимости)

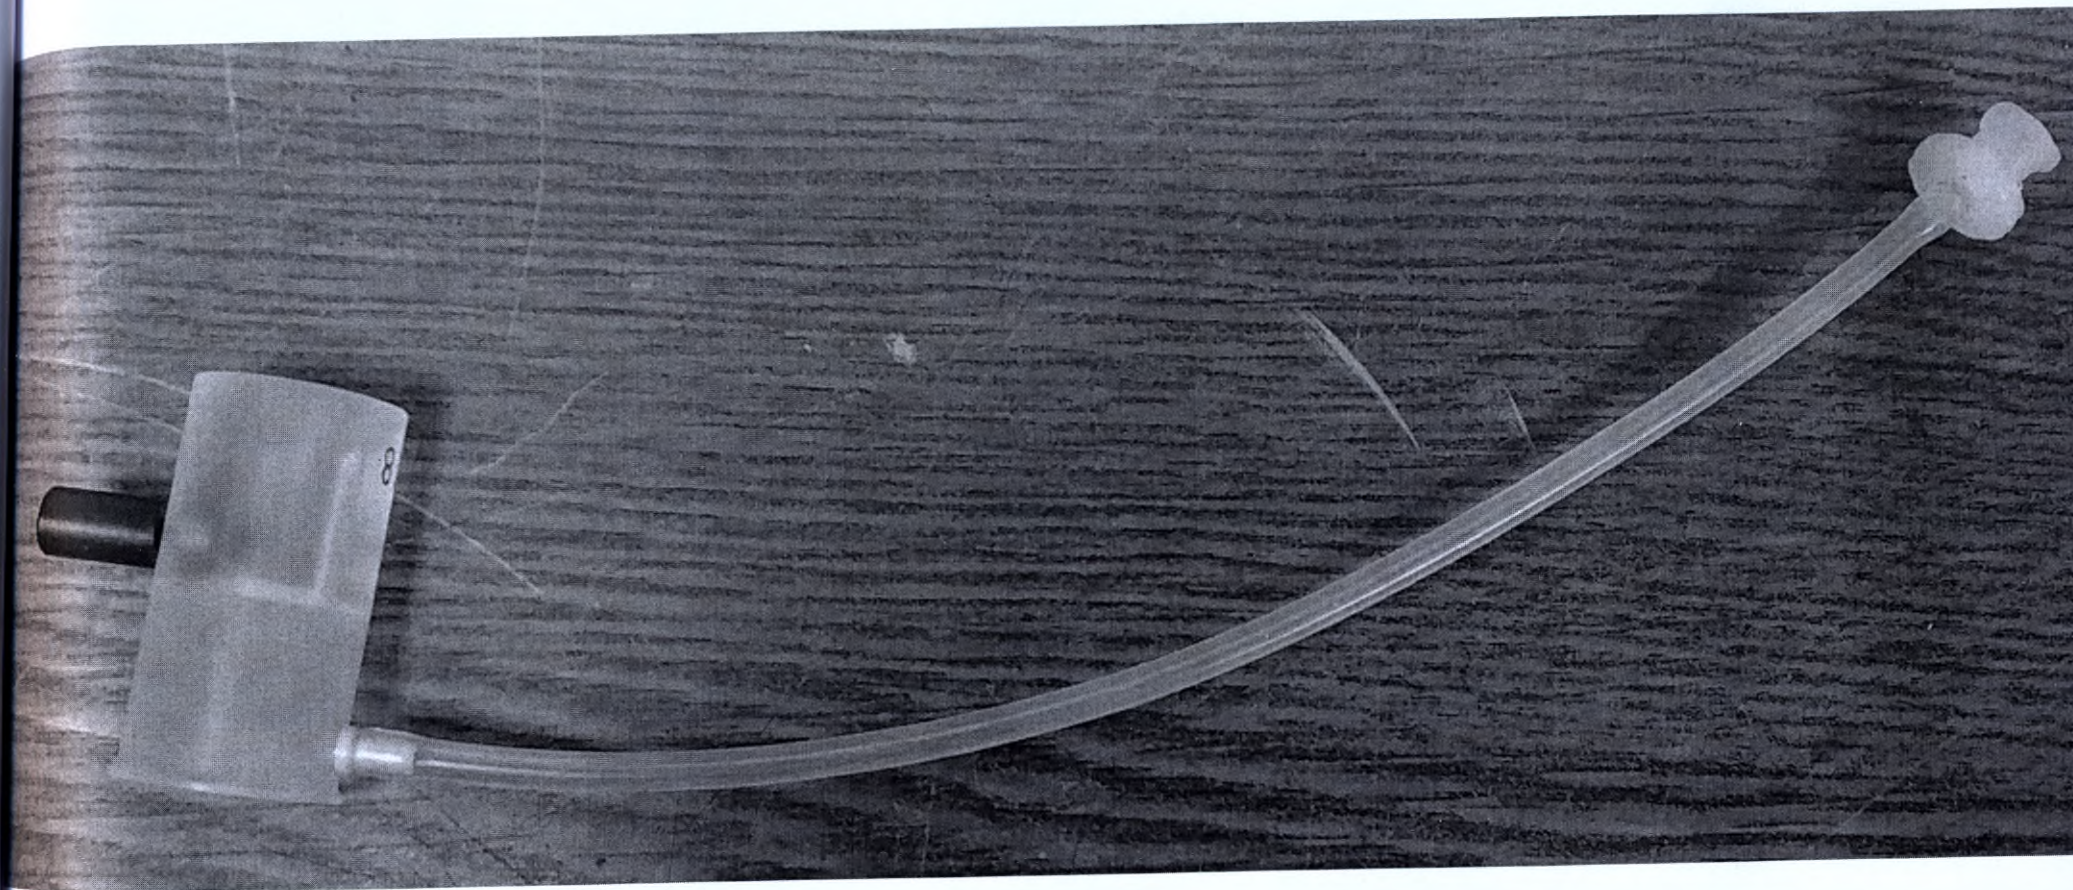


18. Рукоятка для пахиметрии – 1шт. (при необходимости)

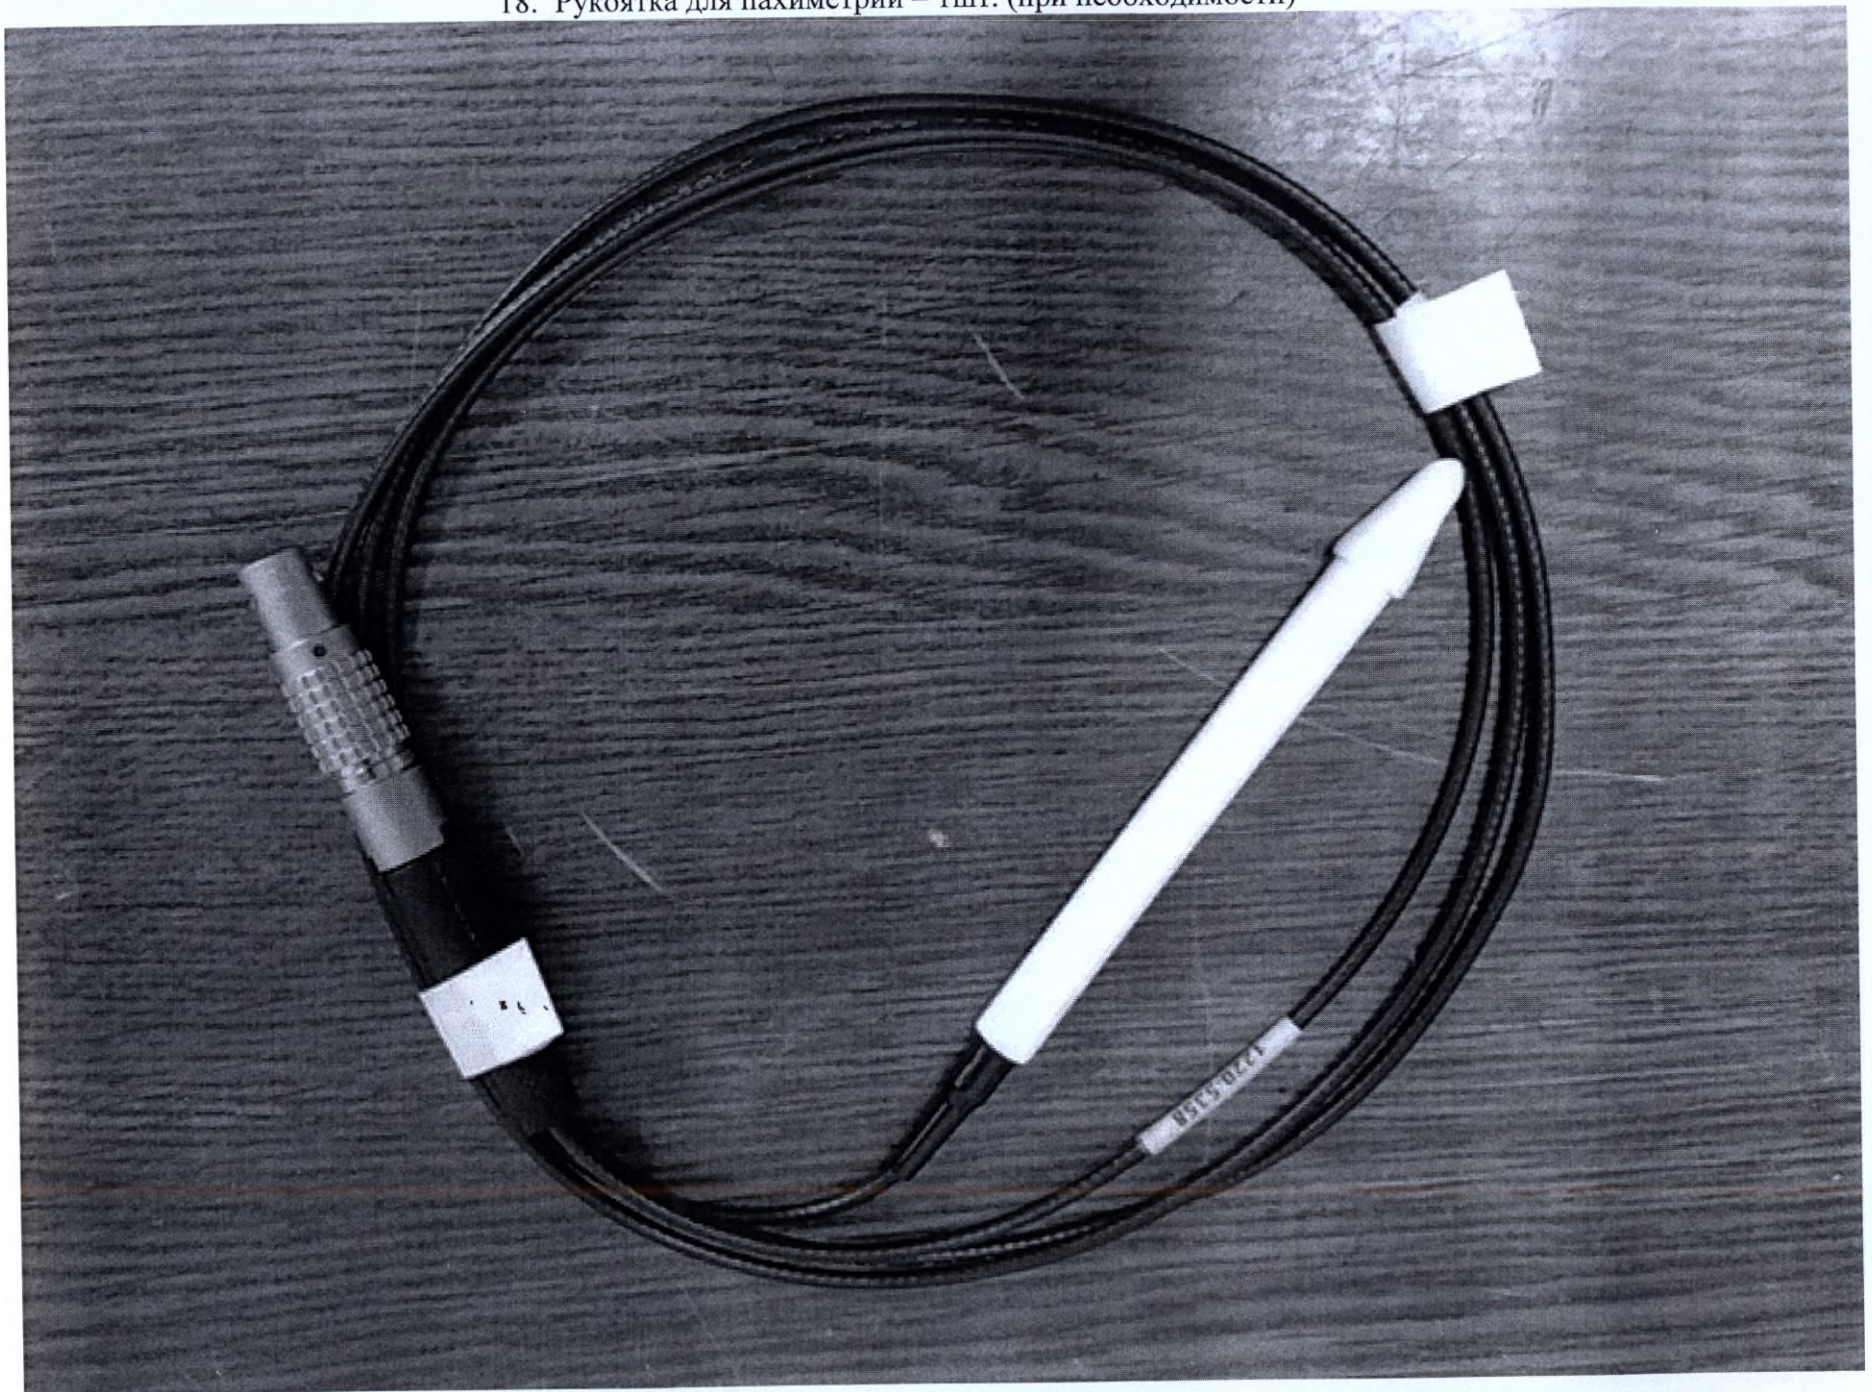


II. Аппарат ультразвуковой офтальмологический диагностический HiScan Touch Full, в составе:


1. Блок основной – 1 шт.

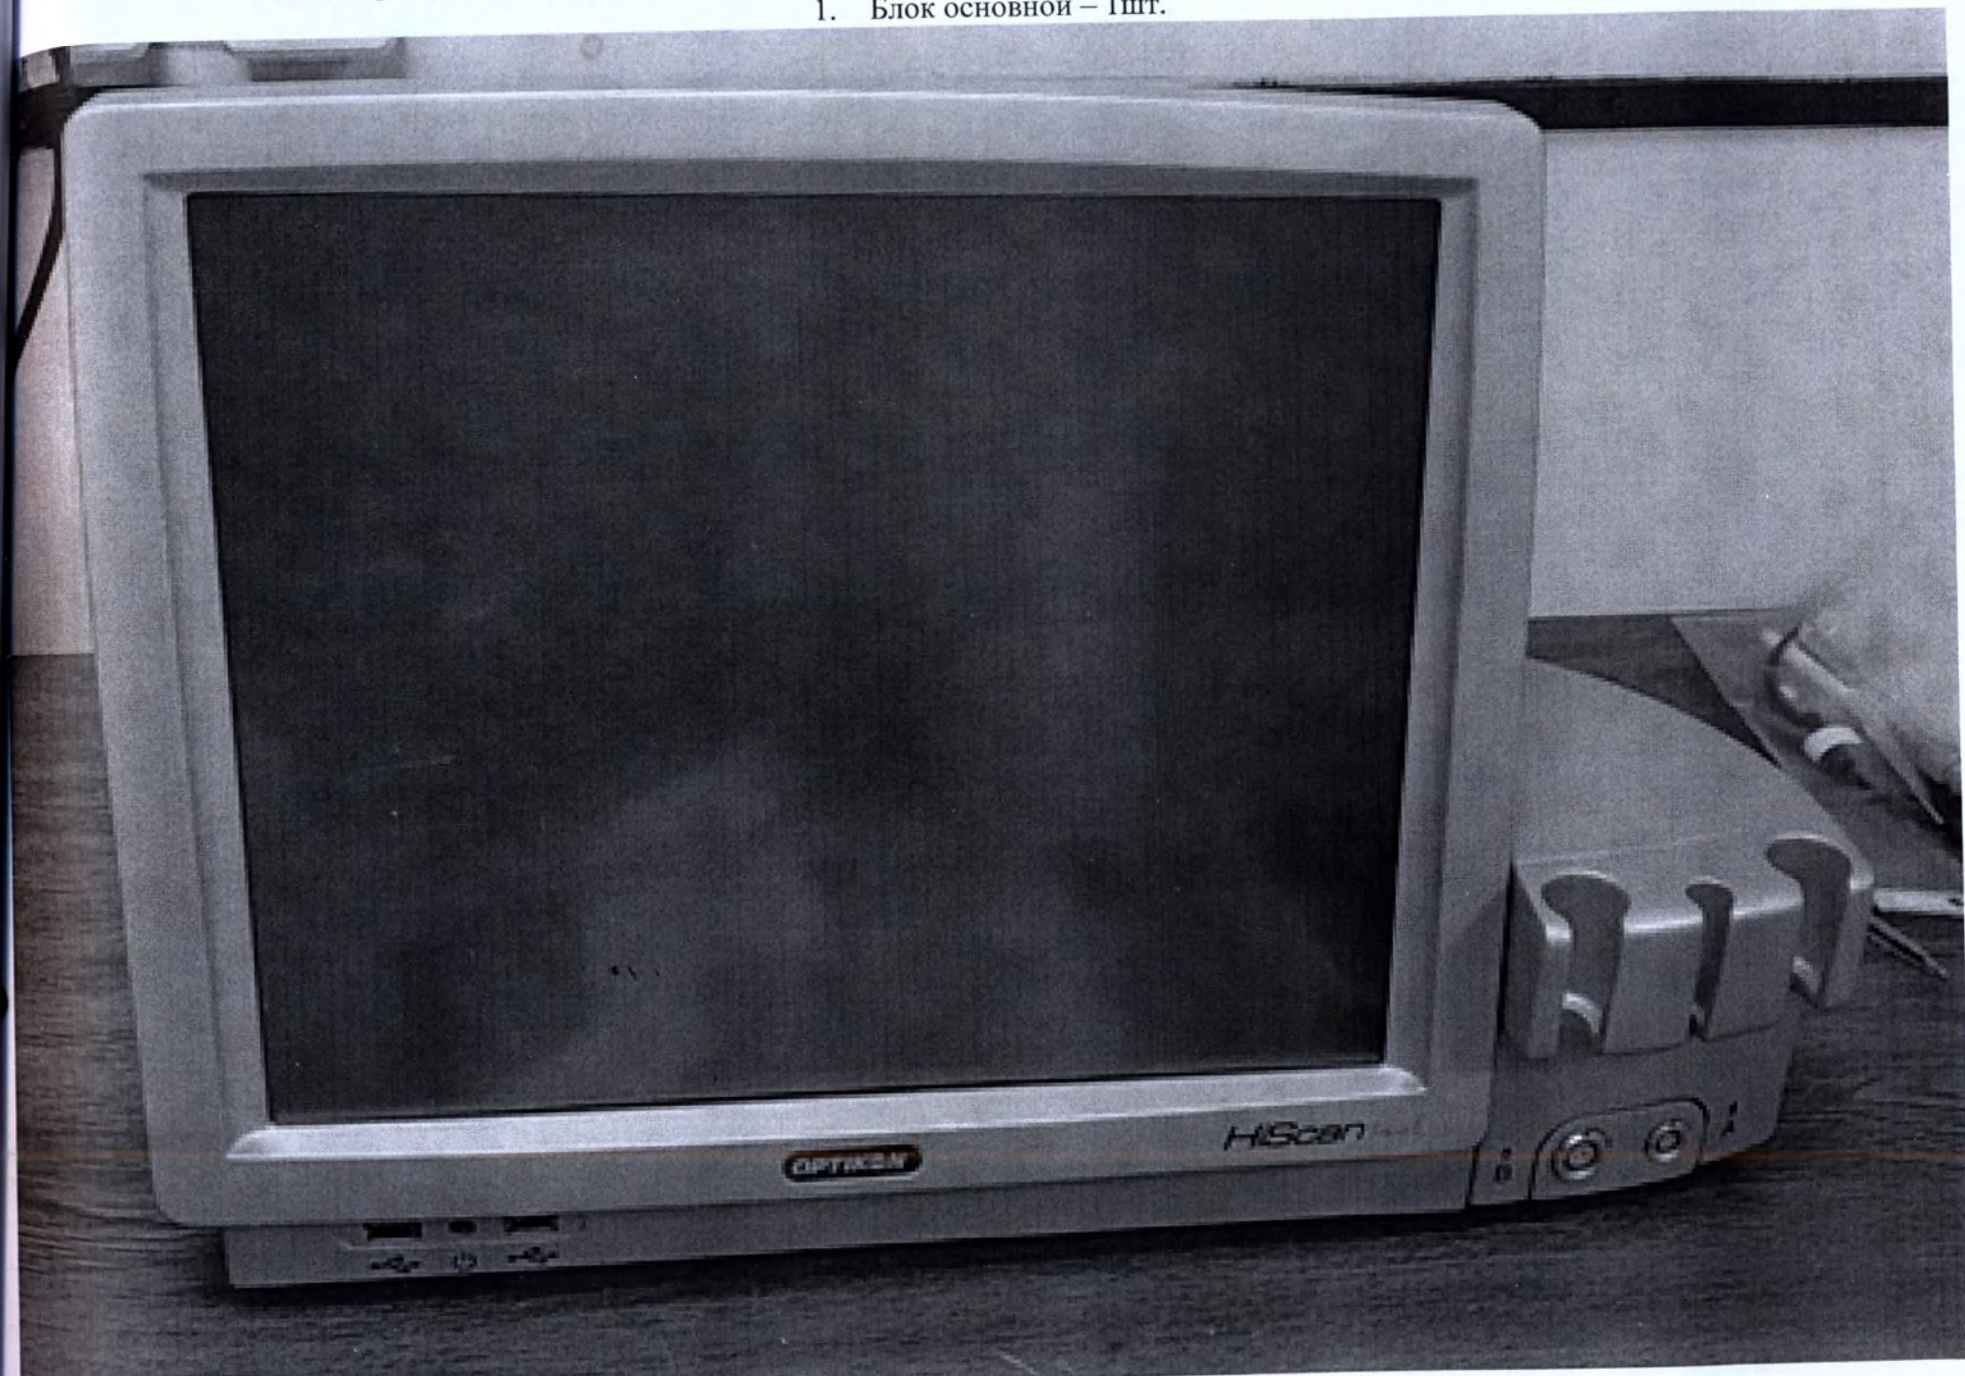

2. Кабель питания – 1 шт.

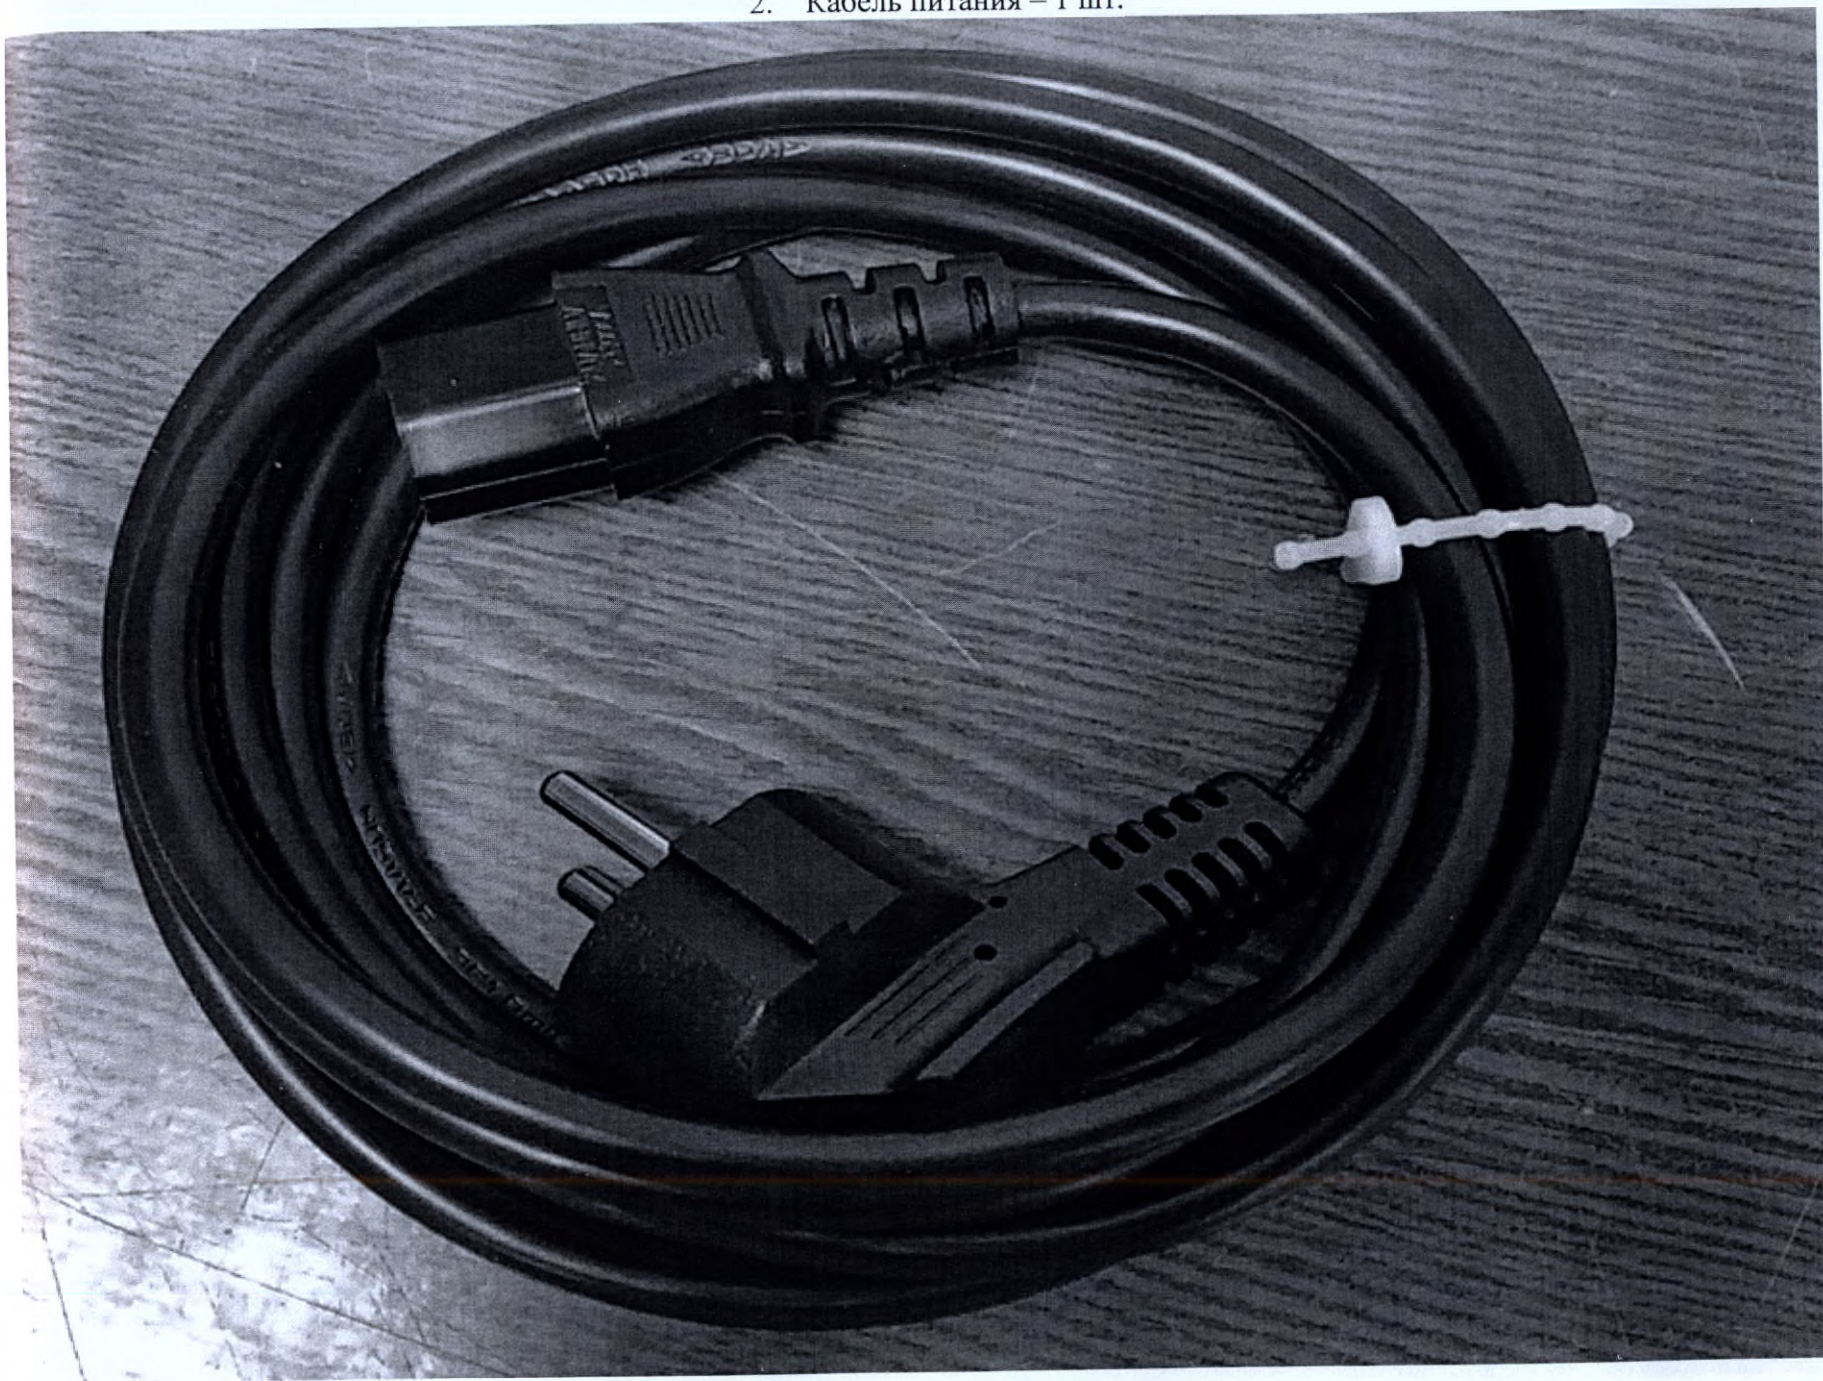


3. Педаль ножная – 1 шт.

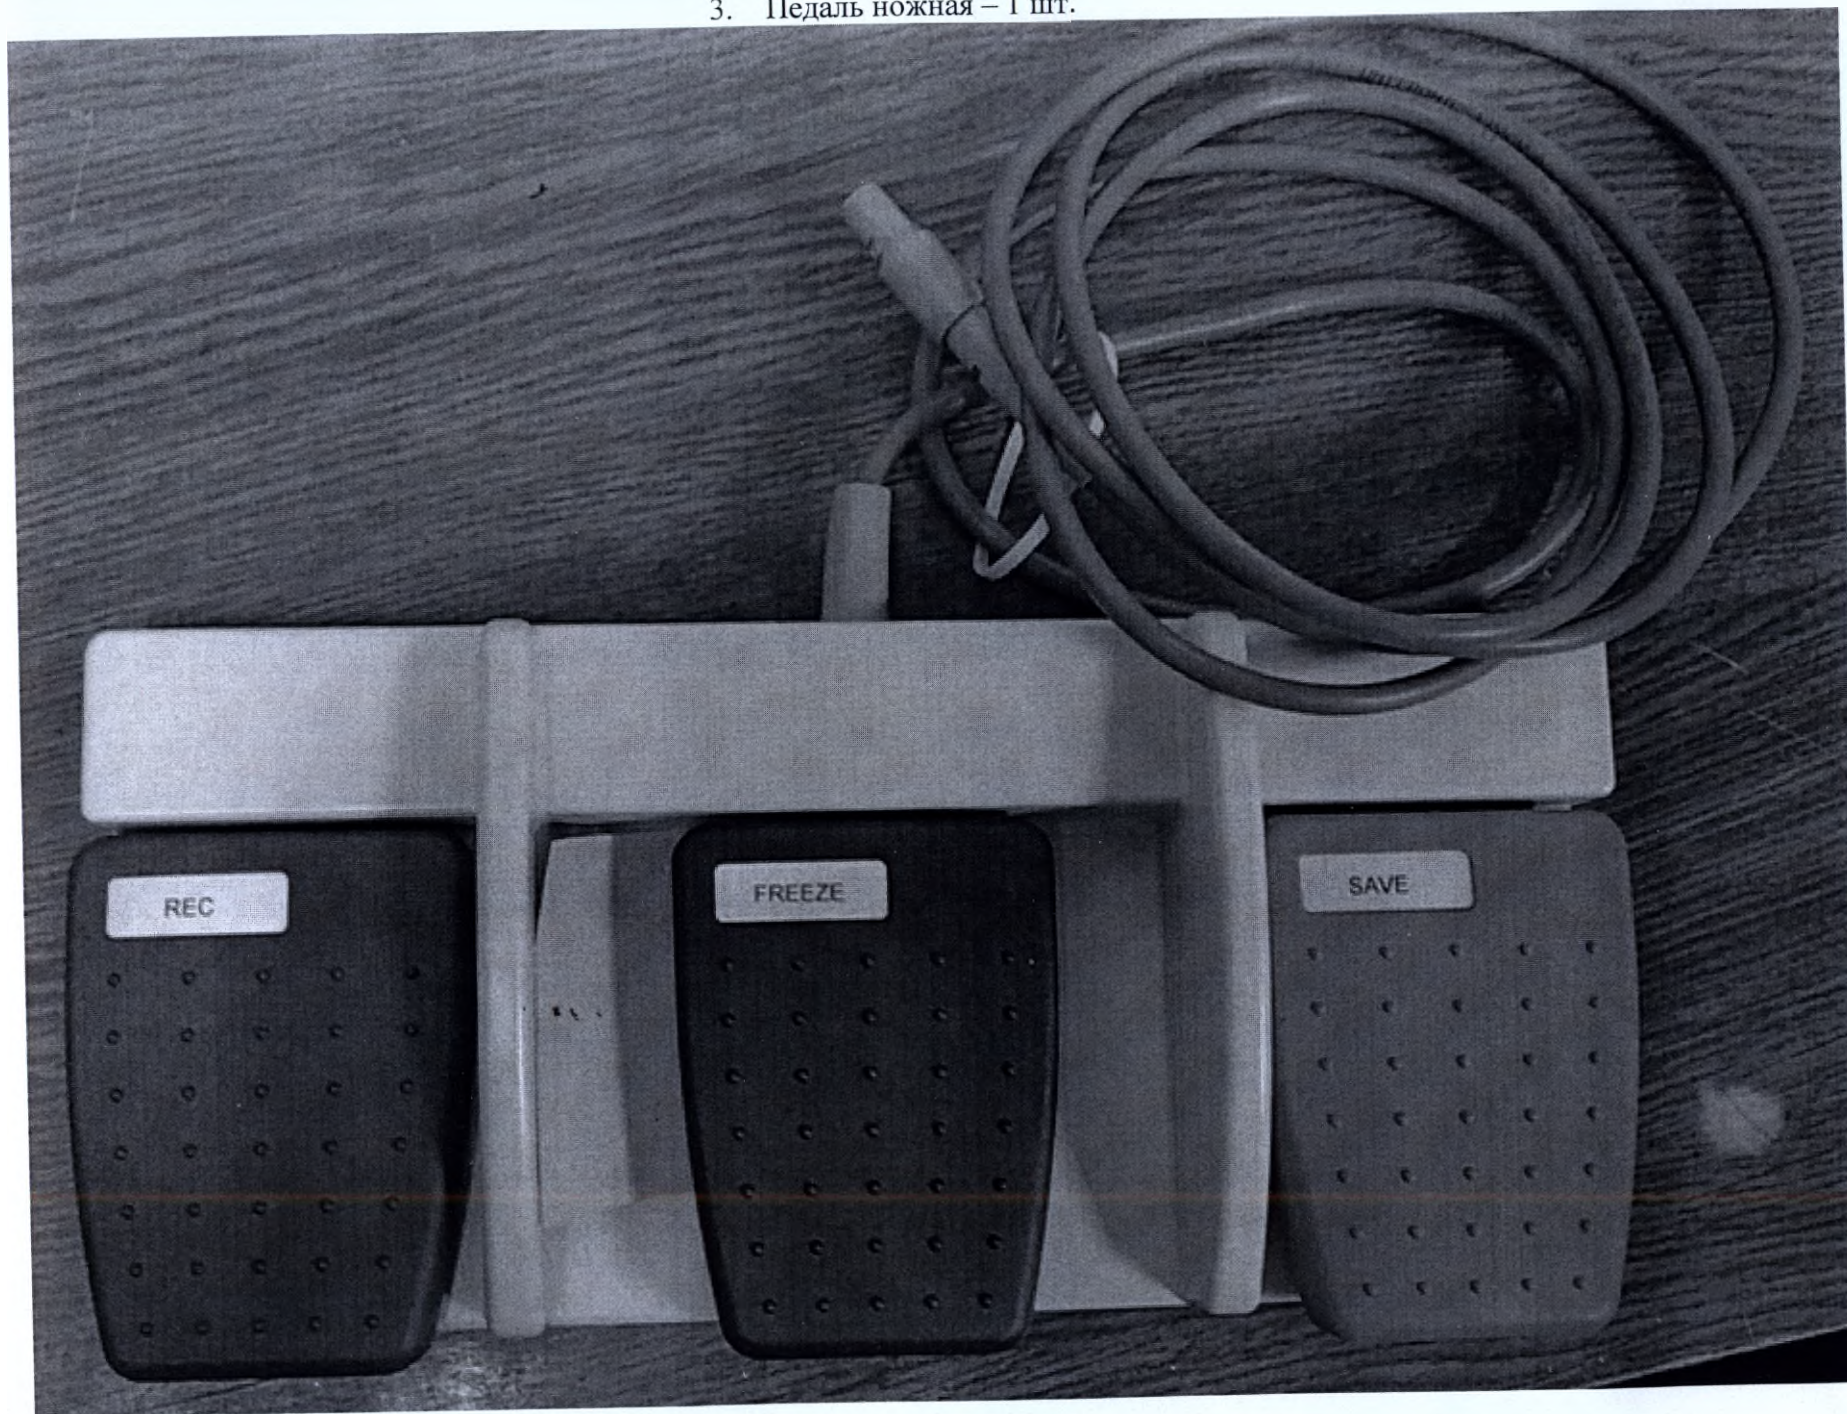


4. Предохранитель— 2 шт.




5. Чехол защитный – 1 шт.

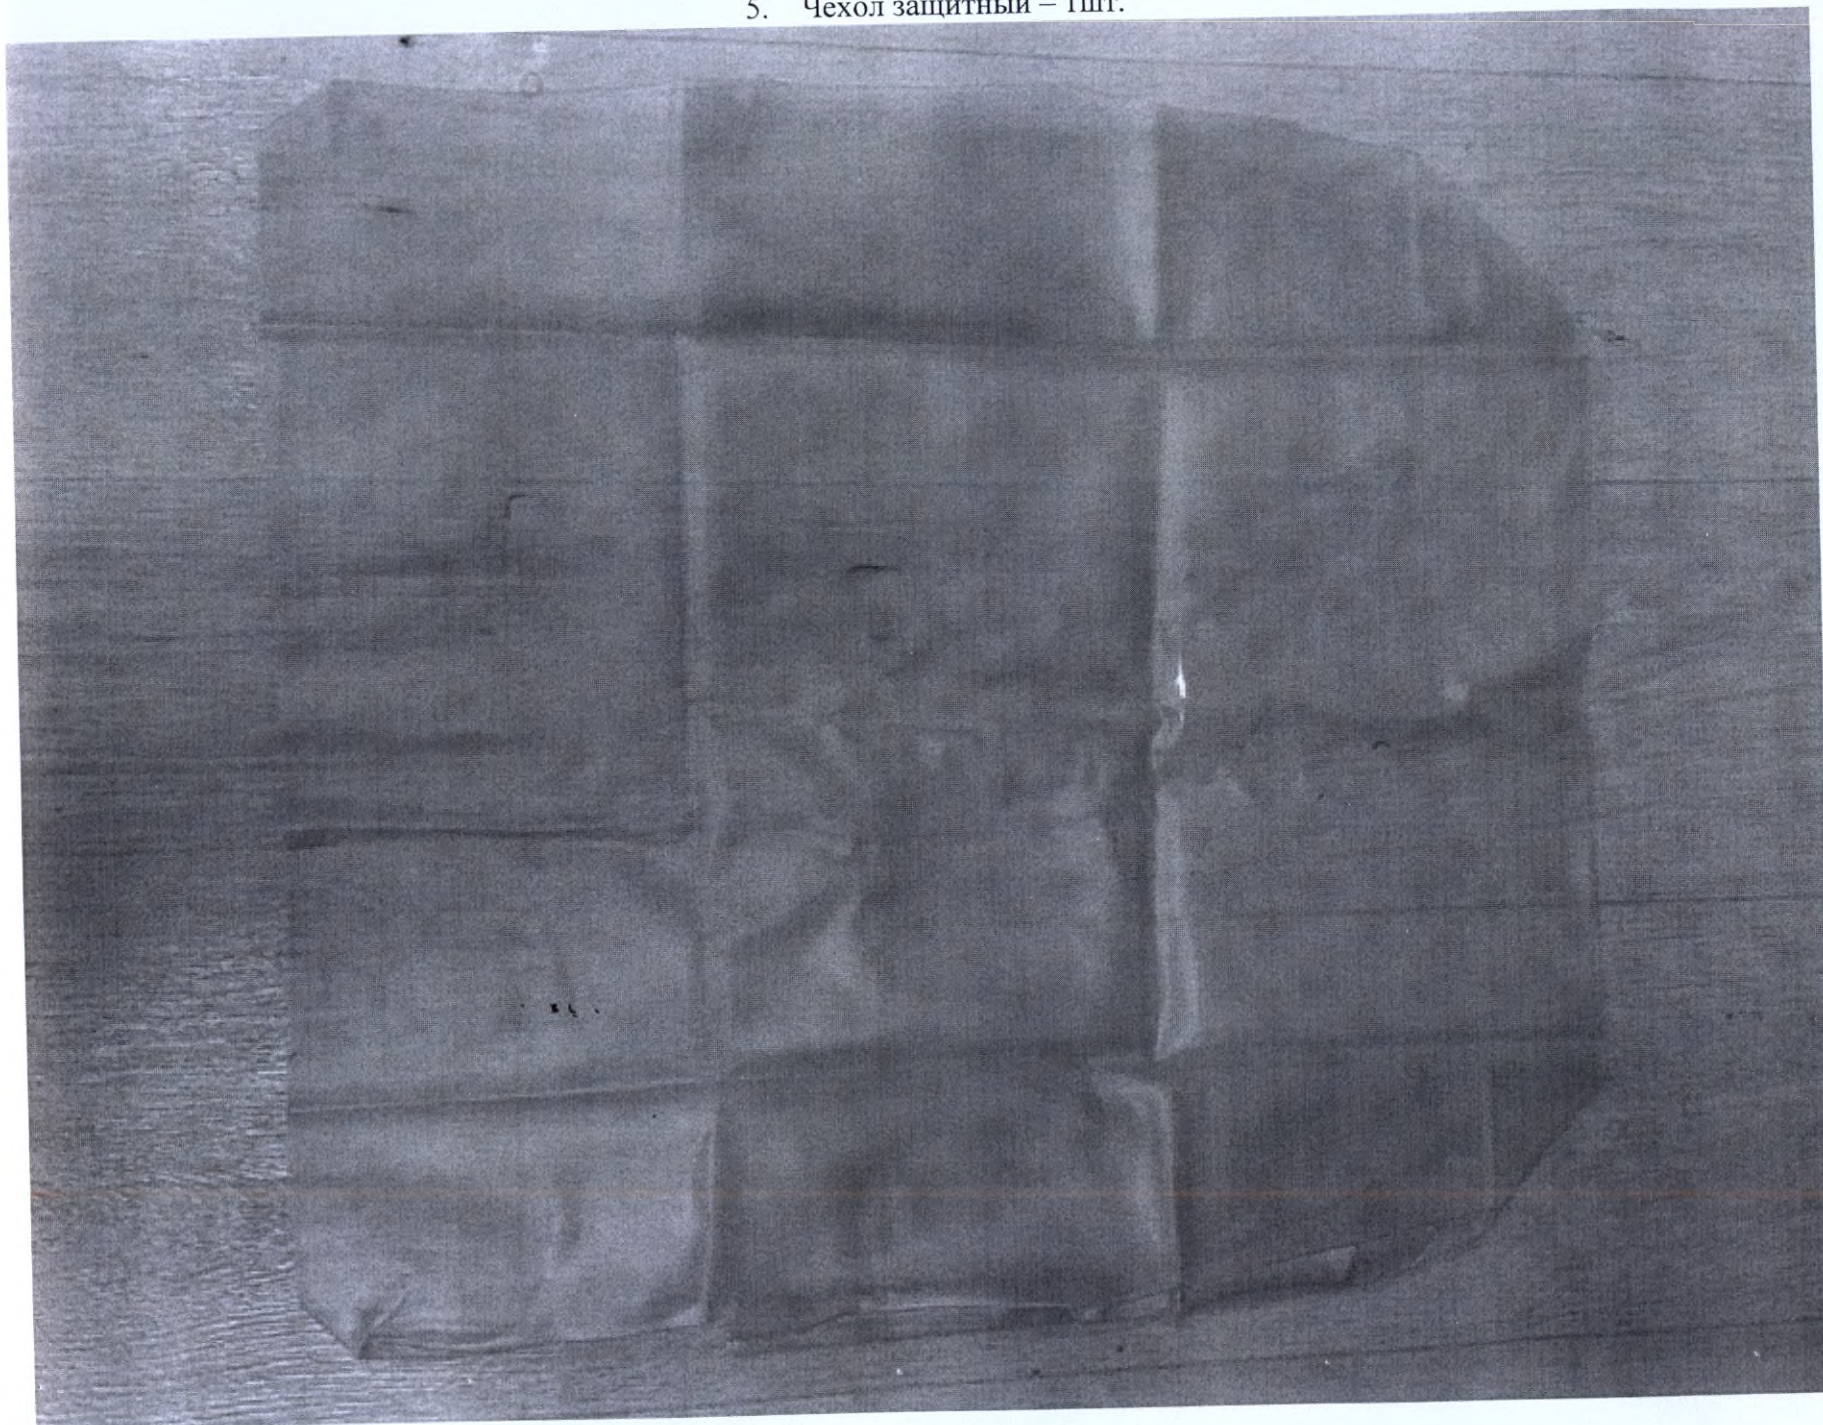

6. Клавиатура – 1шт.

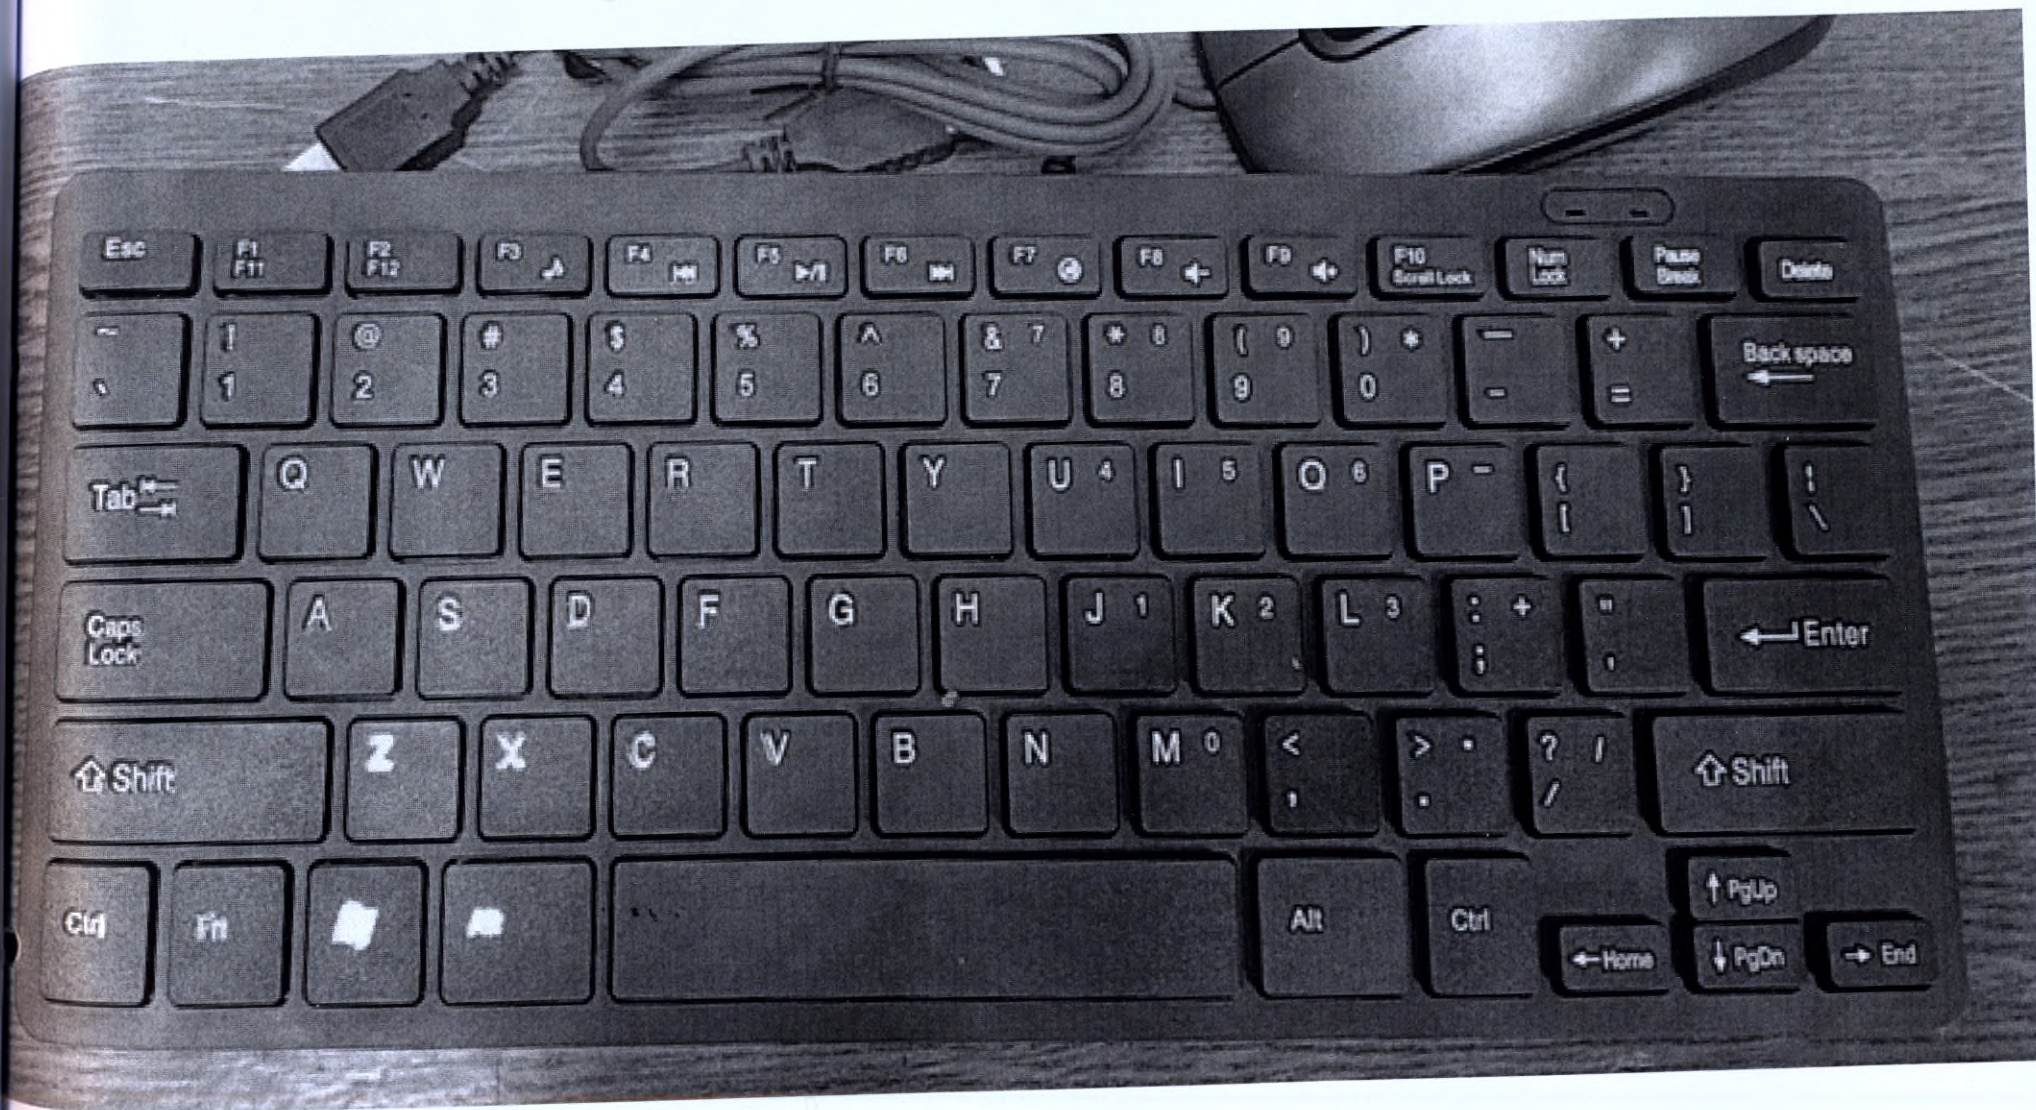

7. Мышь – 1 шт.

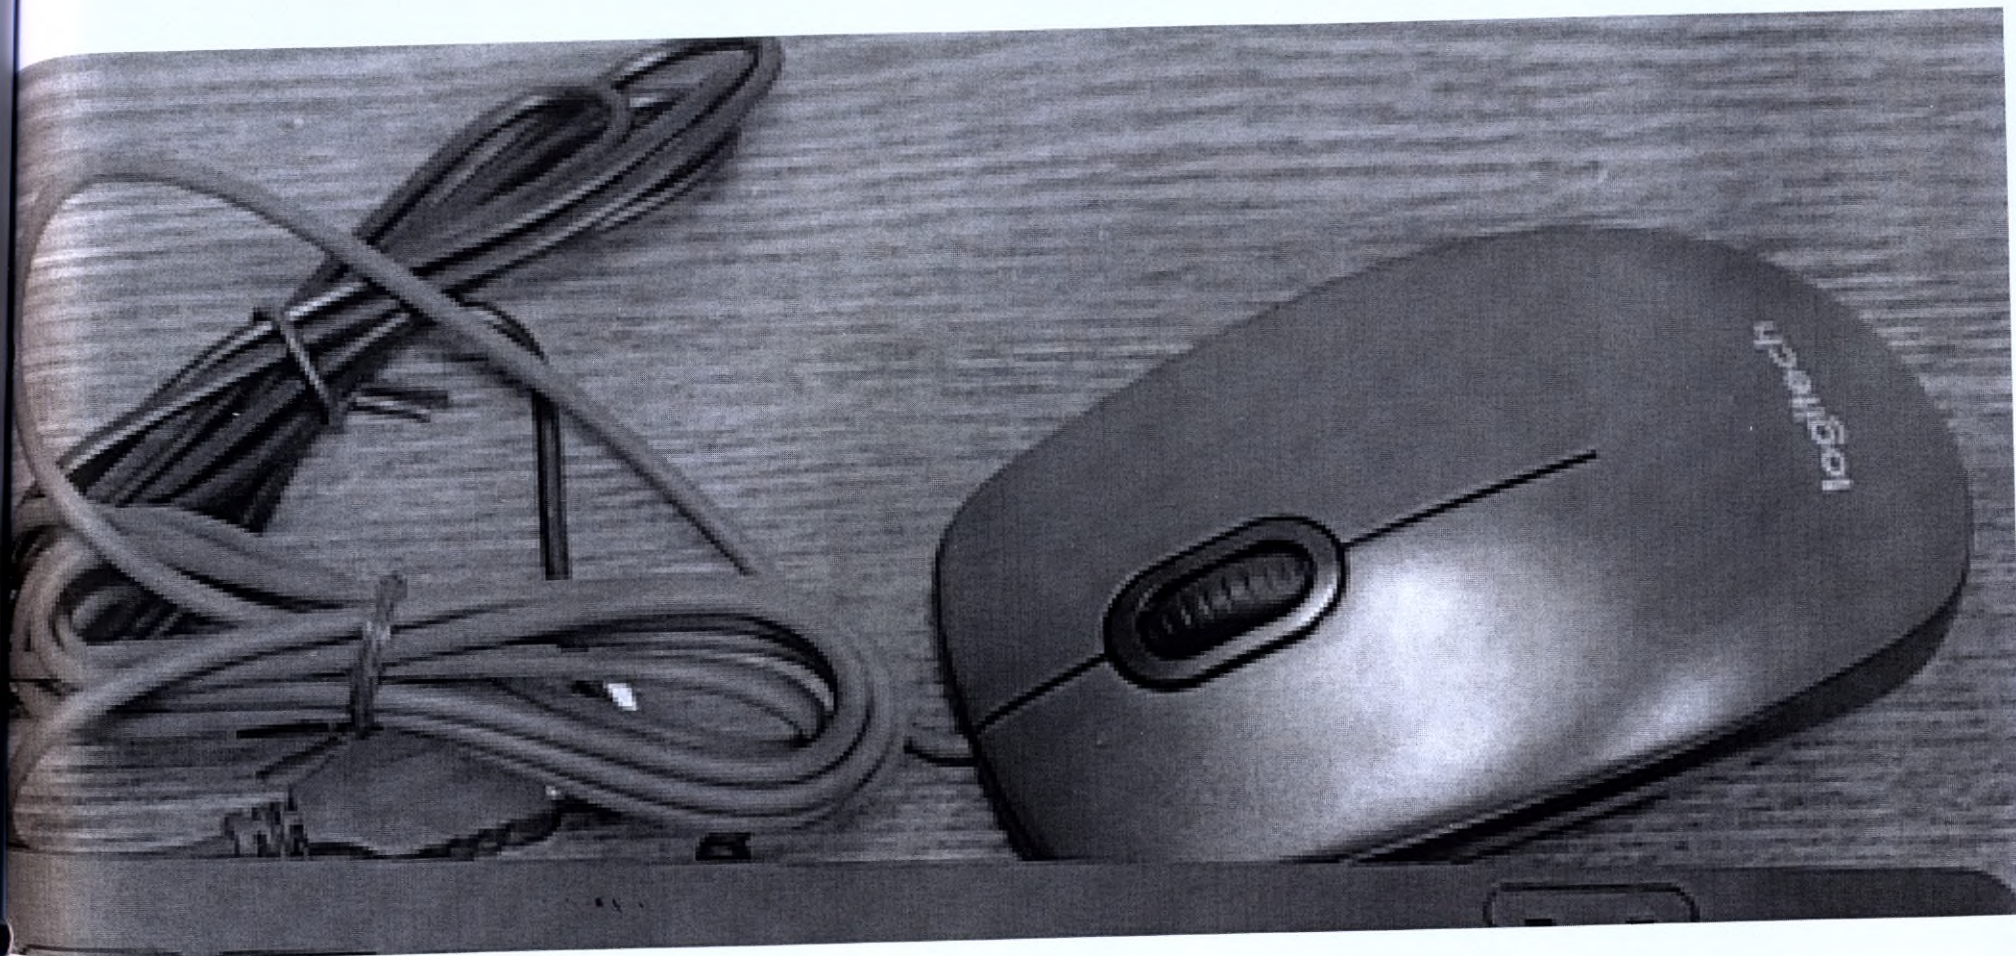

Cod 14101XEN
2018-08-24 Rev.D

CE
0051




HiScan Touch


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АППАРАТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ HiSCAN TOUCH В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

ОПТИКОН 2000 С.п.А.


9. Рукоятка для биометрии – 1 шт. (при необходимости)

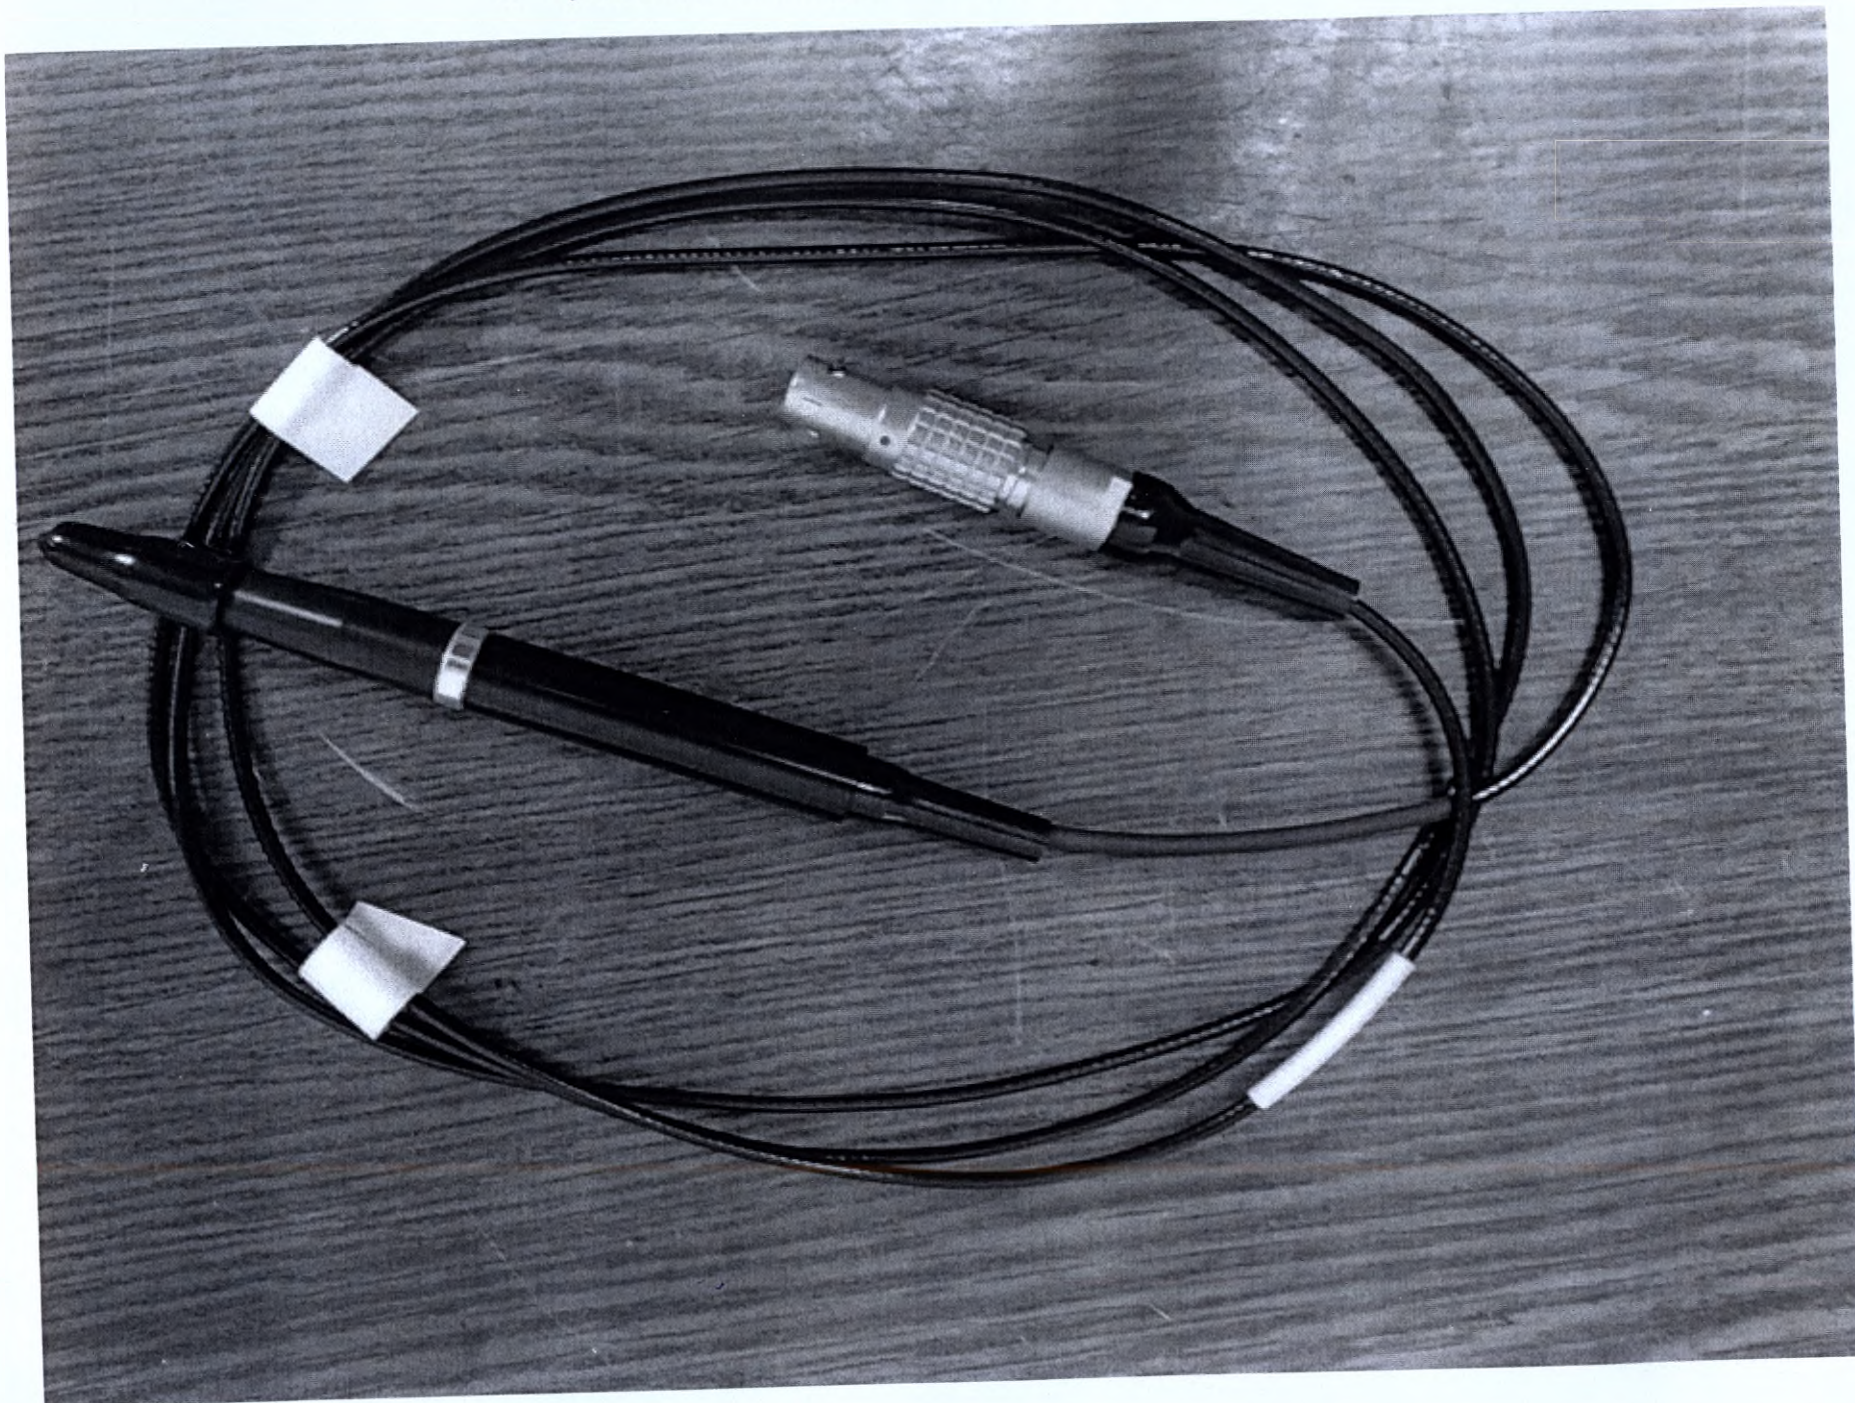


10. А-скан рукоятка диагностическая – 1 шт. (при необходимости)

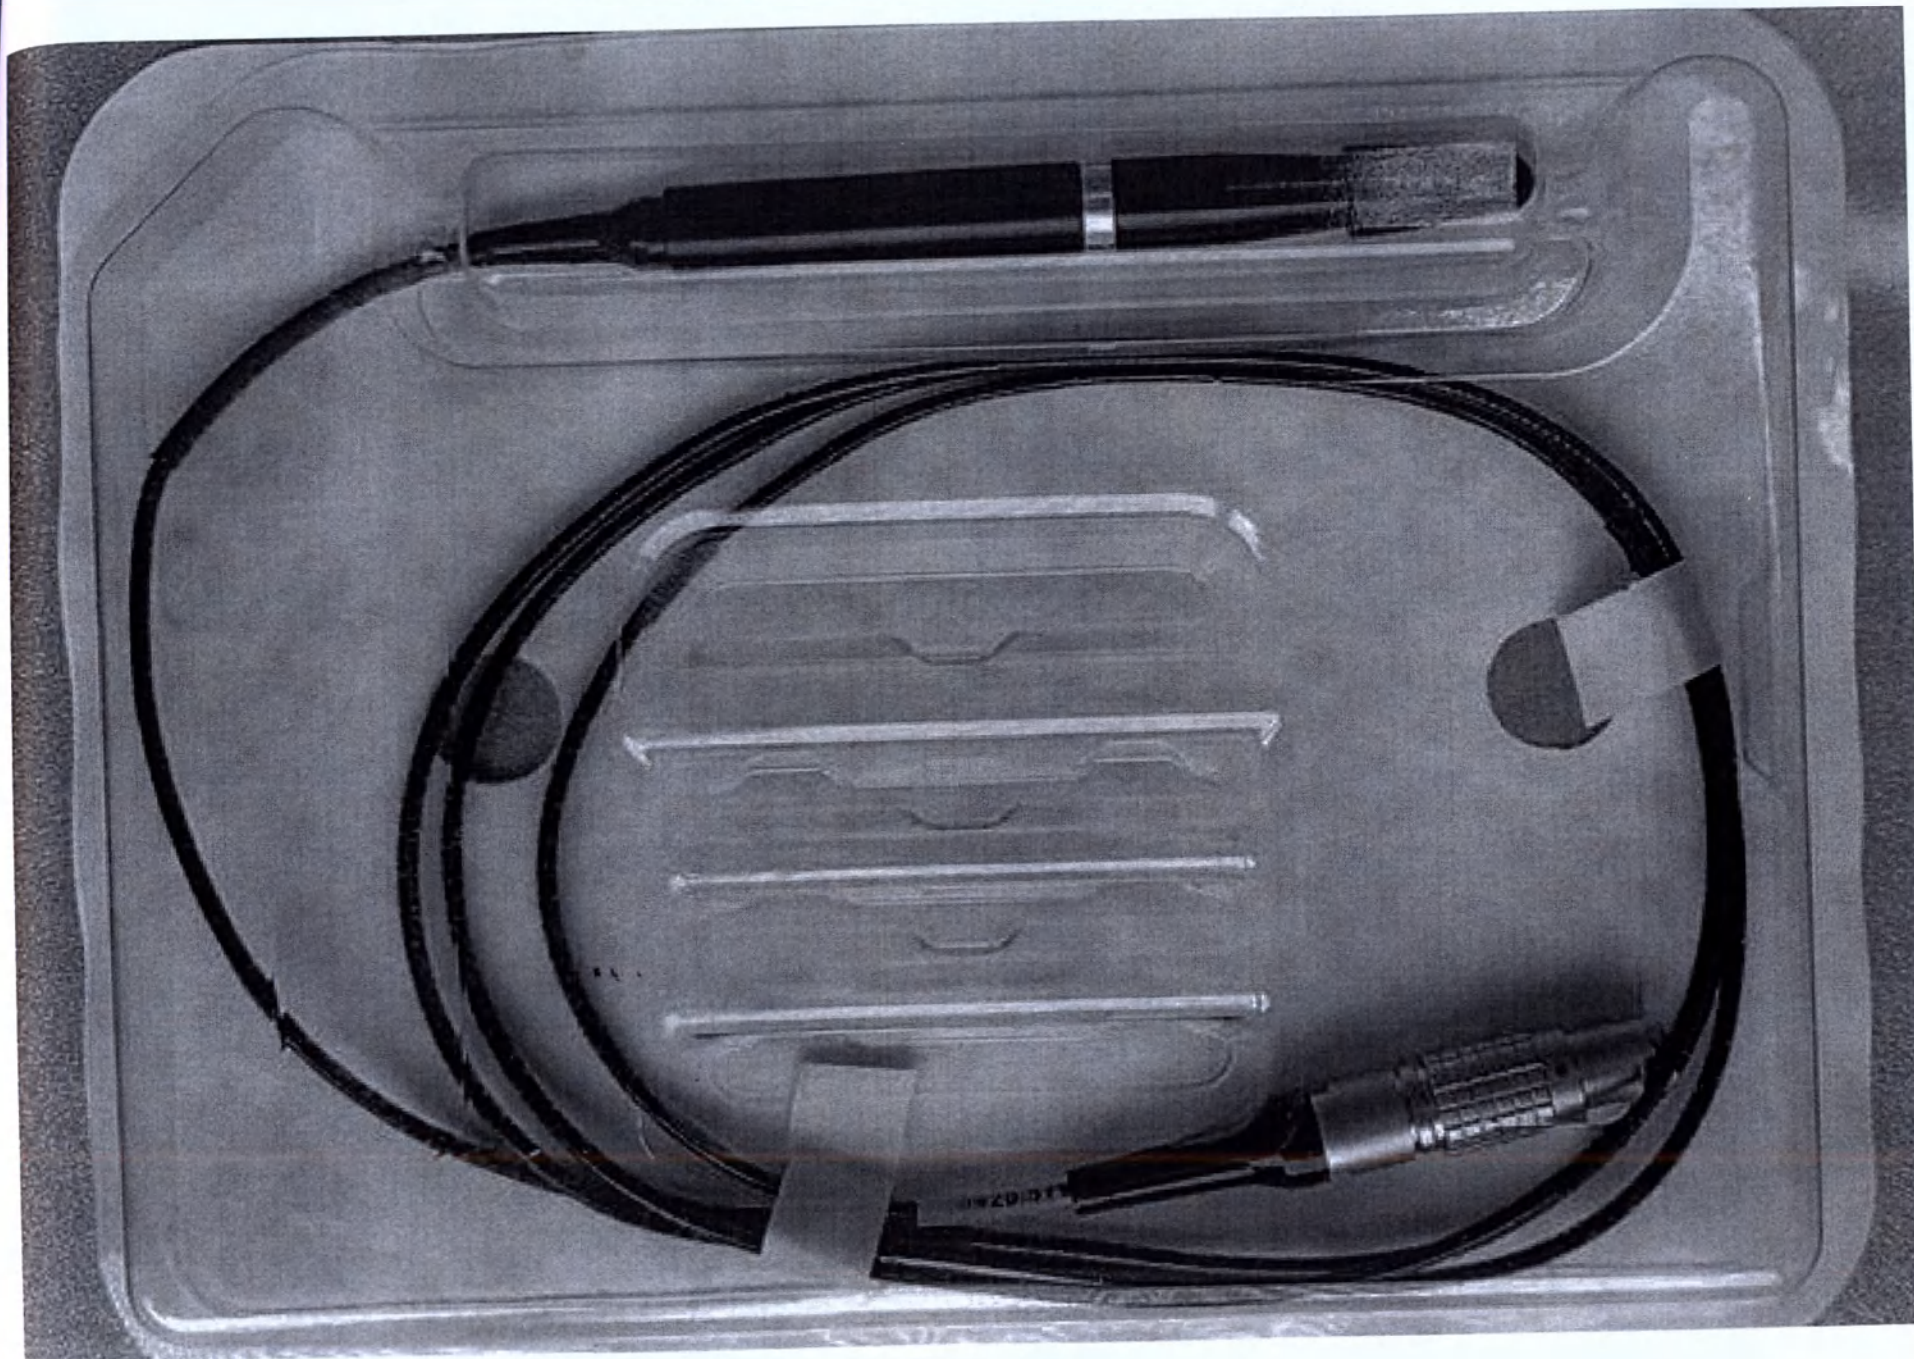

11. Кабель соединительный для Б-скан рукоятки – 1 шт. (при необходимости)

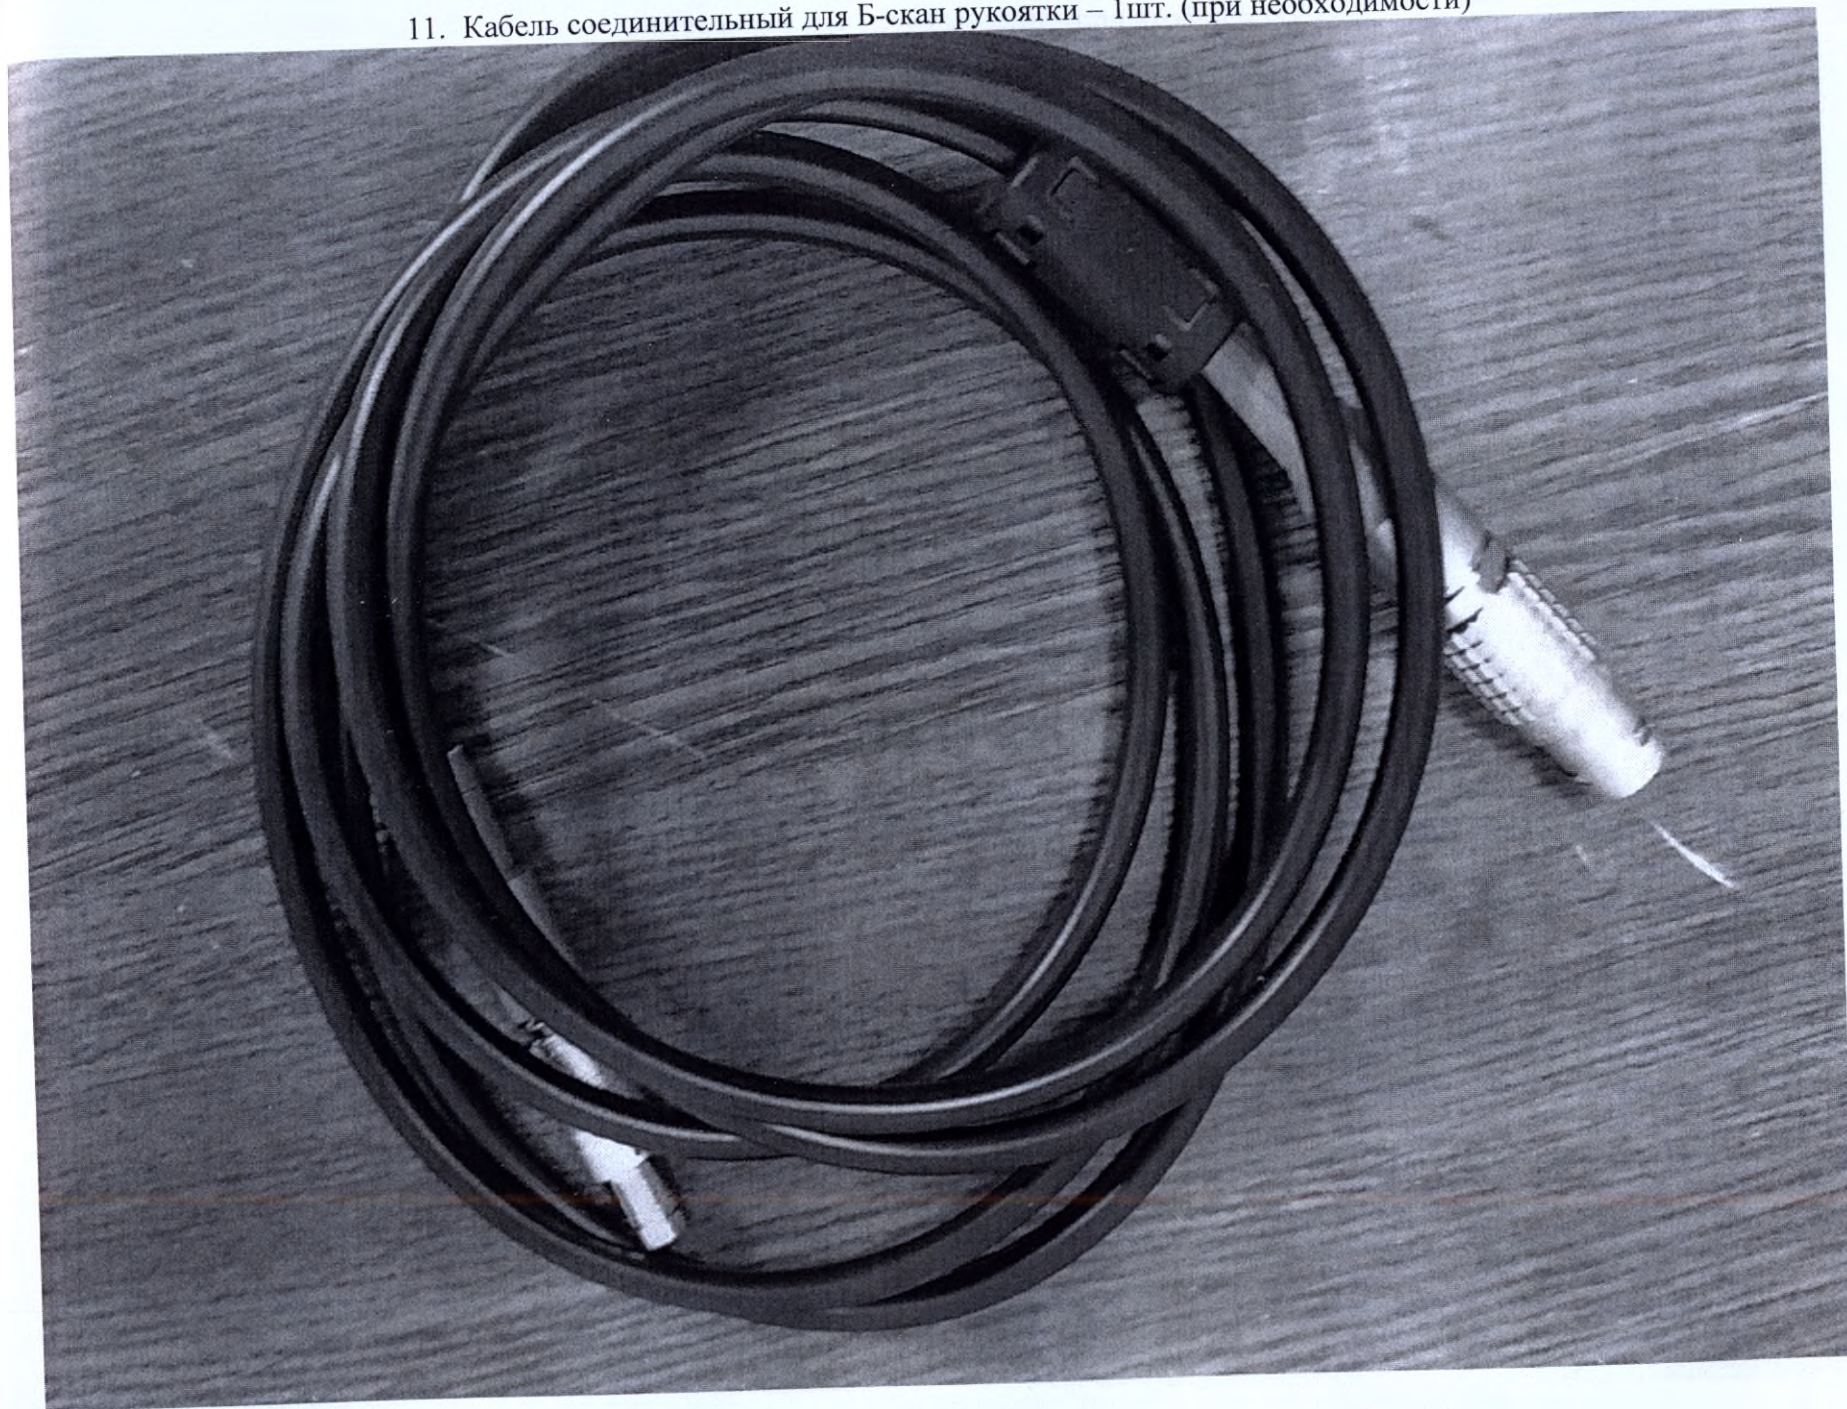

12. Б-скан рукоятка, 12 МГц – 1 шт. (при необходимости)

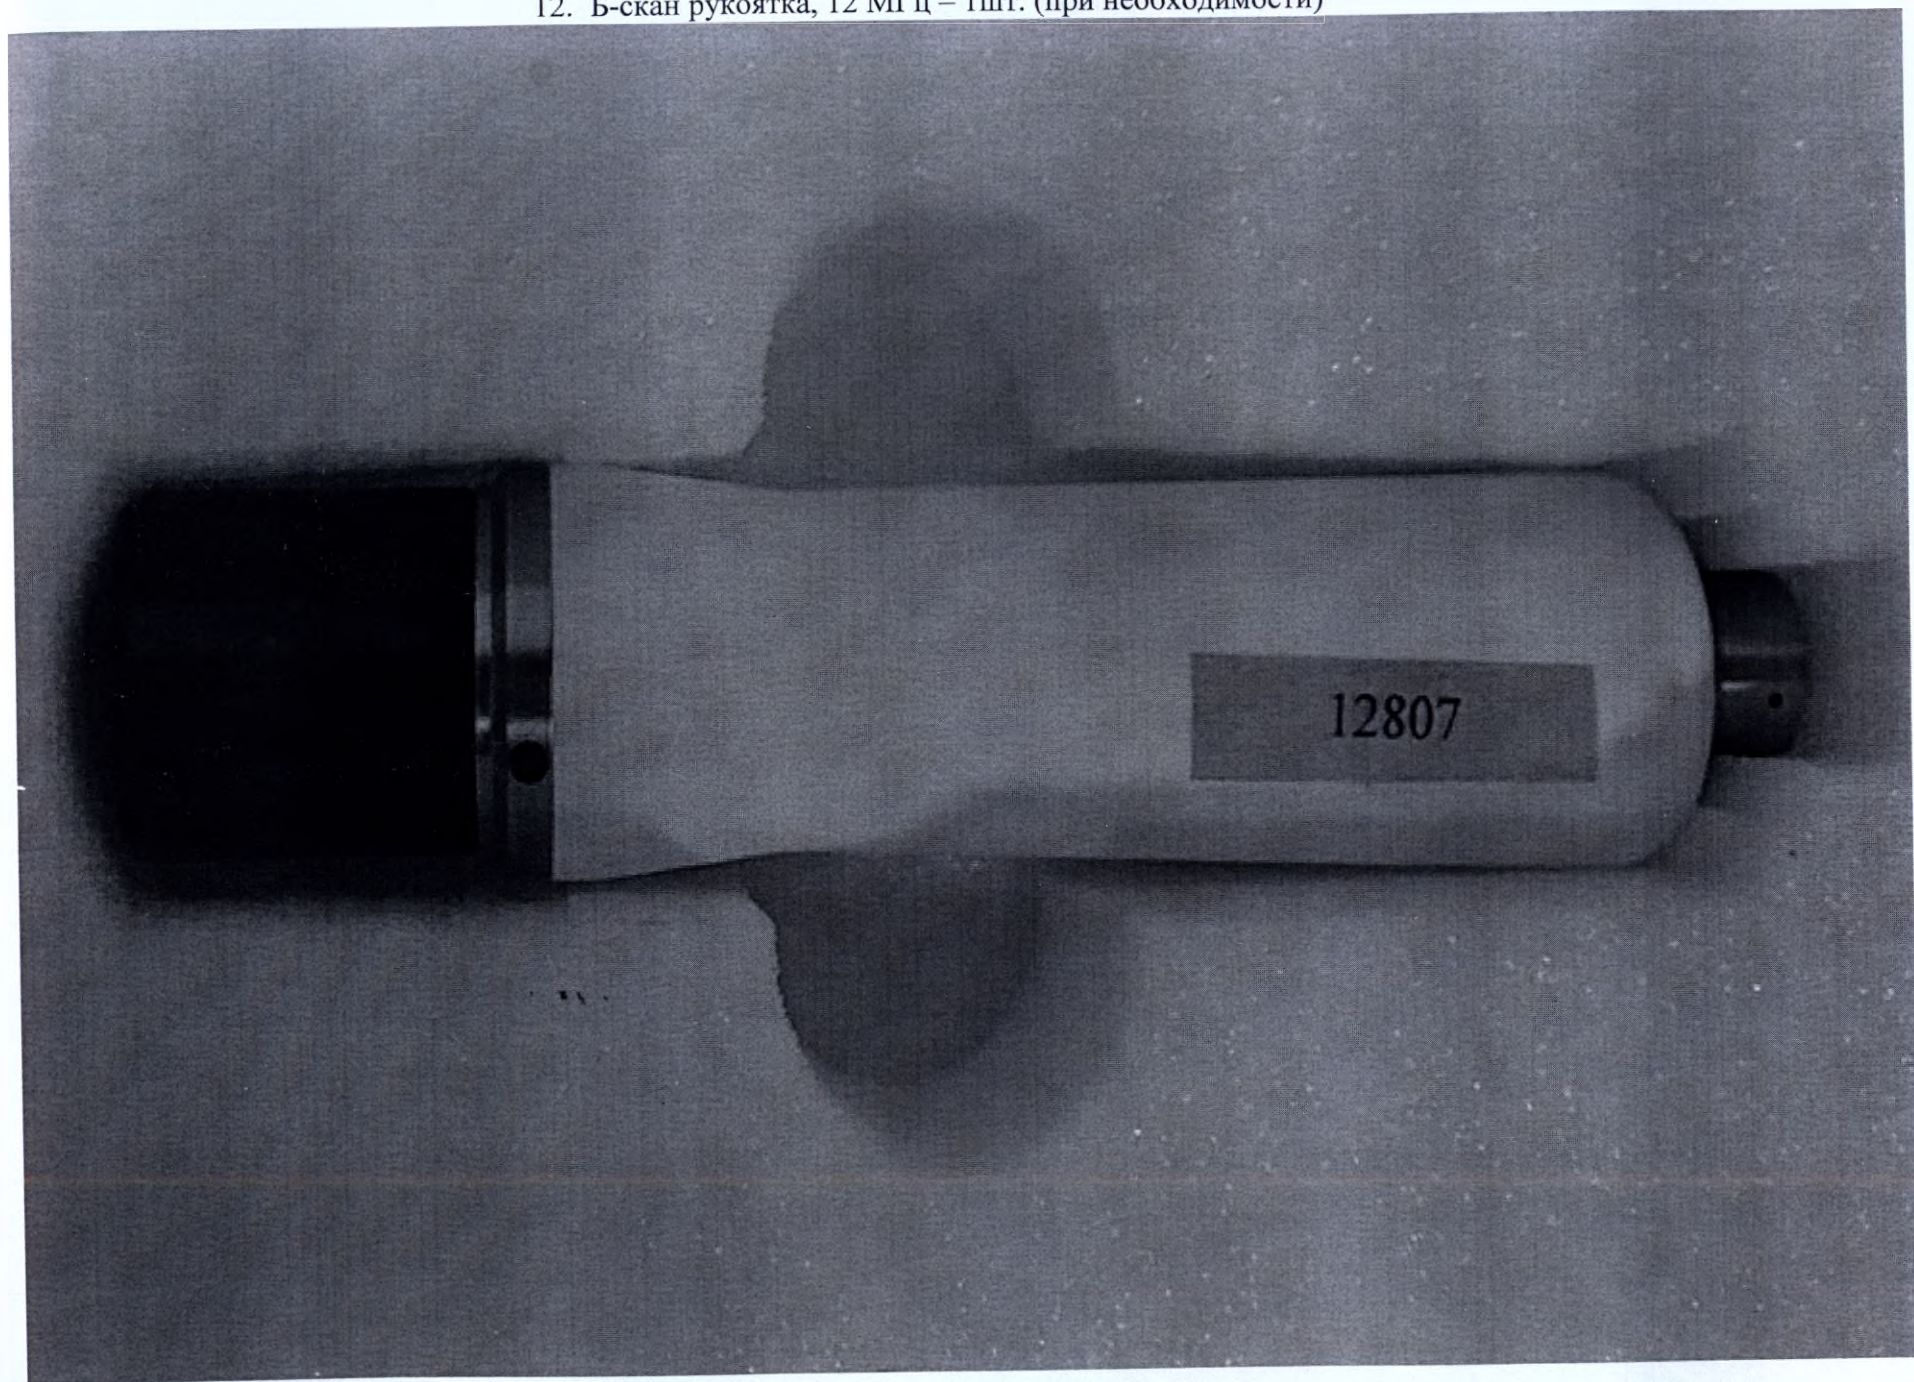


13. Б-скан рукоятка, 20 МГц – 1шт. (при необходимости)



14. Б-скан рукоятка, 35 МГц – 1шт. (при необходимости)




15. Б-скан рукоятка, 50 МГц – 1 шт. (при необходимости)

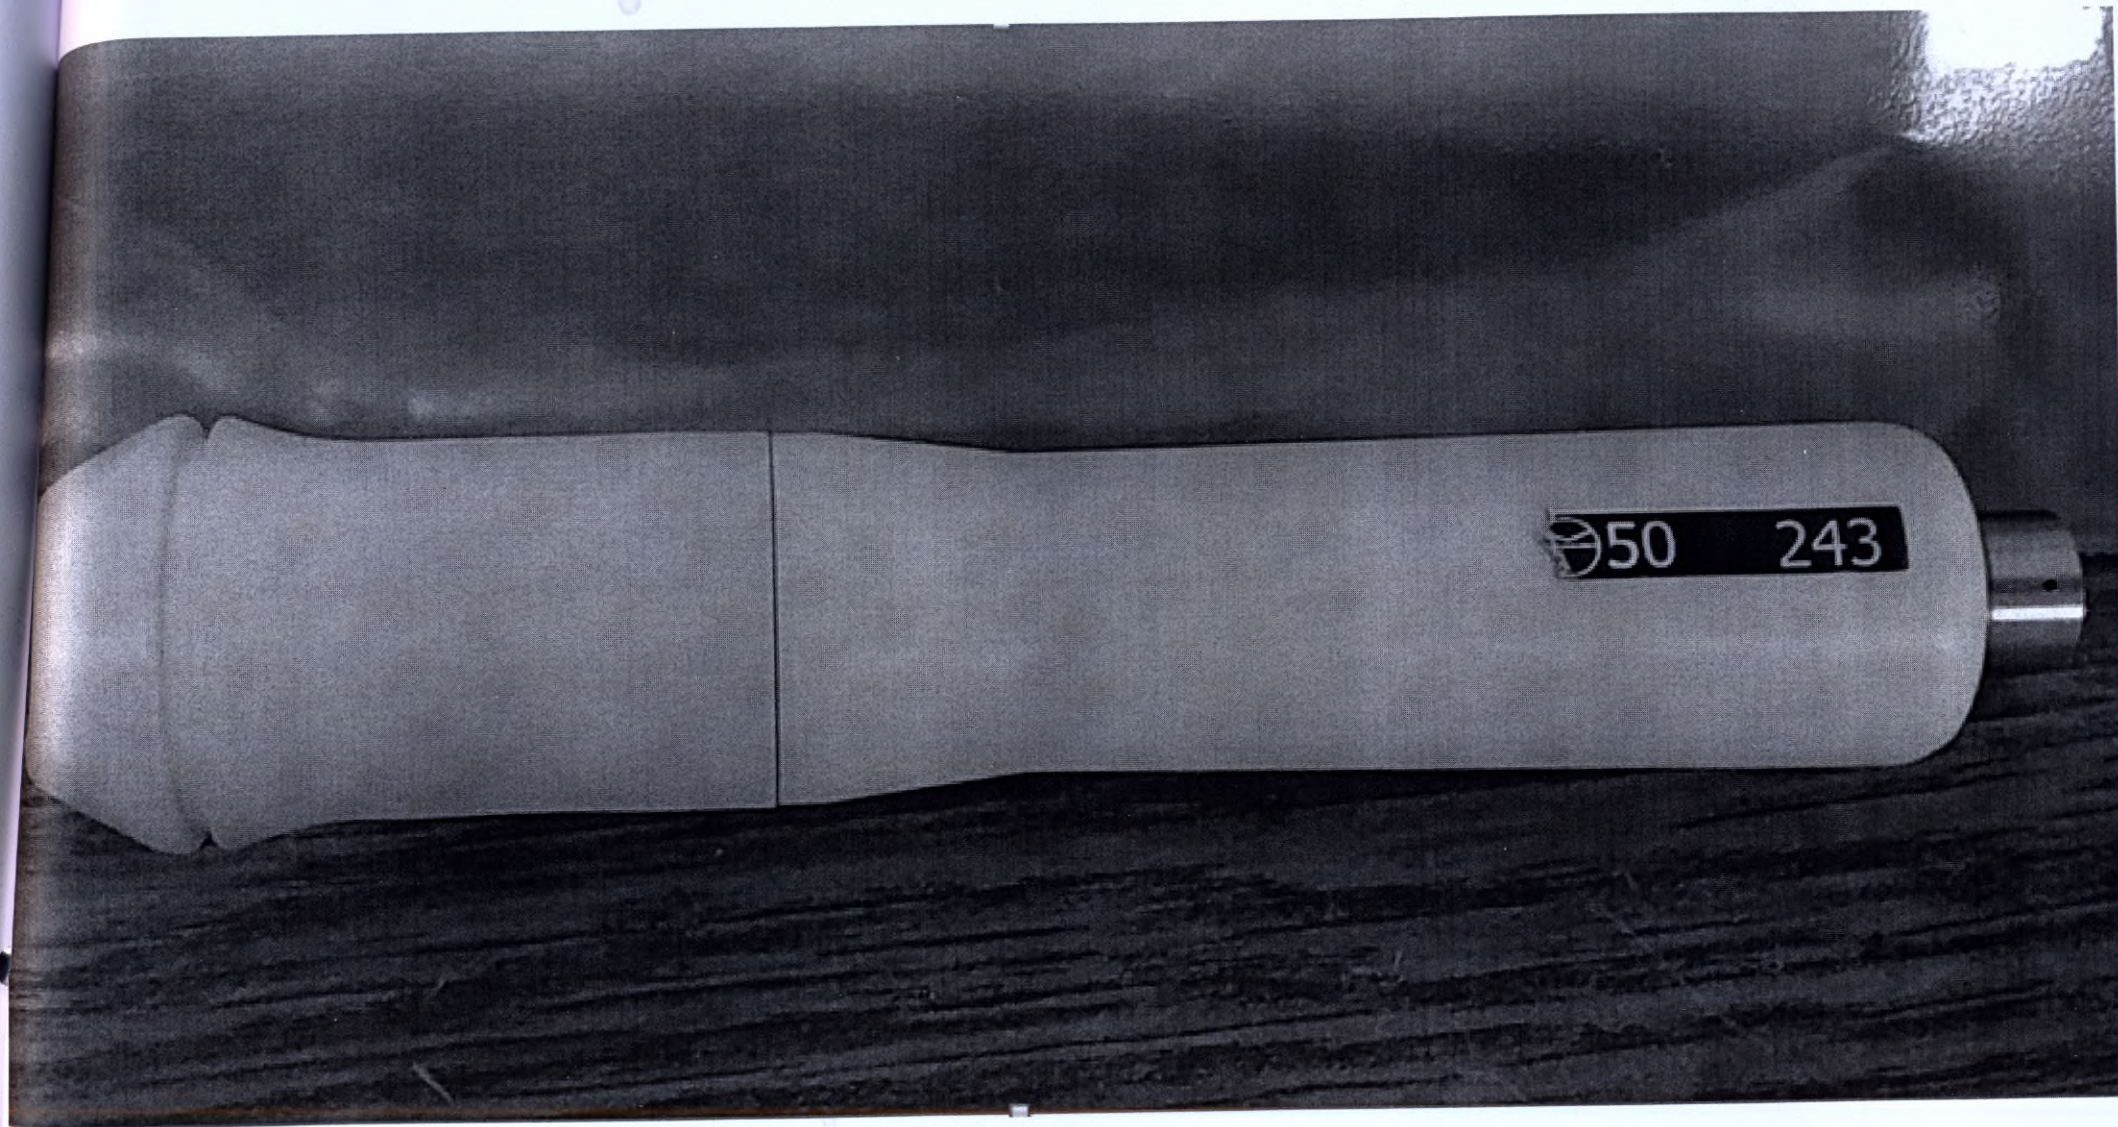


16. Стол передвижной с трансформатором изолирующим – 1 шт. (при необходимости)




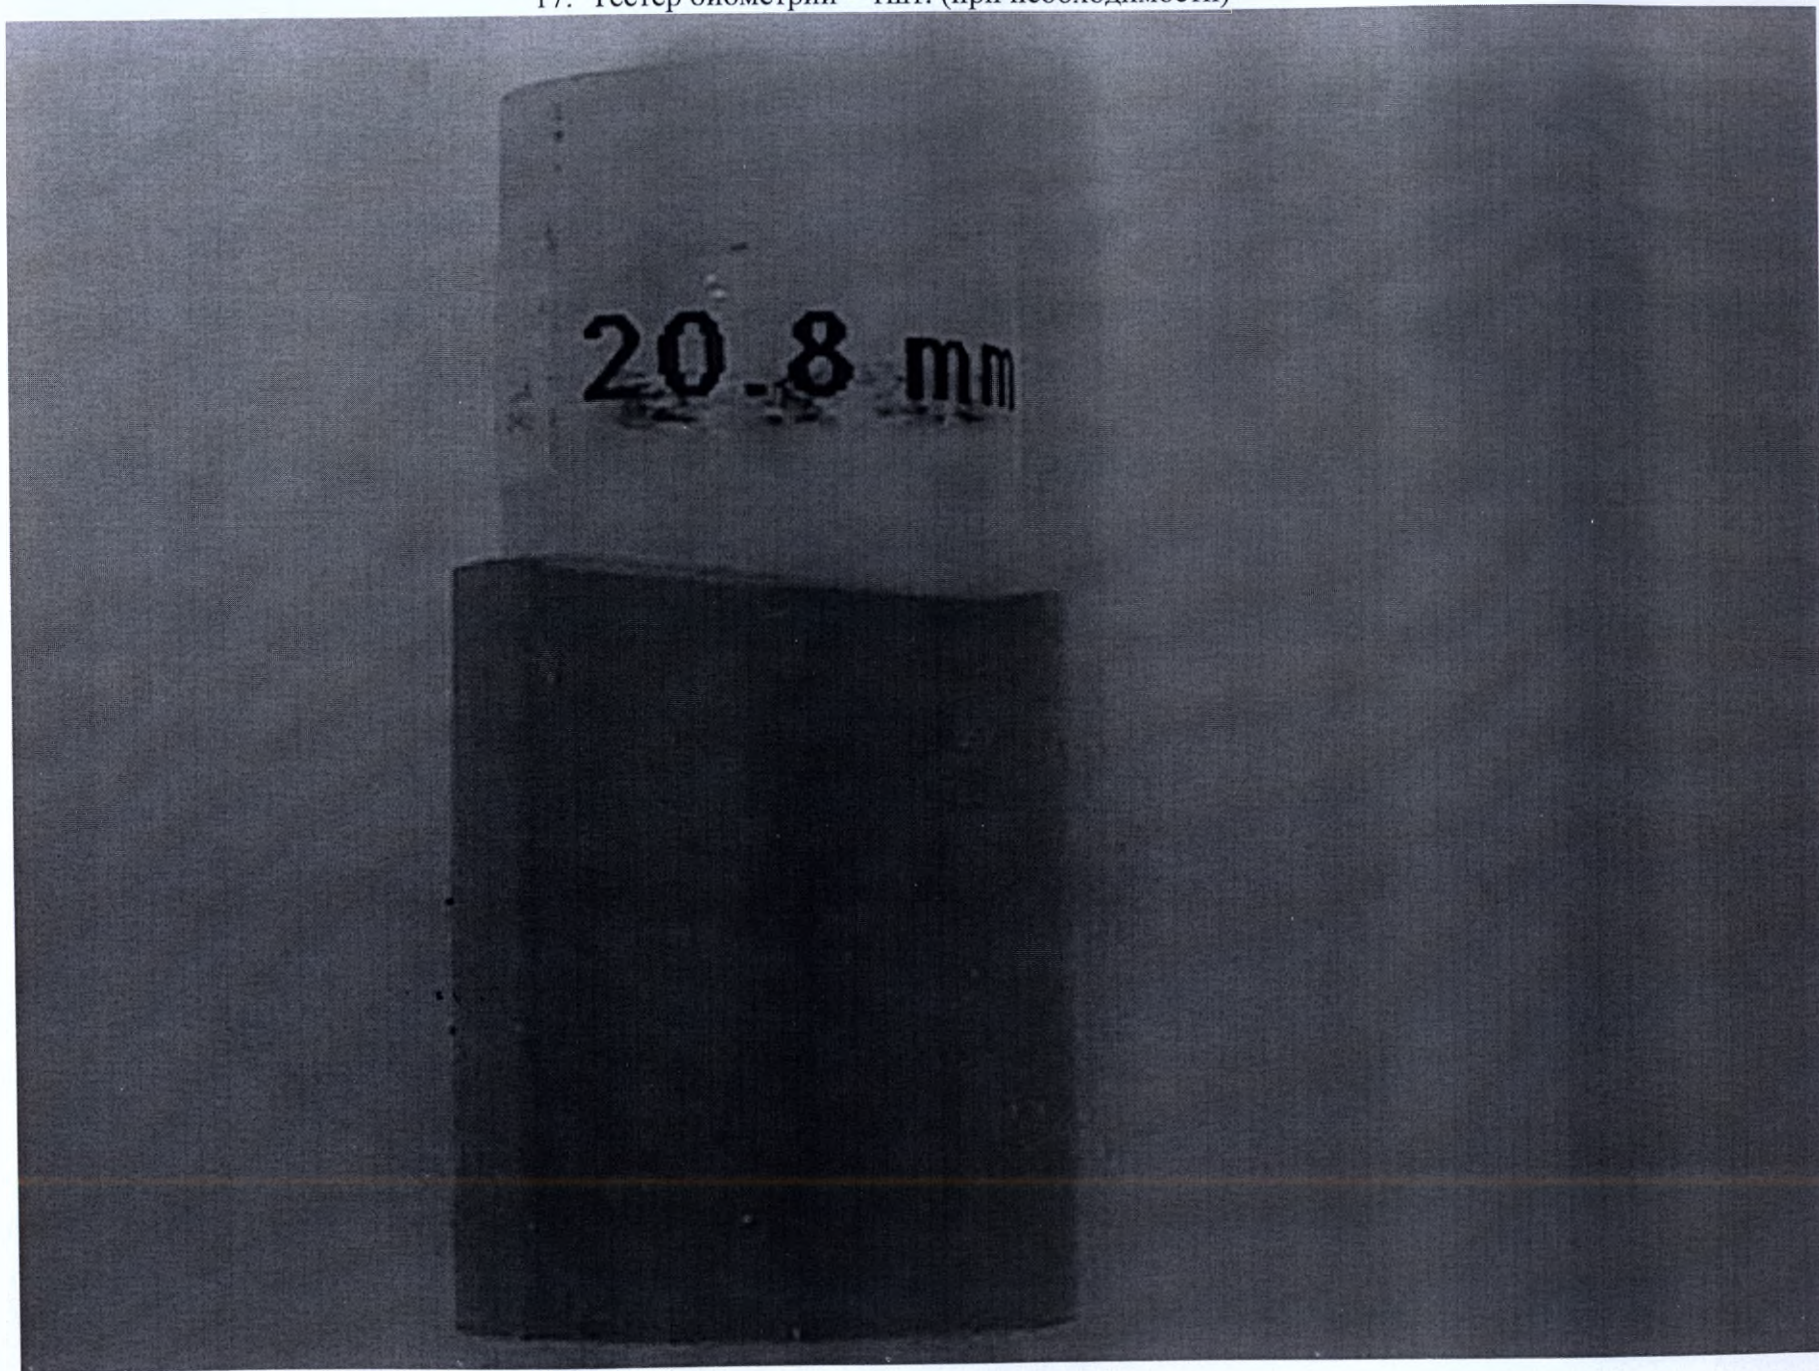


18. Чашка для иммерсионной биометрии диаметром 14 мм – 1 шт. (при необходимости)

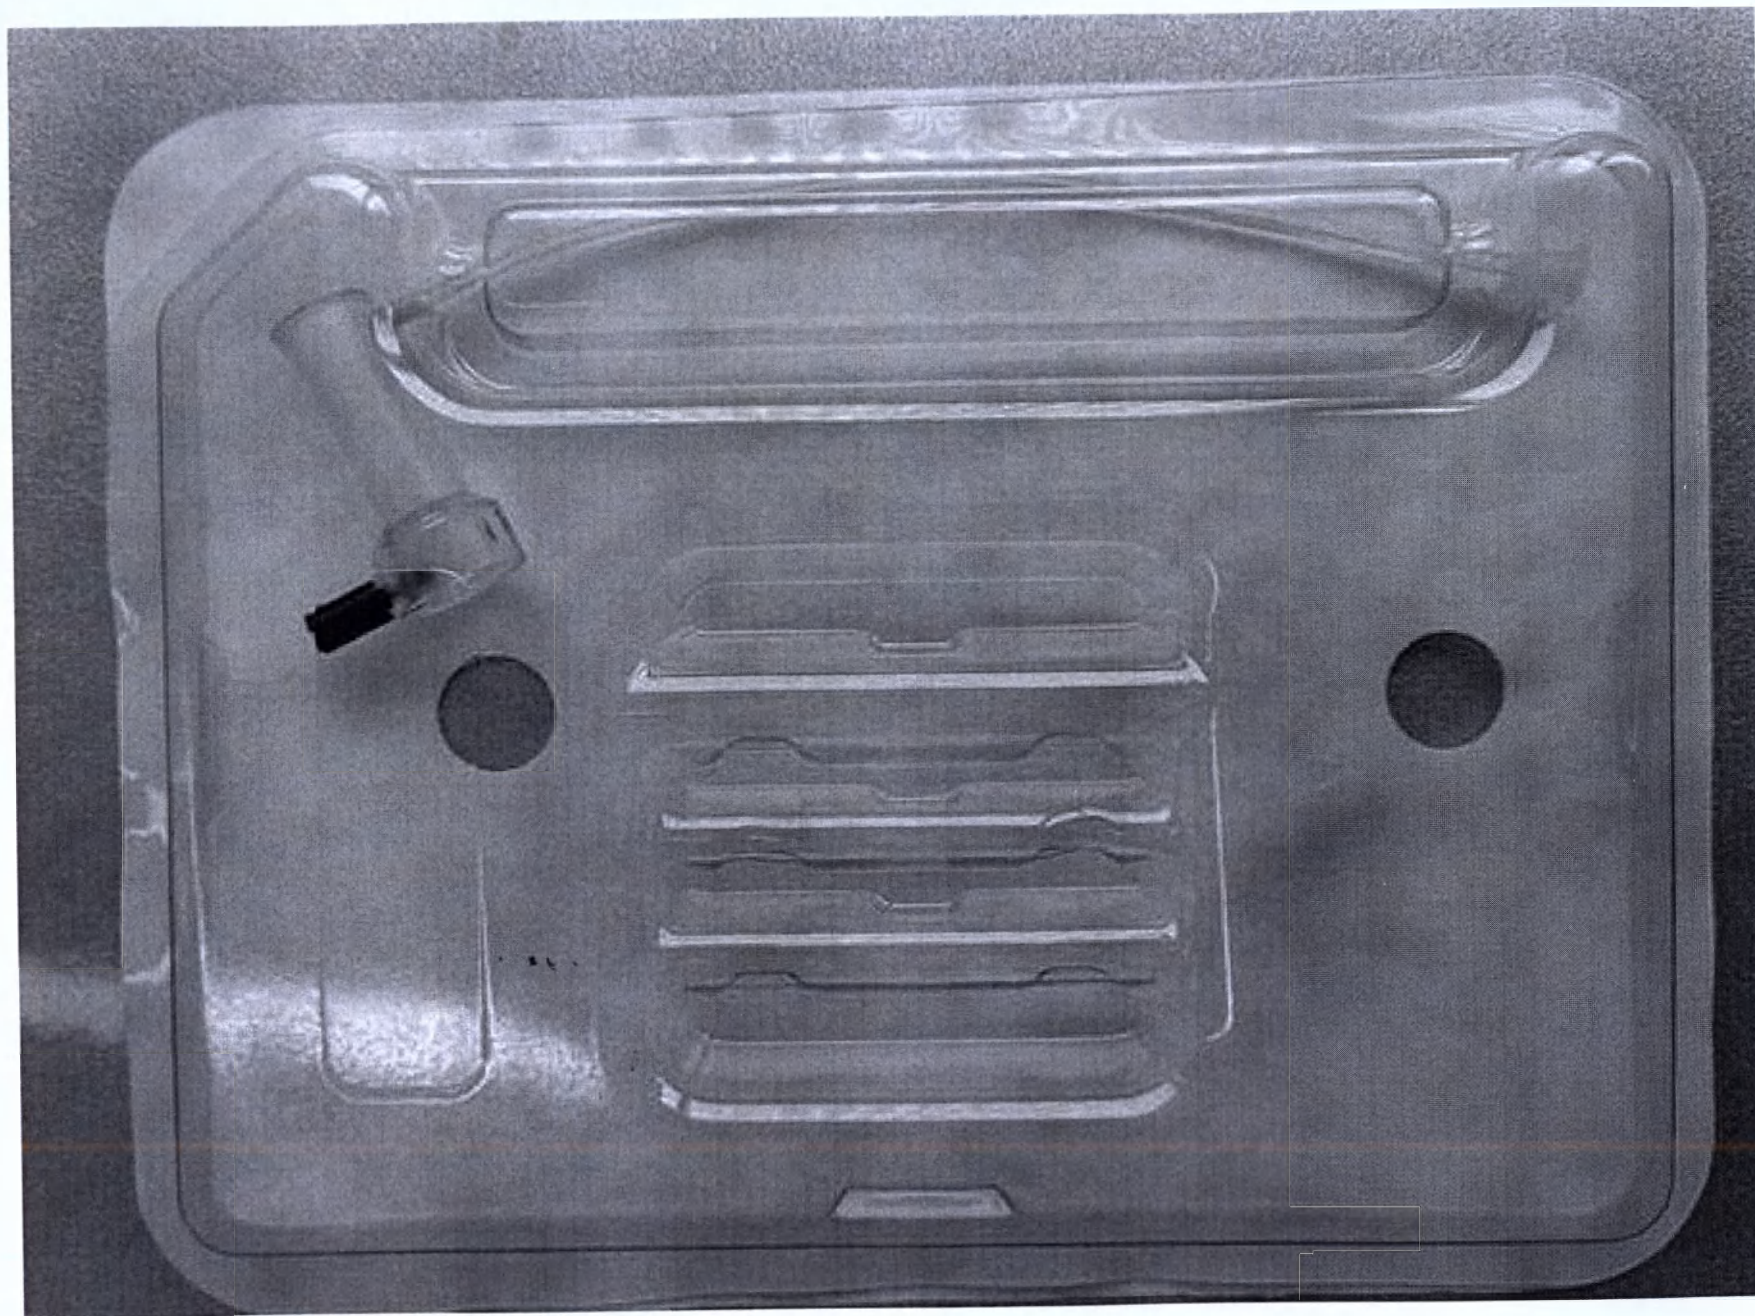


19. Чашка для иммерсионной биометрии диаметром 18 мм – 1 шт. (при необходимости)

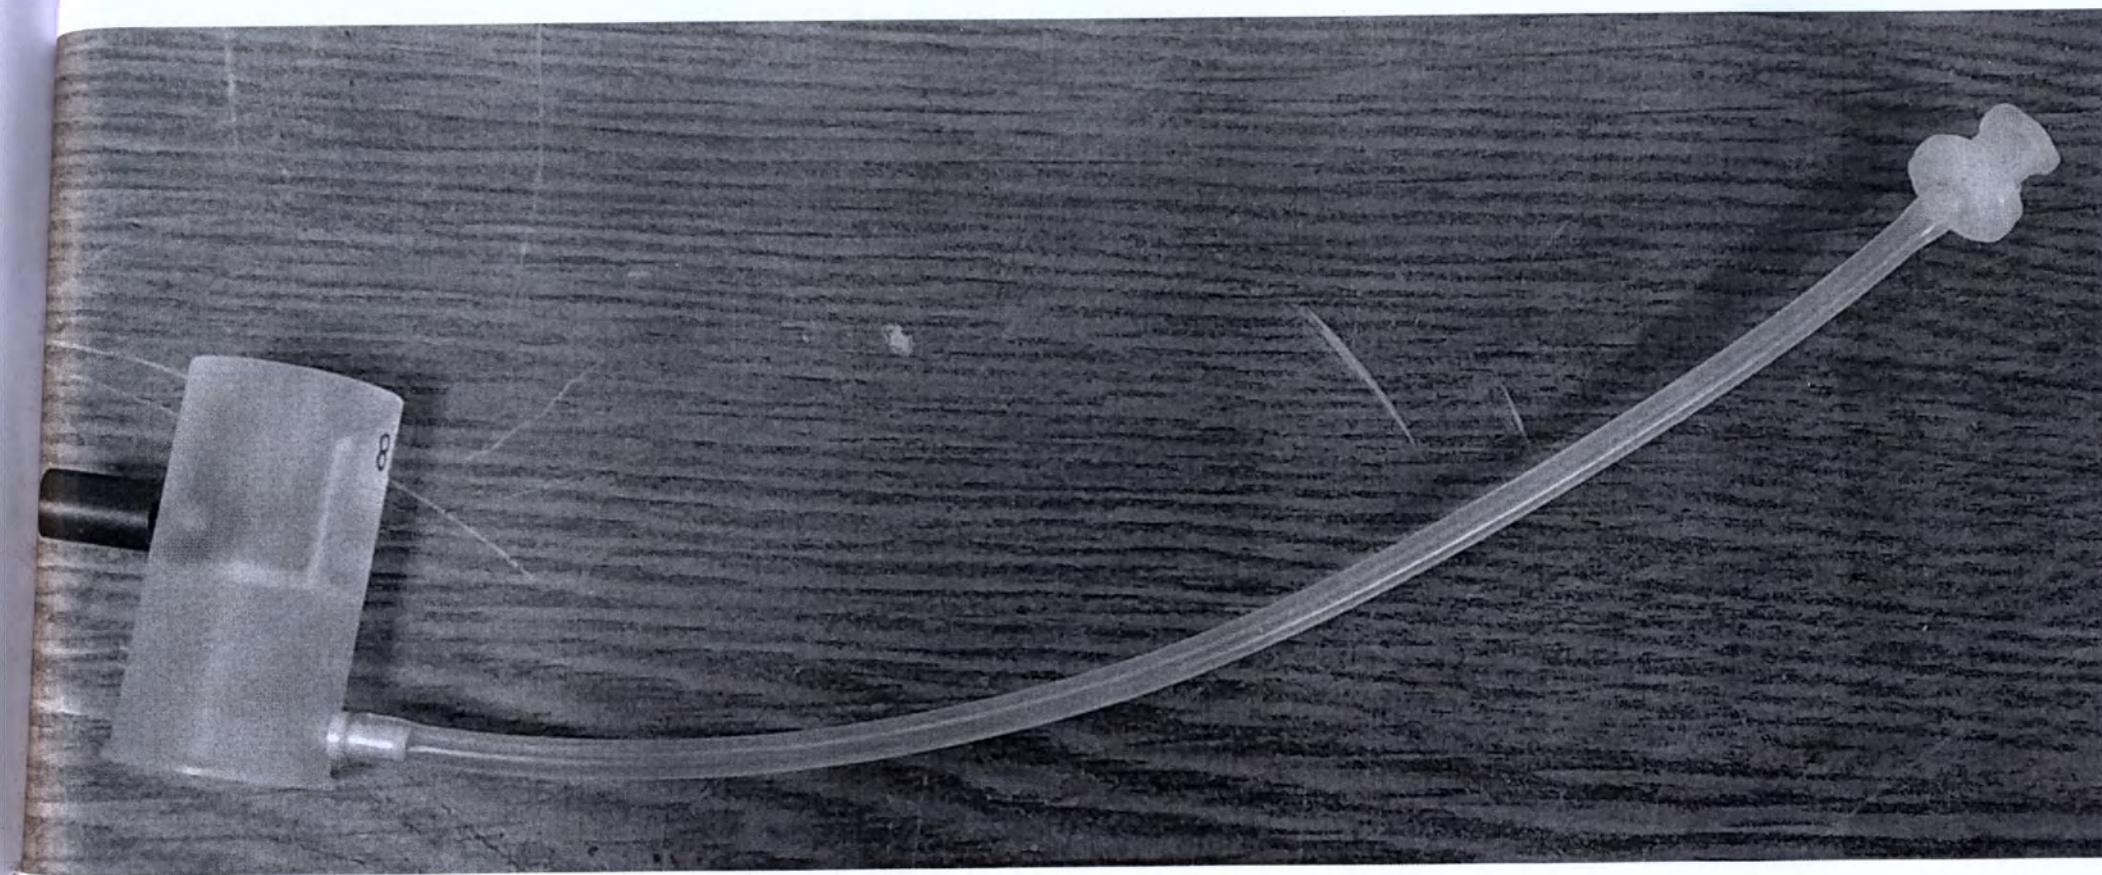


20. Набор Б-скан чашек иммерсионных – 1 шт. (при необходимости), в составе: 20.1. Чашка диаметром 19 мм – 1 шт;
20.2. Чашка диаметром 22 мм – 1 шт; 20.3. Чашка диаметром 24 мм – 1 шт.

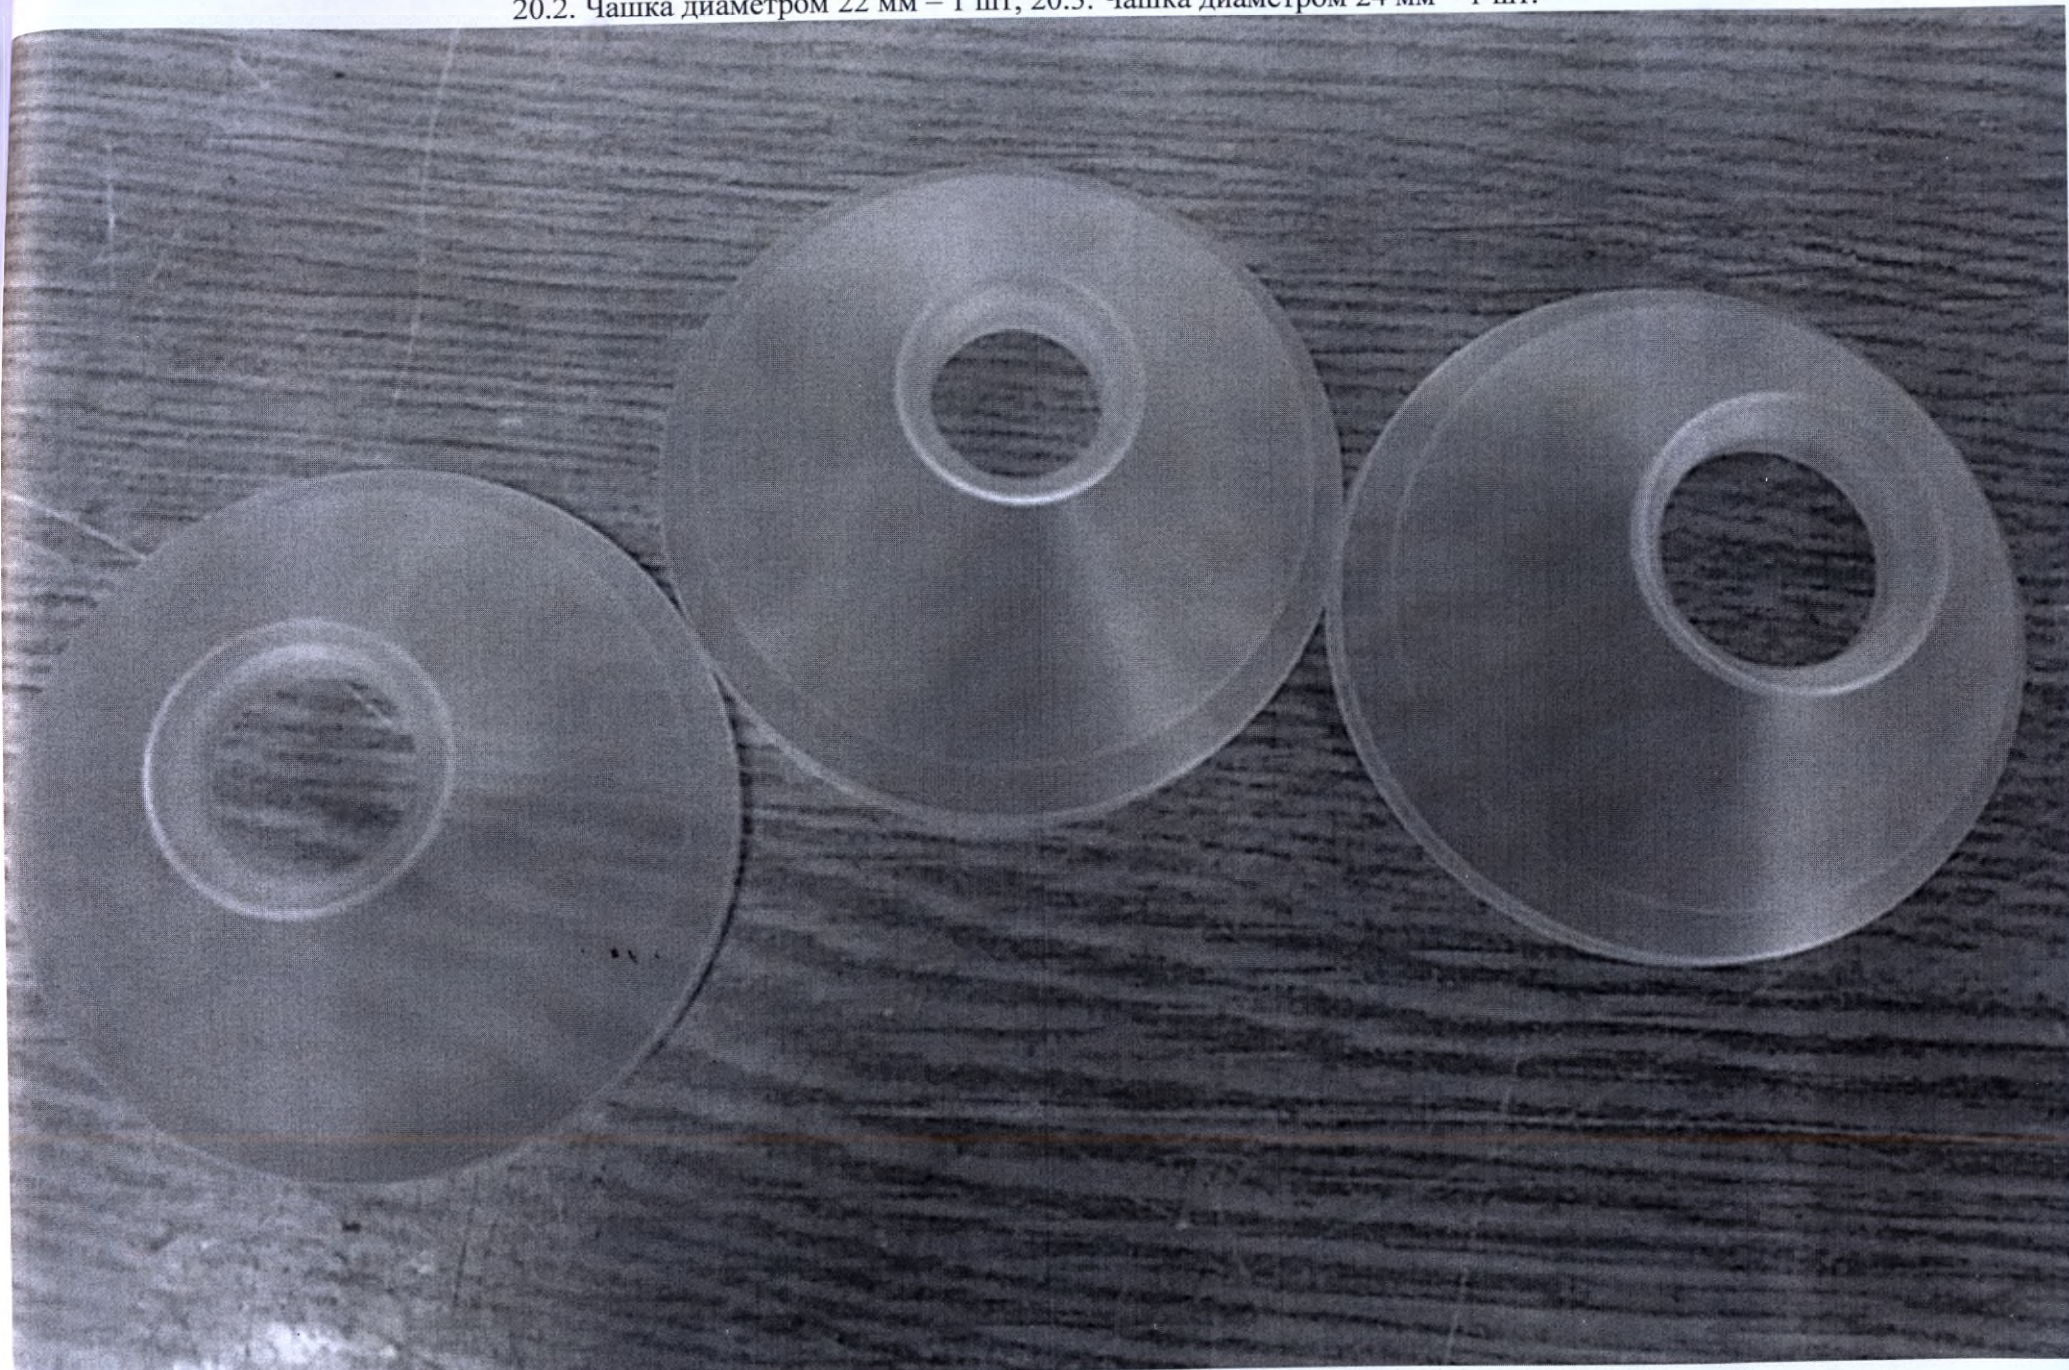


21. Датчик для Б-скан рукоятки, 25 МГц – 1шт. (при необходимости)

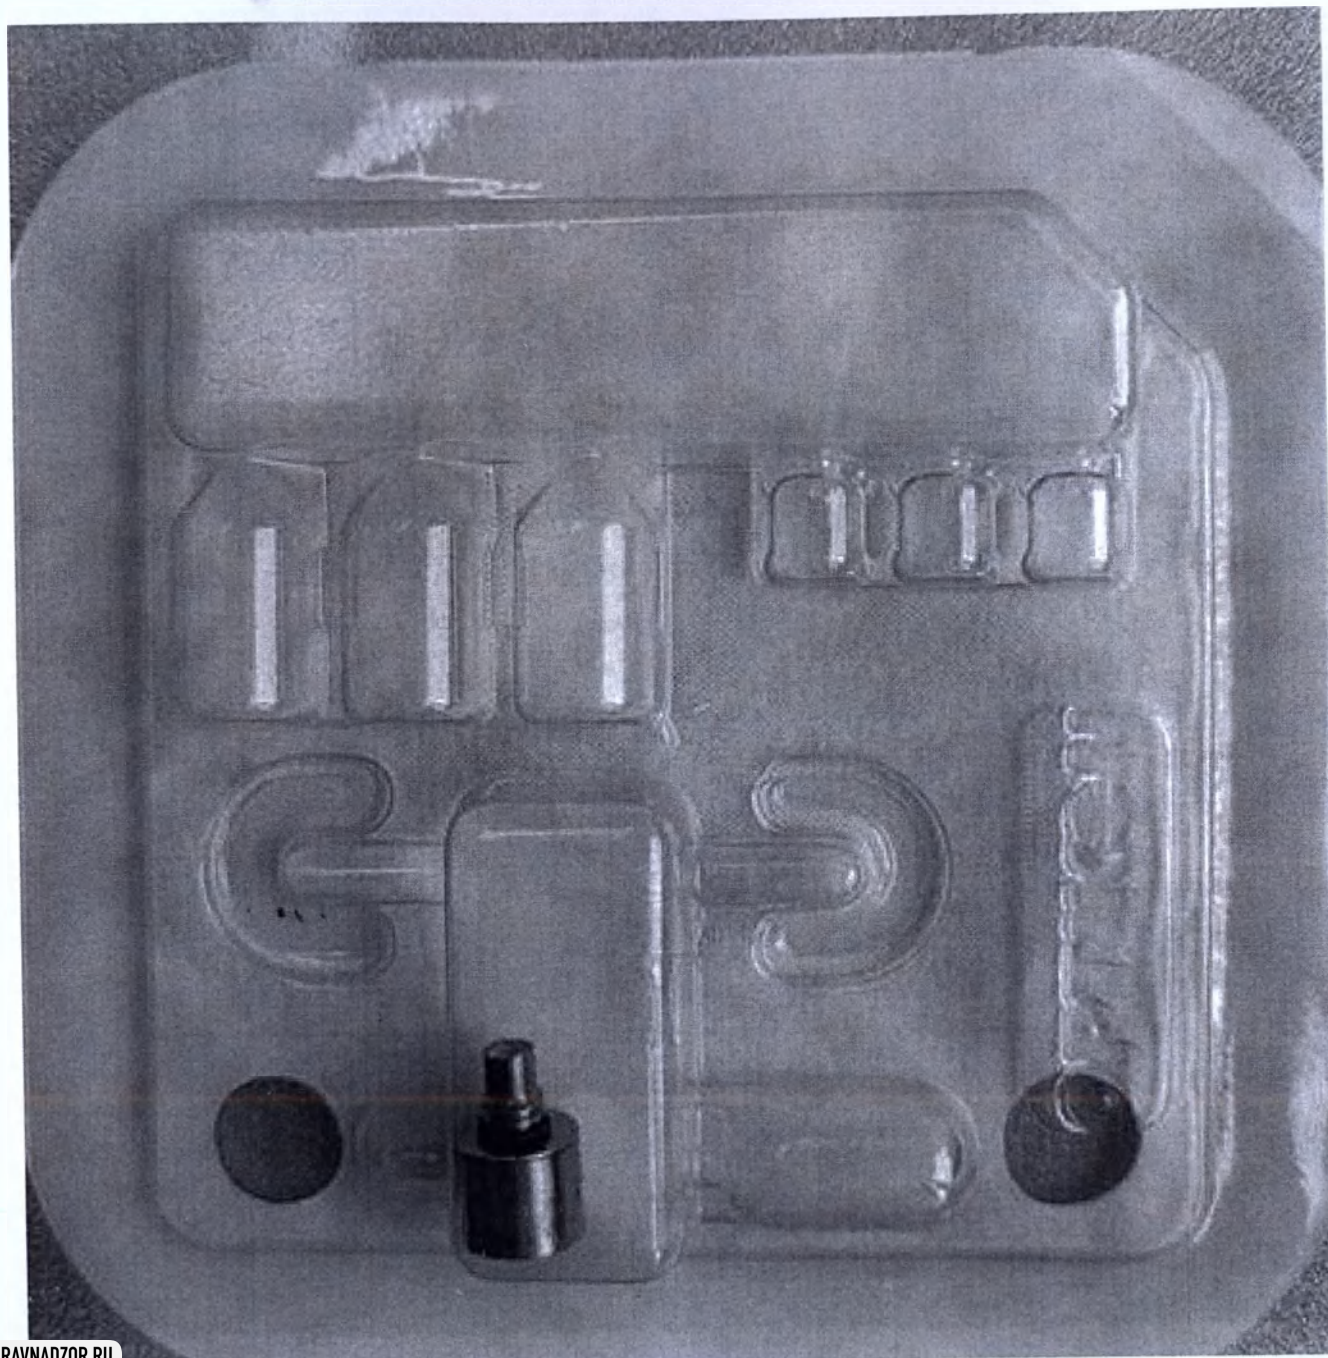


22. Датчик для Б-скан рукоятки, 35 МГц – 1шт. (при необходимости)

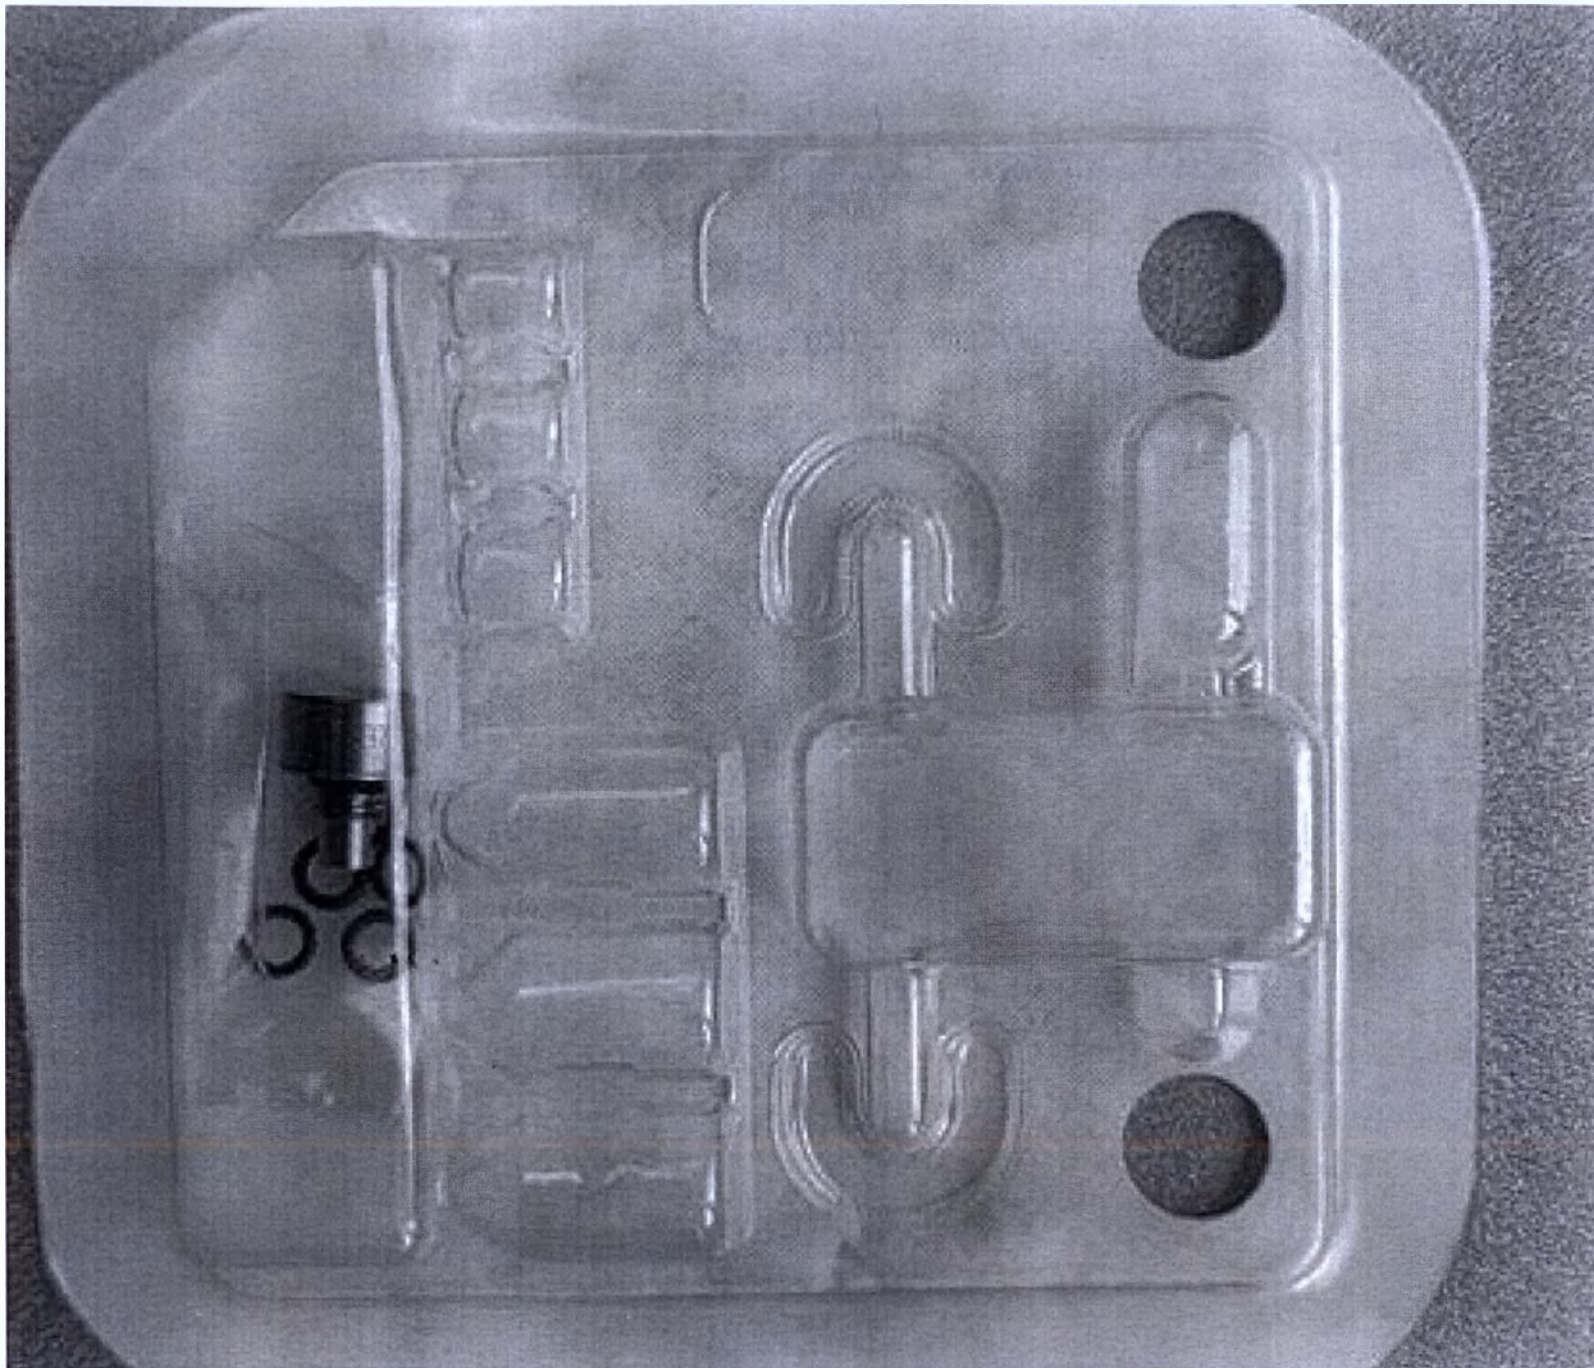

23. Датчик для Б-скан рукоятки, 50 МГц – 1шт. (при необходимости)

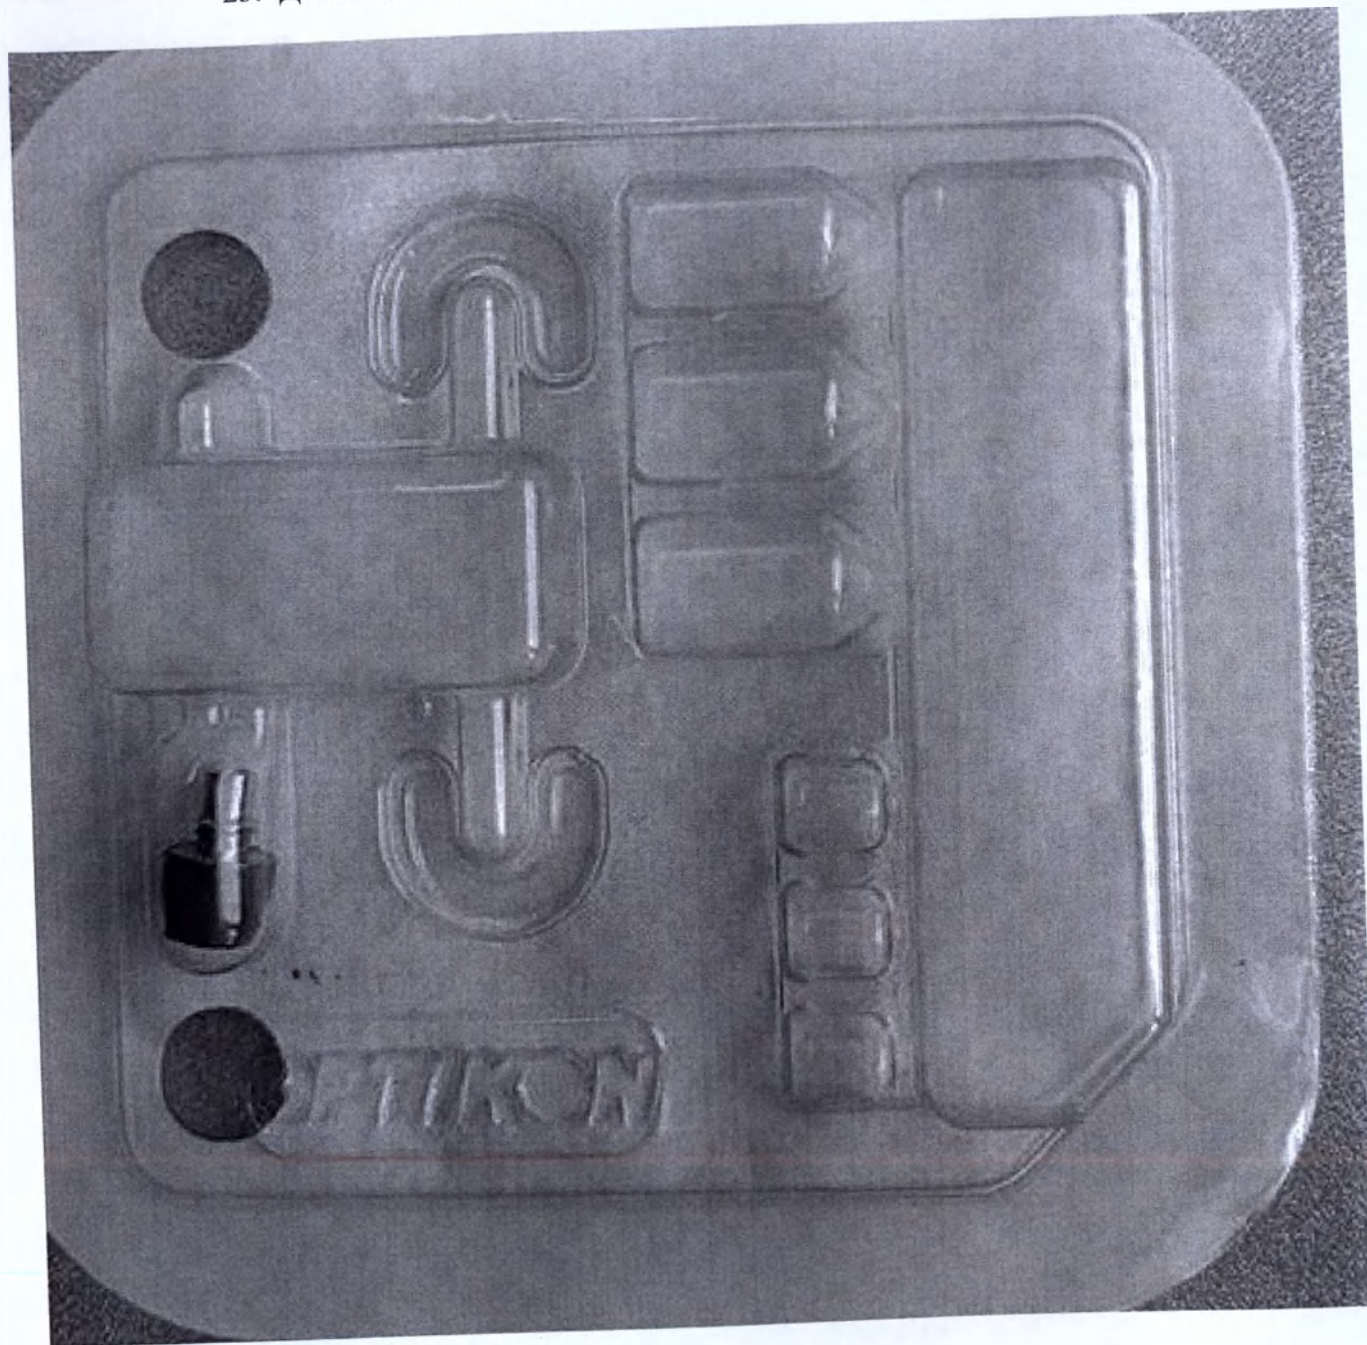

24. Рукоятка для пахиметрии – 1шт. (при необходимости)

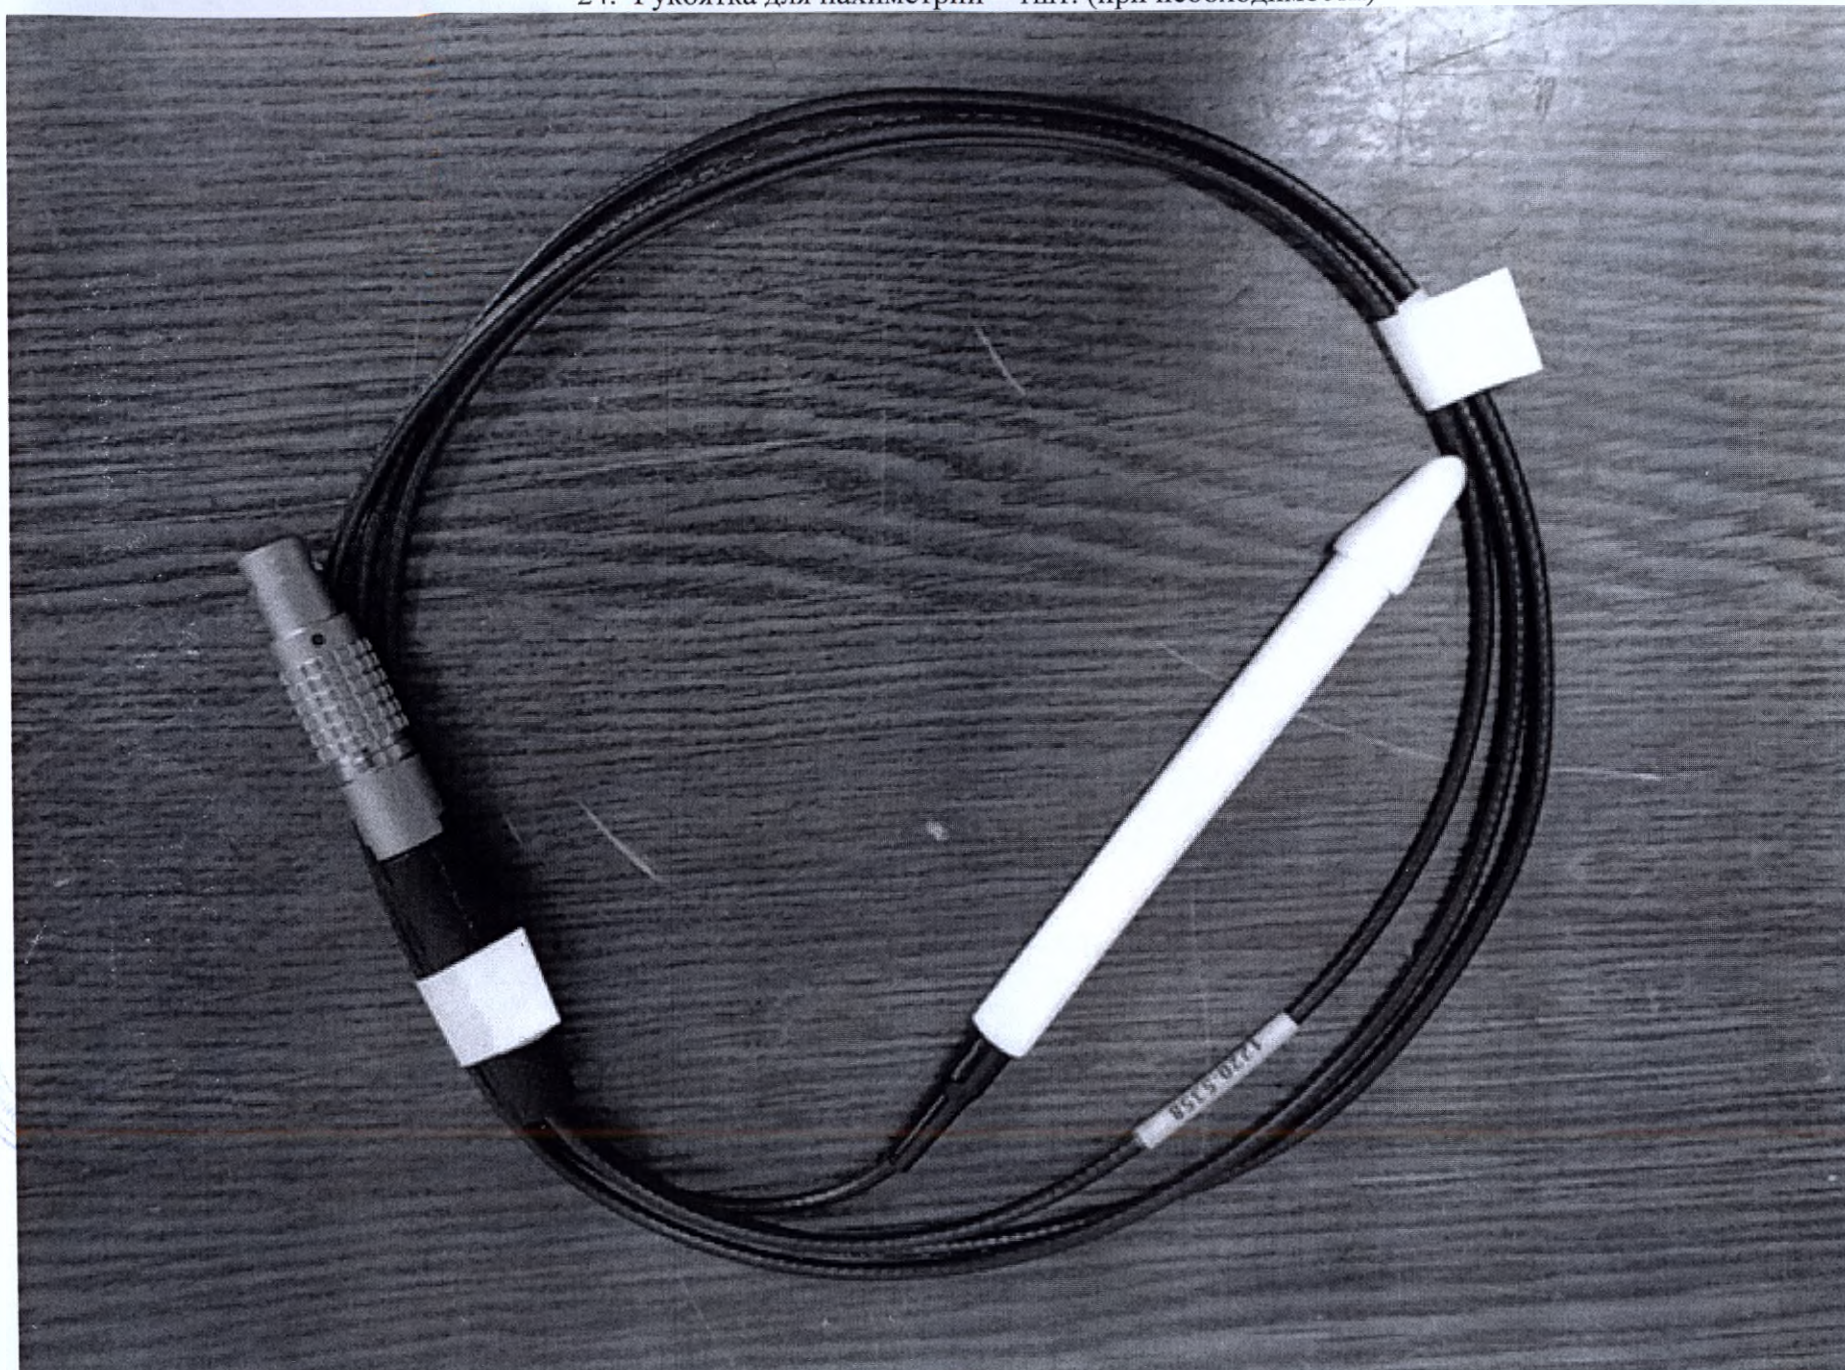

Прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

43 (сорок три) ЛИСТ(ОВ)
Генеральный директор ООО «Бисикей-Эм»
Васильева М.Ю.

Васильева

