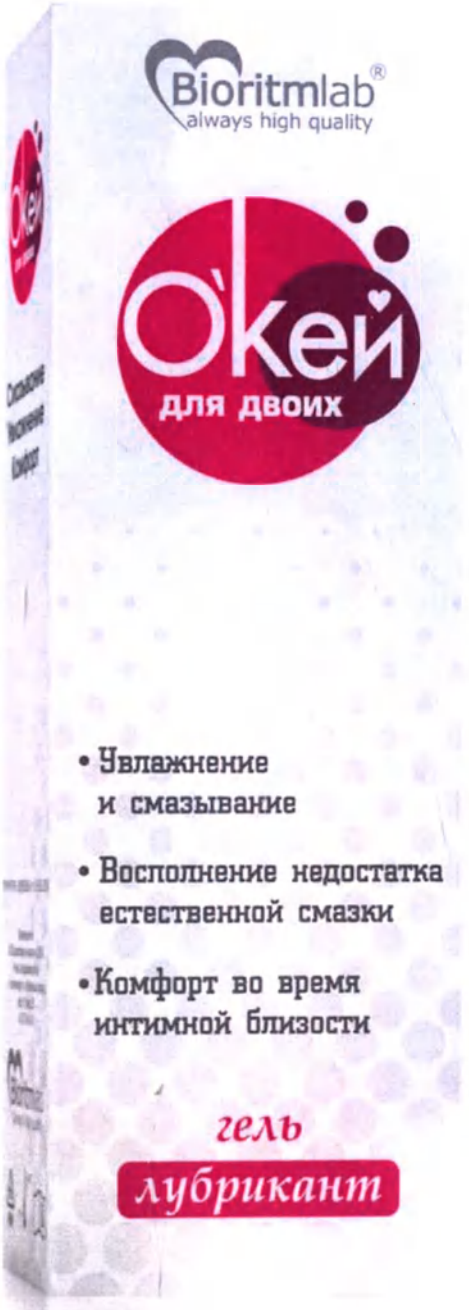

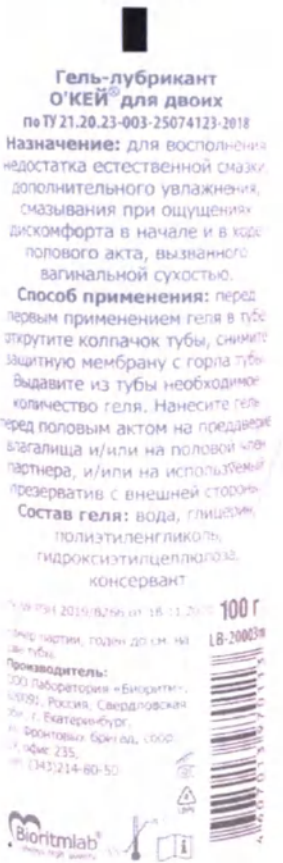

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

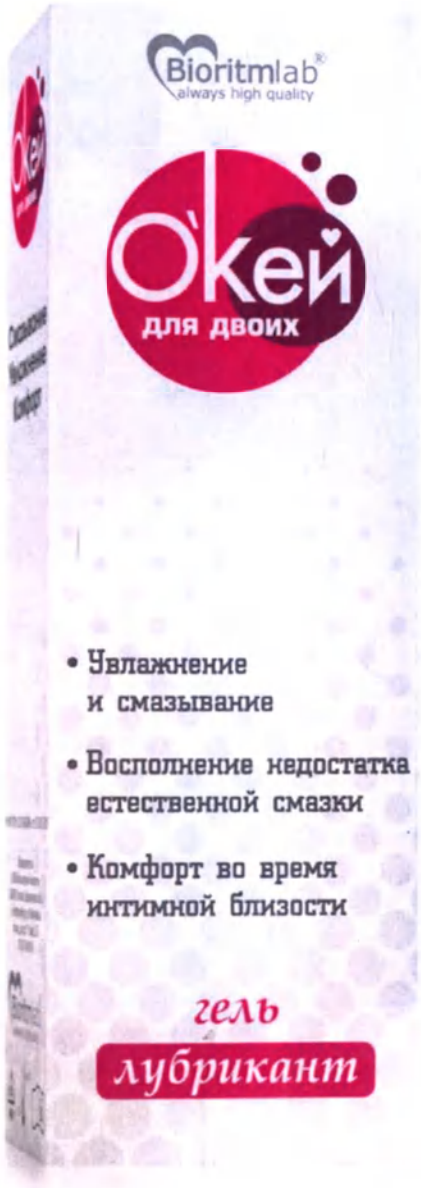

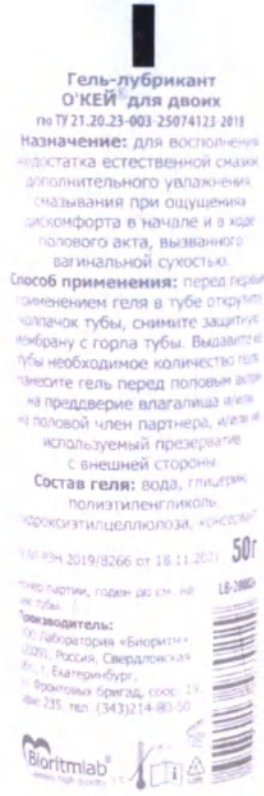

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

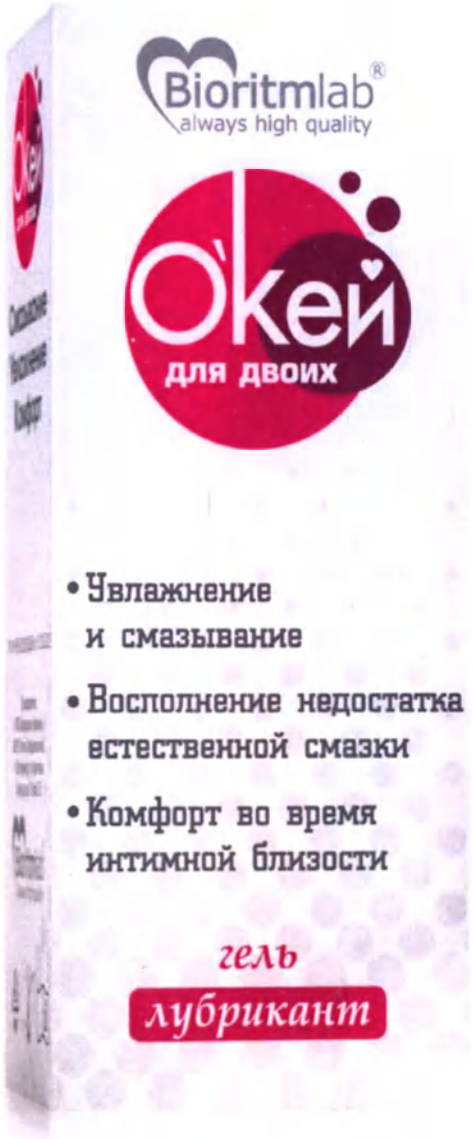

Bioritmlab®
always high quality

О'кей
для двоих

смазывание
увлажнение
комфорт

гель
лубрикант

Гель-лубрикант О'КЕЙ® для двоих
по ТУ 21.20.23-003-25074123-2018

Назначение: для восполнения недостатка естественной смазки, дополнительного увлажнения, смазывания при ощущениях дискомфорта в начале и в ходе полового акта, вызванного вагинальной сухостью.

Способ применения: перед первым применением геля в тубе открутите колпачок тубы, снимите защитную мембрану с горла тубы. Выдавите из тубы необходимое количество геля. Нанесите гель перед половым актом на преддверие влагалища и/или на половой член партнера, и/или на используемый презерватив с внешней стороны.

Состав геля: вода, глицерин, полиэтиленгликоль, гидроксиэтилцеллюлоза, консервант.

РУ № РЗН 2015/8266 от 18.11.2021

Номер партии, годен до см. на шве тубы

Производитель:
ООО Лаборатория «Биоритм»,
620091, Россия, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад,
corp. 19, офис 235, тел: (343)214-80-50

25г

Bioritmlab®

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Гель-лубрикант О'КЕЙ® ДЛЯ ДВОИХ

по ТУ 21.20.23-003-25074133-2018

РУ № РЗН 2019/8266 от 15.05.2019

Для восполнения недостатка увлажнения, сказывания естественной сказки, дополнительного увлажнения, сказывания при ощущениях дискомфорта в начале и в ходе полового акта, вызванного вагинальной сухостью.

Описание

вагинальной сухости, проявление которой может быть связано с целым рядом причин: наступление менопаузы, изменение гормонального фона; заболевания органов малого таза; частые состояния; хронические воспалительные заболевания (сахарный диабет, анемия); частые стрессовые ситуации; восстановление после терапии антибиотиками и противогрибковыми препаратами; после физиологических состояний, которые требуют дополнительного увлажнения.

Показания к применению:

- дискомфорта в начале и в ходе полового акта, вызванного вагинальной сухостью.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

рошито и пронумеровано и скреплено
ечатью 5 листа(ов).
ам. директора по производству
ОО Лаборатория «Биоритм»
абурдаева Галина Адхамовна

29 » марта 2023 года

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРДЖДАЮ

Директор ООО Лаборатория «Биоритм»

_____ Пашкевич К.И.

«14» февраля 2019 г.

Макет маркировки медицинского изделия

Гель-лубрикант О'кей® для двоих

по ТУ21.20.23-003-25074123-2018,

вариант исполнения туба 100 г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО Лаборатория «Биоритм»

_____ Пашкевич К.И.

«14» ноября 2019 г.

Макет маркировки медицинского изделия

Гель-лубрикант О'кей® для двоих

по ТУ21.20.23-003-25074123-2018,

вариант исполнения туба 50 г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО Лаборатория «Биоритм»

_____ Пашкевич К.И.

«14» января 2019 г.

Макет маркировки медицинского изделия

Гель-лубрикант О'кей® для двоих

по ТУ21.20.23-003-25074123-2018,

вариант исполнения туба 25 г

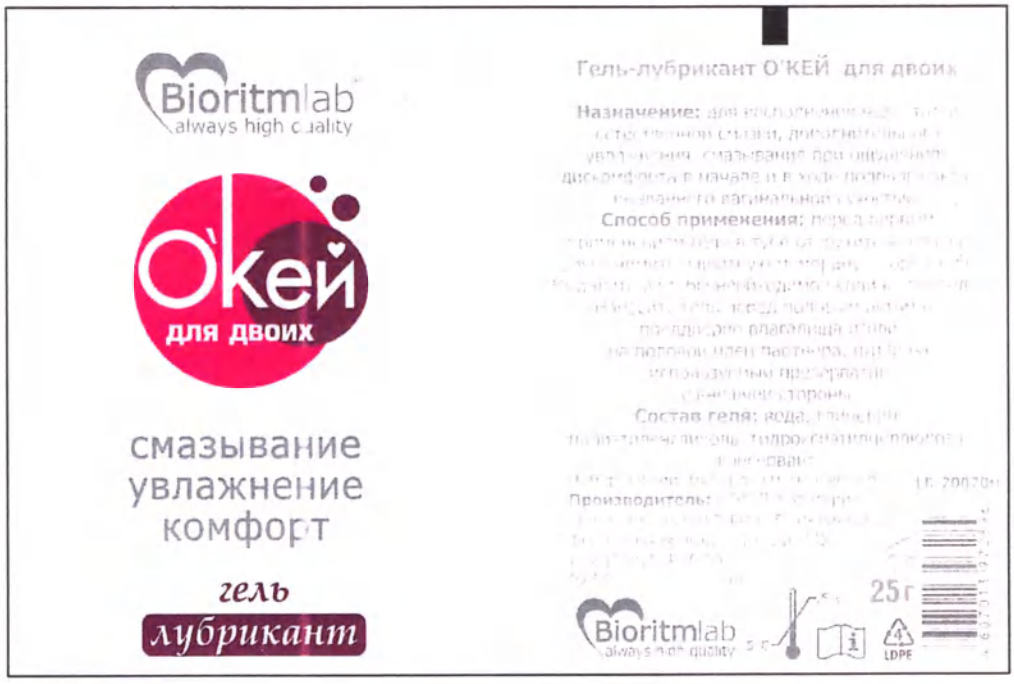

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРДЖДАЮ

Директор ООО Лаборатория «Биоритм»

_____ Платкевич К.И.

«14» 12 2019 г.

Макет маркировки медицинского изделия

Гель-лубрикант О'кей® для двоих

по ТУ21.20.23-003-25074123-2018,

вариант исполнения пакет-саше 4 г.

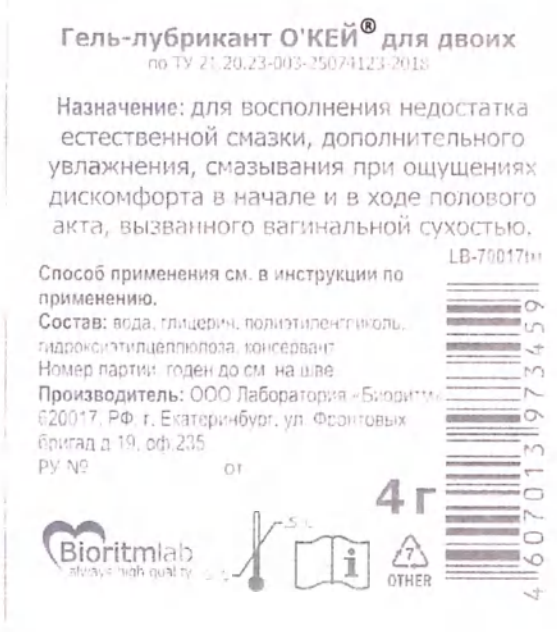

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 8 листа(ов).
Зам. директора по производству
ООО Лаборатория «Биоритм»
Забурдаева Галина Алхамовна

«29» июня 2023 года

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU