

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «биоМерье Рус»



Бердникова Н.В.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Набор реагентов BioFire Blood Culture Identification 2 (BCID2) Panel» для обнаружения и идентификации нуклеиновых кислот микроорганизмов и генов, определяющих устойчивость к антимикробным препаратам, в образцах культуры крови методом мультиплексной ПЦР на системах семейства FilmArray

1. Кассета с реагентами BioFire BCID2 Panel – 30 шт.
2. Раствор буферный – 1,0 мл × 32 шт. (ампула)
3. Раствор регидратирующий – 1,5 мл × 32 шт. (флакон с канюлей)
4. Флакон с канюлей для внесения образца – 32 шт.
5. Пипетка – 32 шт. Фотография общего вида.

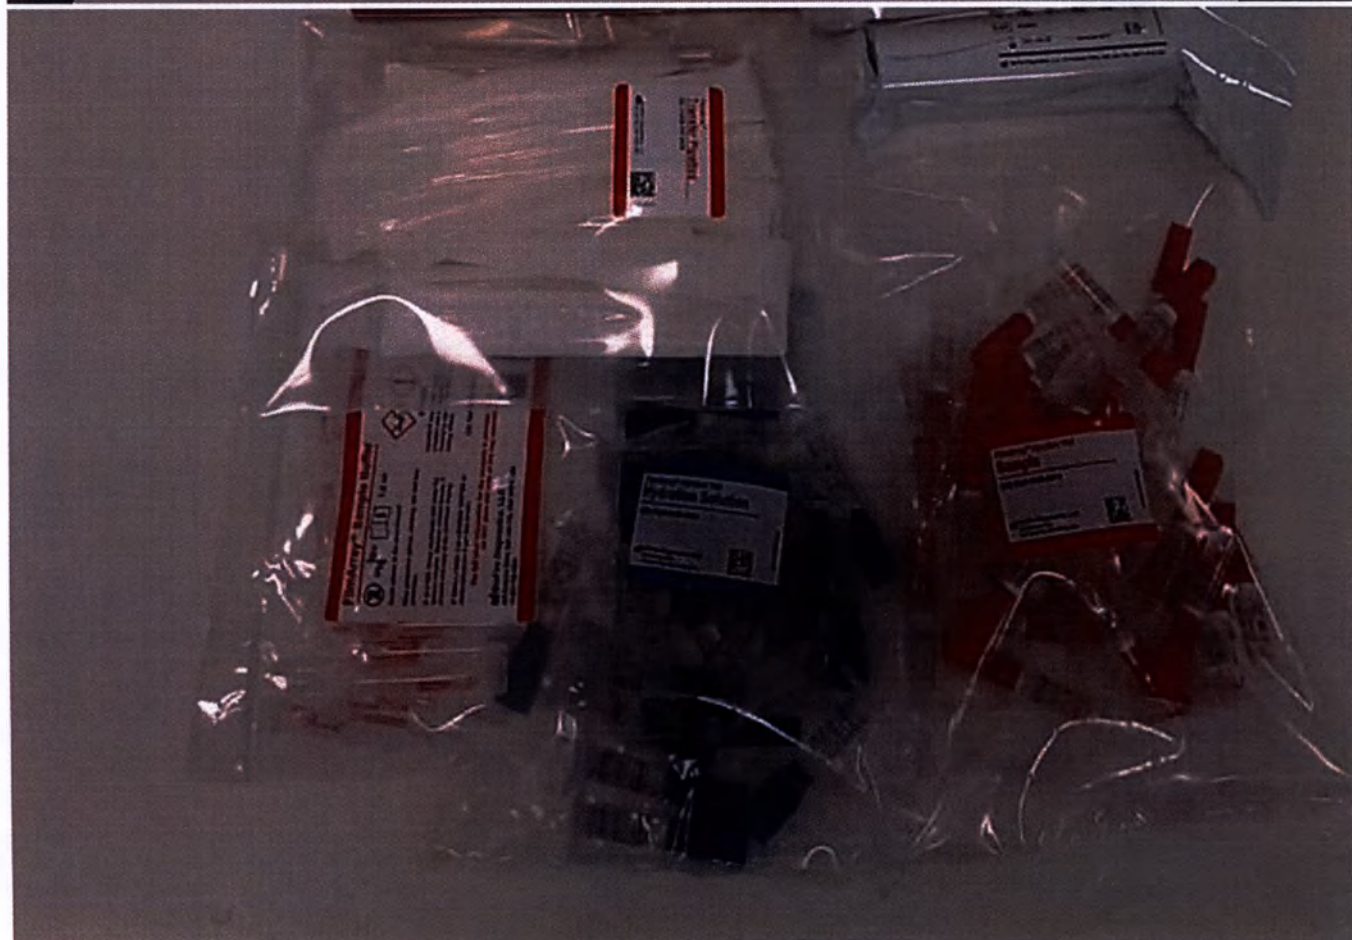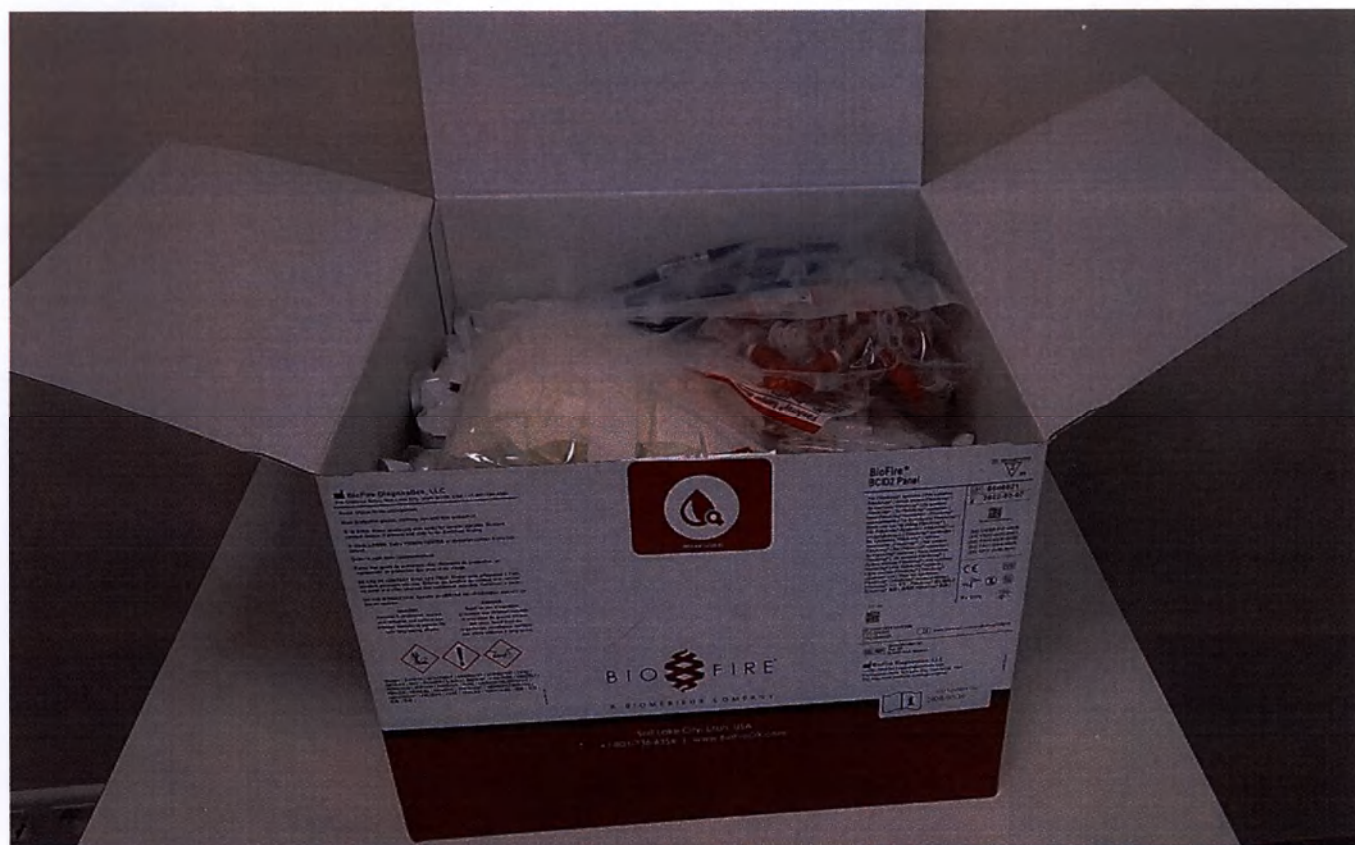

BioFire Diagnostics, LLC
515 Colorado Drive, Salt Lake City, Utah 84108, USA | +1-801-736-6354

Avoid release to the environment.

Wear protective gloves, clothing, eye and face protection.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.

Éviter la rejet dans l'environnement.

Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

DANGER

Harmful if swallowed, causes skin irritation and serious eye damage. Harmful to aquatic life with long lasting effects.

DANGER

Noctif en cas d'ingestion, provoque une irritation cutanée et provoque de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



Danger / BAHAYA / ОПАСНОСТЬ / NEBEZPEČÍ / FARE / GEVAAR / GHT / DANGER / ԽՈՒՐԻՔ / GEFAHR / KINAYNOE / VESZÉLY / PERICOLO / BİTAM / PAVOJAS / FARE / NEBEZPEČENSTVO / PERIGO / PERICOLO / ОПАСНО / ОПАСНОСТЬ / NEBEZPEČENSTVO / NEVARNOST / PELIGRO / FARA / TEHLĚ / NGUY HIỂM / 危險 / 危険 / 危險




BIO FIRE

A BIOMÉRIEUX COMPANY

Salt Lake City, Utah, USA
+1-801-736-6354 | www.BioFireDX.com

BioFire®
BCID2 Panel



For FilmArray® systems (Pro system)
FilmArray® / Untuk sistem FilmArray®
Za sistem FilmArray® / Za sistem
FilmArray® / Το FilmArray®-system
Voor FilmArray®-toestellen (FilmArray®
systeem) / Για συστήματα FilmArray®
Dành cho các hệ thống FilmArray®
Für FilmArray®-Systeme / FilmArray®-
anordnungen / FilmArray®-stelsamen
Do systemów FilmArray® / Skitas
sistemoms / FilmArray® / Per sistemi
FilmArray® / For FilmArray®-systemer
Za FilmArray® sisteme / Para sistemas
FilmArray® / Za sisteme FilmArray®
Pentru sisteme FilmArray® / Pre systémy
FilmArray® / Für FilmArray®-system
[Don't confuse FilmArray® / FilmArray®
sistemleri için / Pour les systèmes
FilmArray® / FilmArray® rendszerhez /
FilmArray® / 시스템 / FilmArray® / 系统 /
FilmArray® 系統 / 適用於 FilmArray® 系統]

KIT USE



(01)00815361020338
(17)220214
(10)0574621

www.biofire.com/labelling/170048

EC REP

Qared SC-REP BV
Pia 257
6-2440 Geel, Belgium

BioFire Diagnostics, LLC
+1-801-736-6354 | support@biofire.com
515 Colorado Drive, Salt Lake City, Utah 84108, USA
Pat: http://www.biofire.com/legal-notices/



IFU Updated On:
2020-07-30

REF RFIT-ASY-0147

RU

Производитель:
«БиоФаер Диагностика, ЛПС»,
США

Набор реагентов BioFire Blood Culture Identification 2 (BCID2) Panel для обнаружения и идентификации нуклеиновых кислот микроорганизмов и генов, определяющих устойчивость к антимикробным препаратам, в образцах культуры крови методом мультиплексной ПЦР на системах семейства FilmArray

1. Кассета с реагентами BioFire BCID2 Panel – 30 шт.
2. Раствор буферный – 1,0 мл x 32 шт. (ампула)
3. Раствор регидратирующий – 1,5 мл x 32 шт. (флакон с канюлей)
4. Флакон с канюлей для внесения образца – 32 шт.
5. Пипетка – 32 шт.

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «БиоМерье Рус»
Адрес:
Россия, 115230, Москва,
1-ый Нагатинский проезд, д. 10, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 221 10 79

RU указываются номер и дата
регистрационного удостоверения



Внешний вид компонентов набора

1. Кассета с реагентами BioFire BCID2 Panel

BioFire®
BCID2 Panel
v1.0

CE IVD B: 002

15°C / 25°C

RT-LBL-0385-02

LOT 18MZ21

2022-02-07

RFIT-SUB-0842

RT-LBL-0385-02

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96


97

98

99

100

2. Раствор буферный - 1,0 мл

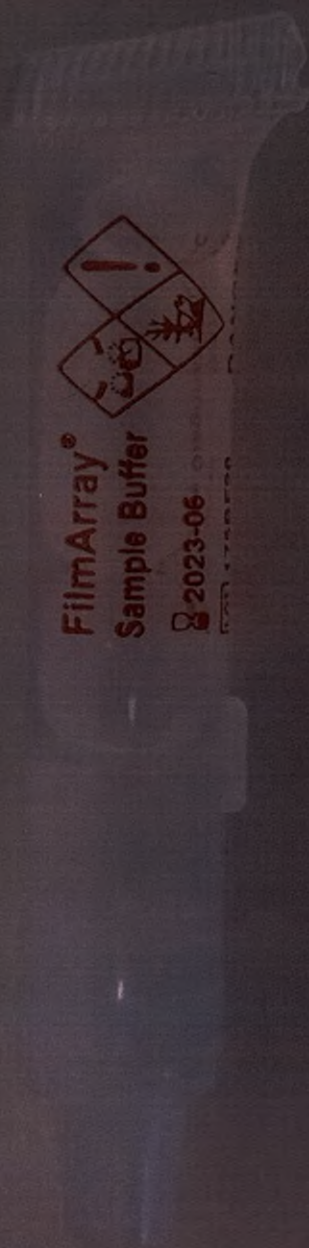

3. Раствор регидратирующий – 1,5 мл



4. Флакон с канюлей для внесения образца

FilmArray®
Sample

LOT 1136820

BioFire Diagnostics
Salt Lake City, Utah

5. Пипетка



Прошито и пронумеровано

10 листов

«27» августа 2024 года

Генеральный директор
Бердникова Н.В.

