


Общество с ограниченной ответственностью «ИПС»
(ООО «ИПС»)
121351, Россия, Москва, ул. Коцюбинского, д. 4, офис 202
Тел./Факс: (495) 775-27-89/937-58-44
E-mail: zaoips1@gmail.com

ОКПО 78025320, ОГРН 1057747567877, ИНН/КПП 7708568682/773101001
р/с № 40702810700000000405 в ООО Дойче банк г. Москвы
к/с 30101810100000000101 БИК 044525101

**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**«Томограф магнитно-резонансный
AIRIS Vento
с принадлежностями»**

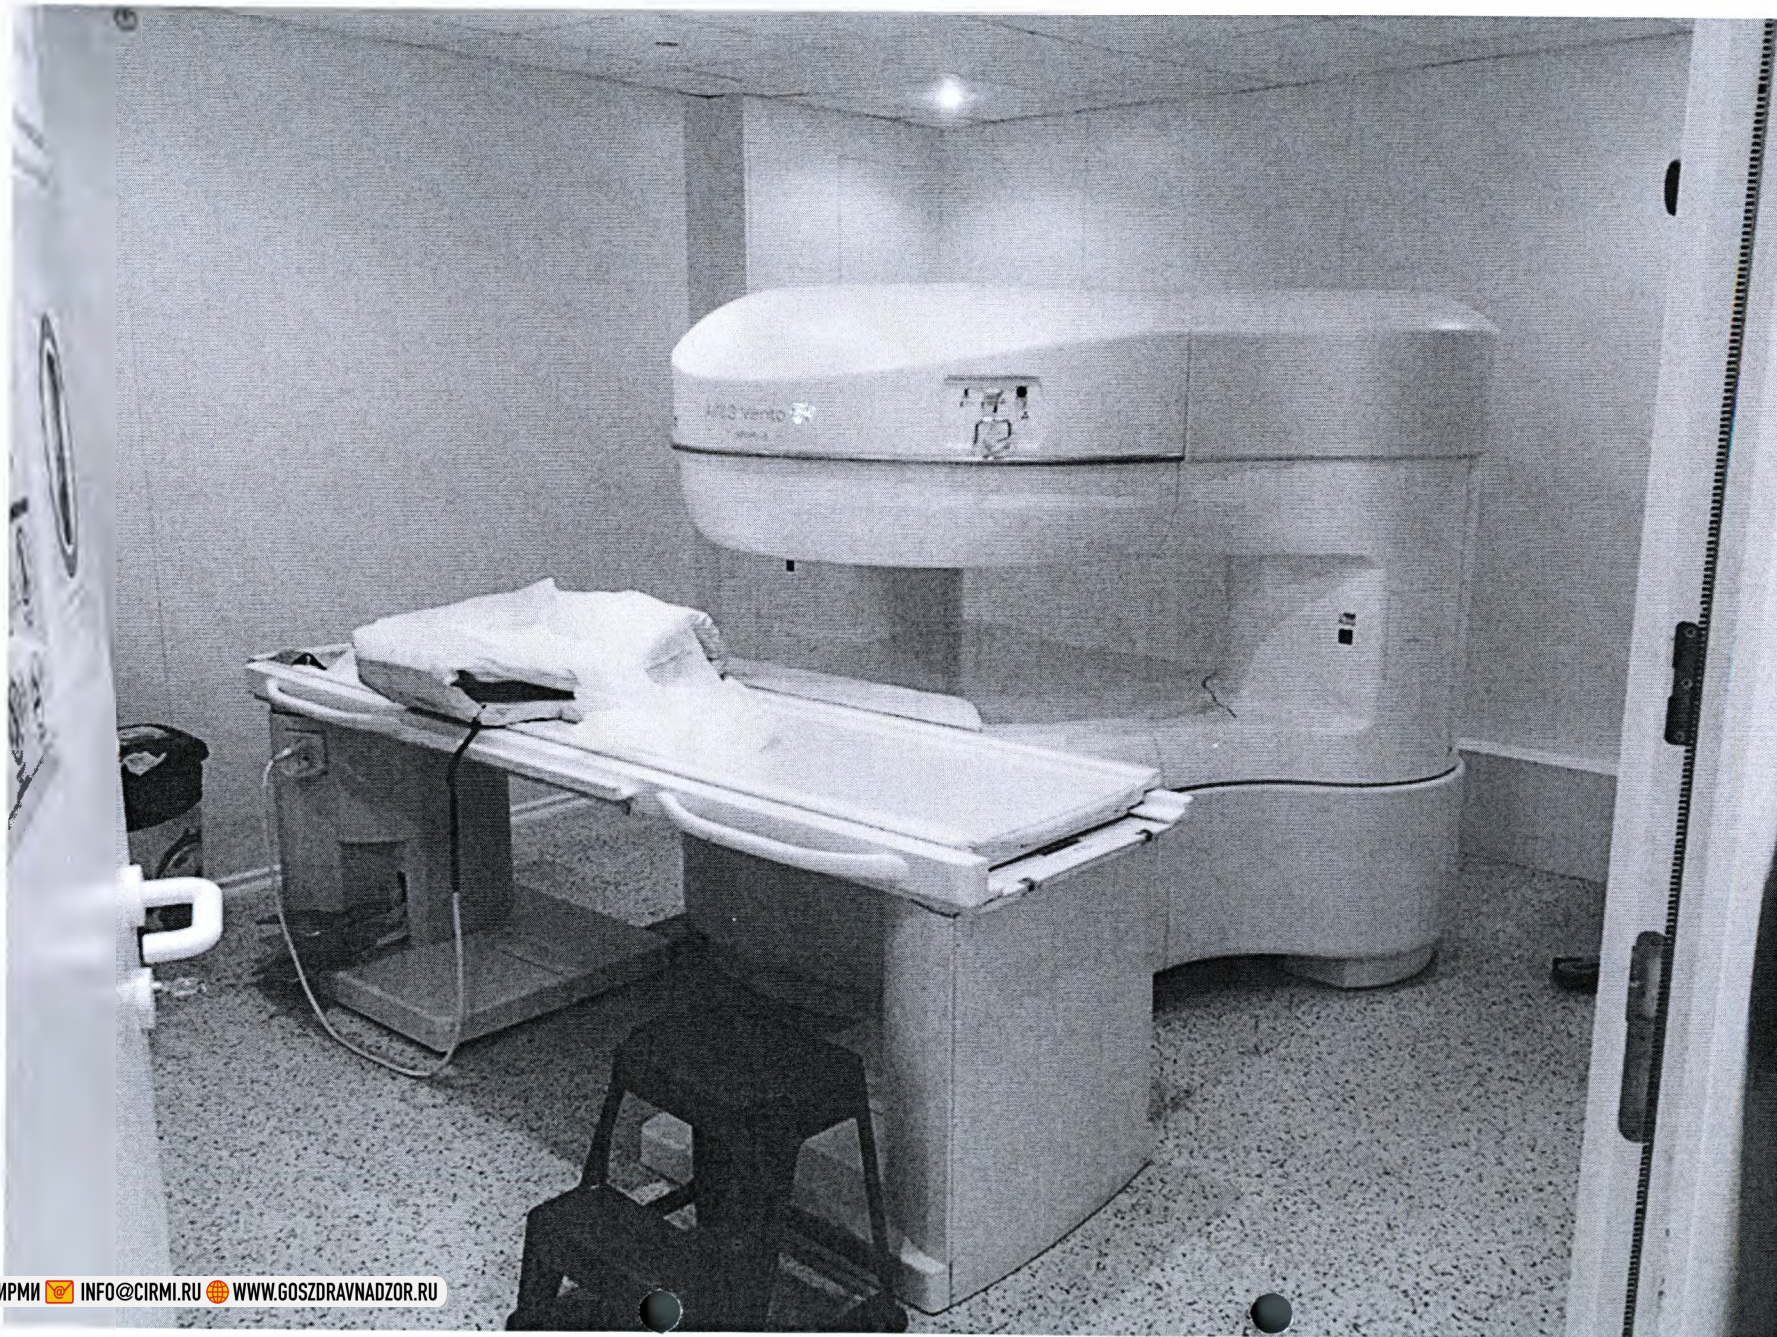








аппарат магнитно-резонансный Airis Vento

Постоянный
магнит 0,3Т
закрытый в
кожухе


Катушка тельная

Стол пациента

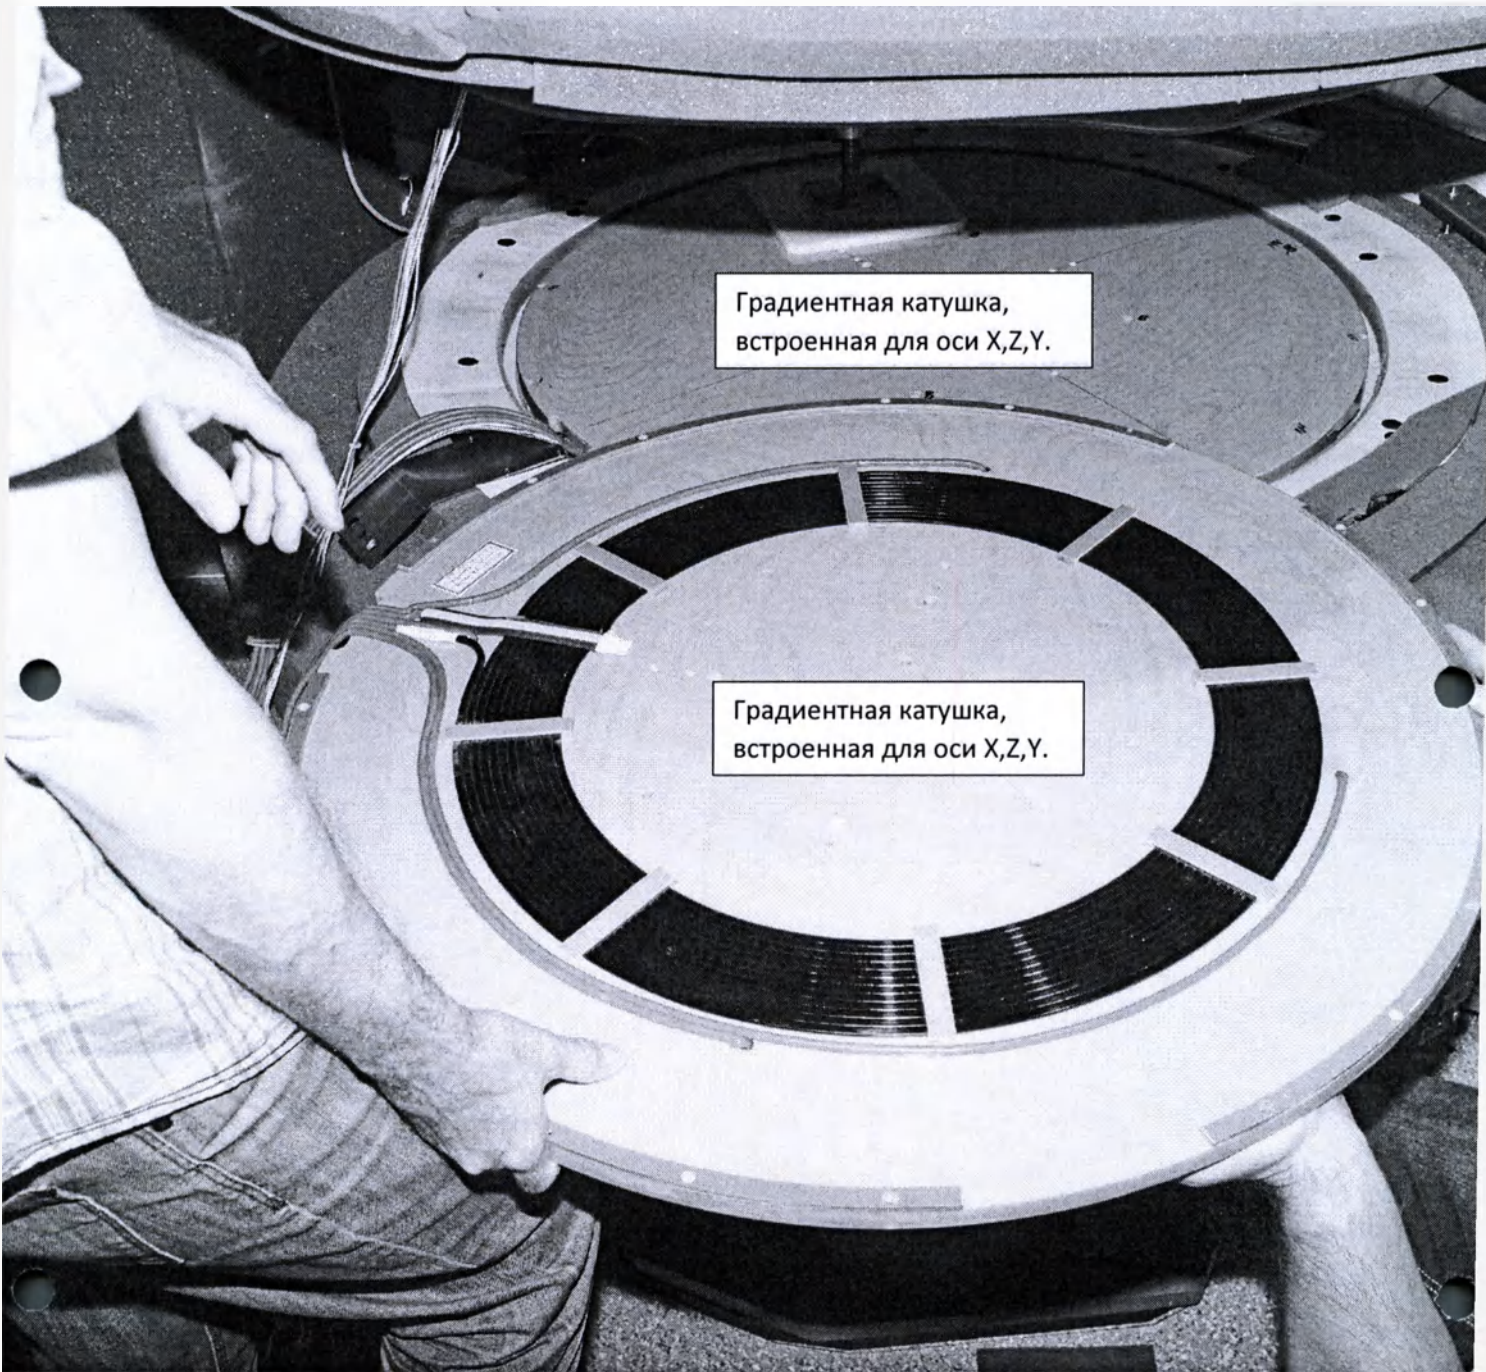


Градиентная катушка,
встроенная для оси X,Z,Y.


Градиентная катушка,
встроенная для оси X,Z,Y.

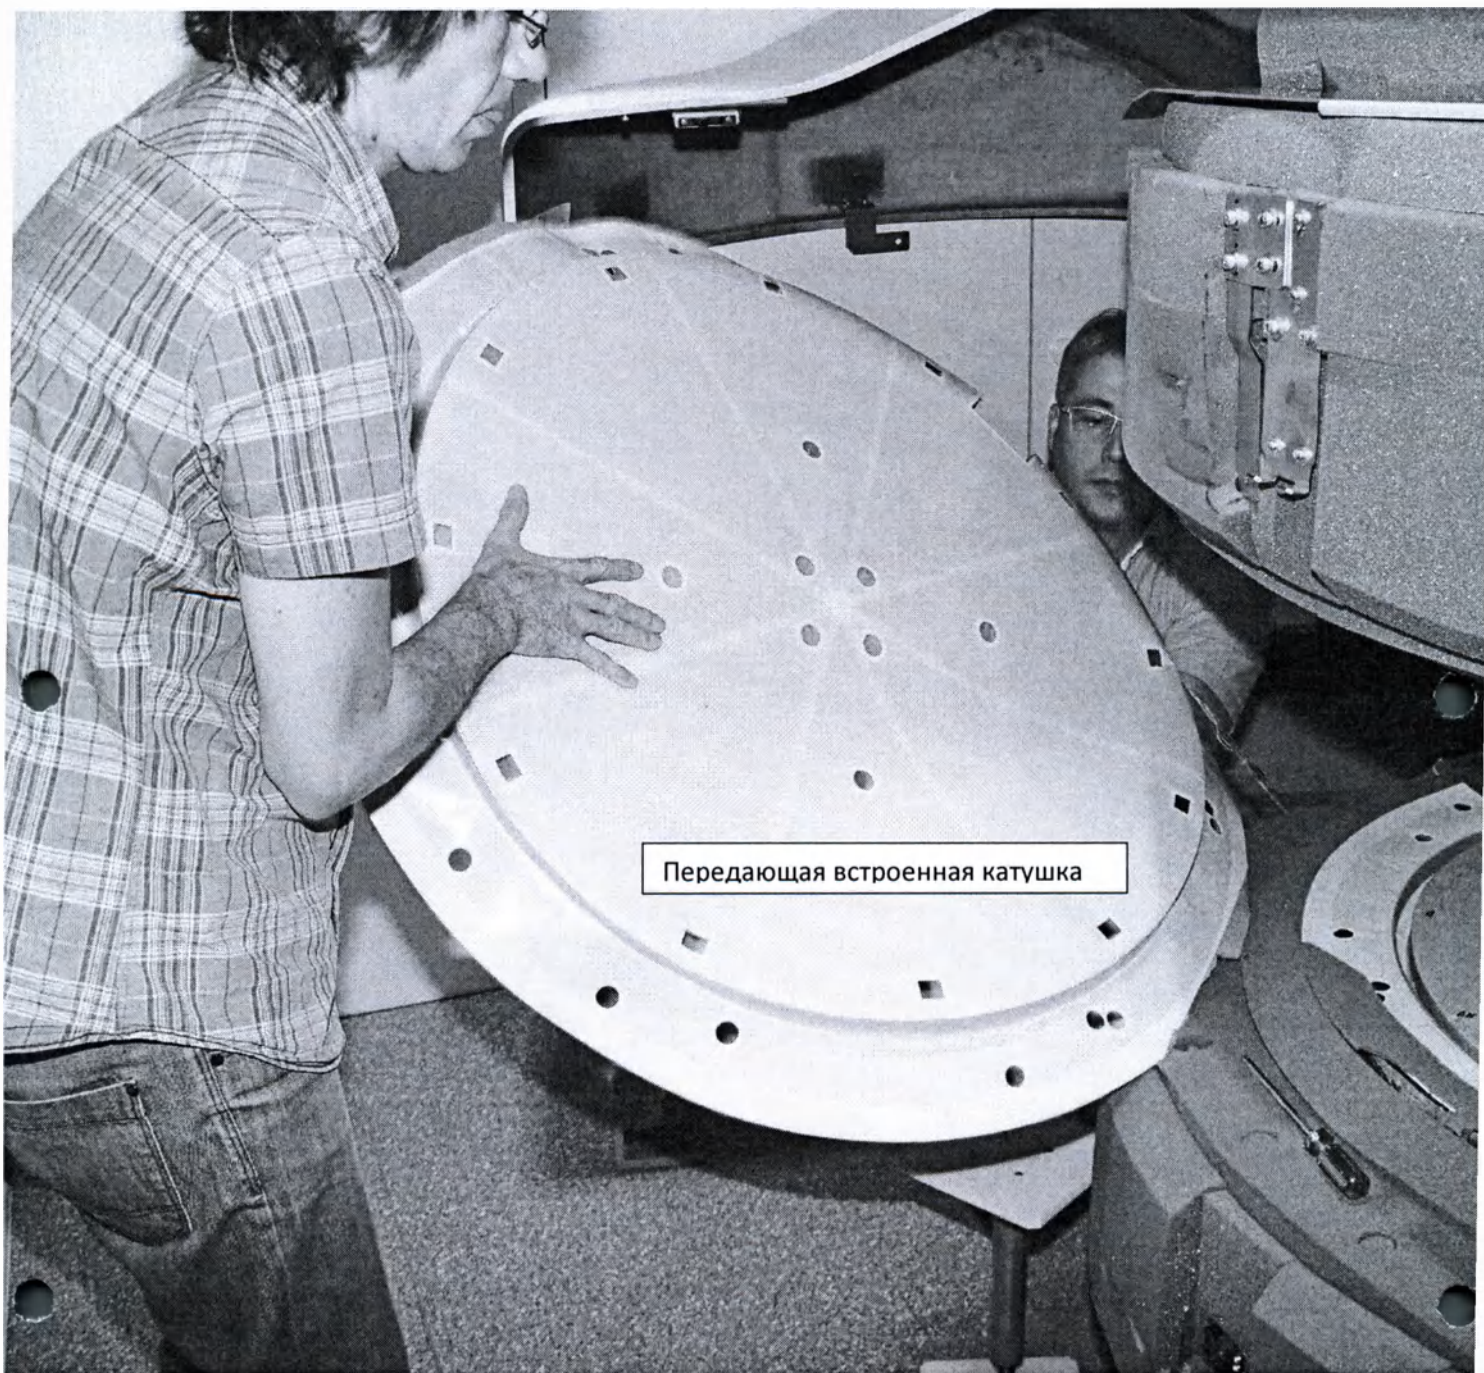

Передающая встроенная катушка

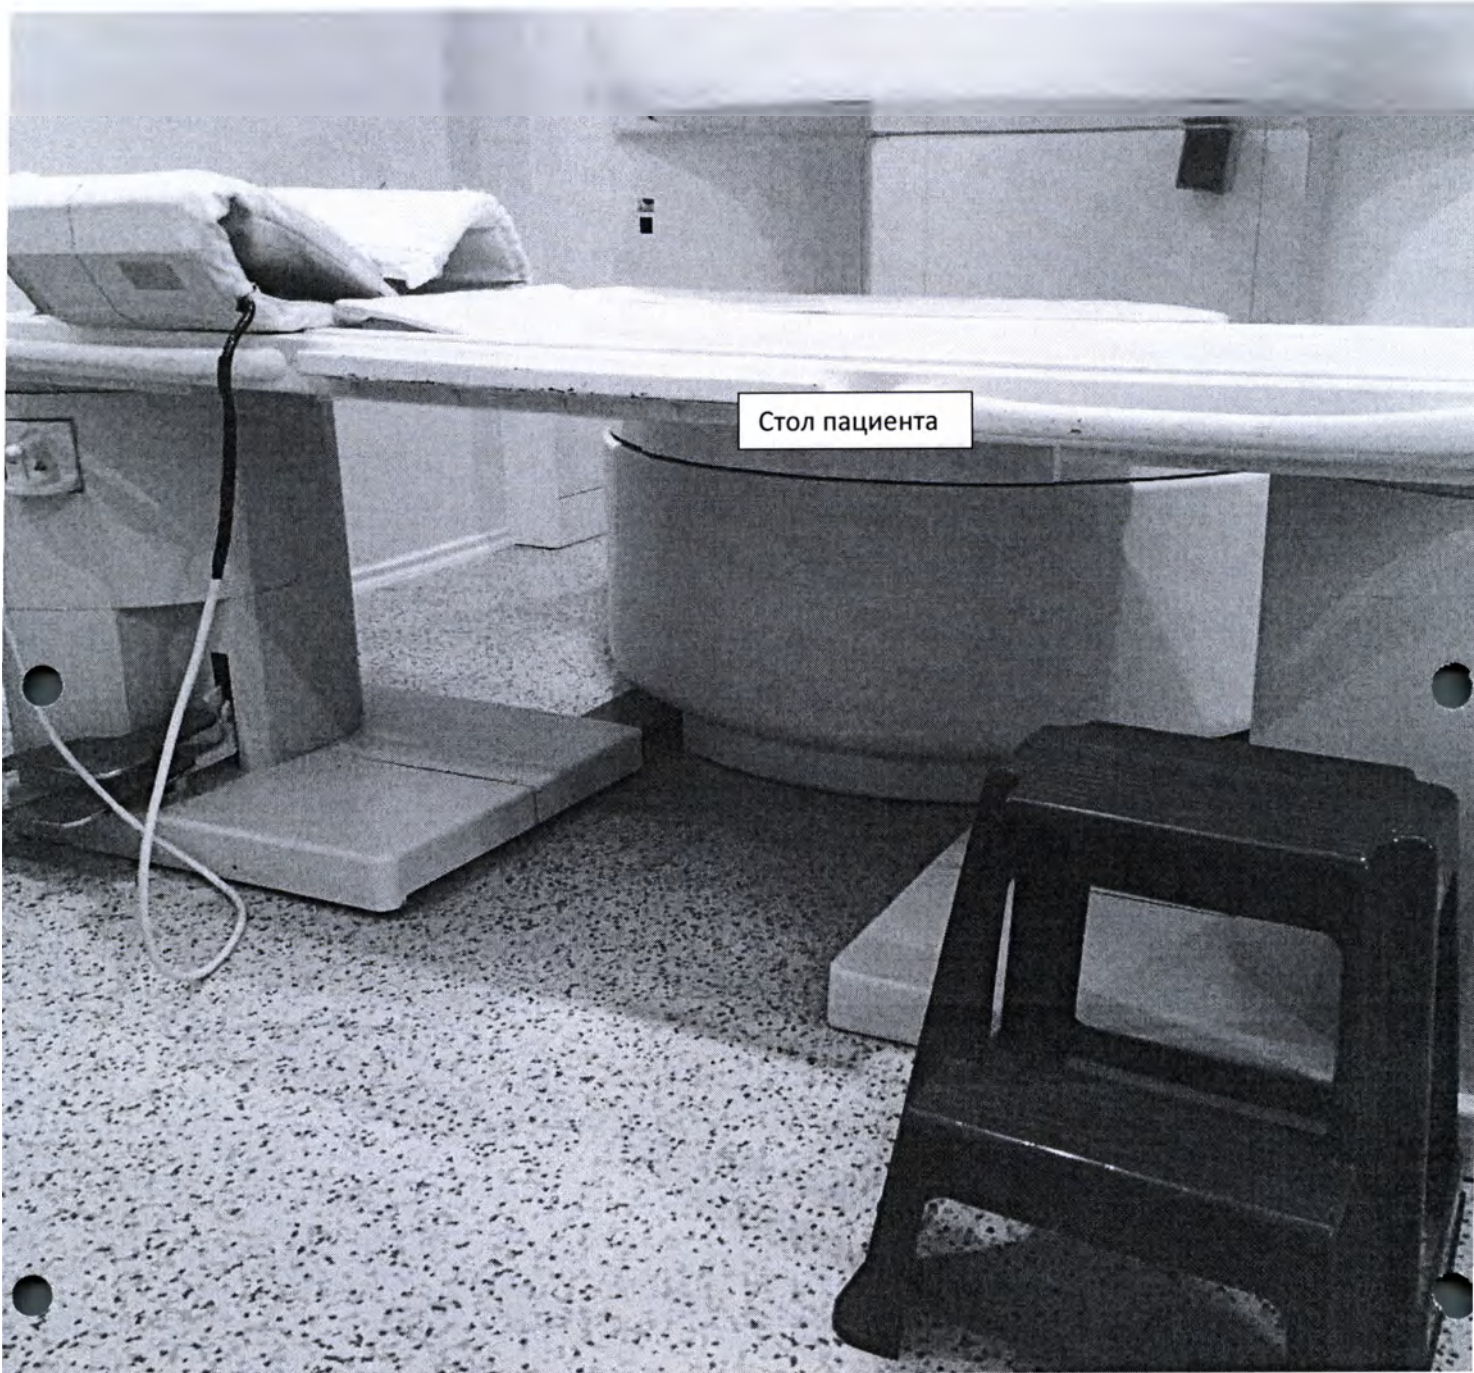


Стол пациента

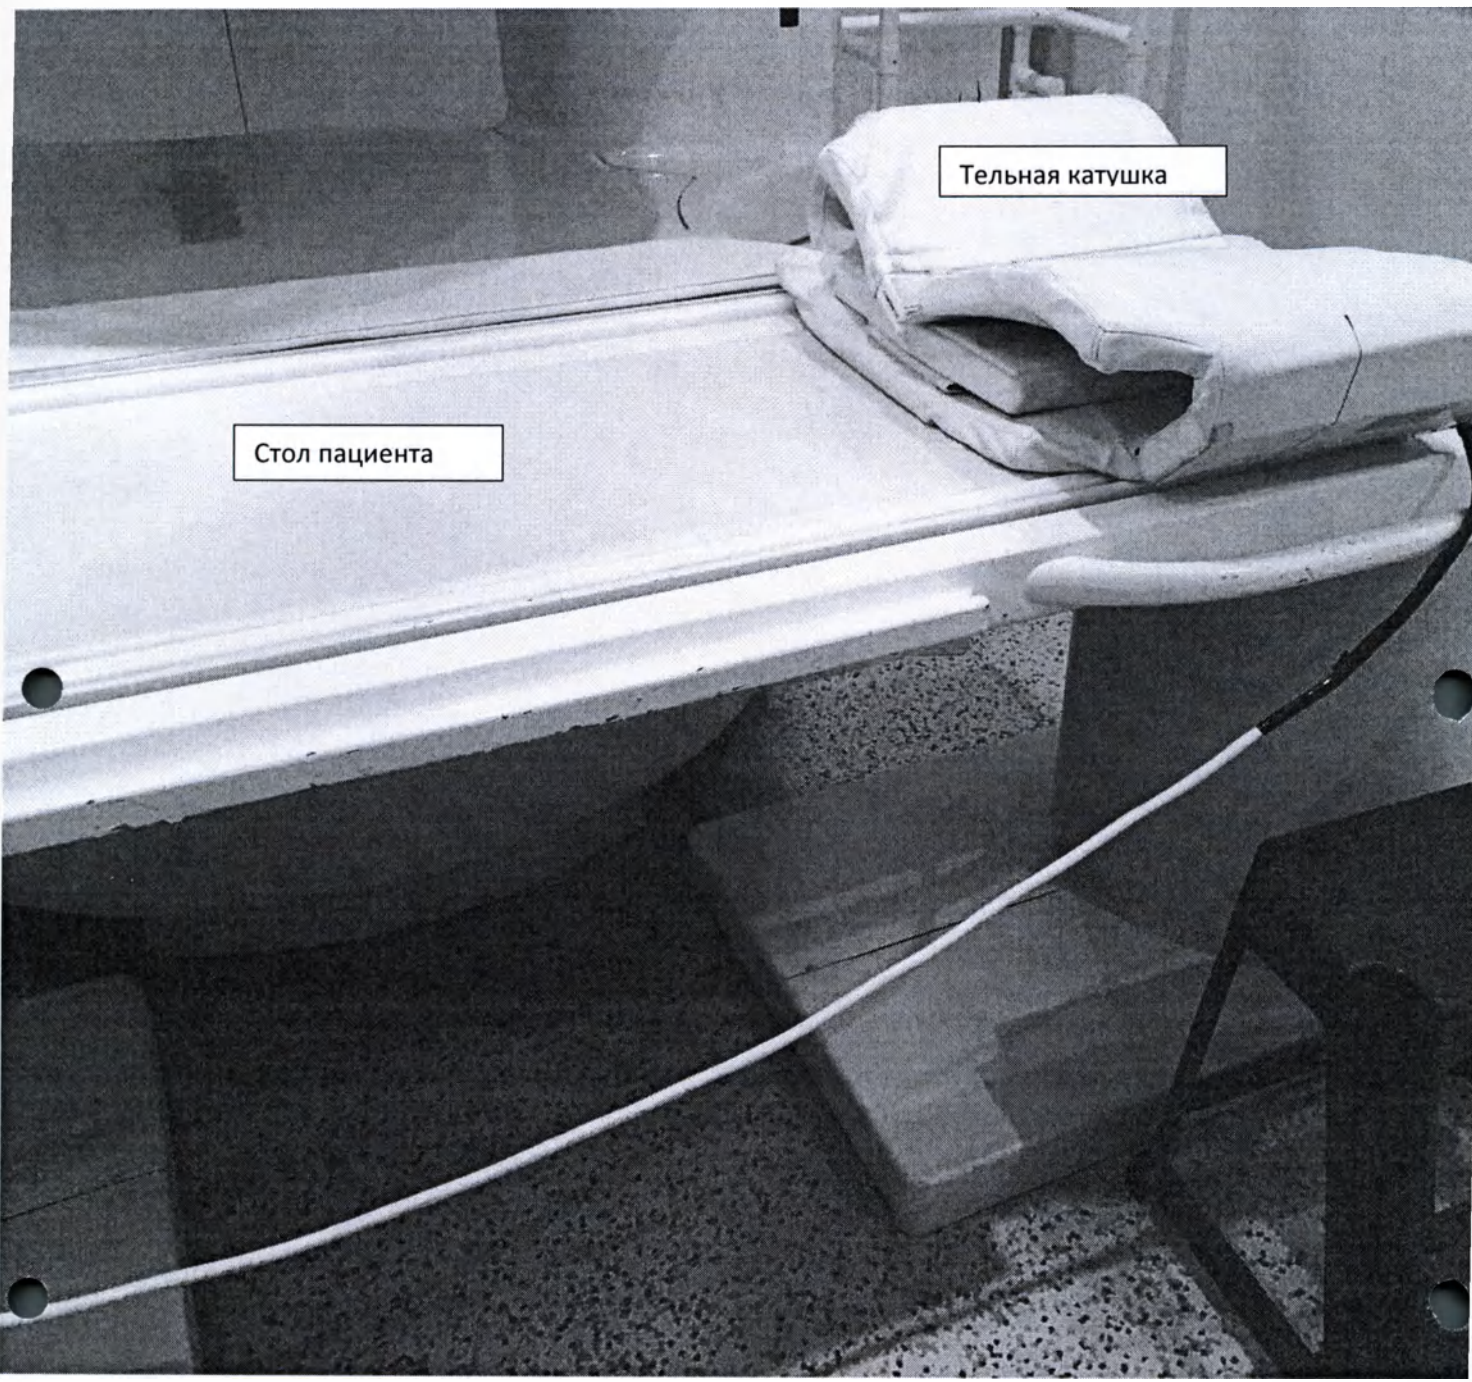
A black and white photograph of a medical patient table. The table is white and has a white cushion or pillow at the head end. A white cable runs along the side of the table. The background is dark and indistinct.

Стол пациента

Тельная катушка

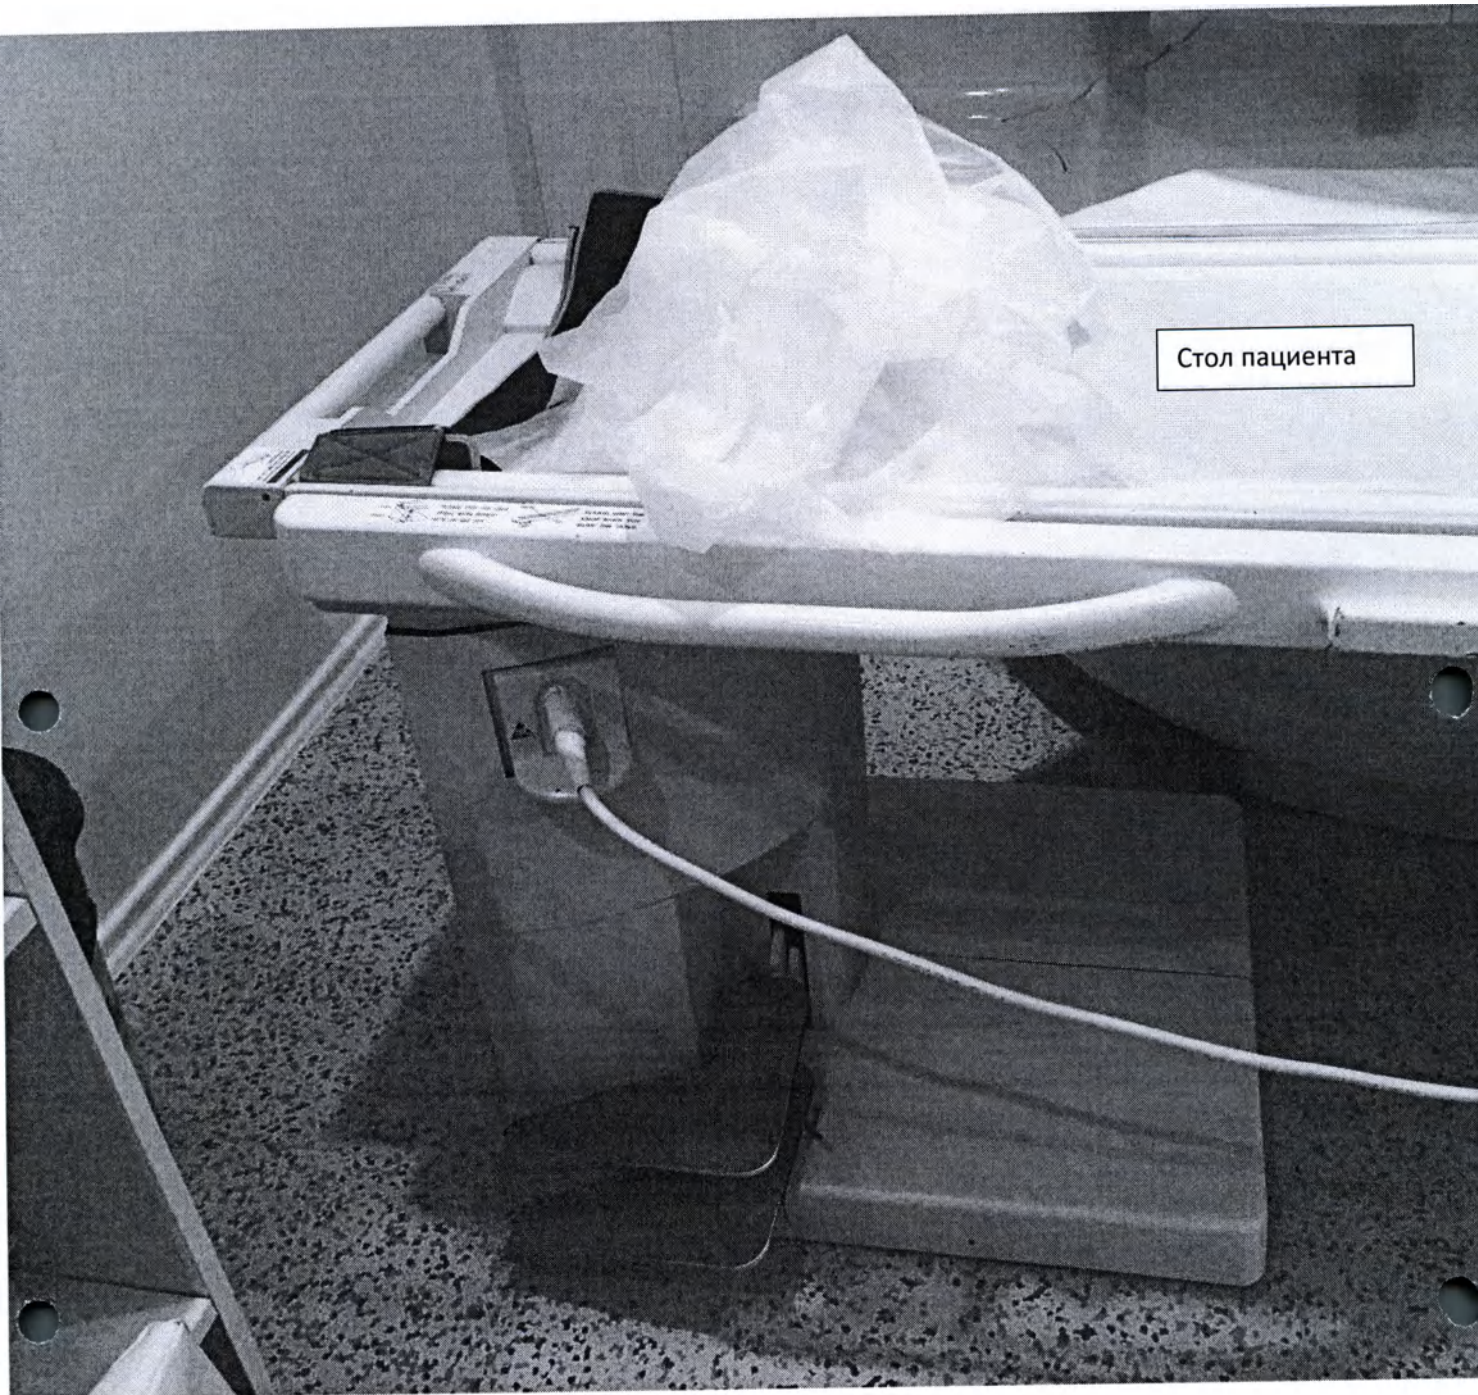

Стол пациента

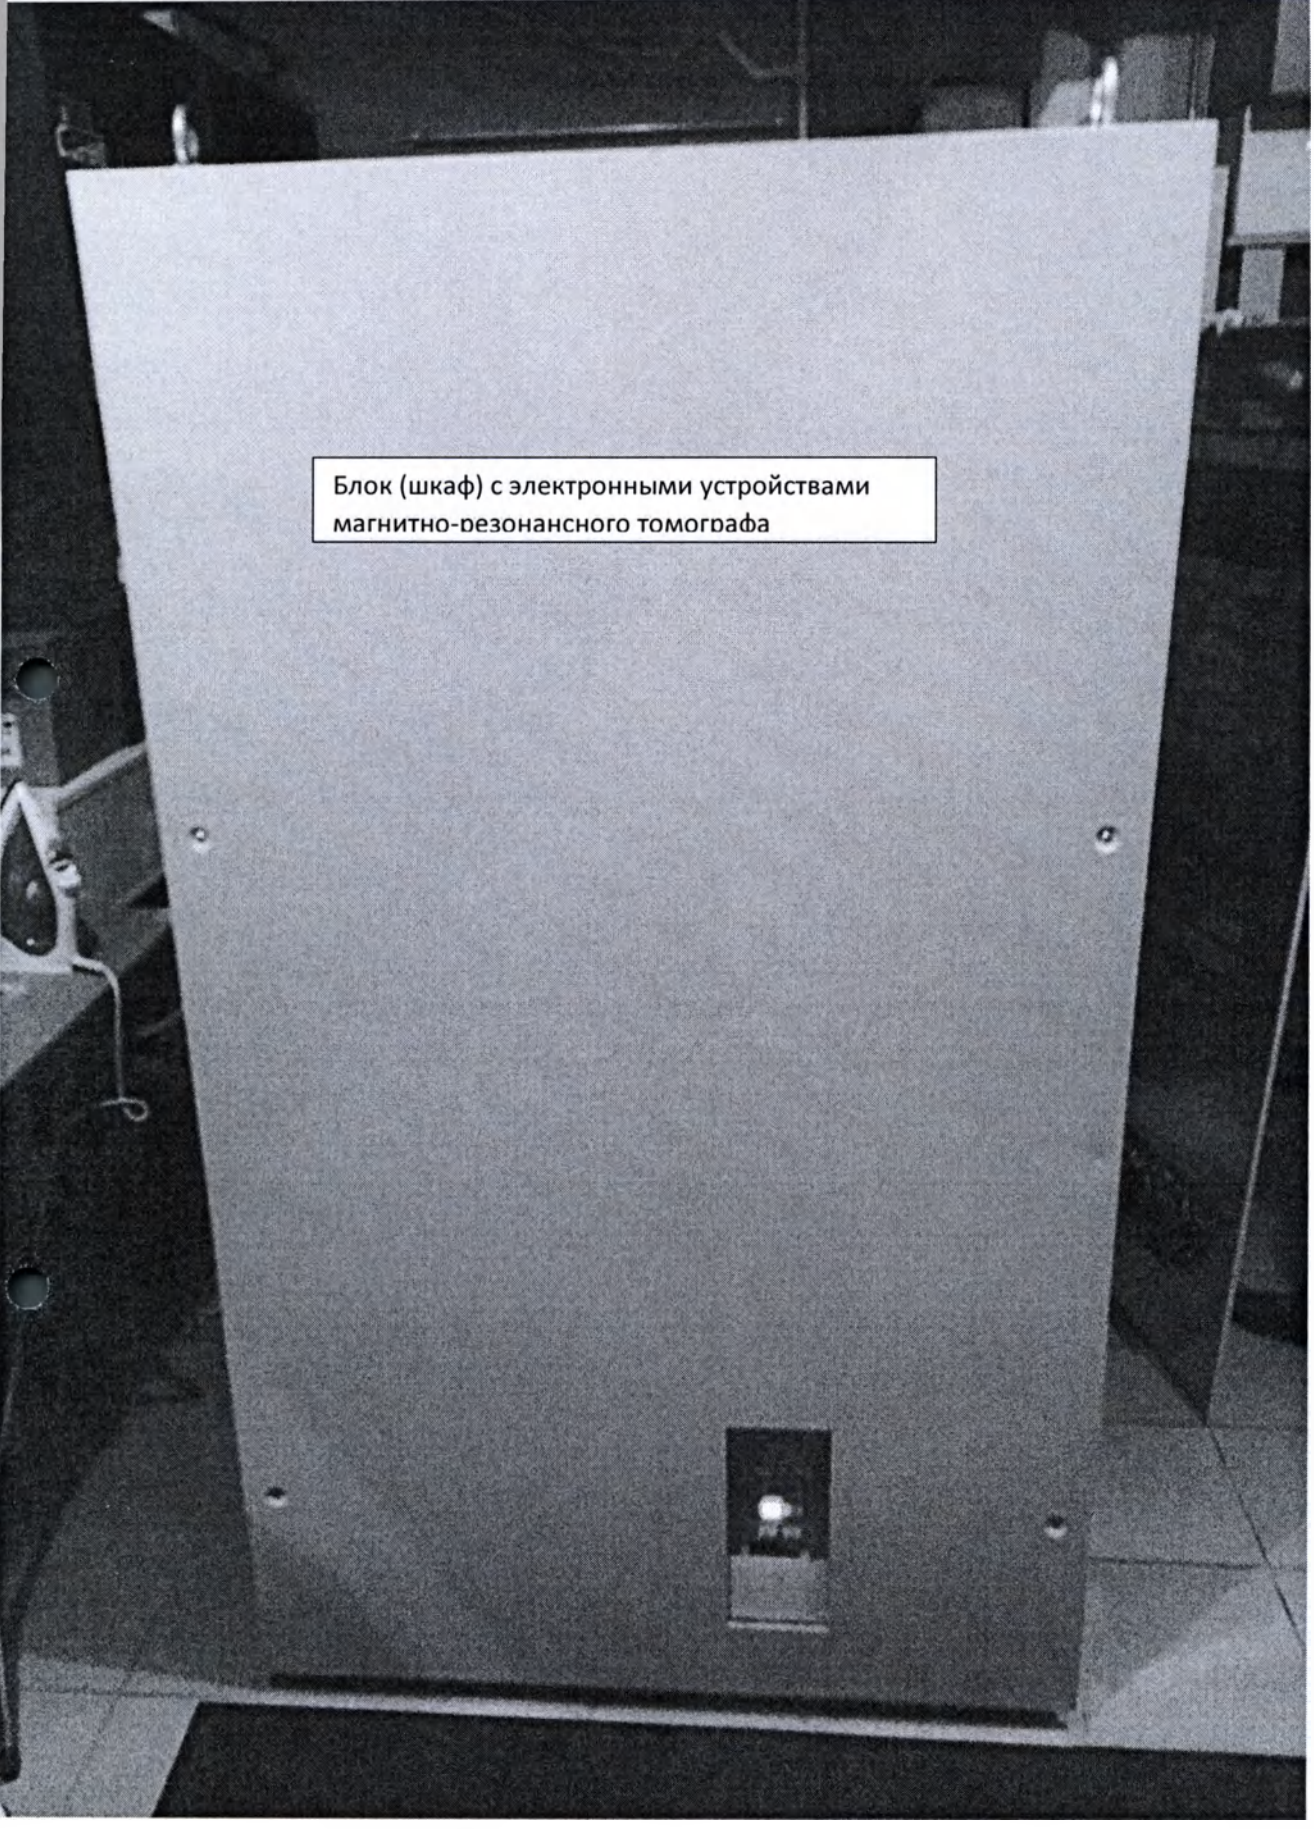


Блок (шкаф) с электронными устройствами
магнитно-резонансного томографа

Блок электроники радиочастотного усилителя

Блок электроники распределения питания


Блок электроники градиентного усилителя

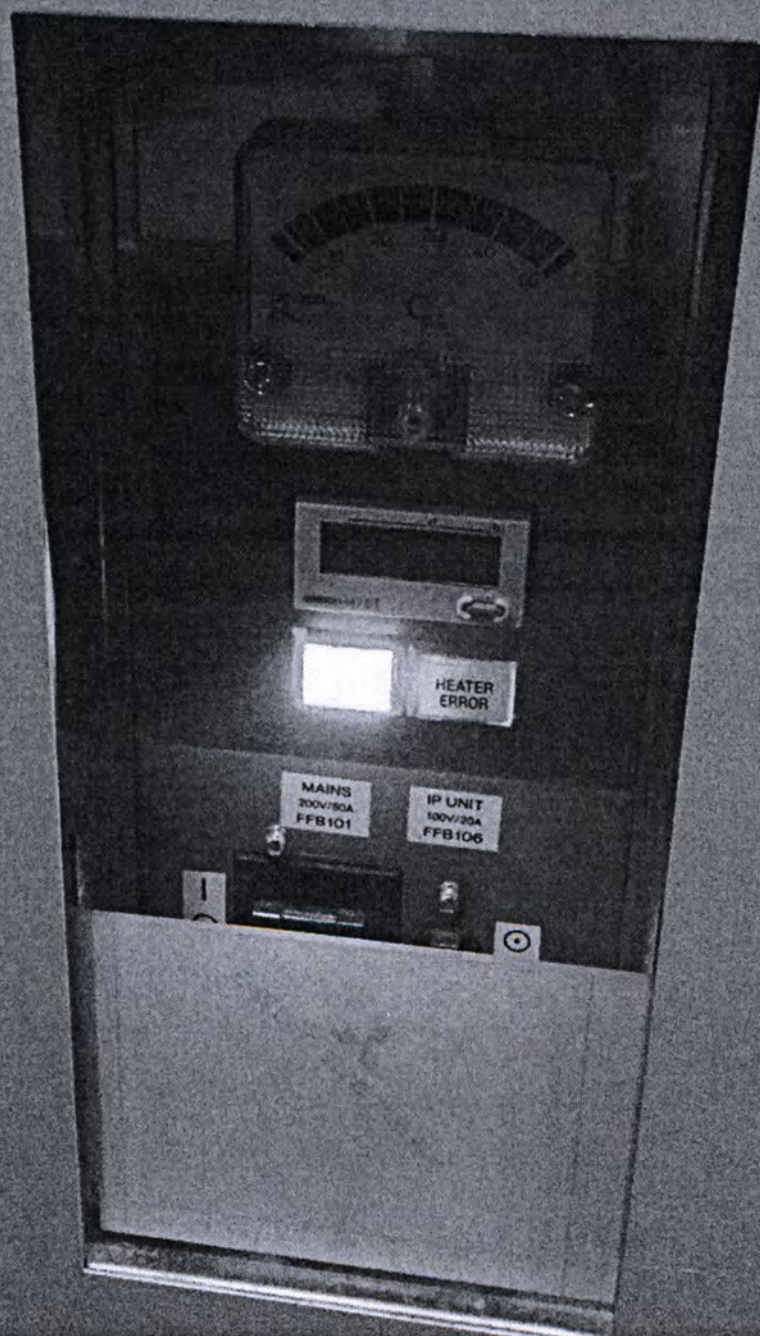



Блок электроники градиентного усилителя

Блок электроники радиочастотного усилителя

Блок электроники распределения питания

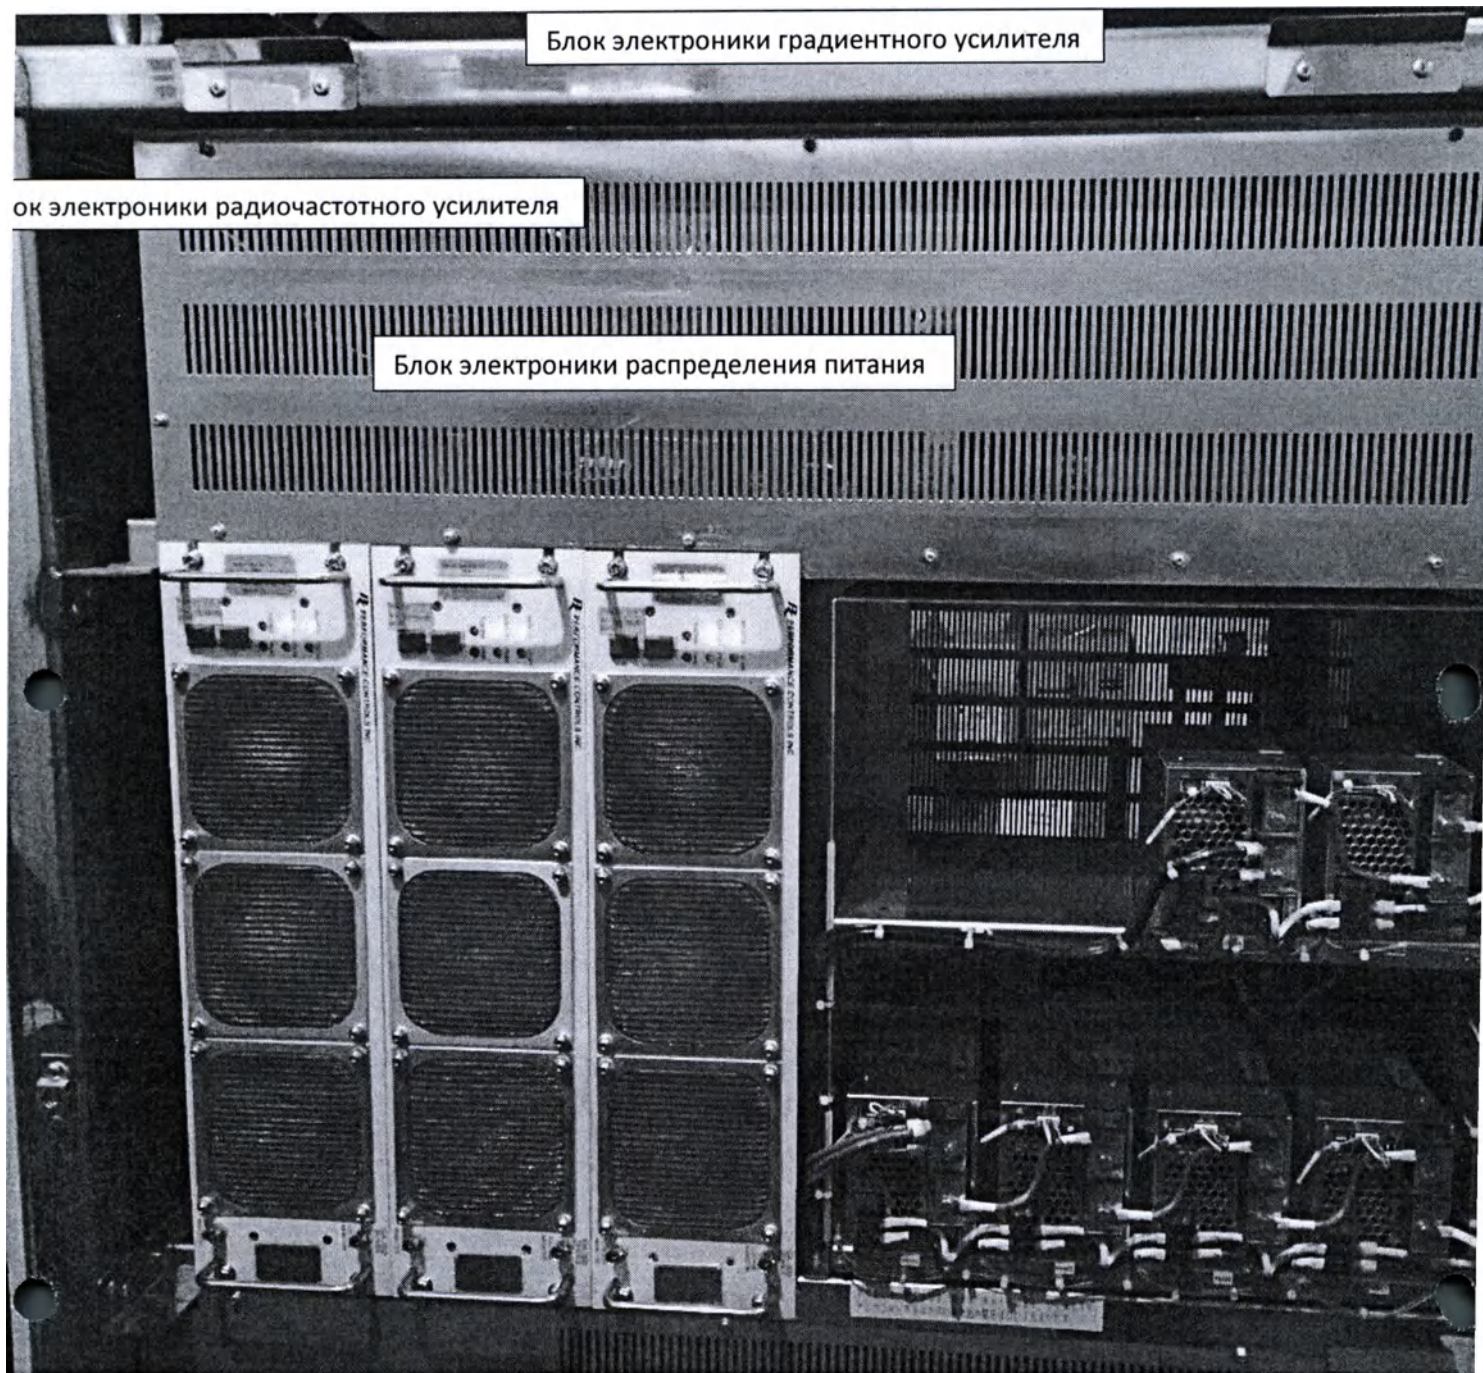

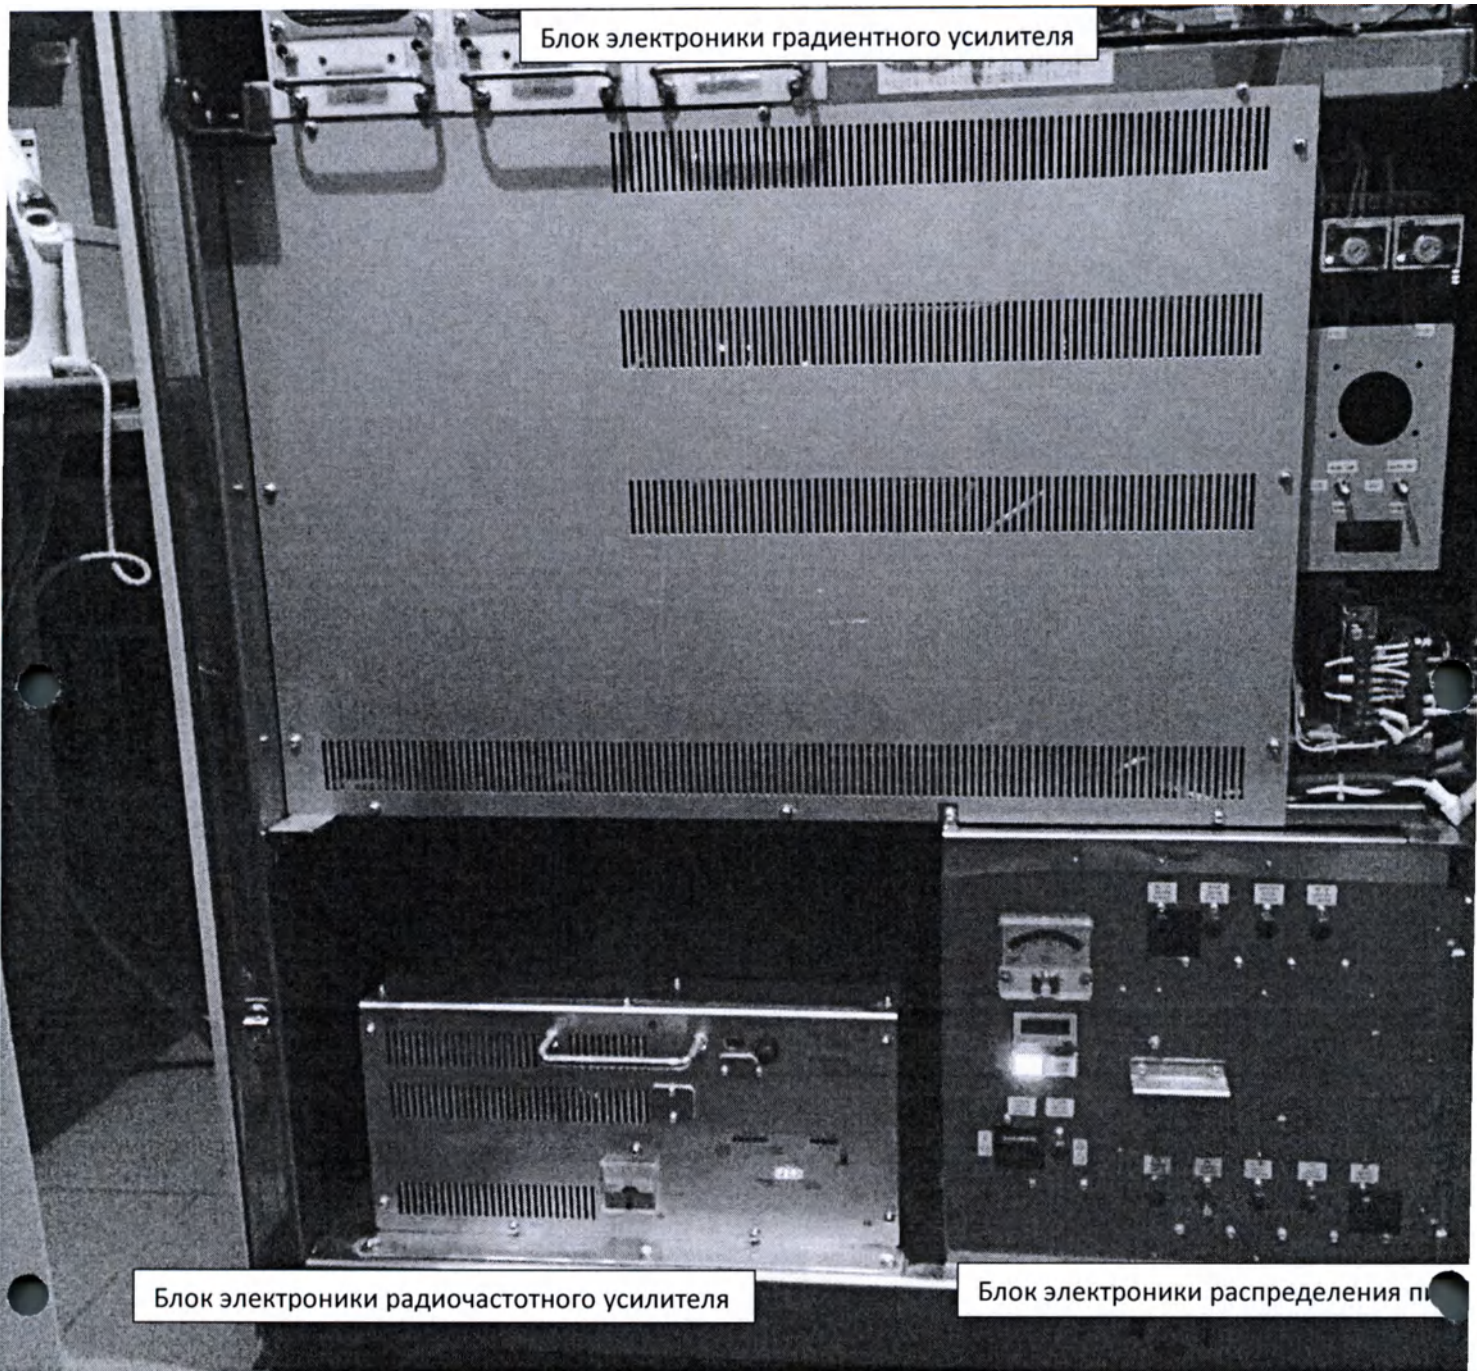

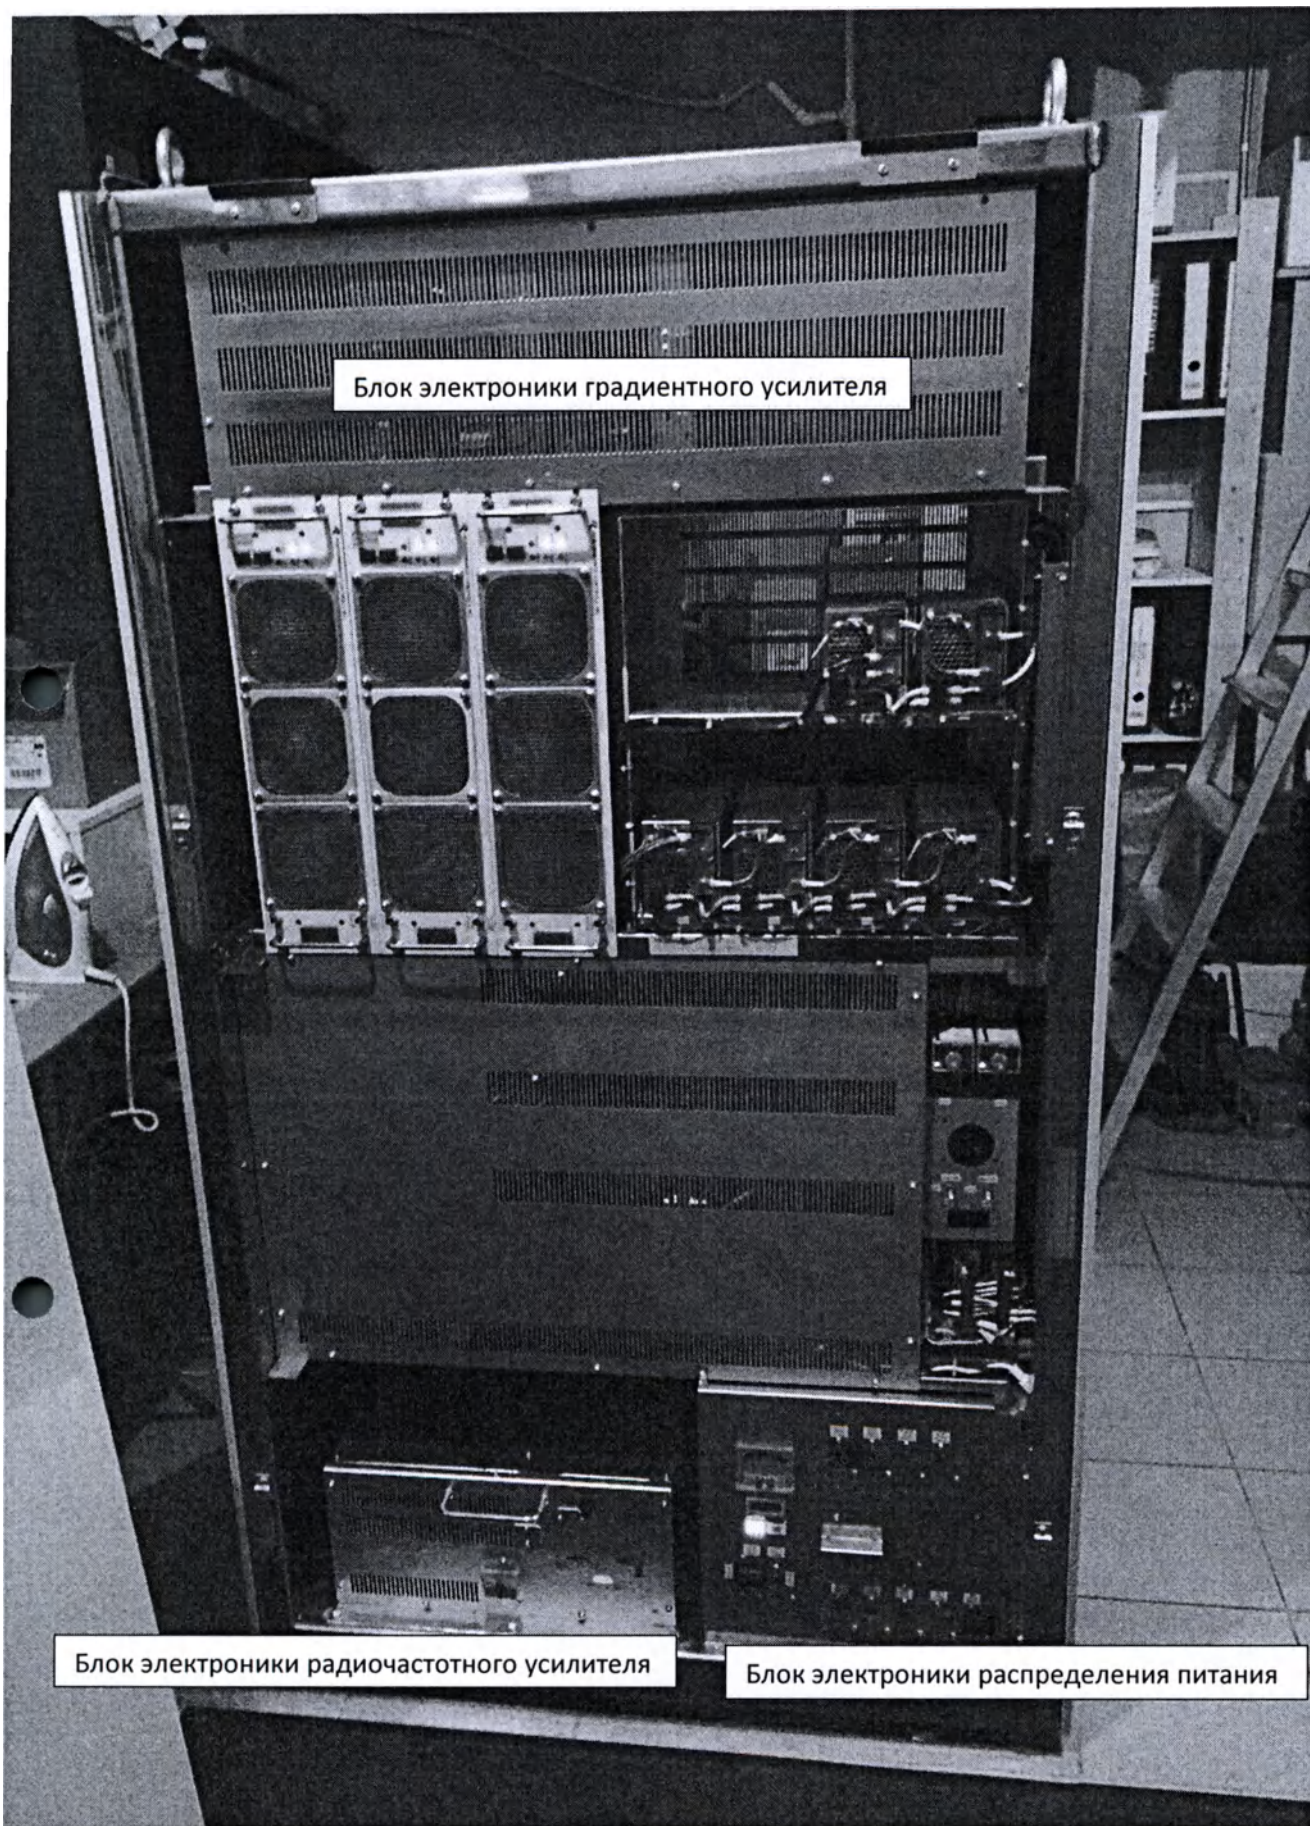

Блок электроники градиентного усилителя


Блок электроники радиочастотного усилителя


Блок электроники распределения питания

Блок электроники радиочастотного усилителя

Блок электроники распределения питания

Блок электроники градиентного усилителя

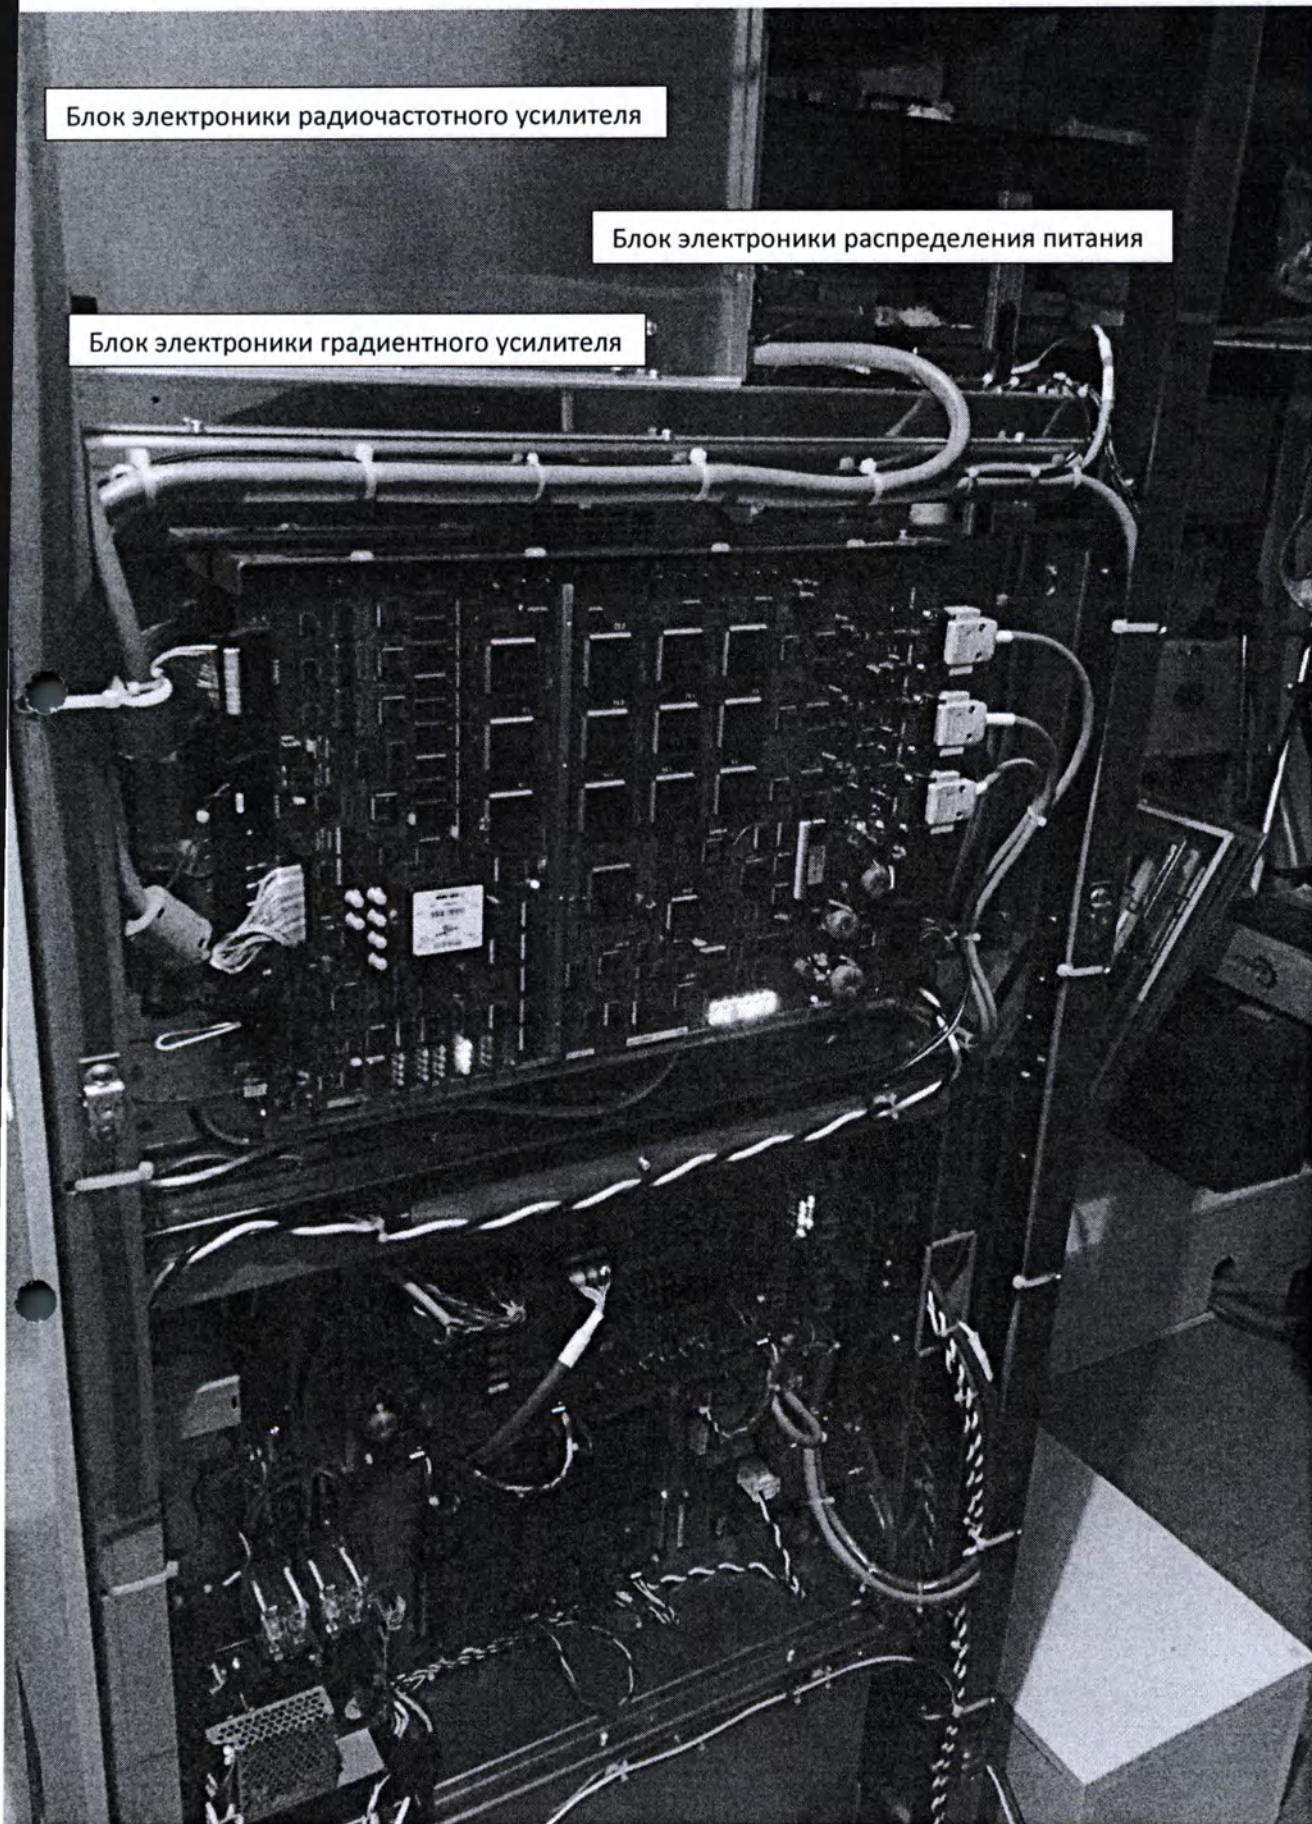


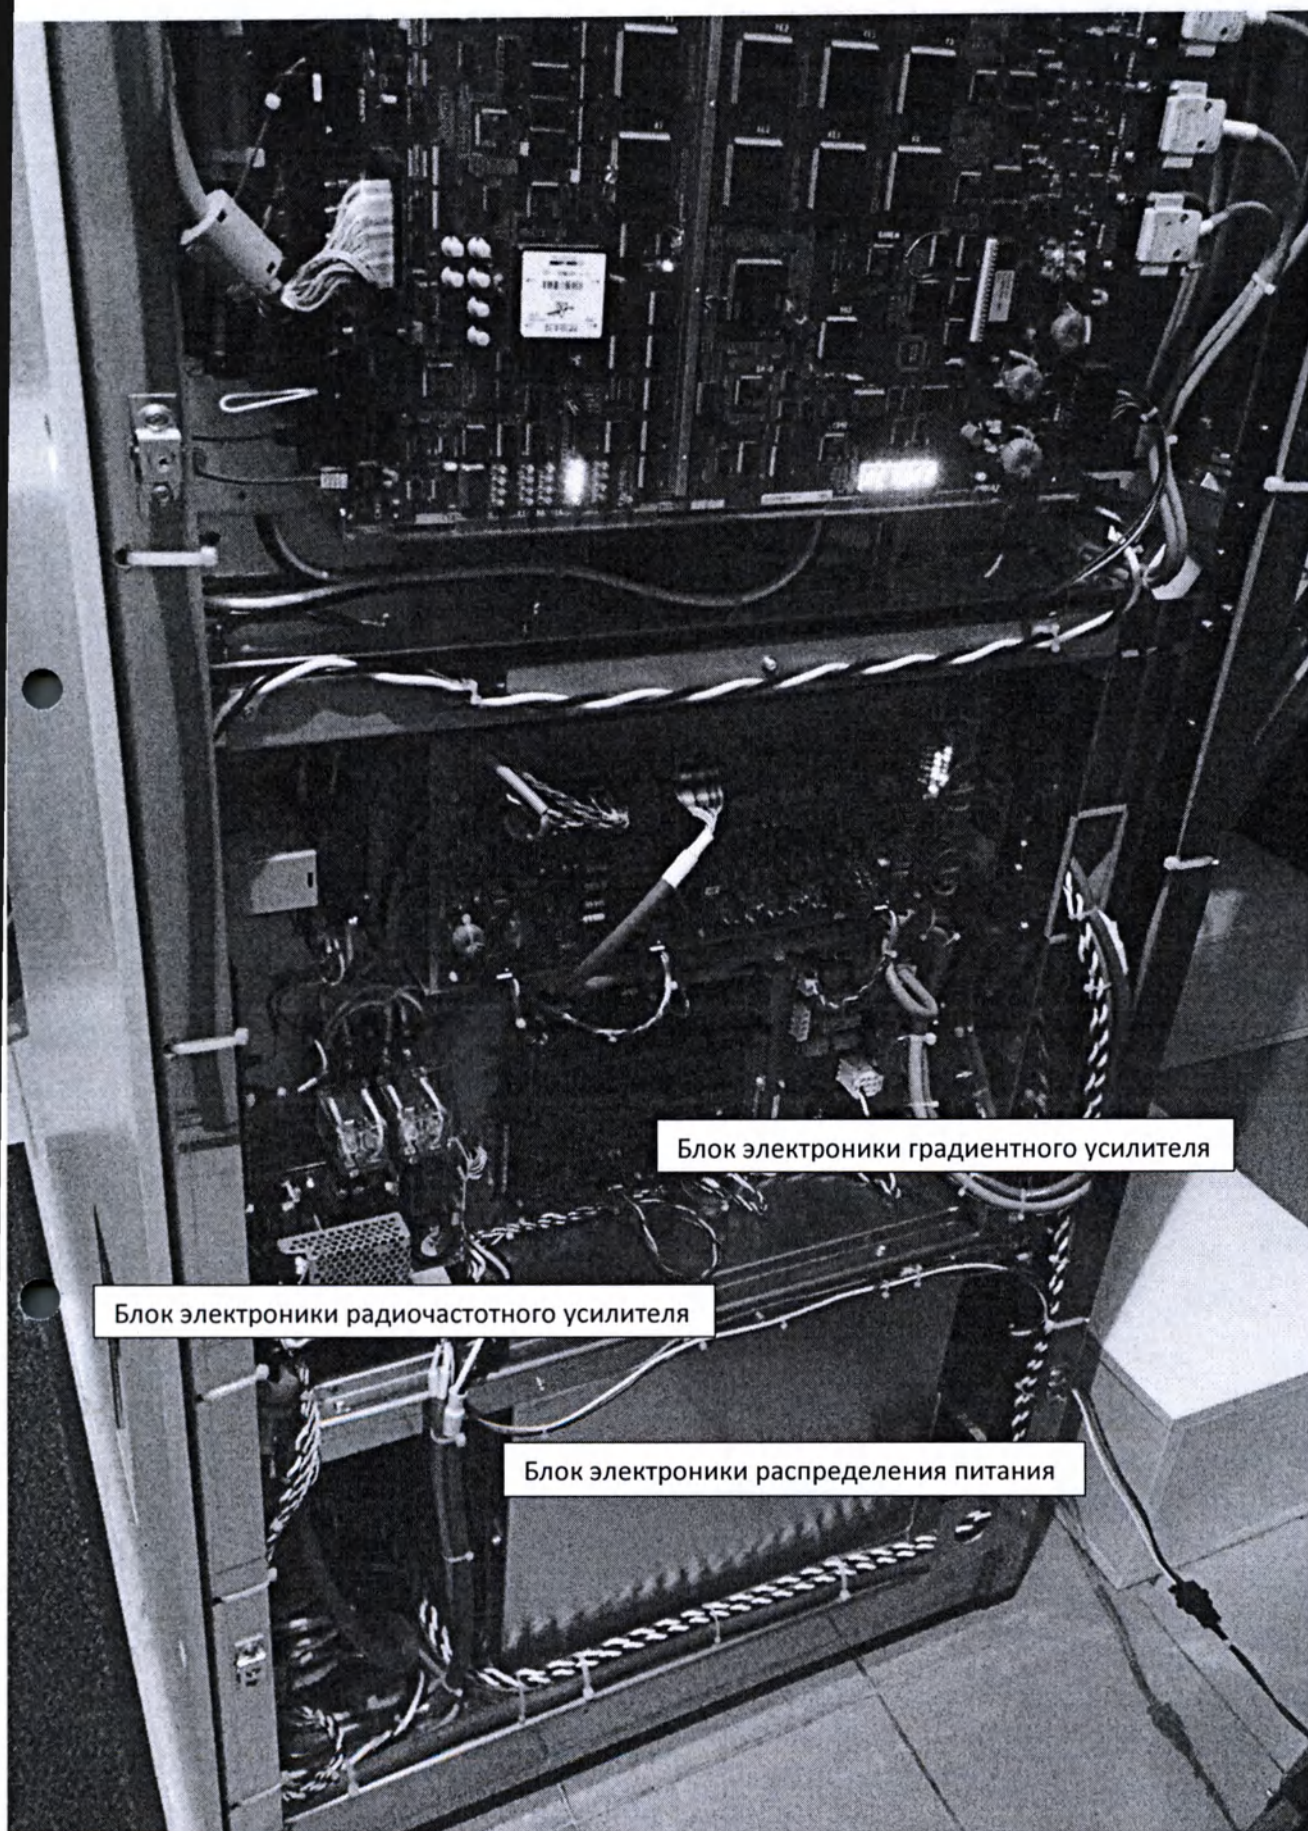

Блок электроники градиентного усилителя

Блок электроники радиочастотного усилителя


Блок электроники распределения питания

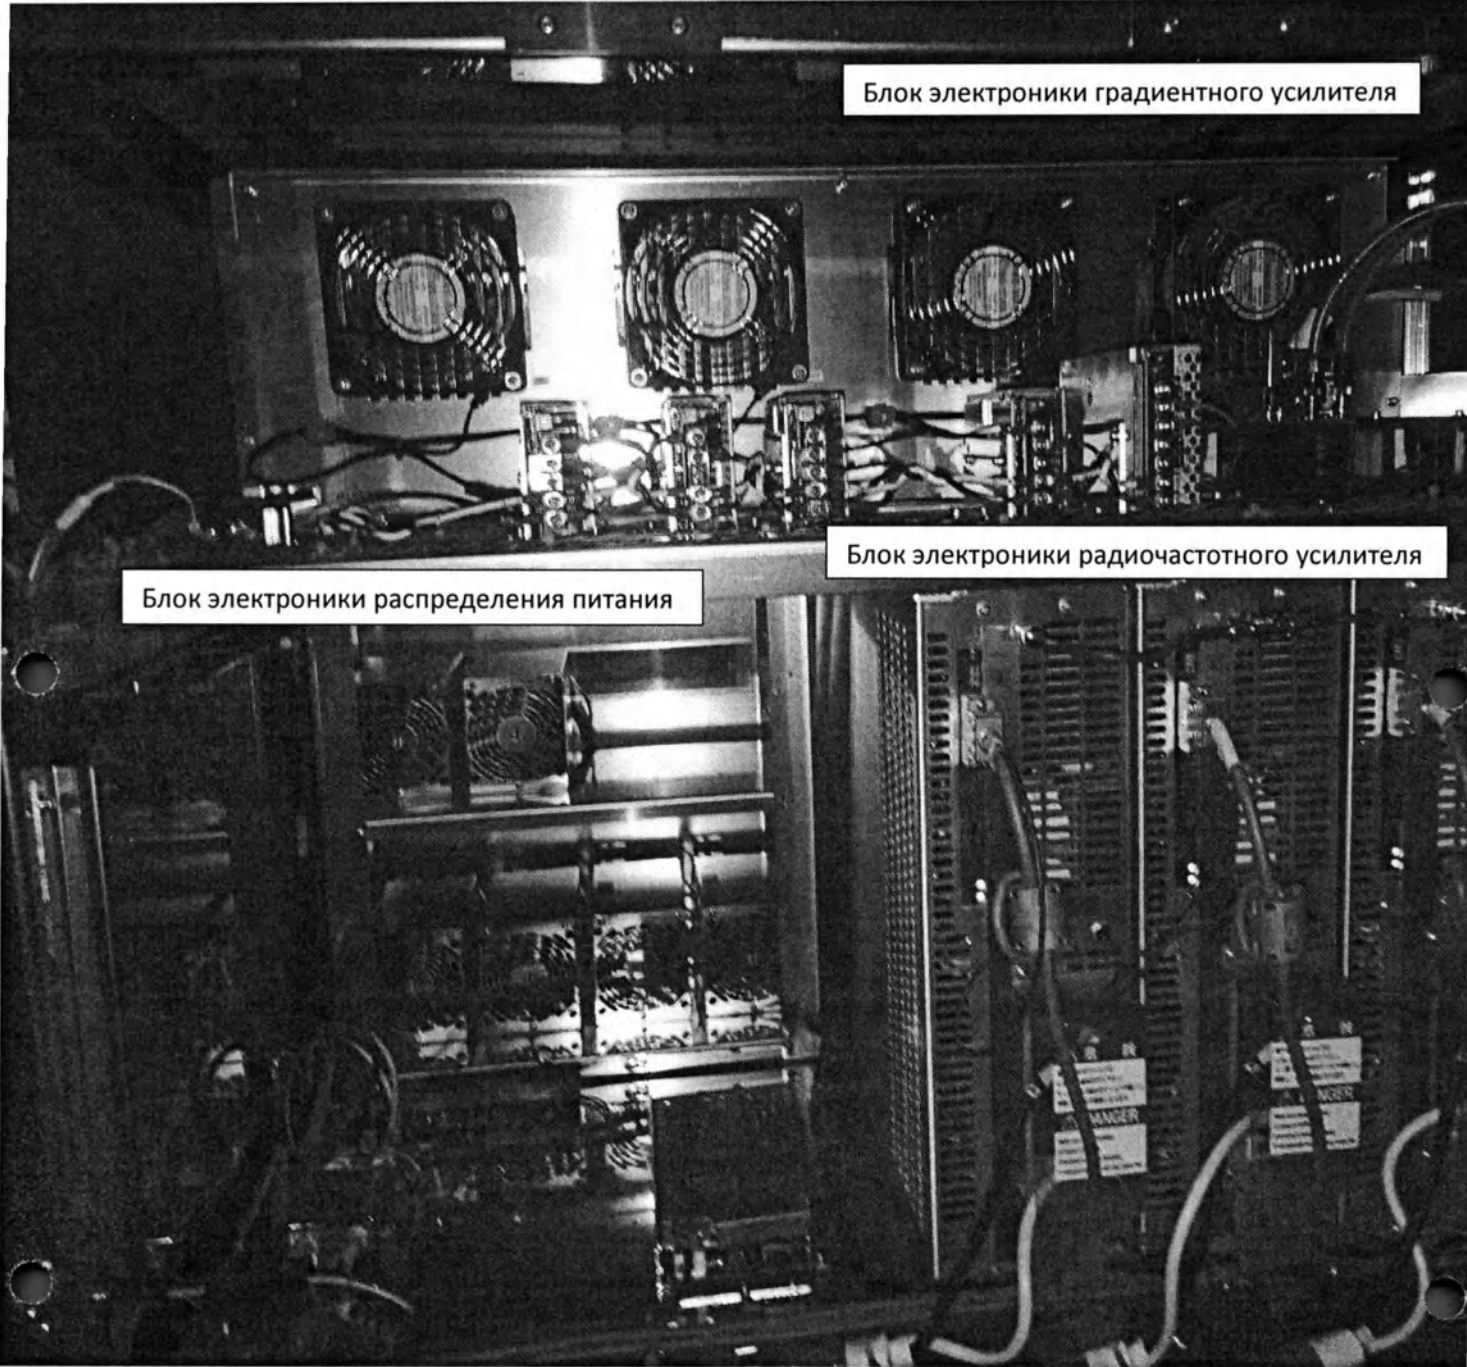

Блок электроники градиентного усилителя

Блок электроники распределения питания

Блок электроники радиочастотного усилителя

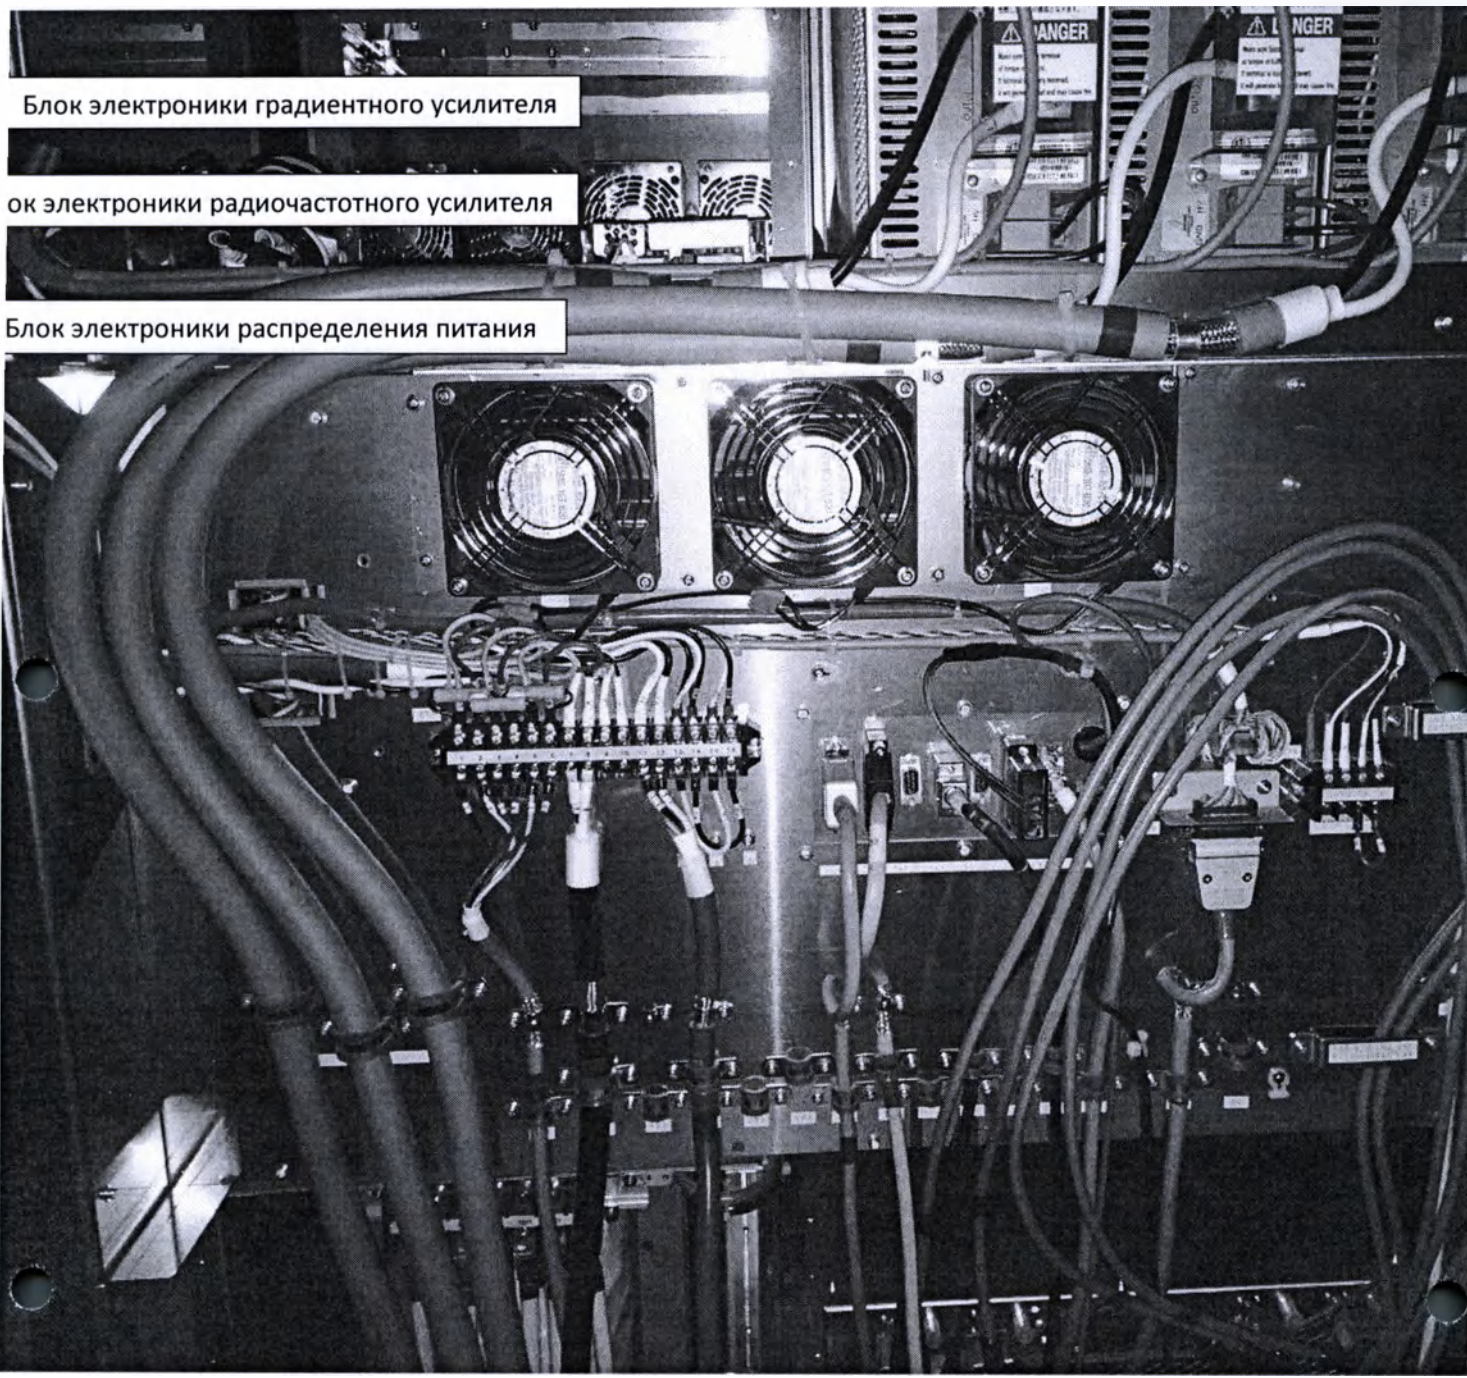

Блок электроники градиентного усилителя


Блок электроники радиочастотного усилителя


Блок электроники распределения питания

Блок электроники градиентного усилителя

Блок электроники радиочастотного усилителя

Блок электроники распределения питания

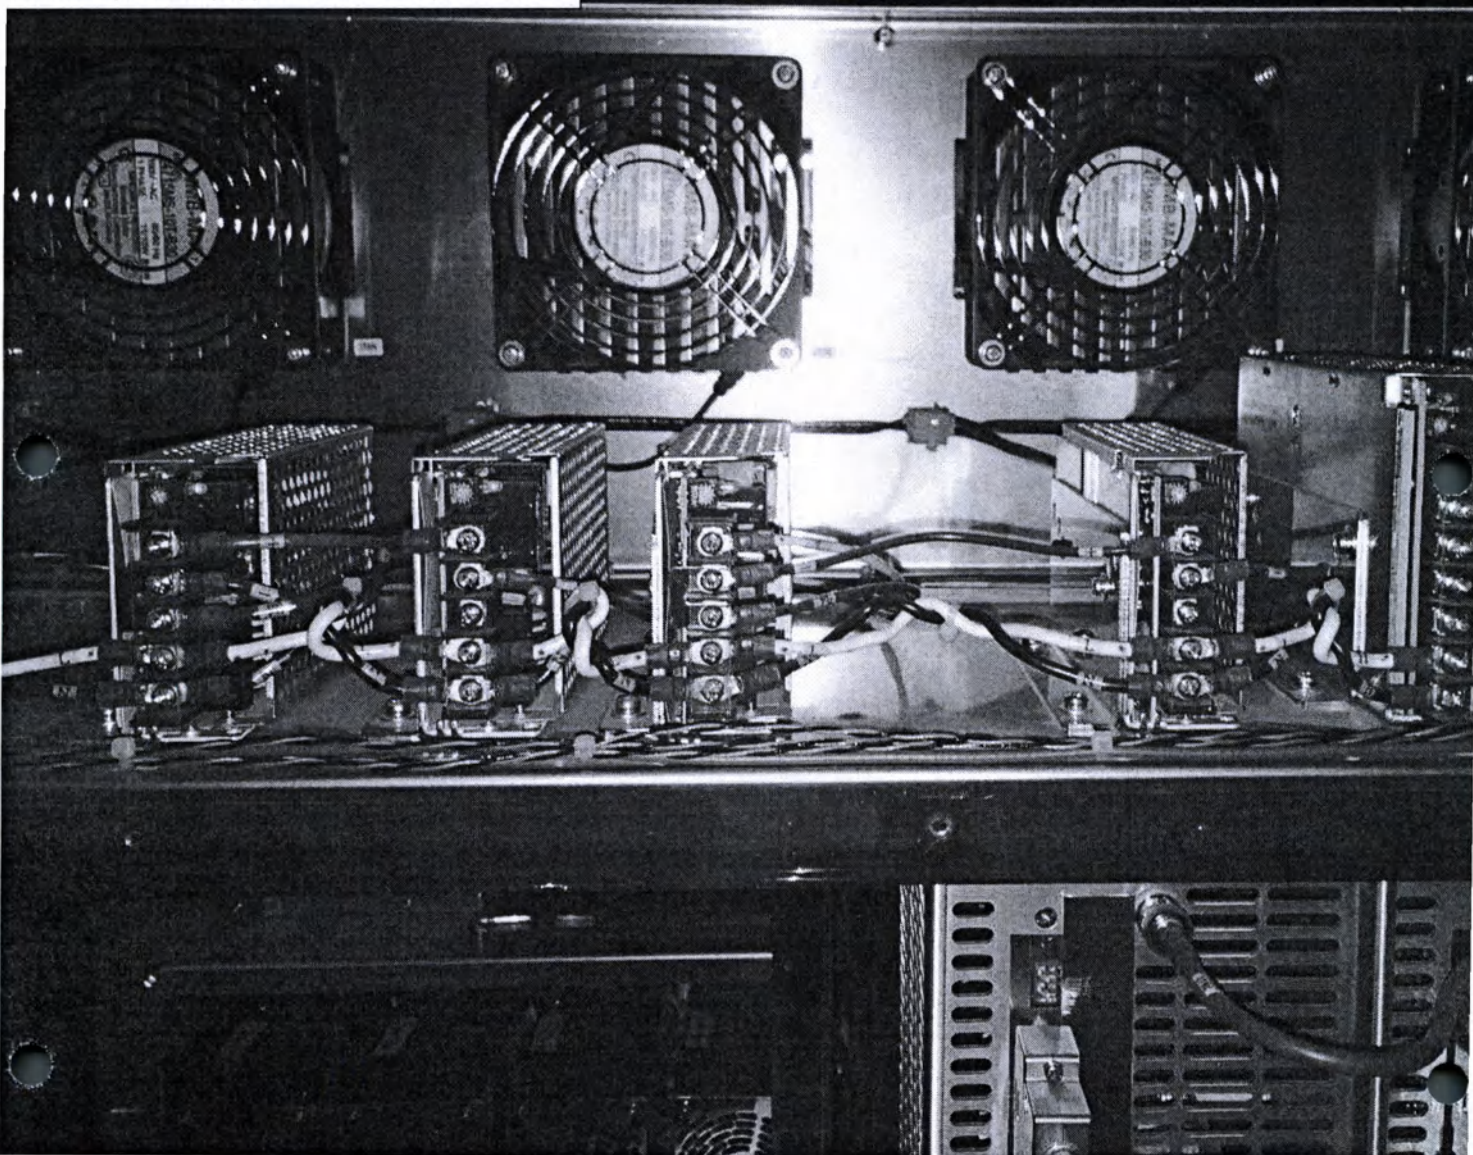

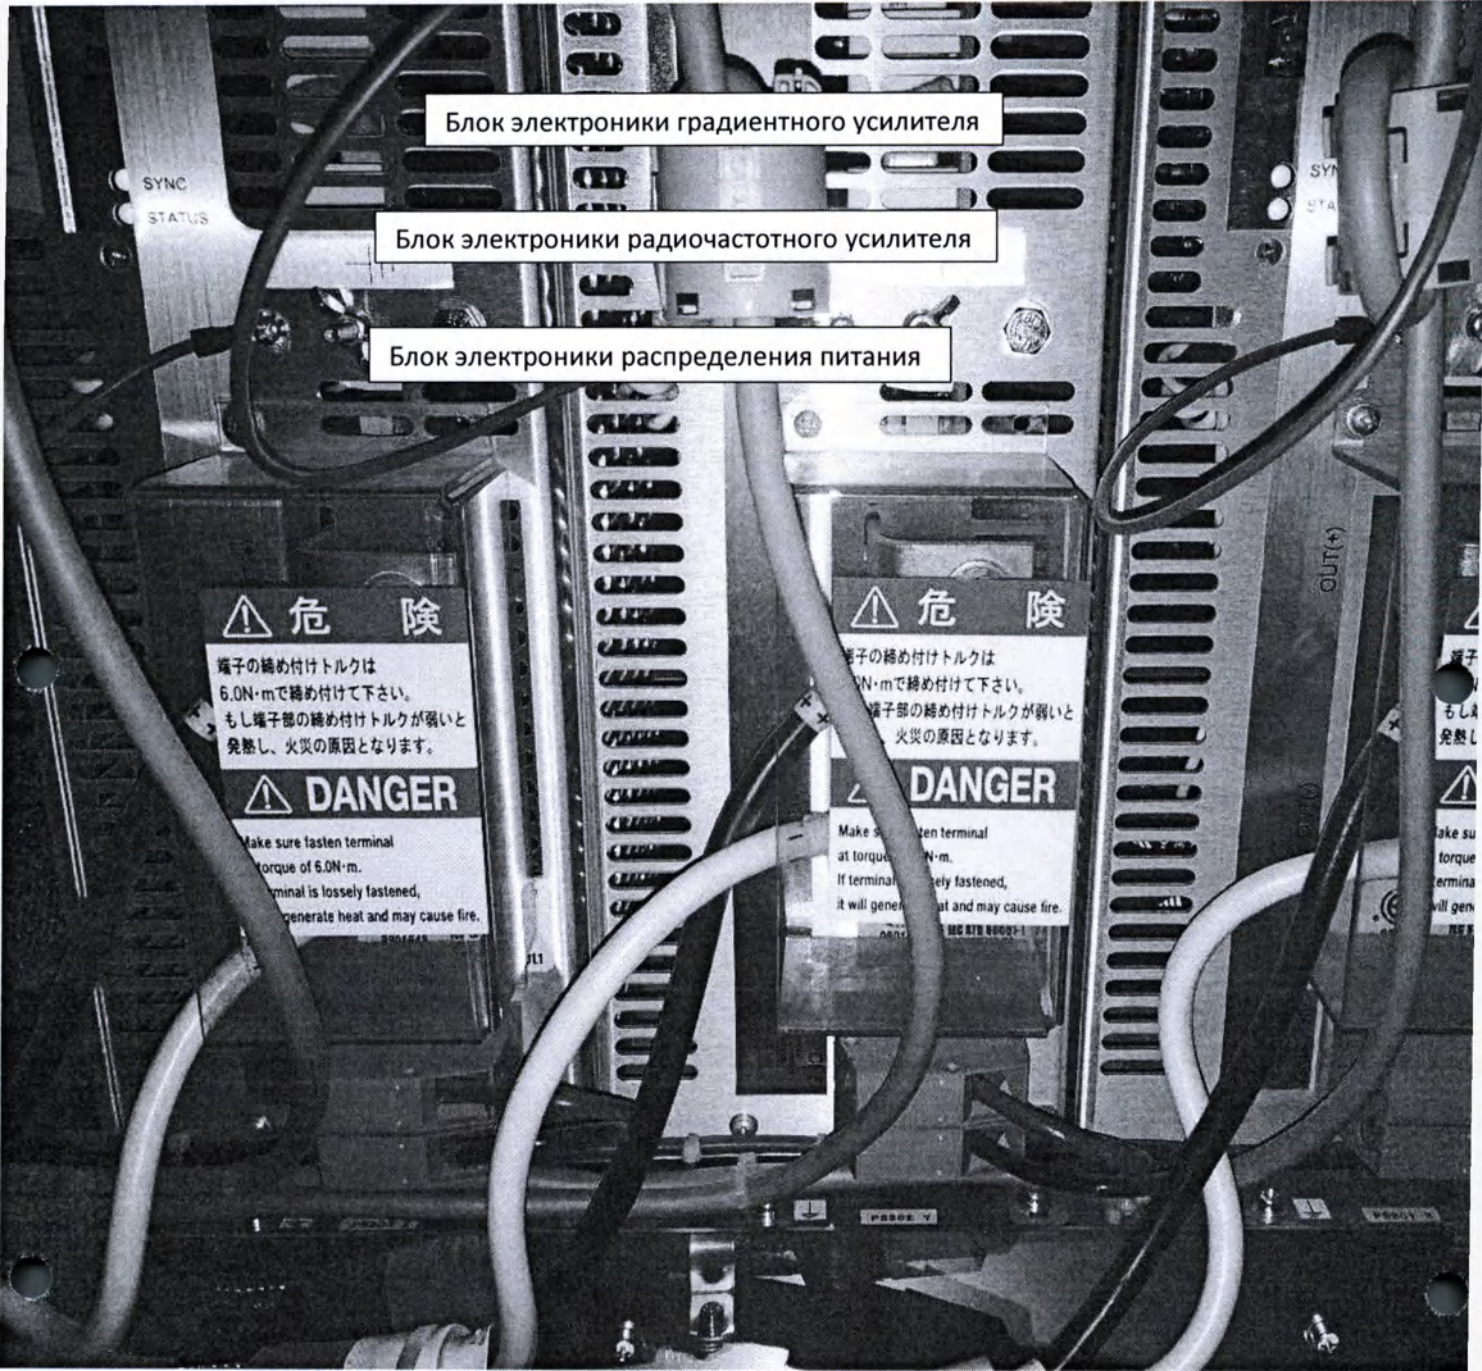


Блок электроники градиентного усилителя

Блок электроники радиочастотного усилителя

Блок электроники распределения питания

инсоль управления: компьютерный блок

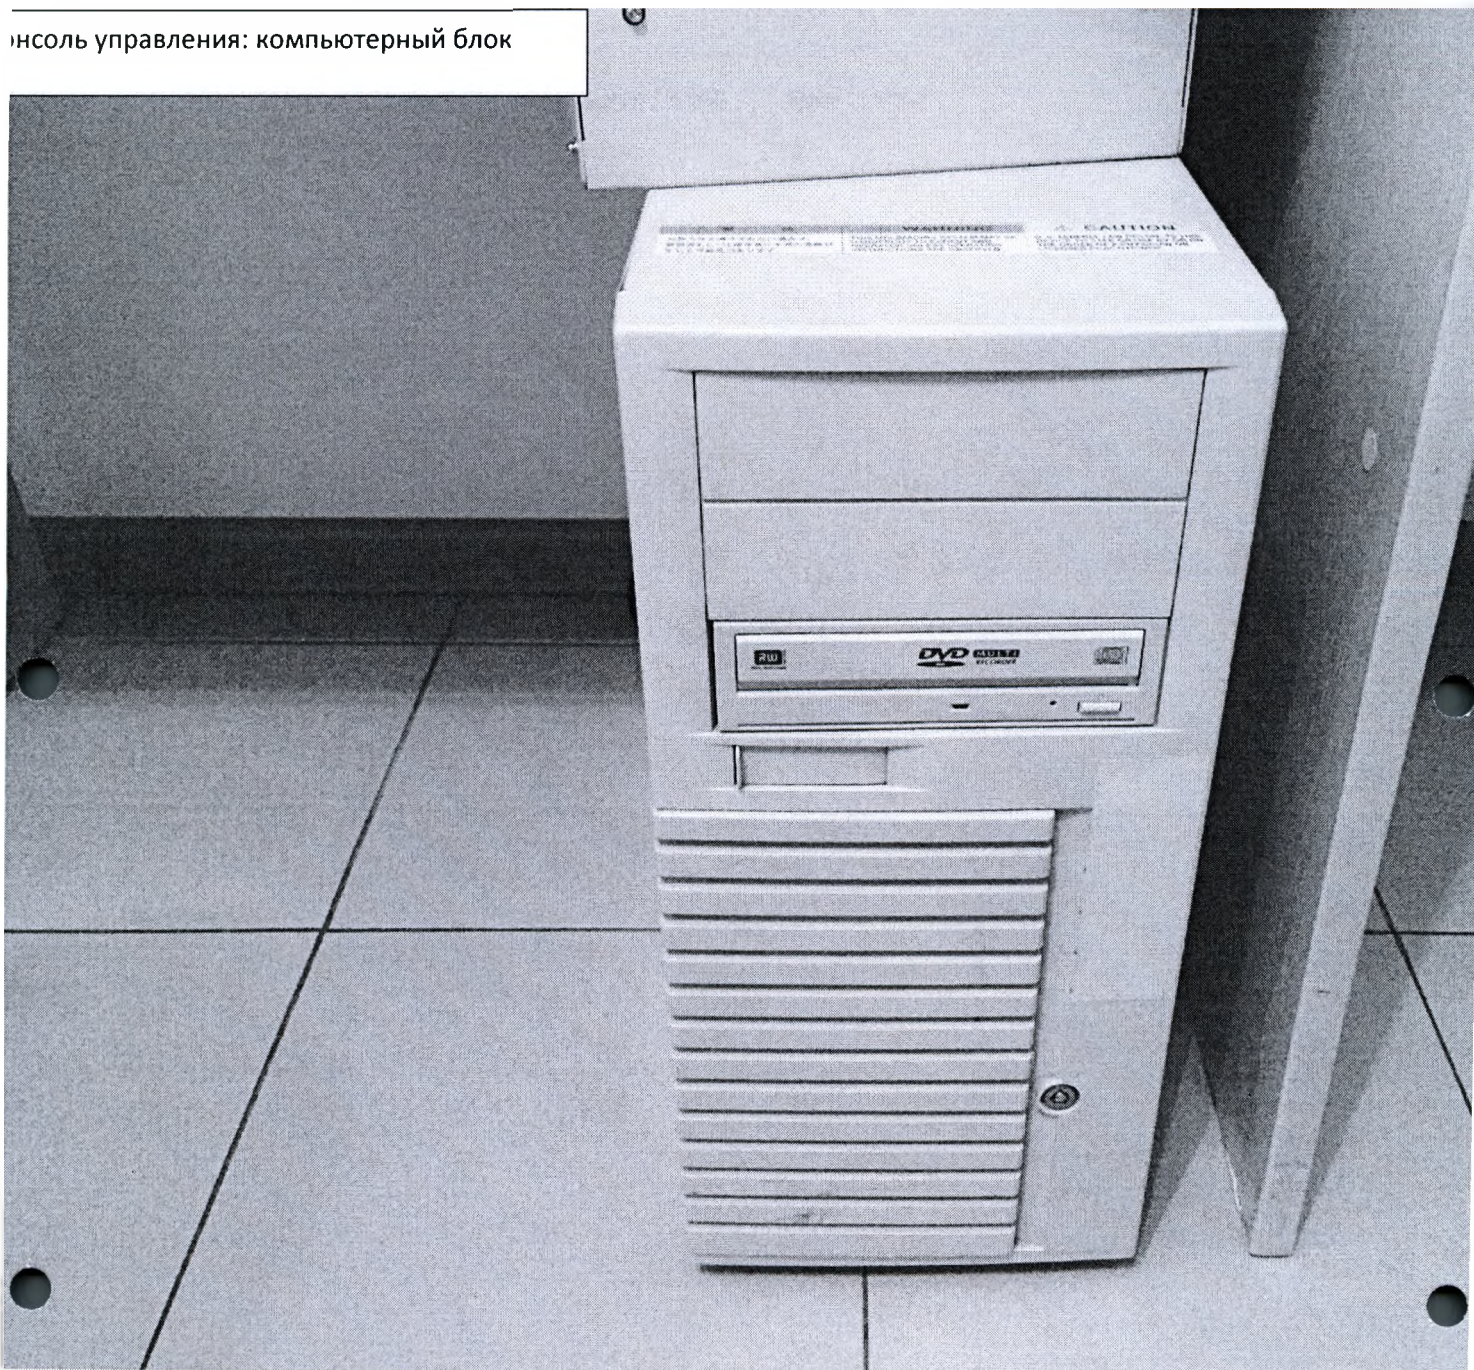

инсоль управления: компьютерный блок

MR IMAGING SYSTEM

TYPEMR-OP-150B

MAINS	TYPET	FREQ.	VOLTAGE	INPUT
		50/60Hz	100V	1.0kVA


No. KR17170.002

DATE

Hitachi Medical Corporation

REVISION											
	C		E	F	G	H	I	J			
N	O	P	Q	R	S	T	U	V			
A ₁	B ₁	C ₁	D ₁	E ₁	F ₁	G ₁	H ₁	I ₁	J ₁		
N ₁	O ₁	P ₁	Q ₁	R ₁	S ₁	T ₁	U ₁	V ₁	W ₁		
A ₂	B ₂	C ₂	D ₂	E ₂	F ₂	G ₂	H ₂	I ₂	J ₂		
N ₂	O ₂	P ₂	Q ₂	R ₂	S ₂	T ₂	U ₂	V ₂	W ₂		

Консоль управления: Жидкокристаллический
монитор

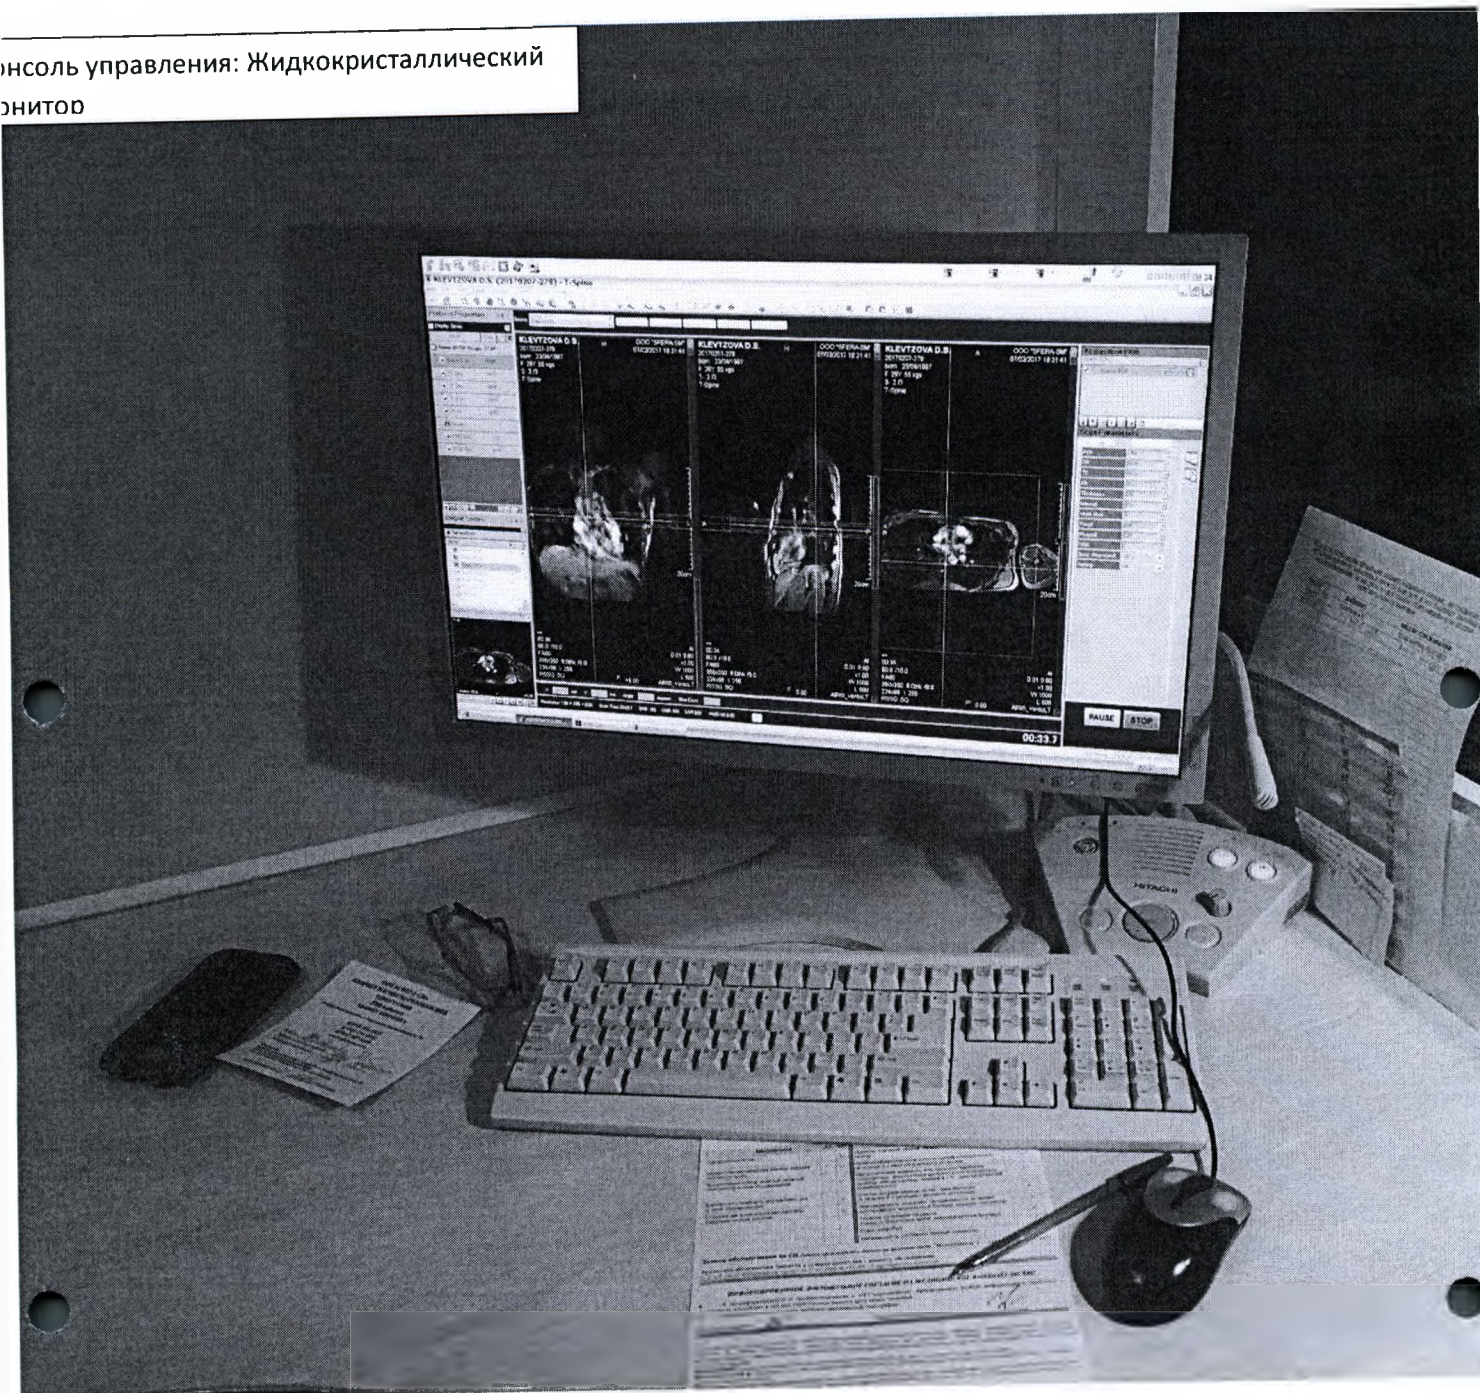


онсоль управления: Клавиатура



онсоль управления: Мышь




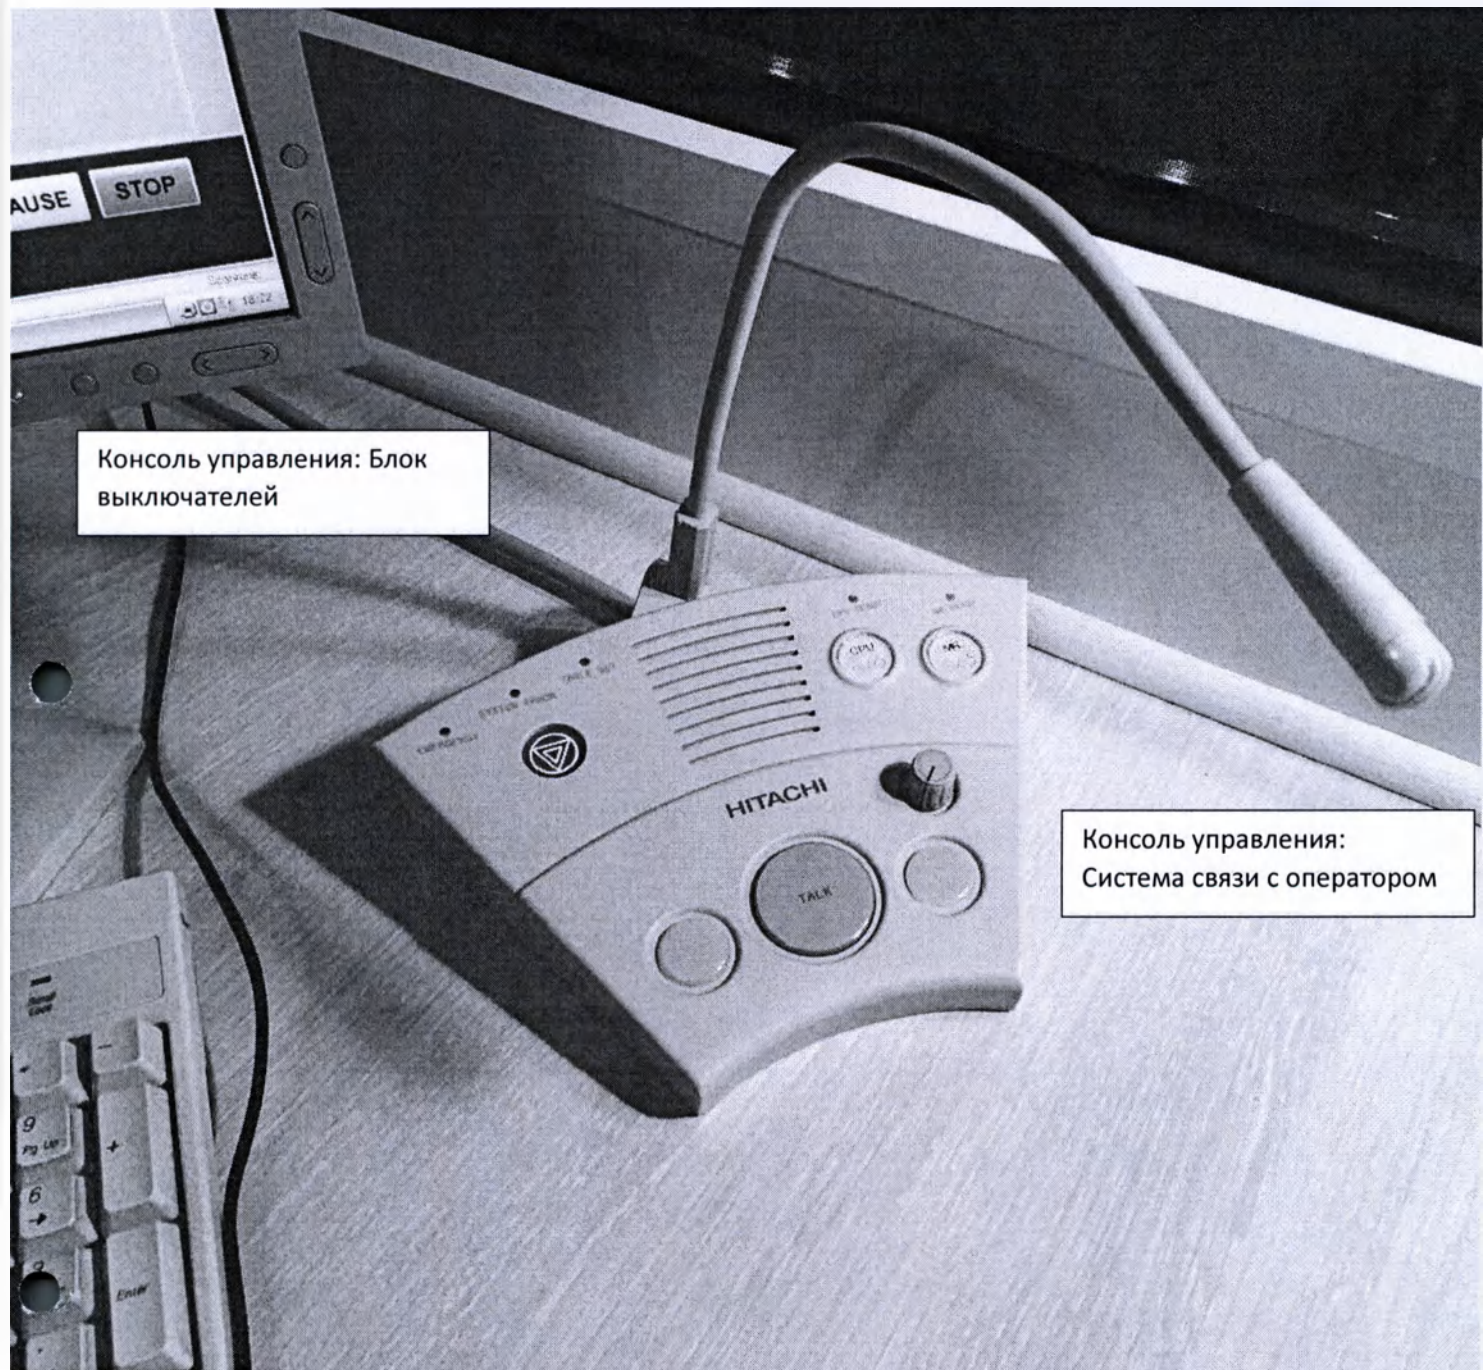

Консоль управления: Блок
выключателей

Консоль управления:
Система связи с оператором

Система связи с оператором

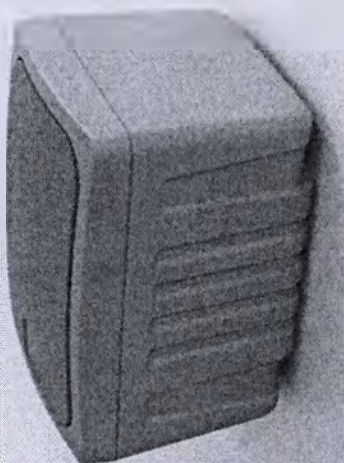

Программное обеспечение

SERVICE PACK CD ROM

30



PO: 4555017640

Item: 00020


FCO-MR-12-0005Z 6305

5000097341


5697 / 5697 / FCO

SP 1.2.4


Программное обеспечение

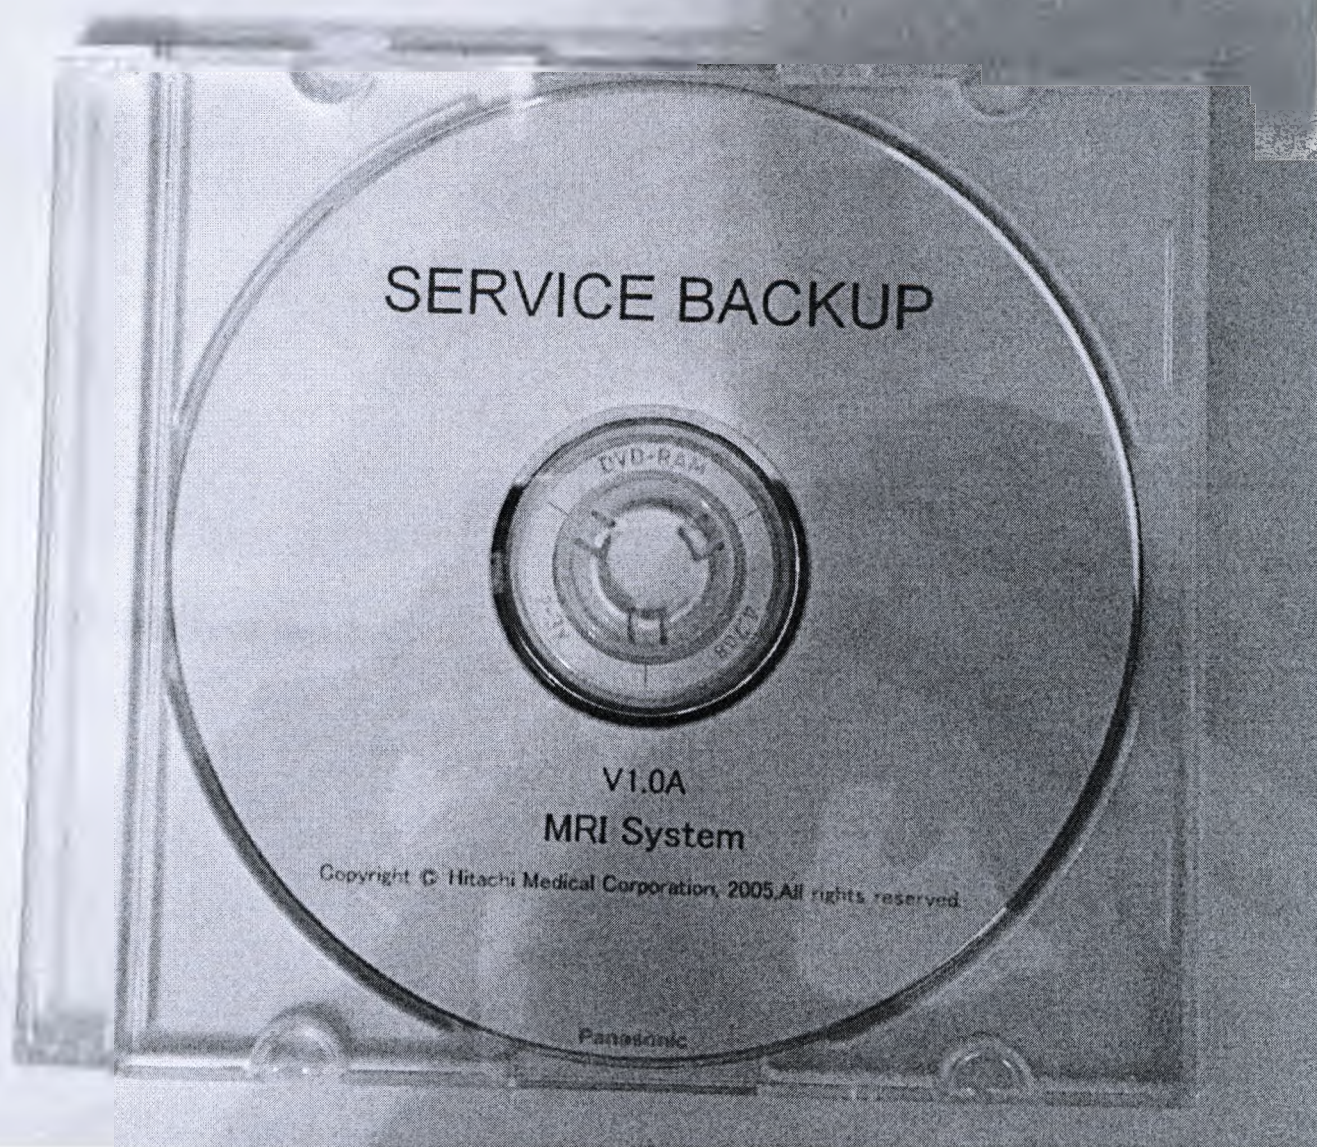

Программное обеспечение

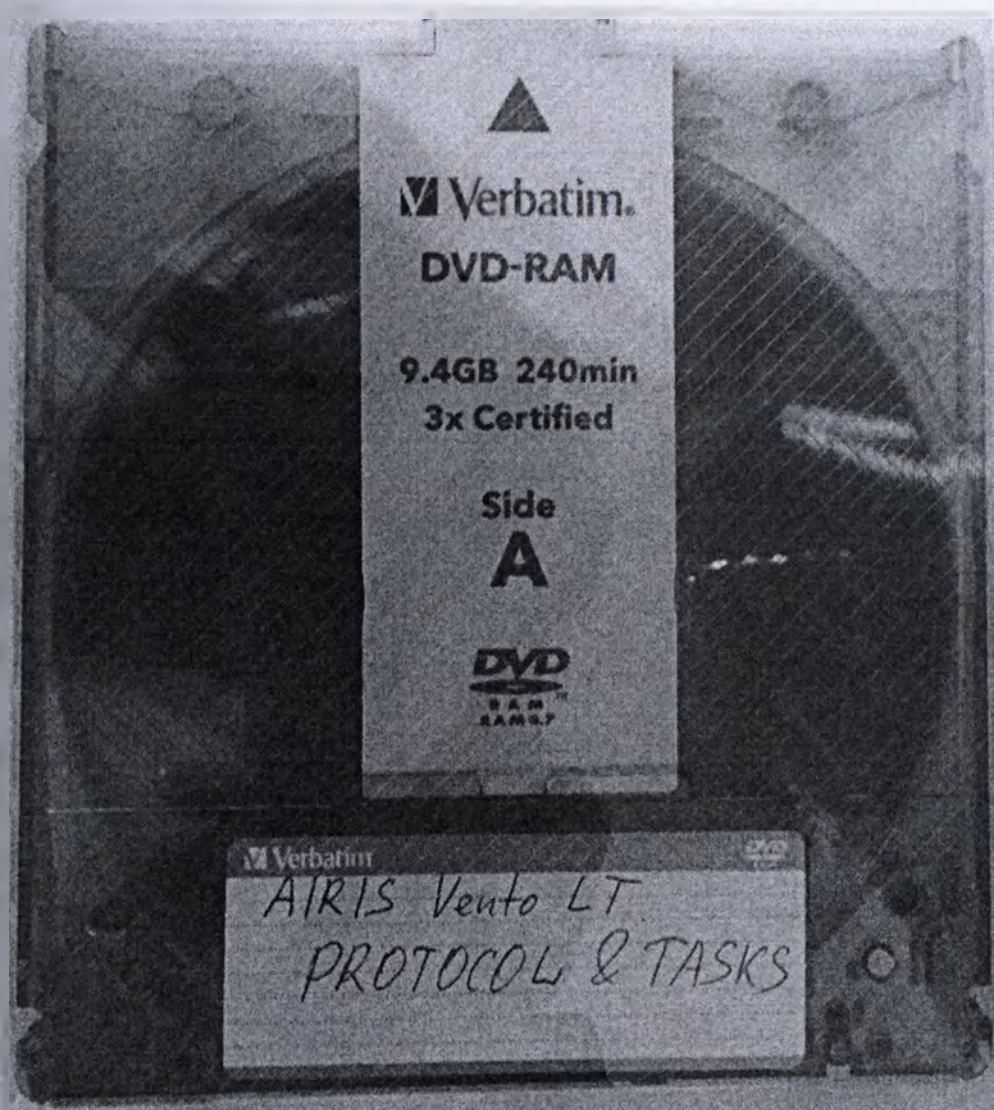


Программное обеспечение

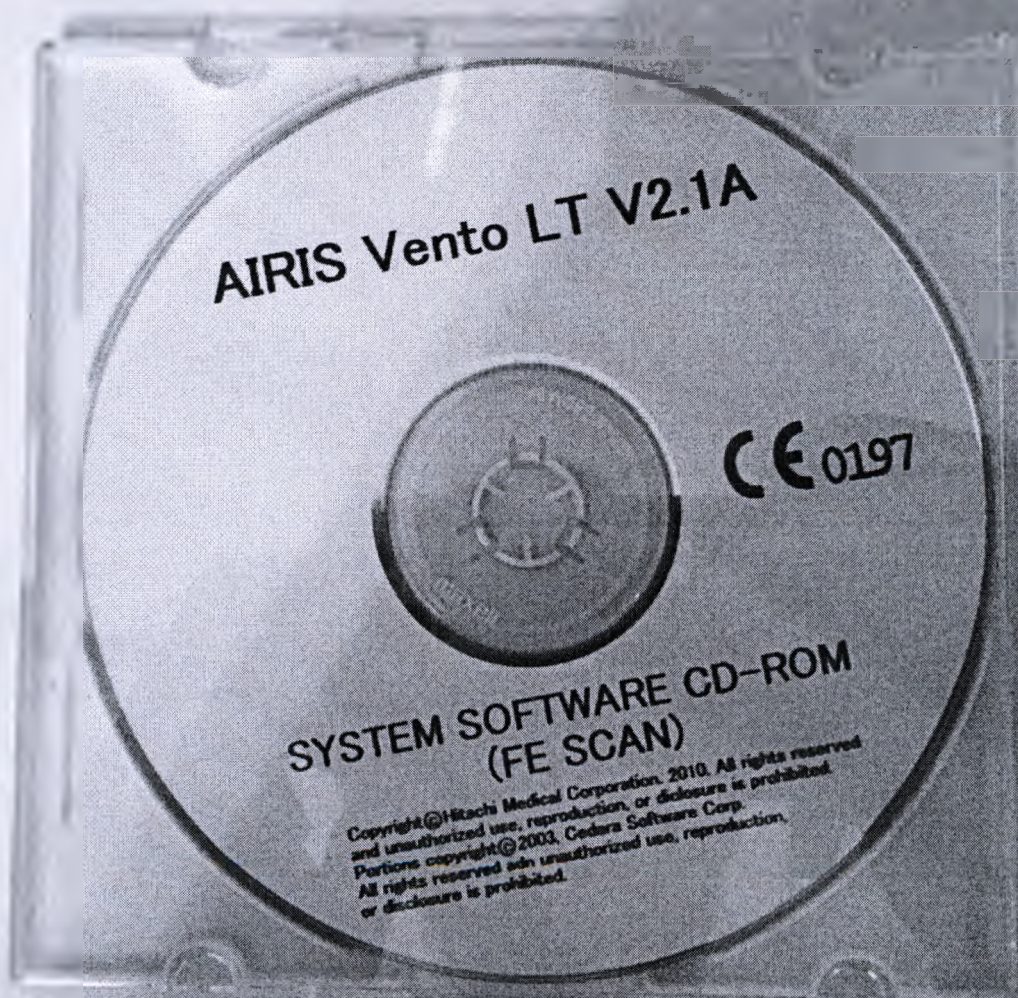

Программное обеспечение



Программное обеспечение

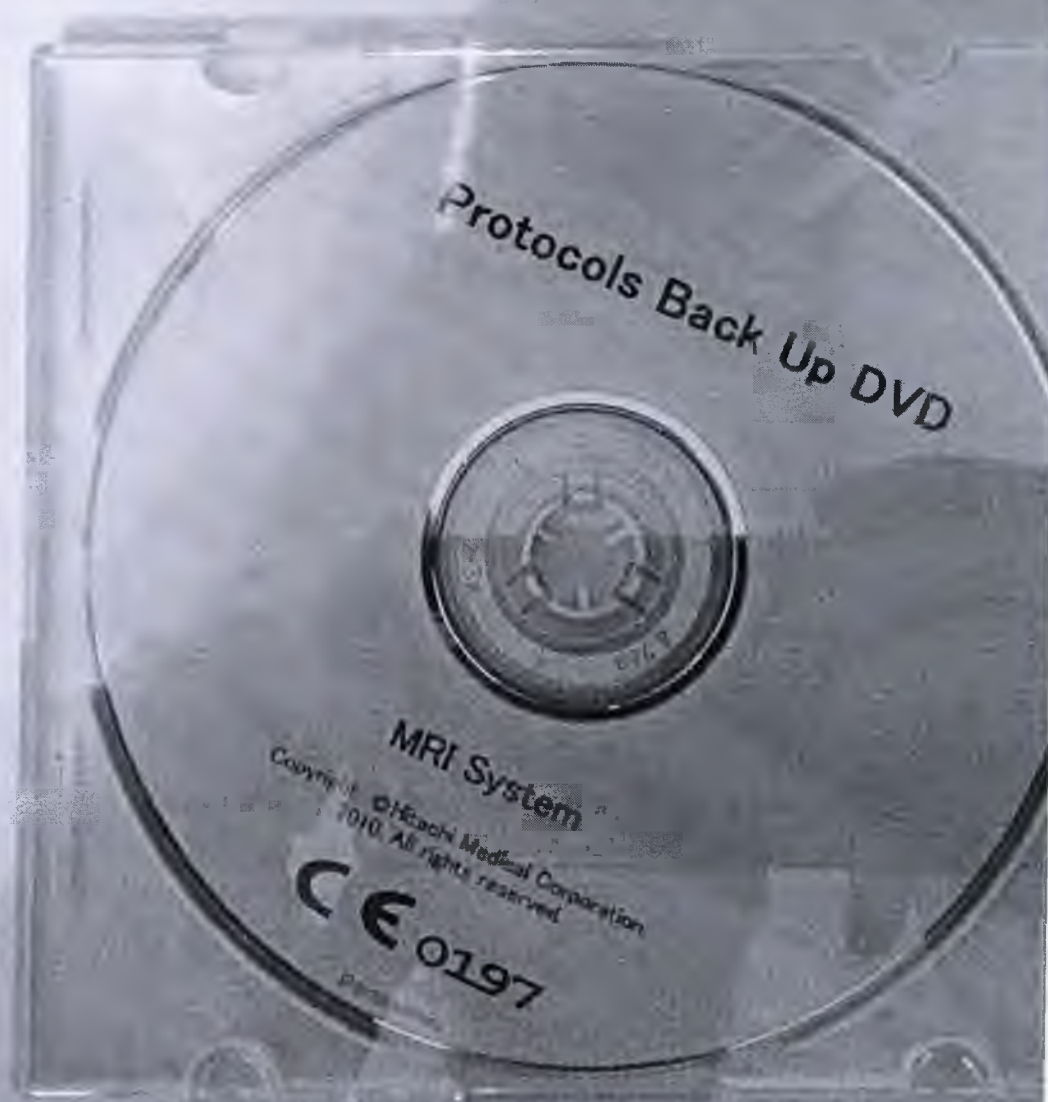

Программное обеспечение

Model : AIRIS Vento LT (MR-SF-165)
Serial Number : 16305 (0305)

CE 0197

Optional Software Name	Key 1	Key 2	Key 3	Key 4
DWI Package	7A44	9547	4E91	E3BE
BASG Imaging	DF61	1D46	6BE0	E7DA
Remote Service	89F1	A2BD	BB49	0C11
PC-MRA	1F19	48AB	528E	F833
DICOM Modality Worklist	8C71	CB74	037D	0156
IHE PDI	8041	6BC7	828A	9A2B
Gate Package	2ABC	15D3	1CC8	2D3A

Copyright (c) Hitachi Medical Corporation. 2010. All Rights Reserved.
Portions copyright (c) 2003, Cedara Software Corp.
All rights reserved and unauthorized use, reproduction, or disclosure is prohibited.

Программное обеспечение

Service Pack CD-ROM

V2.1A Service Pack 3 Enhancement V1.0A

SERVICE PACK CD AIR.VENTO + APER.ETERNA 2



PO: 4555017463

Item: 00010

FCO-MR-12-0003

G30J

5000096335

5697 / 5697 / FCO

SP 1.2.3

System Version
AIRIS Vento LT V2.1A

Copyright © Hitachi Medical Corporation. 2012.
All rights reserved

Программное обеспечение




Программное обеспечение

Model: AIRIS Vento LT(KB514091A)

	File Name	Document No.
1	Check and Service Program	L4E-BM5699-2
2	Printer and DICOM Network setting function	L0E-BM5690-2
3	IHE Consistent Presentation of Images	L0E-BM5692-2
4	DICOM Modality Worklist	L0E-BM5693-2
5	DICOM MPPS	L0E-BM5694-2
6	Sentinel Customer Support	L0E-BM5703-1
7	Installation & Adjustment	L2E-BM5705-3
8	Image Adjustment	L2E-BM5701-1
9	Maintenance and Inspection	L3E-BM5702-2
10	Magnetic Field Adjustment	L0E-BM5665-3
11	DVD Recovery Tool	L0E-BM5696-2
12	Standard Protocol Installation	L2E-BM5729-2
13	IHE Key Image Note	L0E-BM5697-1
14	IHE PDI	L0E-BM5698-2
15	IHE Basic Security	L0E-BM5691-2
16	DICOM Conformance Statement	E1E-BM7358-1
17	IHE Integration Statement	E1E-BM7359-1
18	Circuit Diagram	L3E-BM5629-1
19	Operator Call	L0E-BM5607-2
20	Magnetic Field Compensation Unit	L0E-BM5325-3
21	Principle of Operation	L1E-BM5715-1
22	Uninterruptible Power Supply (UPS)	L2E-BM5709-1
23	MO Read	L0E-BM5695-2
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Программное обеспечение

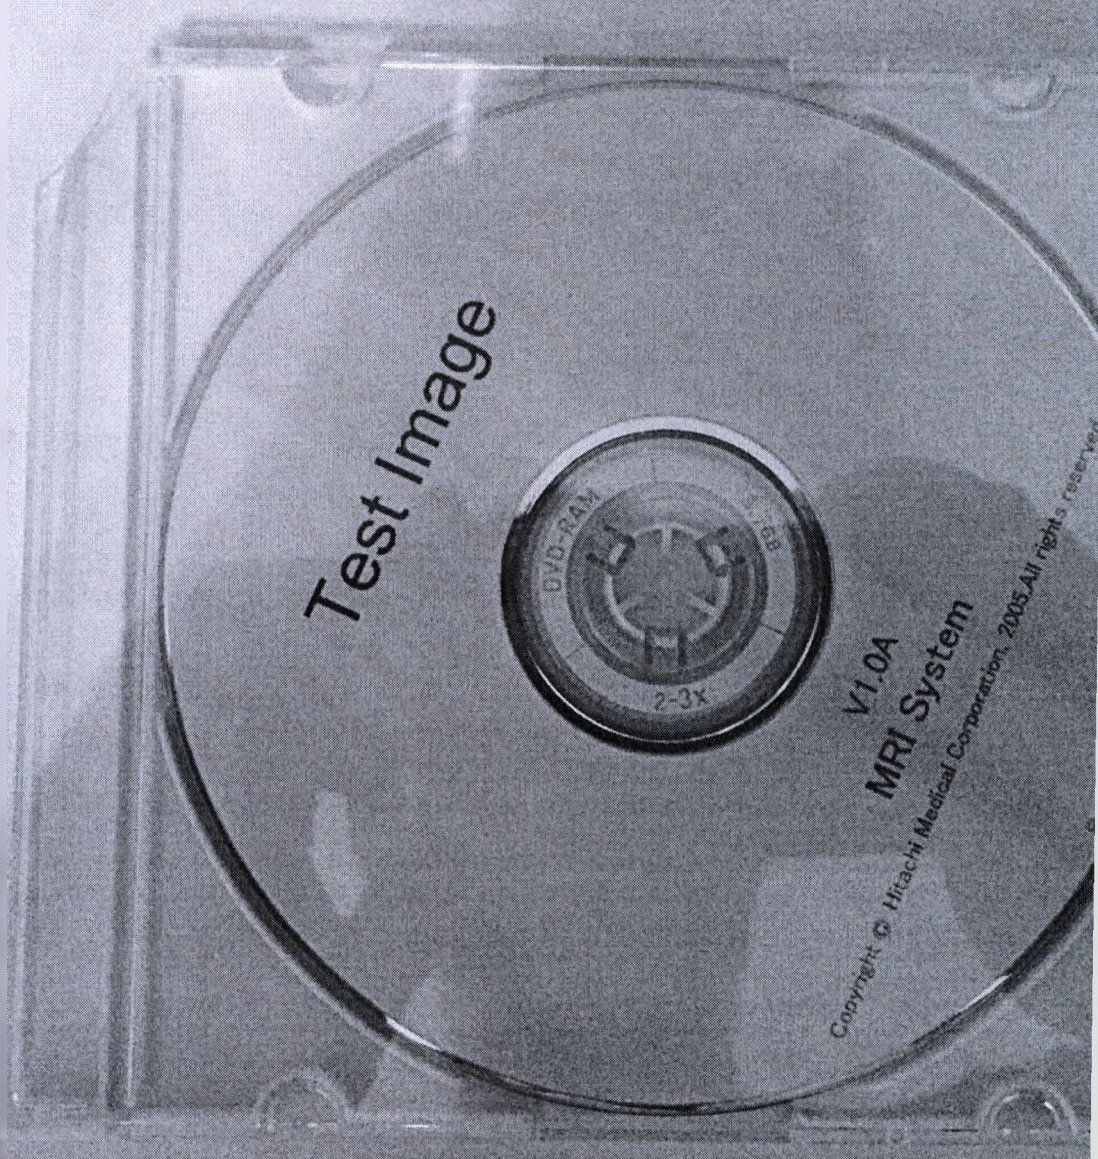

Программное обеспечение

AIRIS Vento LT


Standard Protocols V2.1A

For System Software V2.1A~

Copyright © Hitachi Medical Corporation
2010. All rights reserved.

CE 0197

Panasonic

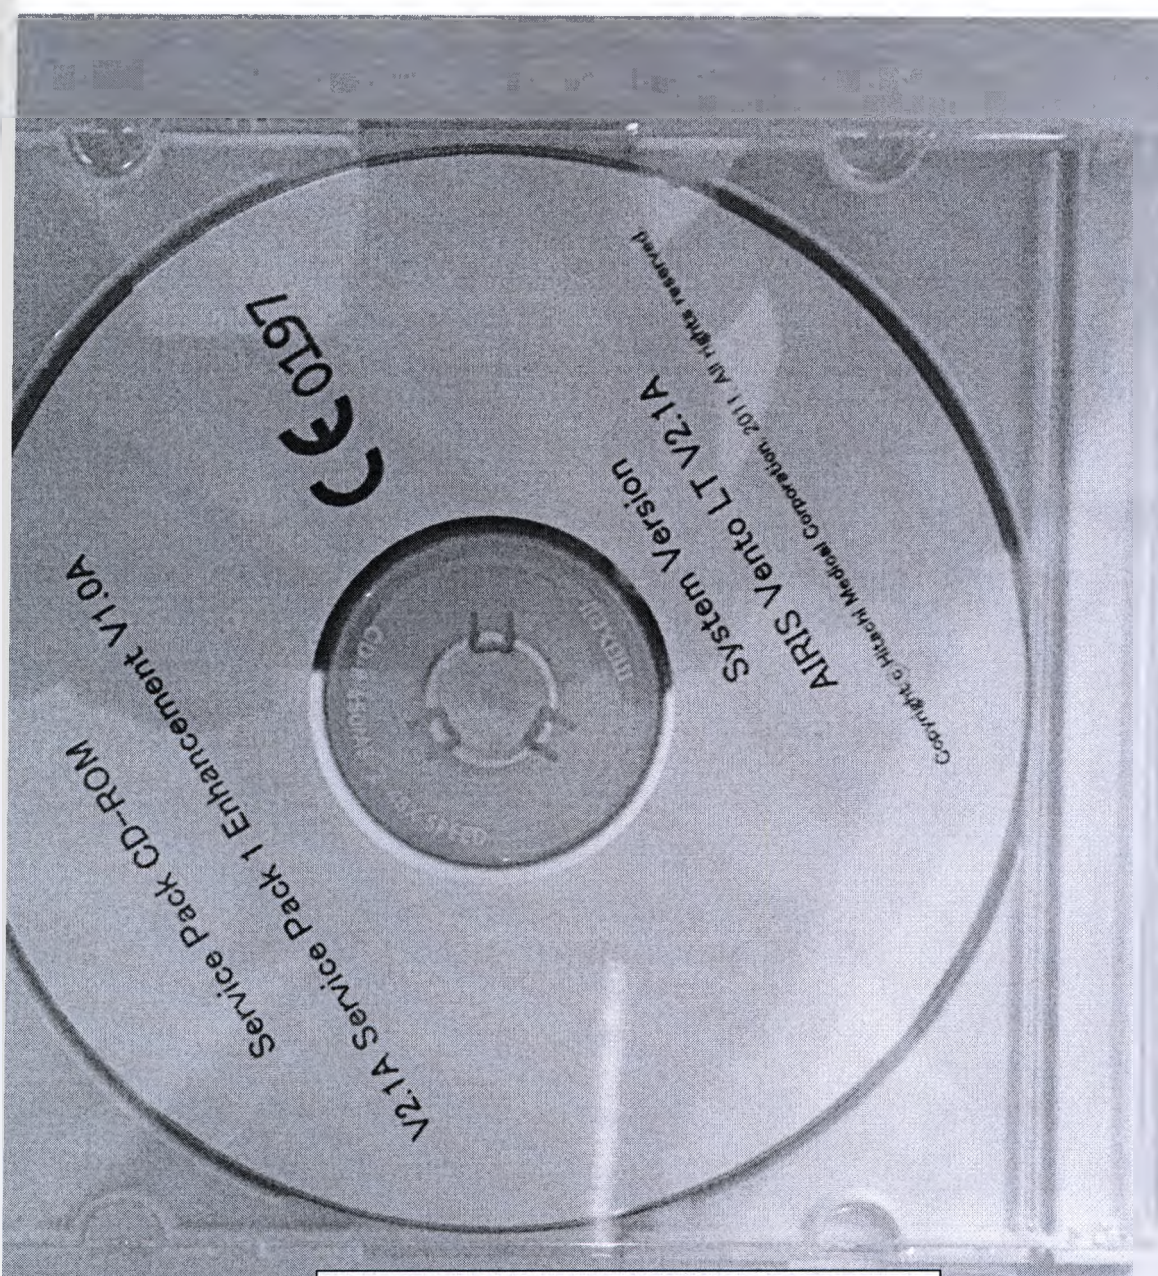

Программное обеспечение


Программное обеспечение


Service Pack CD-ROM
V2.1A Service Pack 2 Enhancement V1.0A
SP 1,2

System Version
AIRIS Vento LT V2.1A

Copyright © Hitachi Medical Corporation. 2011
All rights reserved

Цель ЭКГ

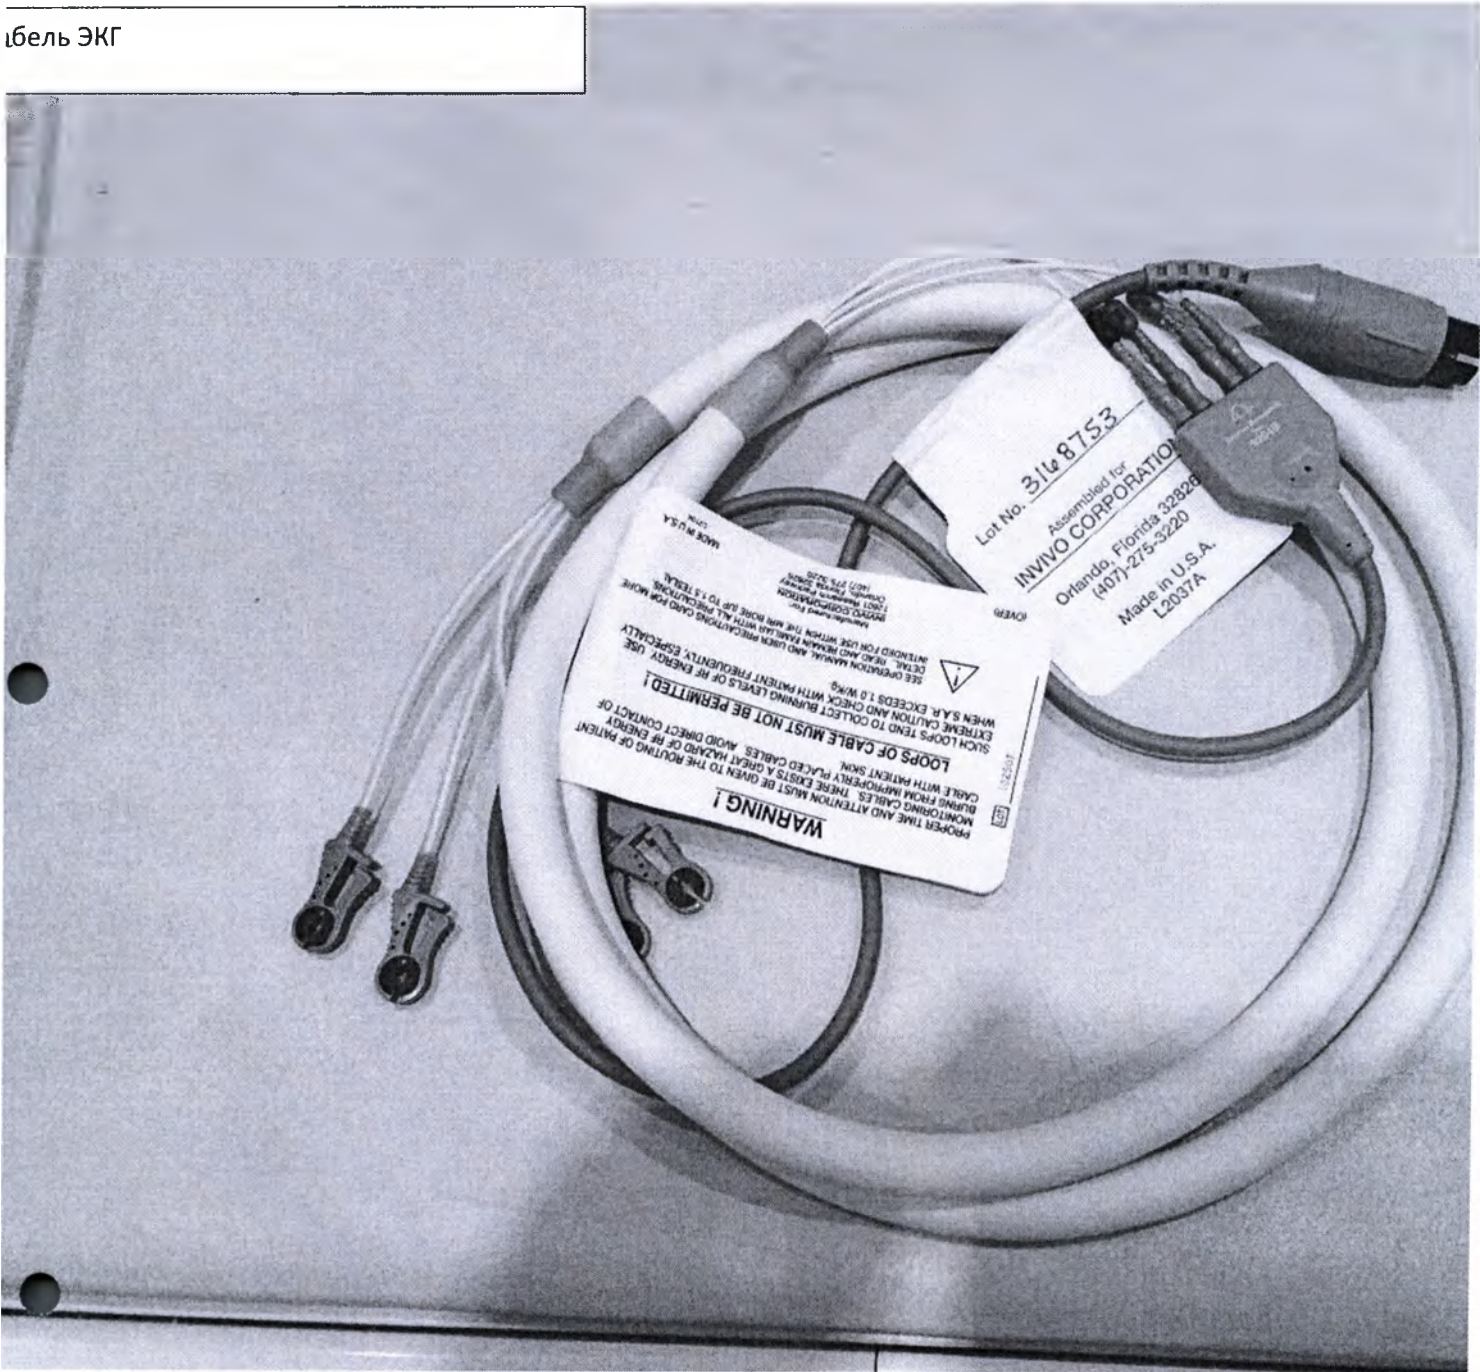

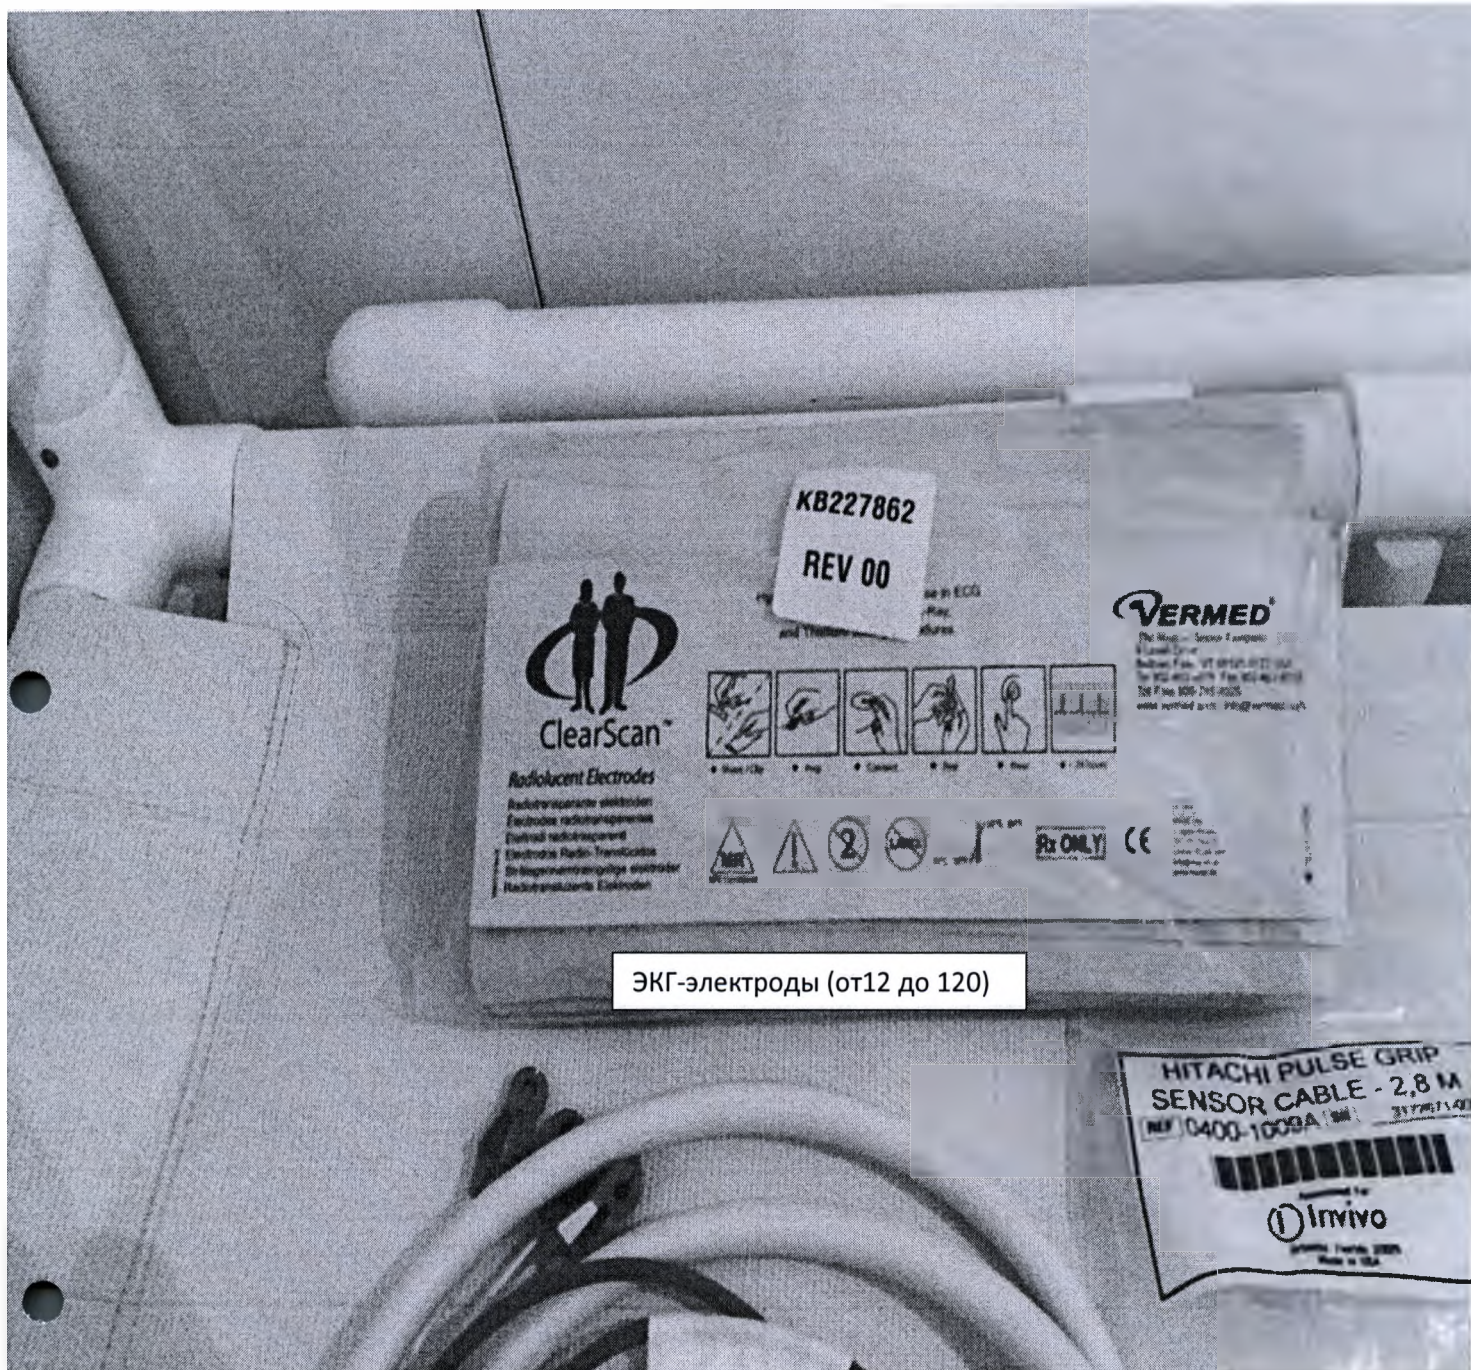

ЭКГ-электроды (от12 до 120)


датчик периферического пульса (от 1 до 5 шт.)




датчик с трубками для дыхательной
синхронизации (от 3 до 10 шт.)




ильтр для кабелей освещения

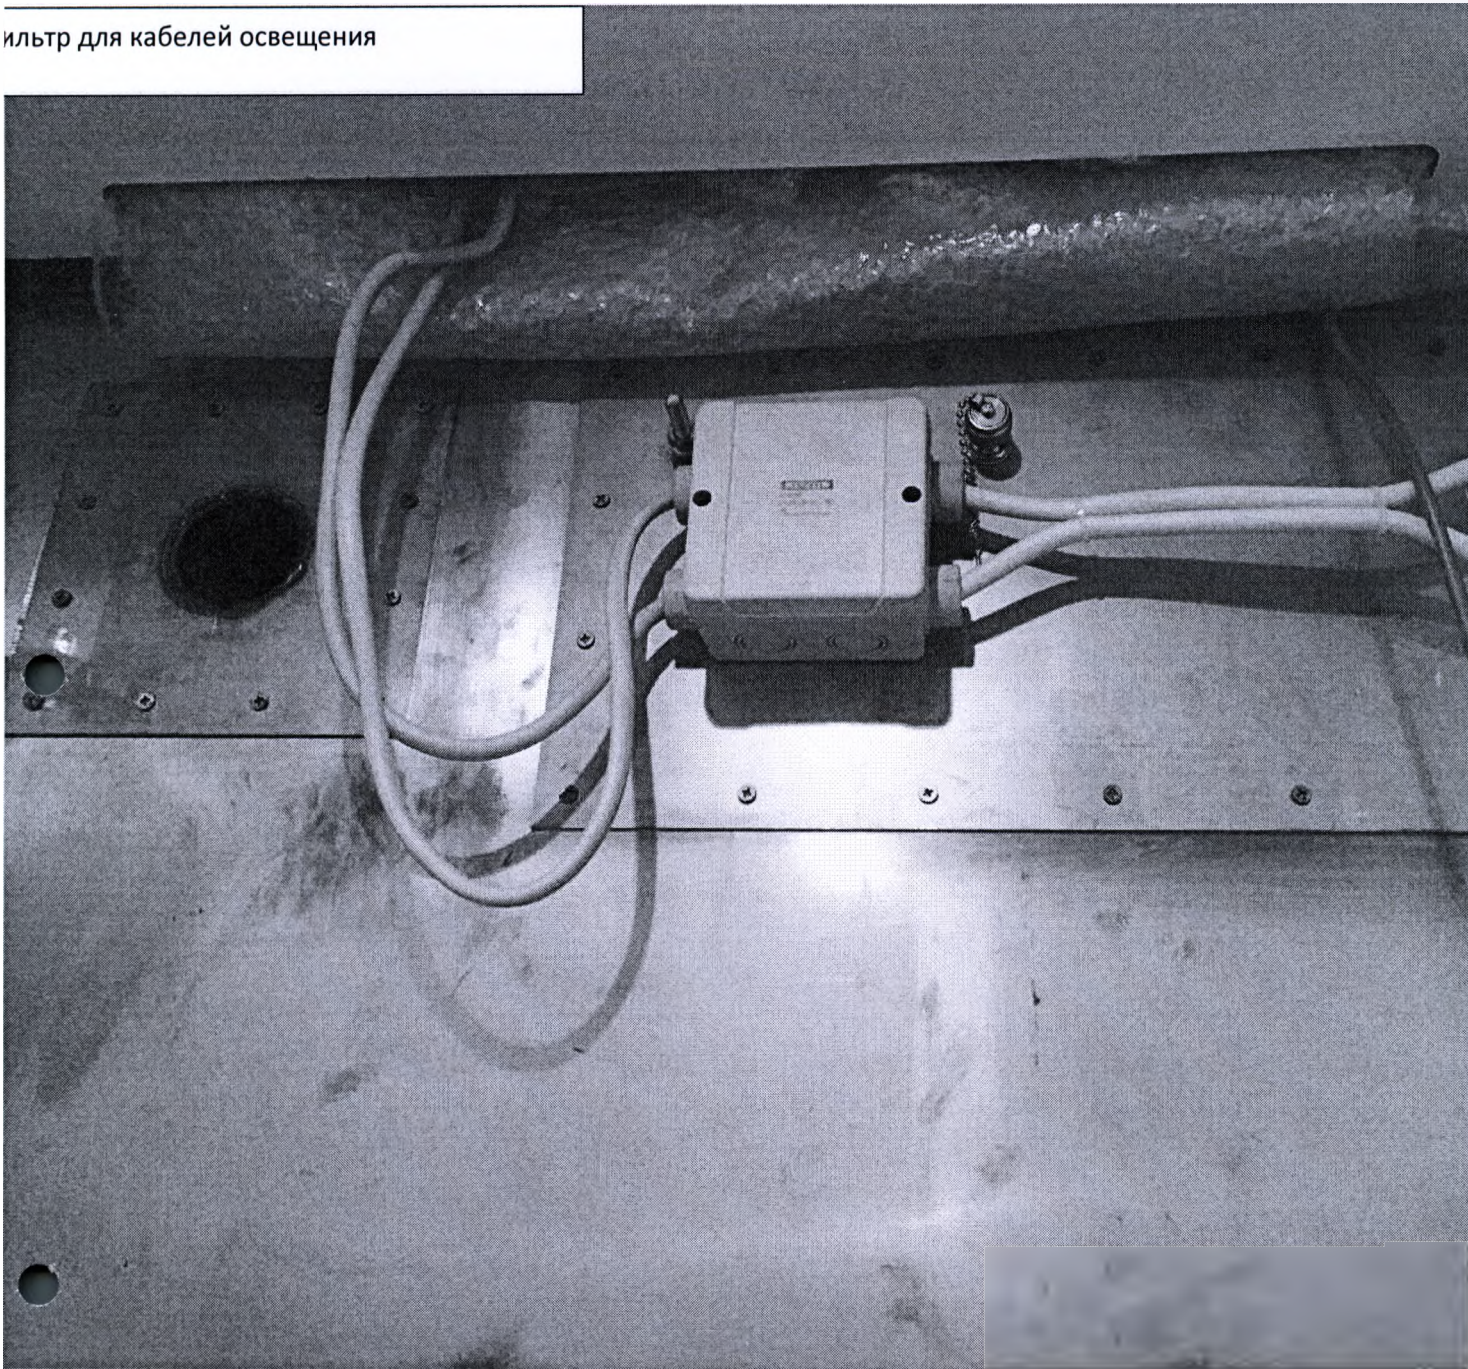


Фильтр для электронных и оптических кабелей

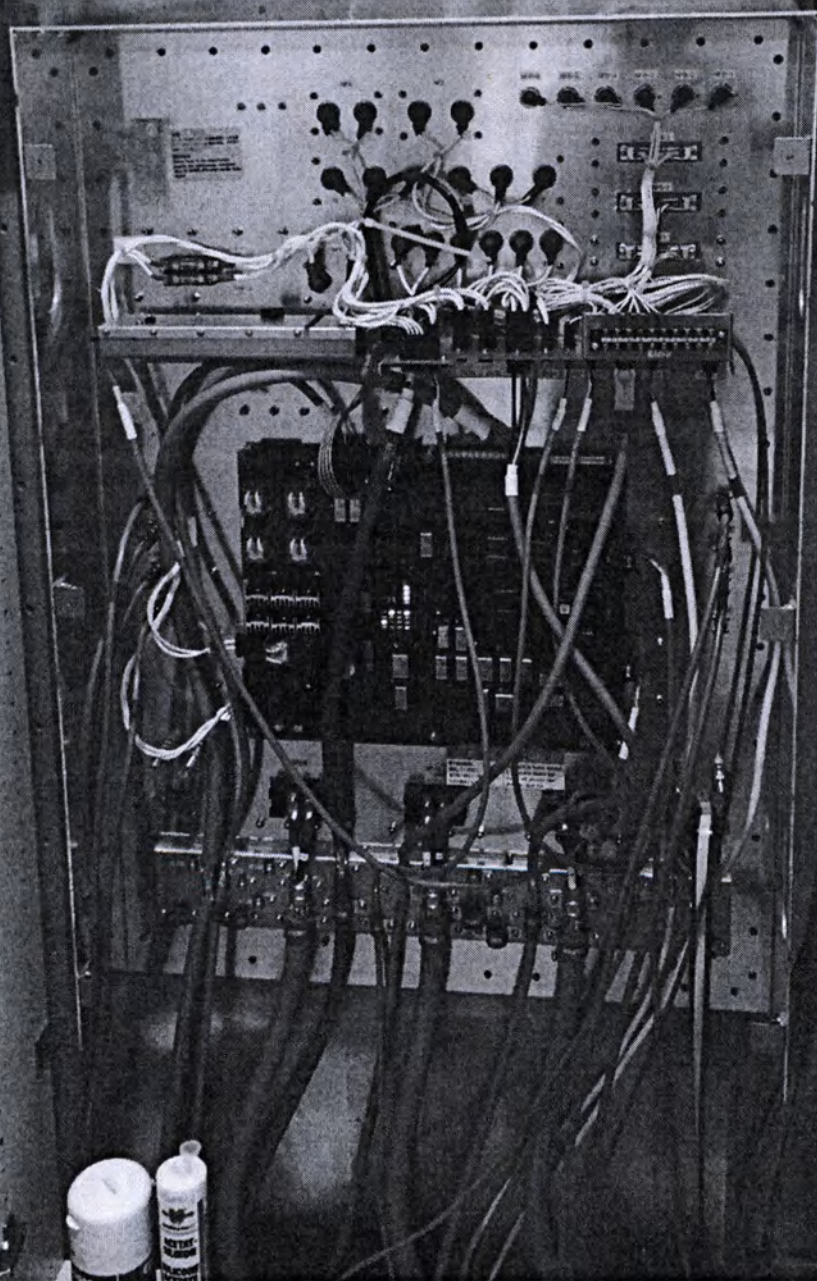

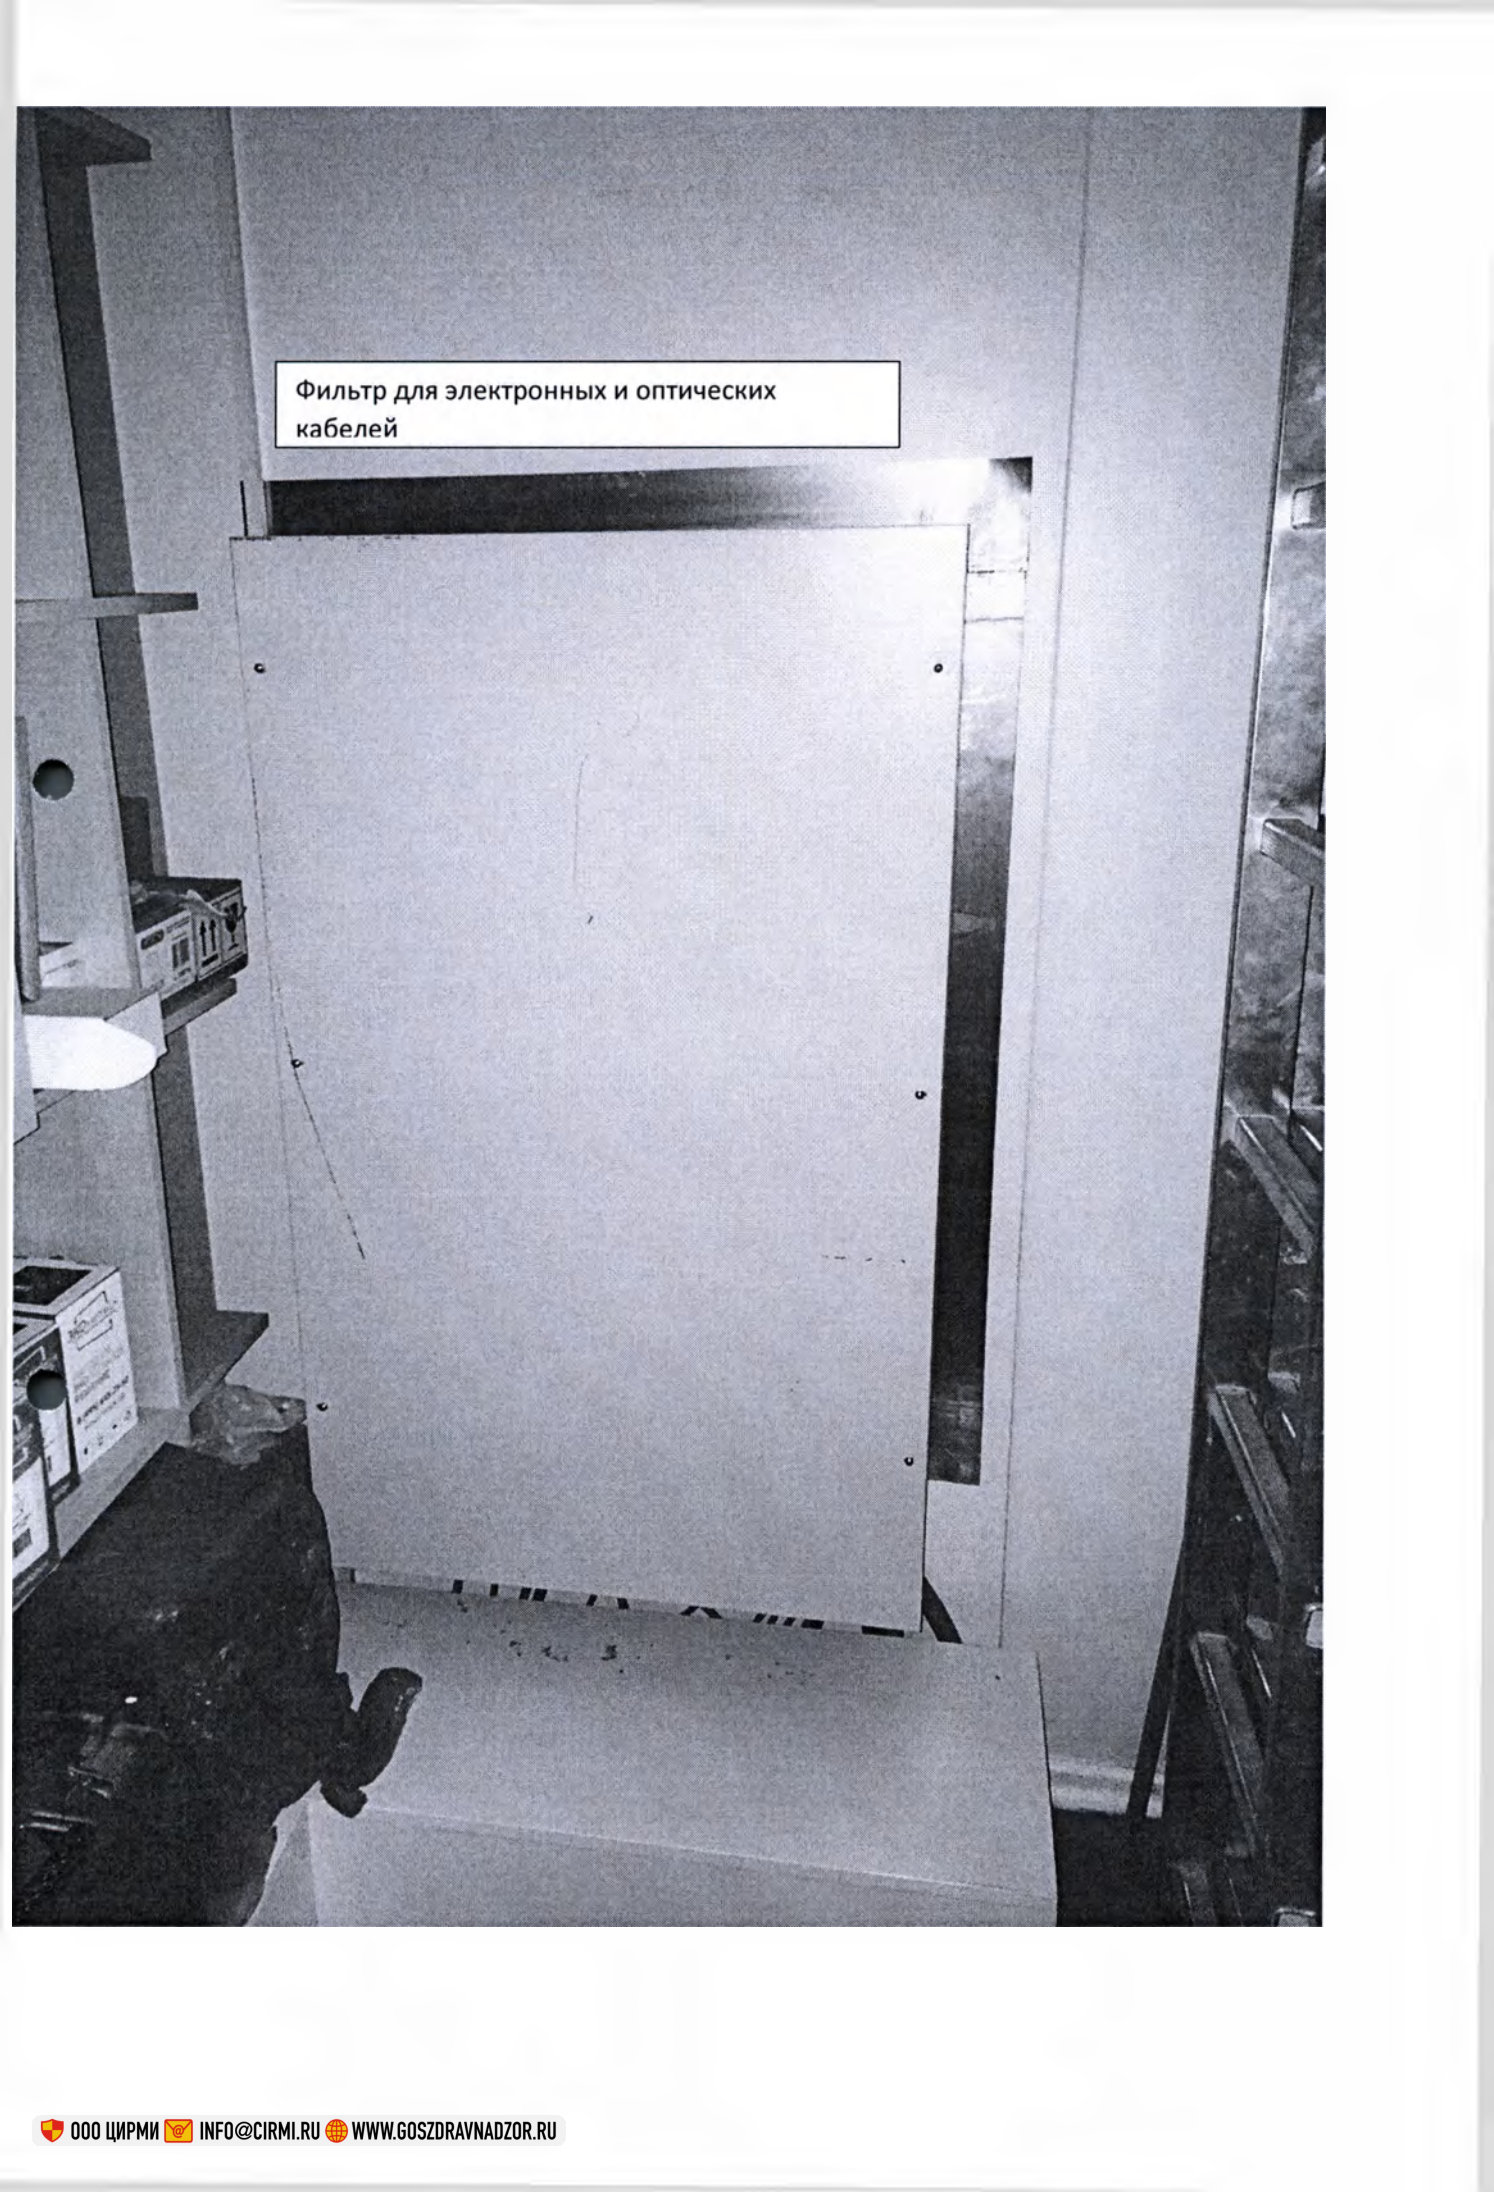


Фильтр для электронных и оптических кабелей

антом 1 калибровочный для настройки
тушек

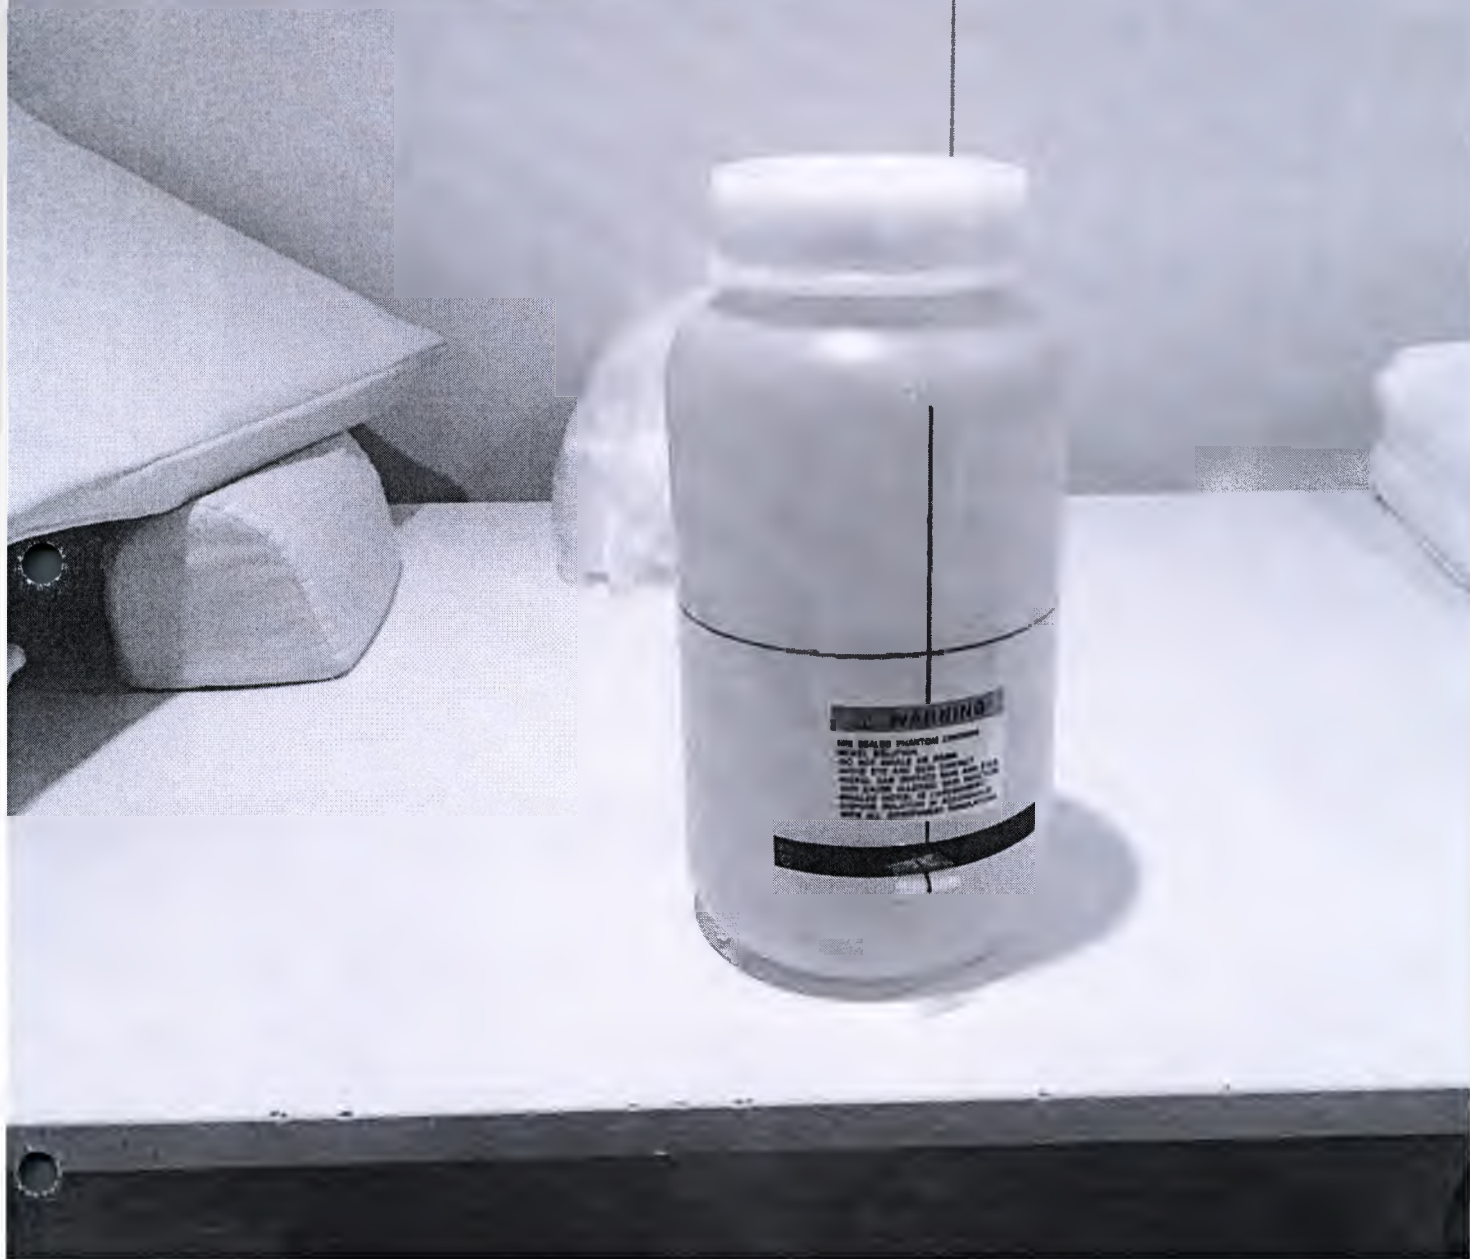


антом 1 калибровочный для настройки
тушек

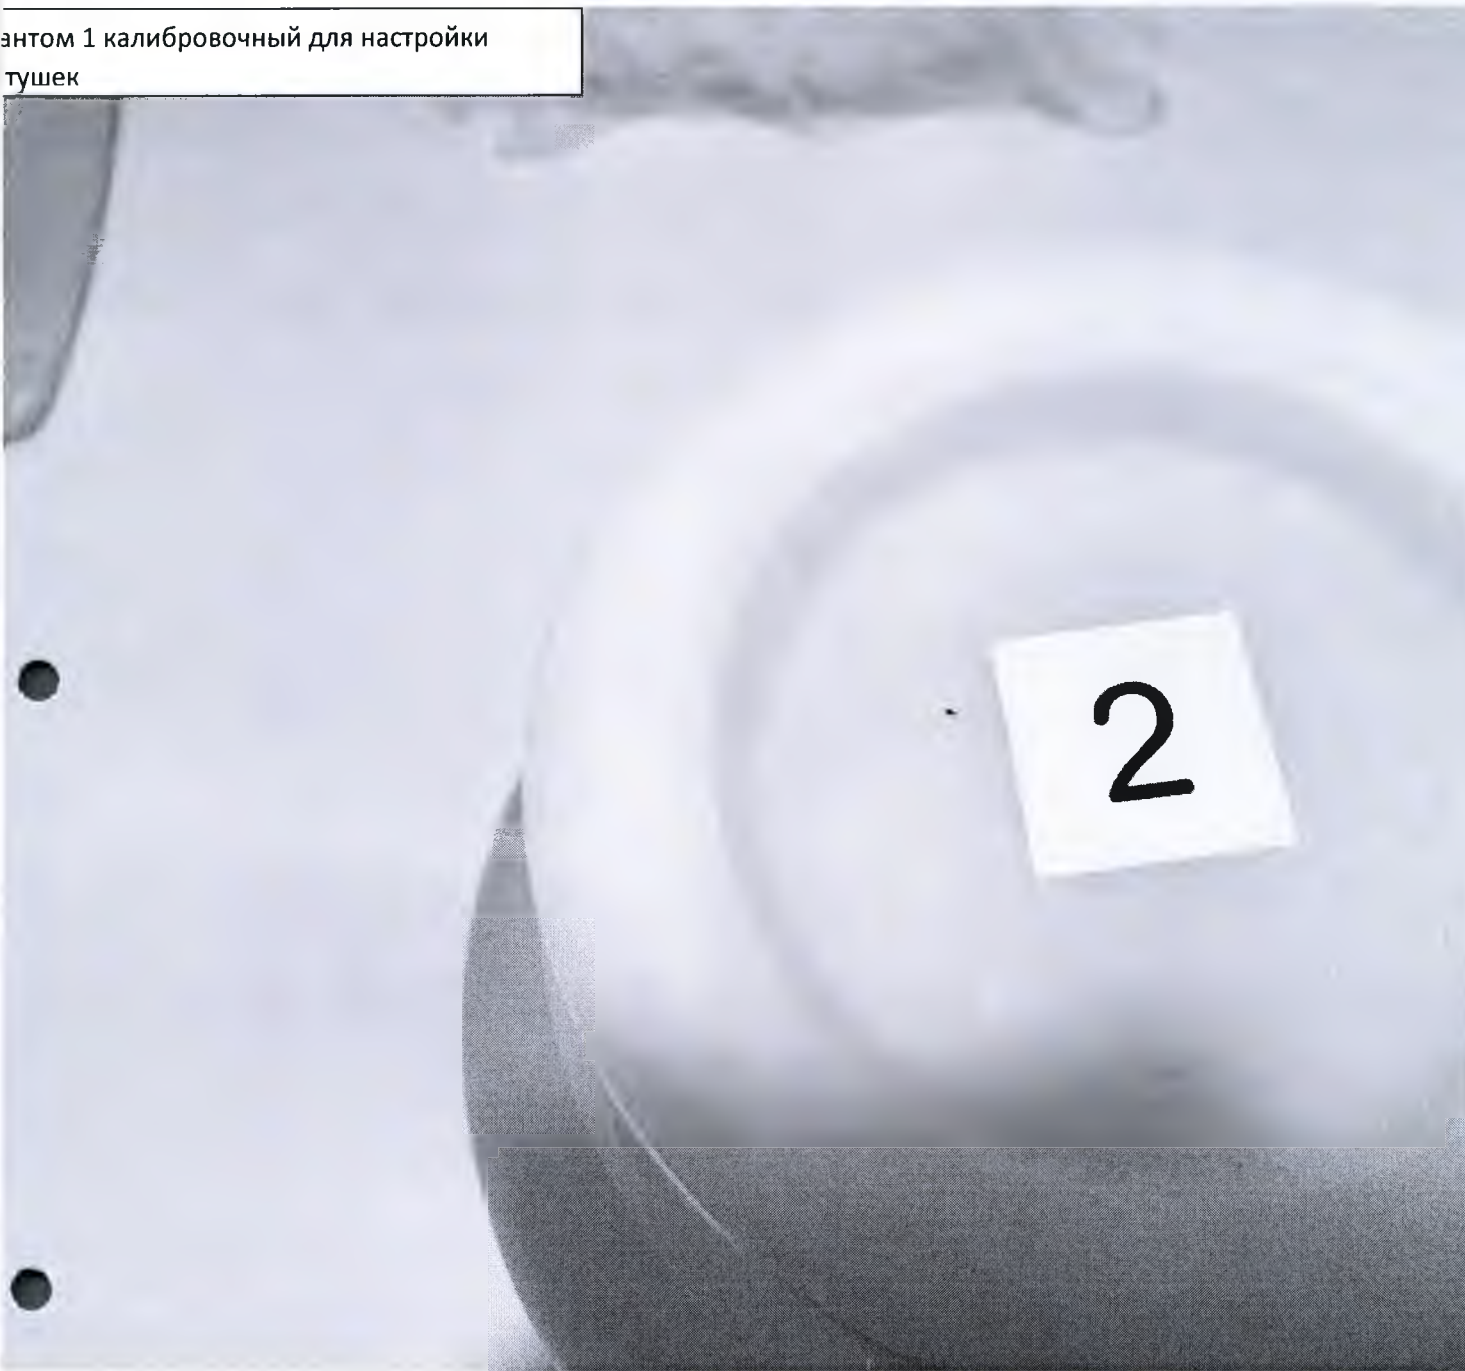


антом 2 калибровочный для настройки
штушек



антом 3 калибровочный для настройки
тушек

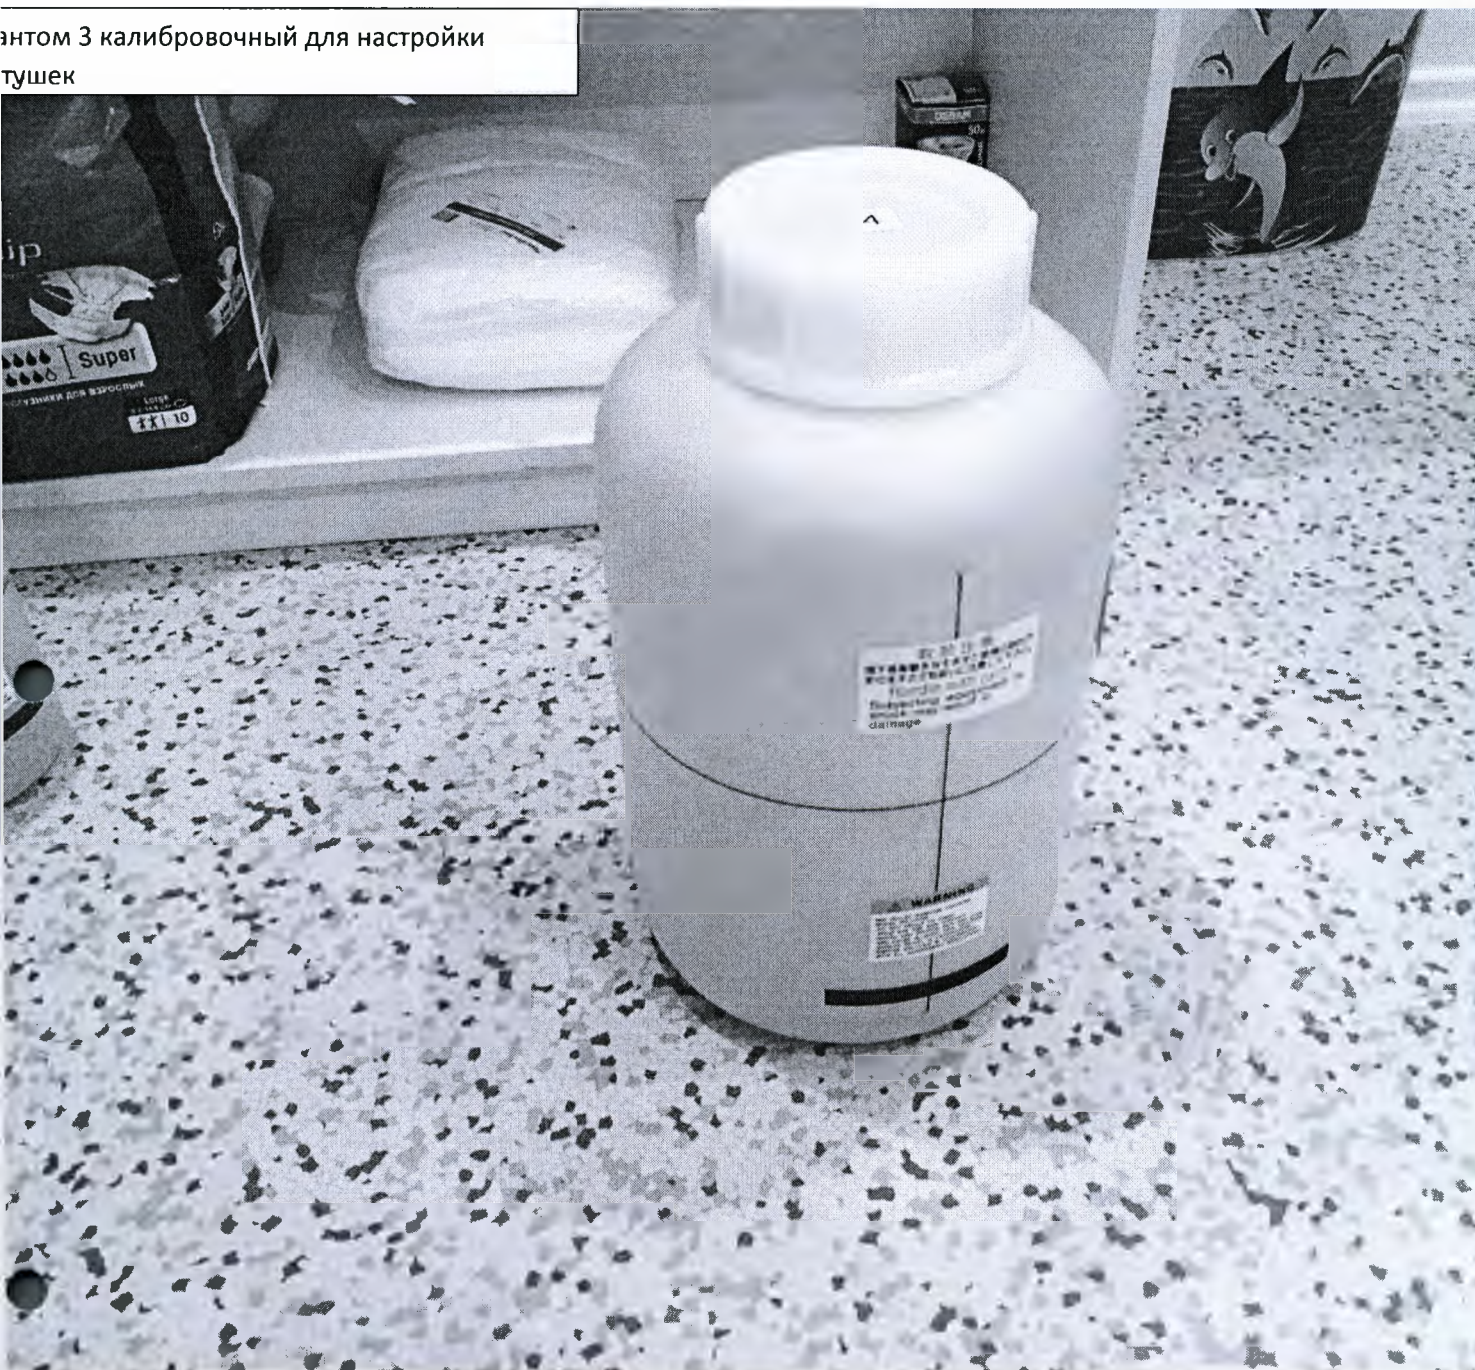

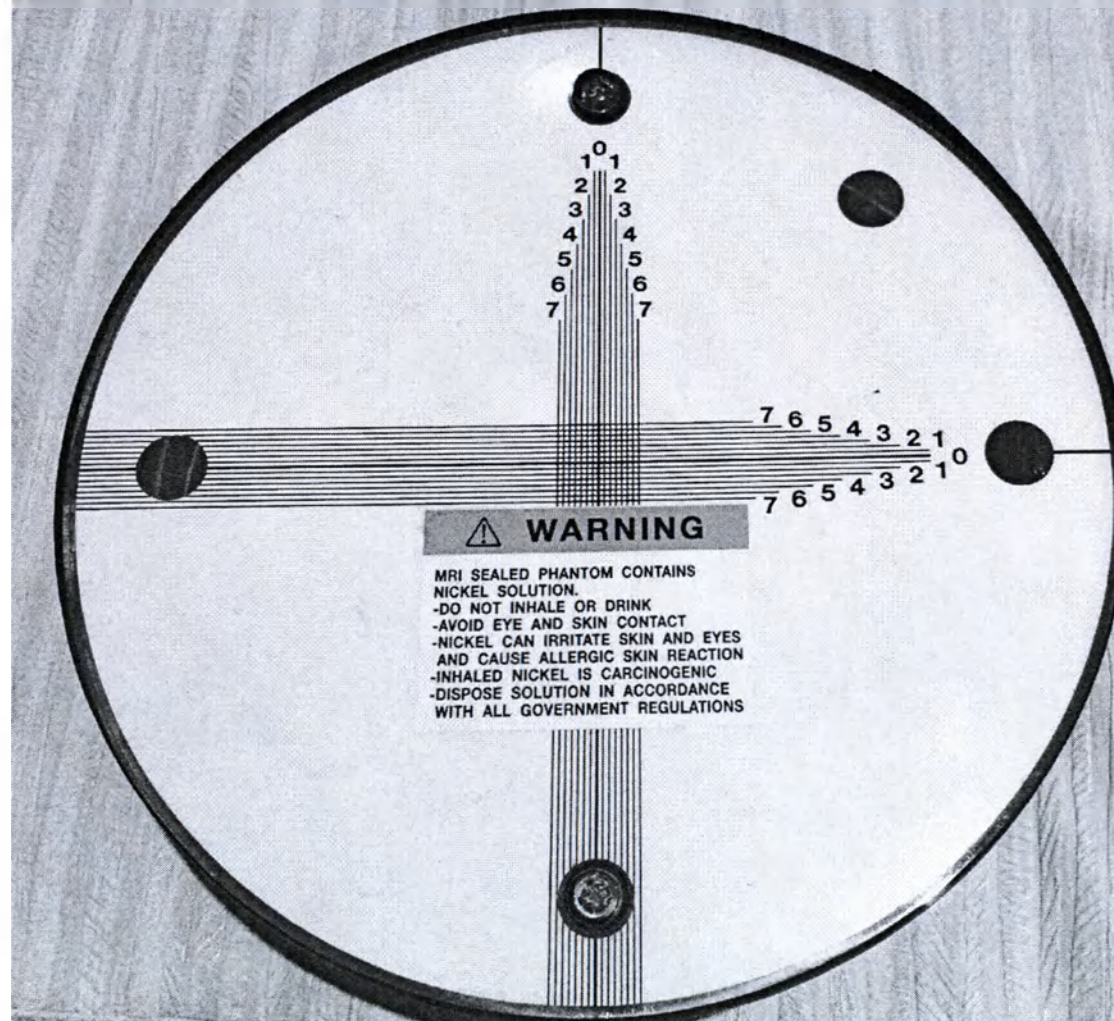


Фантом калибровочный фантом для поля обзора




Матрас пациента




Матрас пациента

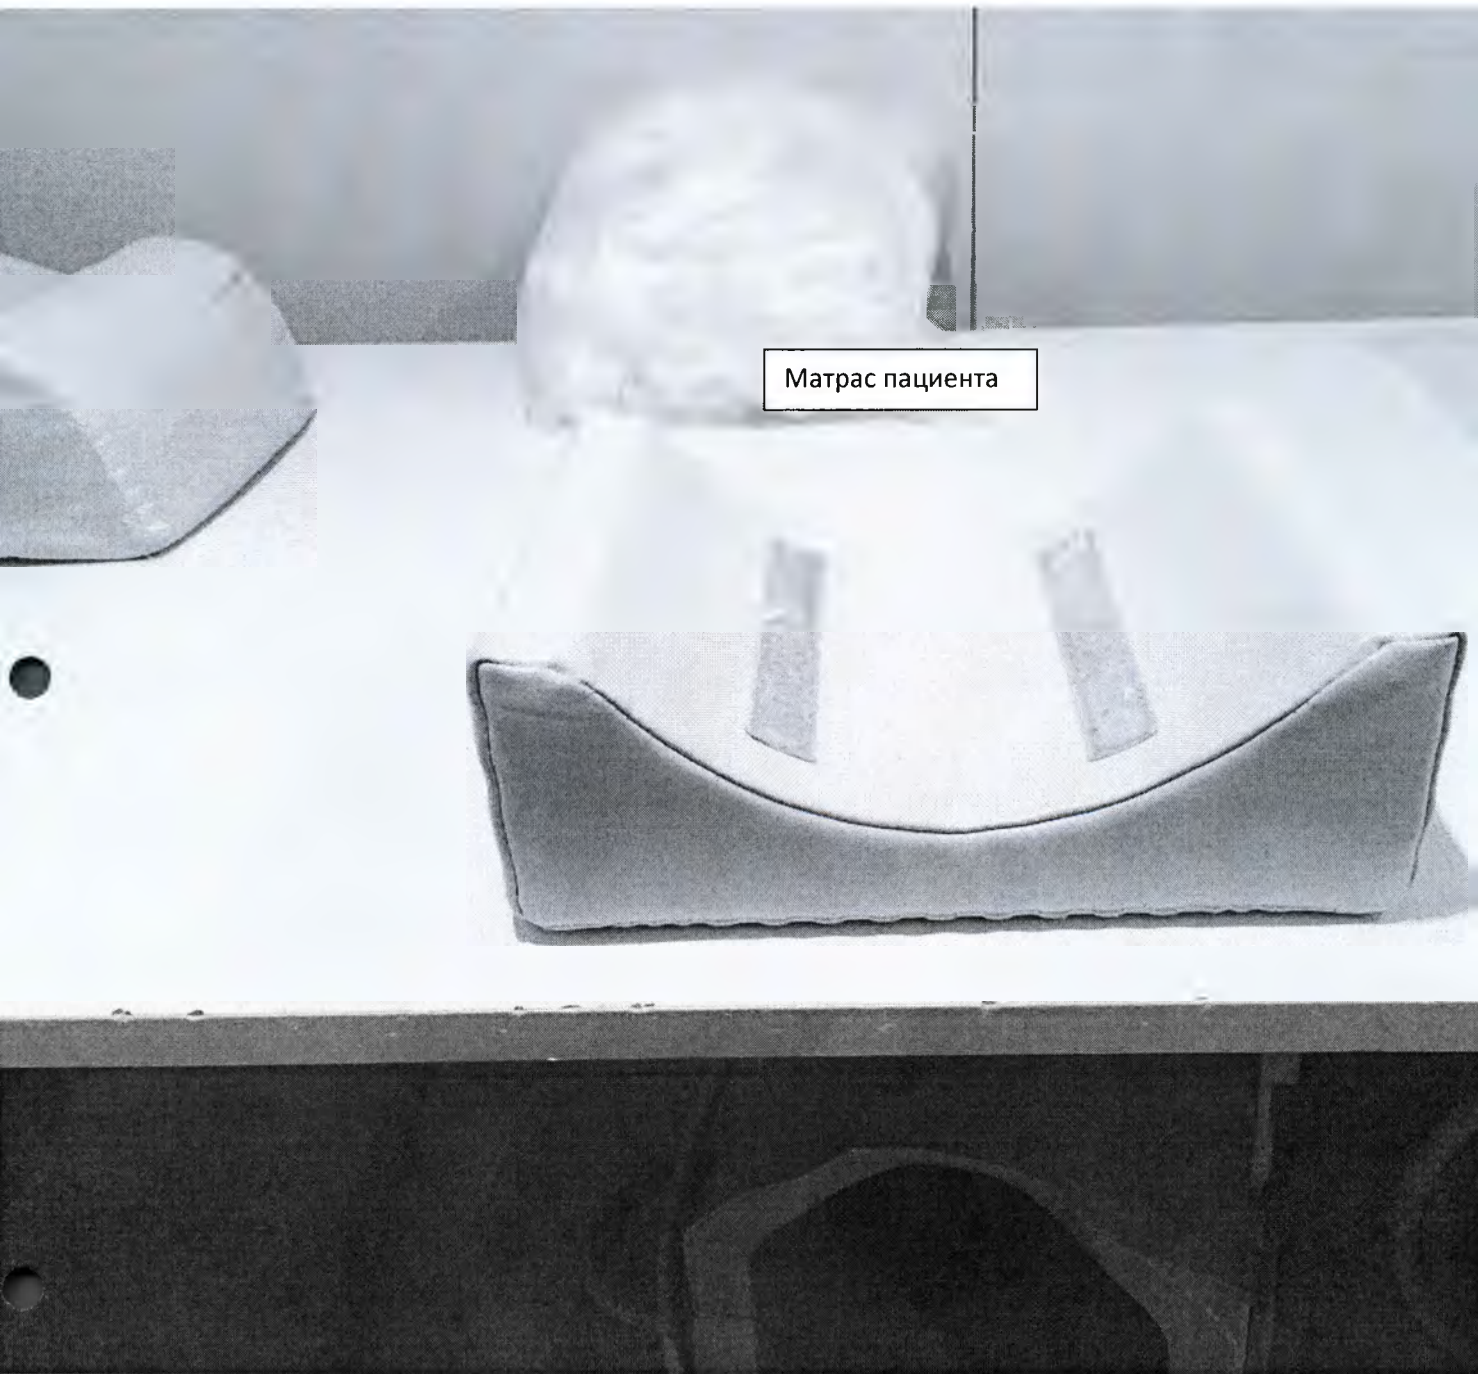


Матрас пациента

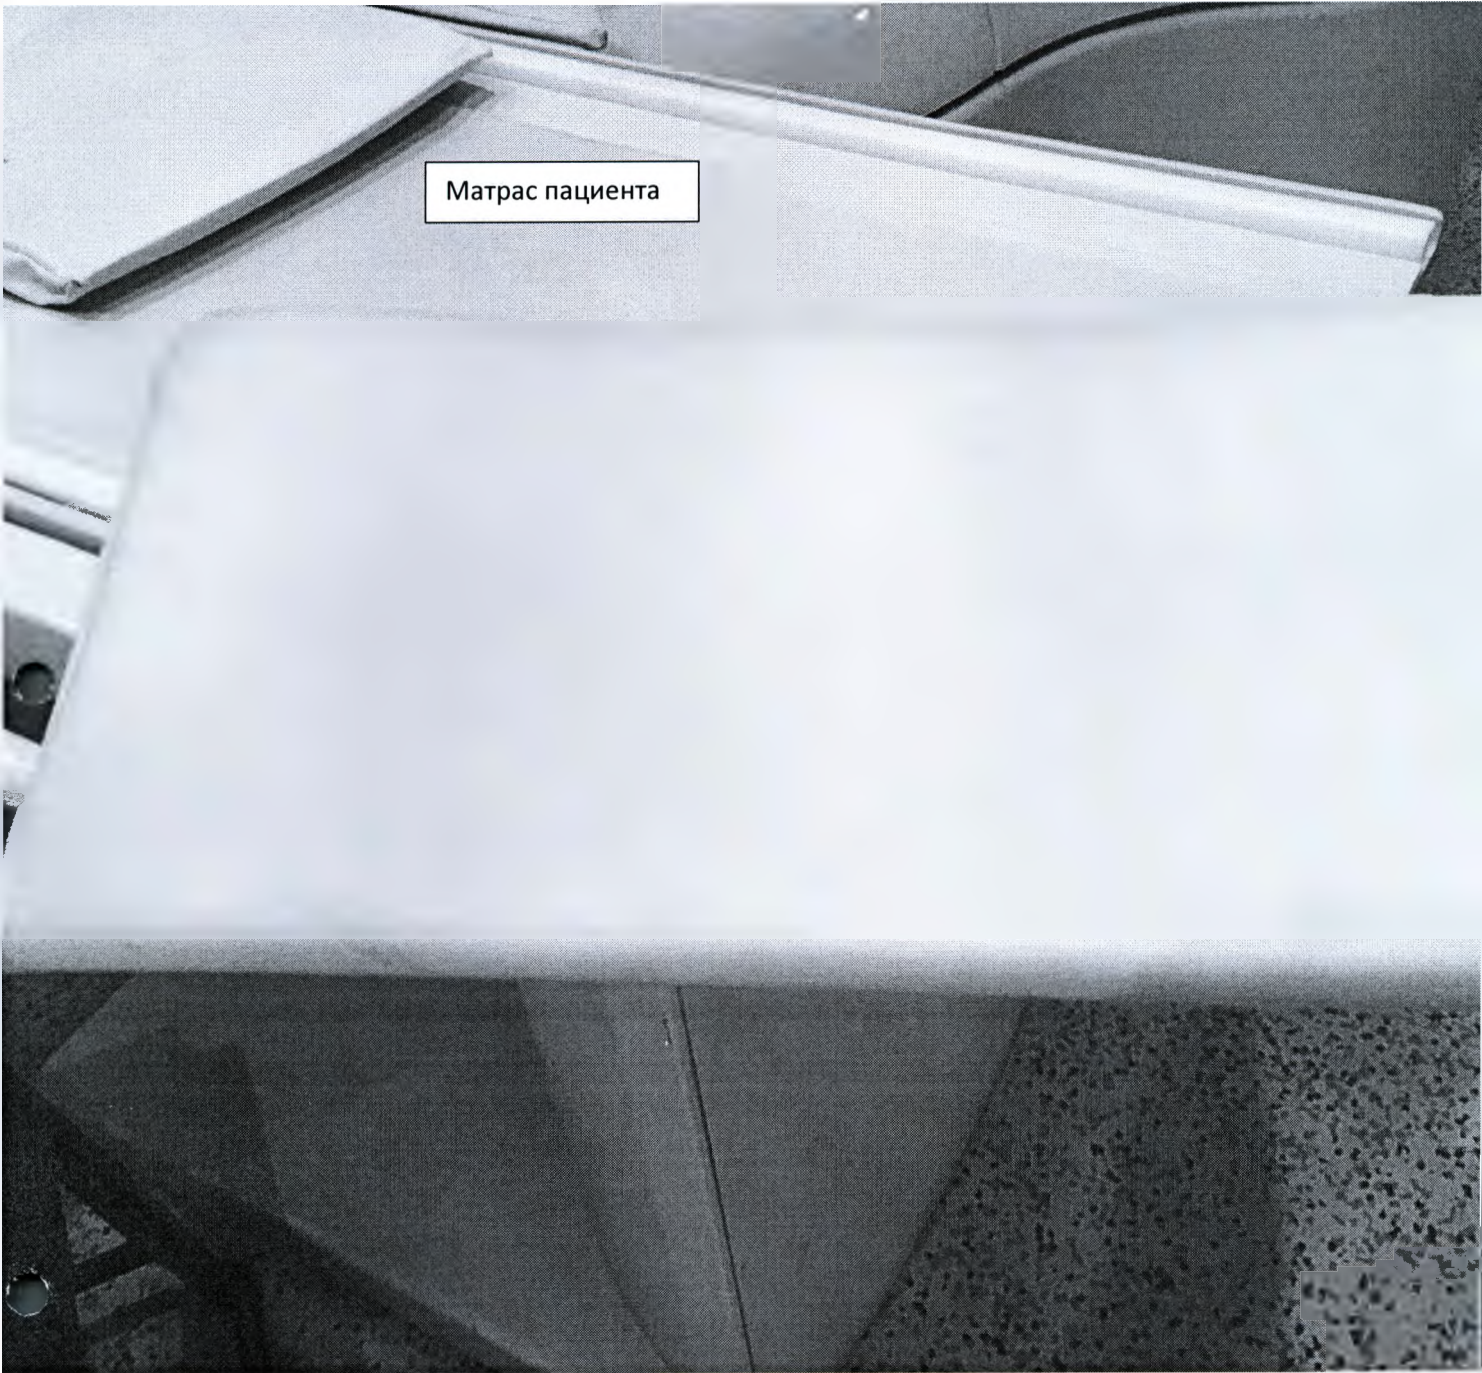


Матрас пациента

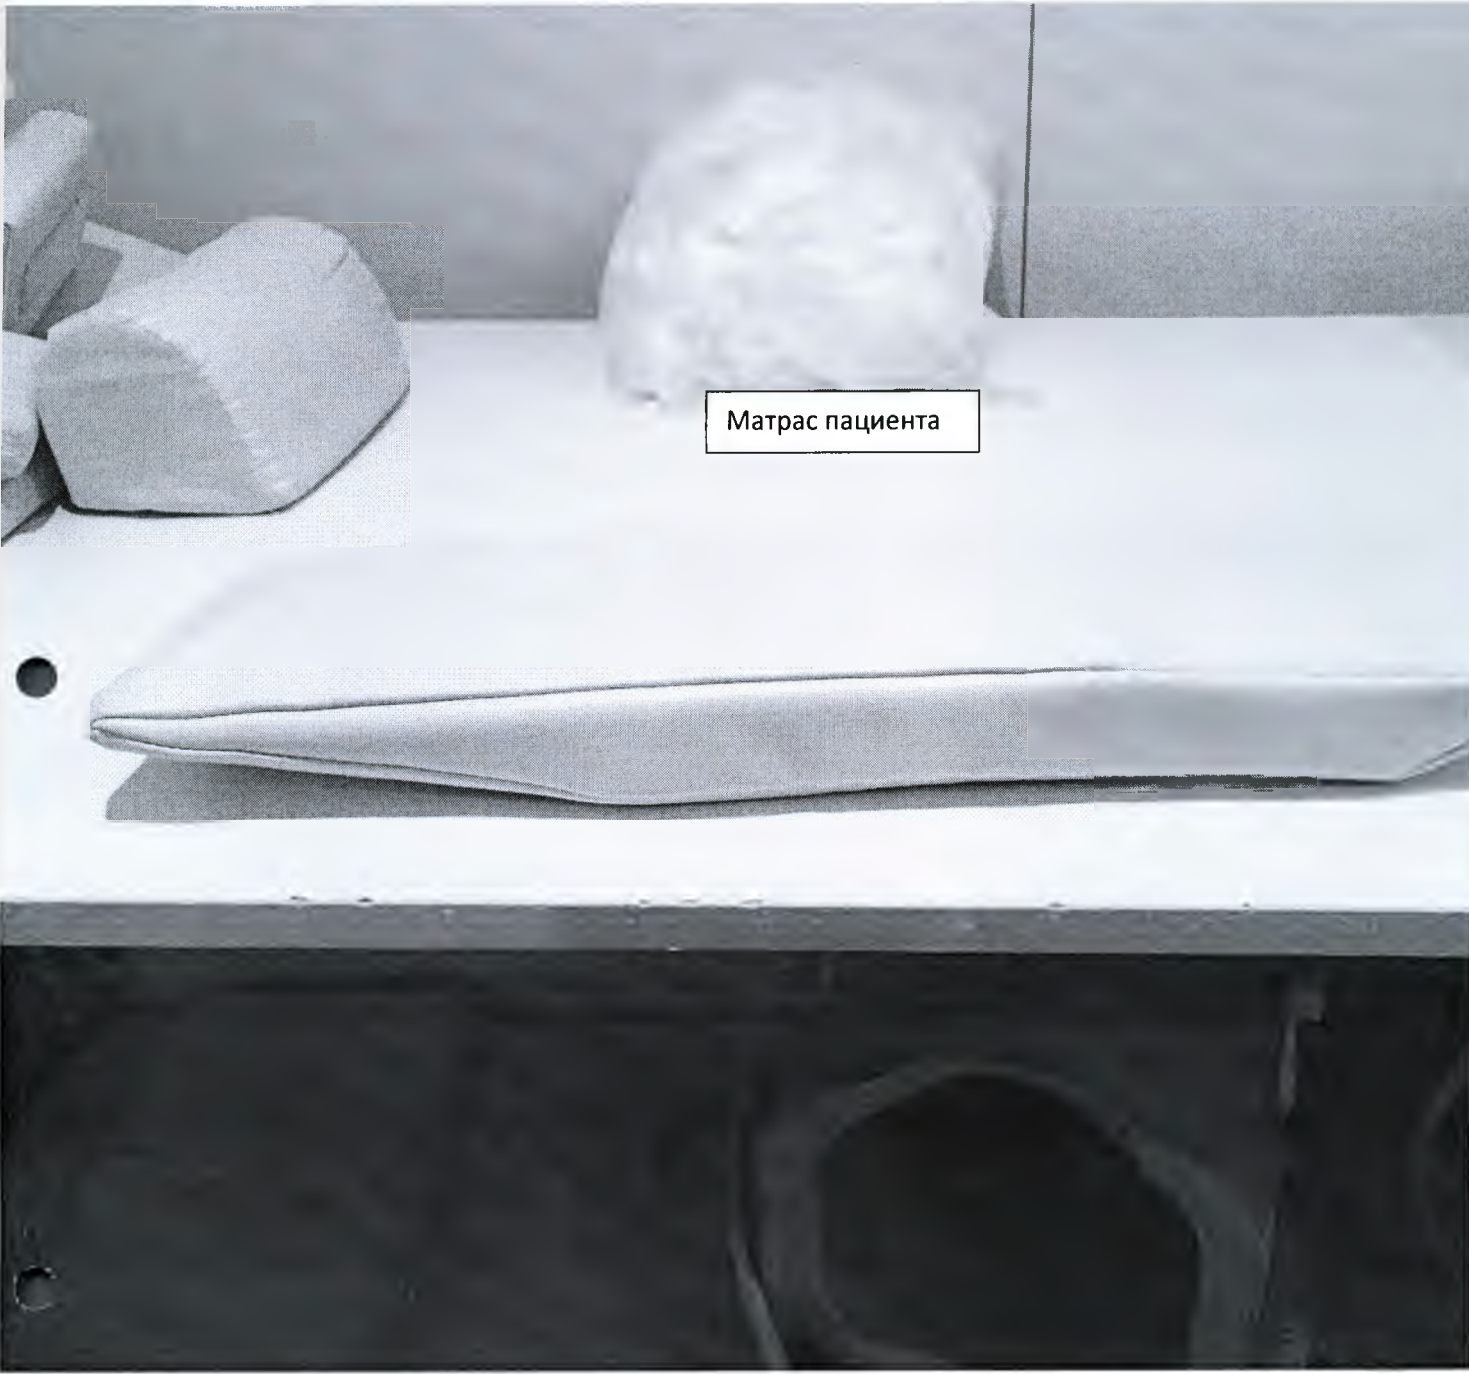

Матрас пациента

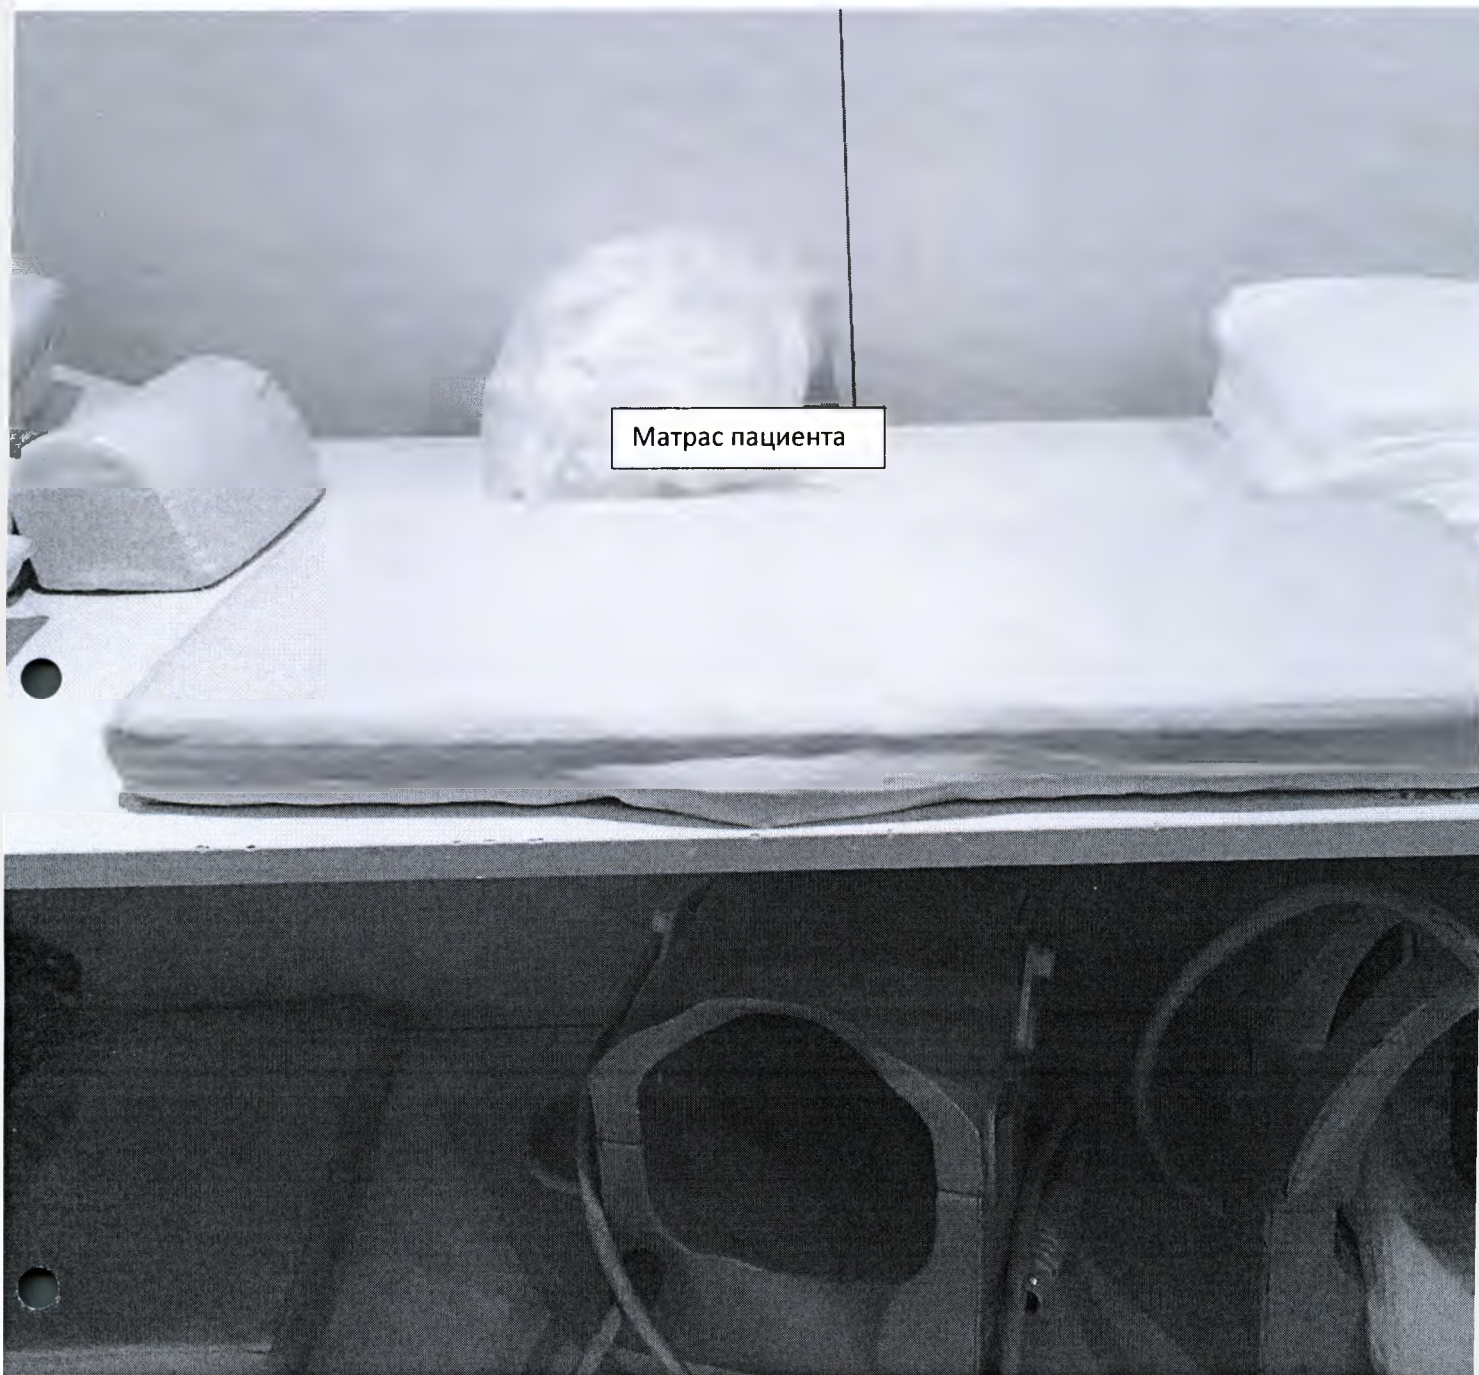

Катушка для головы

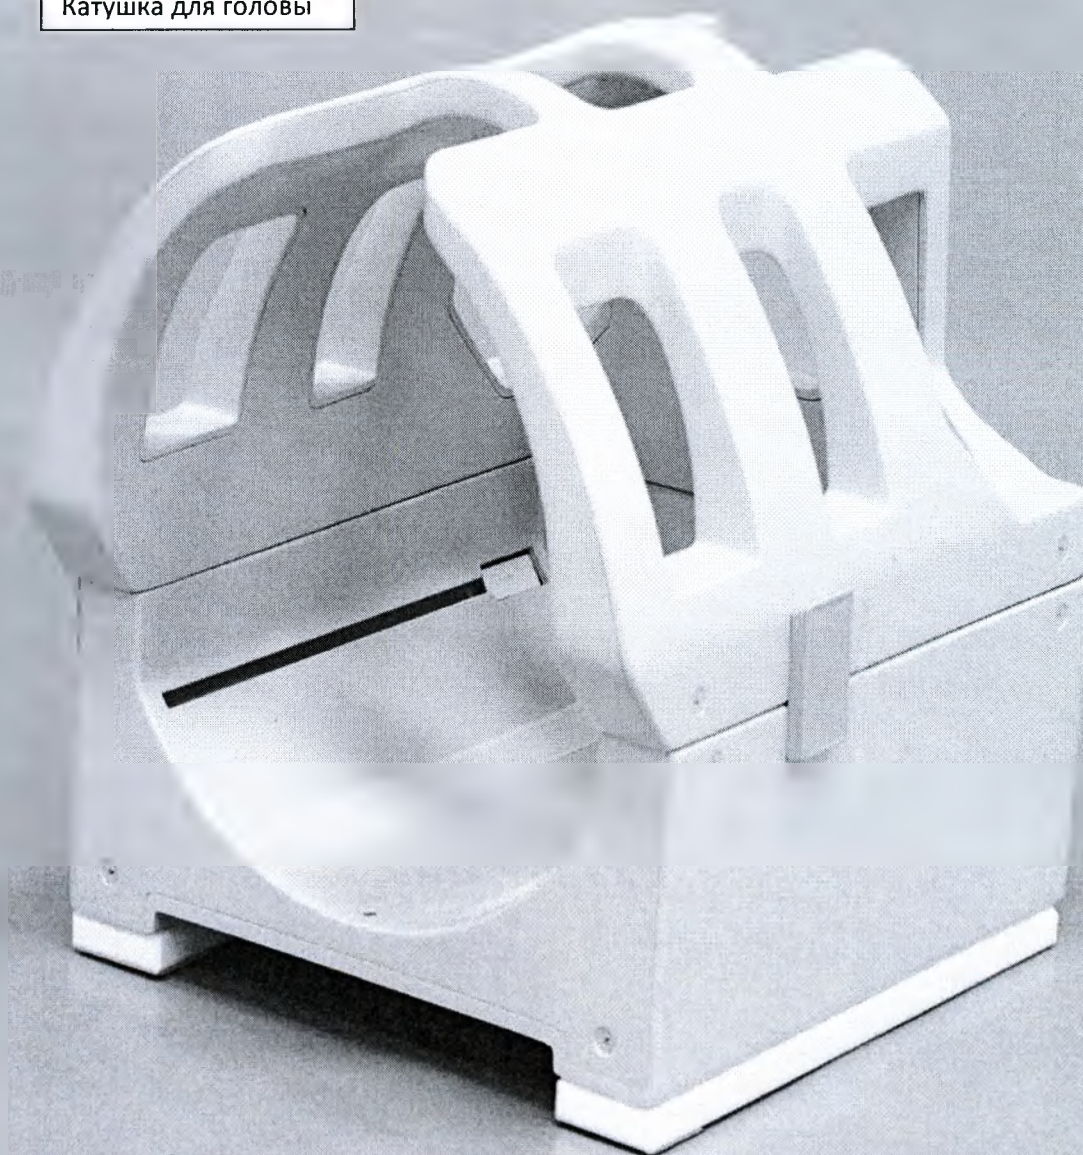


Катушка гибкая для тела и спины большая

Катушка гибкая для тела и спины средняя


Катушка гибкая для тела и спины малая




Катушка кольцеобразная для суставов и
шеи, средняя

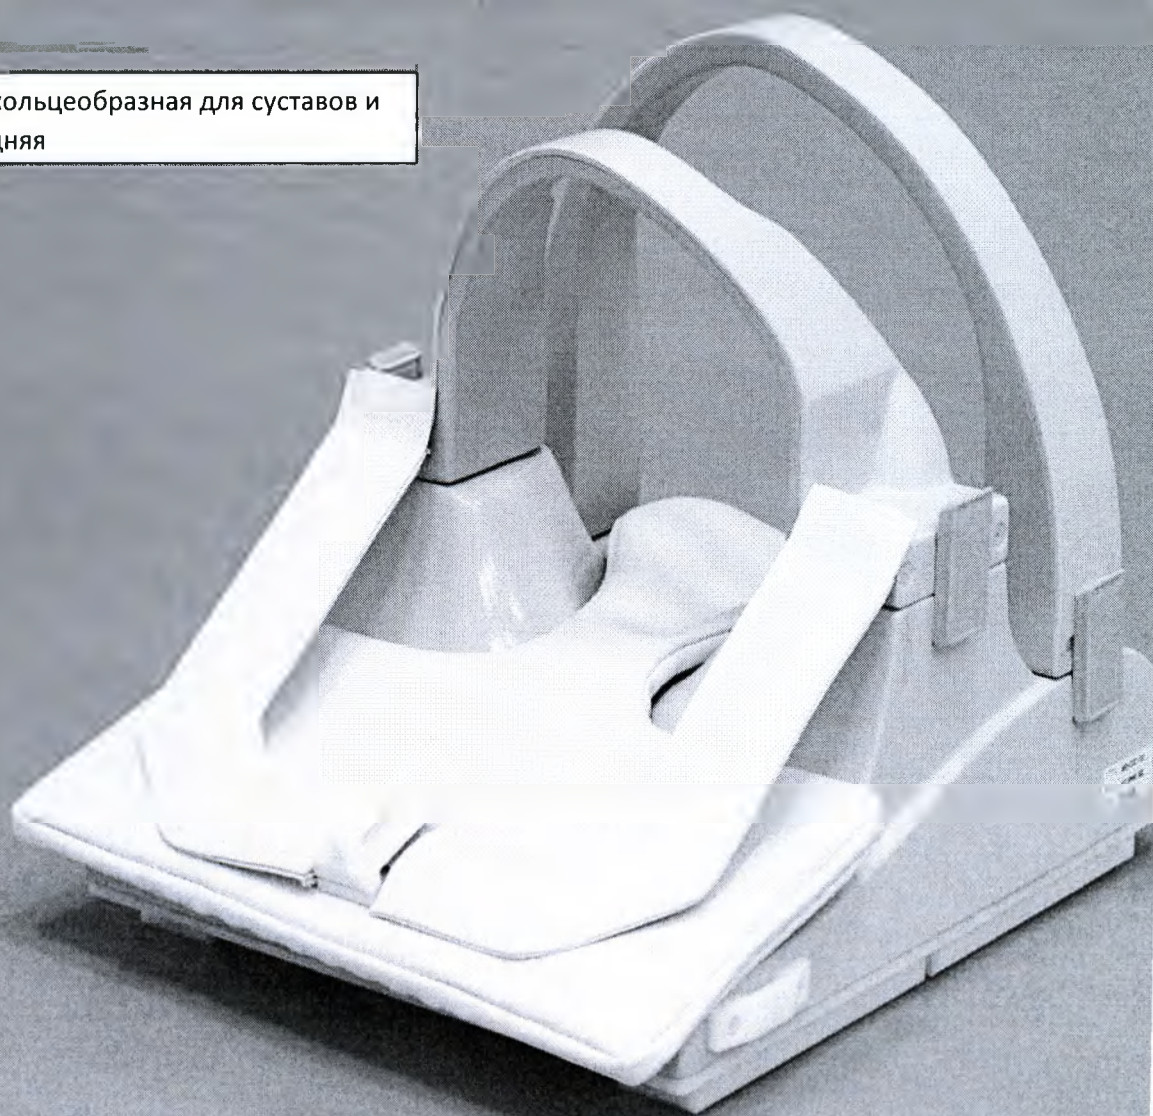

Катушка для колена

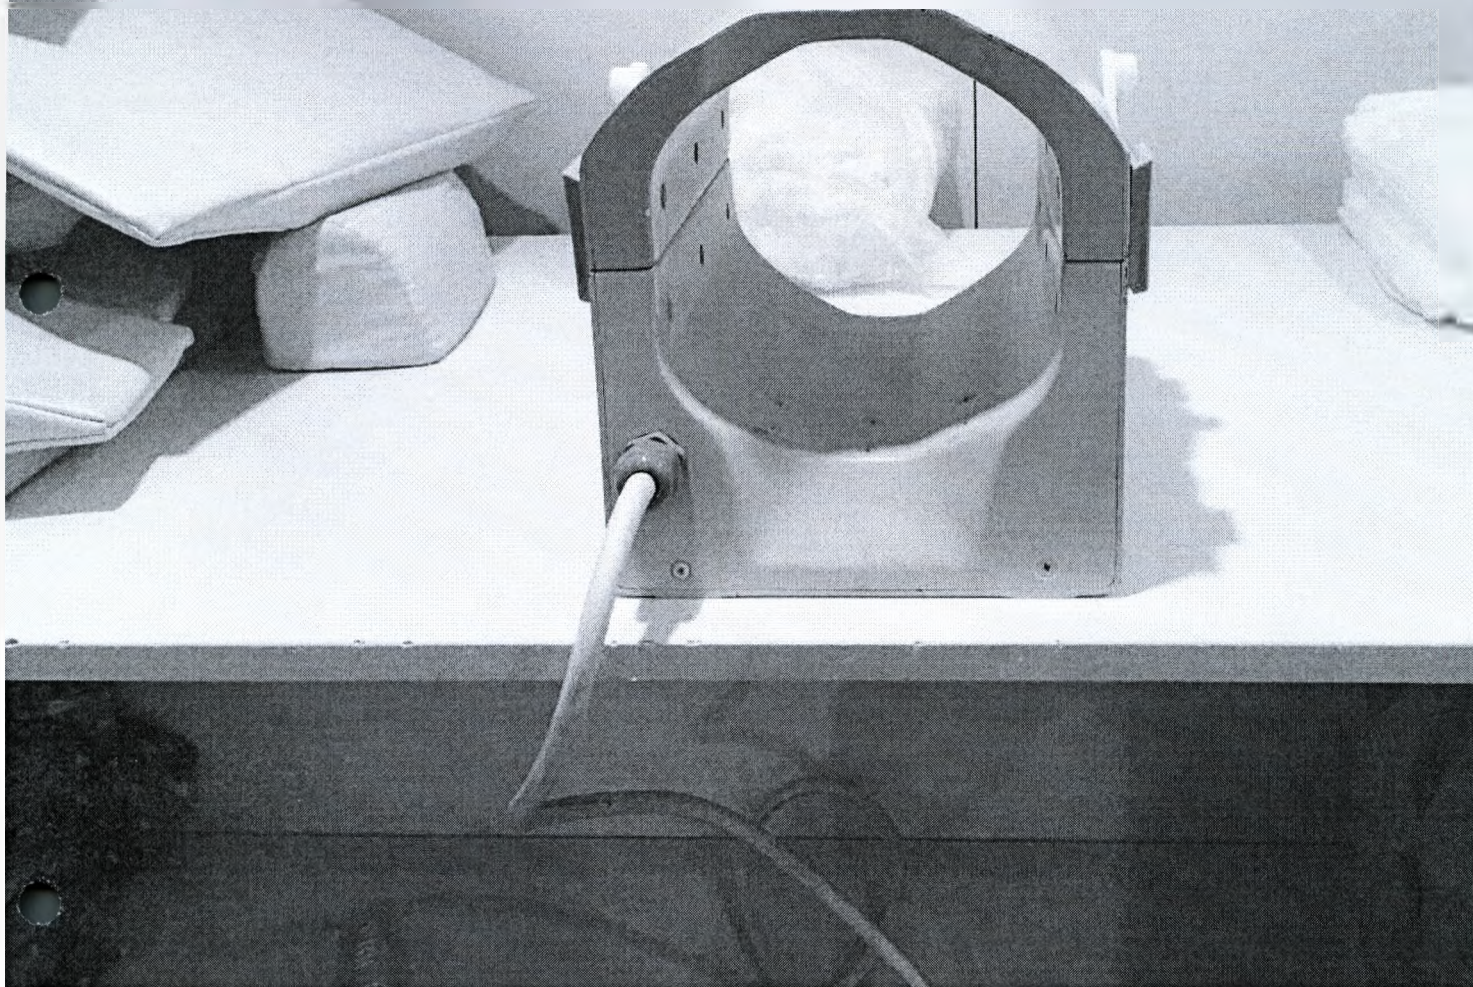

Катушка для колена

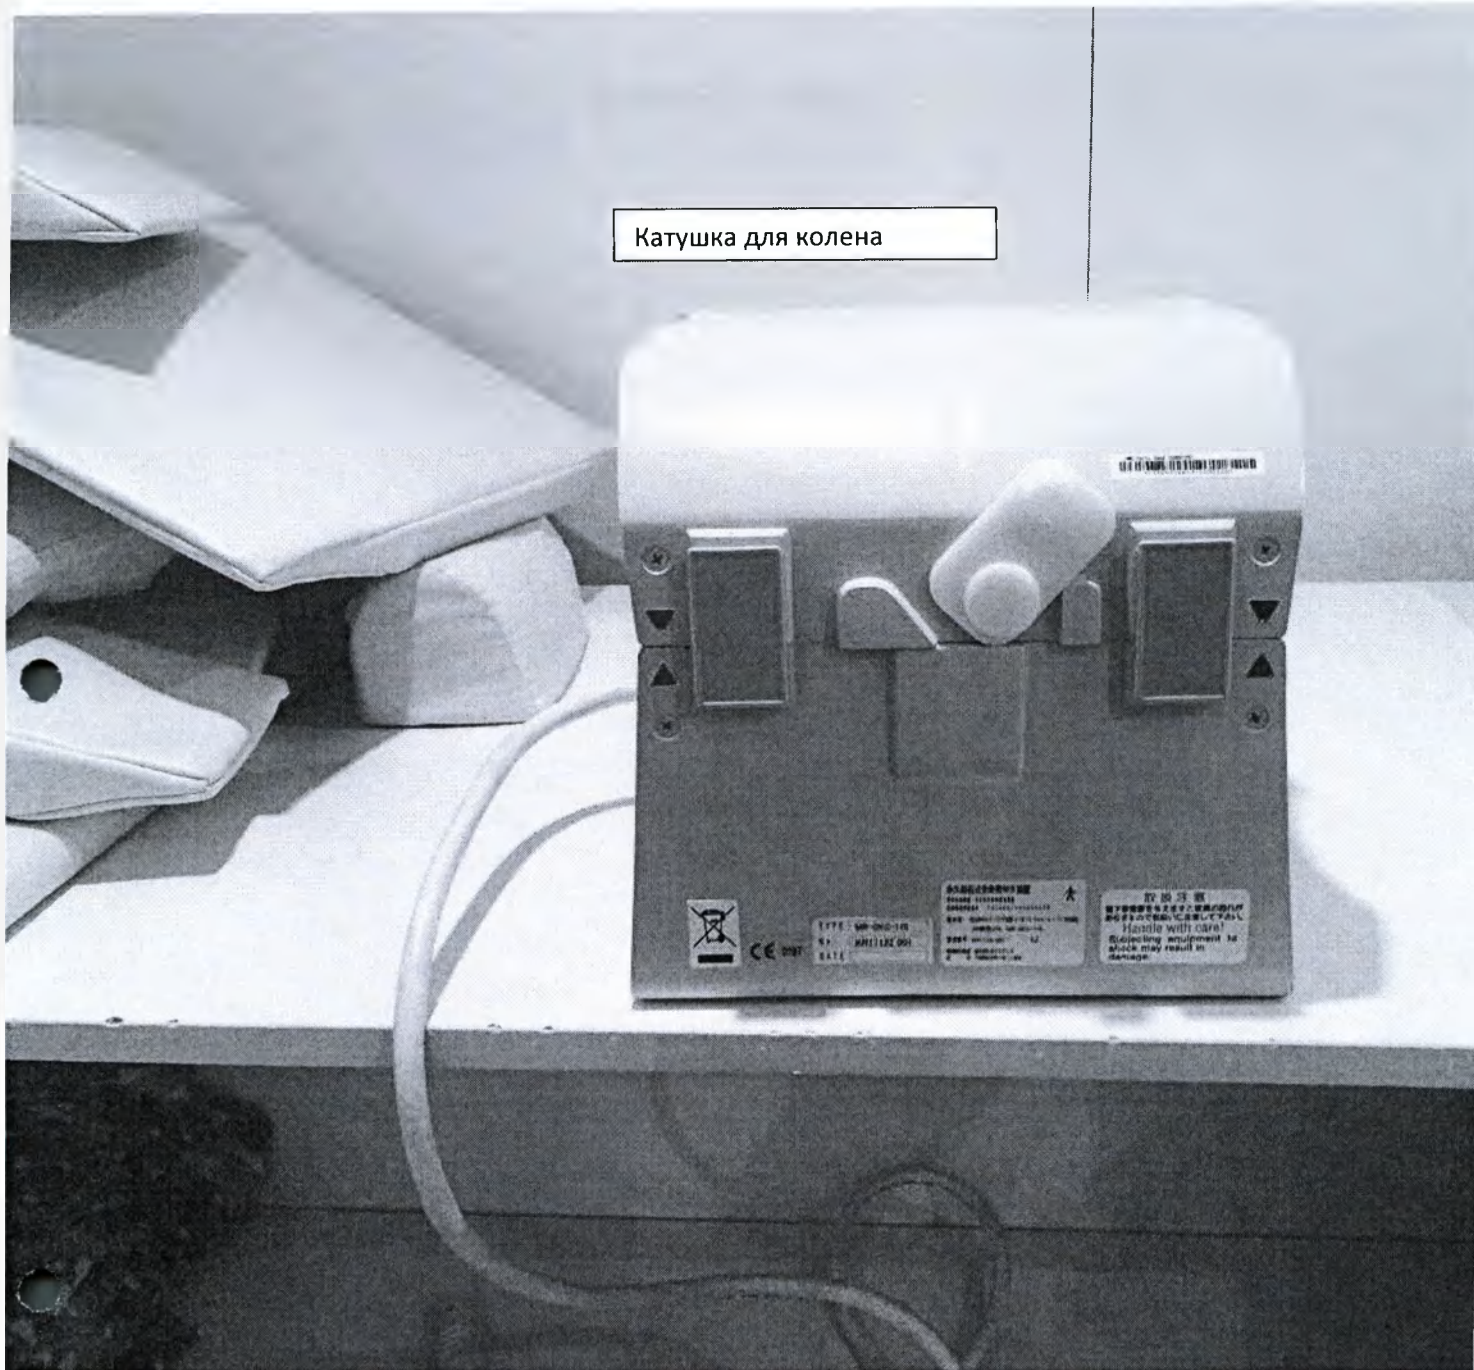


Катушка для суставов, большая

Катушка для суставов, средняя


Катушка для суставов,
малая




гушка для суставов средняя

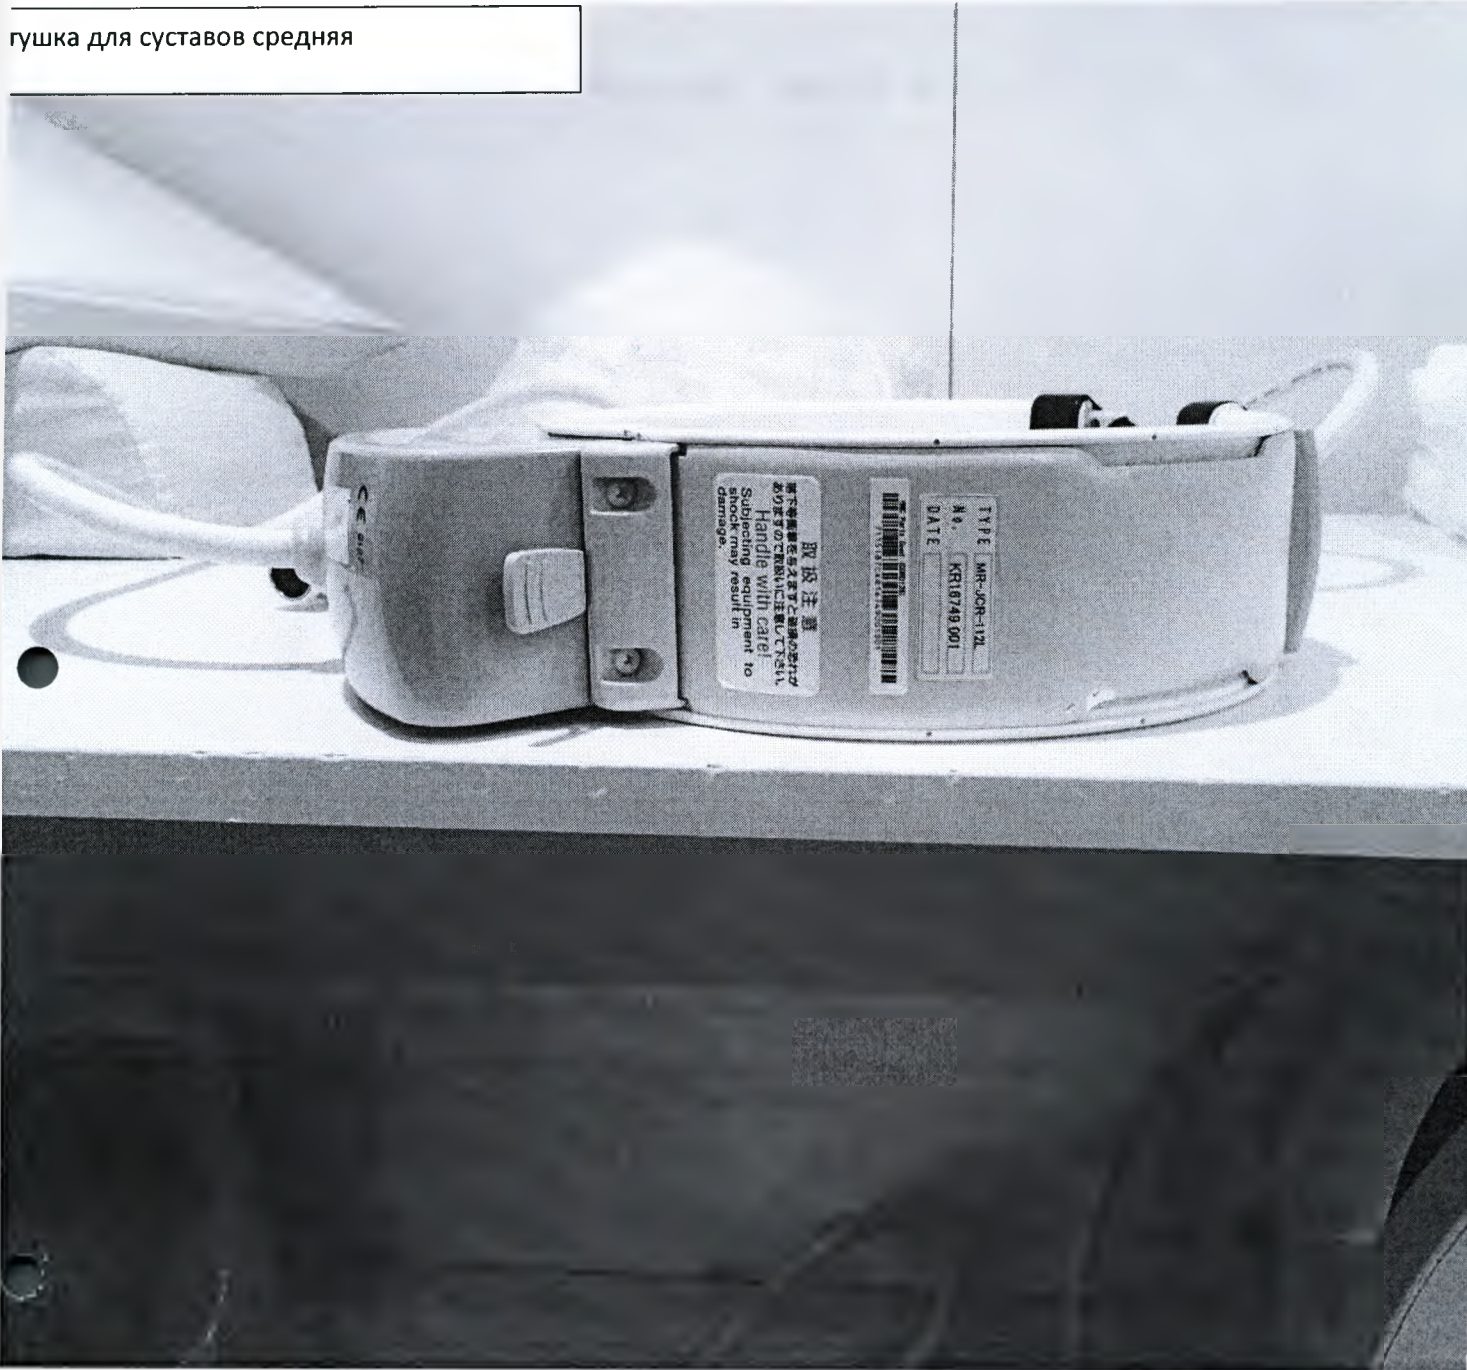


гушка для суставов средняя

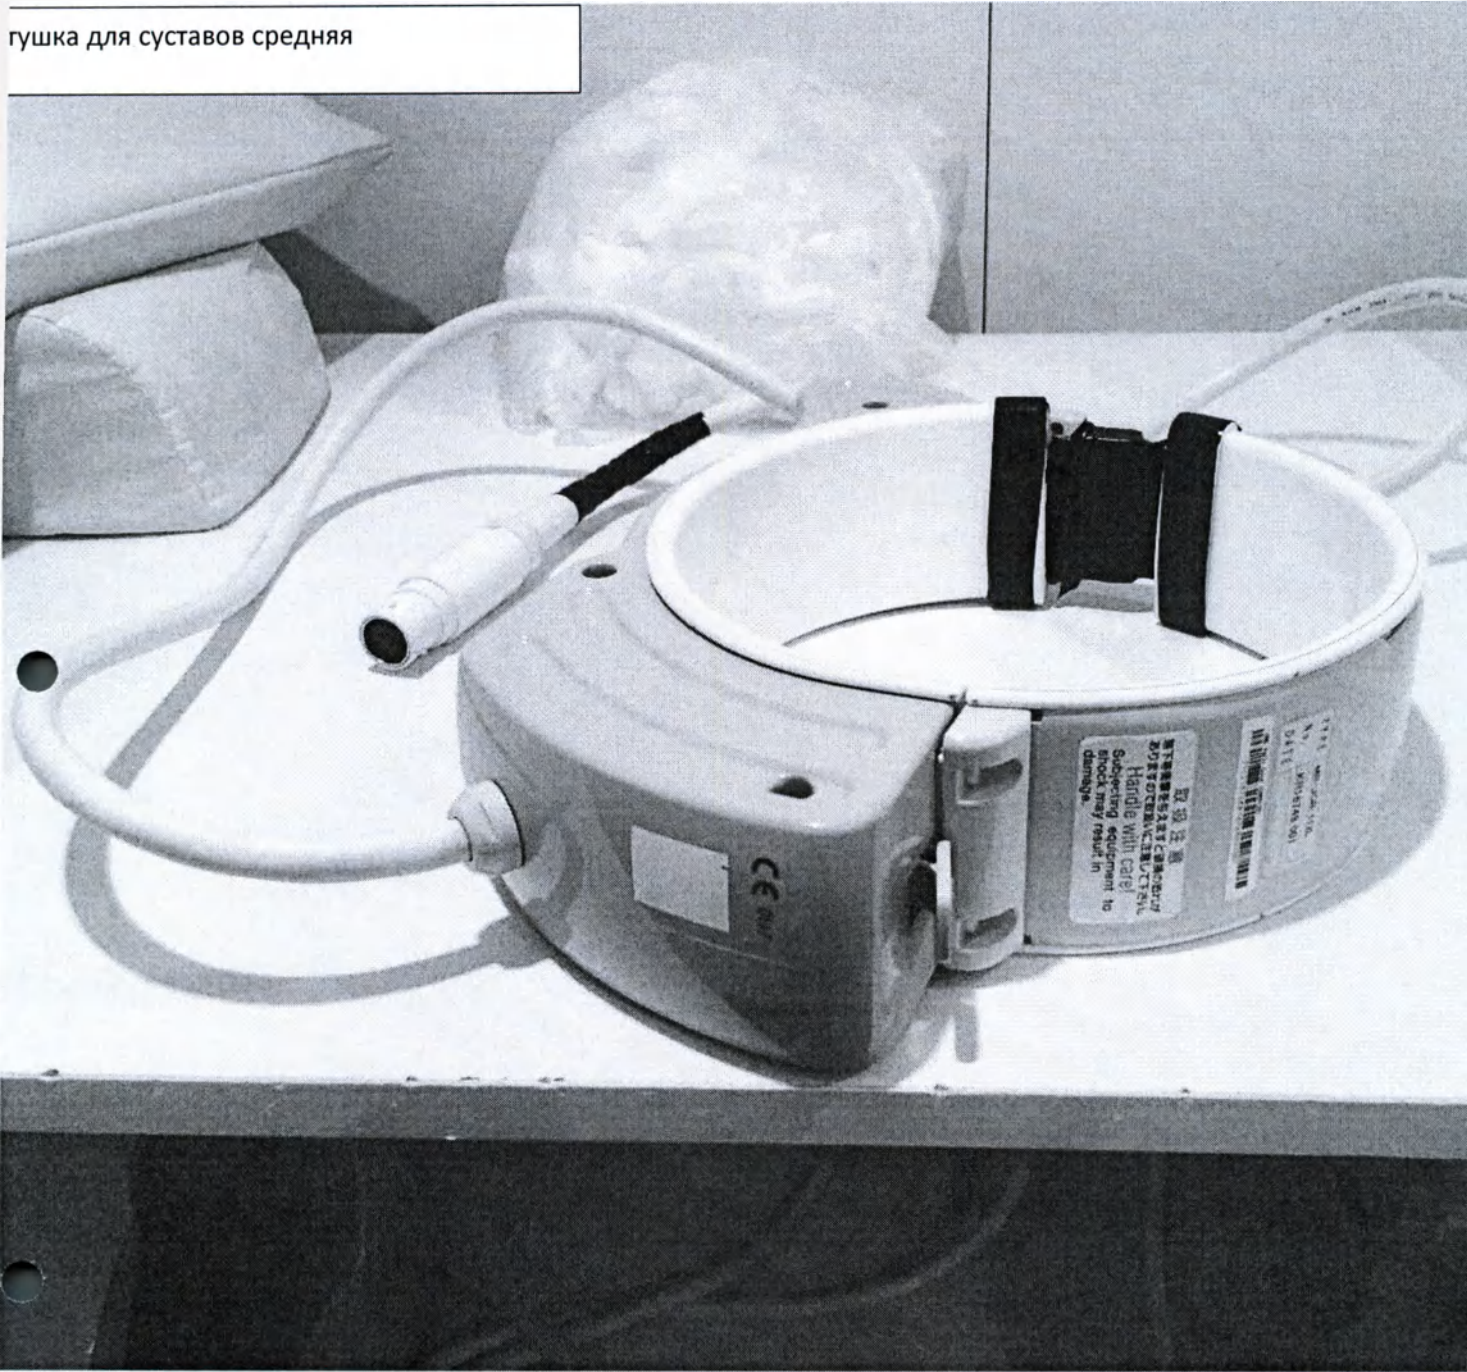

Катушка для кисти

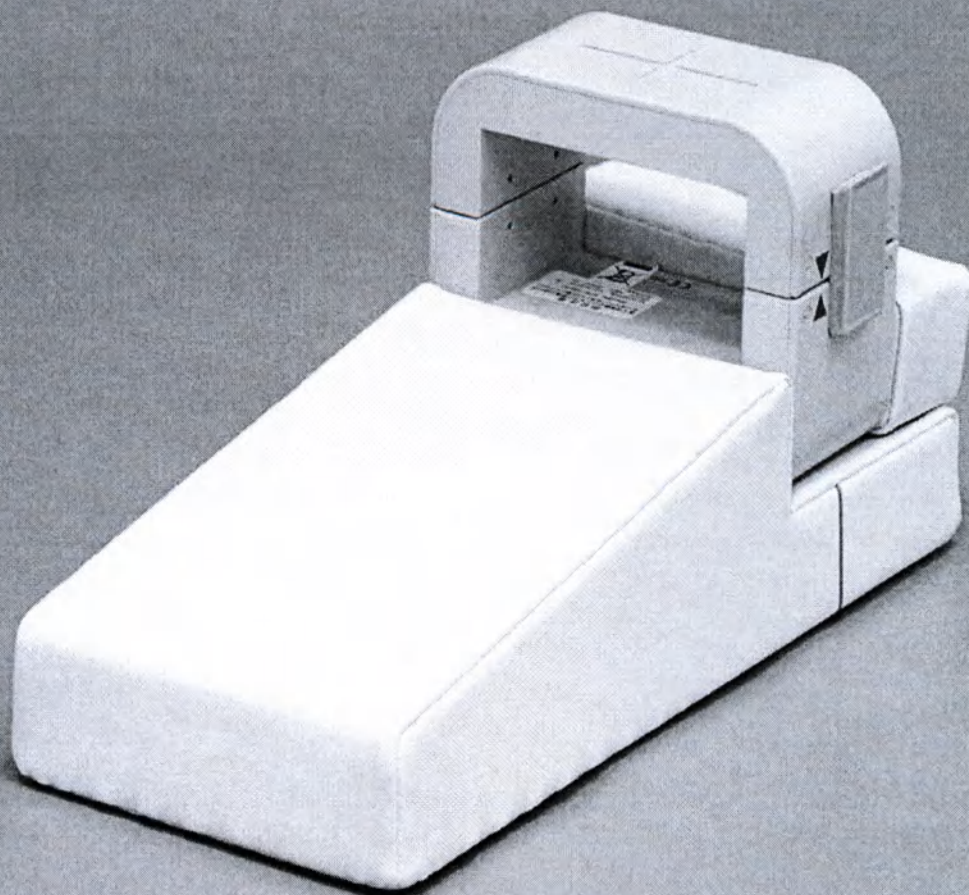


Катушка височно-нижнечелюстная

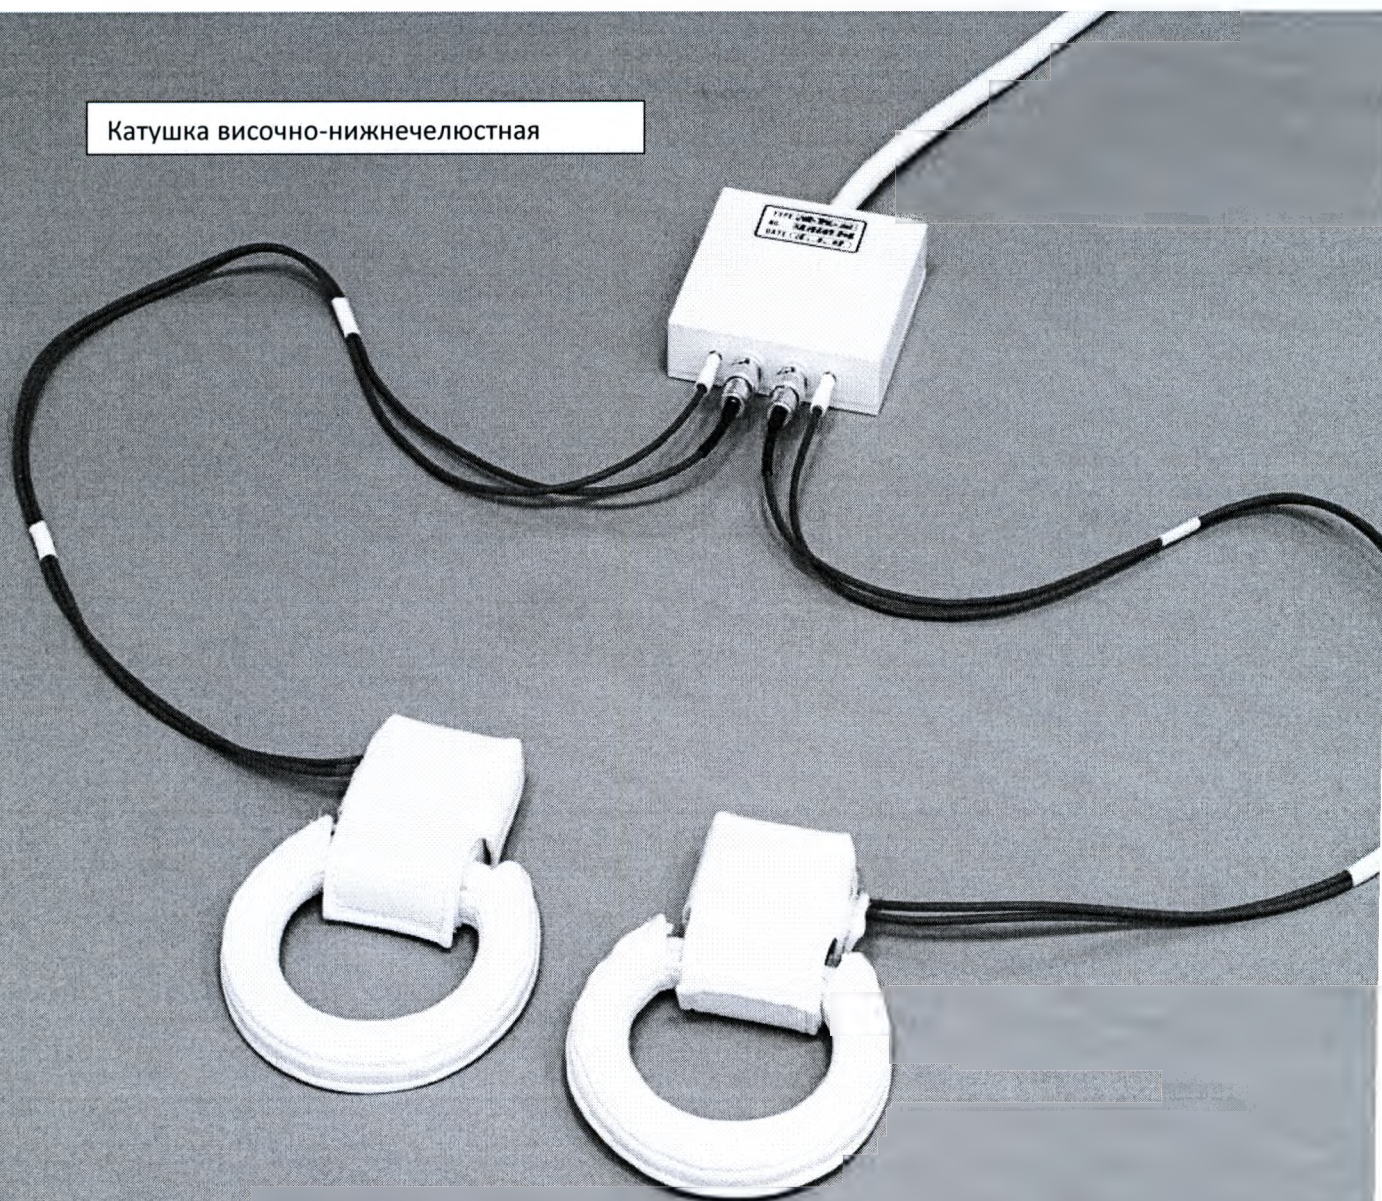

Катушка маммографическая



Катушка многоканальная для головы

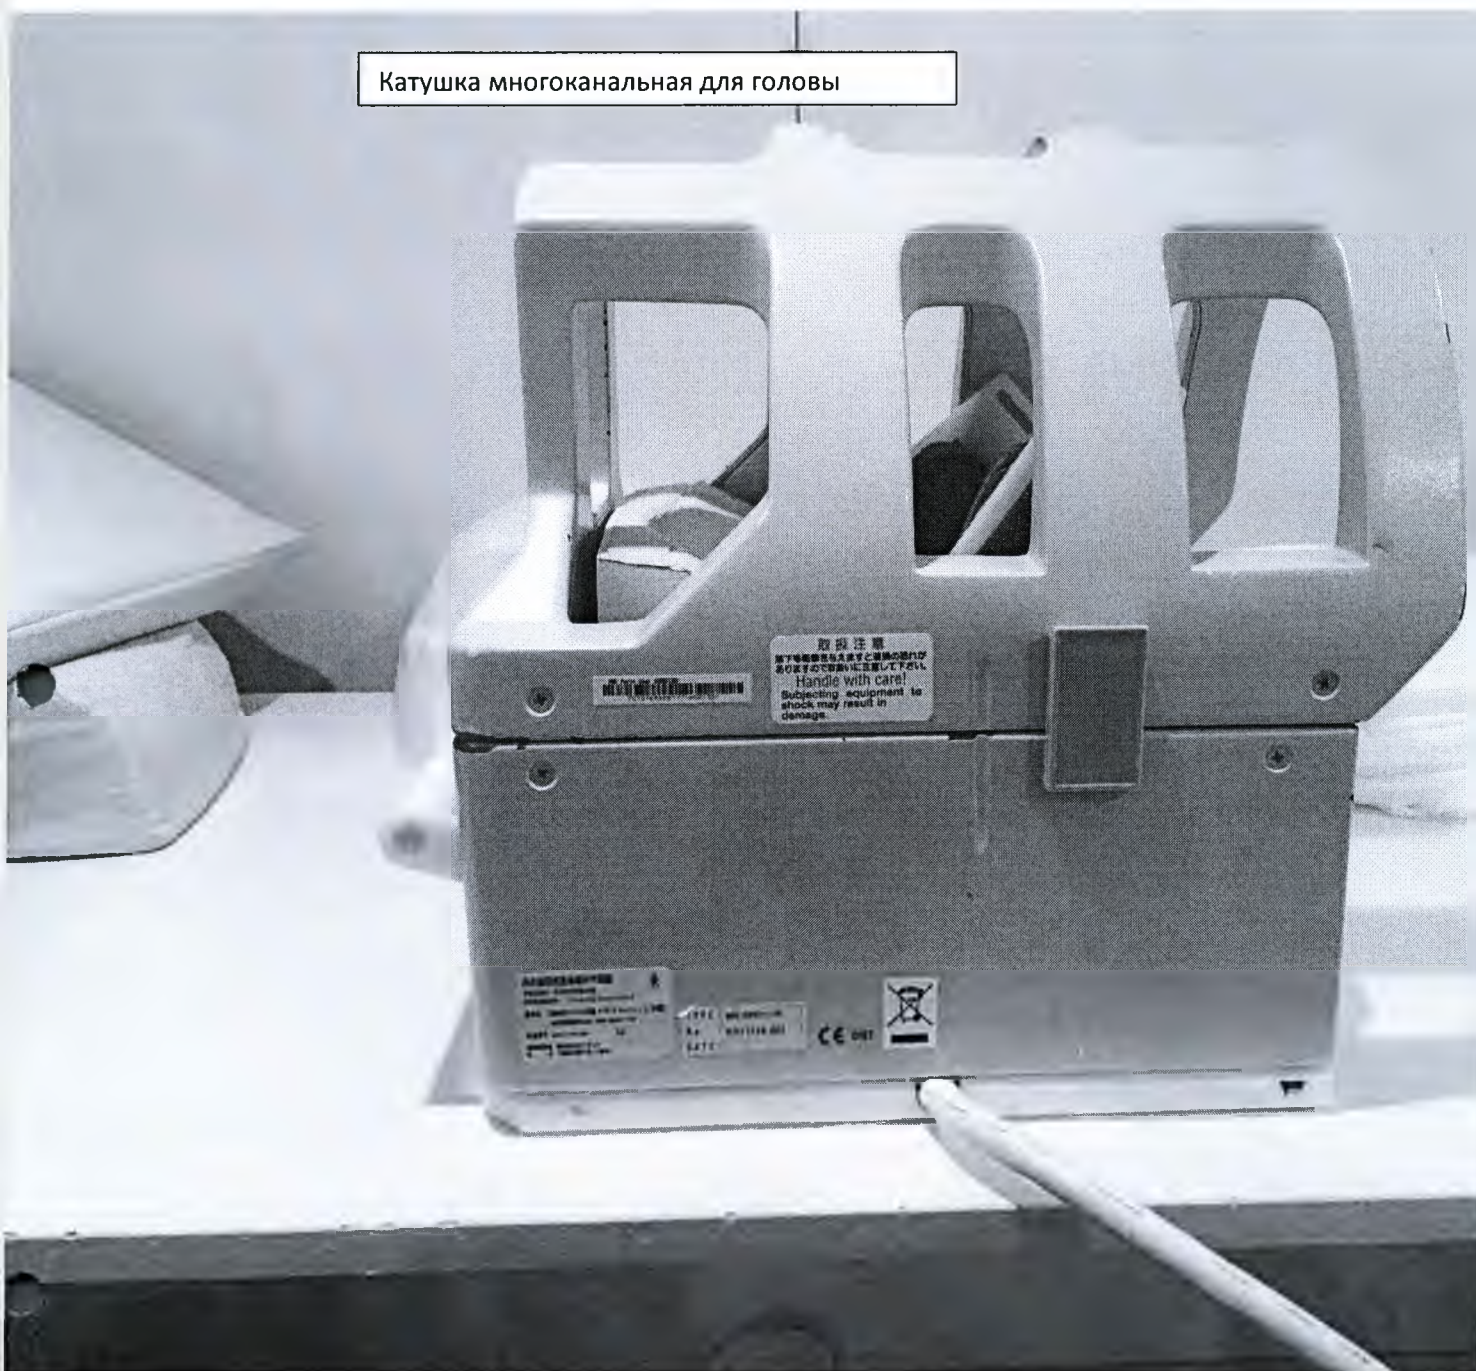


Катушка многоканальная для головы



Катушка многоканальная для плеча



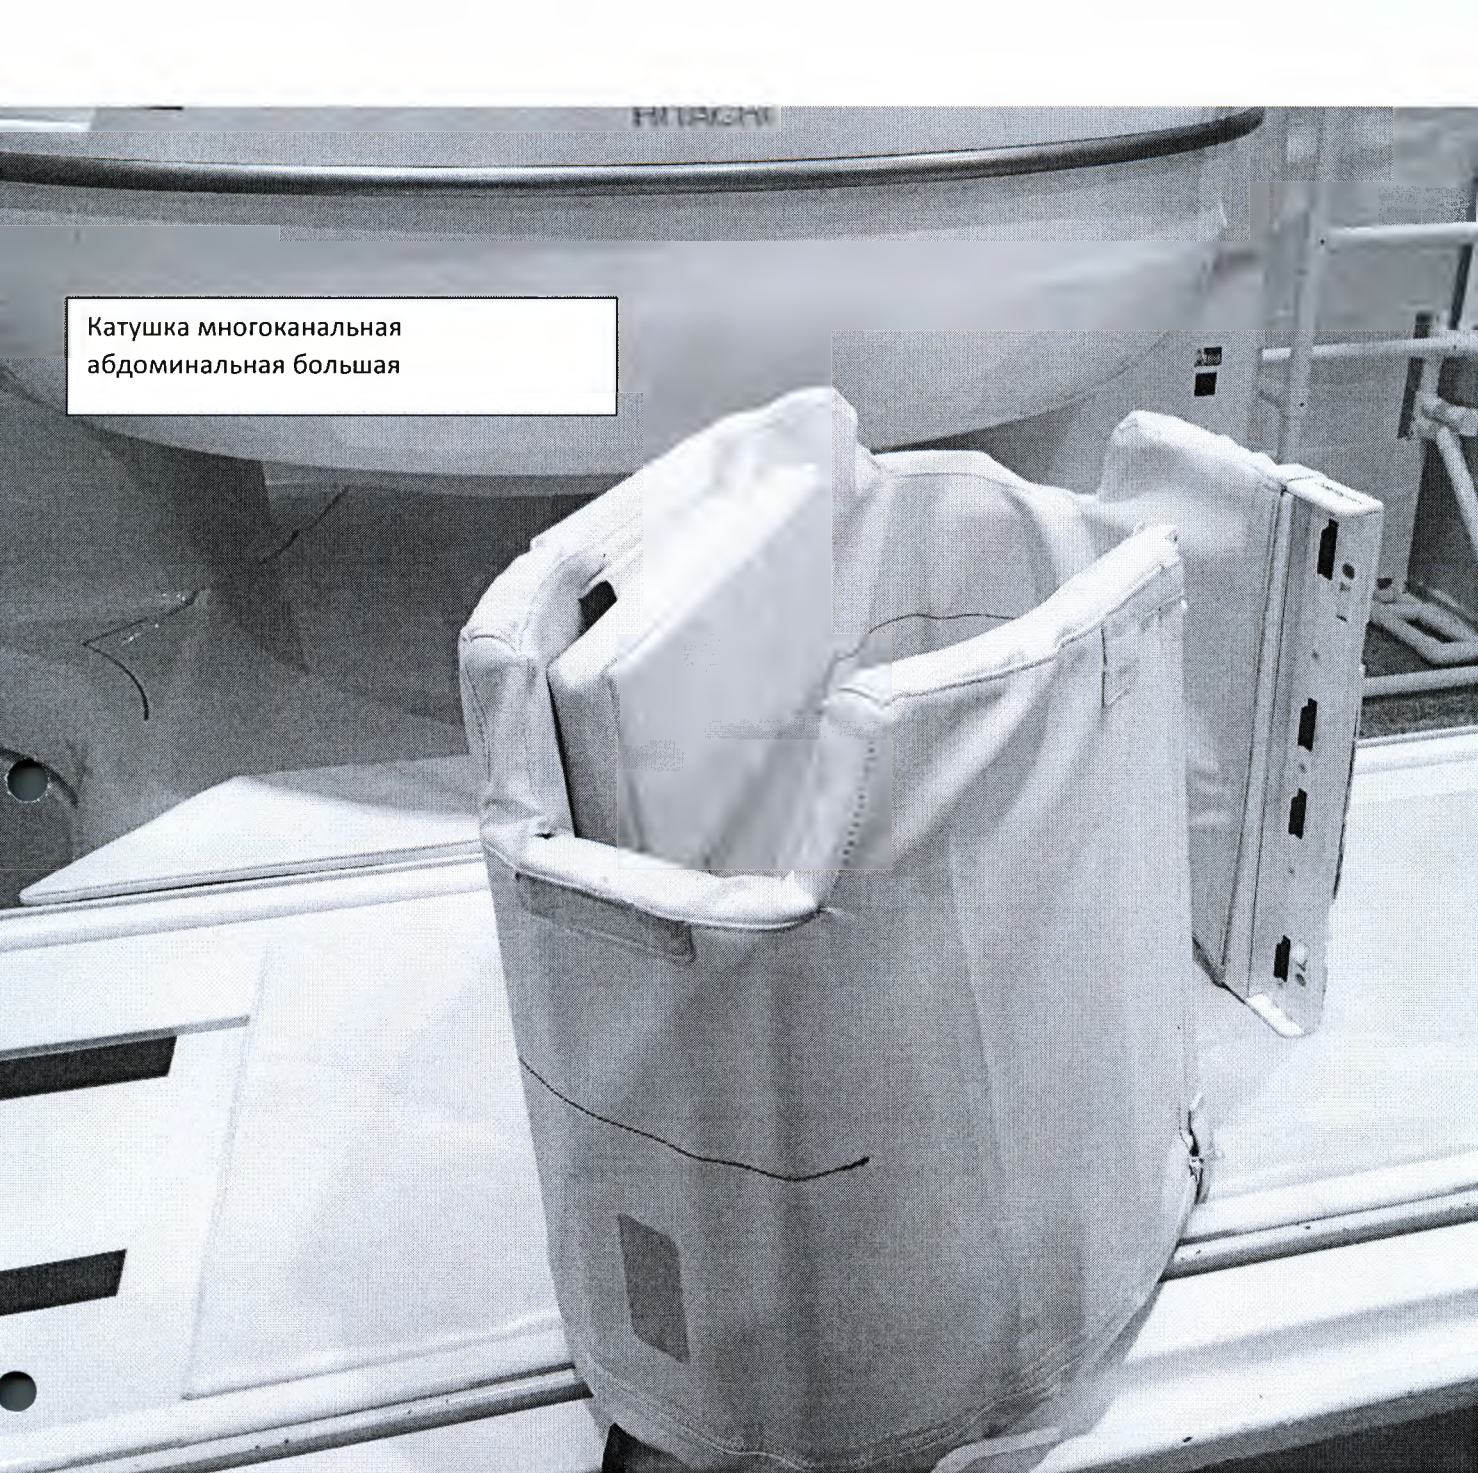


Катушка многоканальная
абдоминальная большая

Катушка многоканальная абдоминальная
средняя




Катушка для головы и шеи

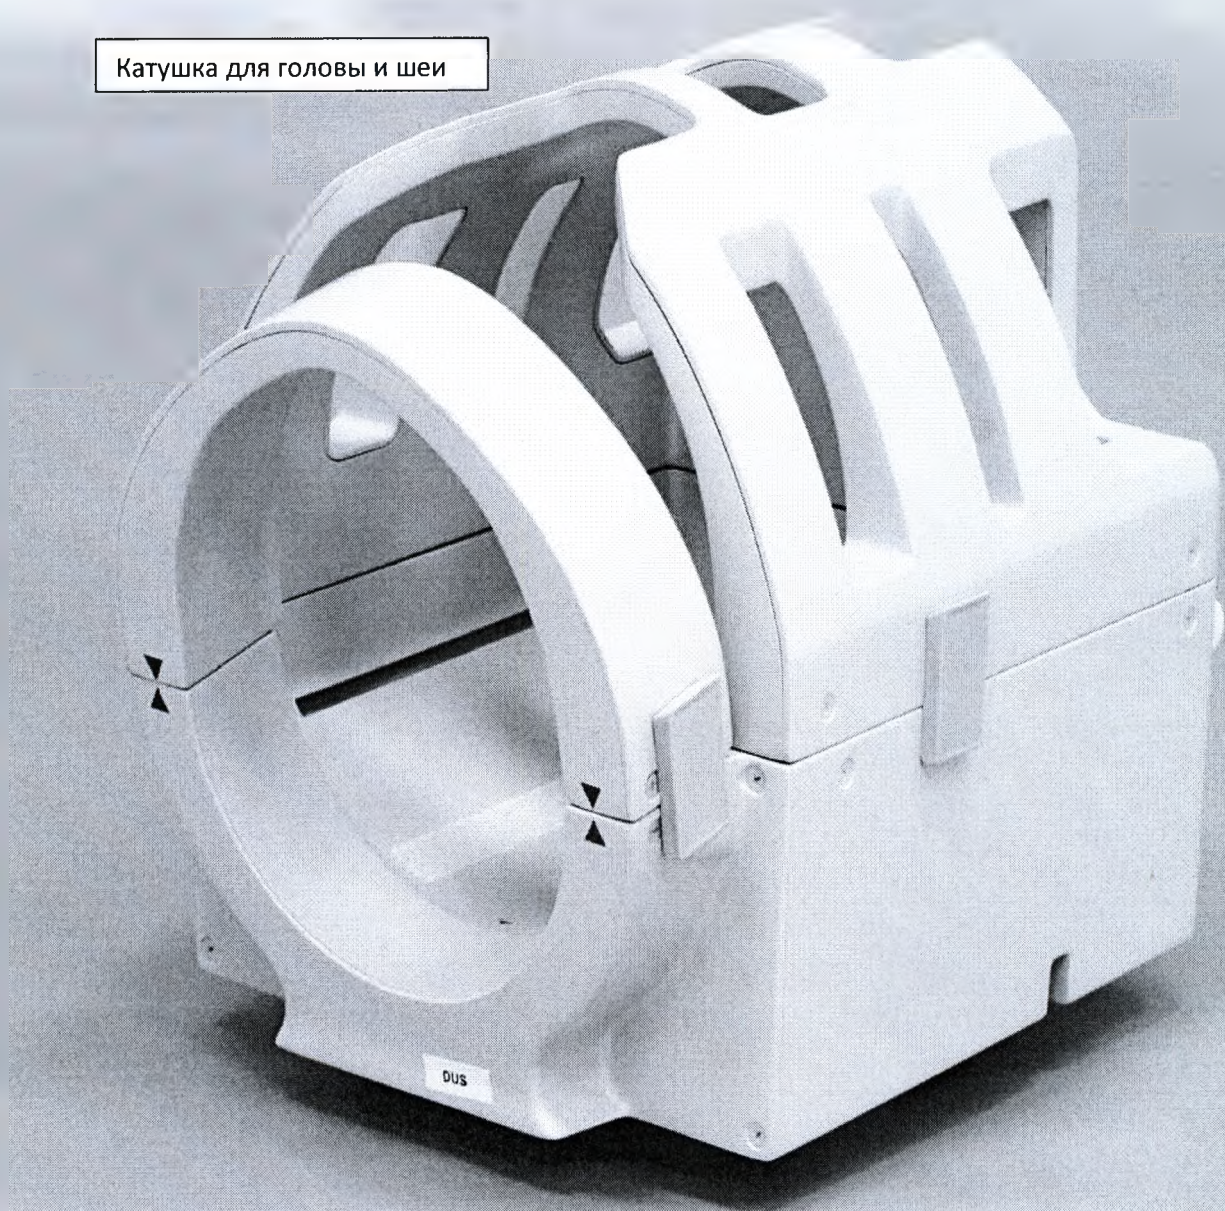

Набор для активной
компенсации флуктуации
внешнего магнитного поля




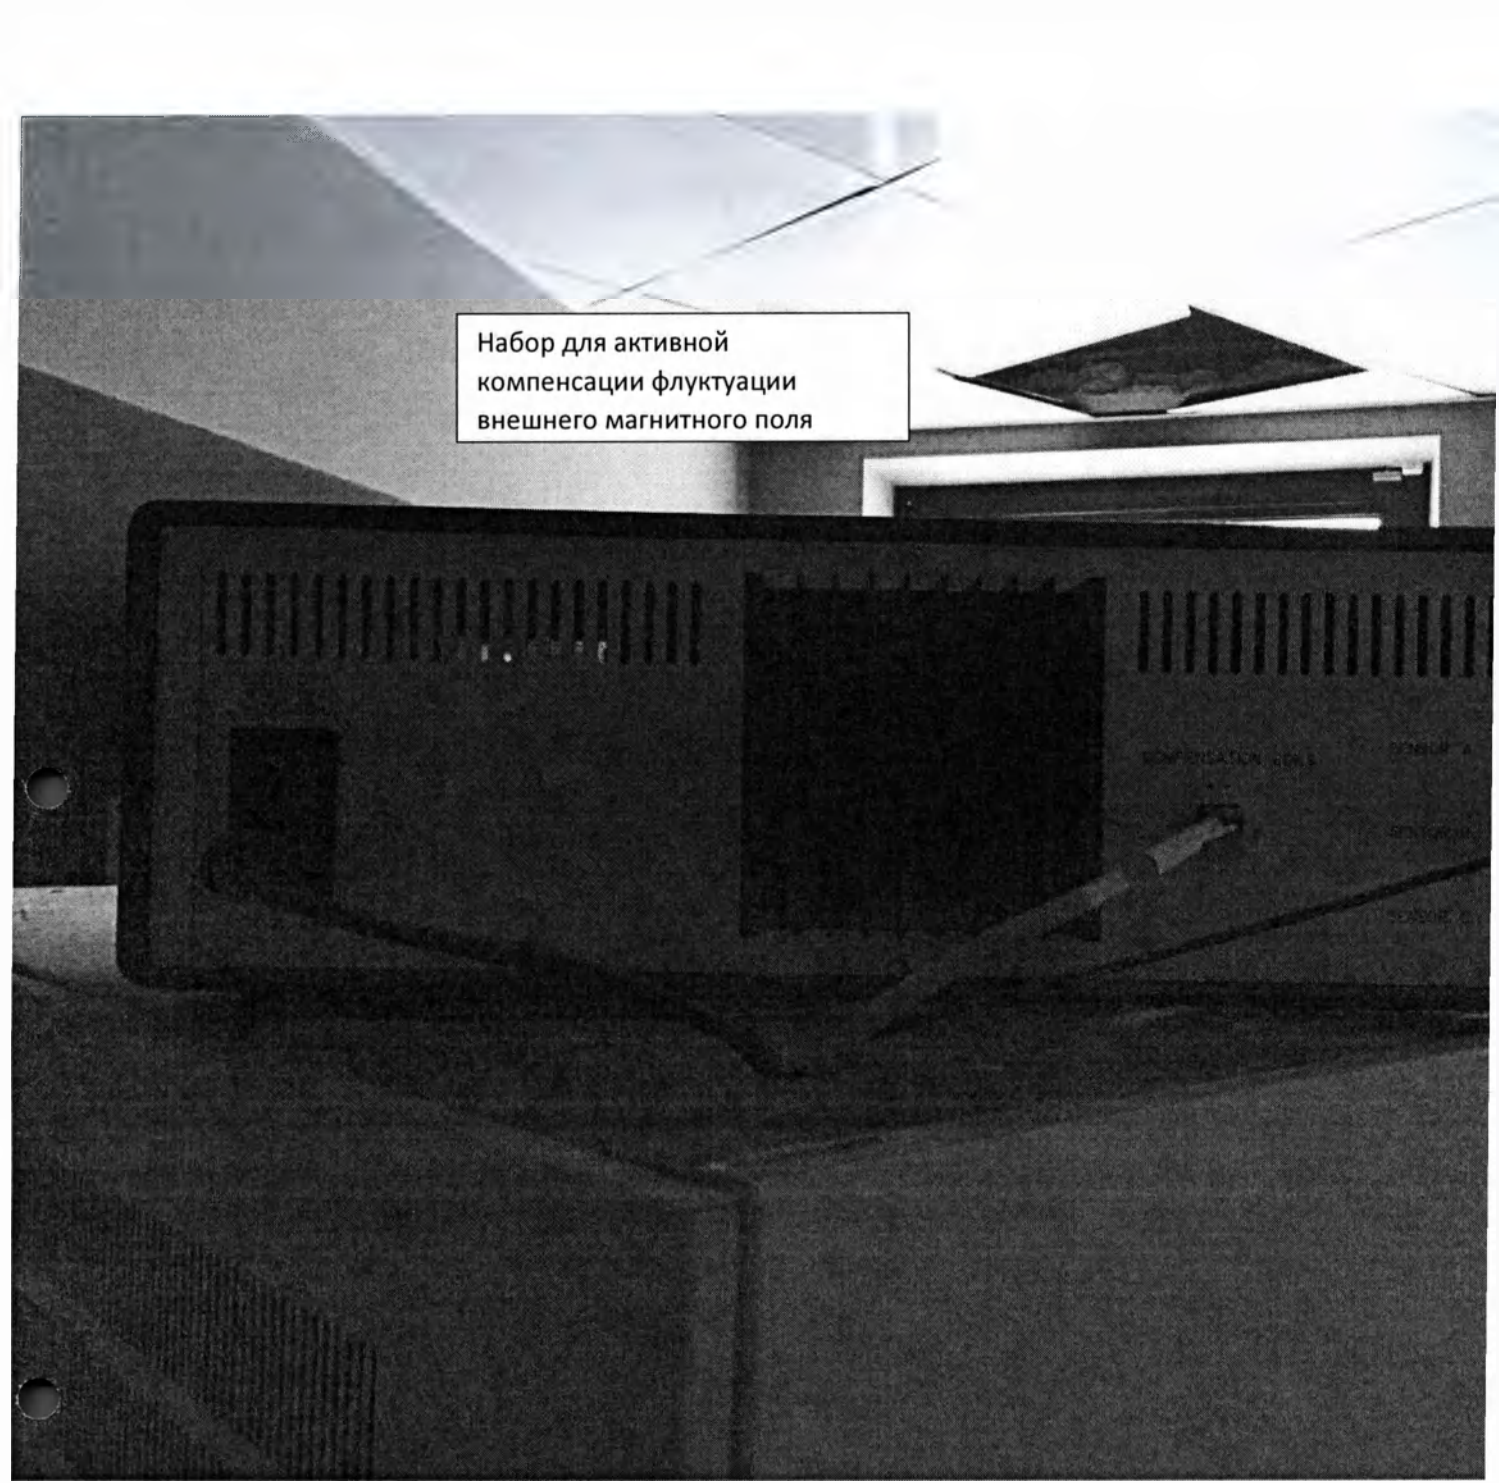



Набор для активной
компенсации флуктуации
внешнего магнитного поля



Датчик для определения флуктуации
внешнего магнитного поля

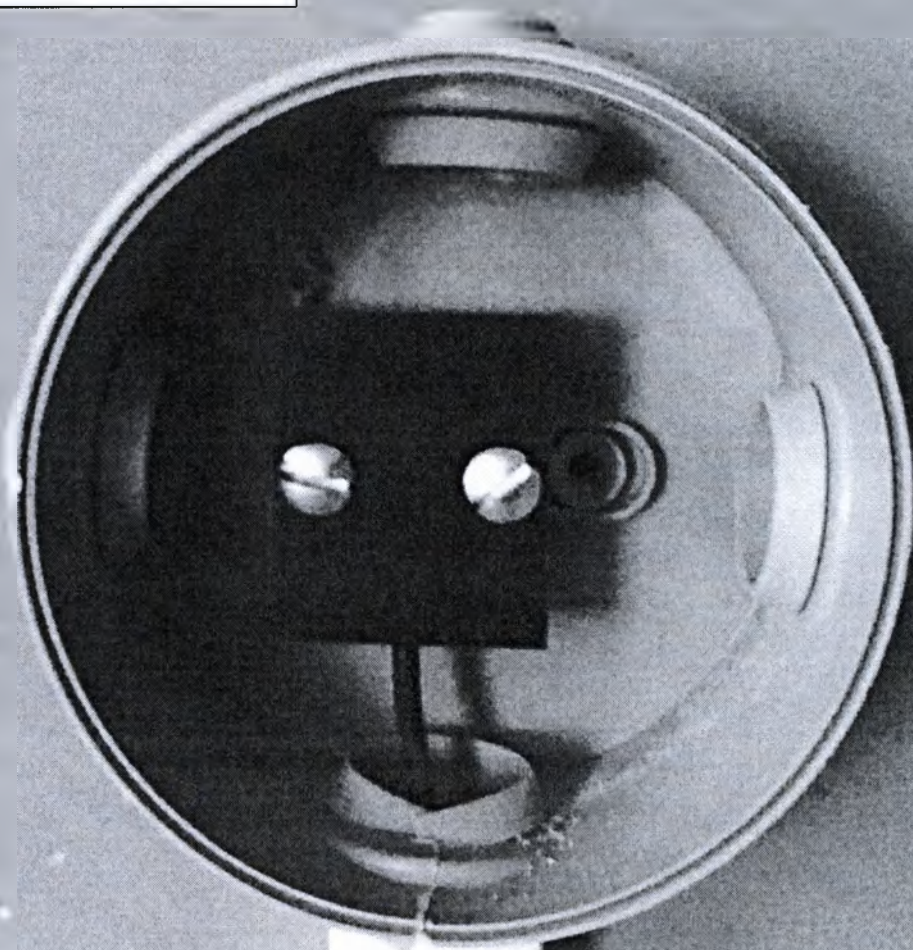

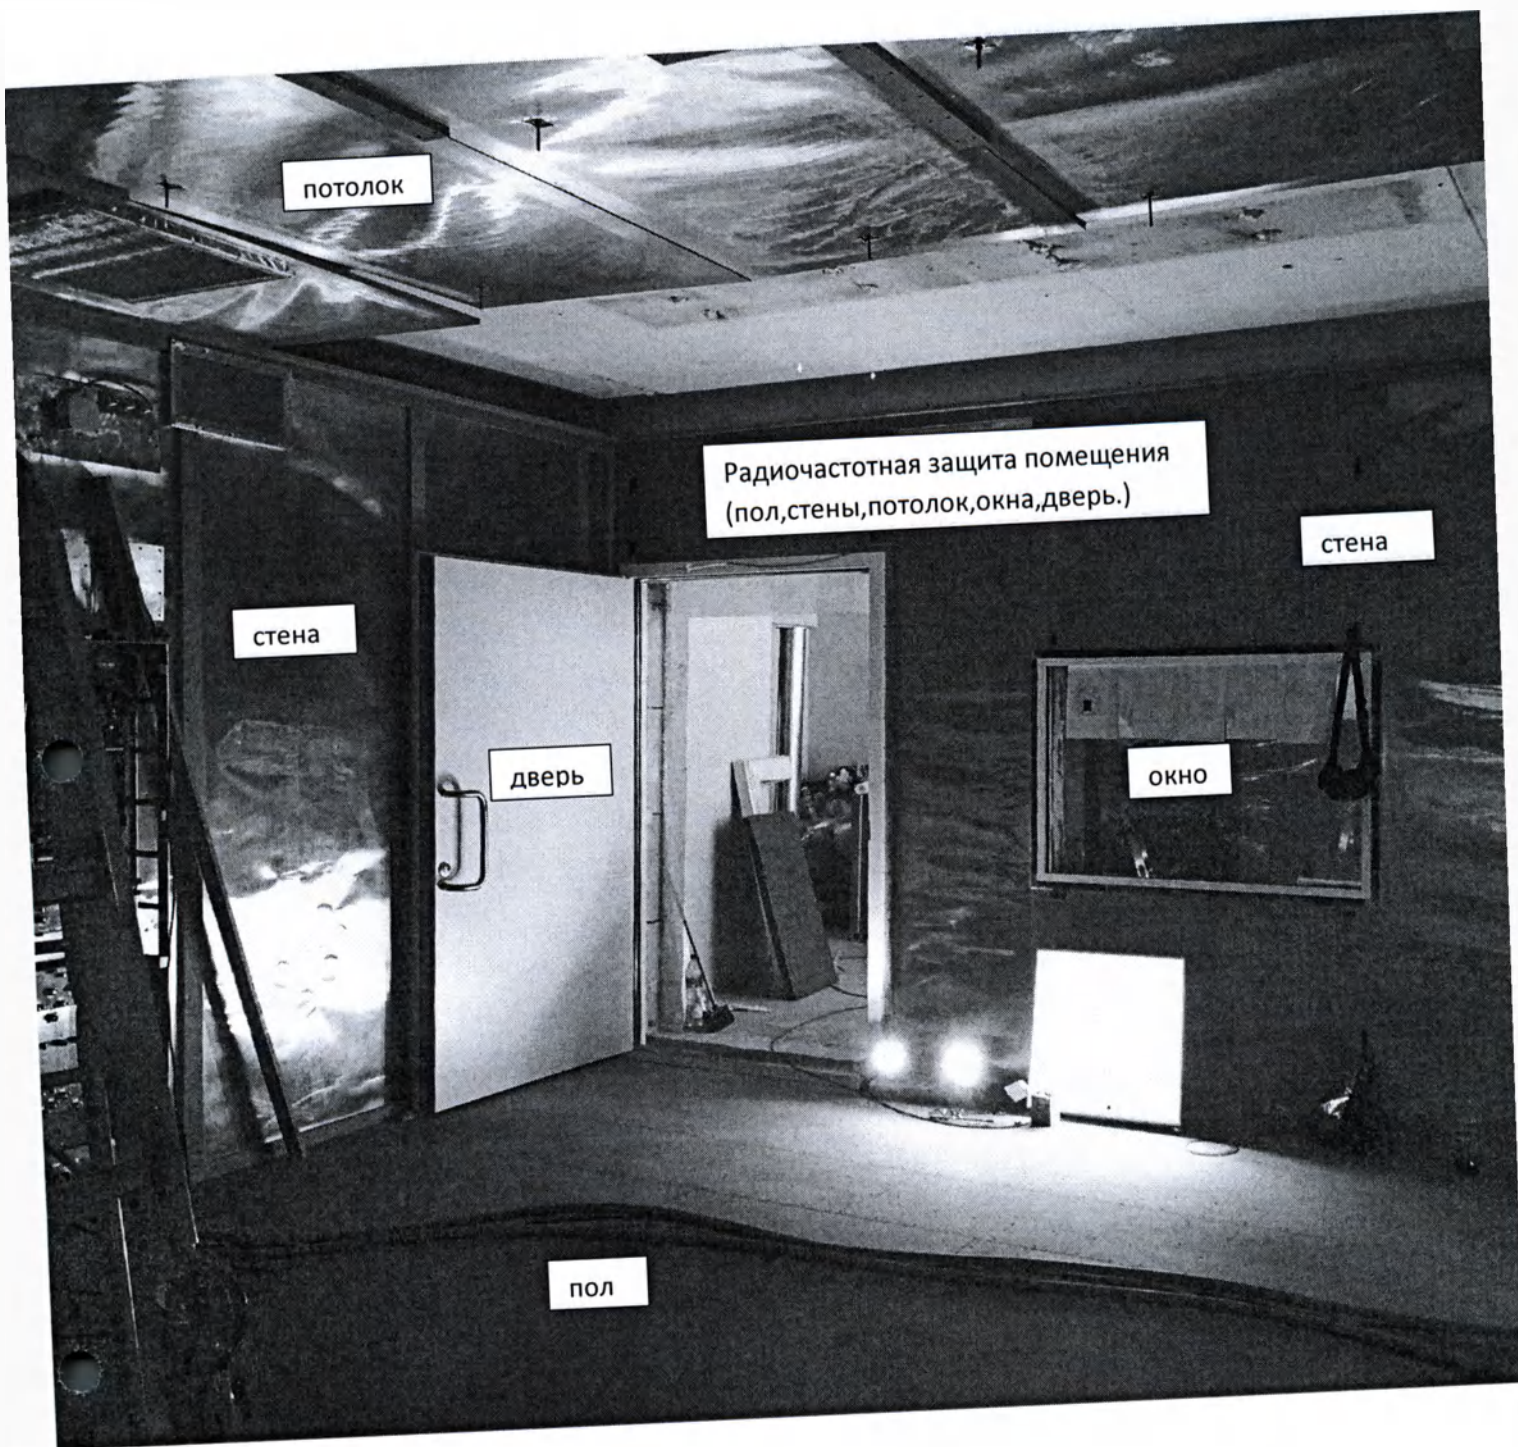

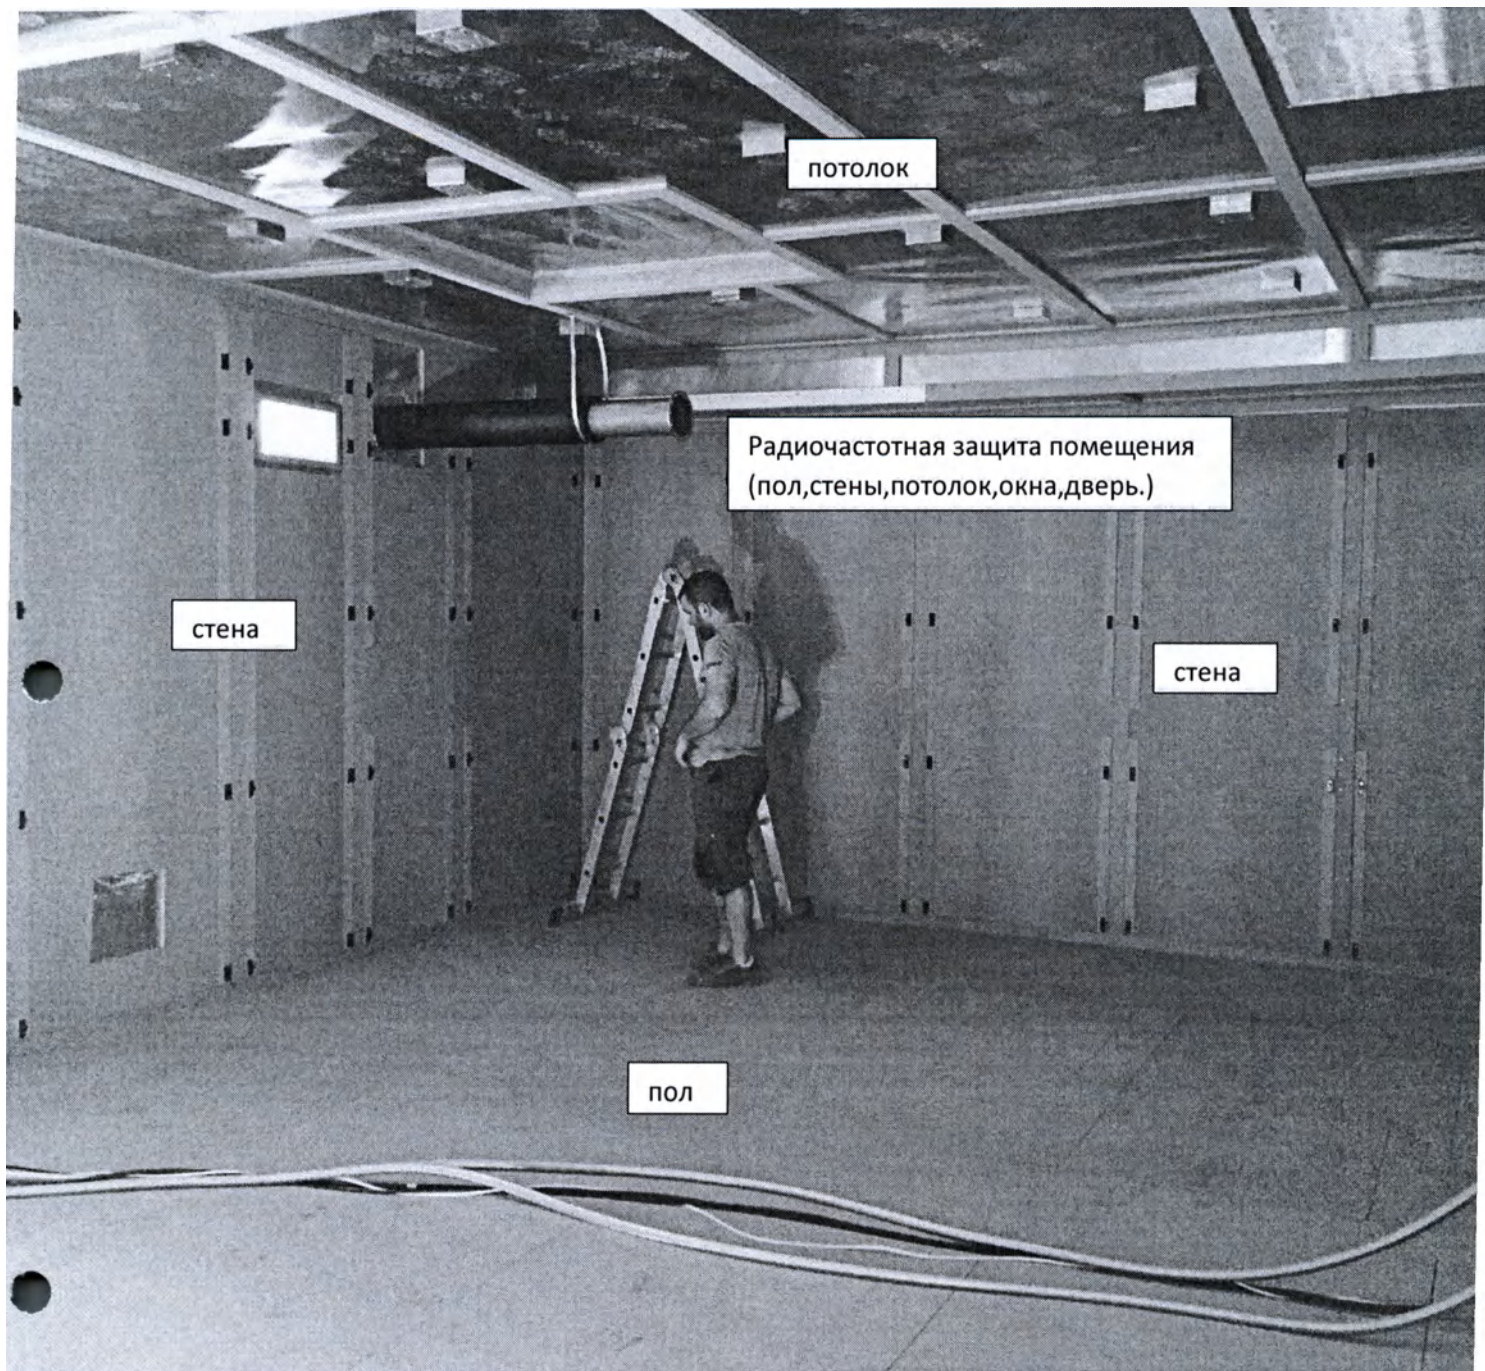



ПОТОЛОК


Радиочастотная защита помещения
(пол, стены, потолок, окна, дверь.)

стена

стена

пол

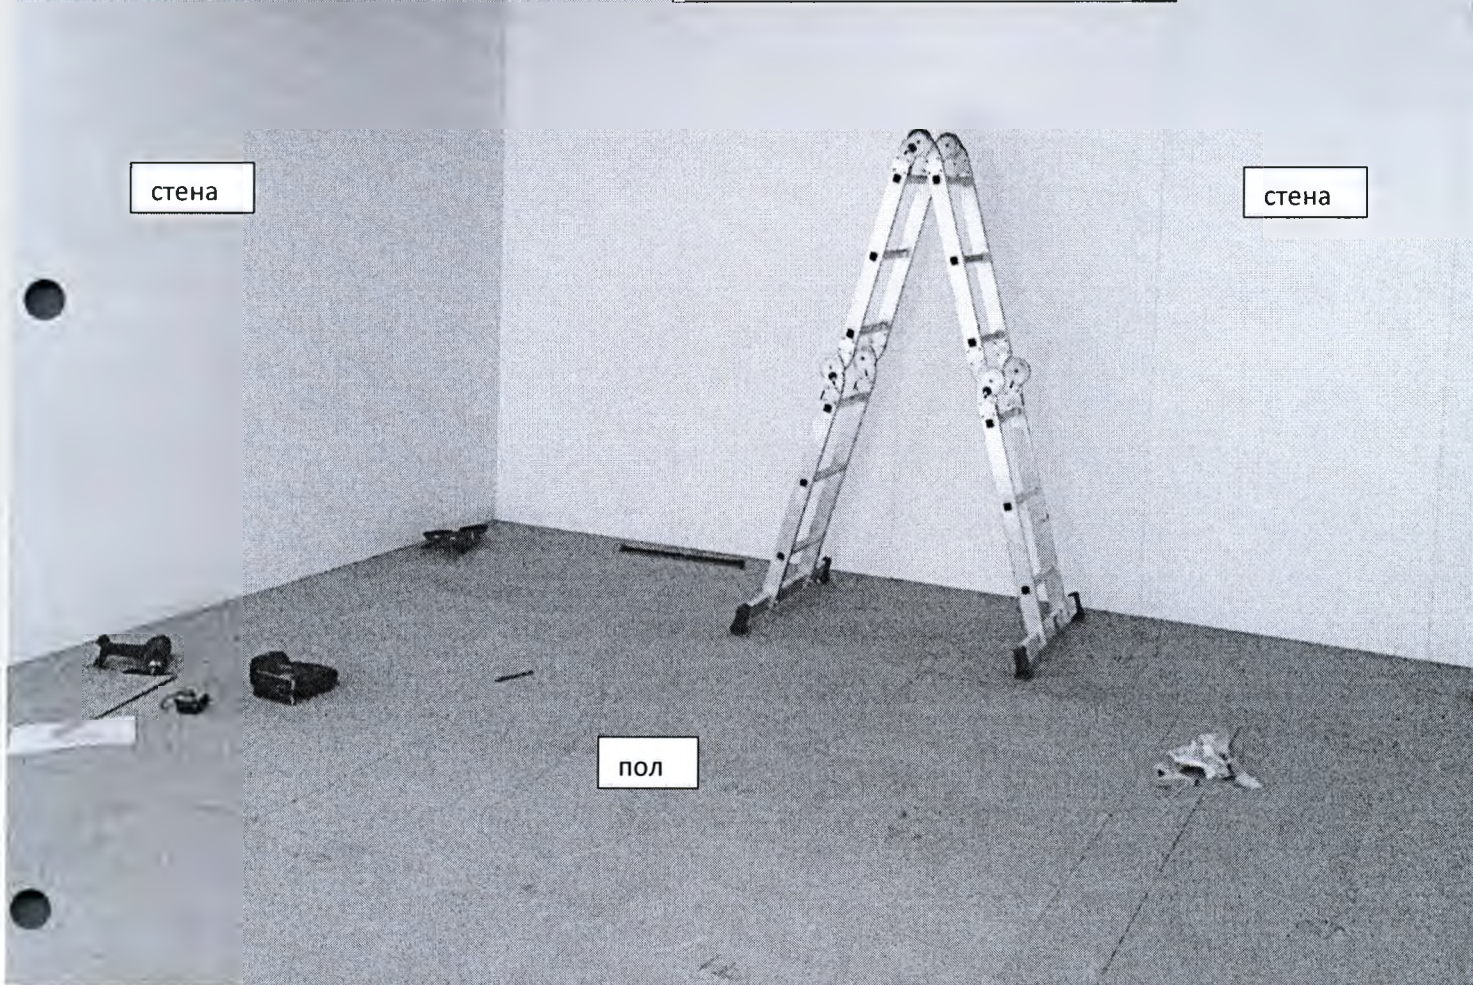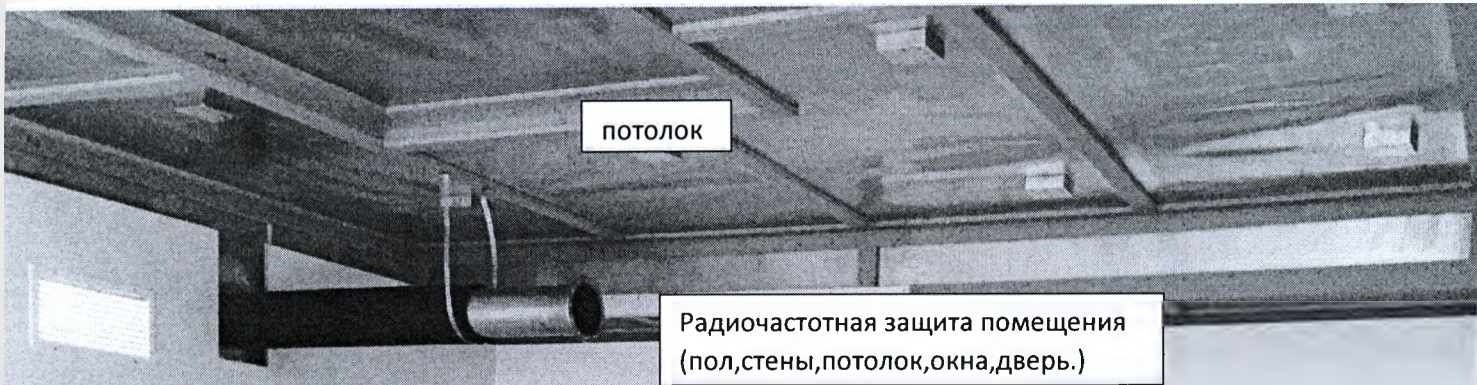

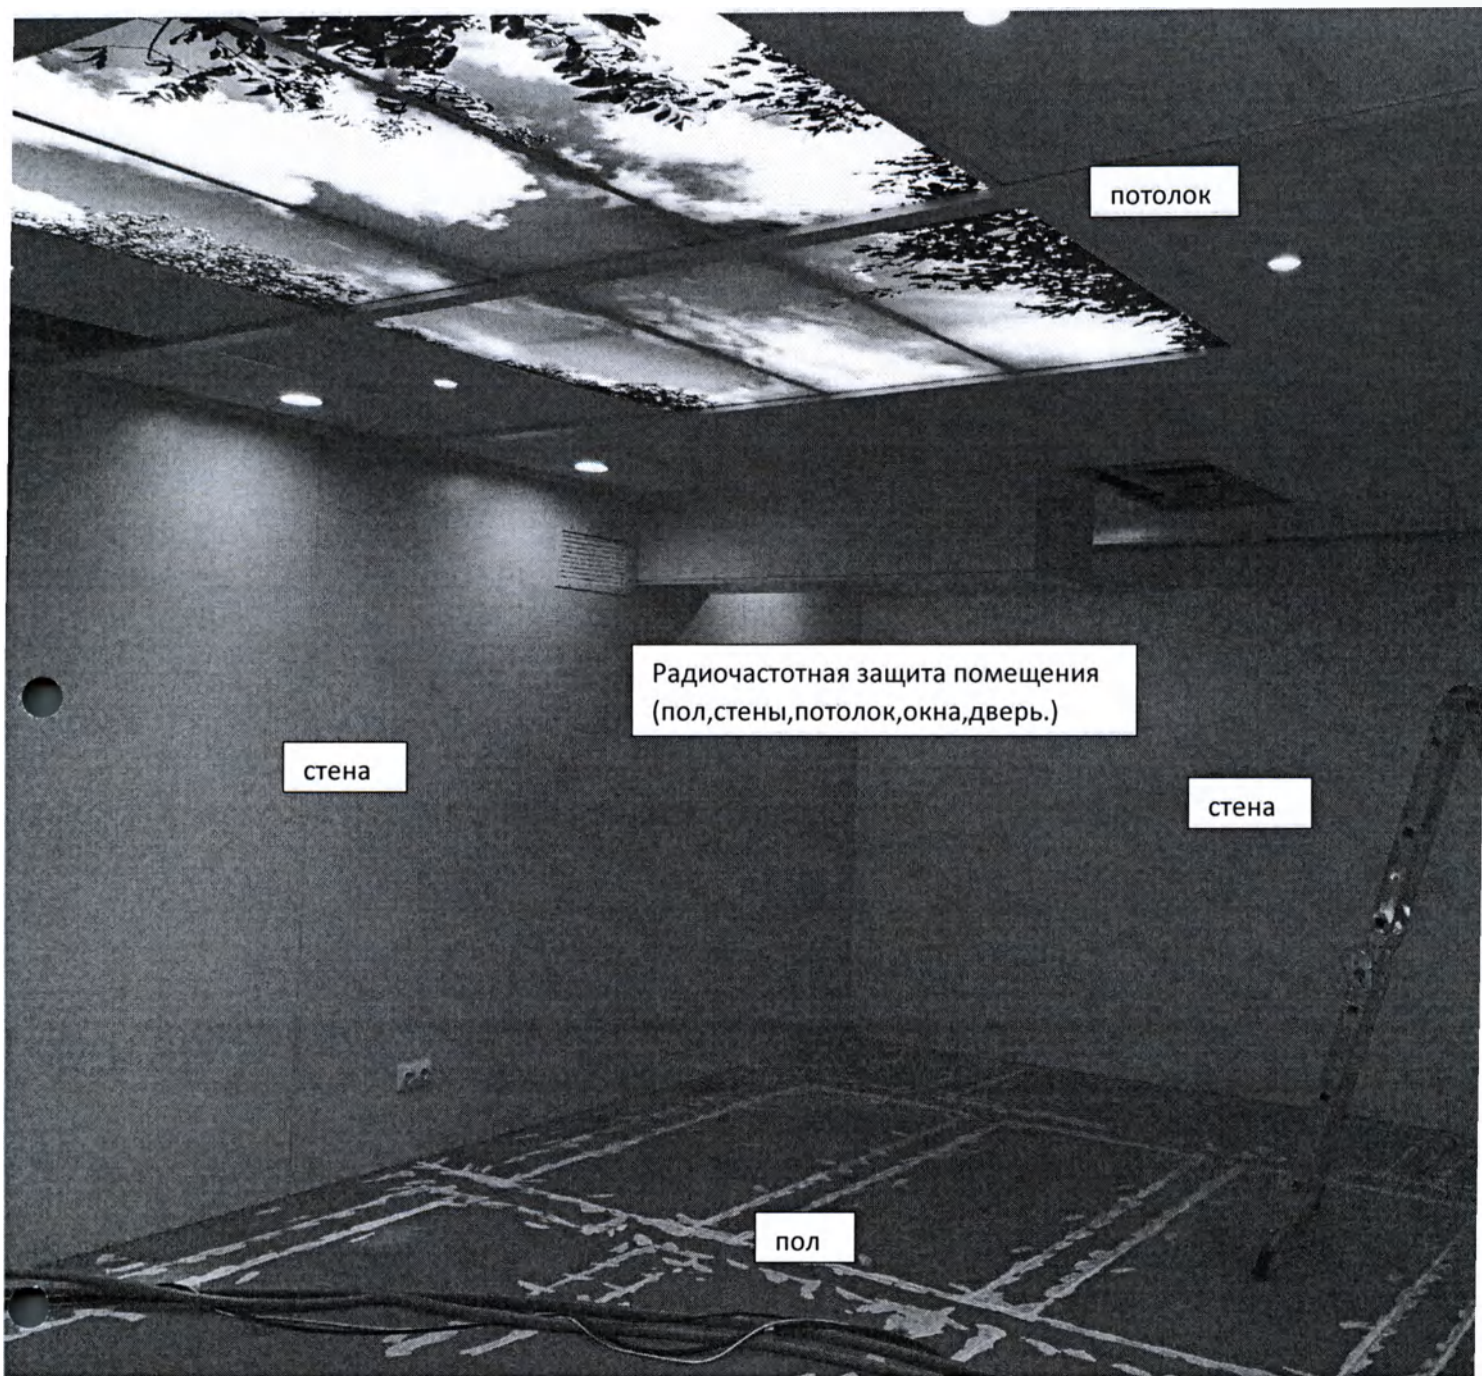


потолок

Радиочастотная защита помещения
(пол, стены, потолок, окна, дверь.)

стена

стена

пол

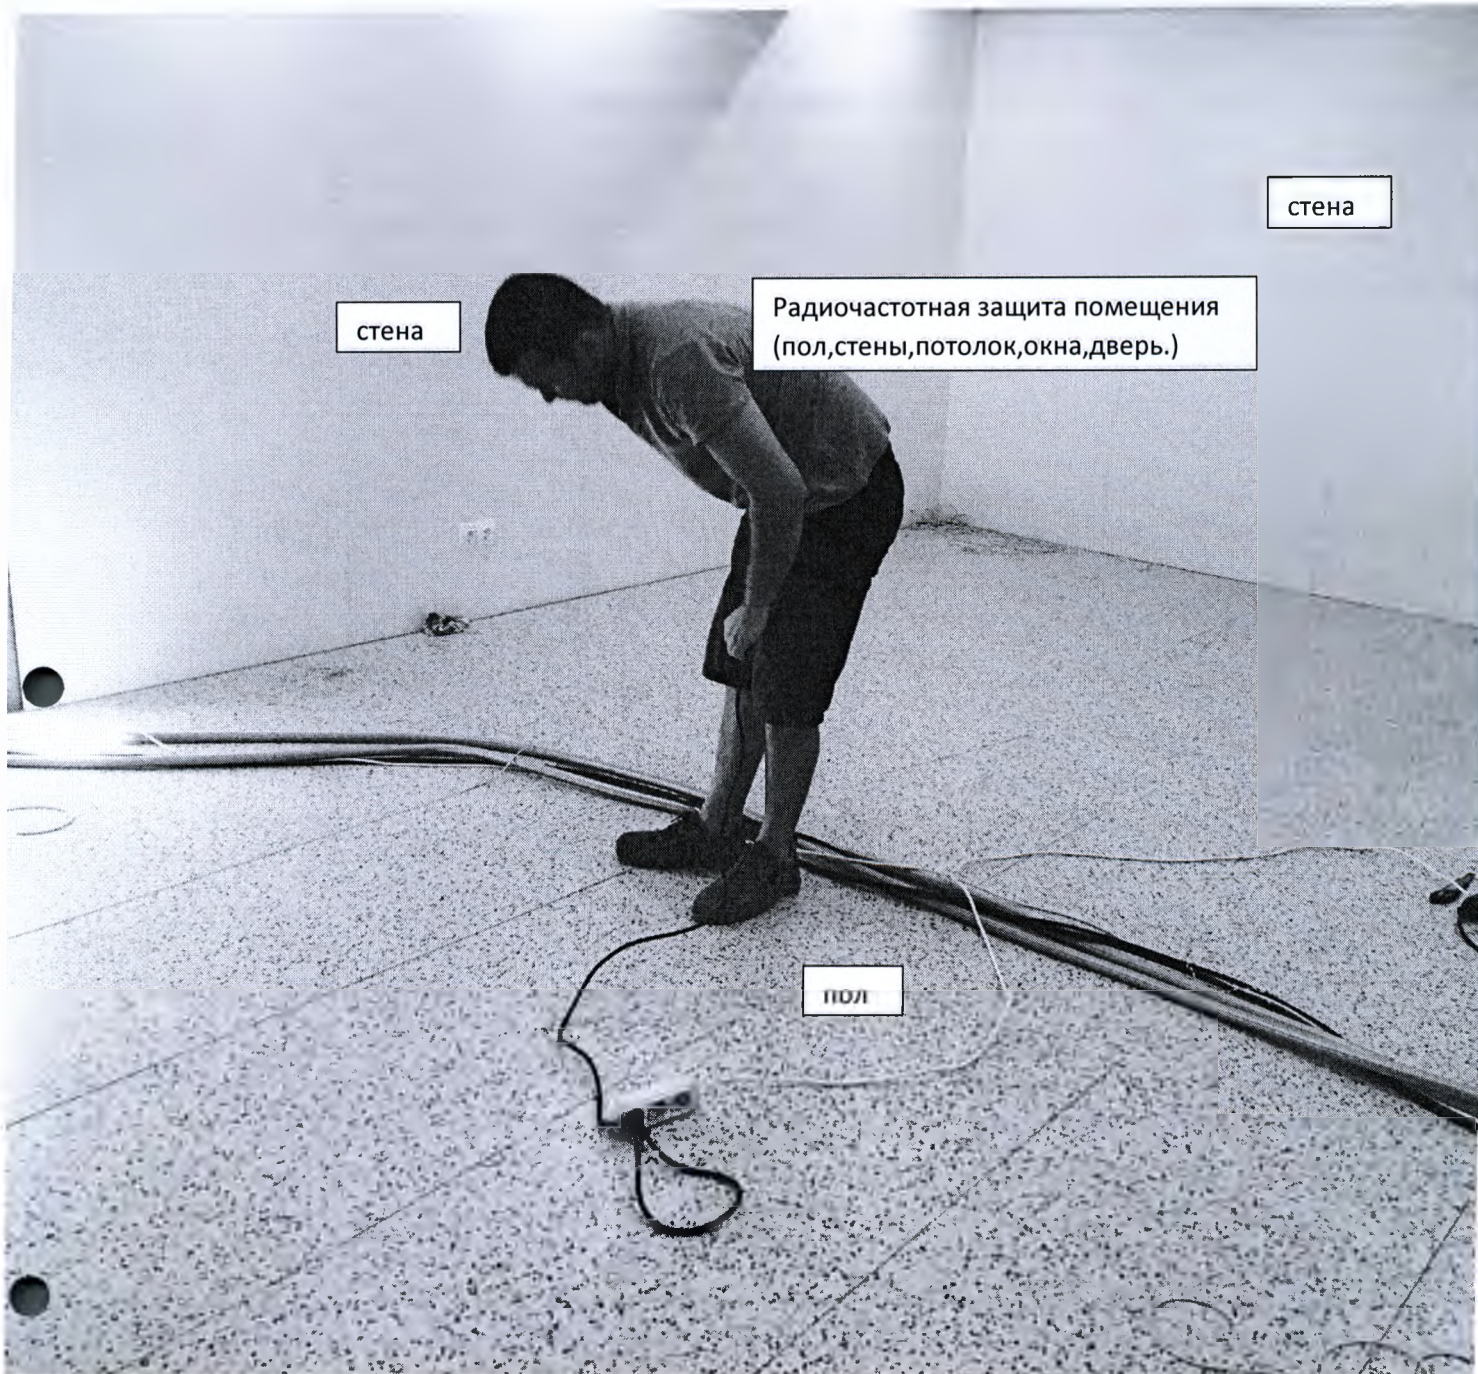


стена


стена

Радиочастотная защита помещения
(пол, стены, потолок, окна, дверь.)


пол

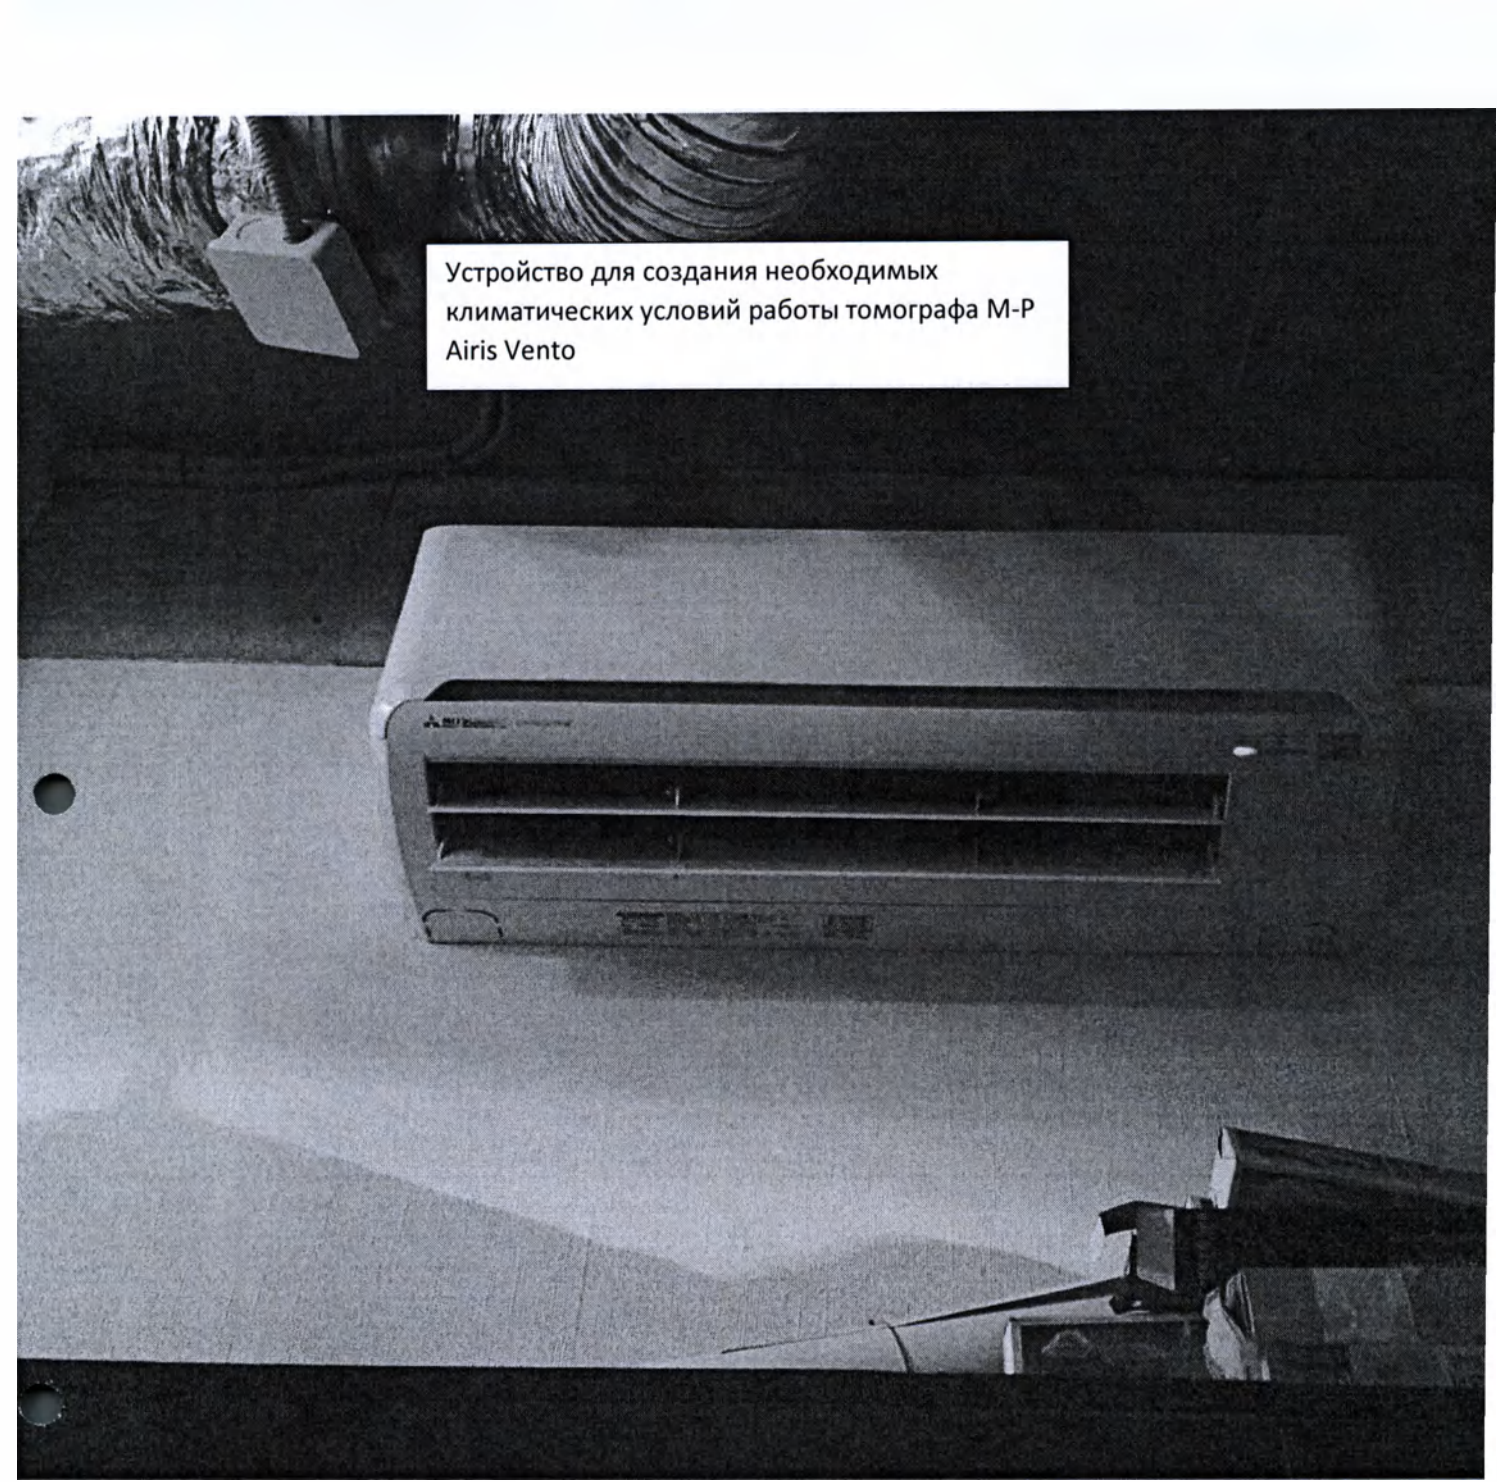

Устройство для создания необходимых
климатических условий работы томографа М-Р
Airis Vento

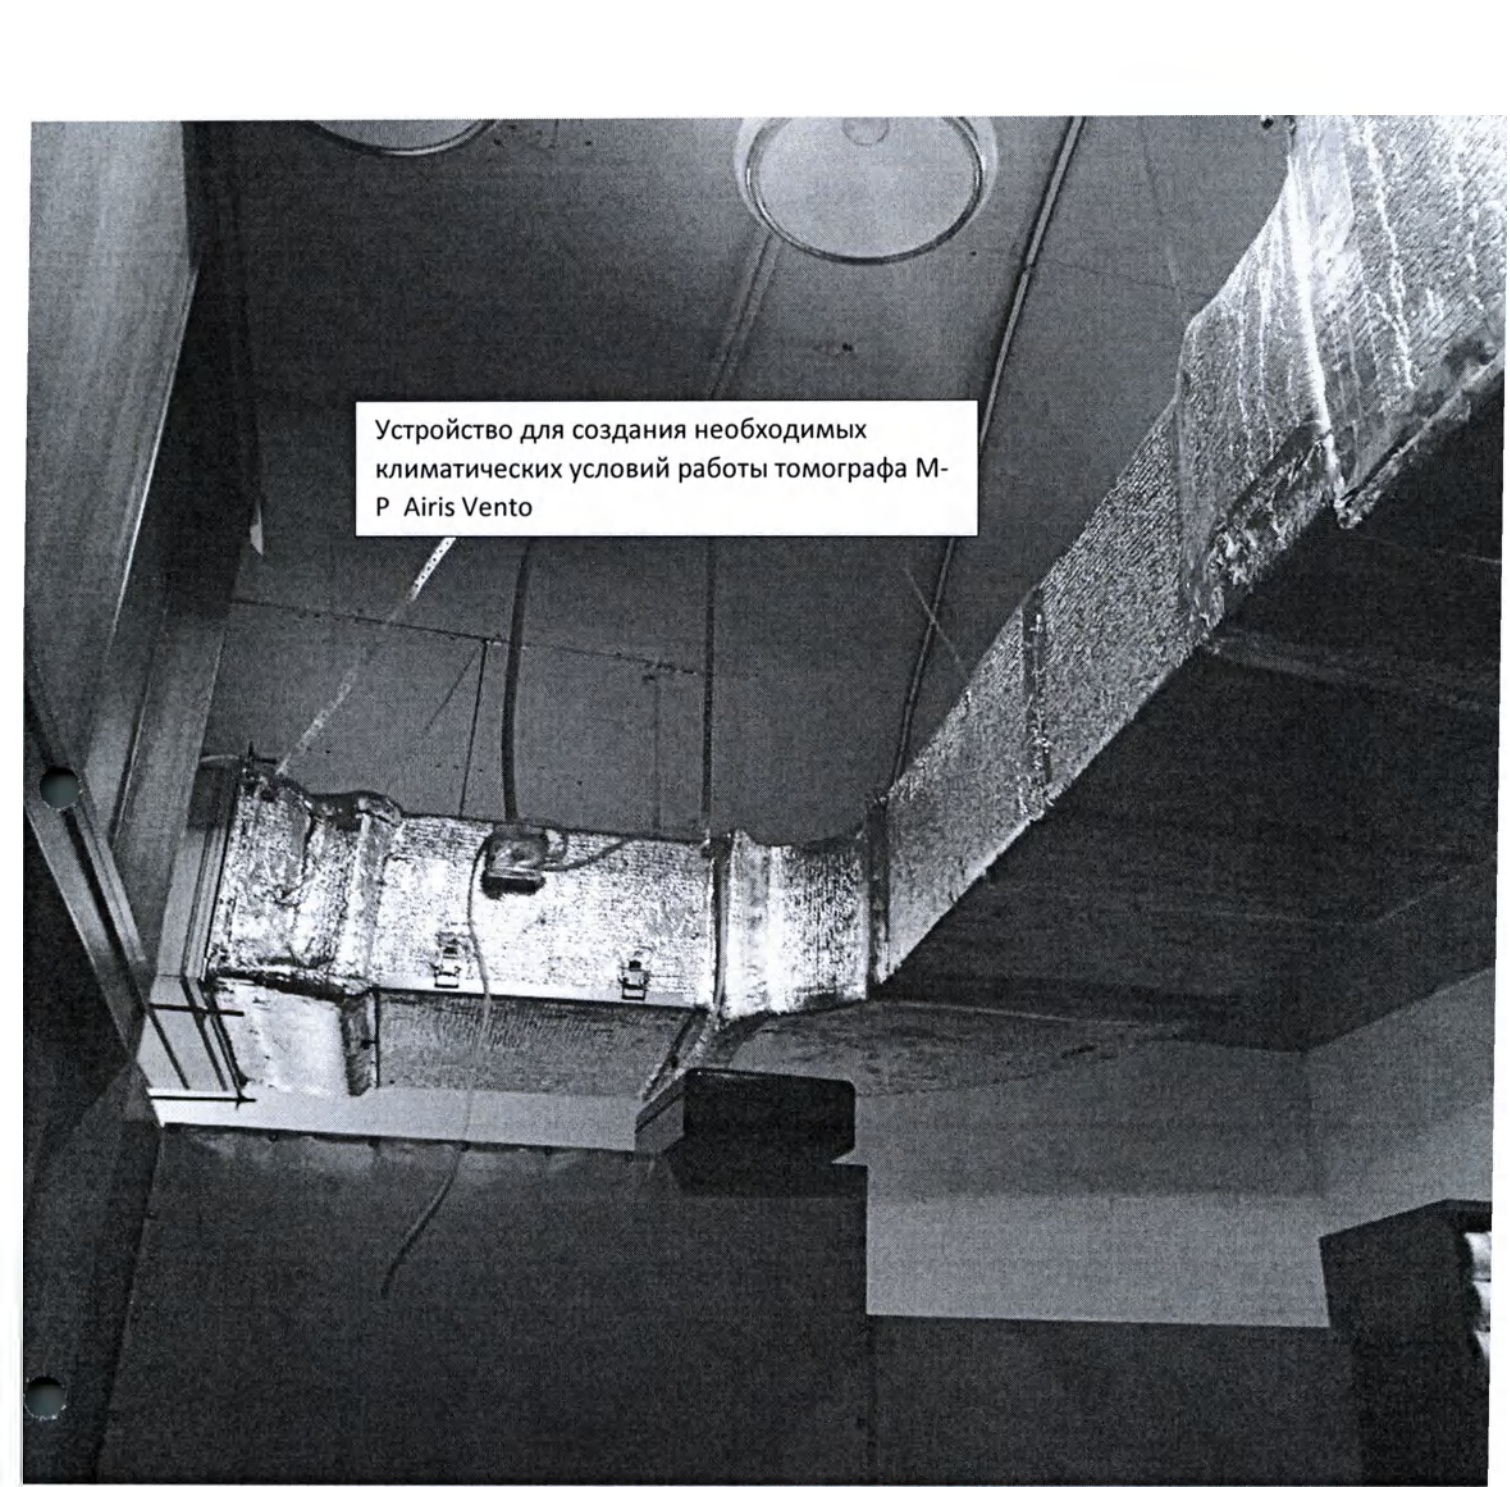

Устройство для создания необходимых
климатических условий работы томографа М-
Р Airis Vento

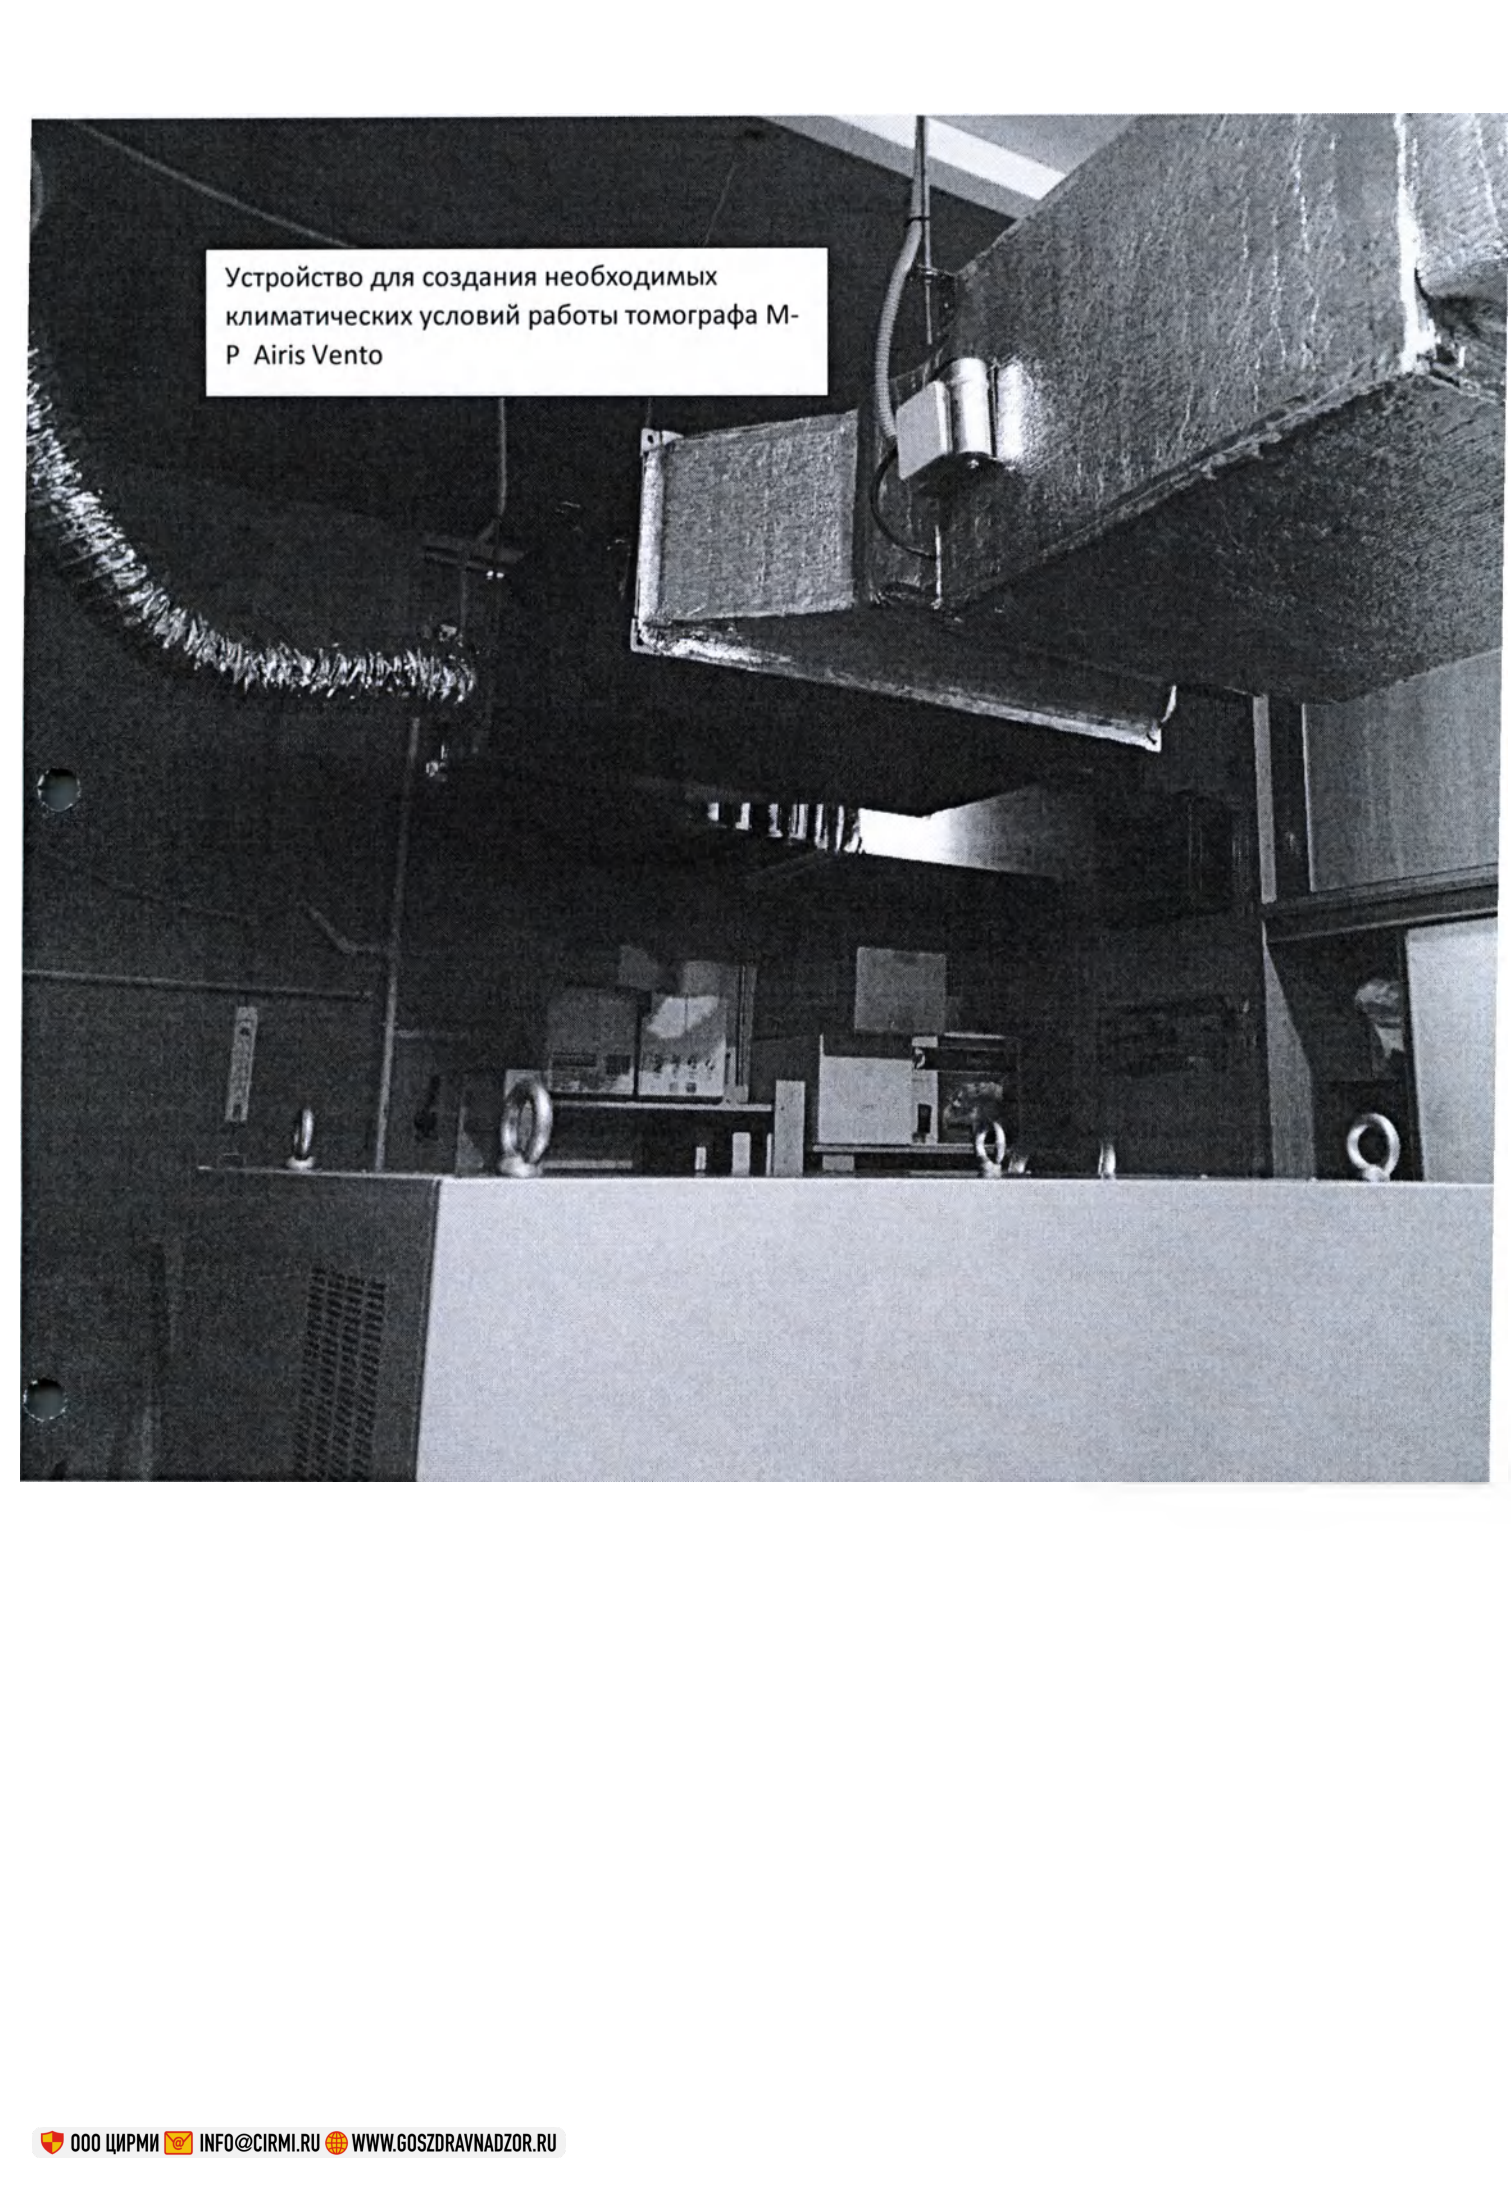


Устройство для создания необходимых
климатических условий работы томографа М-
Р Airis Vento




Устройство для печати медицинских изображений

Источник резервного (бесперебойного) питания для электронных блоков томографа МР Airis Vento. Батарея в сборе для источника резервного (бесперебойного) питания для электронных блоков томографа магнитно-резонансного Airis Vento

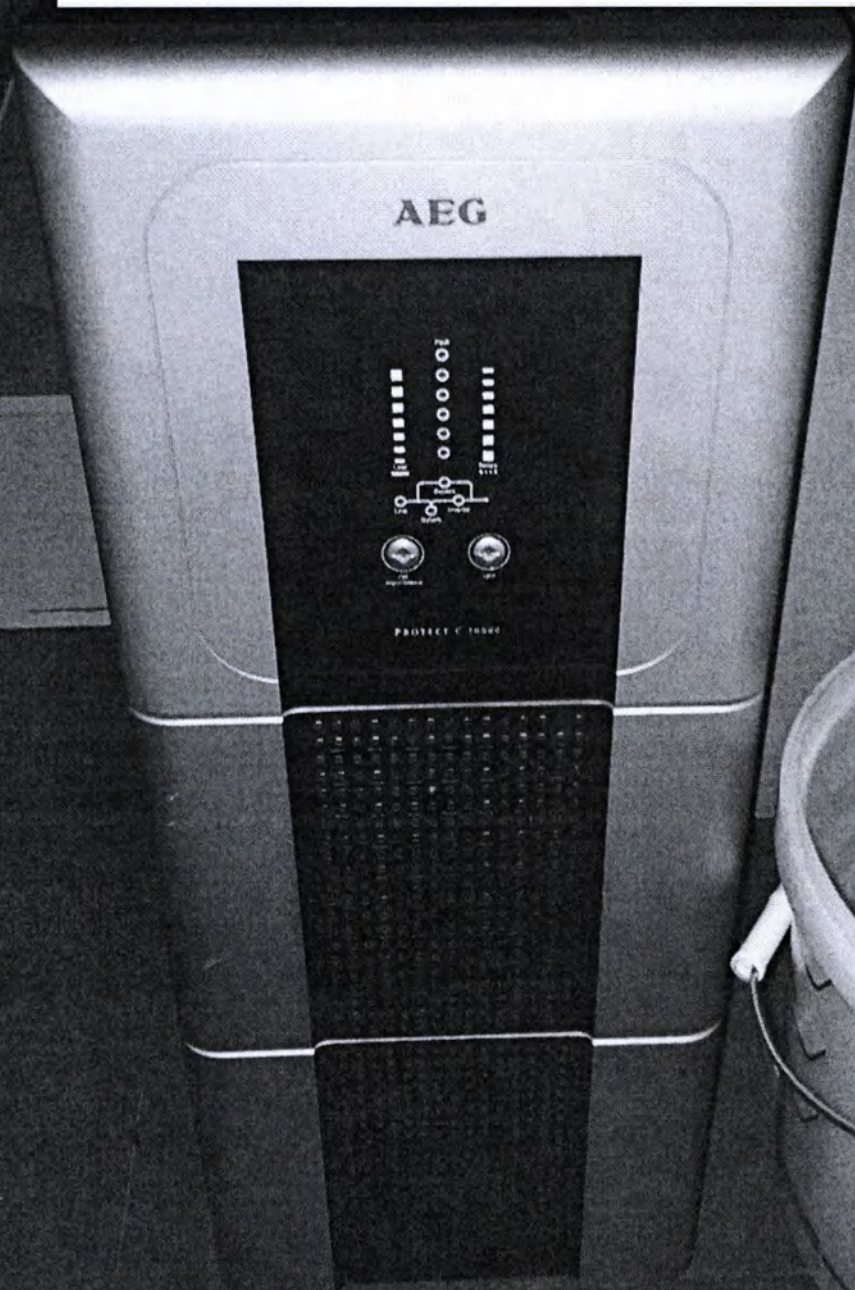

Источник резервного (бесперебойного) питания для электронных блоков томографа МР Airis Vento. Батарея в сборе для источника резервного (бесперебойного) питания для электронных блоков томографа магнитно-резонансного Airis Vento

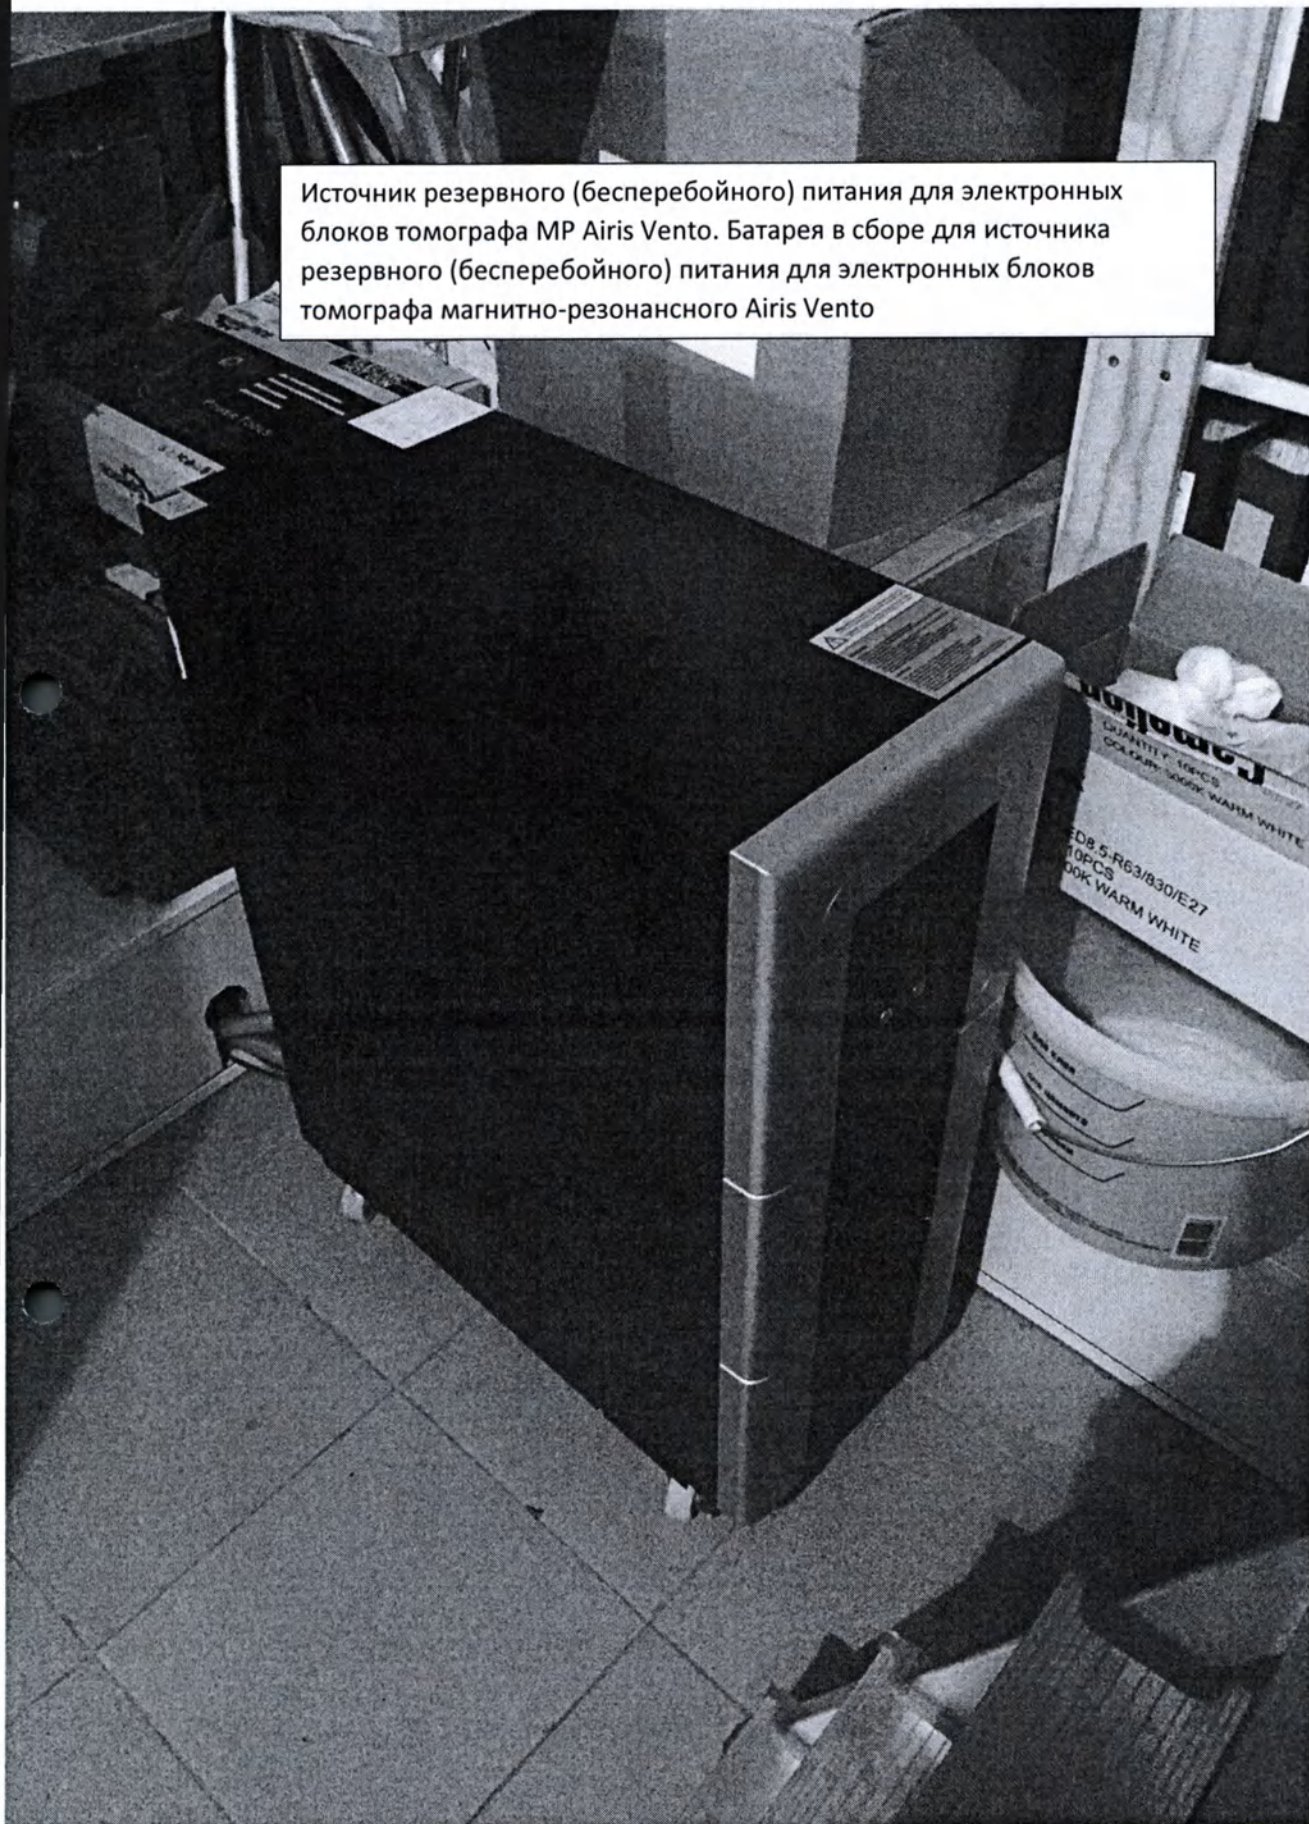




Немагнитная каталка




Немагнитная каталка

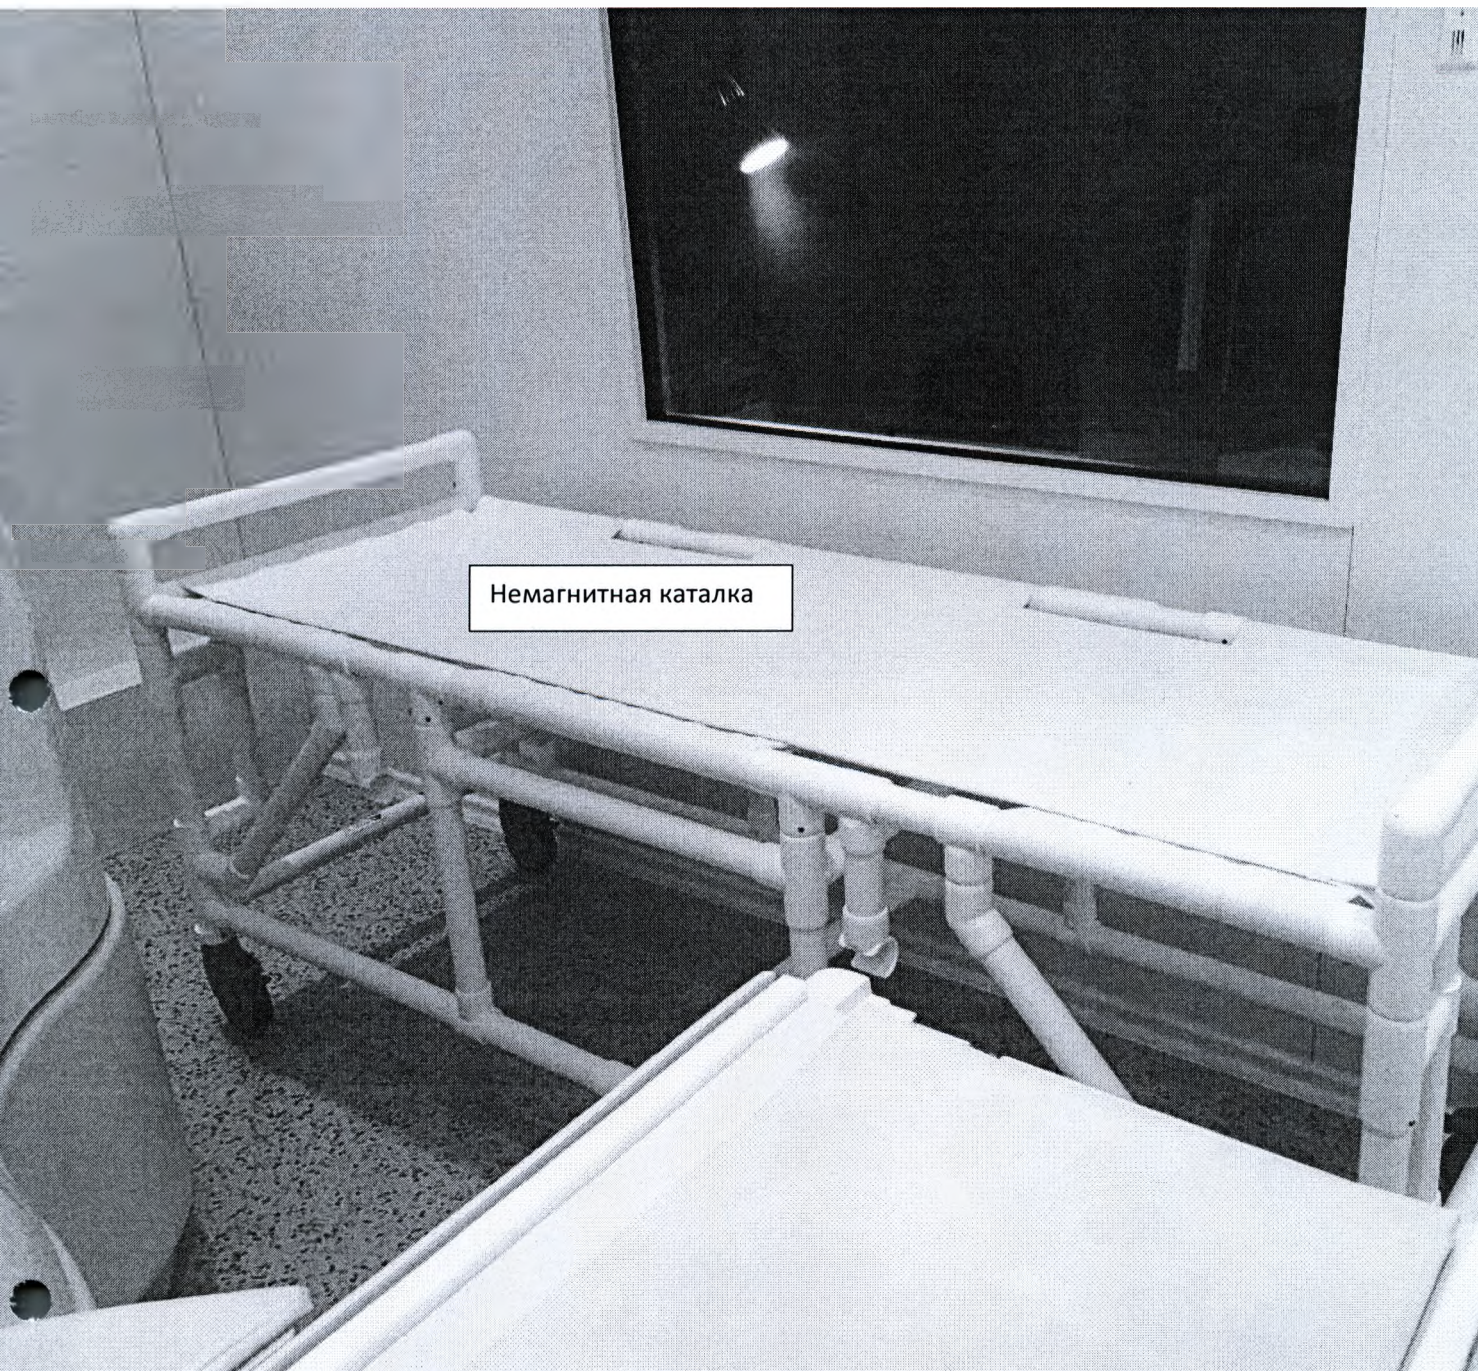

Немагнитная каталка


Инжектор немагнитный на
передвижном штативе для
введения контрастного вещества
для исследований на МР
томографе

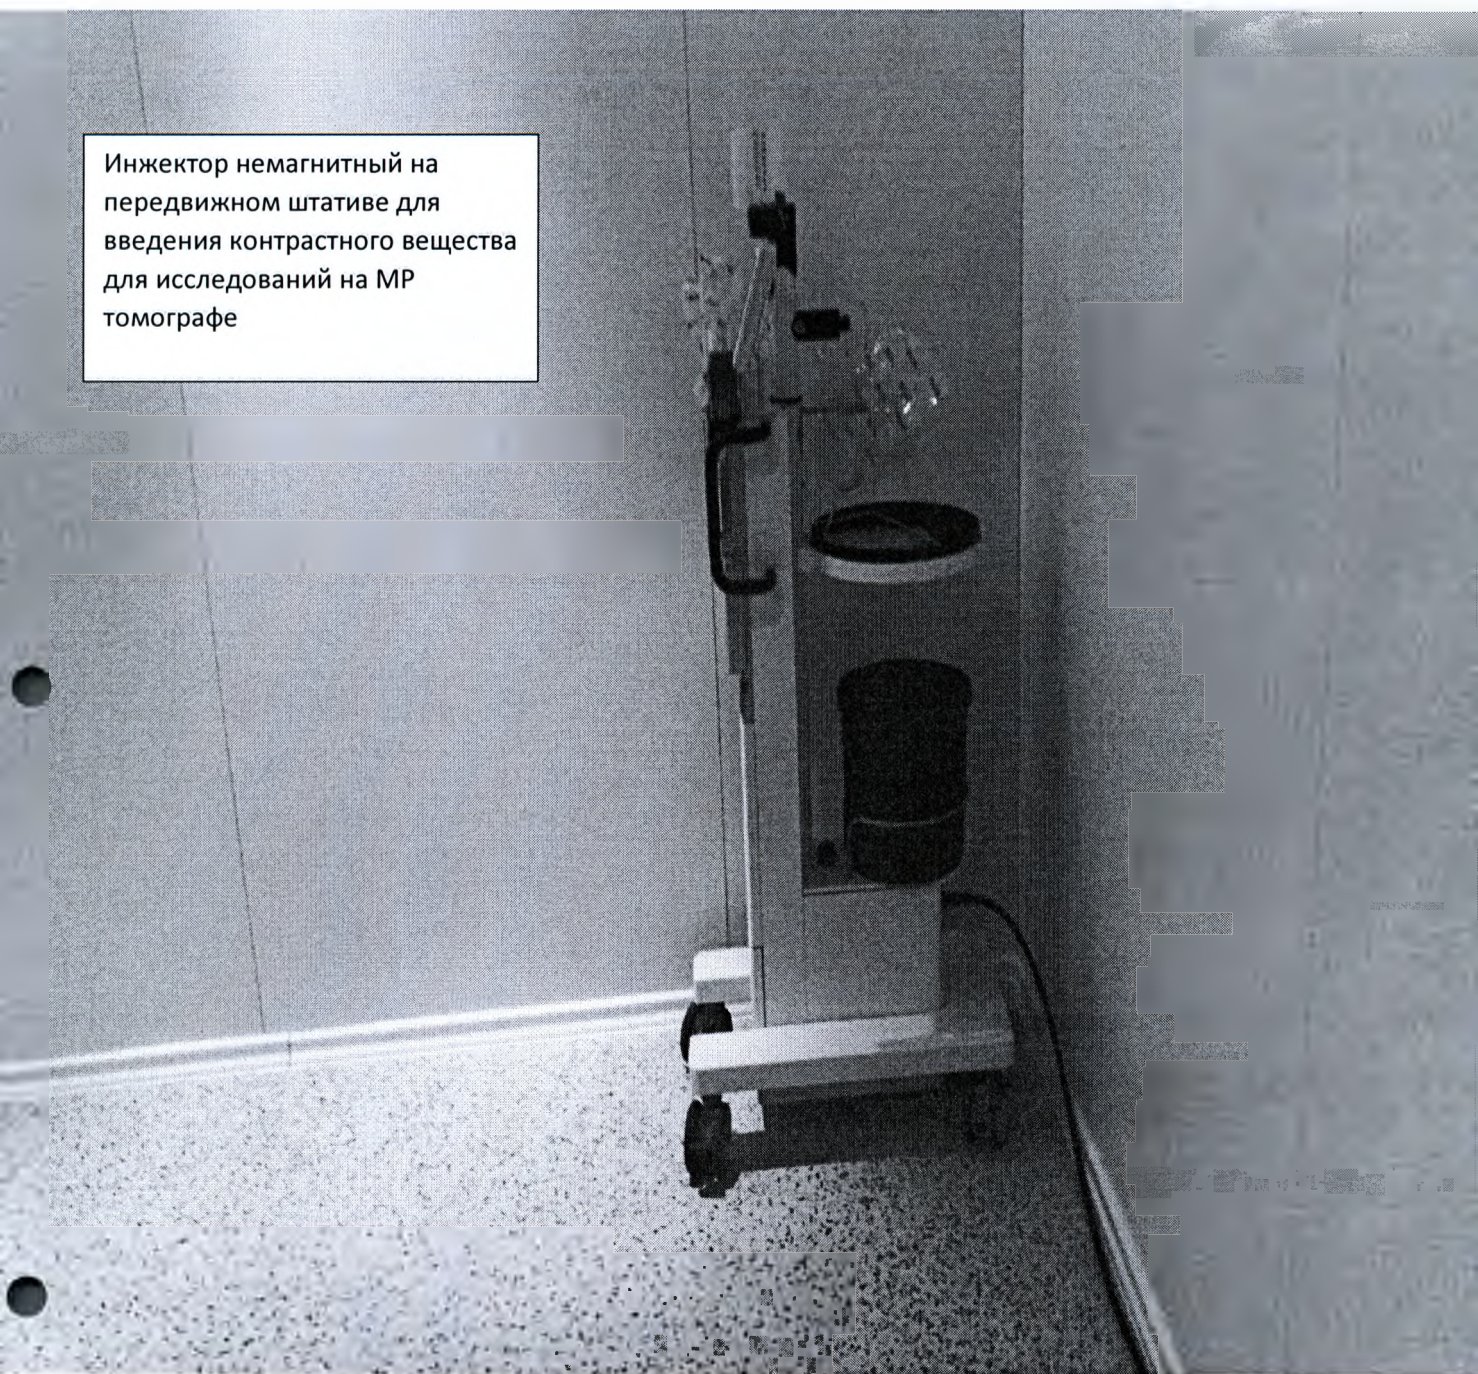




Держатель флаконов с
контрастом (от 3 до 10 шт)

Панель управления инжектором

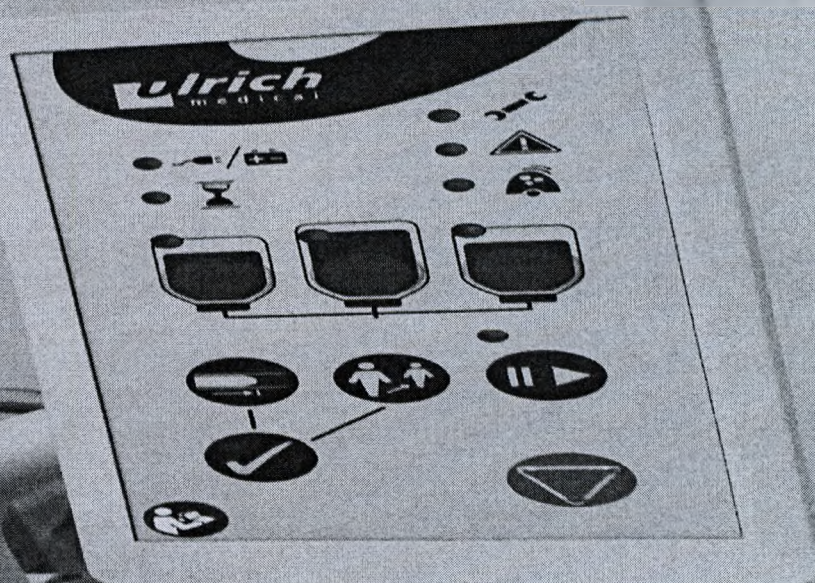

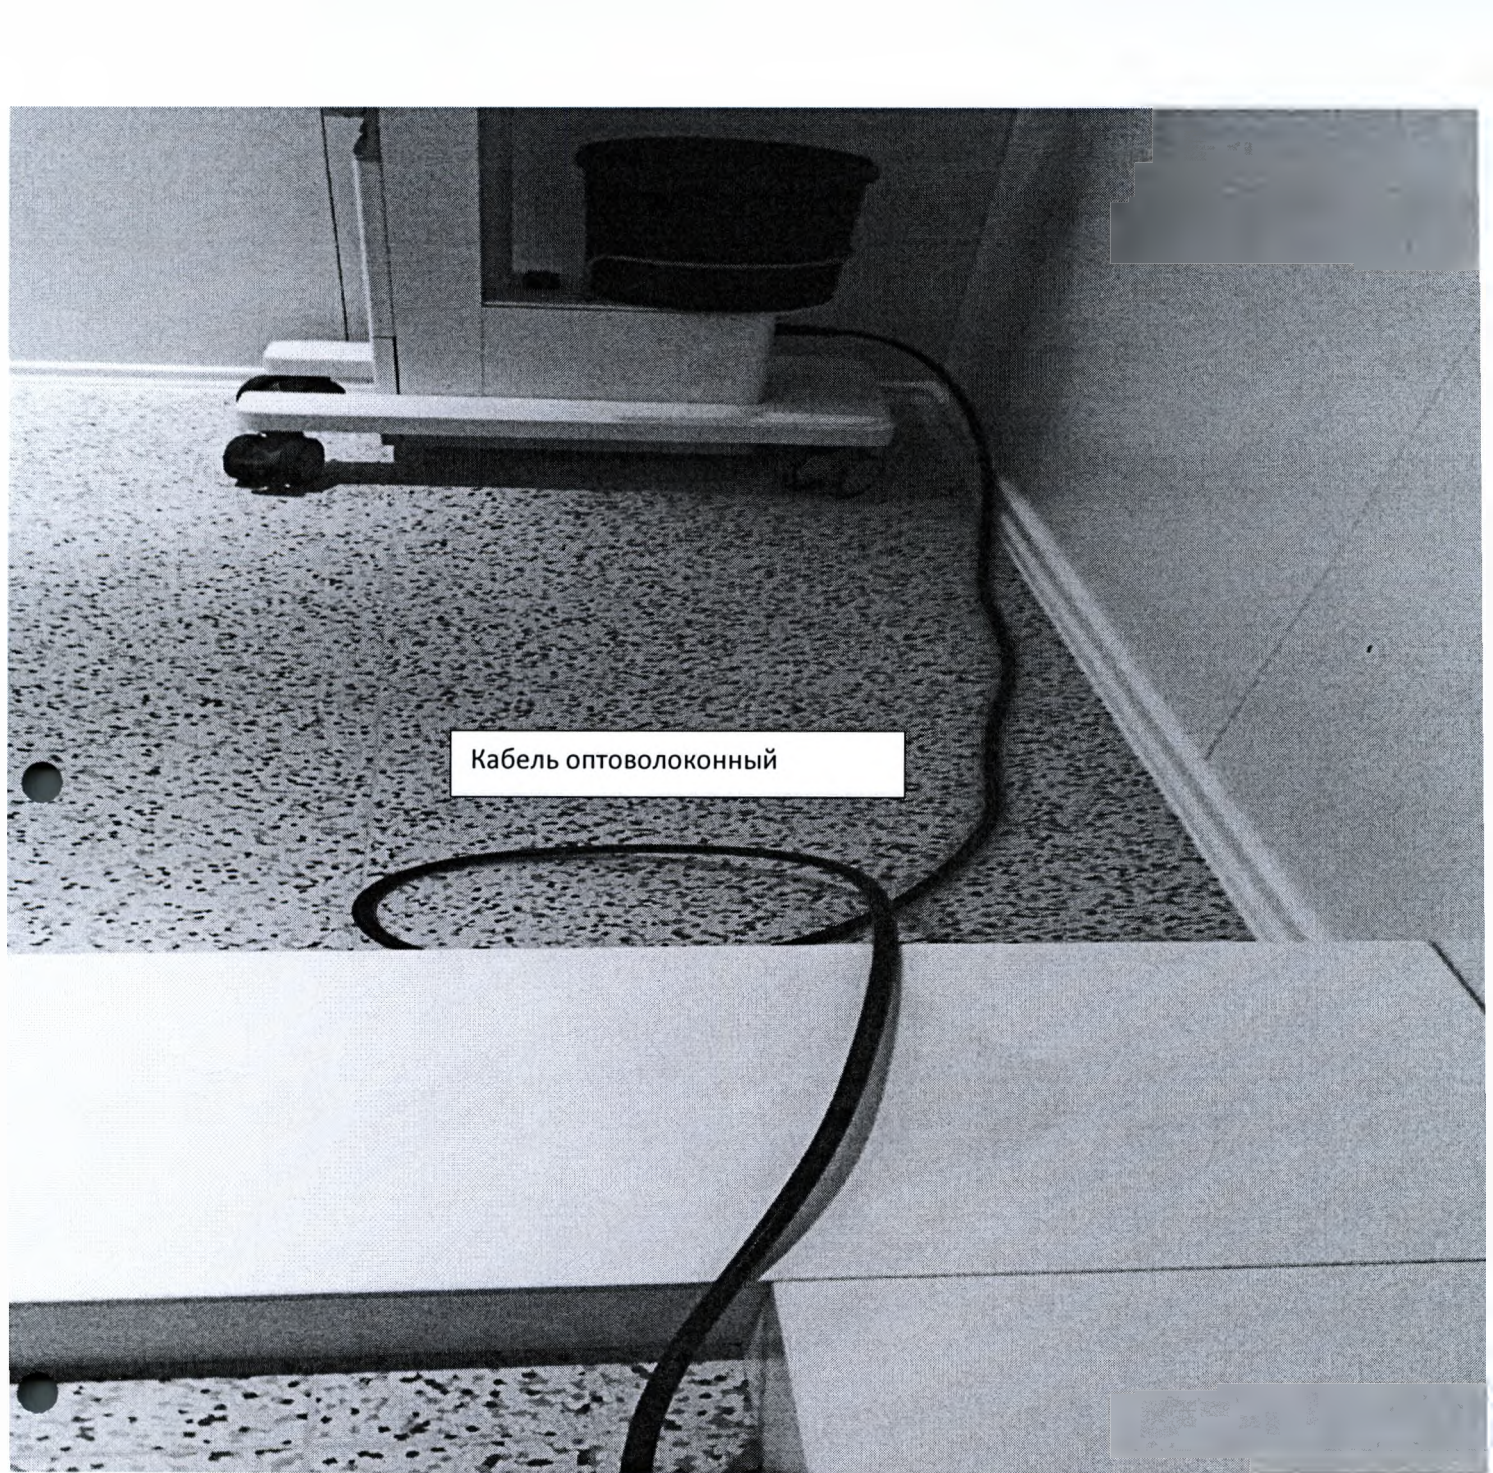

Кабель оптоволоконный

Магнитно-резонансный томограф Hitachi

AIRIS VENTO Руководство по эксплуатации

Инструкция по применению


Заметка операторам и персоналу по техническому обслуживанию

- Перед тем как использовать систему, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению и ознакомьтесь с системой.
- После того как прочтёте материал, храните его в доступном месте рядом с системой.

Hitachi Medical Corporation
Токио, Япония

Q1E-BM6008-3

Copyright © Hitachi Medical Corporation. 2008, 2009. Все права защищены.

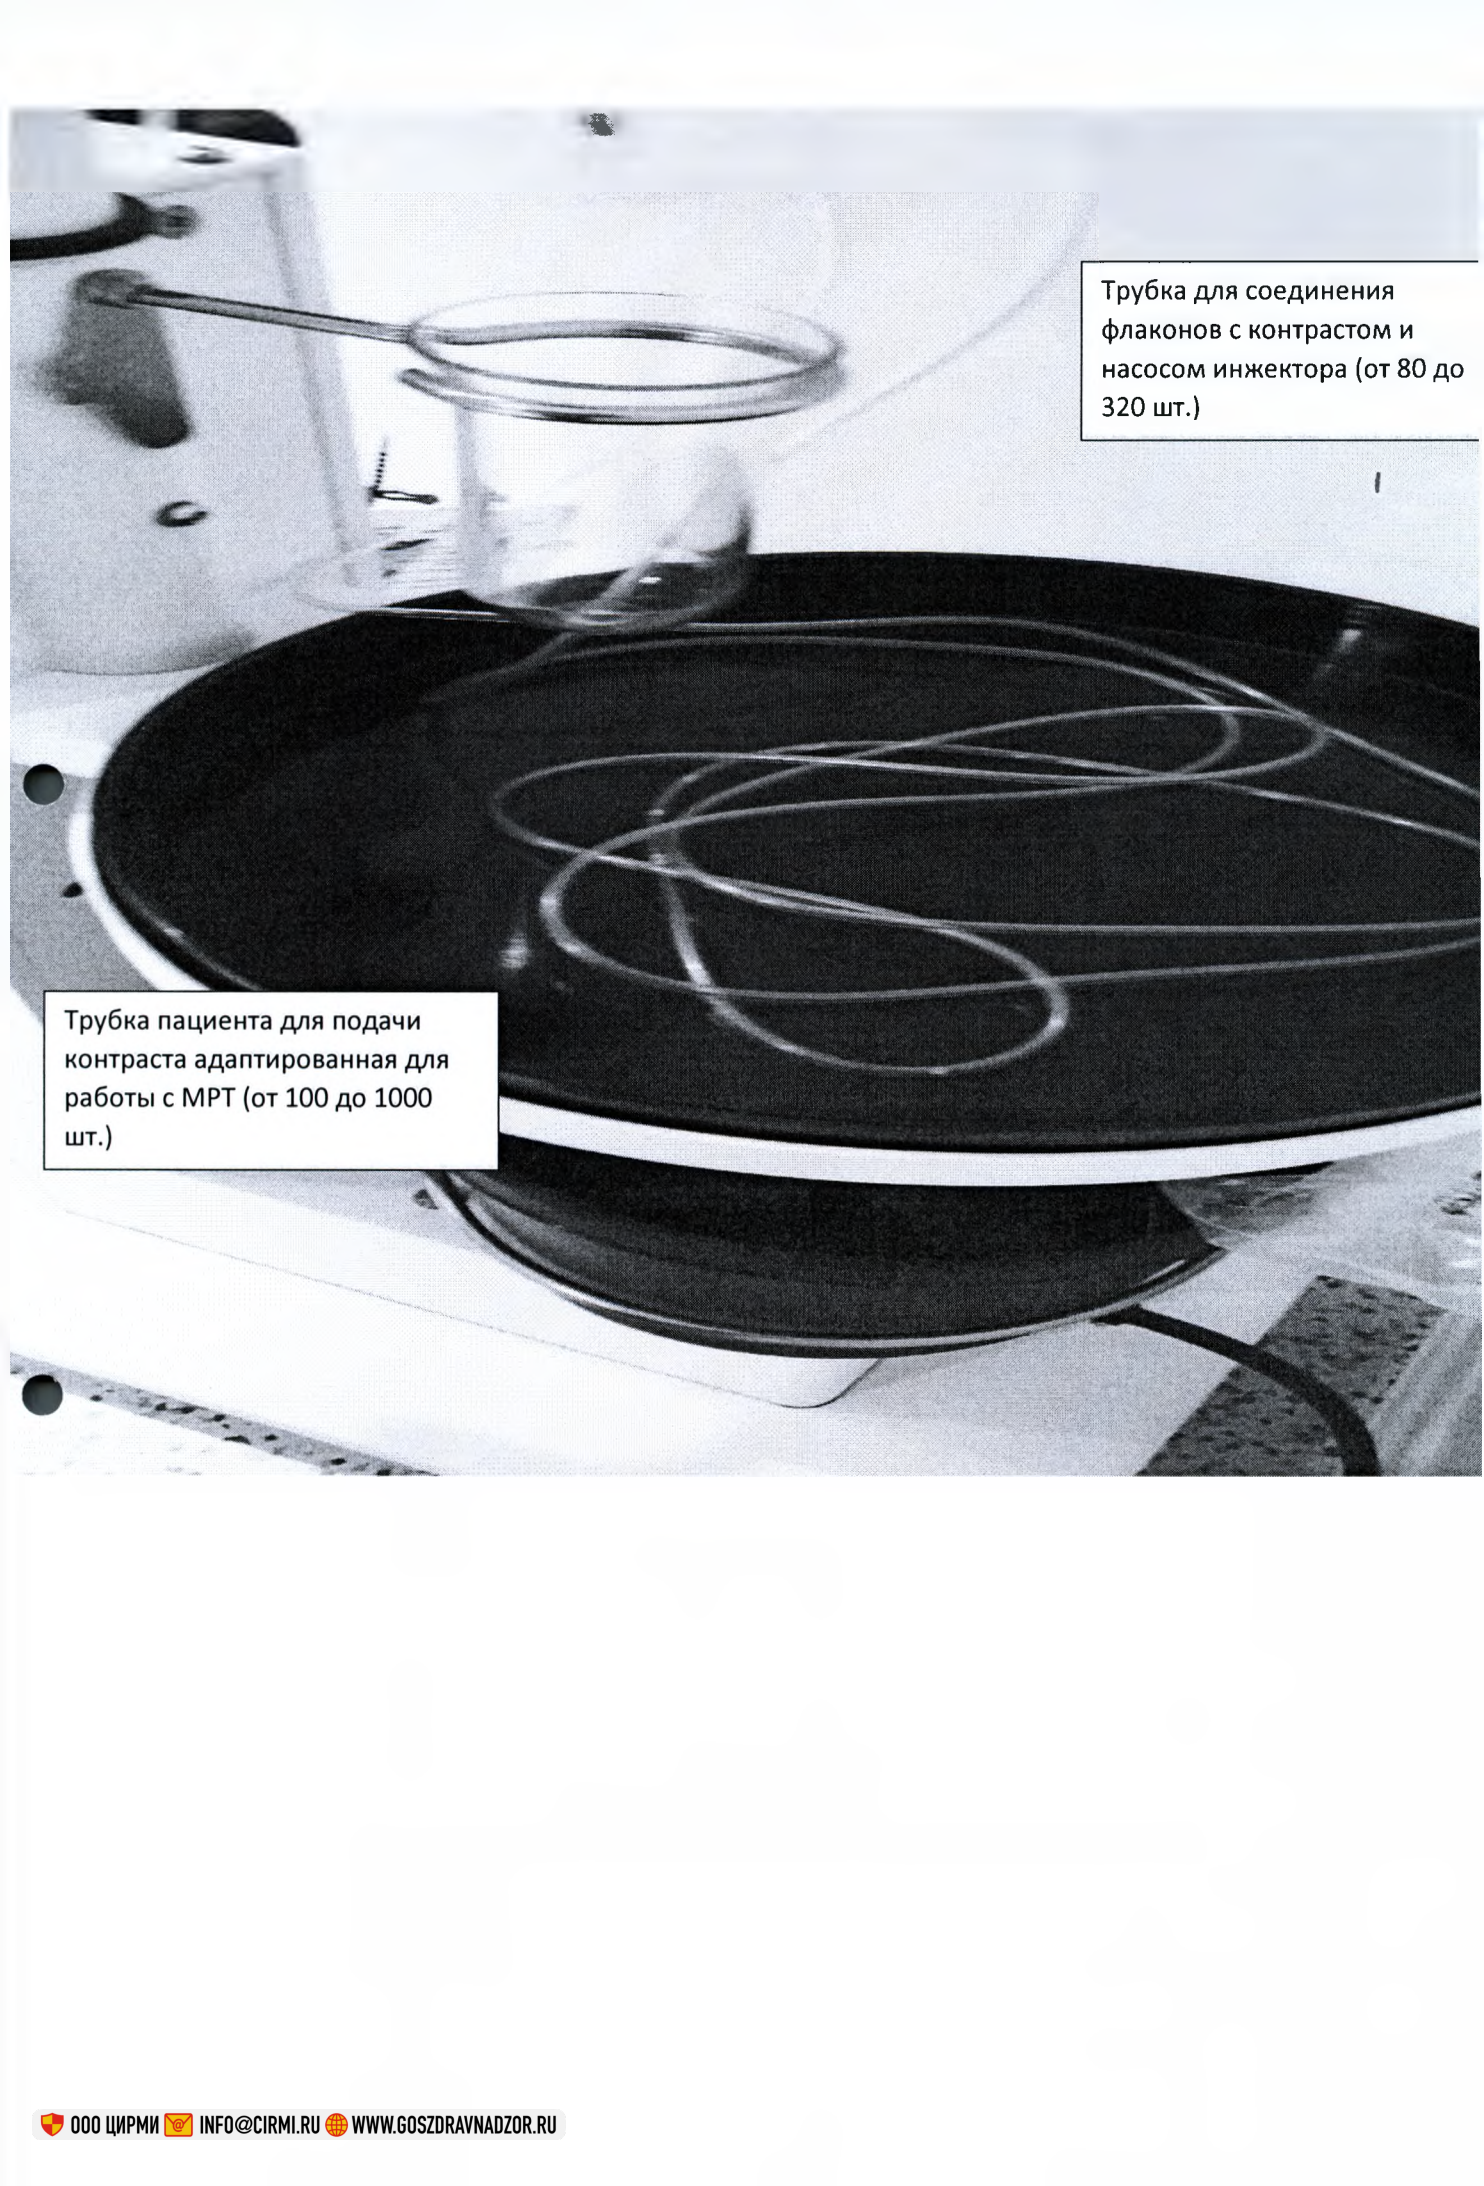




Трубка для соединения
флаконов с контрастом и
насосом инжектора (от 80 до
320 шт.)

Трубка пациента для подачи
контраста адаптированная для
работы с МРТ (от 100 до 1000
шт.)


Металлоискатель



Рабочая станция для обработки изображений
(дополнительная)

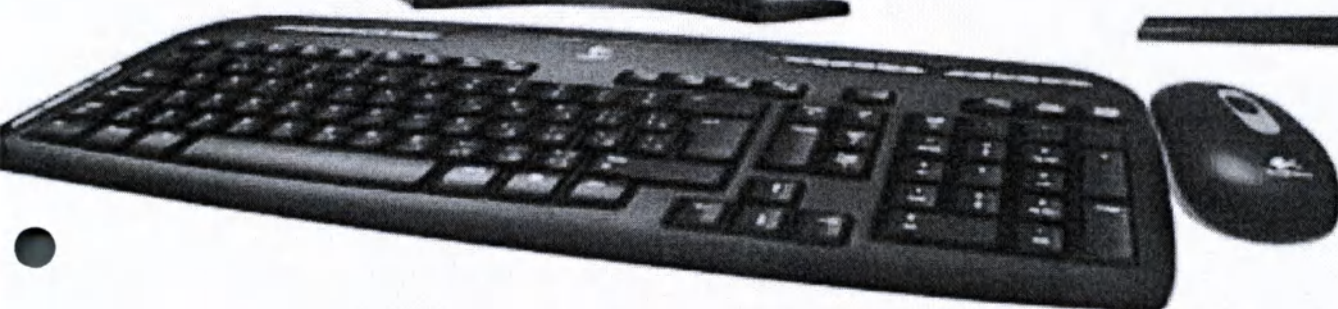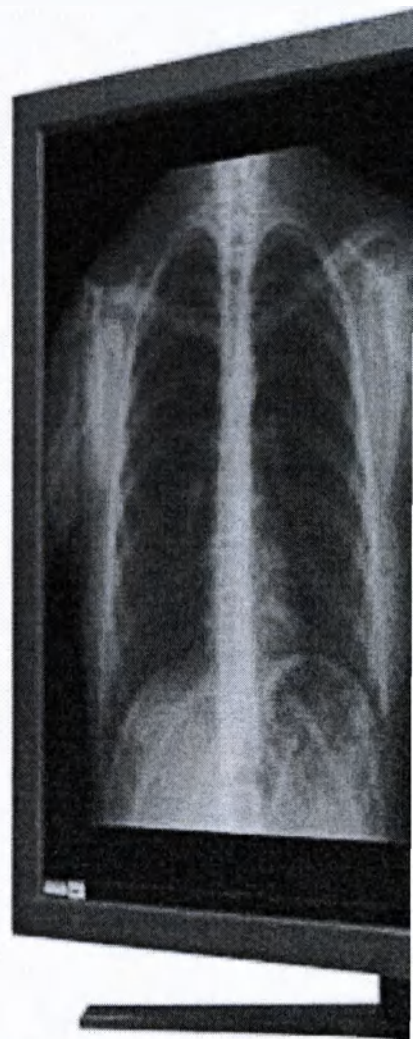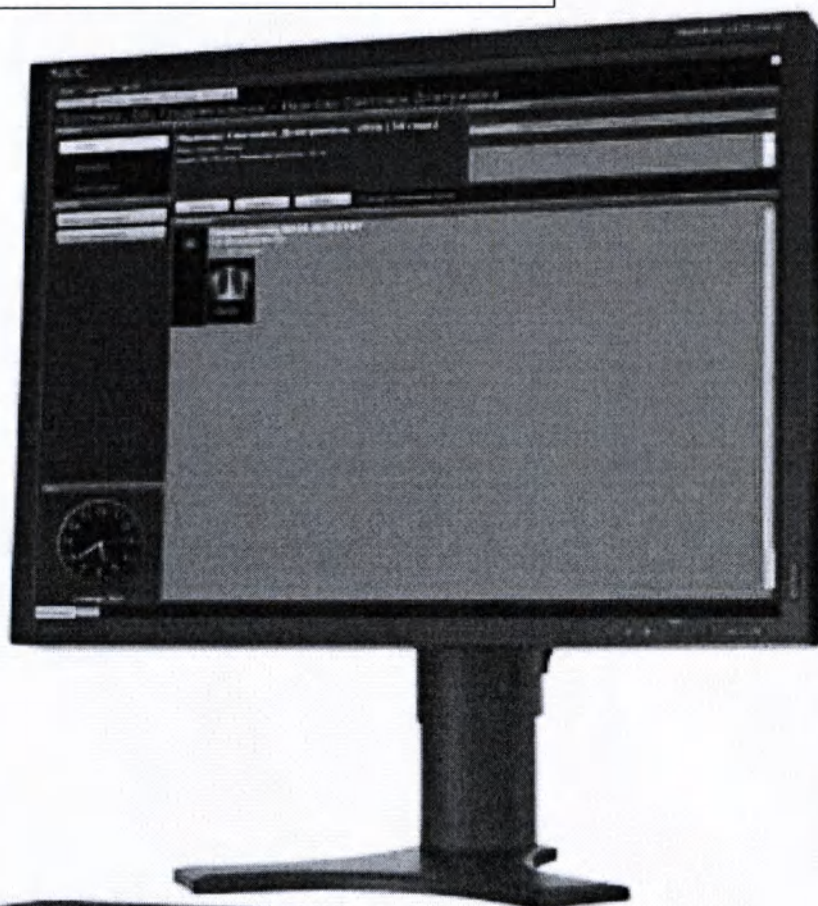

Компьютерный сервер для
радиологической информационной
системе

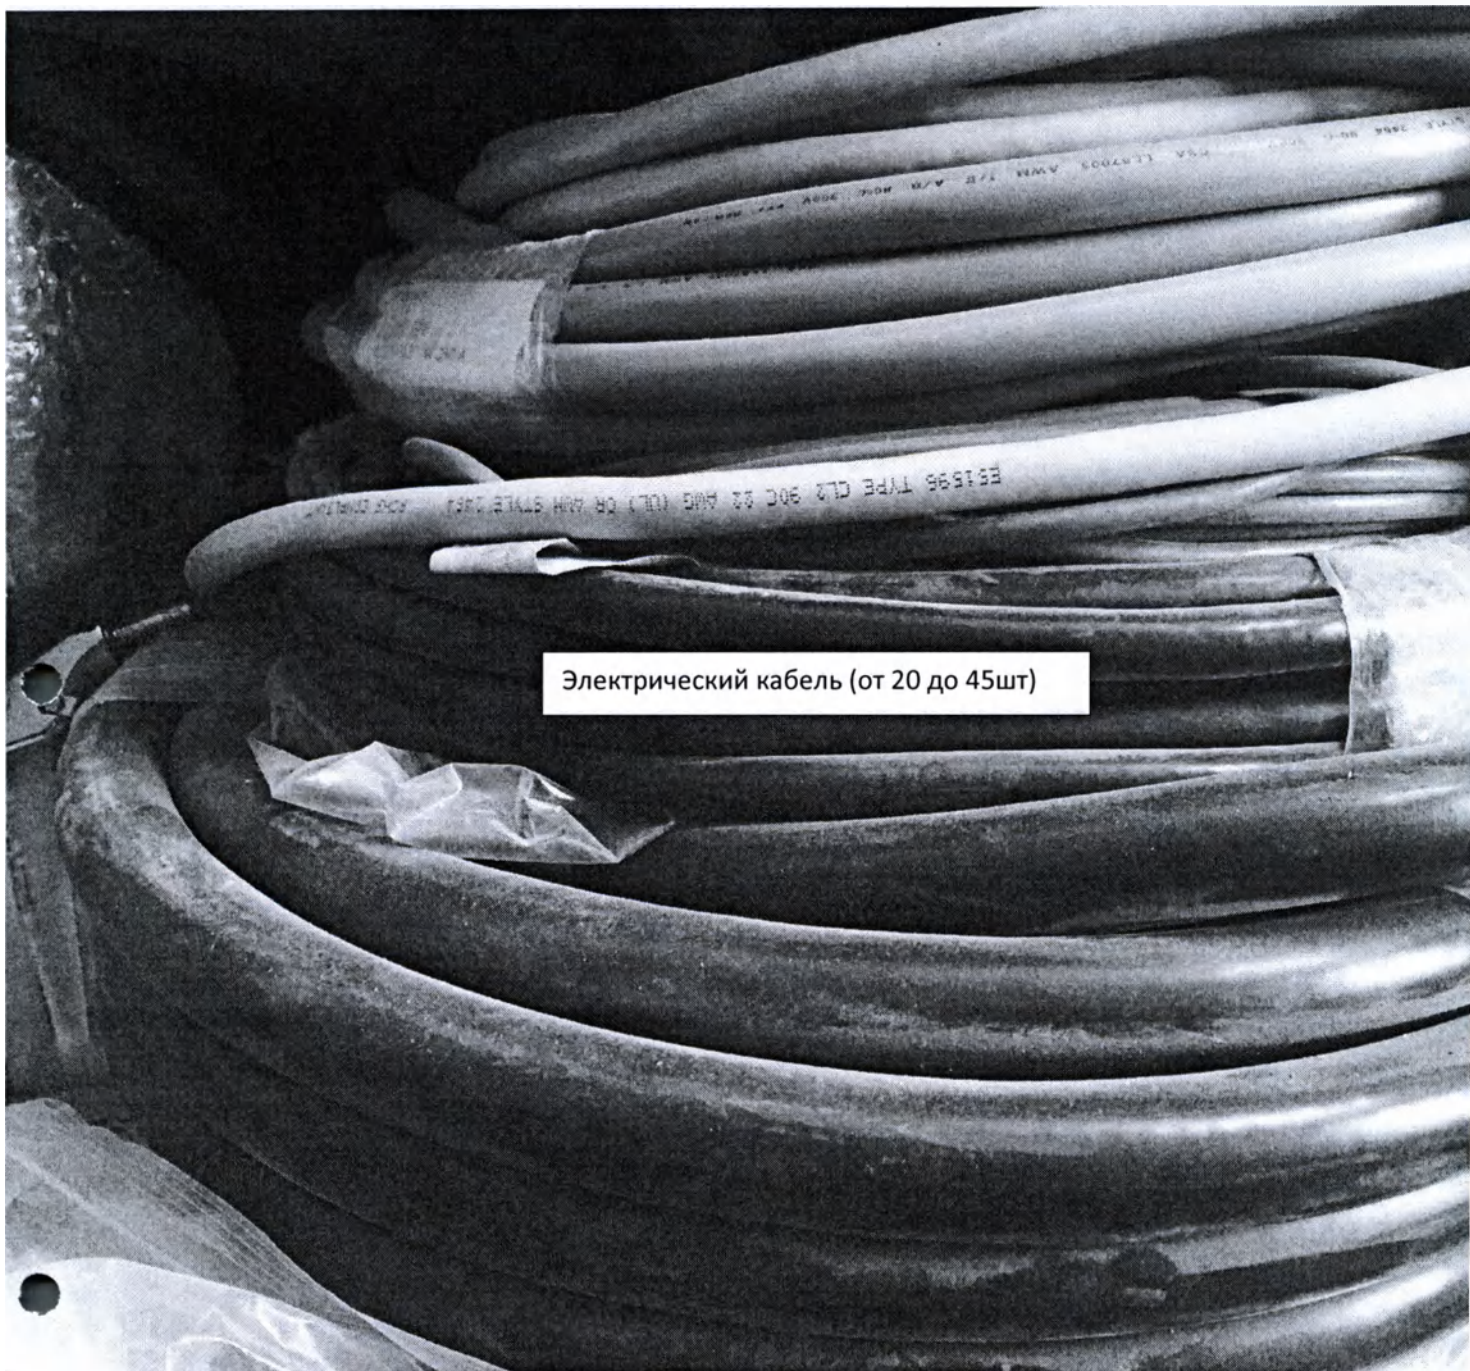

Электрический кабель (от 20 до 45шт)

Переключатель (от 10 до 20шт)

ROTOR CONTROL
6 FFB

CONTROL
5 FFB

C. MAINS
3 FFB

X-RA
2 FFB

FUJI AUTO BREAKER
EA20SB
125A
OFF
125A


XCONT5 FPGA REV


14M	11	12	13	14	15	16	17
	4	5	6	7	8	9	10
13H	11	12	13	14	15	16	17
	1	2	3	4	5	6	7
	11	12	13	14	15	16	17

XCONT5 12M B420732A

MS1 MS2 US1 US2 VS1 VS2 WS1 WS2


6 TN

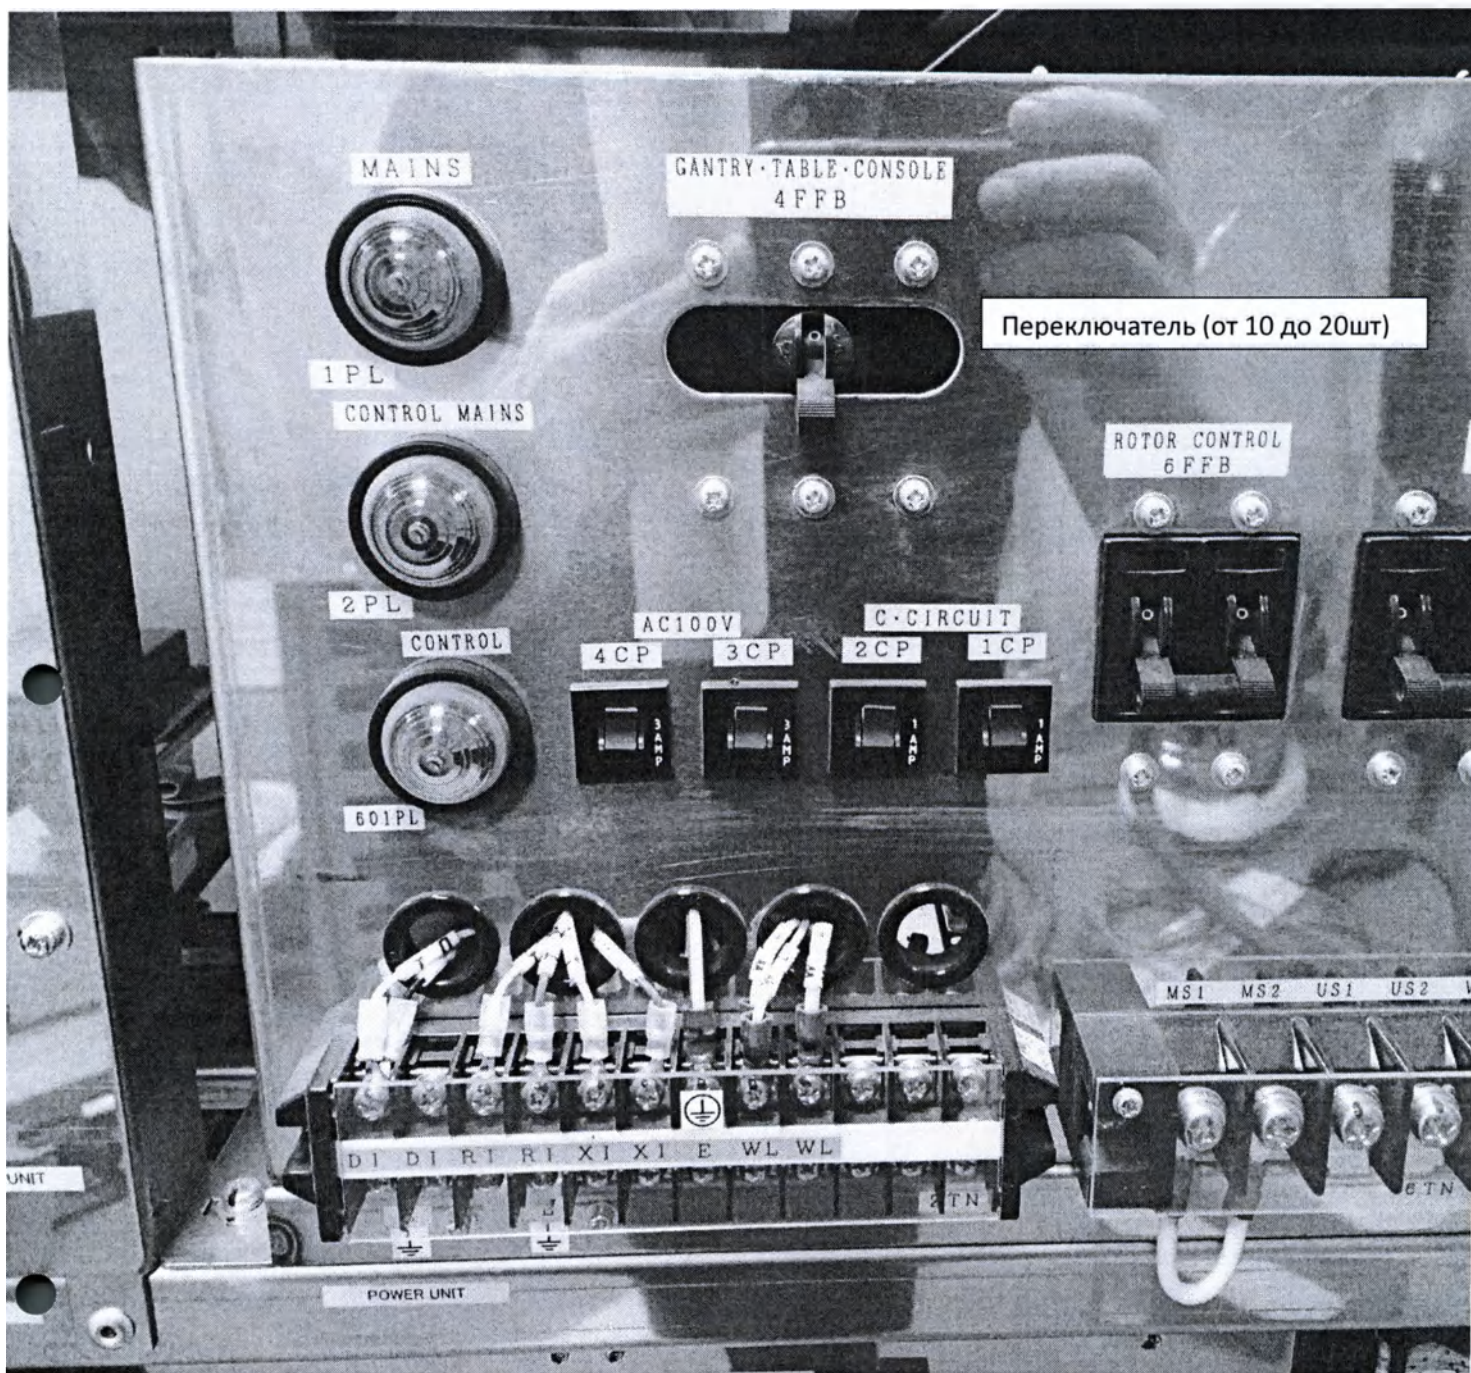

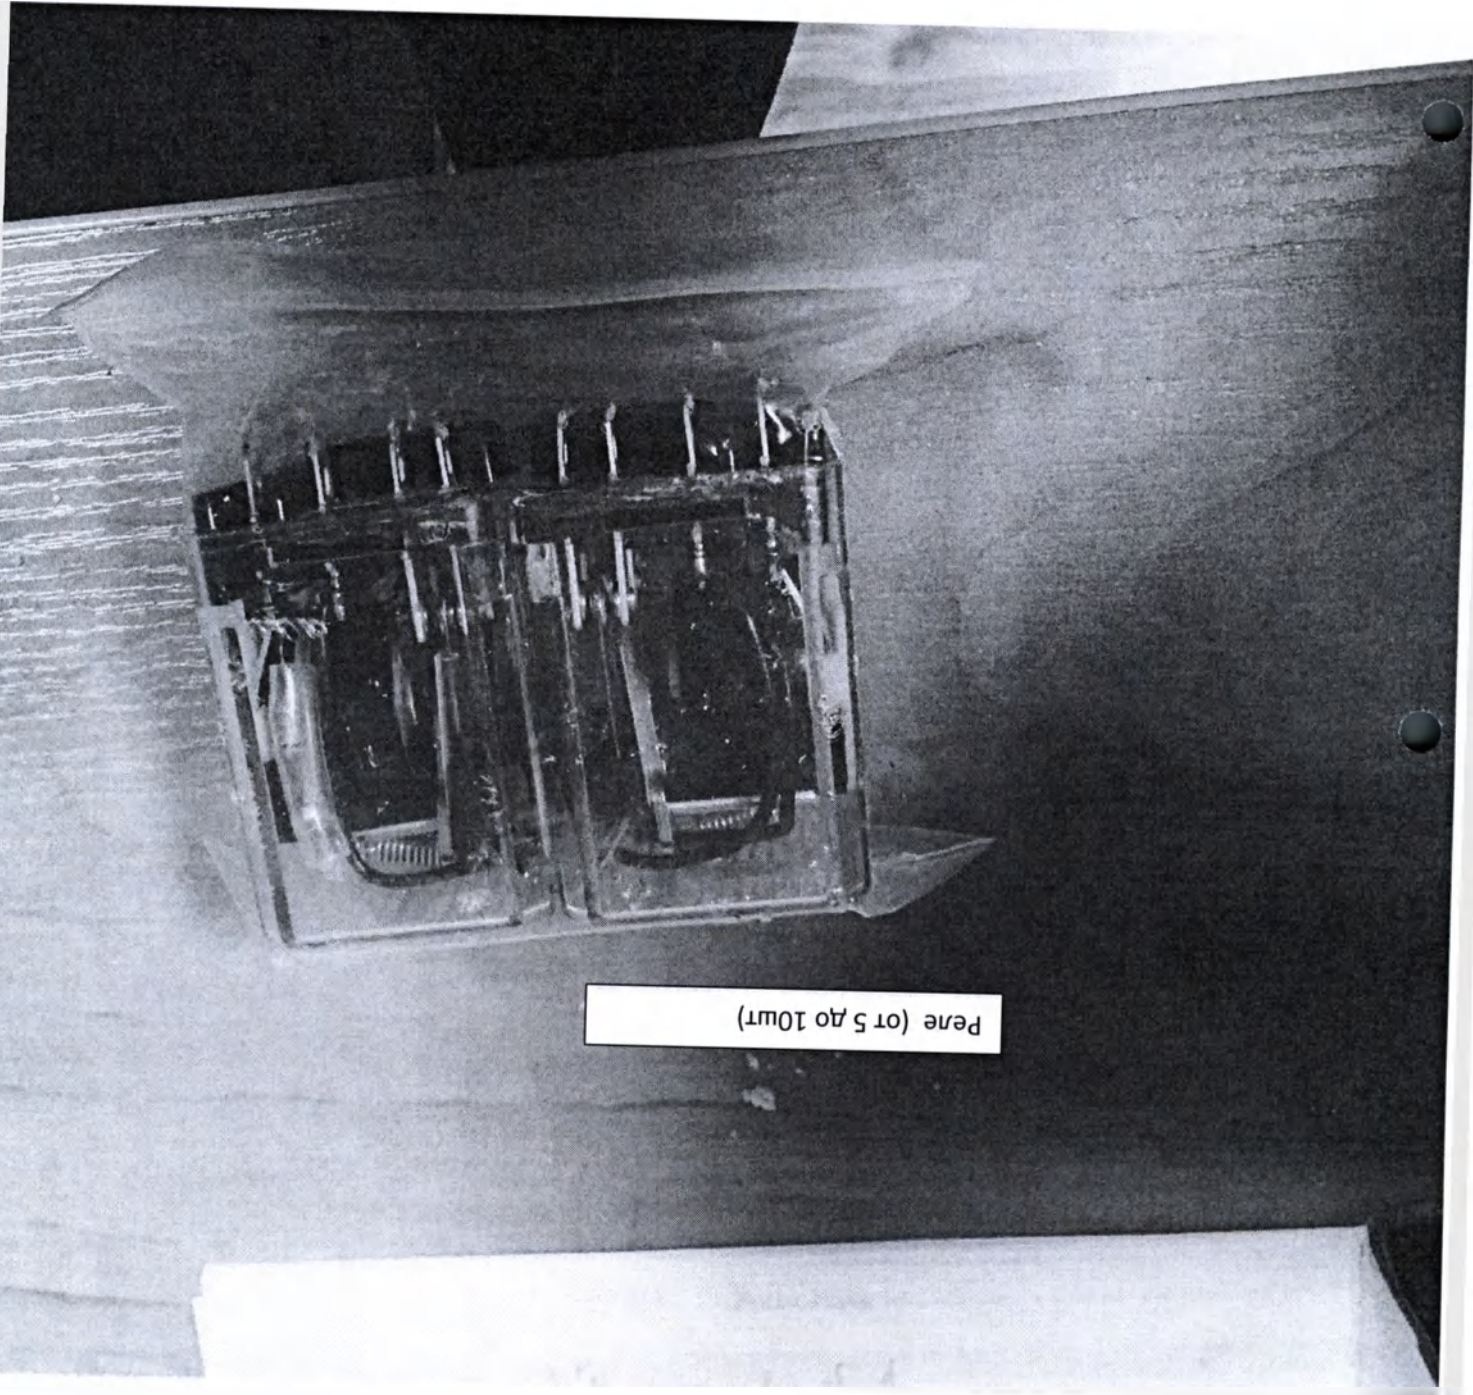


Рене (от 5 до 10шт)


Реле (от 5 до 10шт)

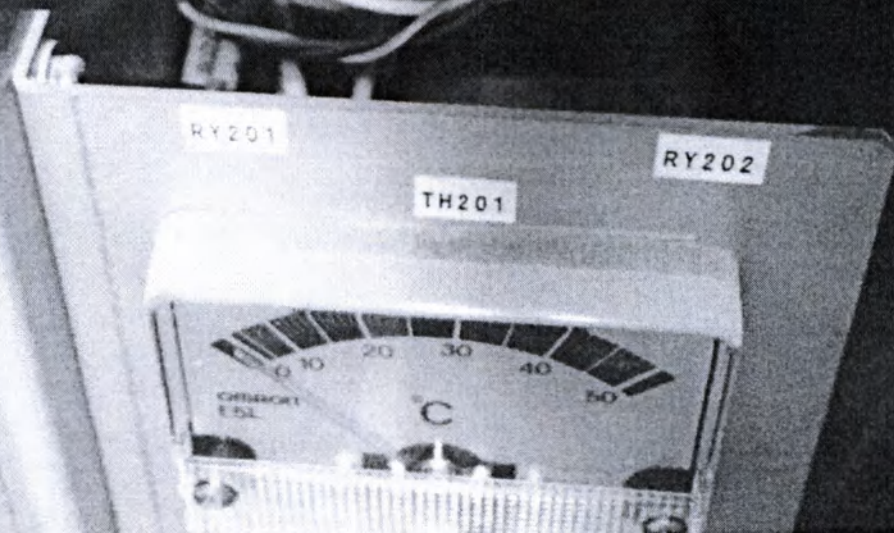

Тележка транспортировочная (от 1 до 2 шт.)

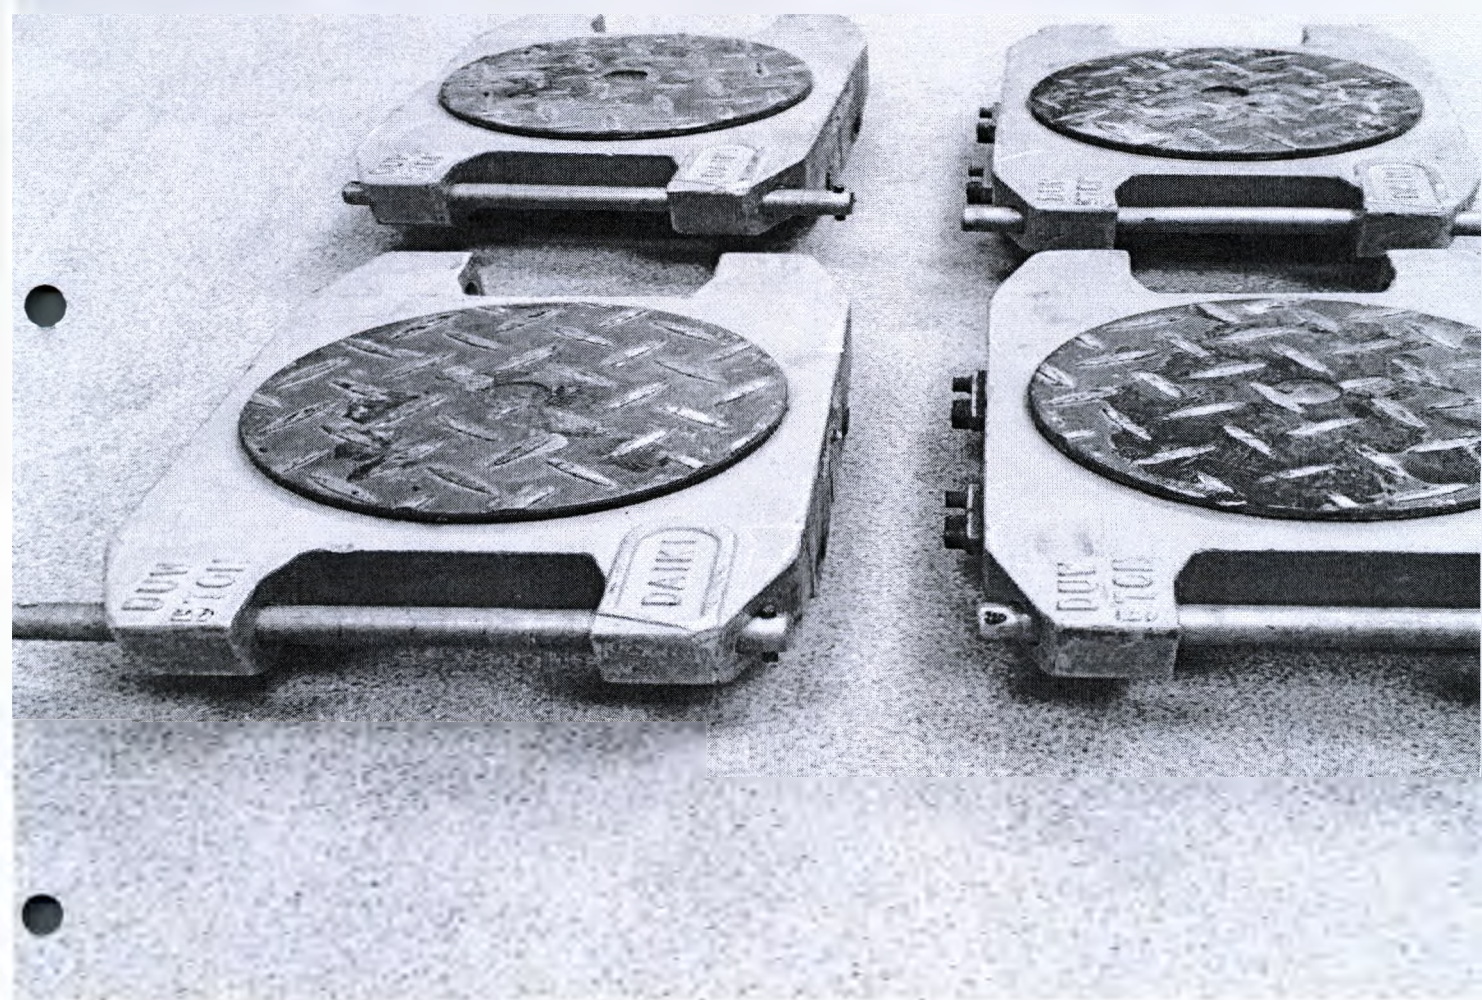


Балка
транспортировочная
(от 1 до 2 шт.)

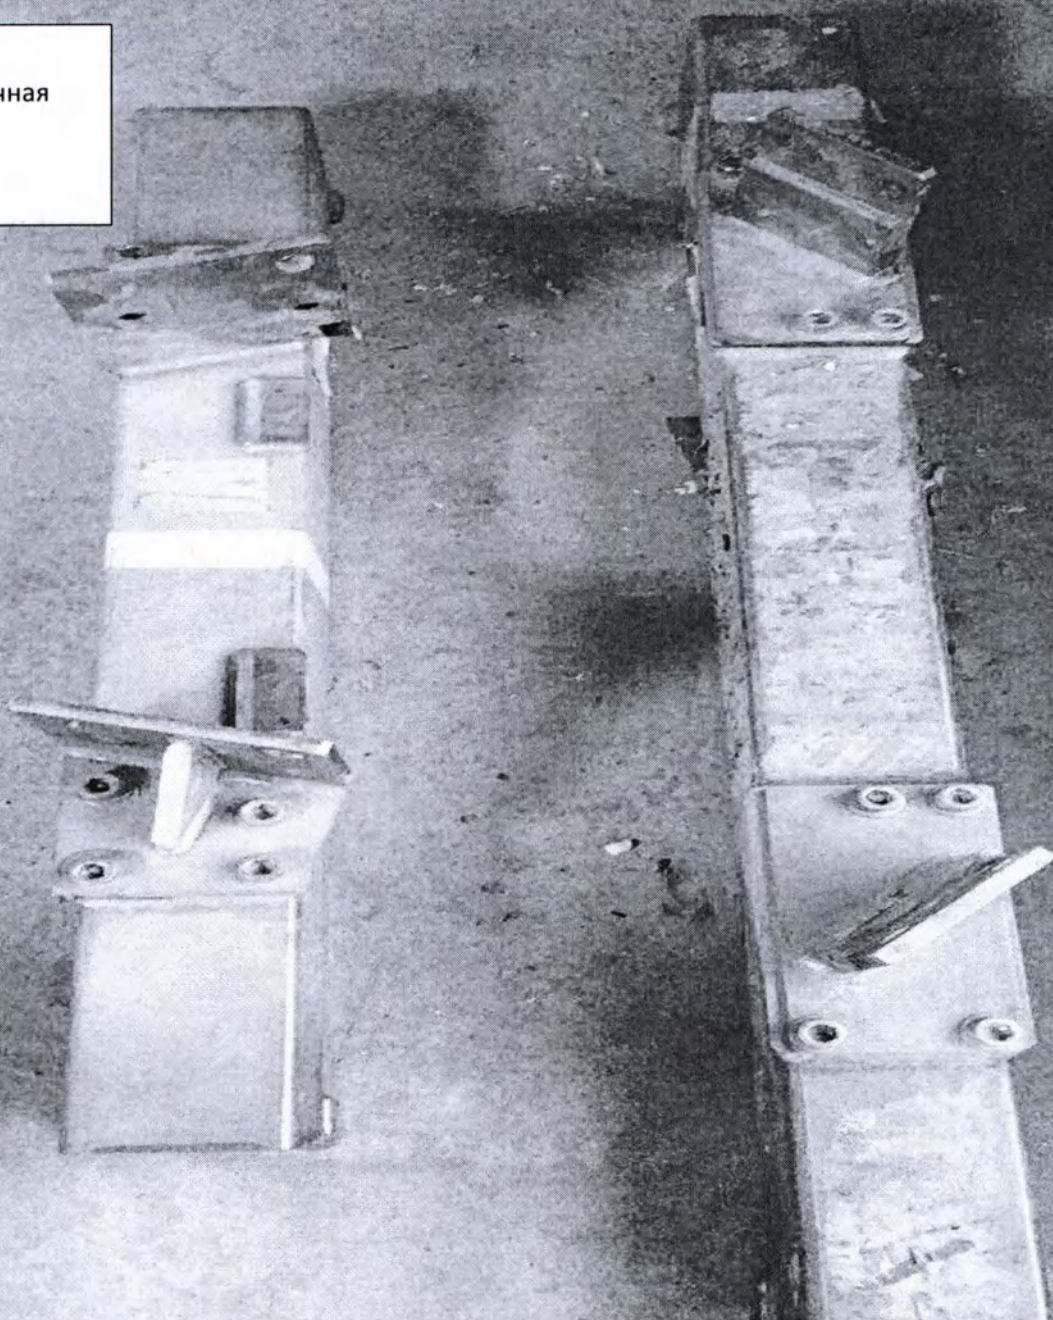


специальный немагнитный инструмент для
юнтажа магнита



специальный немагнитный инструмент для
монтажа магнита

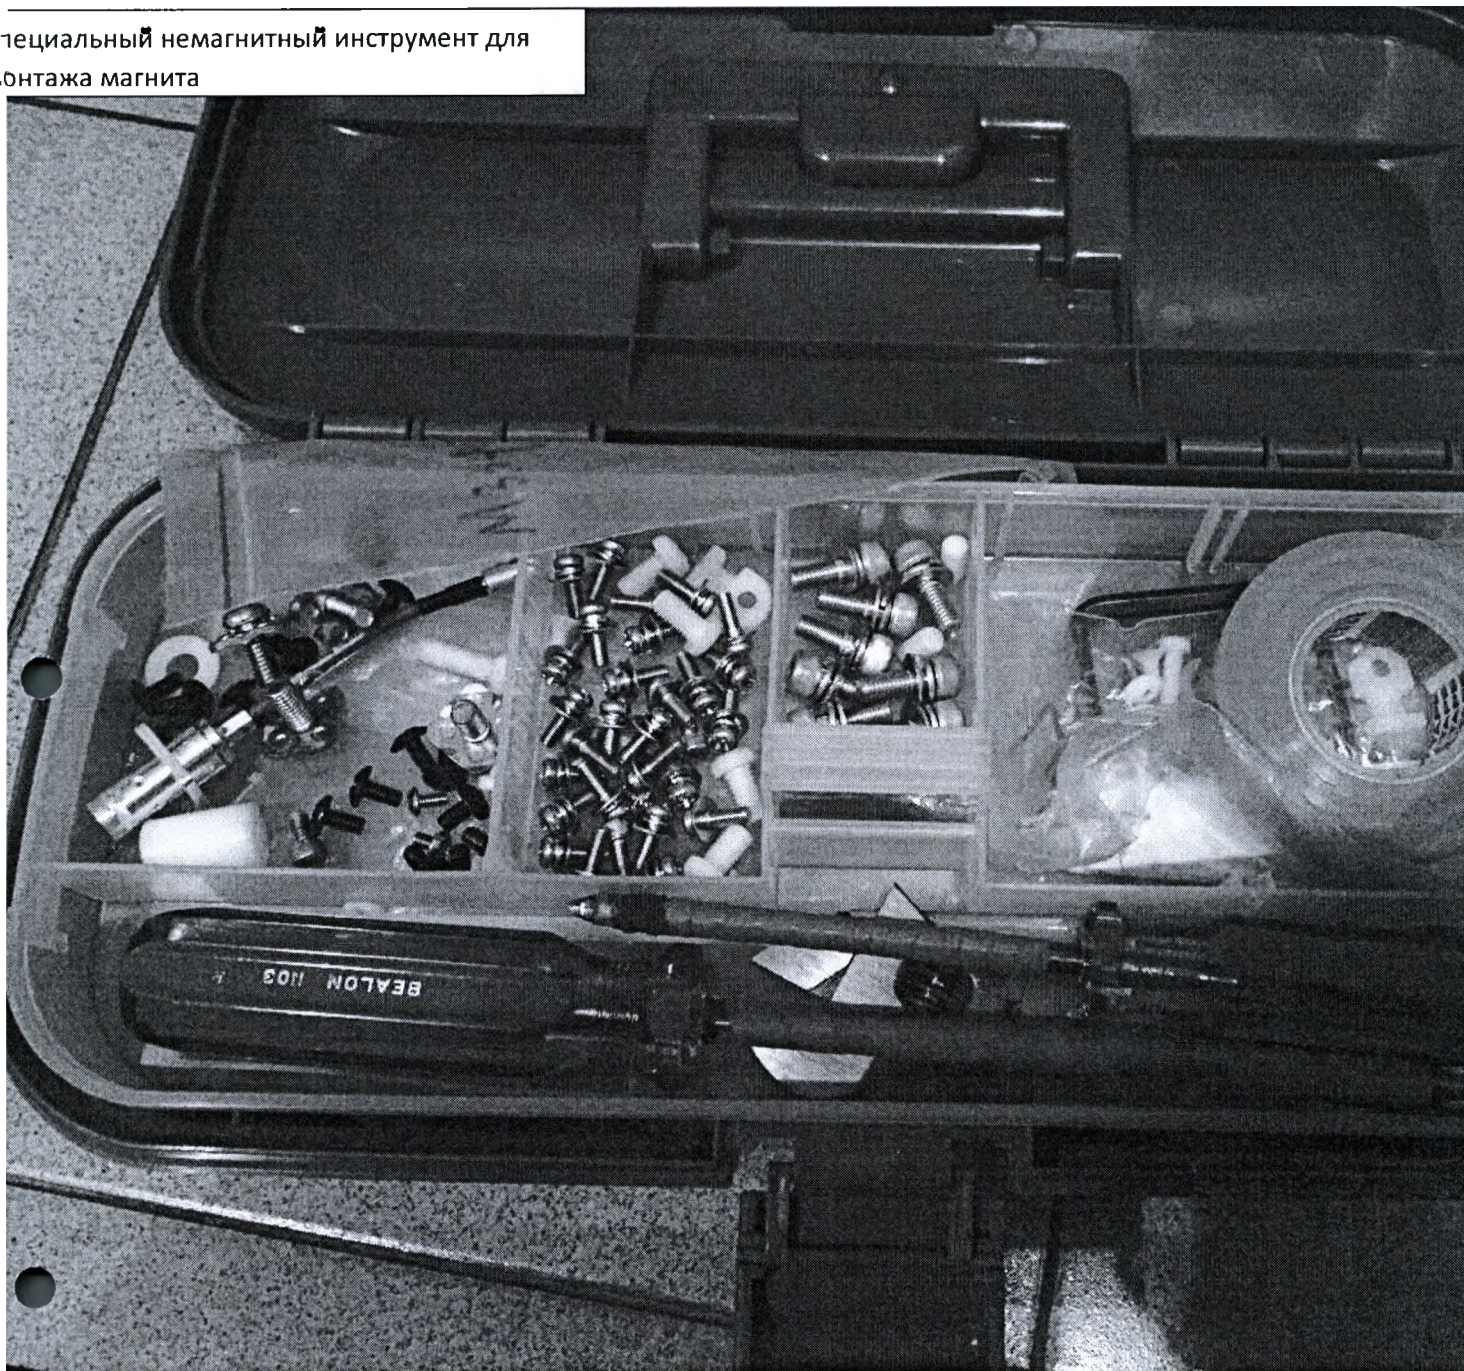

специальный немагнитный инструмент для
монтажа магнита

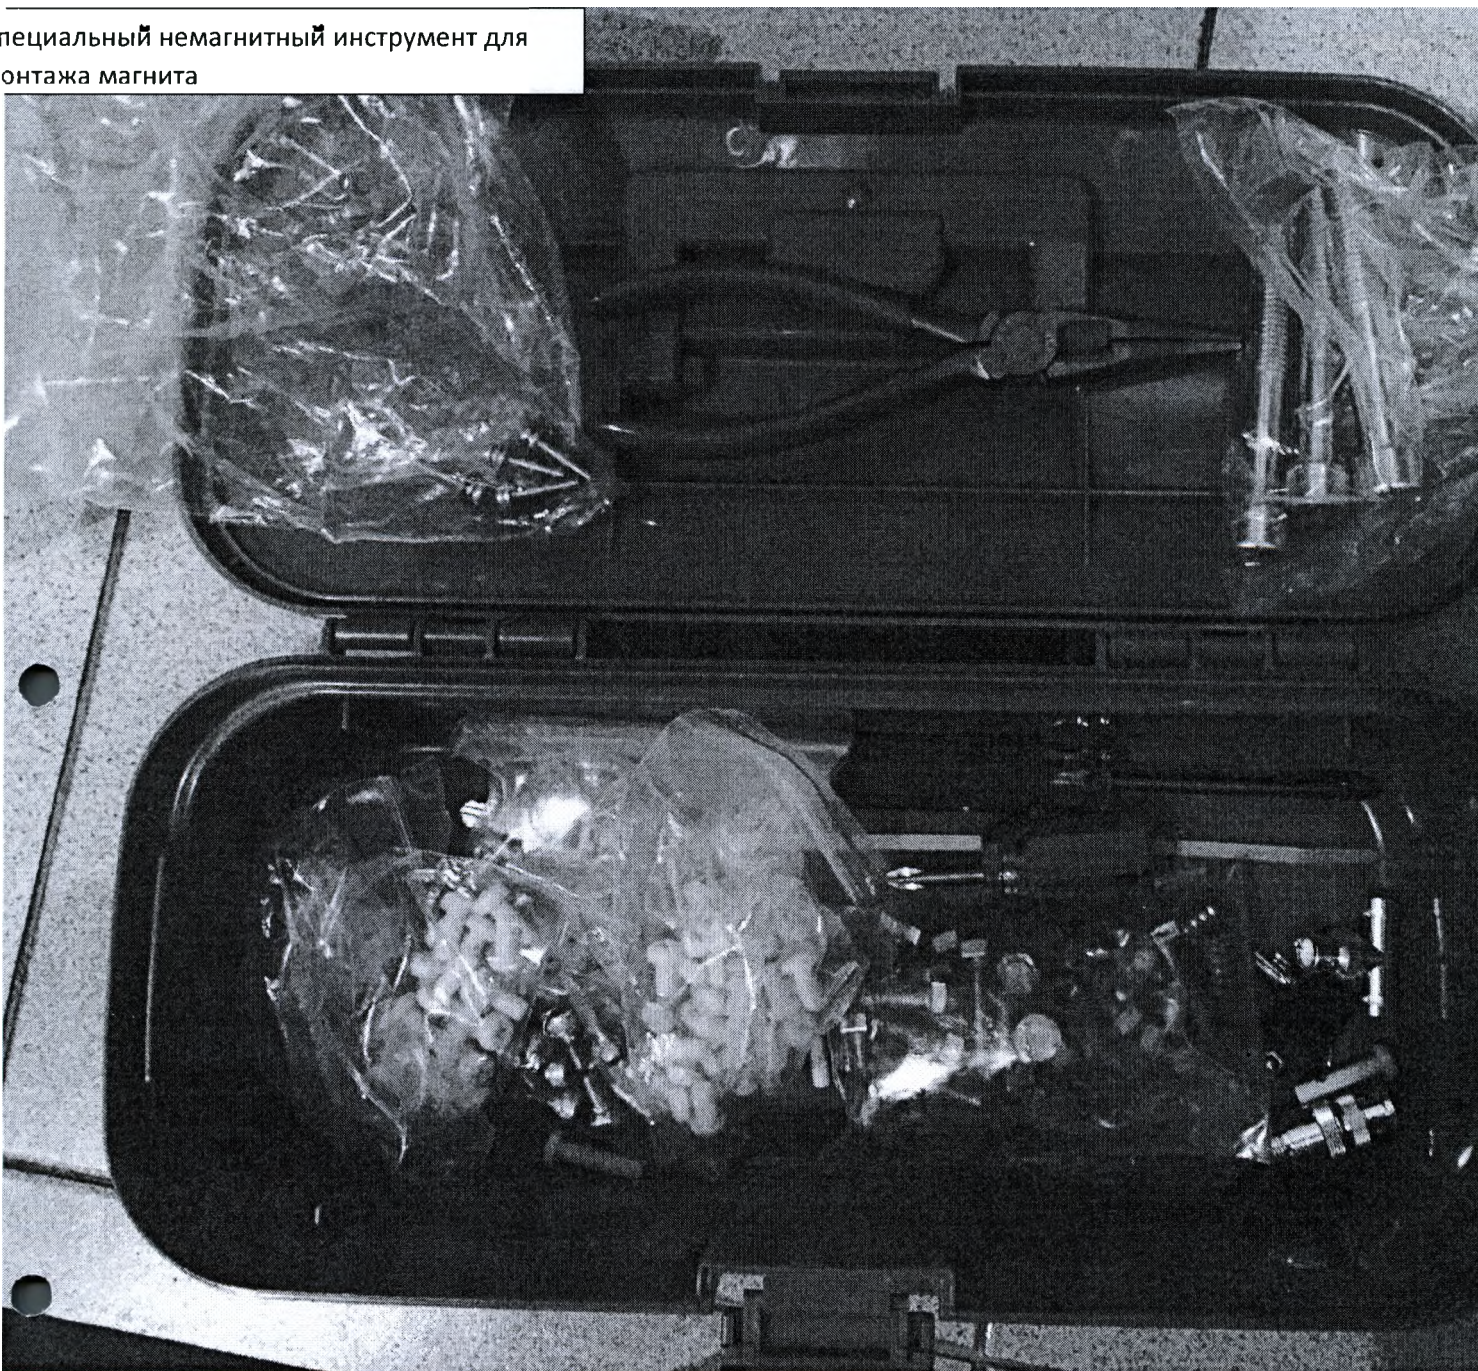

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

116 (сто шестнадцать) листа(ов)

Генеральный директор

