



Фотографические изображения медицинского изделия

Программное обеспечение для внешней рабочей станции для хранения, обработки и анализа ультразвуковых данных EchoPAC Software Only с принадлежностями


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель центра
регистрации и сертификации Россия и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»

А.П. Харитонова

2021 г.



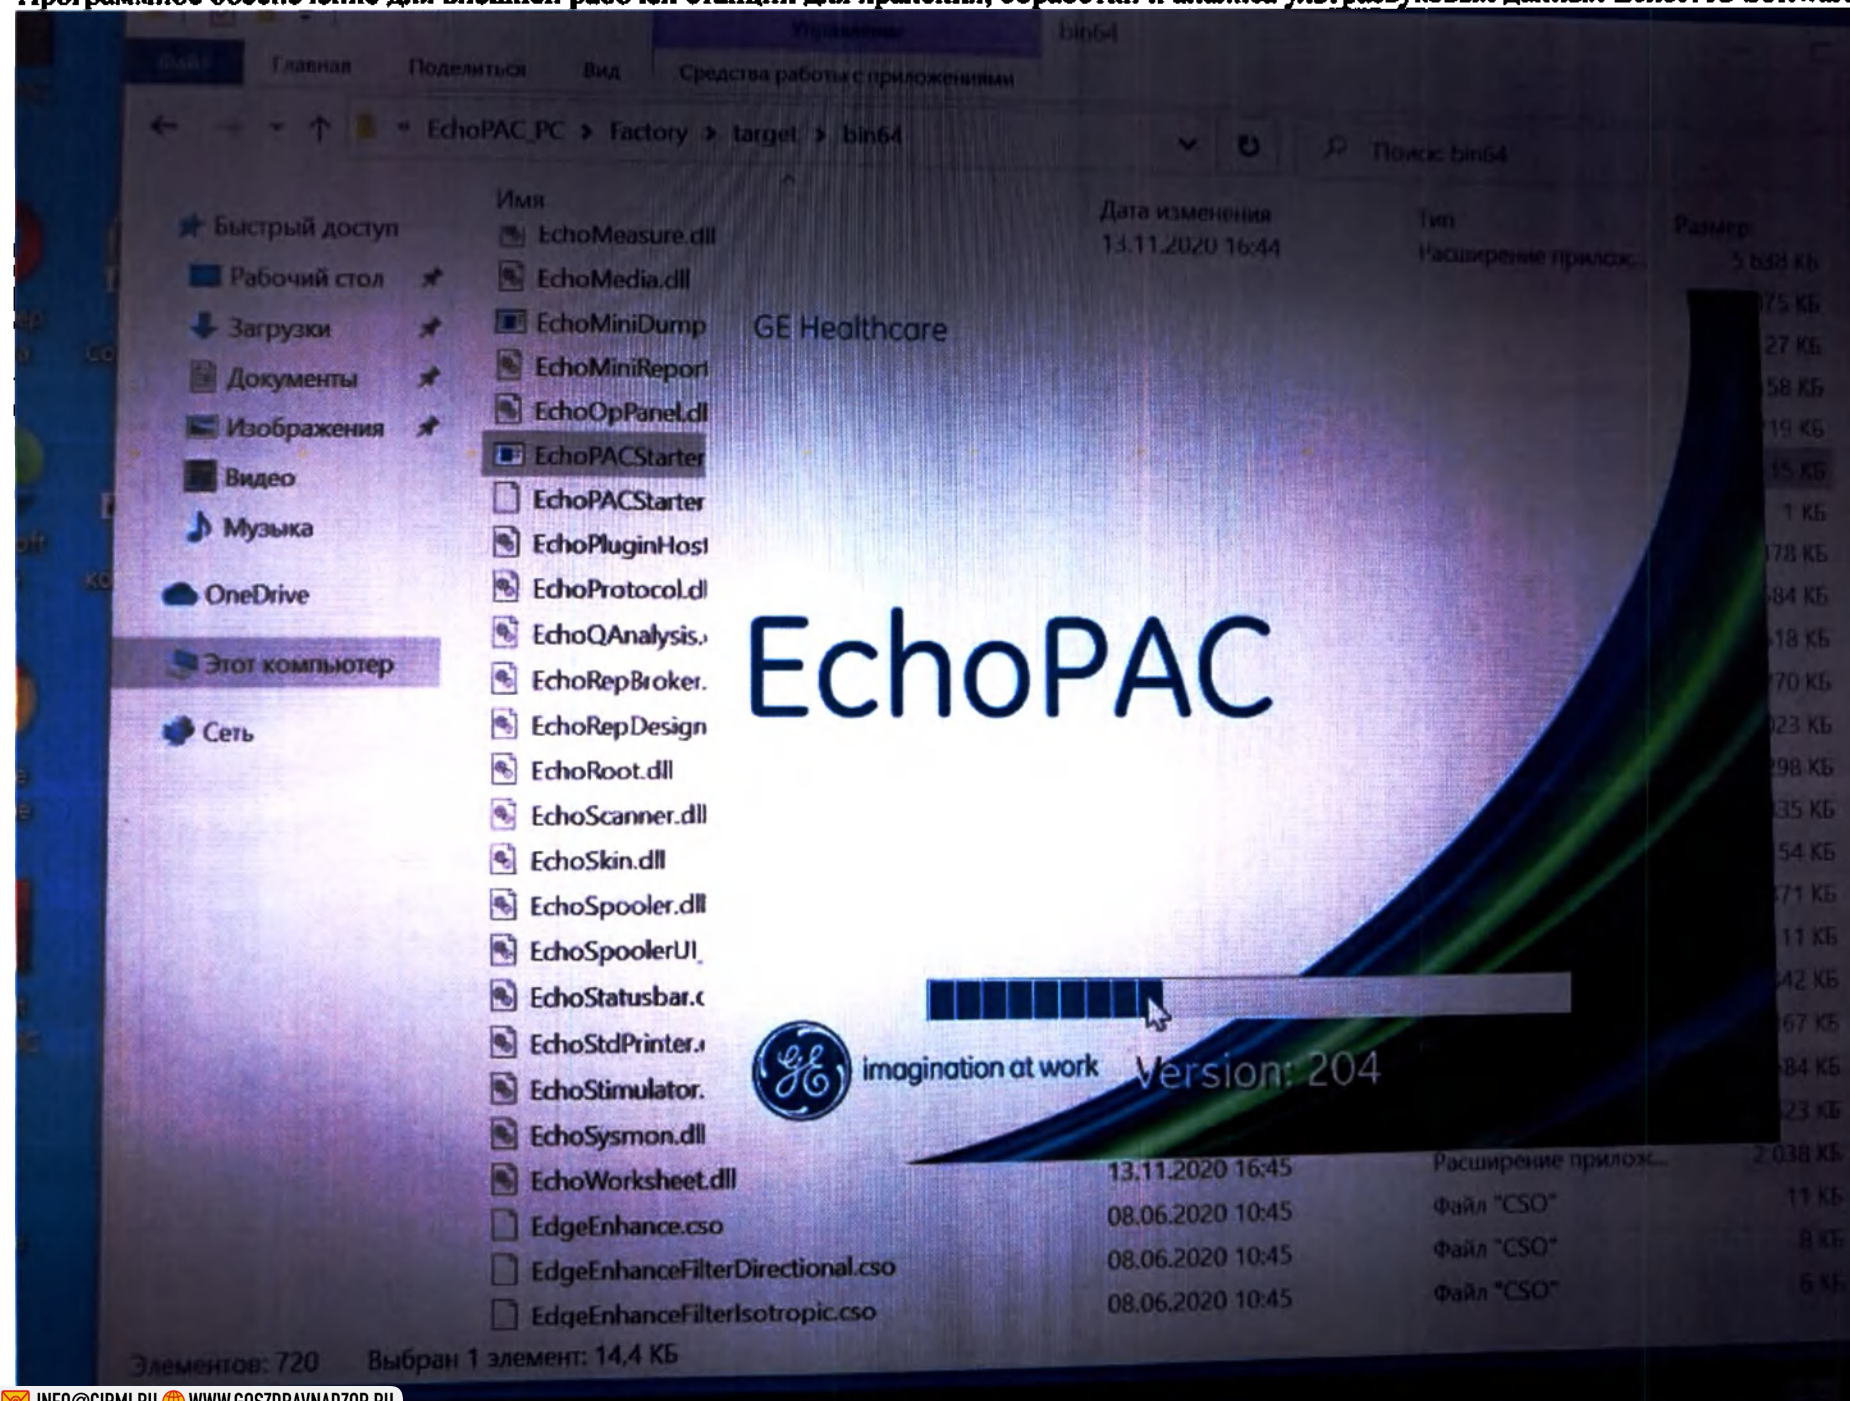



Этикетка изделия

EchoPAC Software Only



REF EchoPAC Software Only v204

LOT EPSWOv204R57.0


UDI (01) 00840682146883 (10) EPSWOv204R57.0




GE Vingmed Ultrasound AS
Strandpromenaden 45, 3191 Horten, Norway



2021-02



Закреть

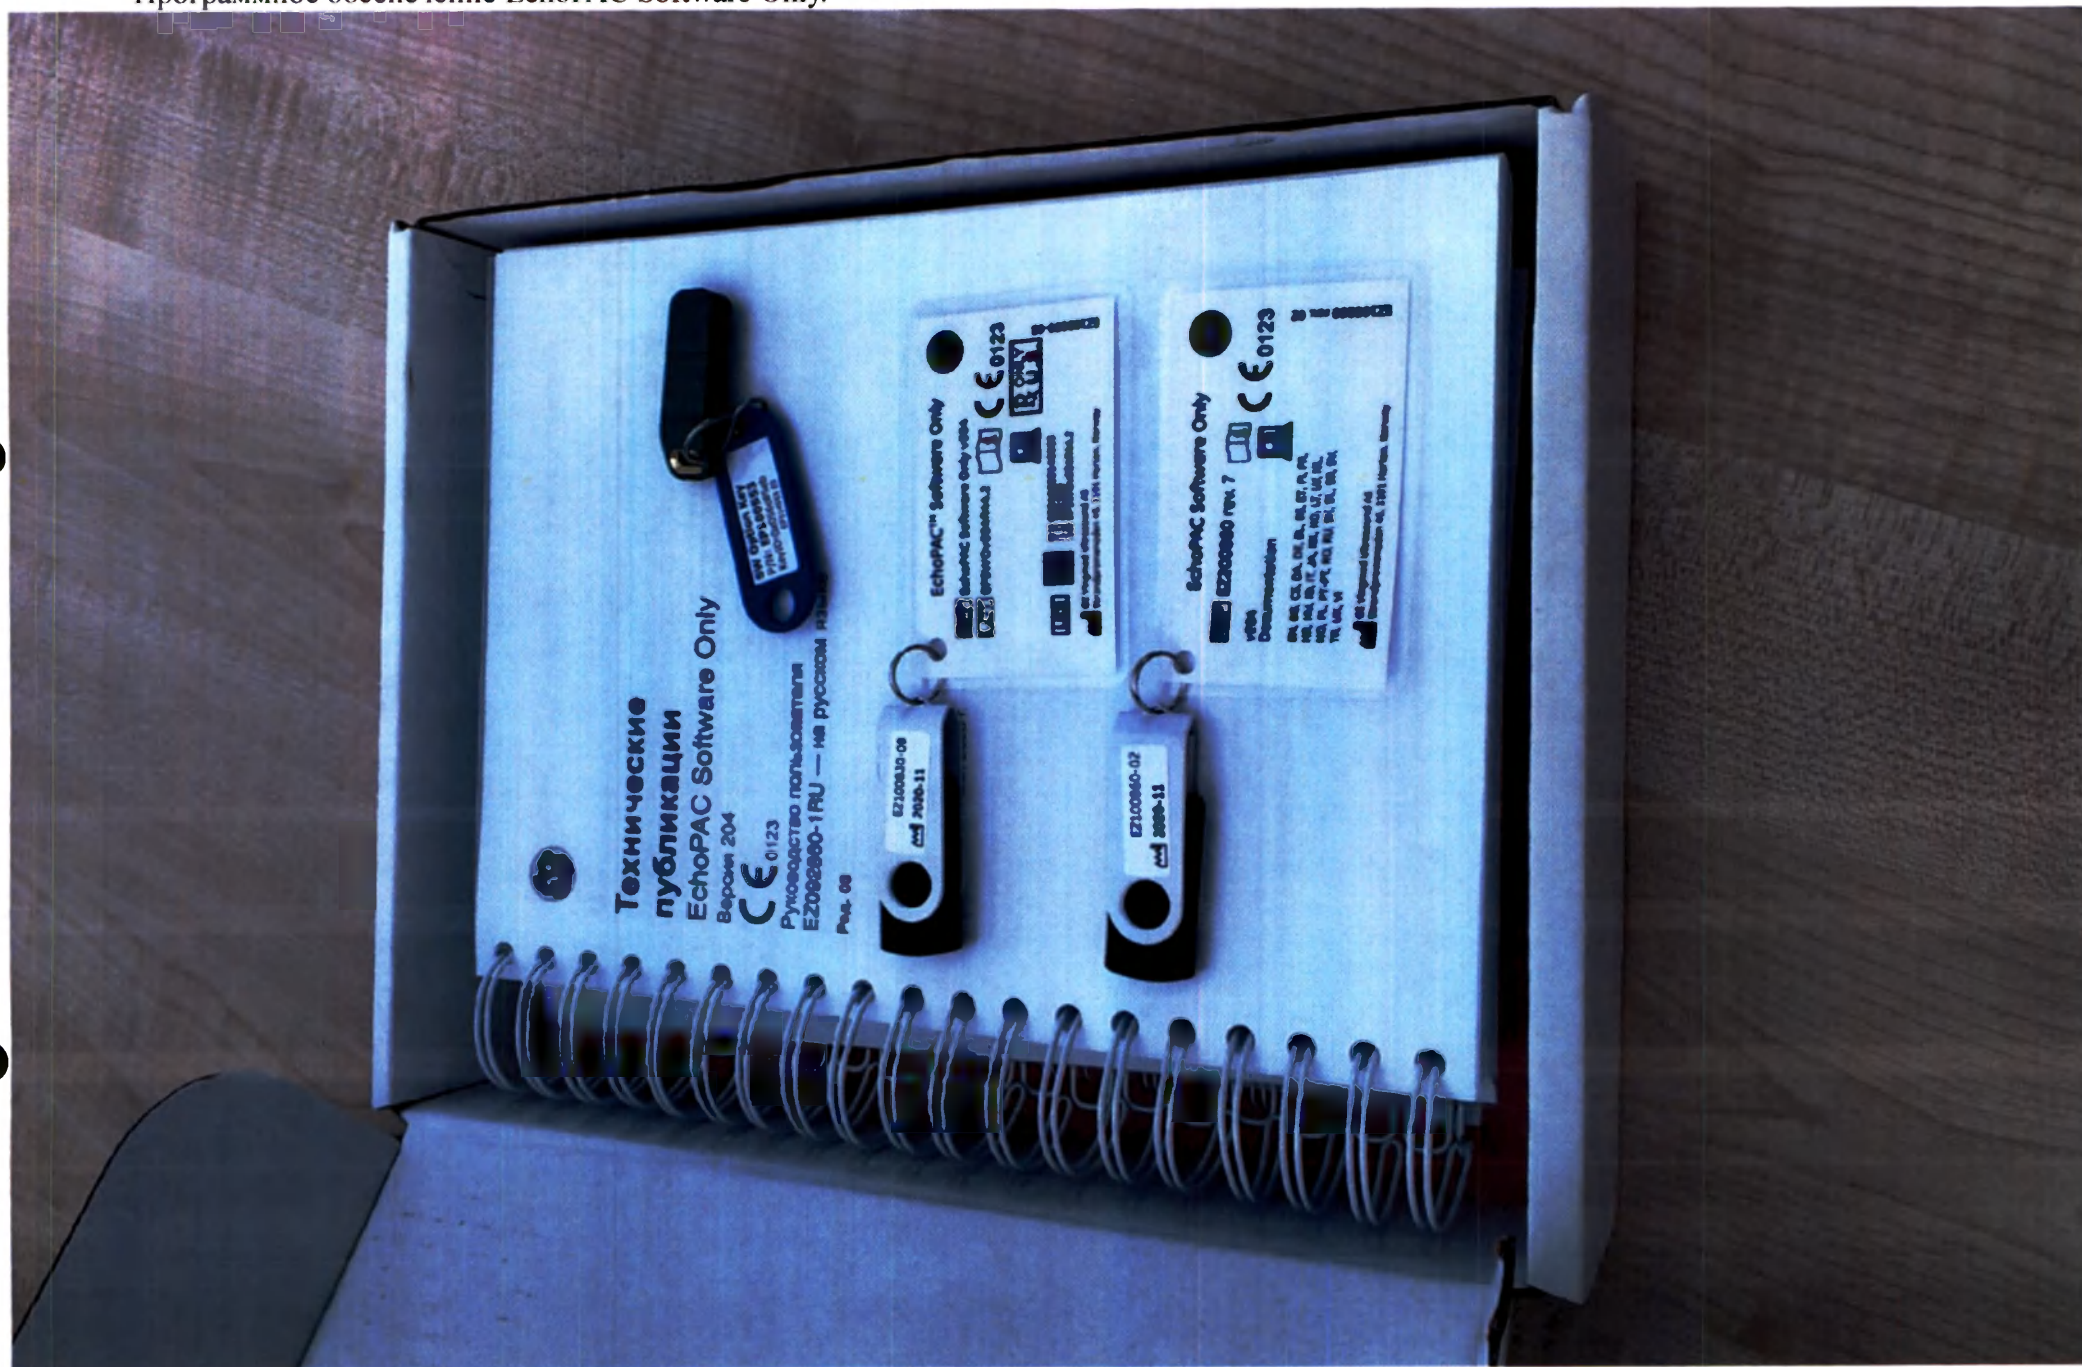


GE Healthcare




Activation Codes
PN 2394558


Activation Code Summary Sheet

Serial Number	: 0X056C85EB
Model	: EchoPac Software Only
Version Number	: v204
Software Extension	: N/A
Codes Generated	: FEB 26, 2021
Permanent Code(s)	: 7YWGQ-%UCCT-FYX24-A9N4F-Q7JMM
Demo Code(s)	: LPNFP-WR4VJ-DLU&B-A?MJR-ZVV2F

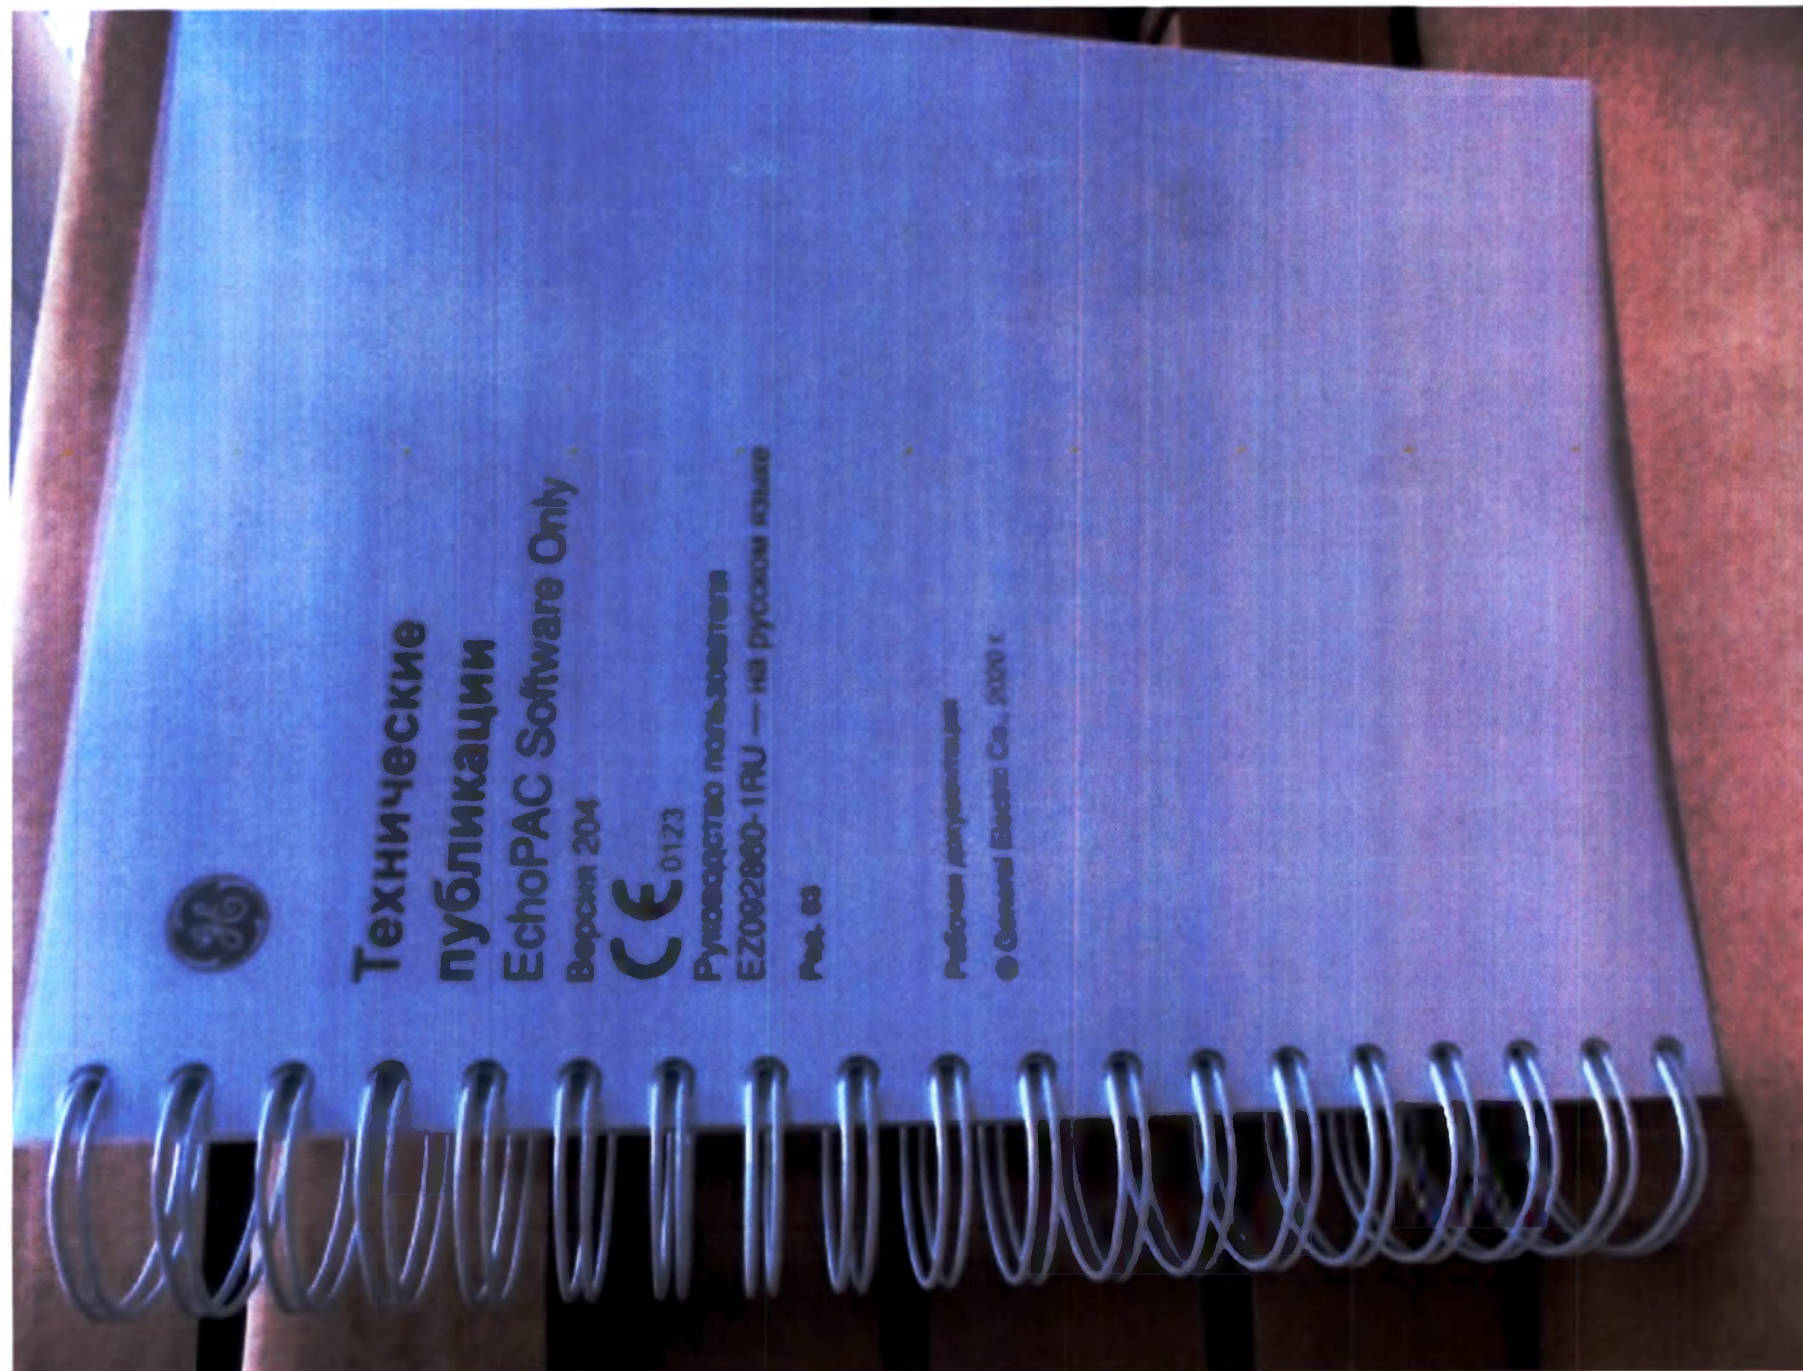

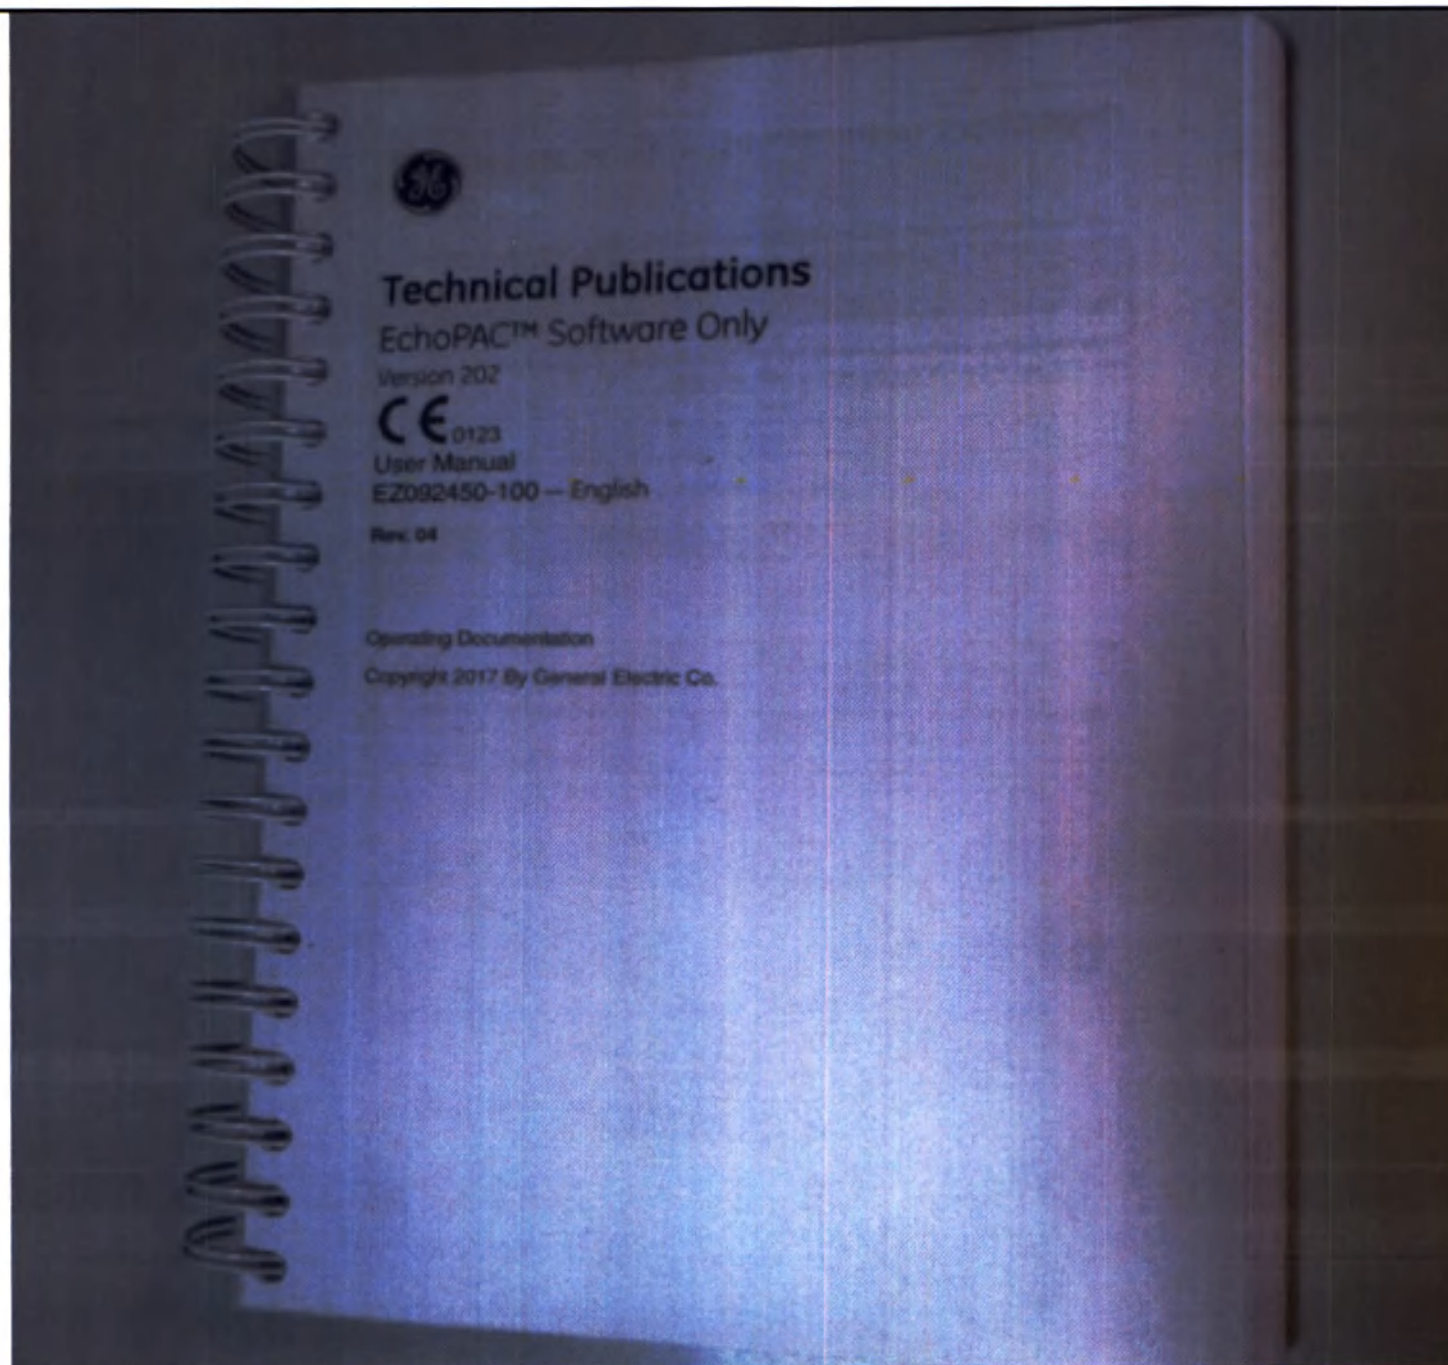

Расширенное справочное руководство на английском языке.

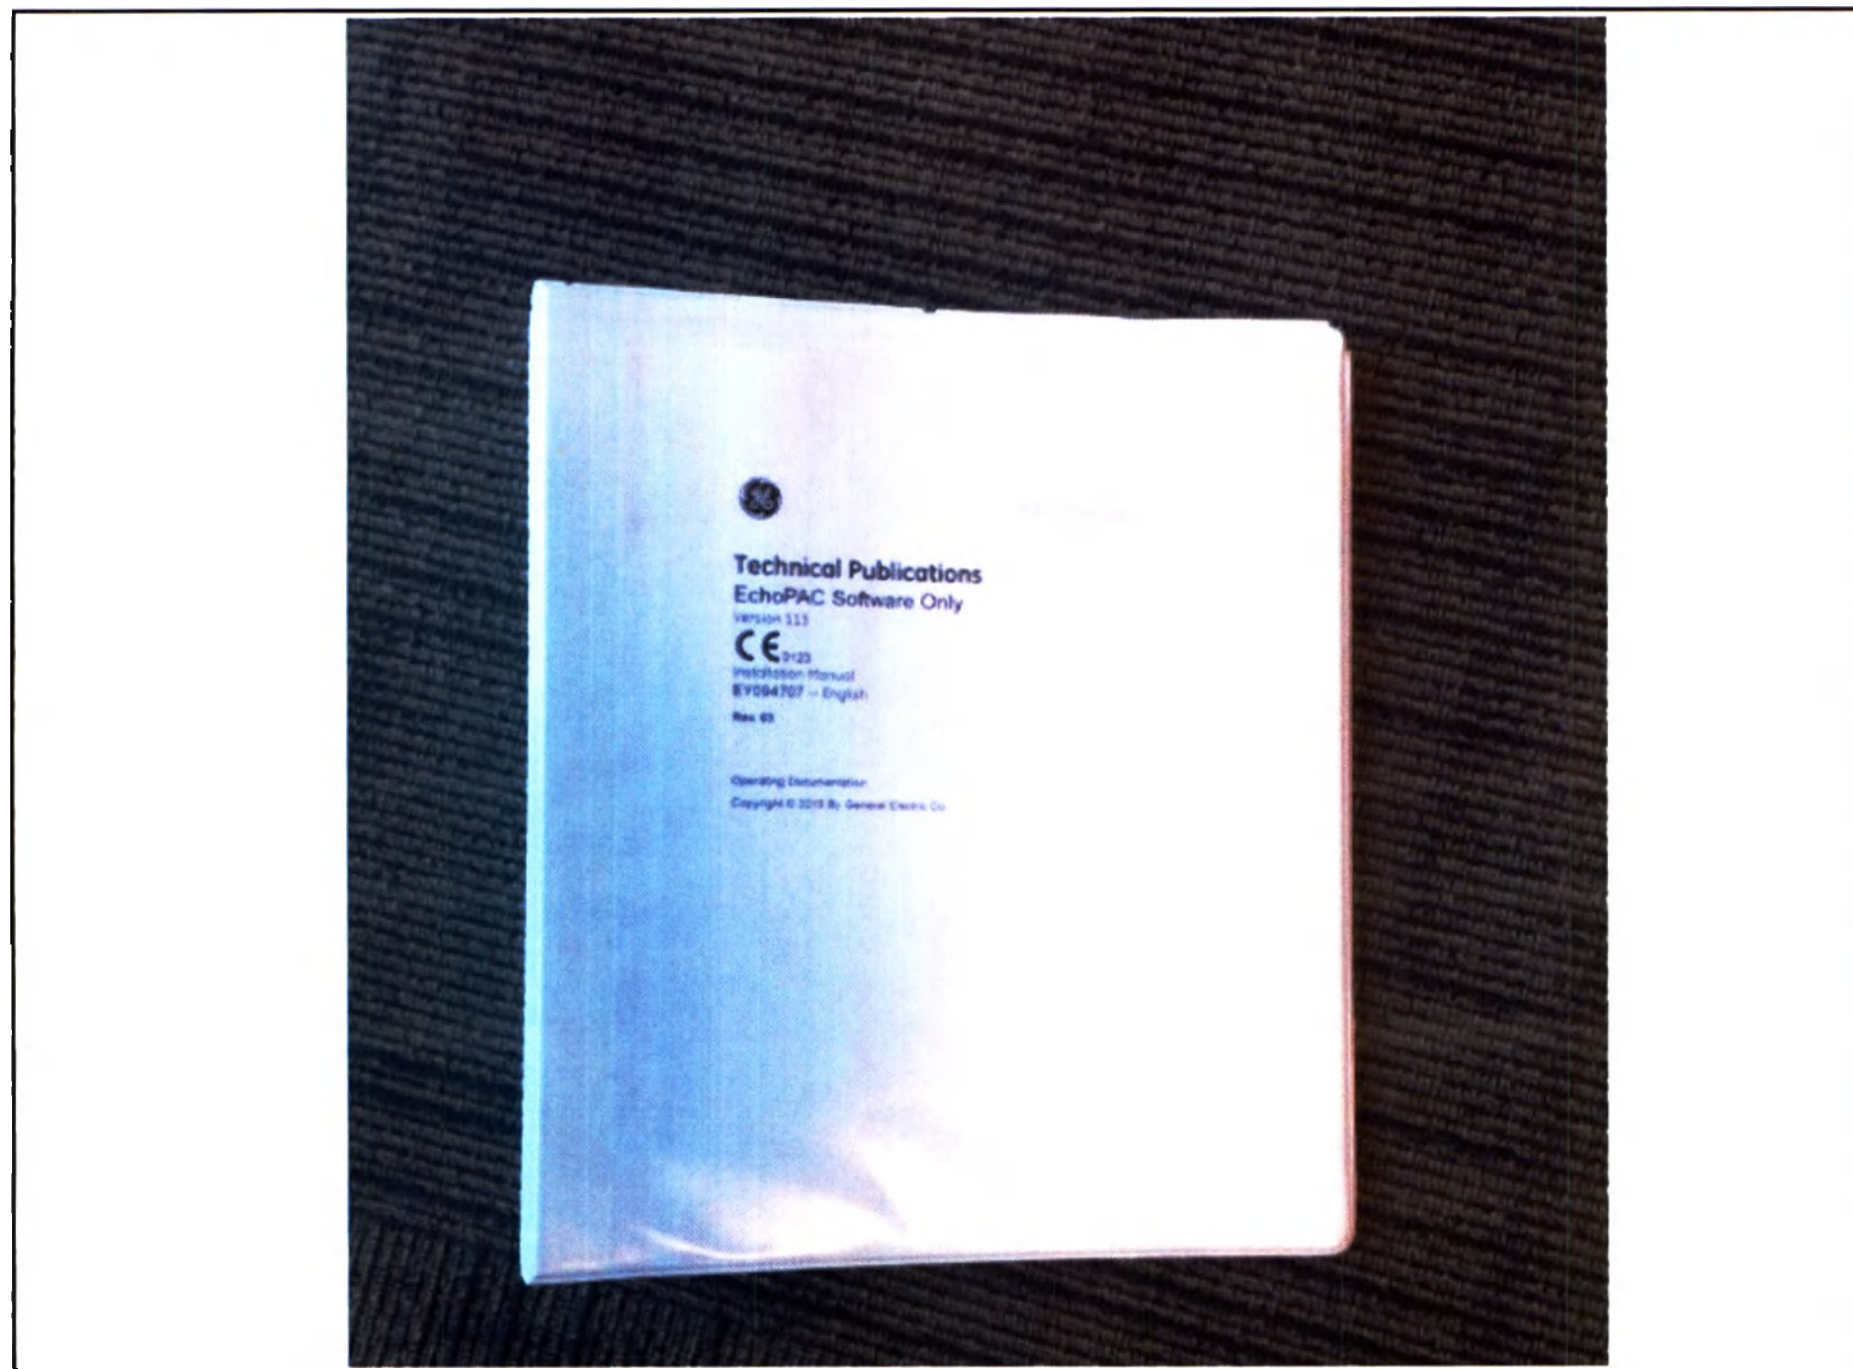

Archive

Config

Help

Exit

Imaging

Meas/Text

Report

Connectivity

System

About

Admin

SYSTEM (location setup/date-time/formats)

Settings

Location

Hospital

GE Vingmed Ultrasound

Department

Echolab

Date and Time

13/05/2014

10:13:55

Time Format

24

Date Format

EU

Language


ENG

Manual Language


ENG


Units


Metric

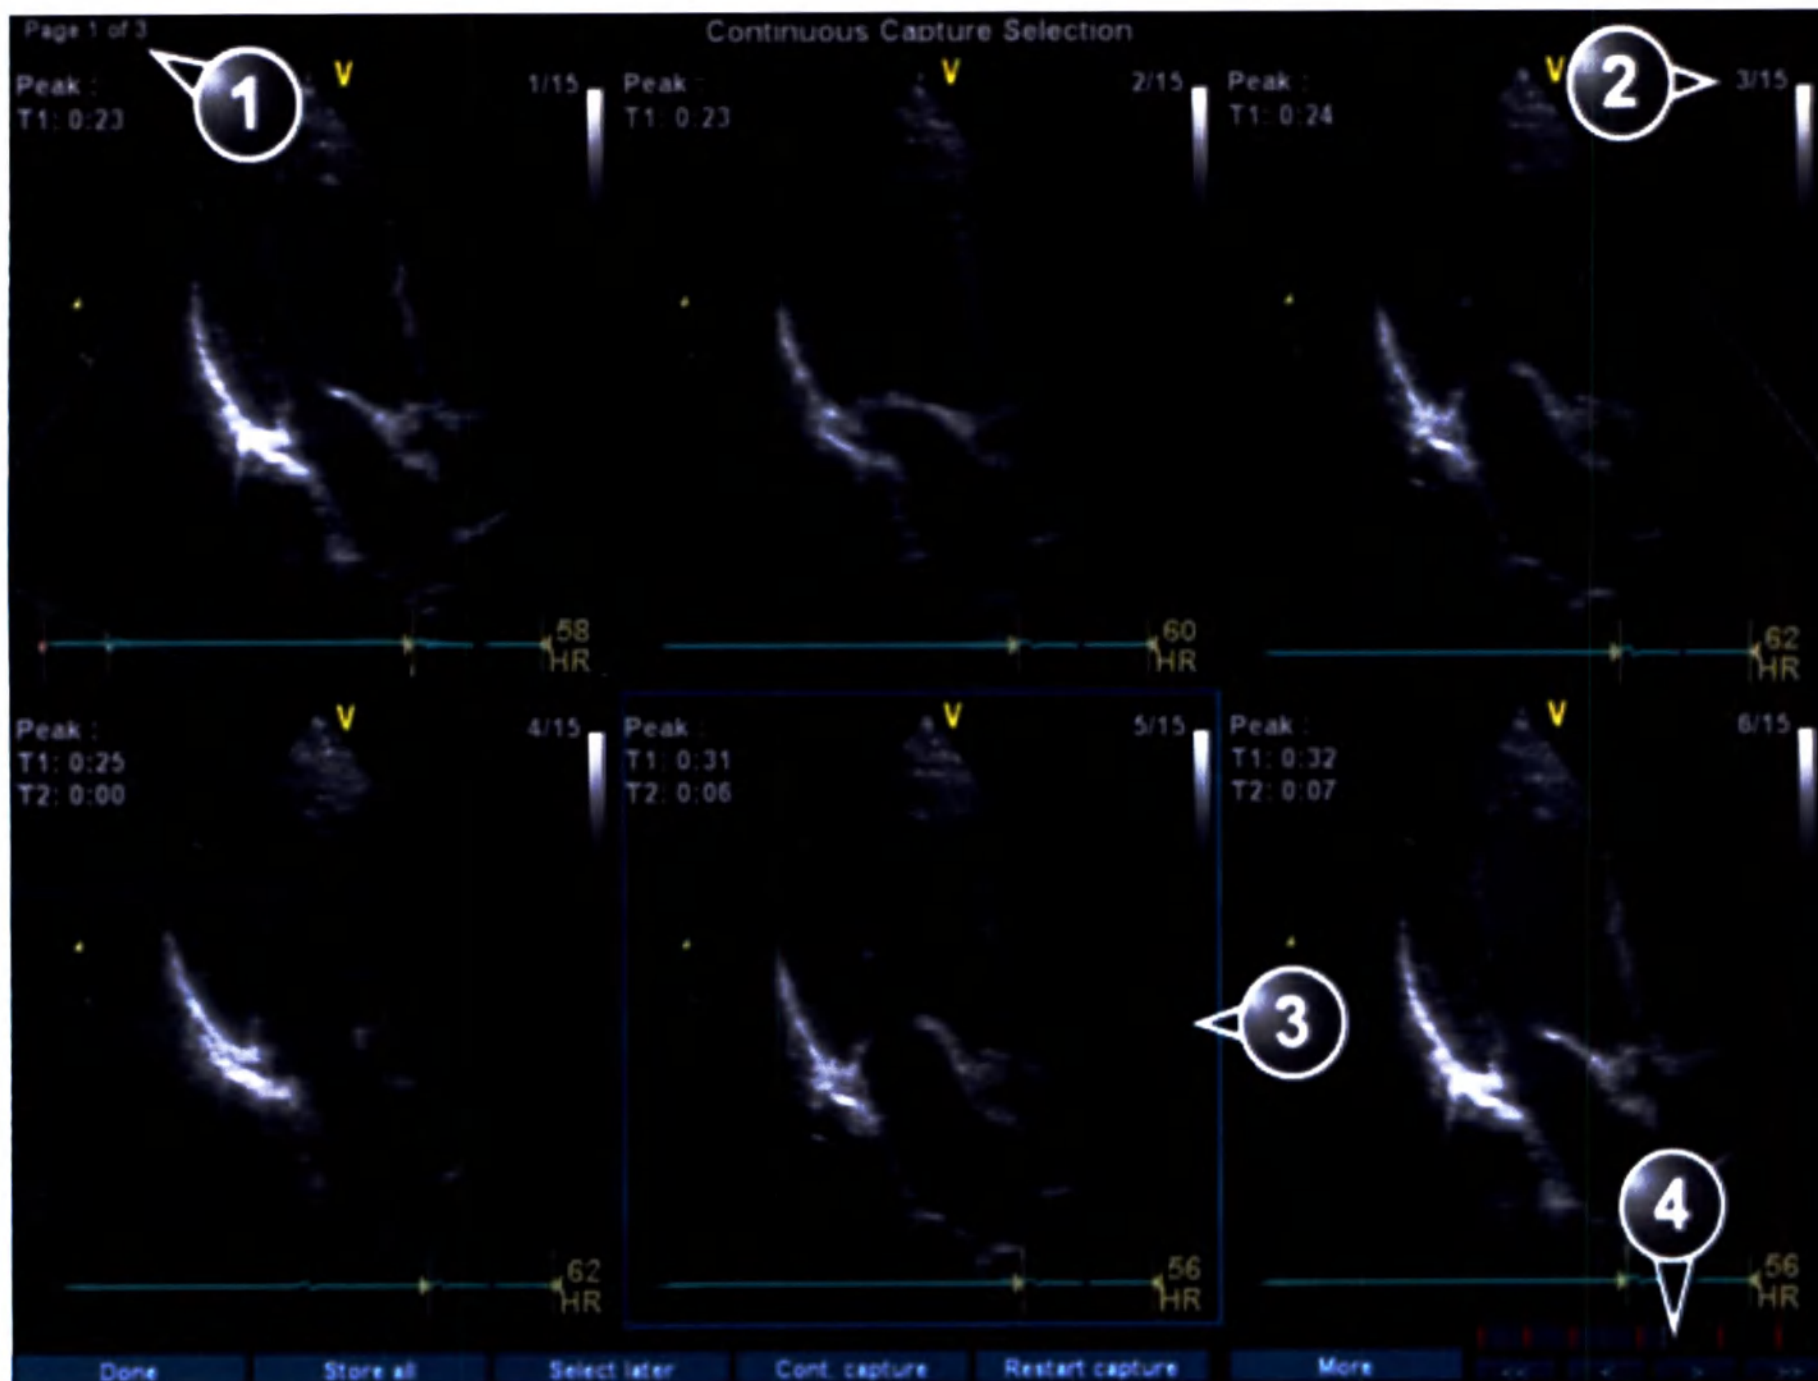


Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований с контрастными веществами.

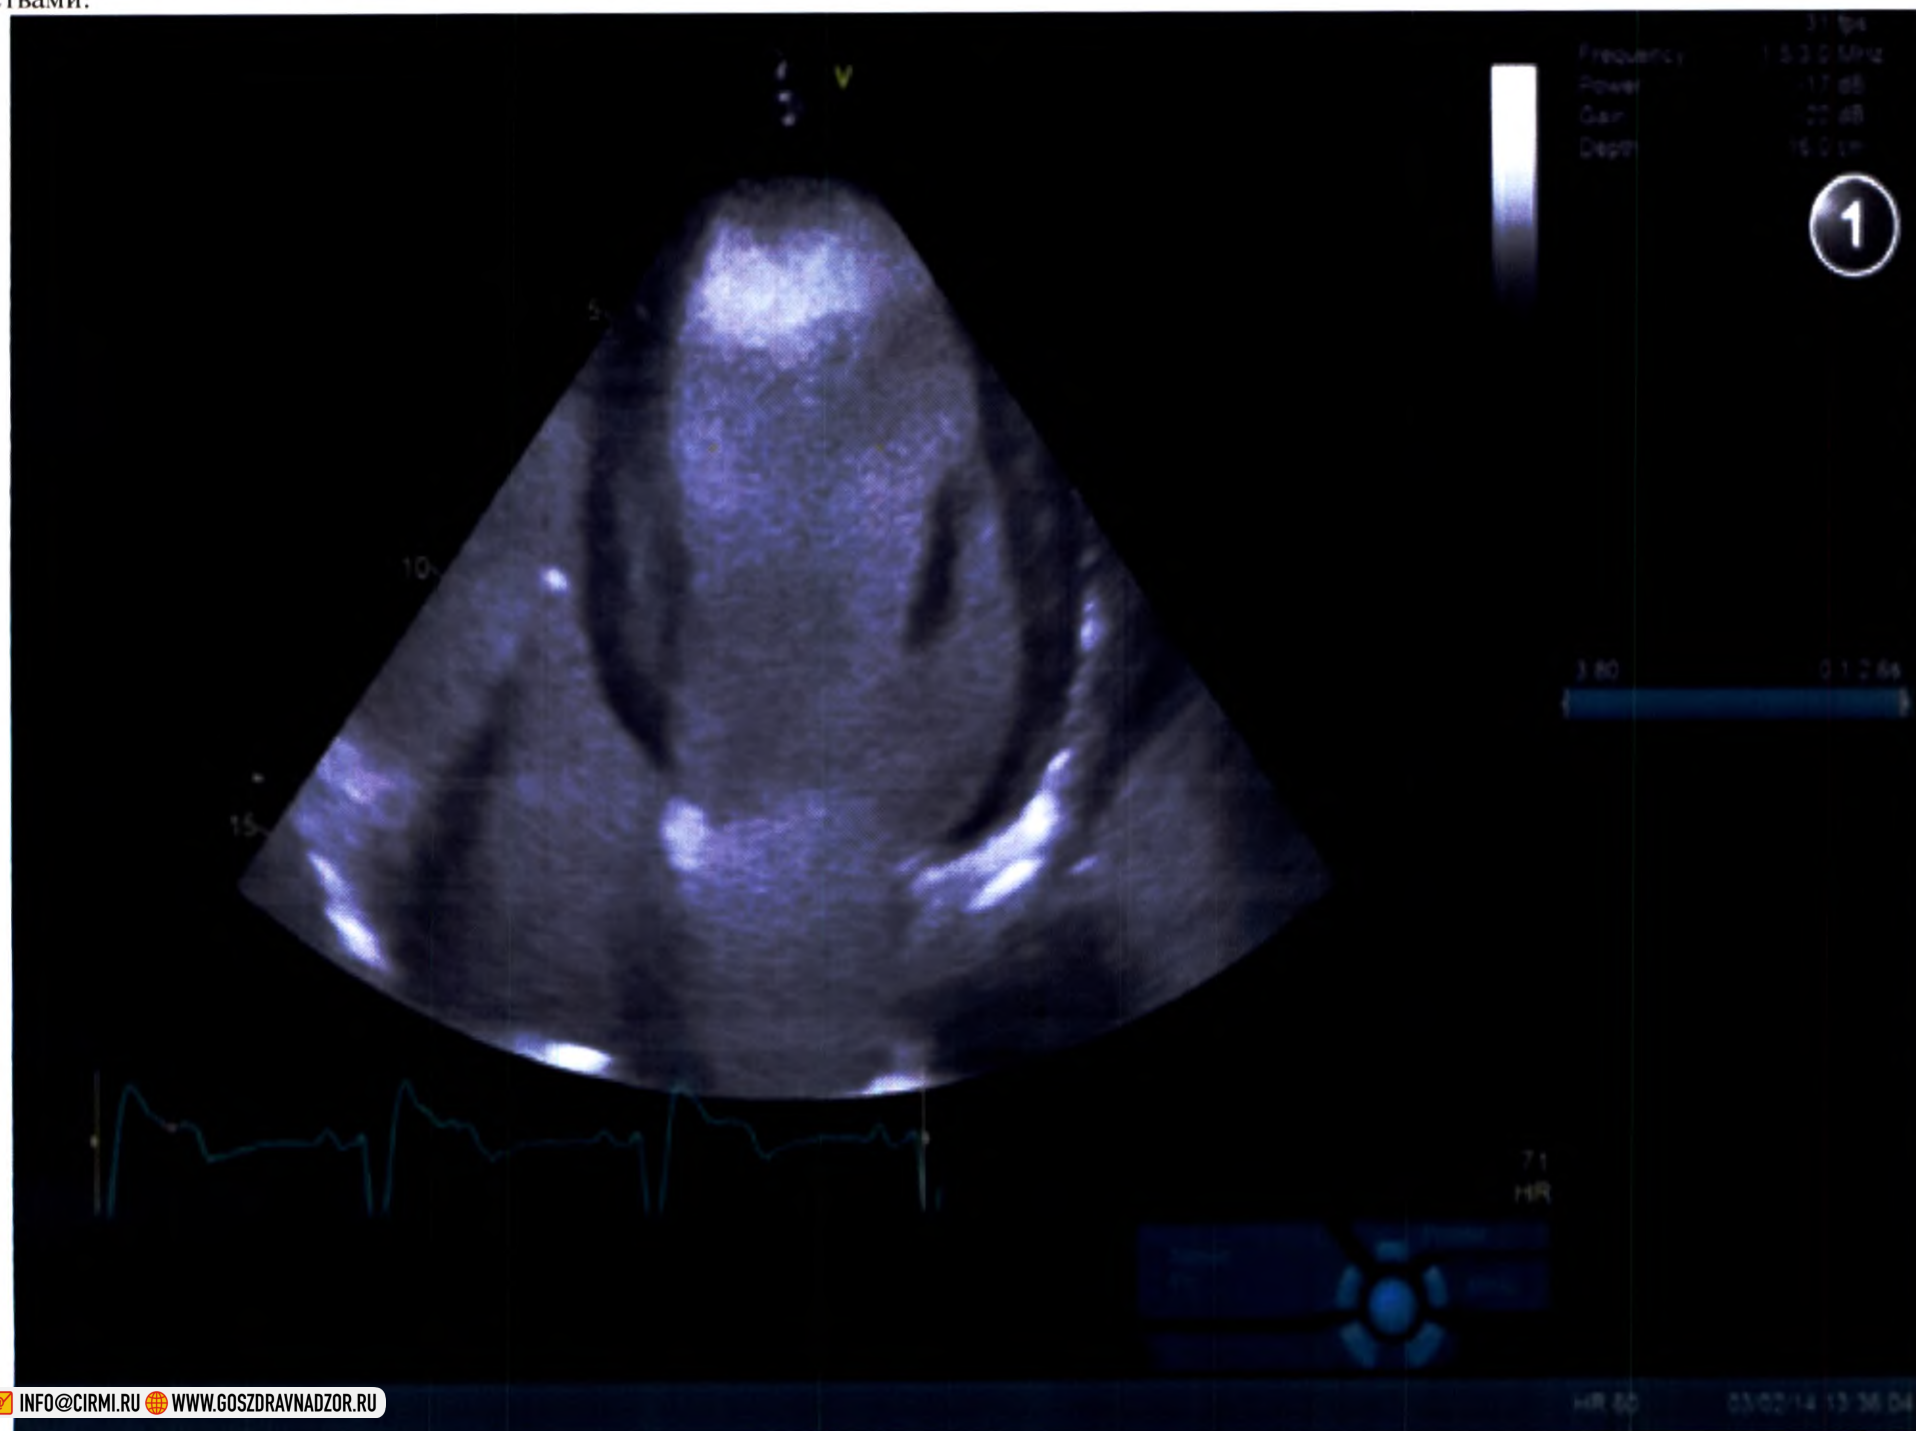


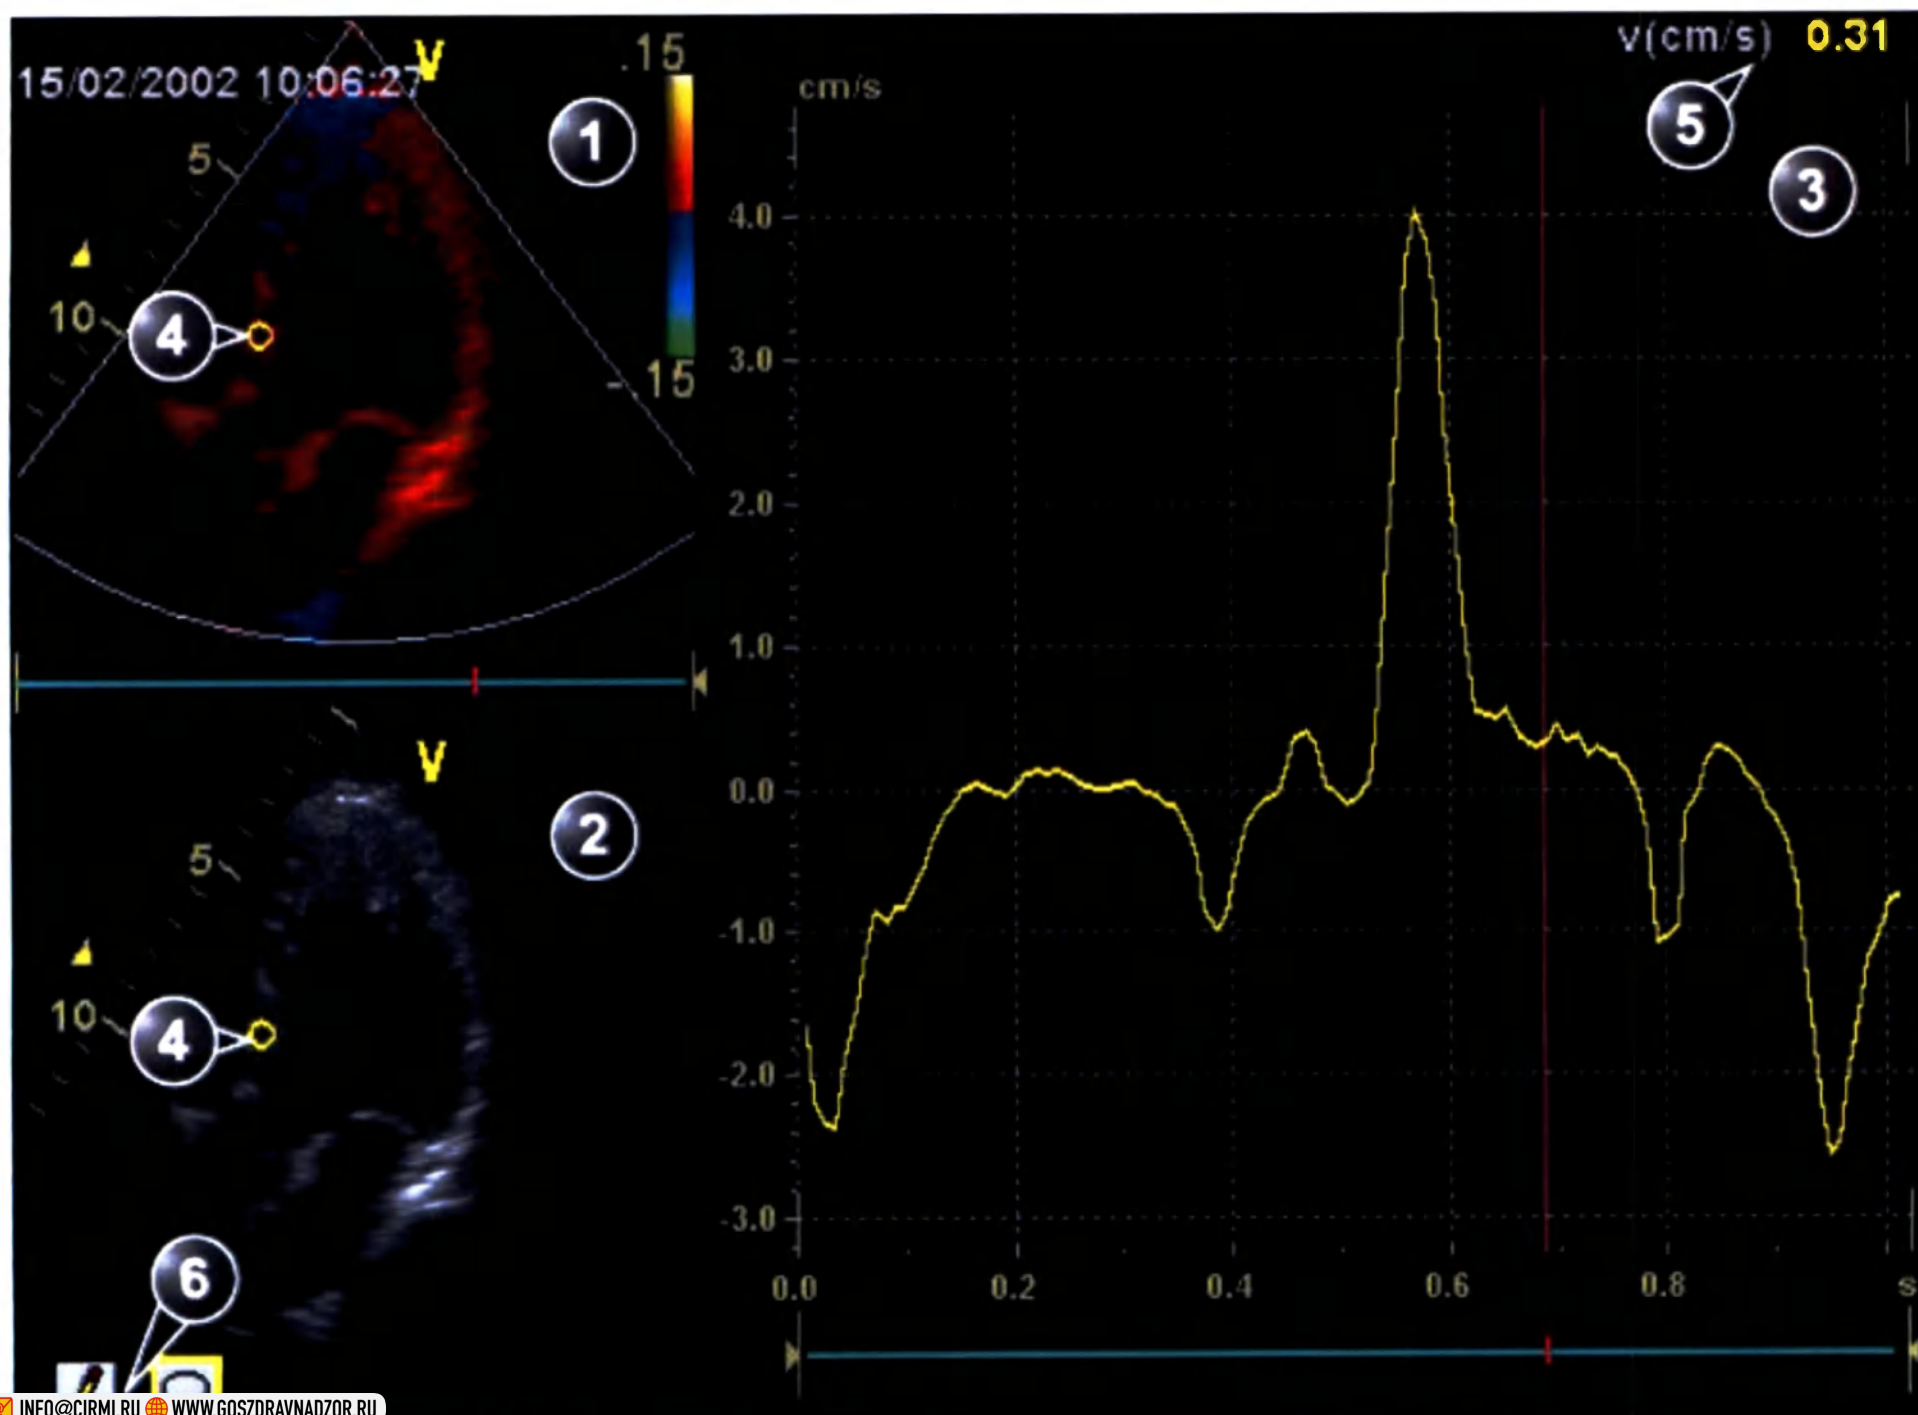

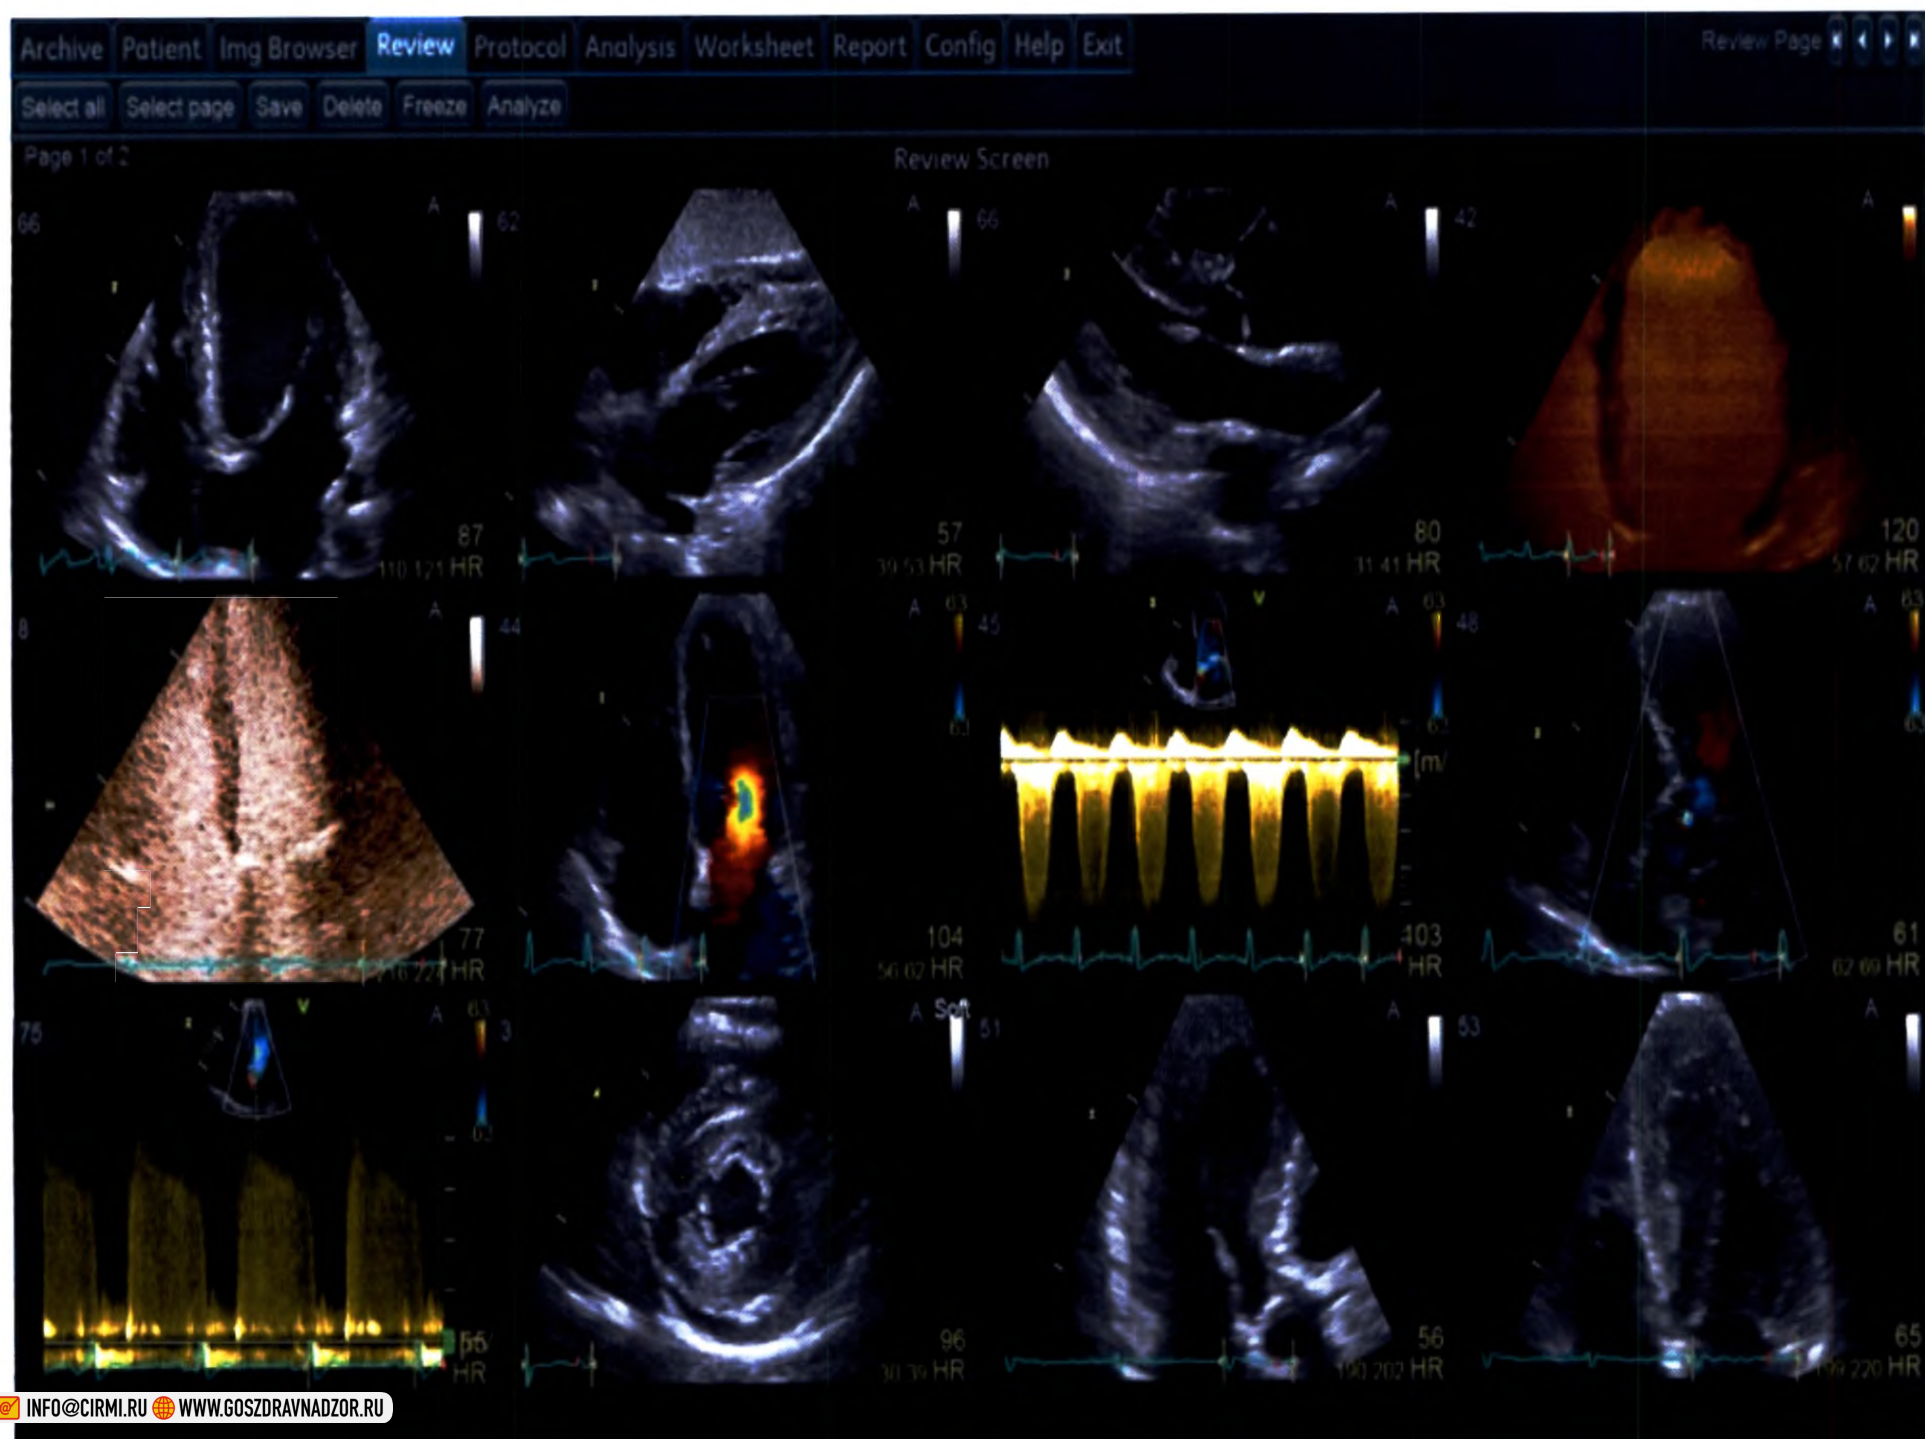


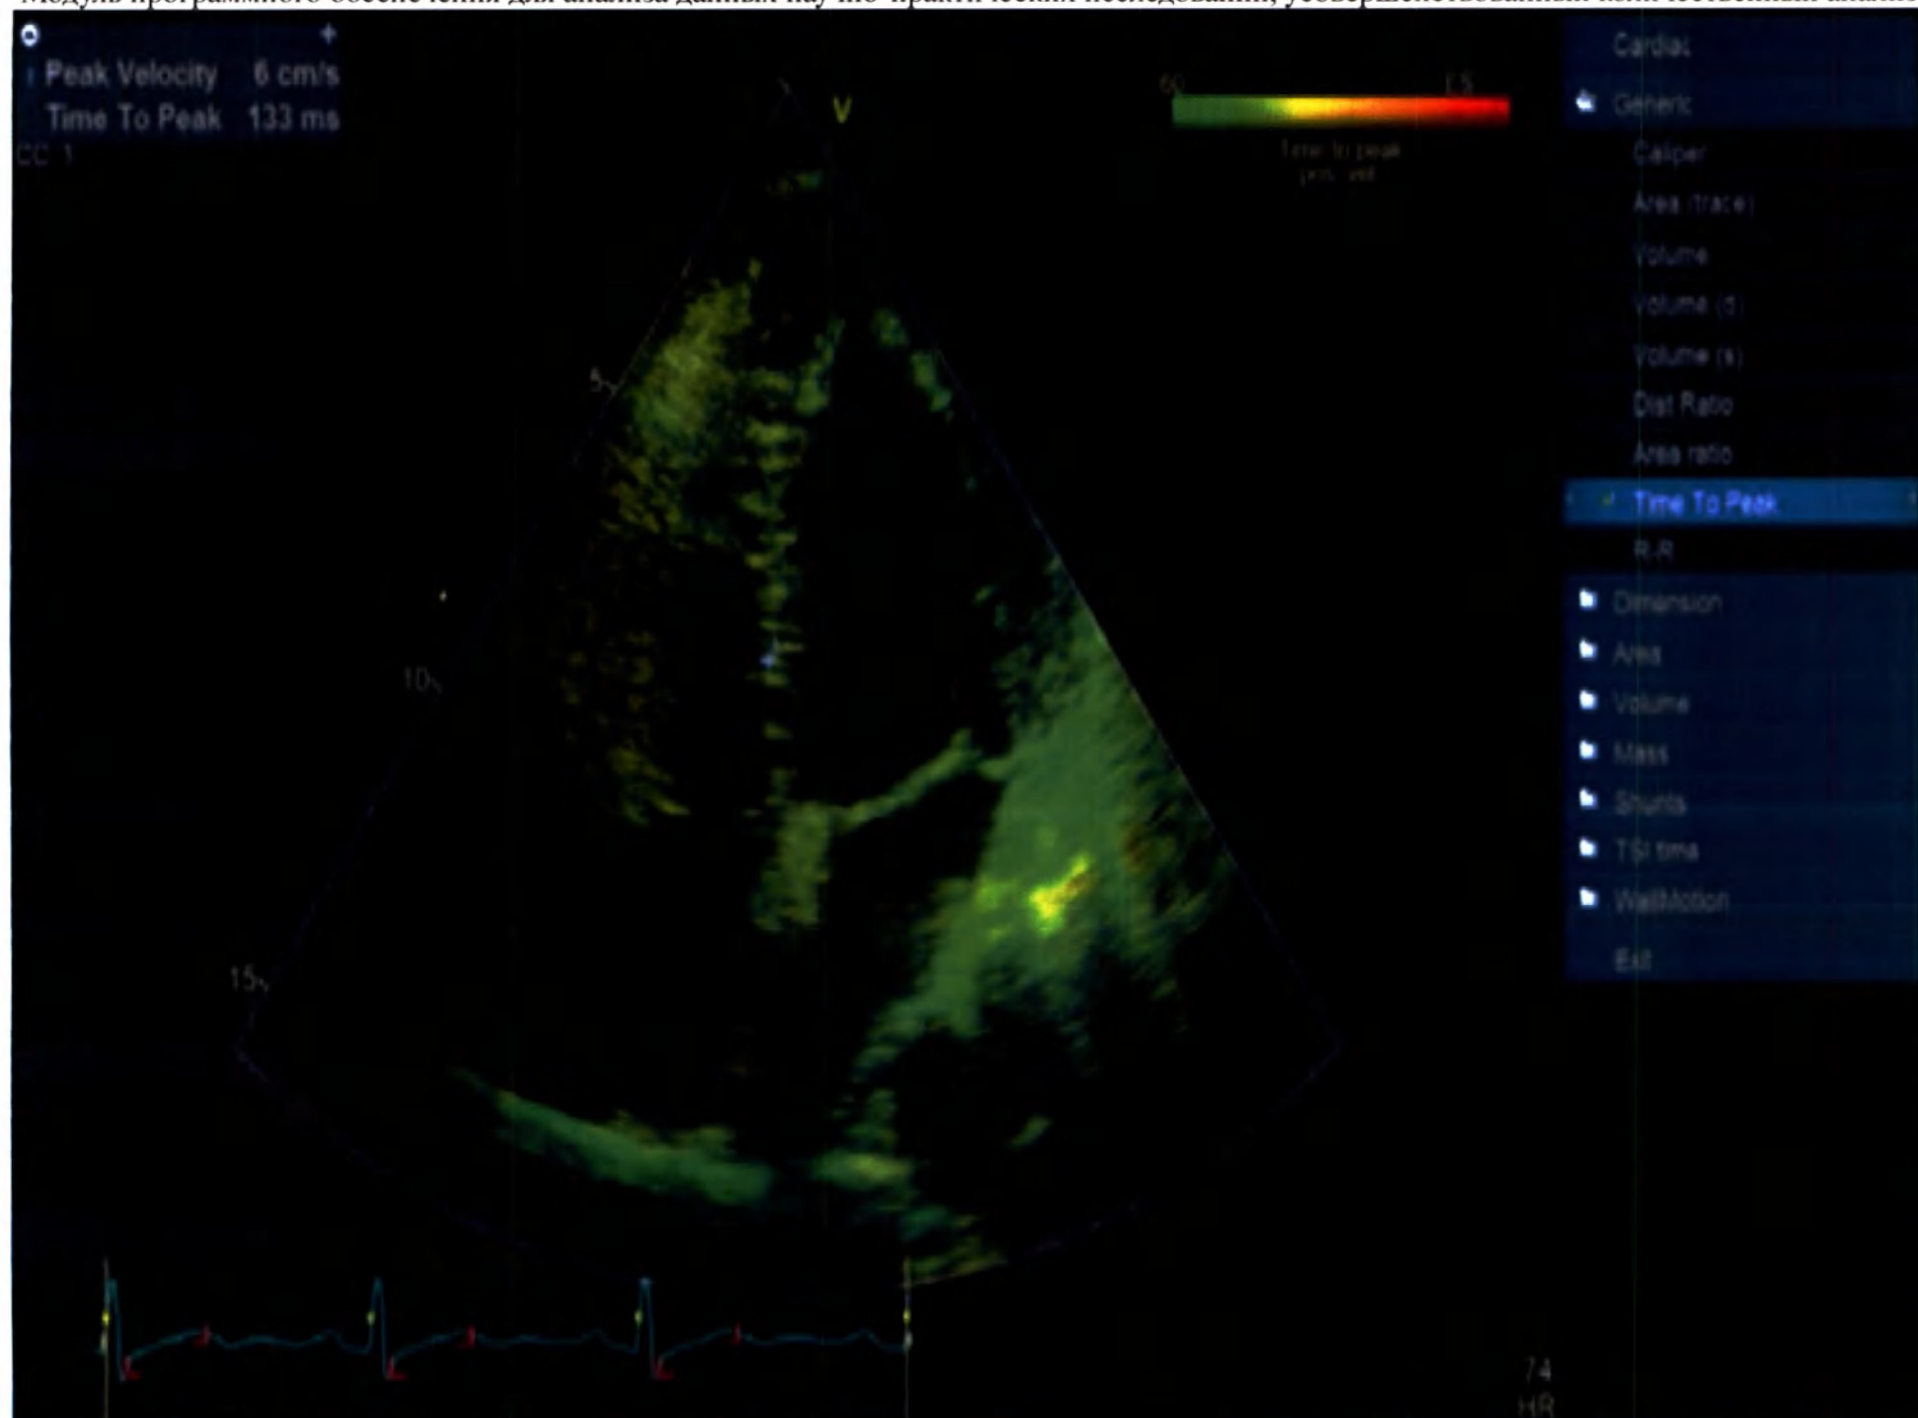


Модуль программного обеспечения для автоматического анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований, автоматические кардиологические измерения

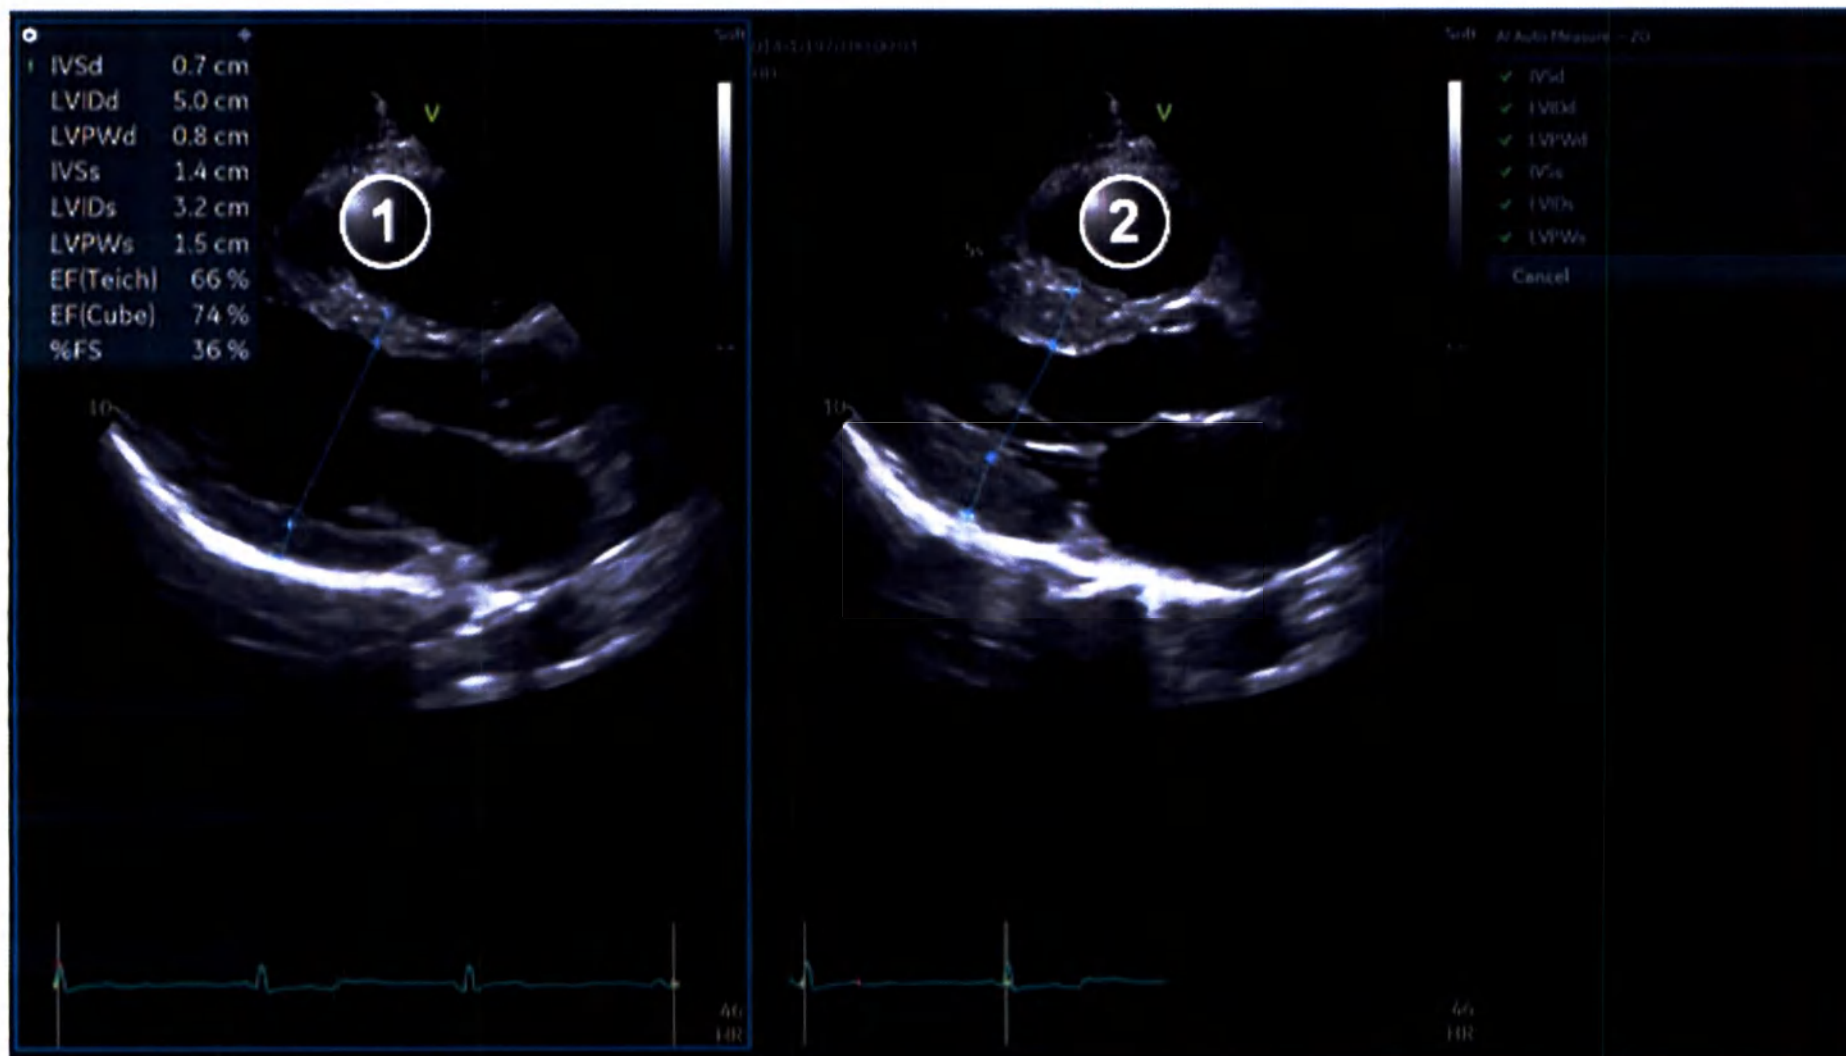


Модуль программного обеспечения для автоматического анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований, автоматические кардиологические измерения

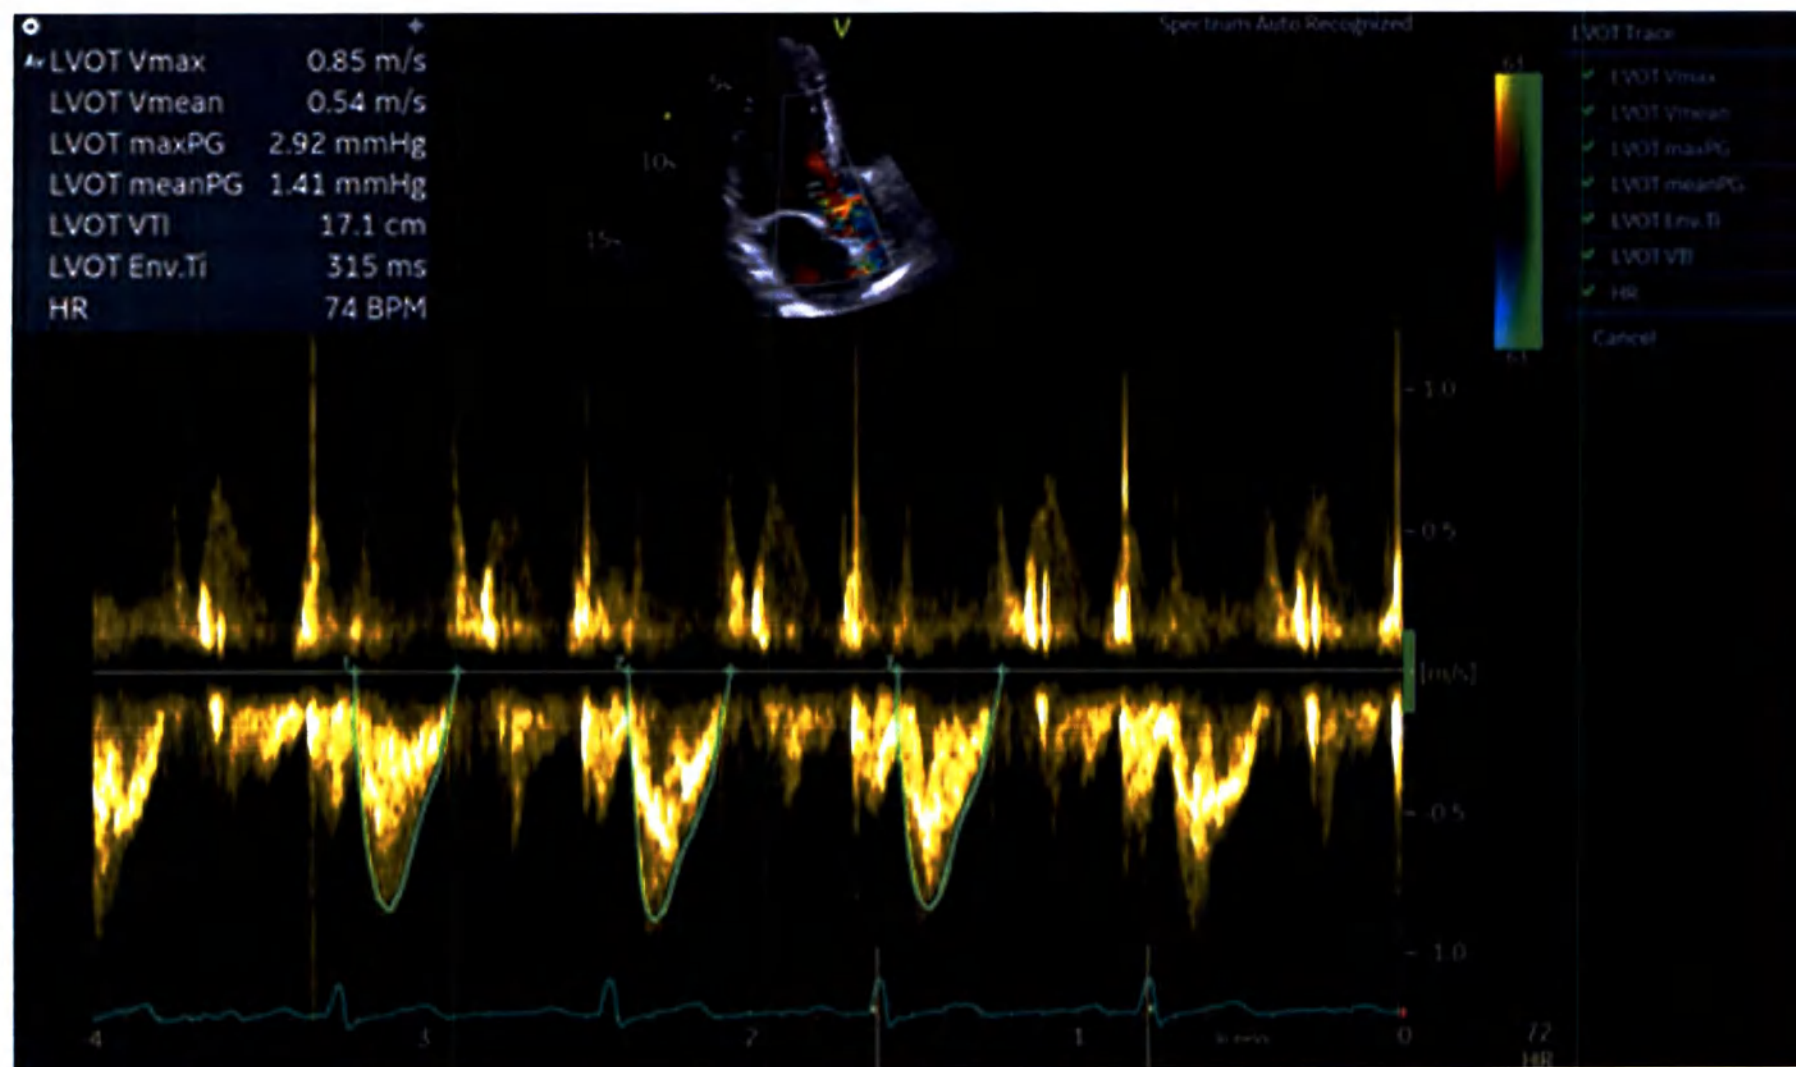


Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований, оценка деформации миокарда и синхронности сокращения ЛЖ.

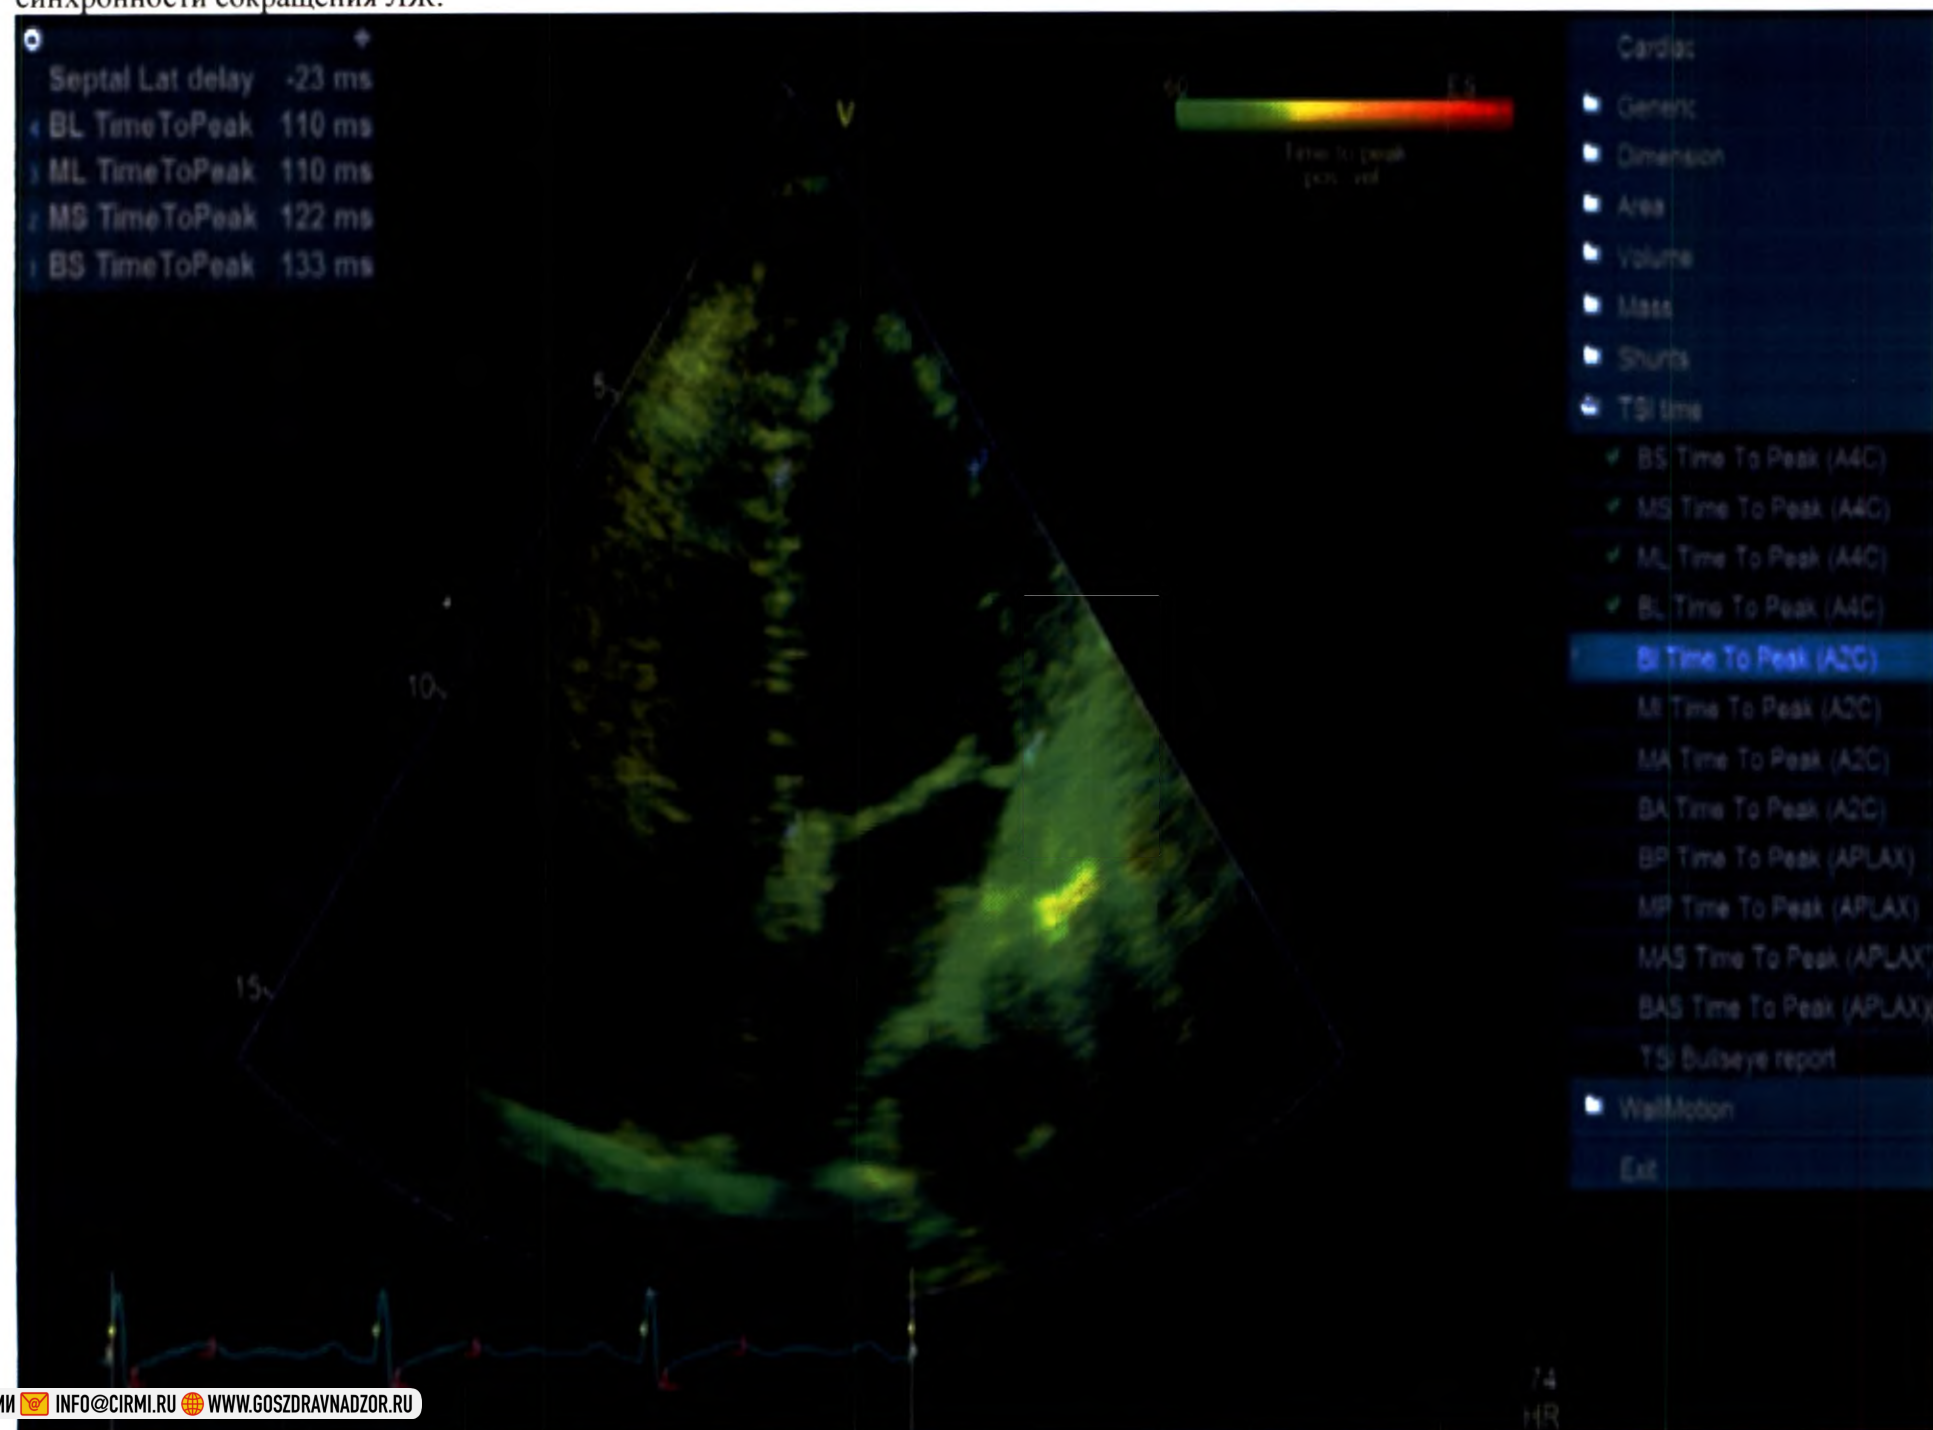


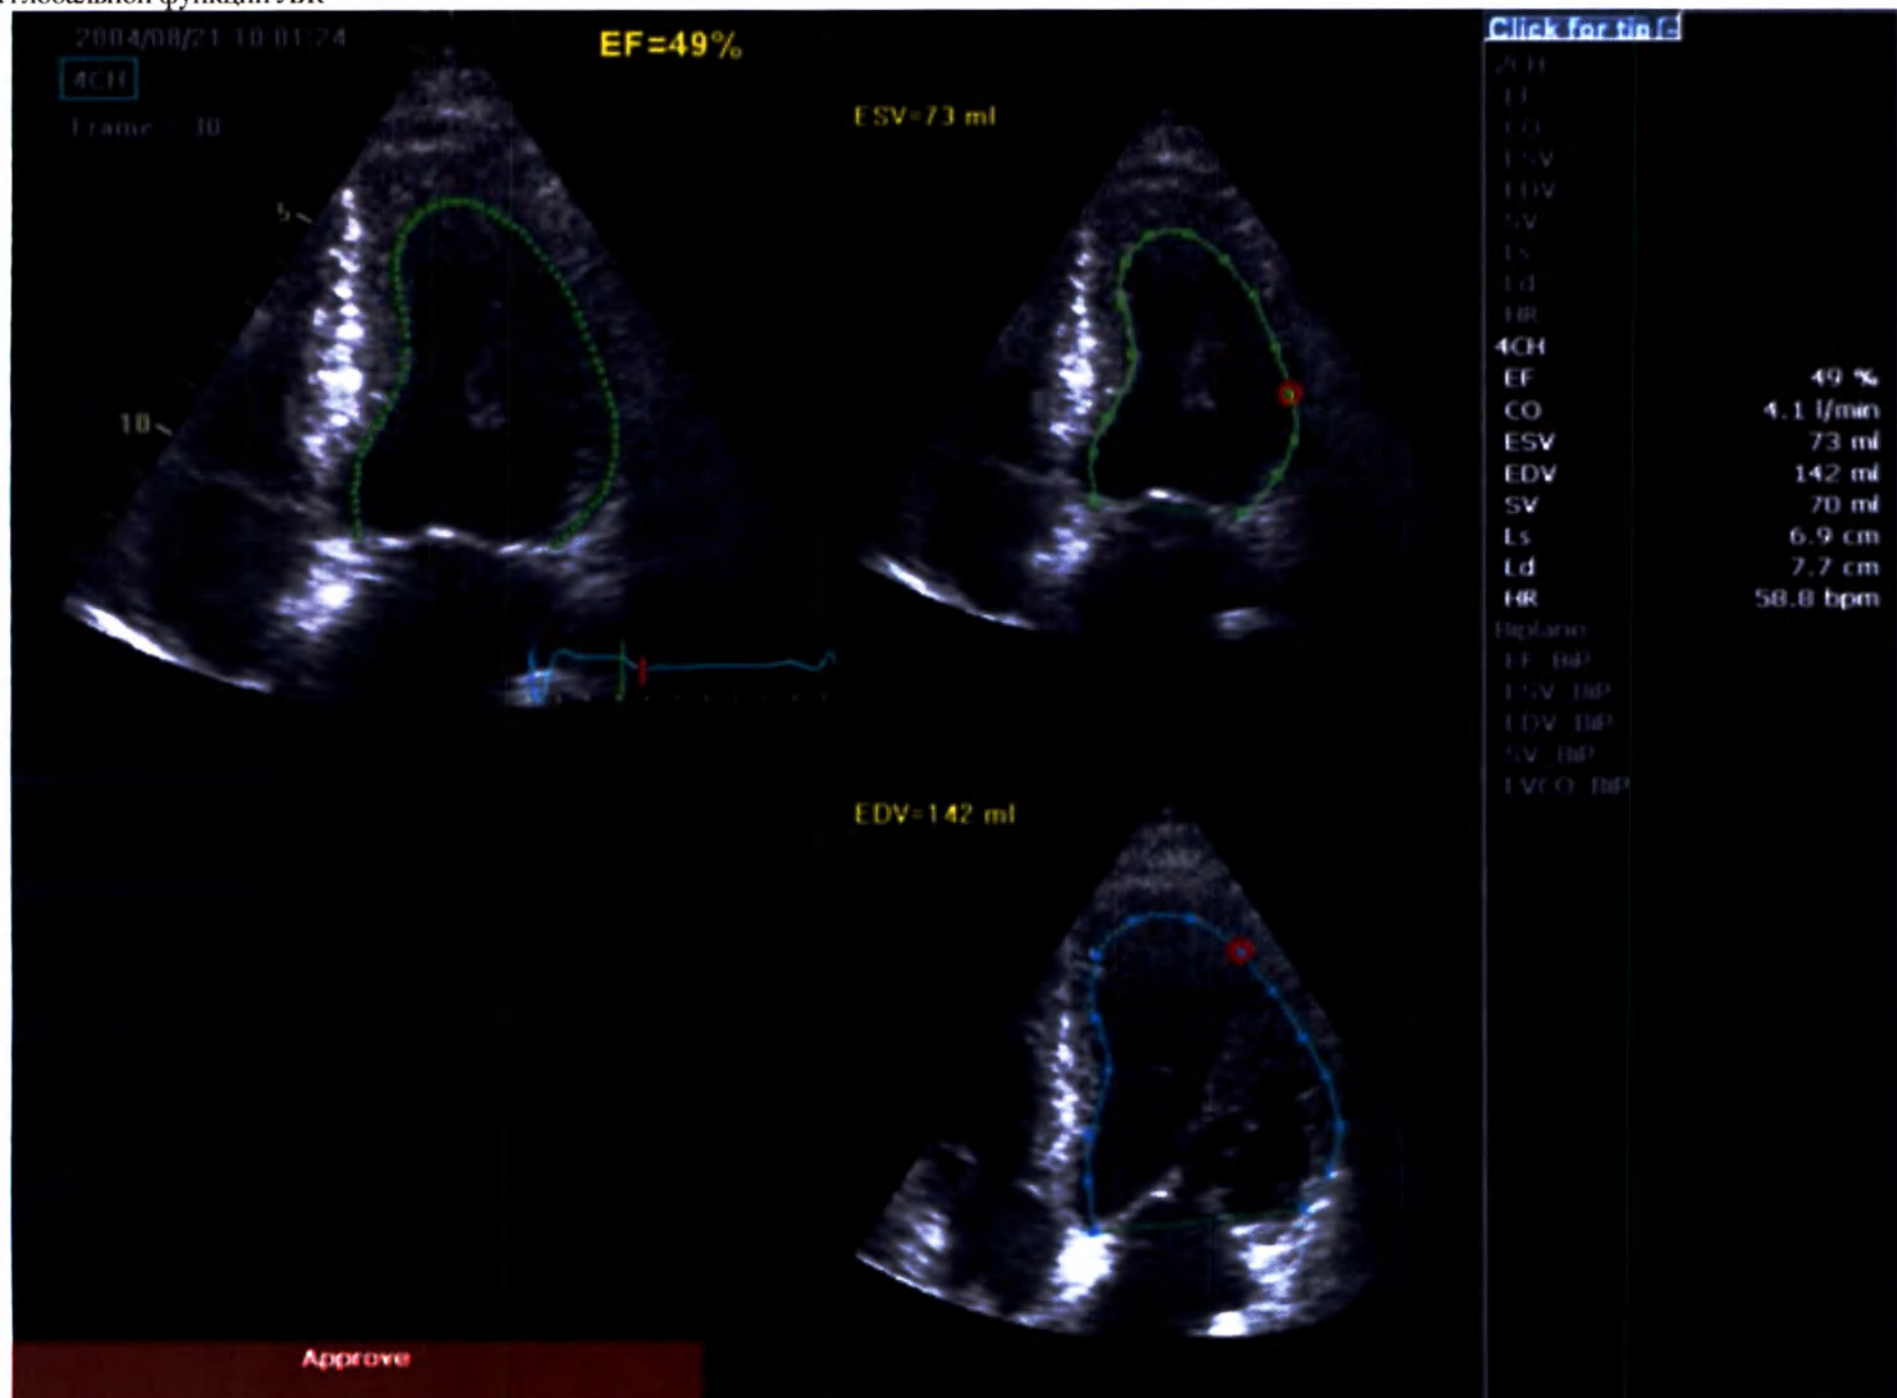



Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований, неоплеровская качественная и количественная оценка глобальной и региональной функции сердца, степени деформации миокарда ЛЖ

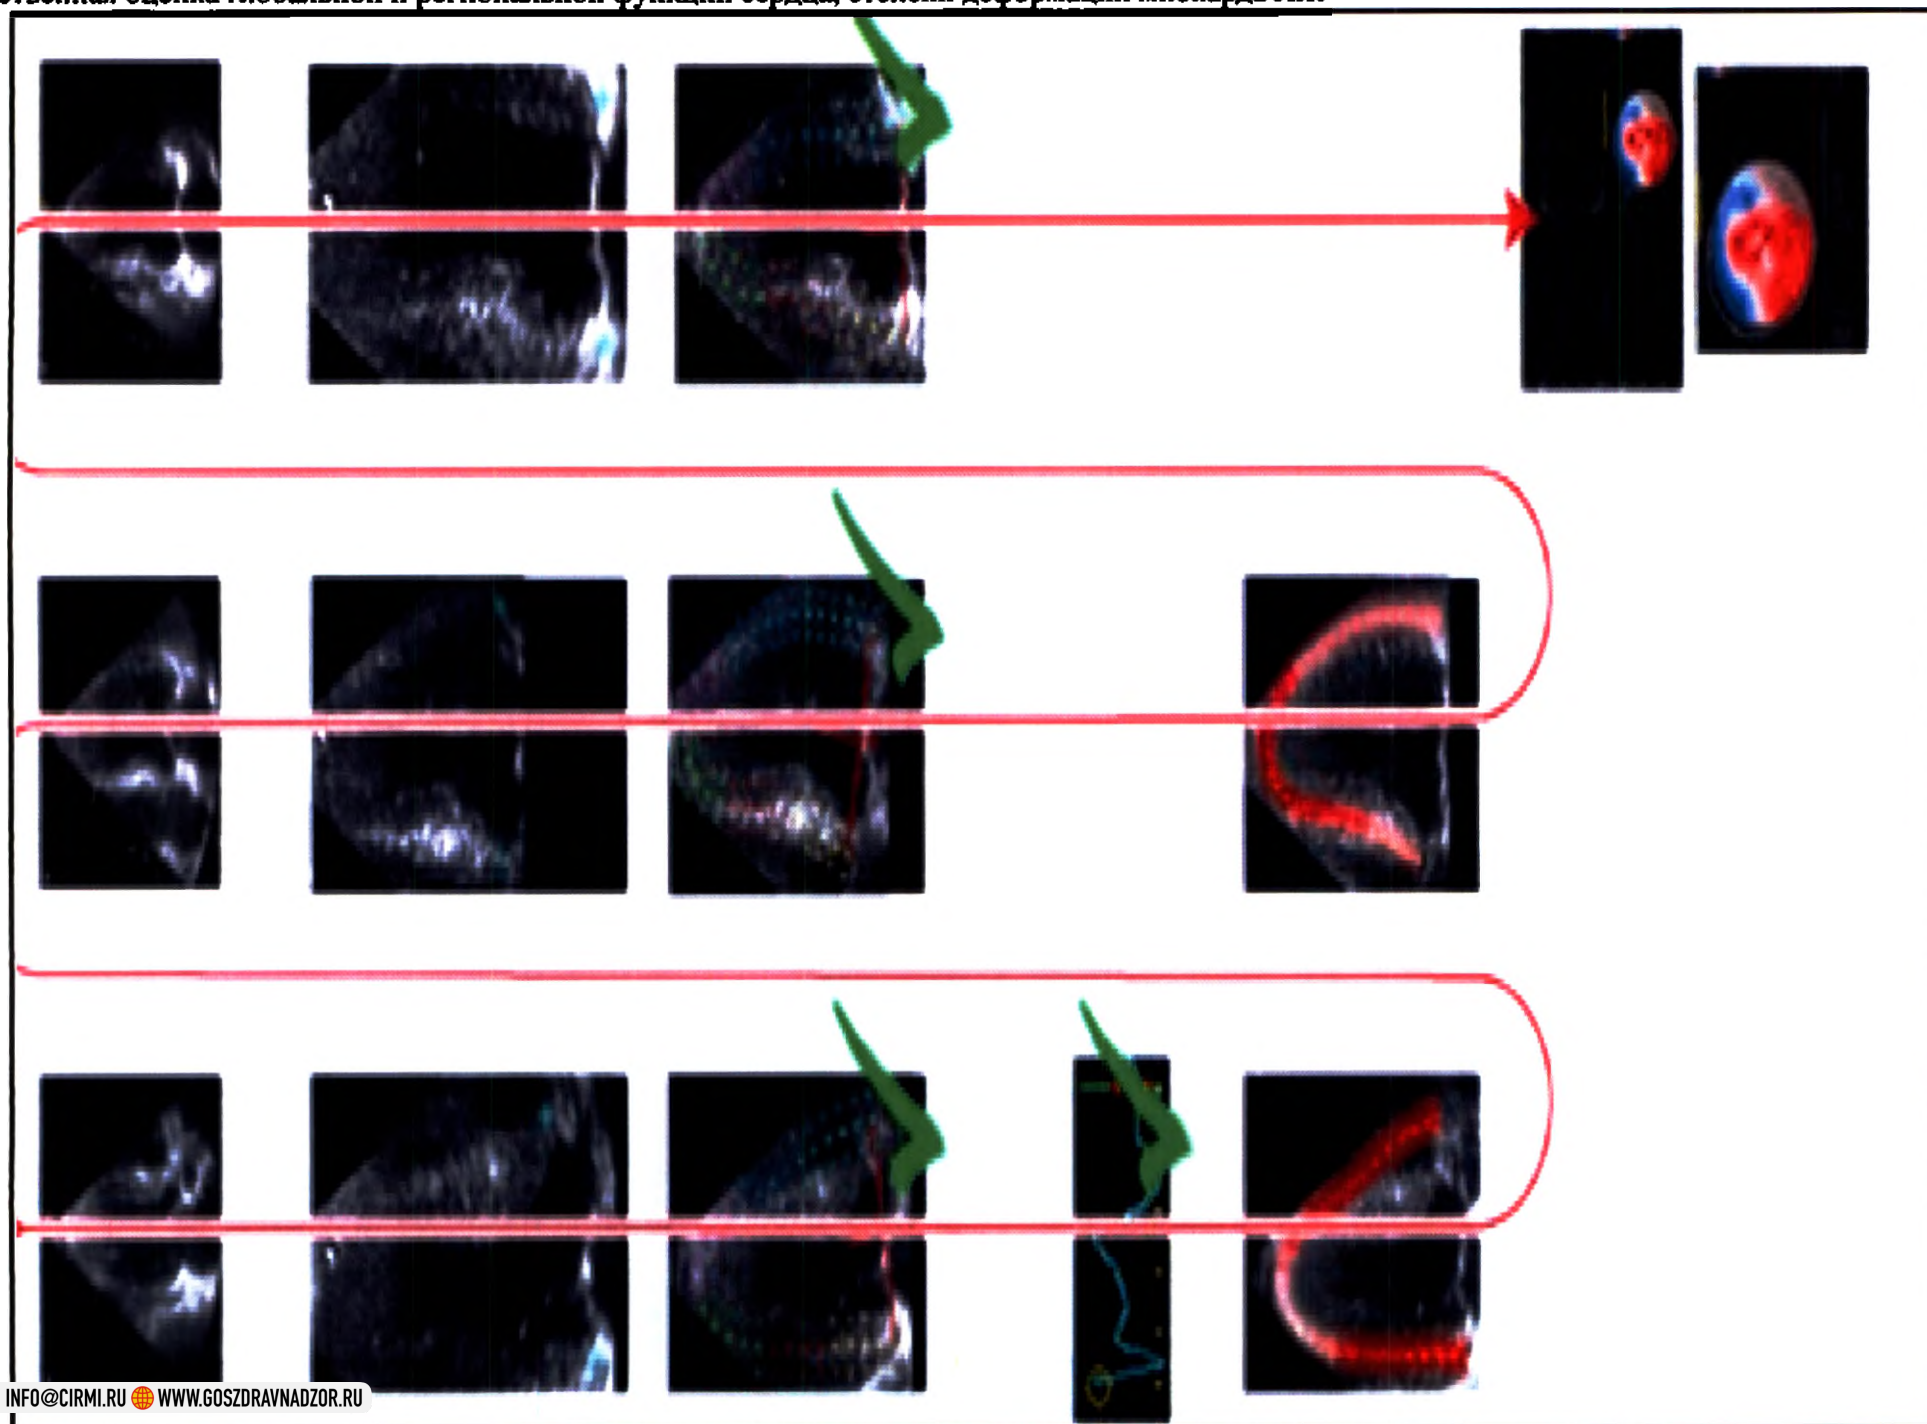


Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований, неоплериовская качественная и количественная оценка глобальной и региональной функции сердца, степени деформации миокарда ЛЖ

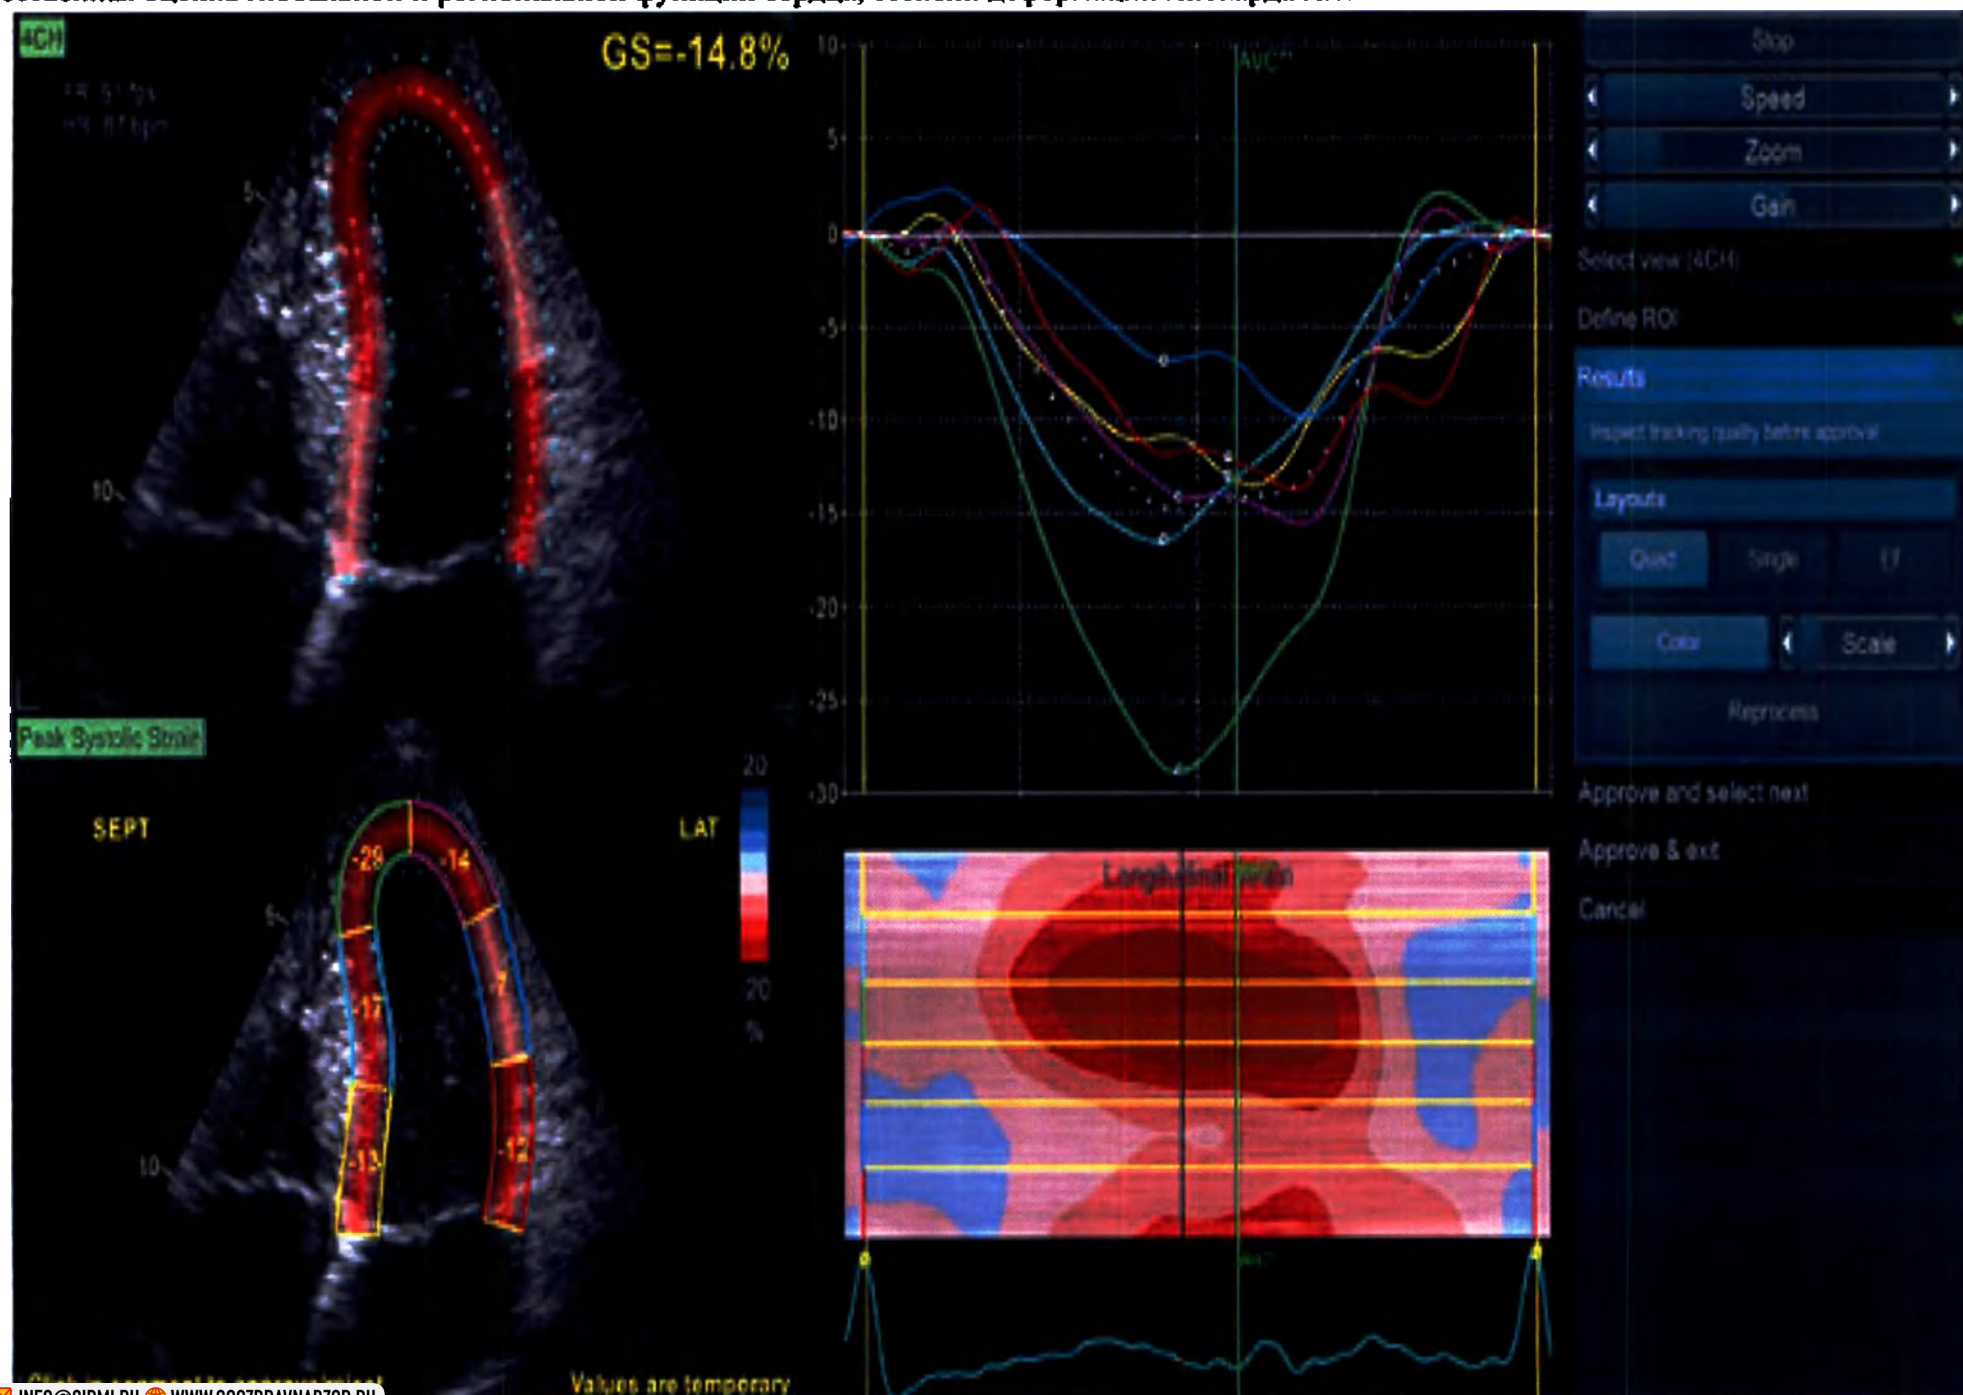


Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований, оценка толщины комплекса интима-медиа.

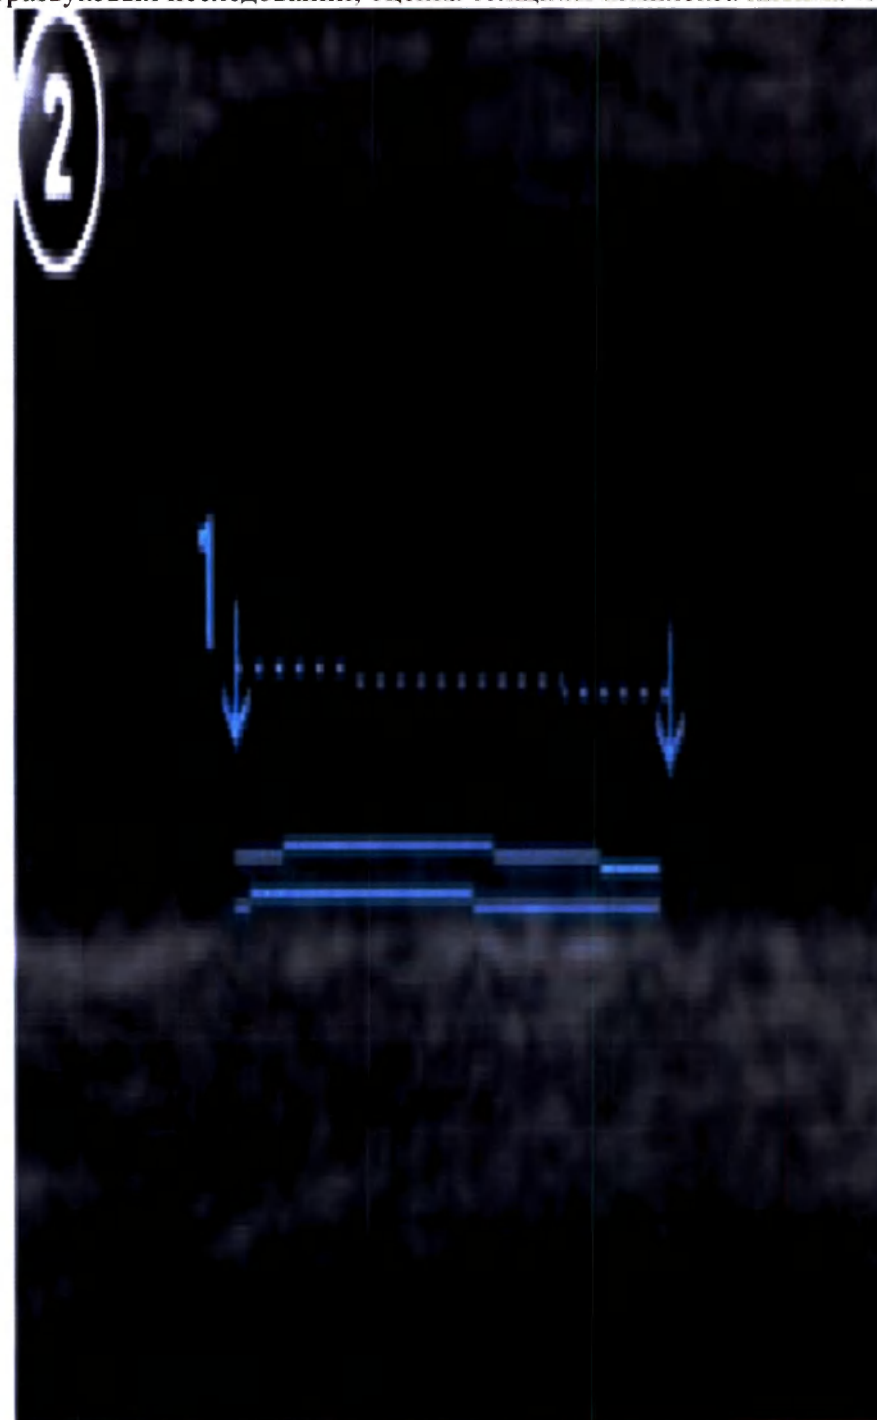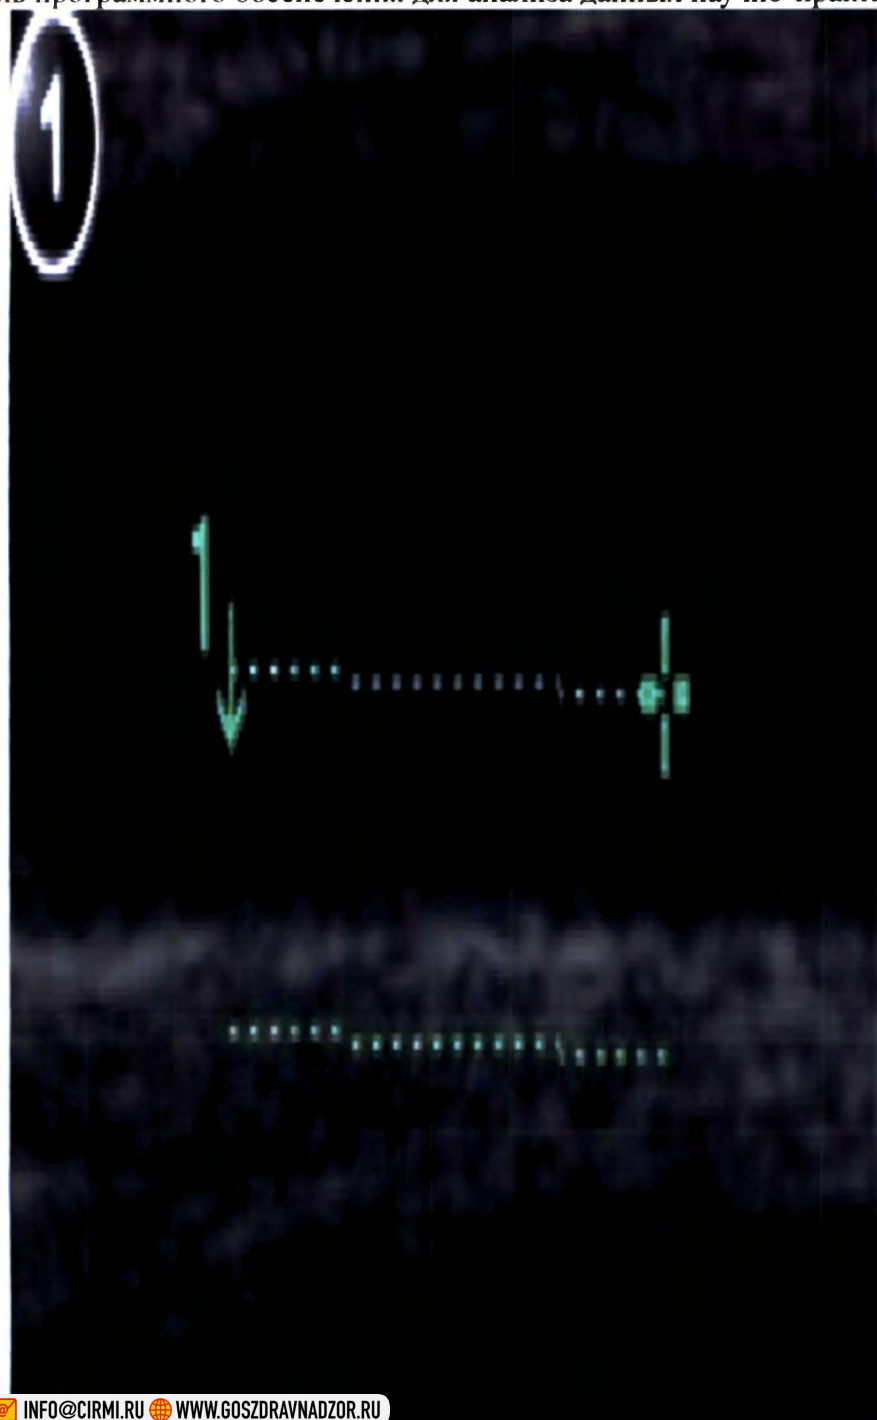


Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований, анализ и обработка объемных медицинских ультразвуковых изображений.

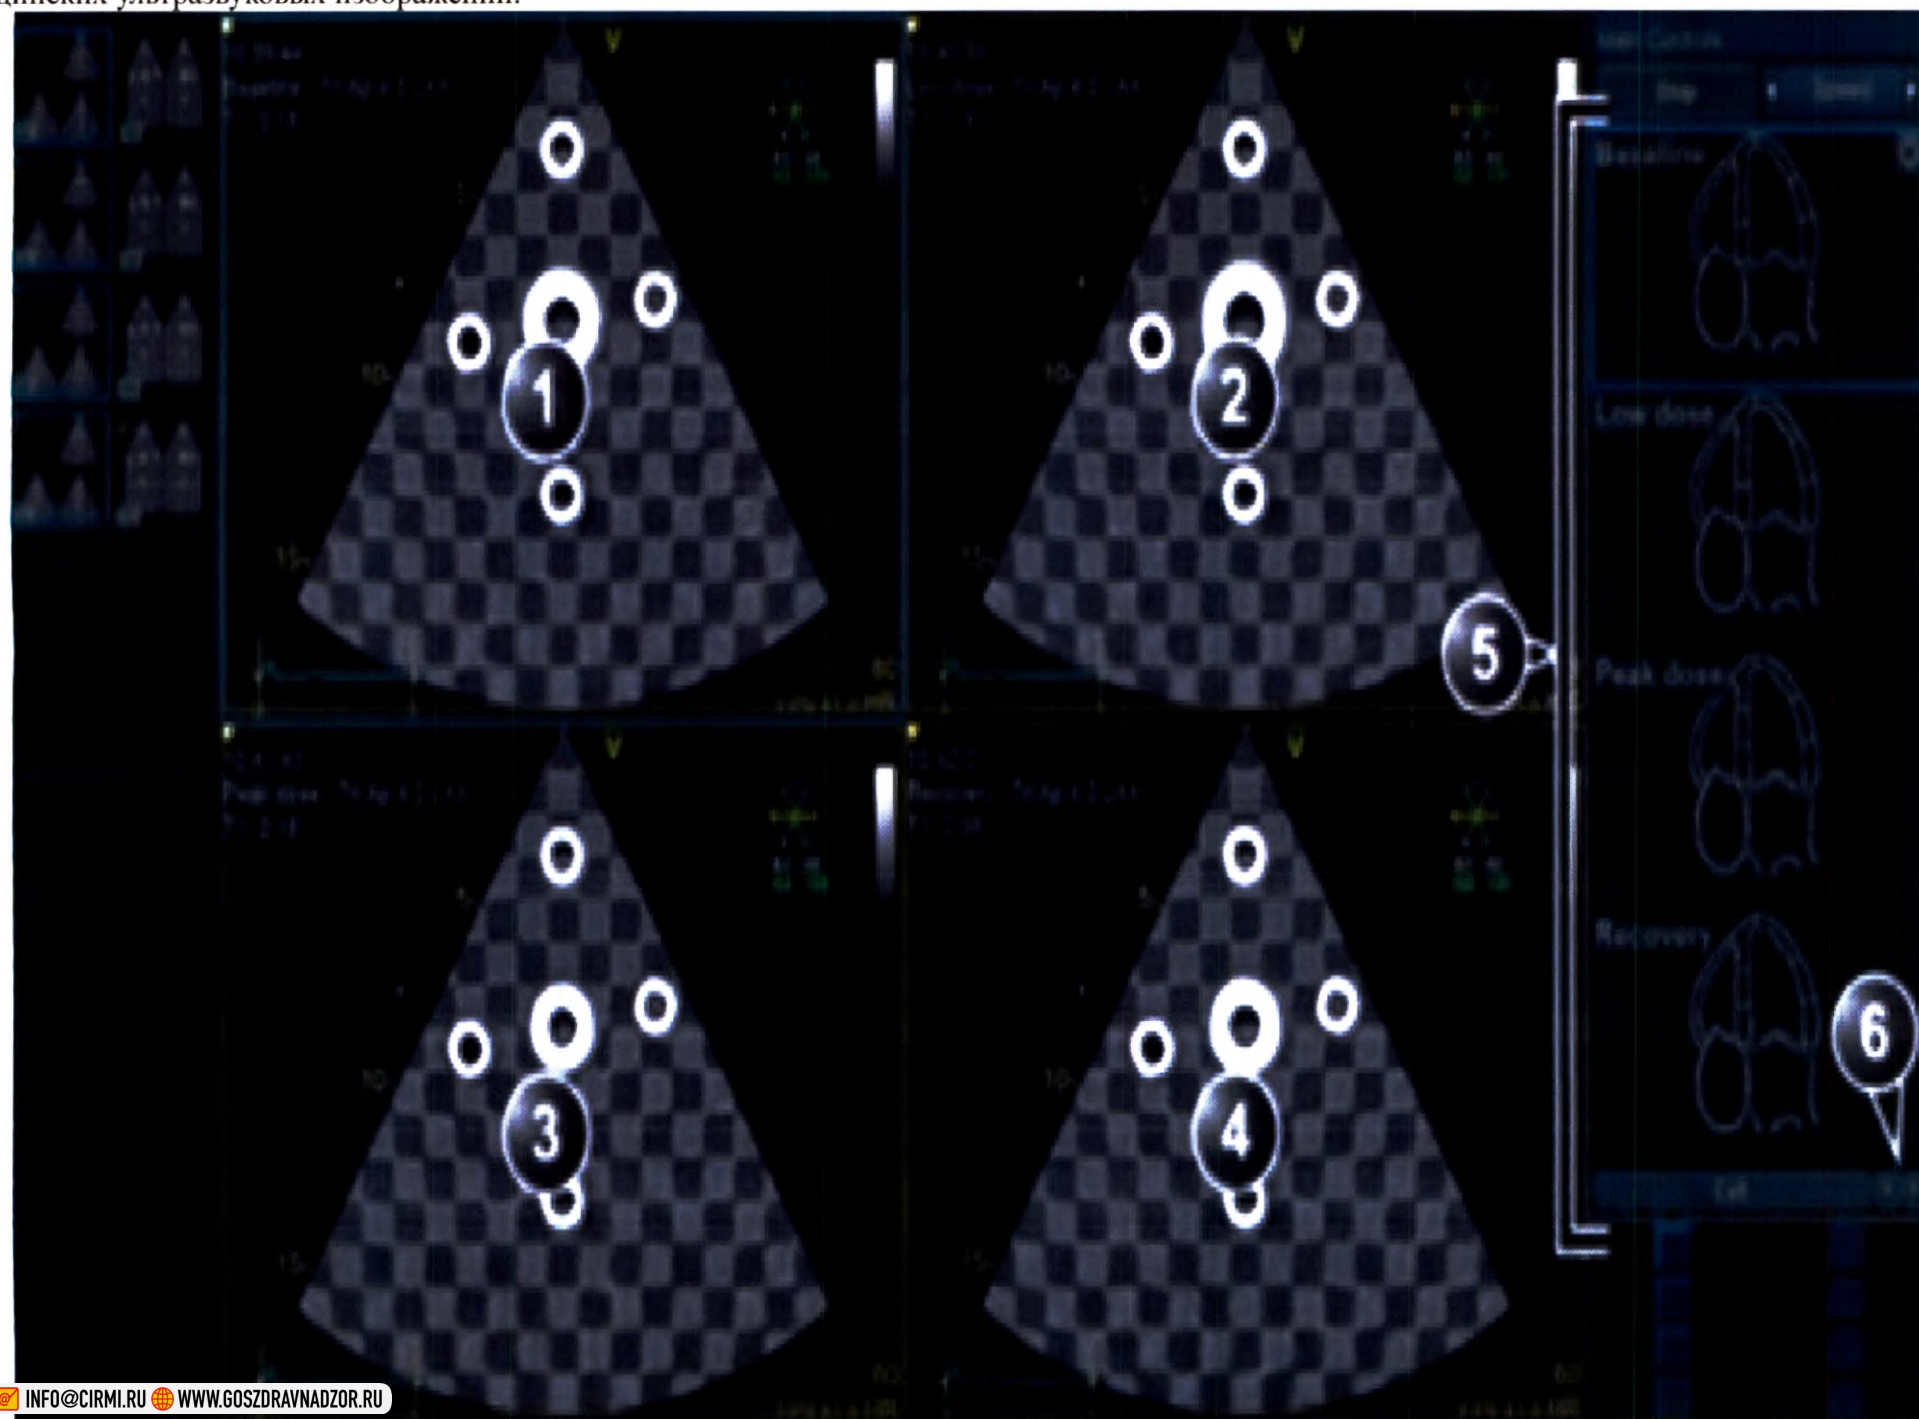


Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований, трехмерный автоматический анализ массы миокарда левого желудочка.

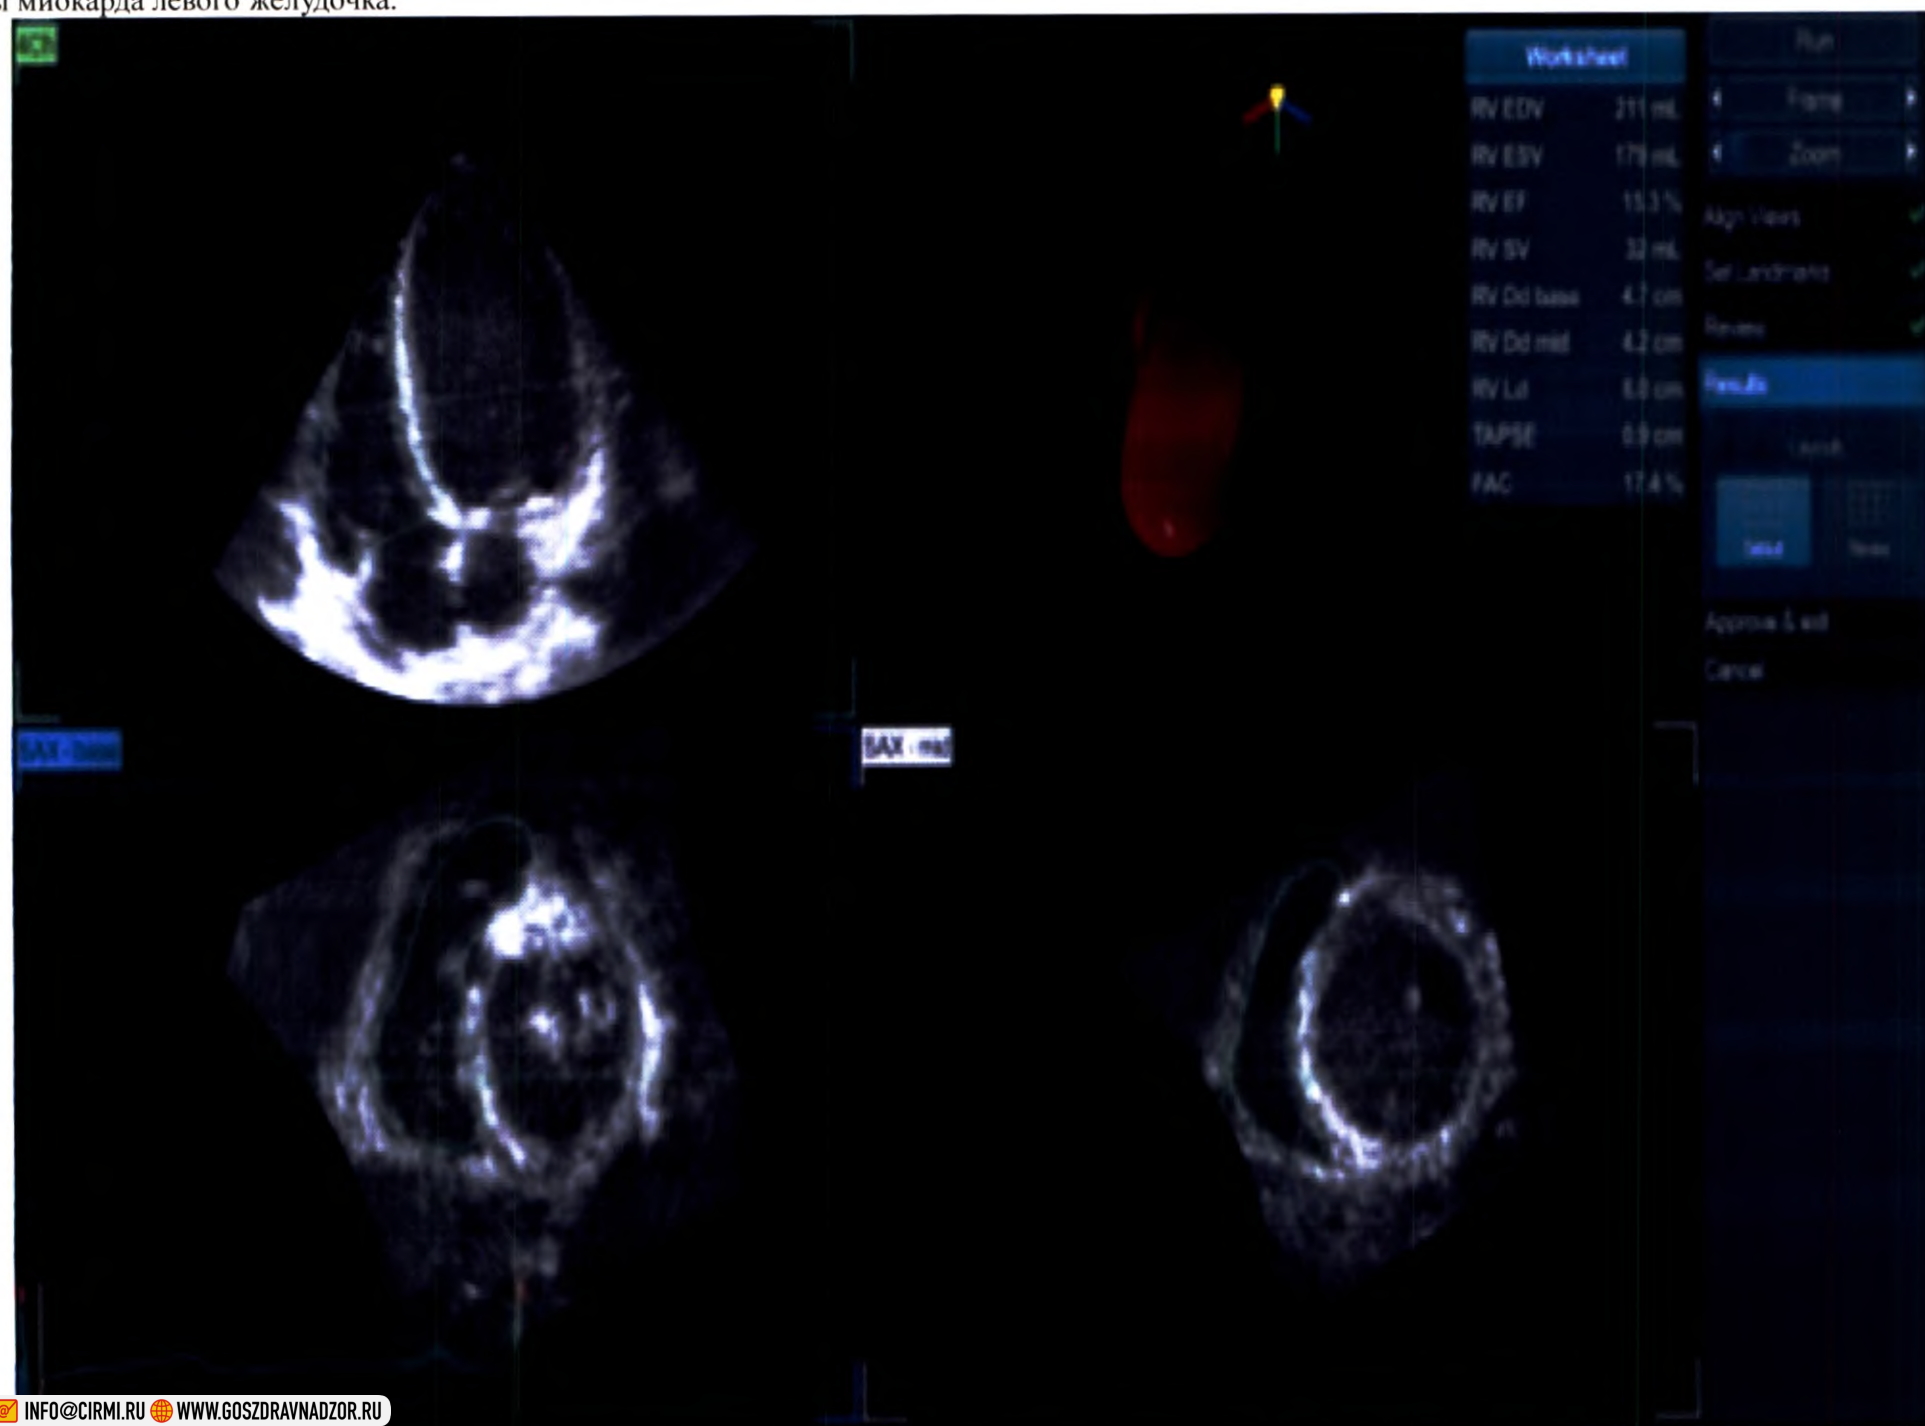


Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований, трехмерный не доплеровский качественный и количественный анализ региональной сократительной функции левого желудочка.

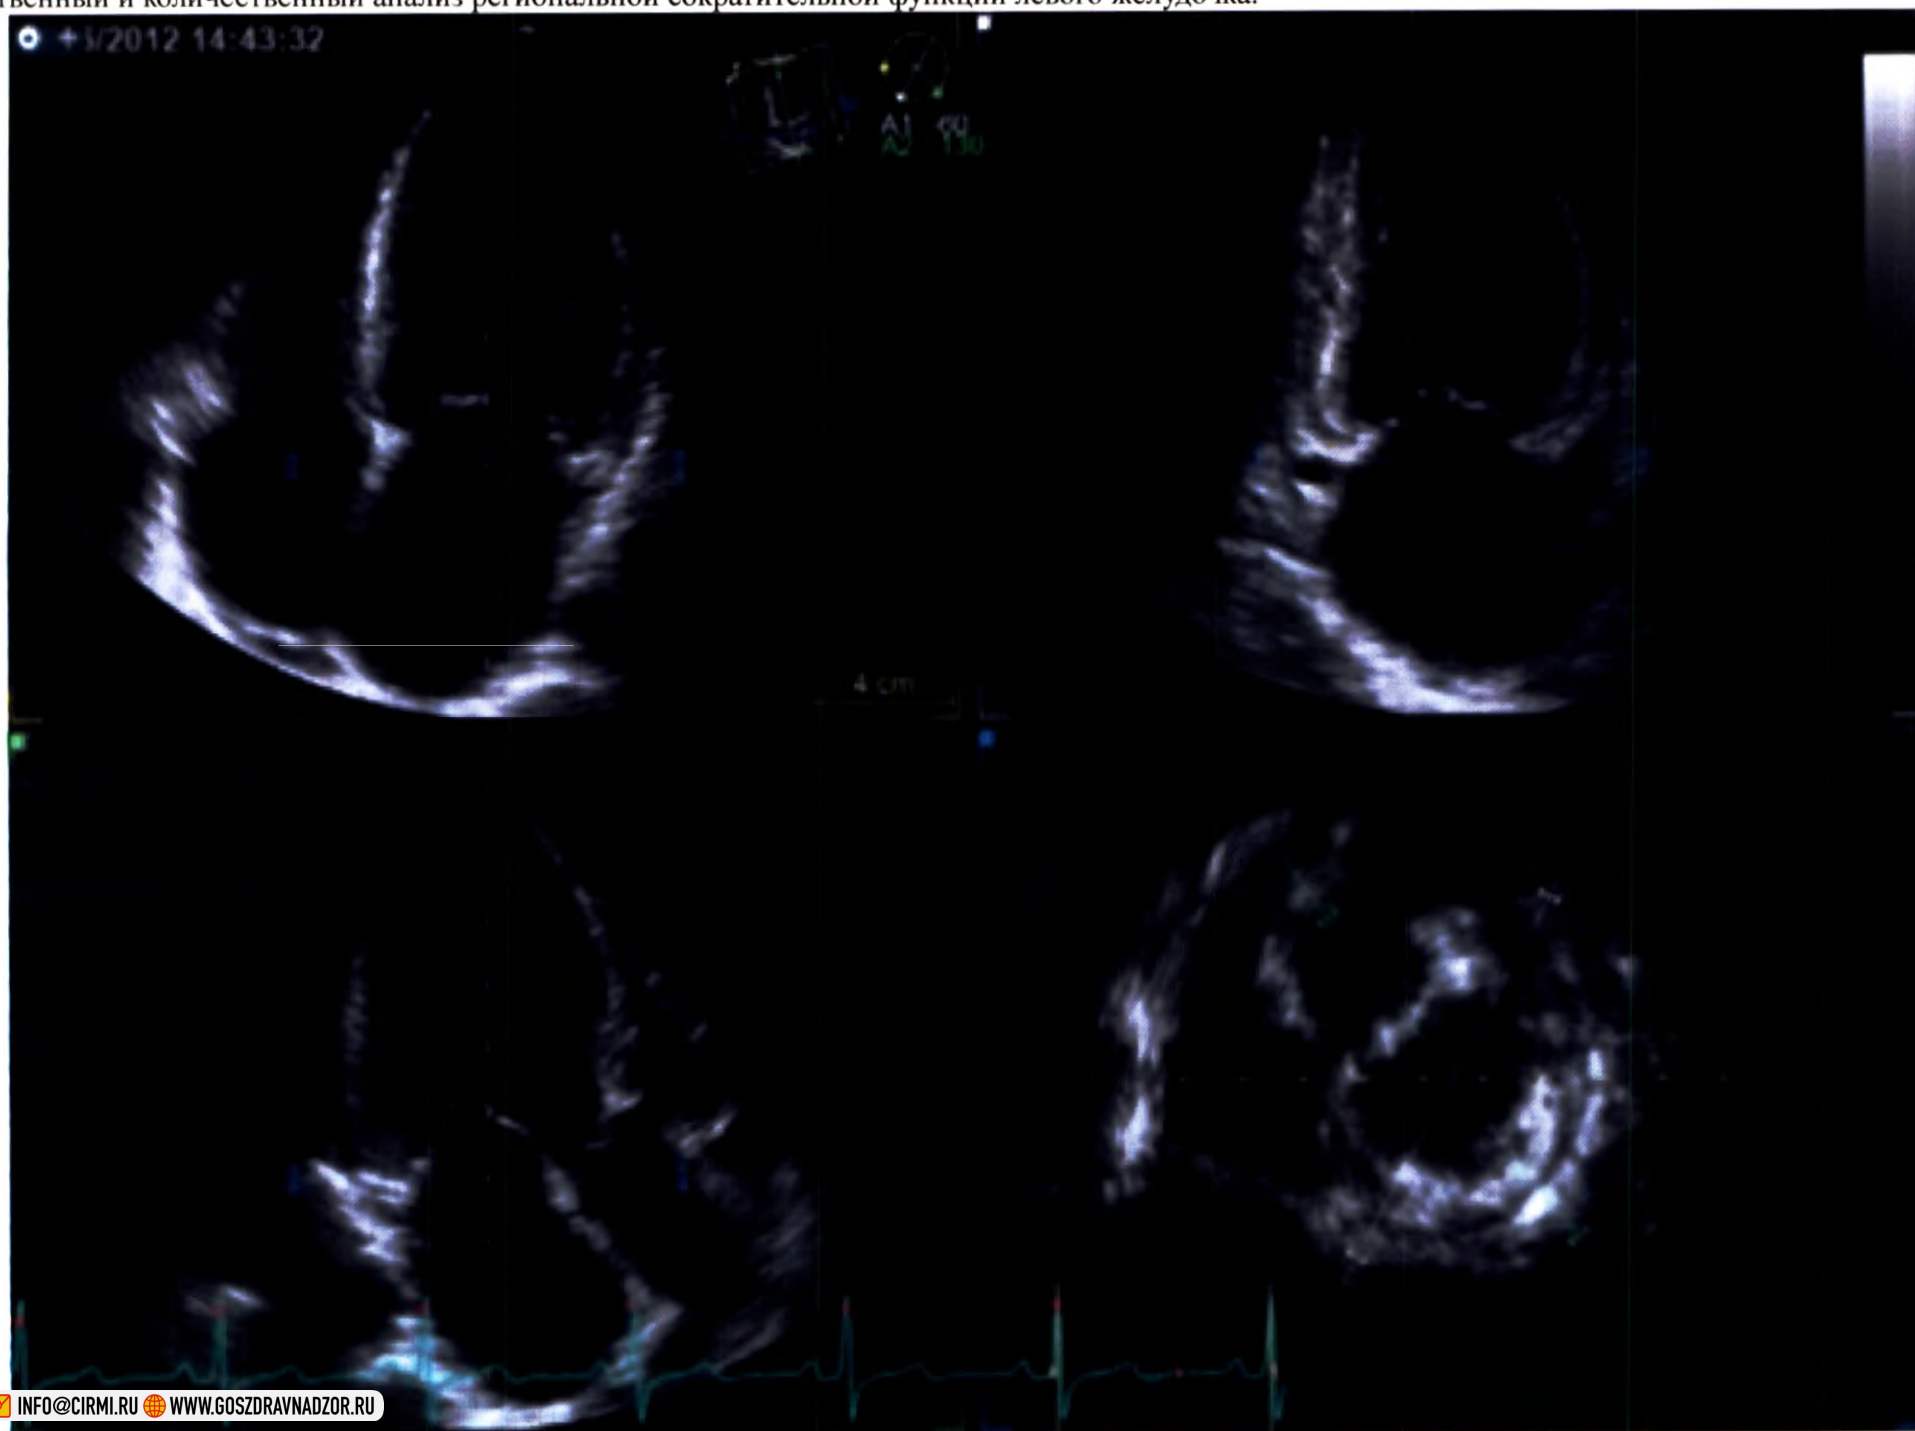


Модуль программного обеспечения для анализа объемных данных научно-практических ультразвуковых исследований, количественная оценка размеров и функции левого предсердия

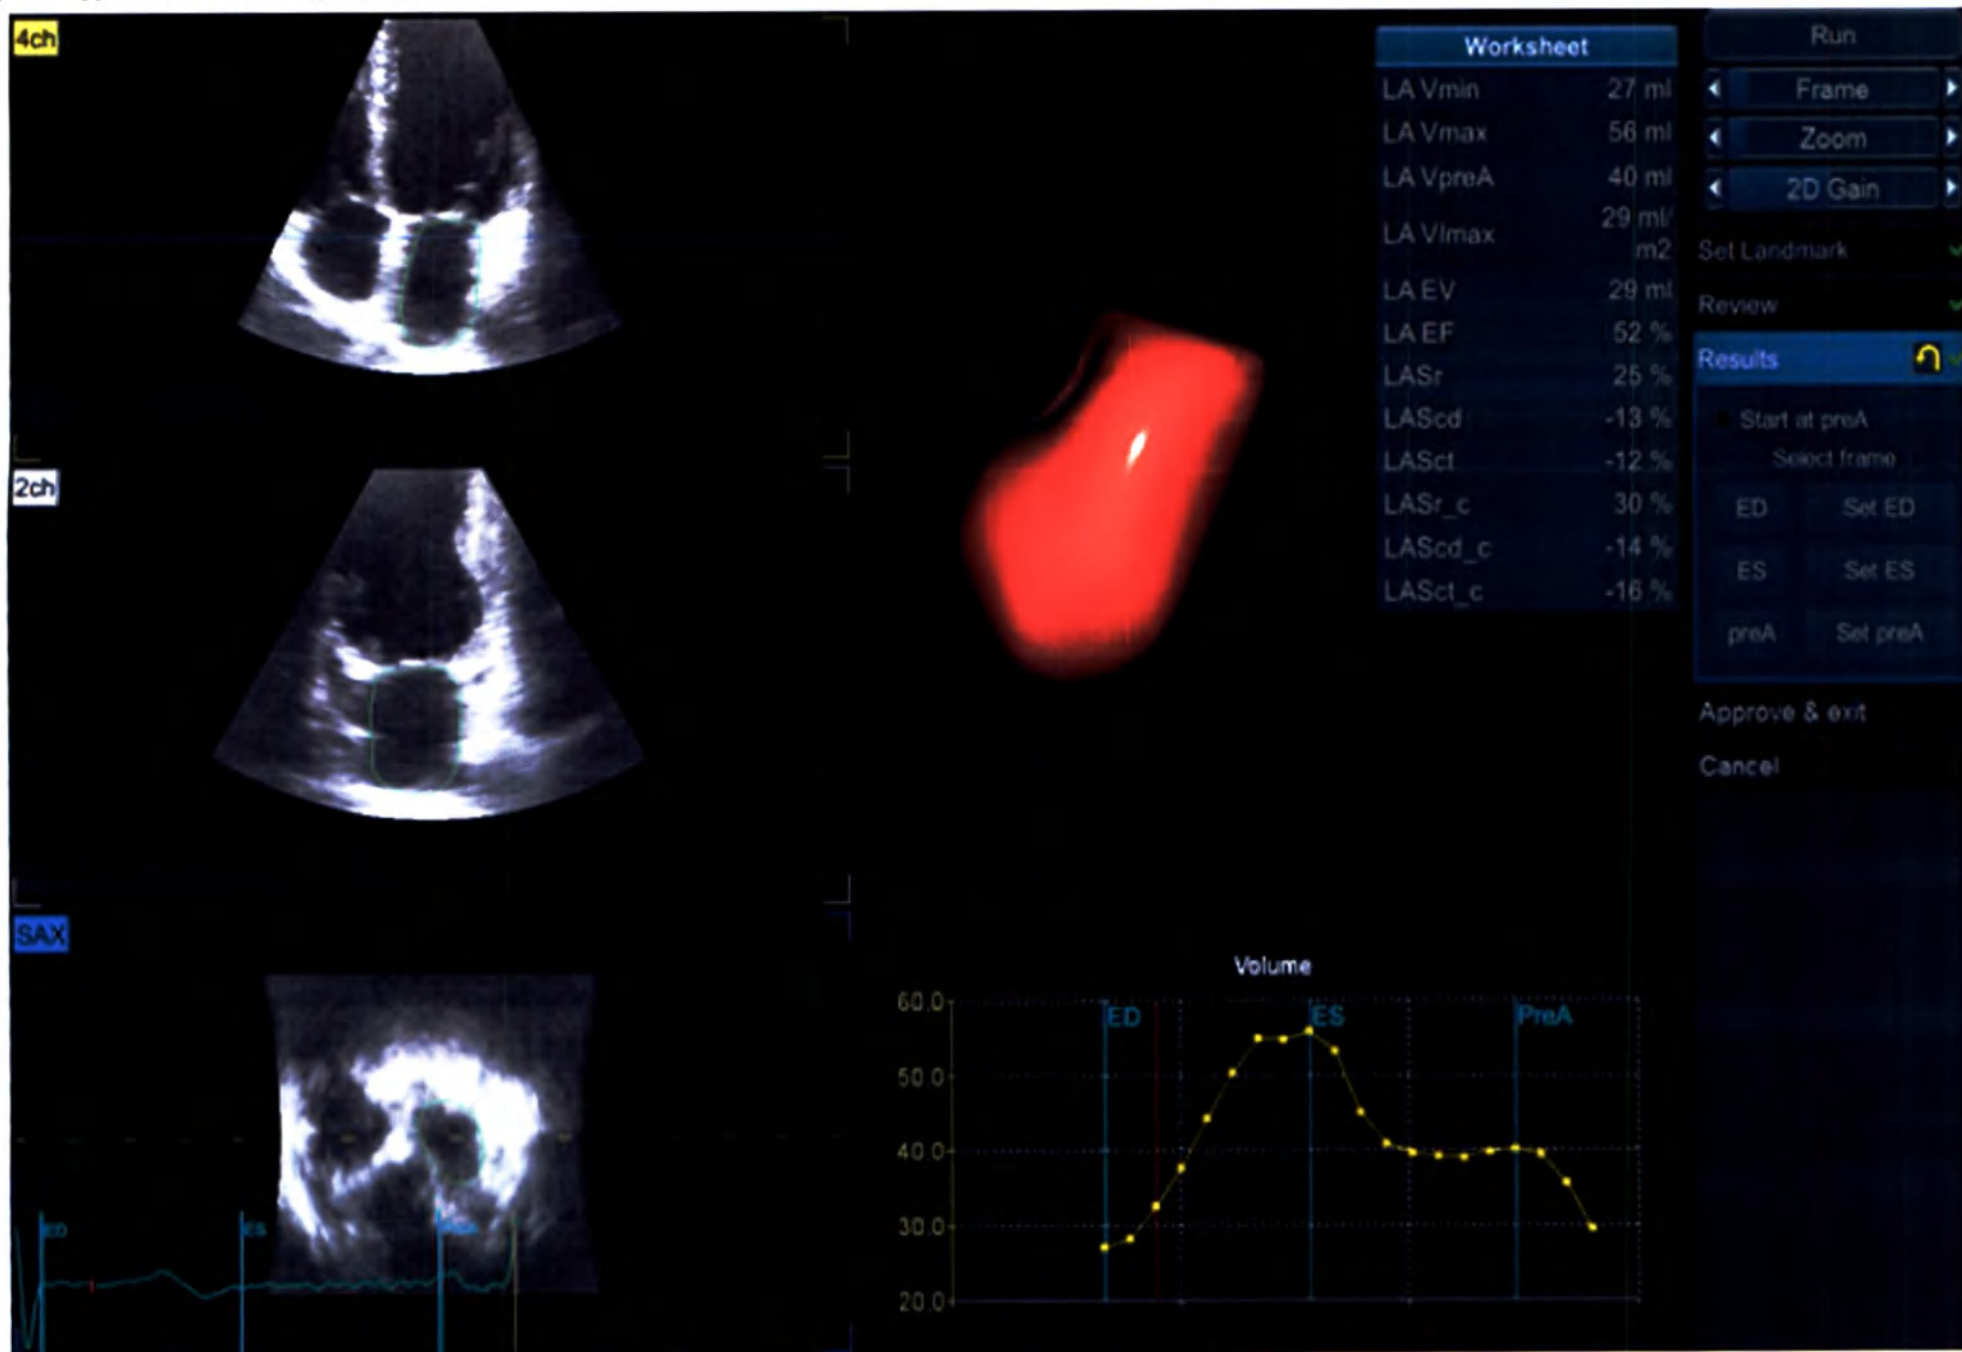

Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований, недоплеровская качественная и количественная оценка глобальной функции сердца, степени деформации миокарда левого предсердия

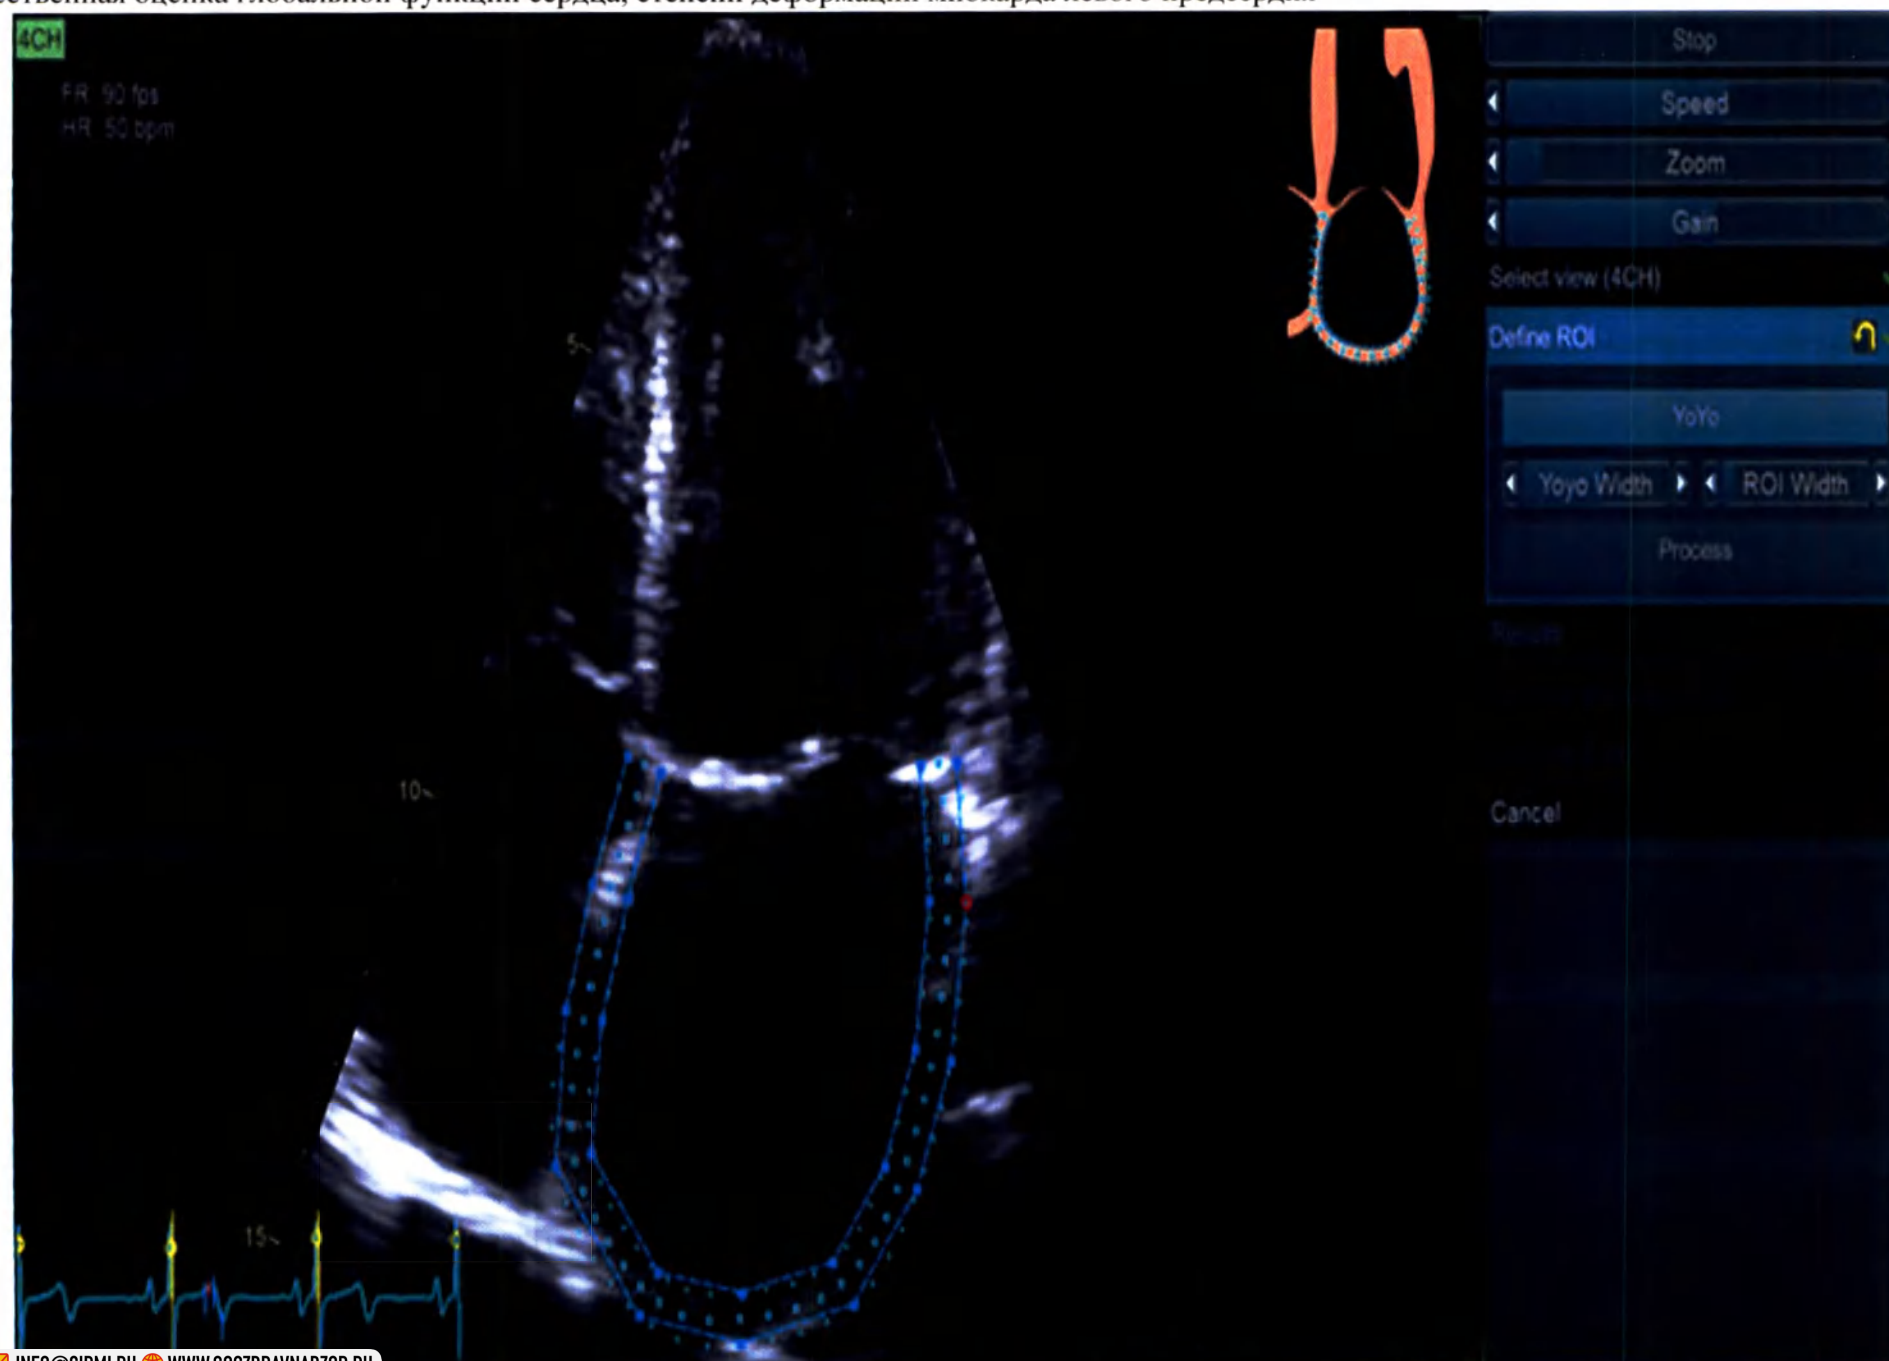


Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований, недоплеровская качественная и количественная оценка глобальной функции сердца, степени деформации миокарда левого предсердия

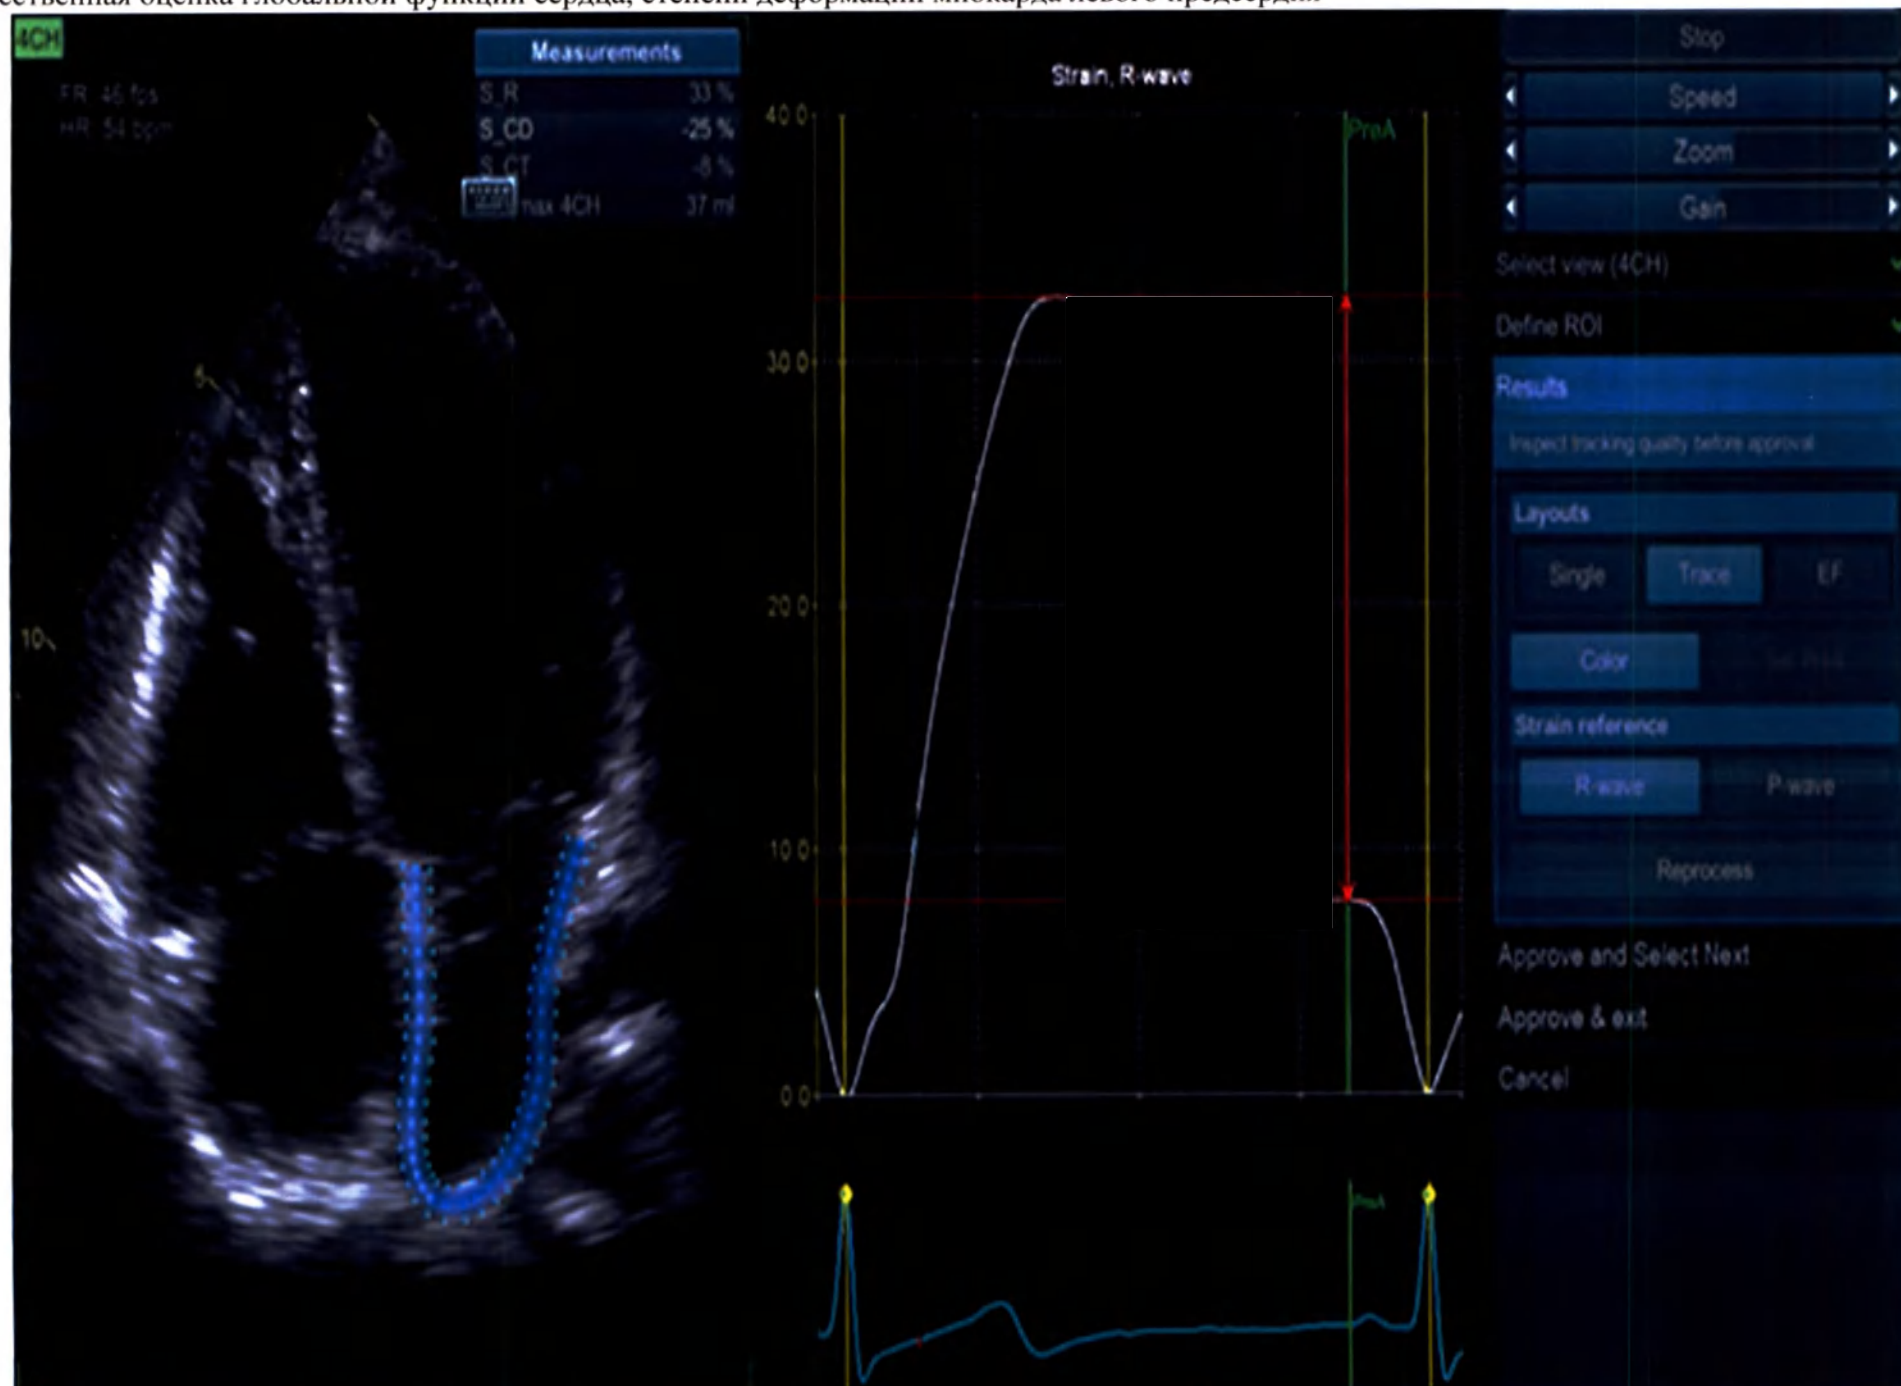


Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований, недоплеровская качественная и количественная оценка глобальной функции сердца, степени деформации миокарда левого предсердия




Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований, недоплеровская качественная и количественная оценка глобальной функции сердца, степени деформации миокарда левого предсердия

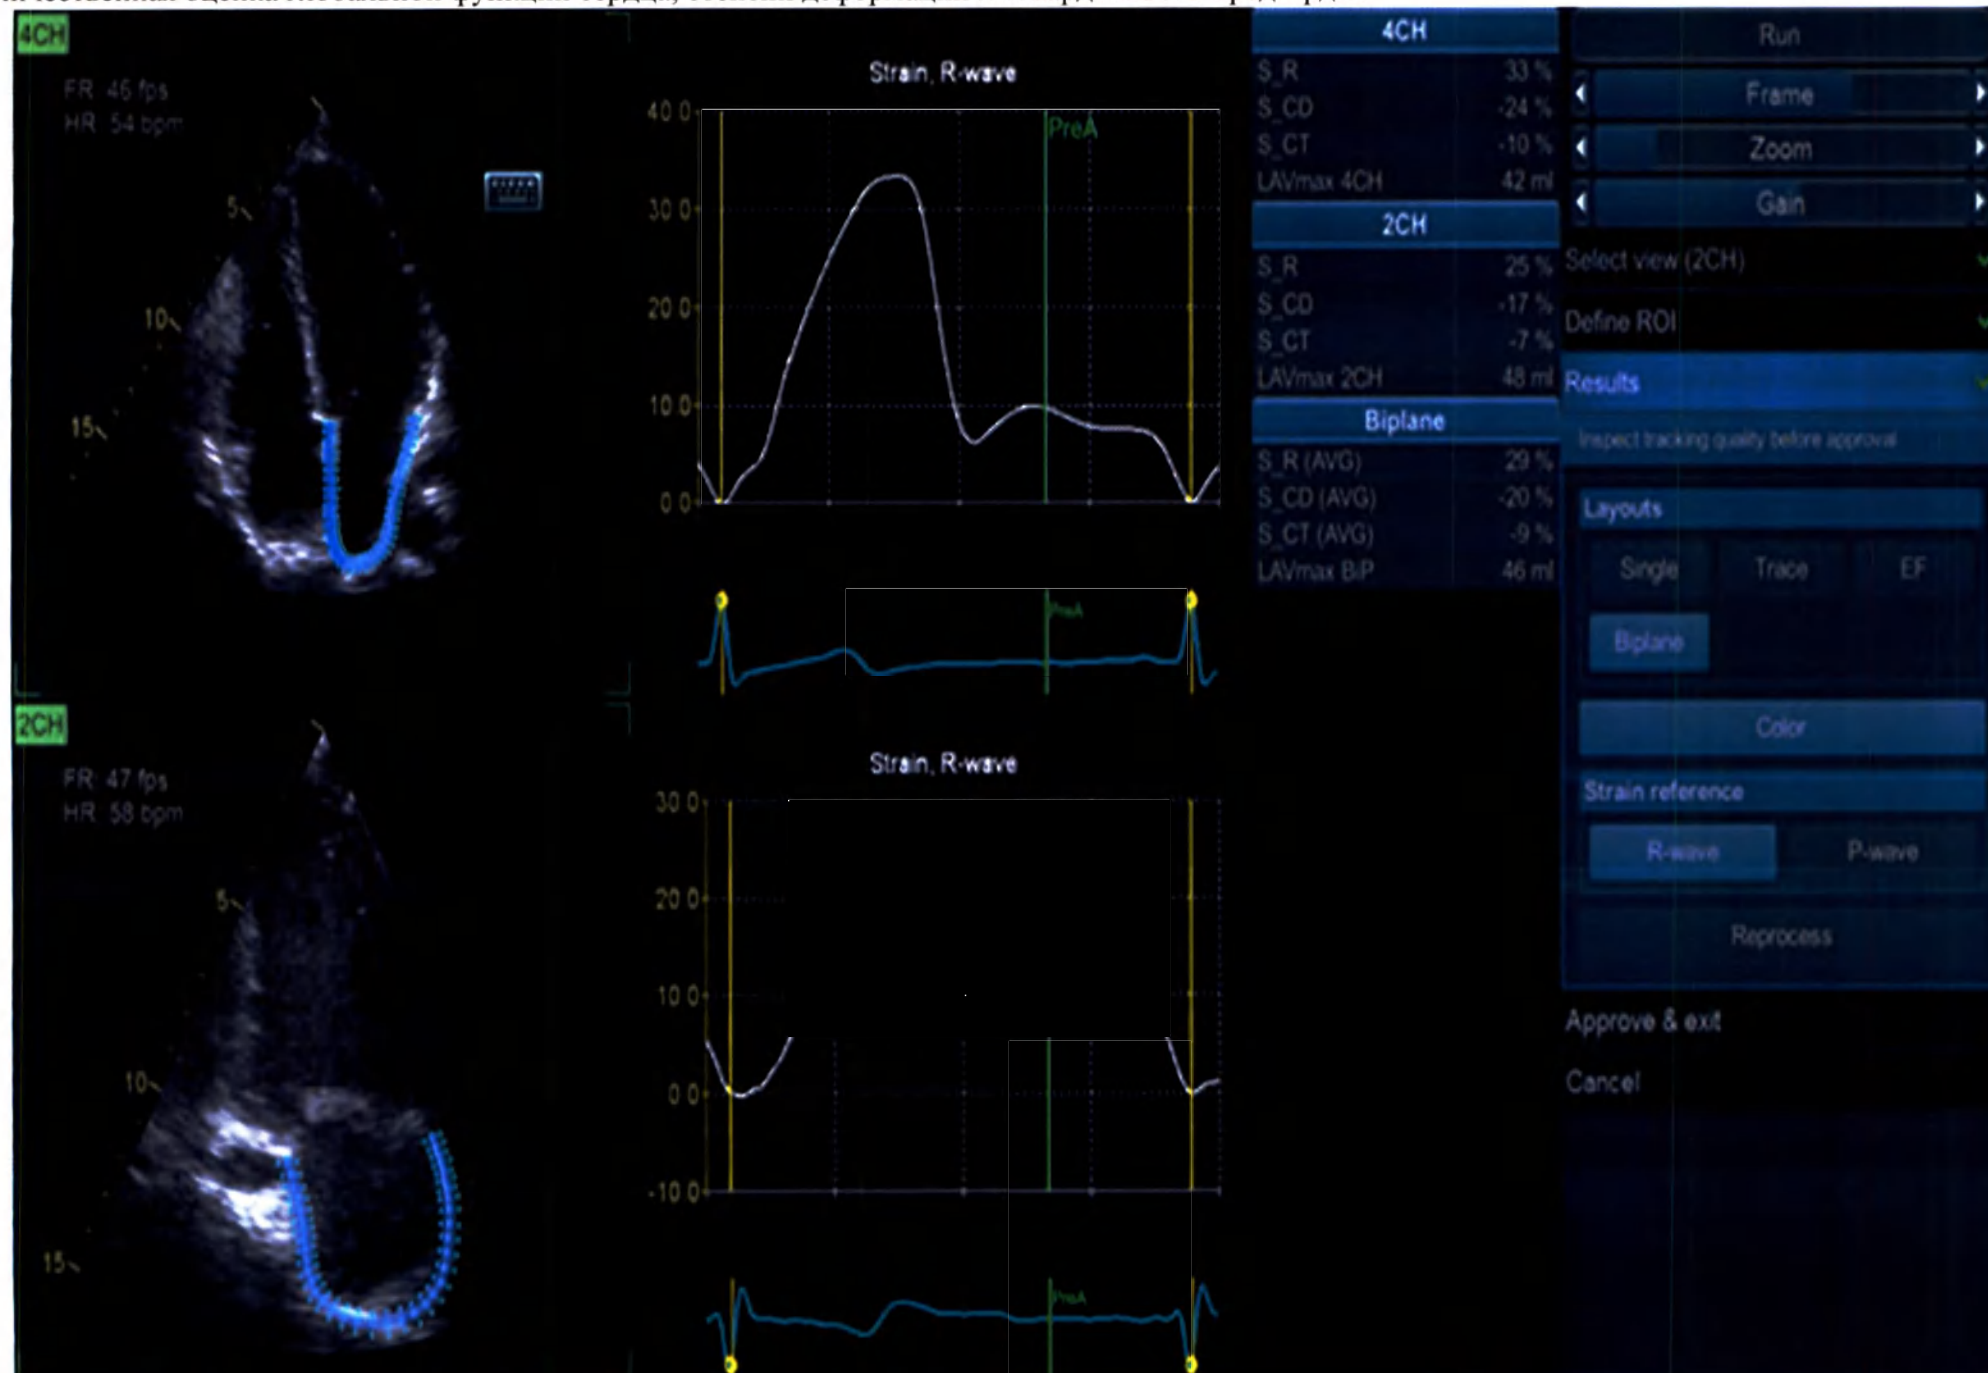


Модуль программного обеспечения для анализа объемных данных научно-практических ультразвуковых исследований, качественный и количественный анализ глобальной и региональной сократительной функции правого желудочка

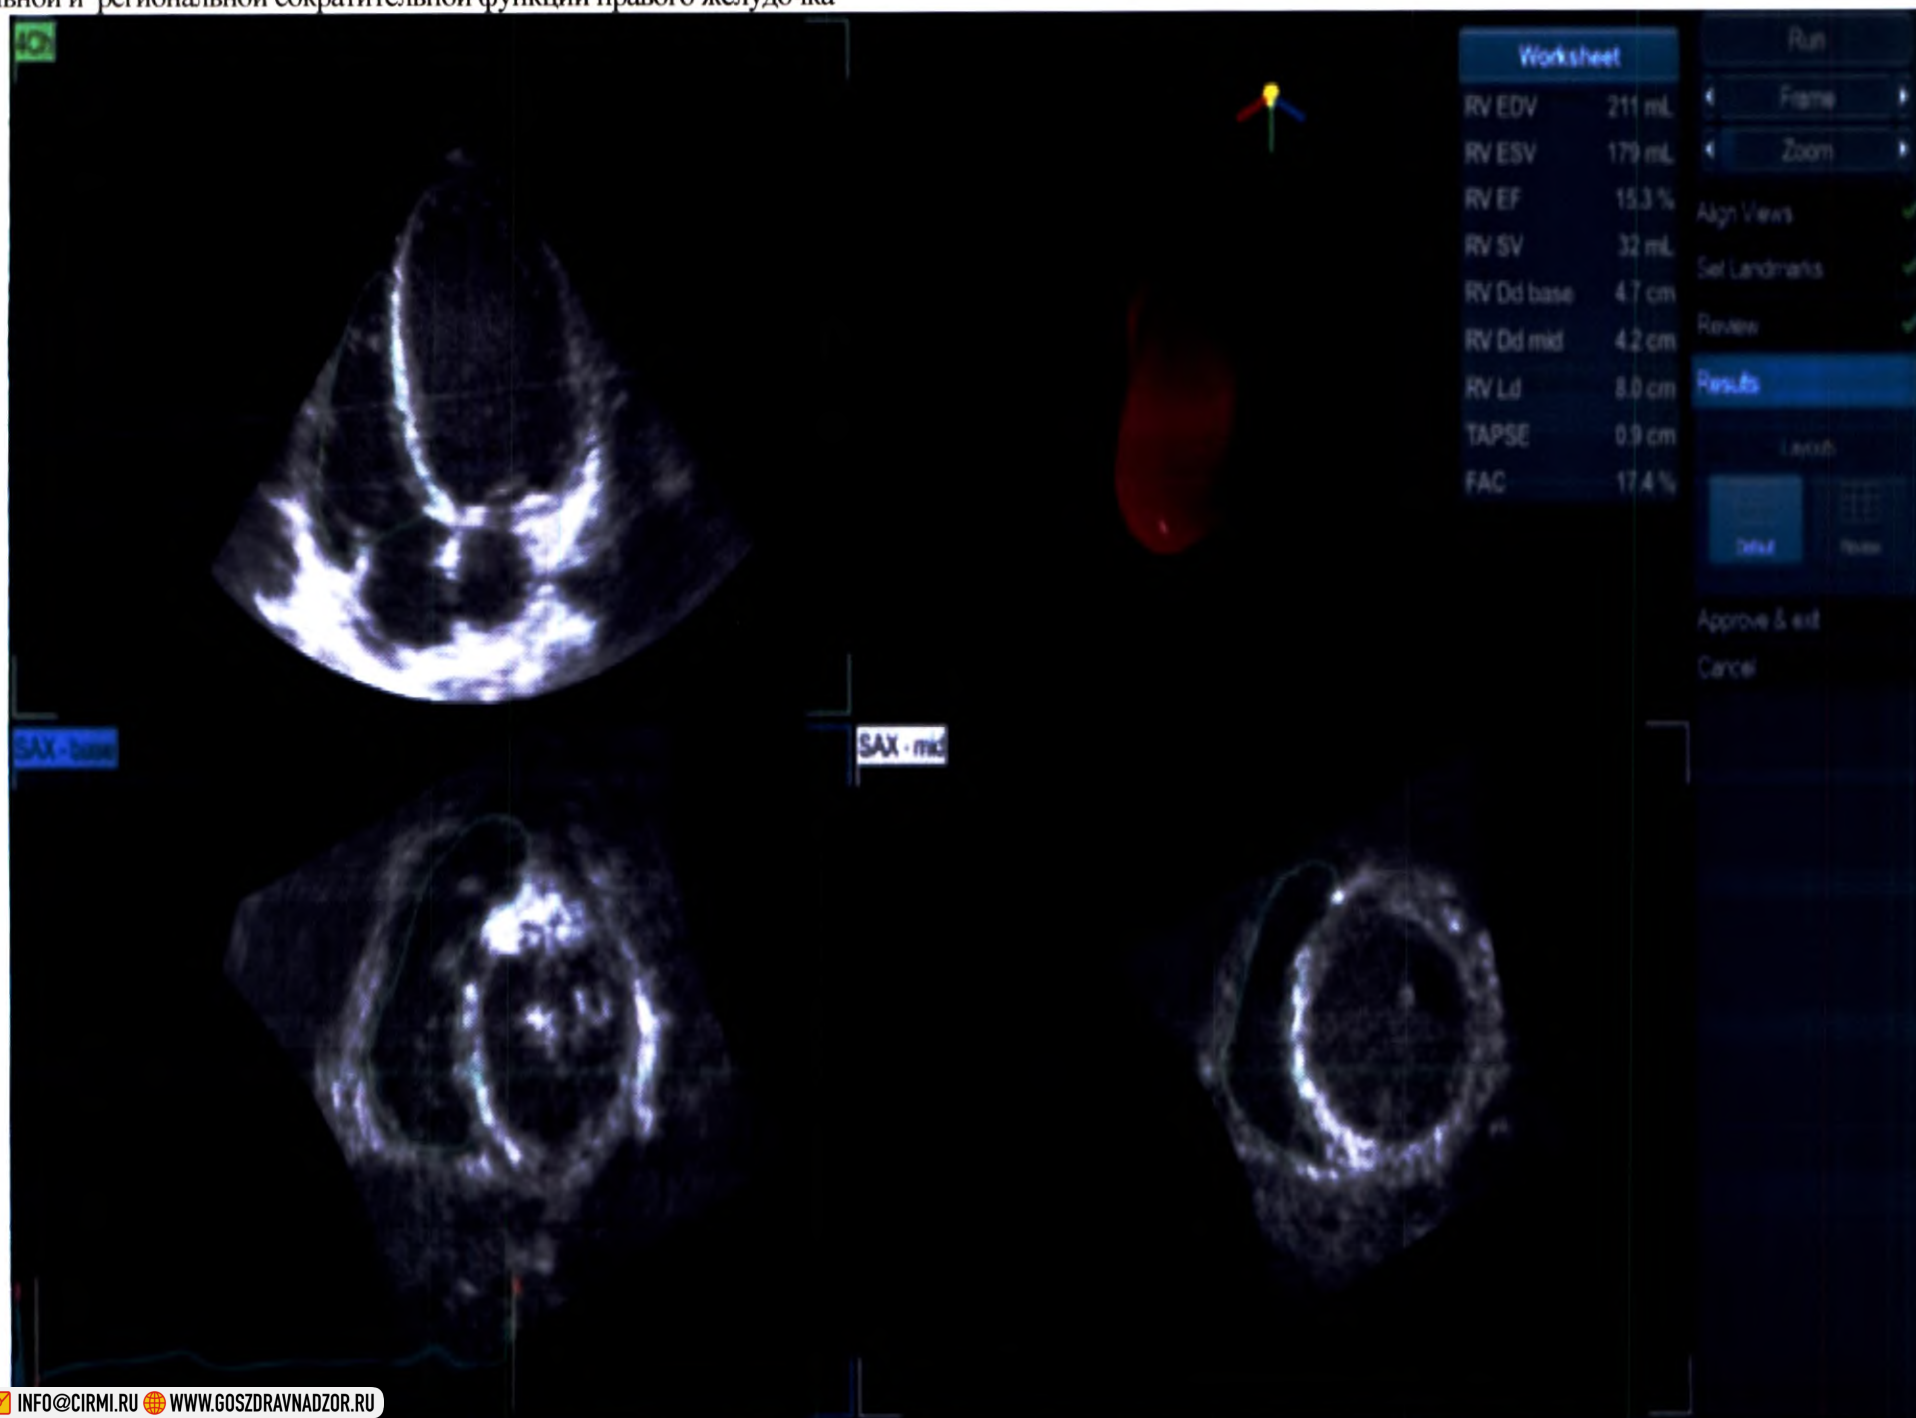


Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований, неоплеровская качественная и количественная оценка глобальной и региональной функции сердца, степени деформации миокарда правого желудочка

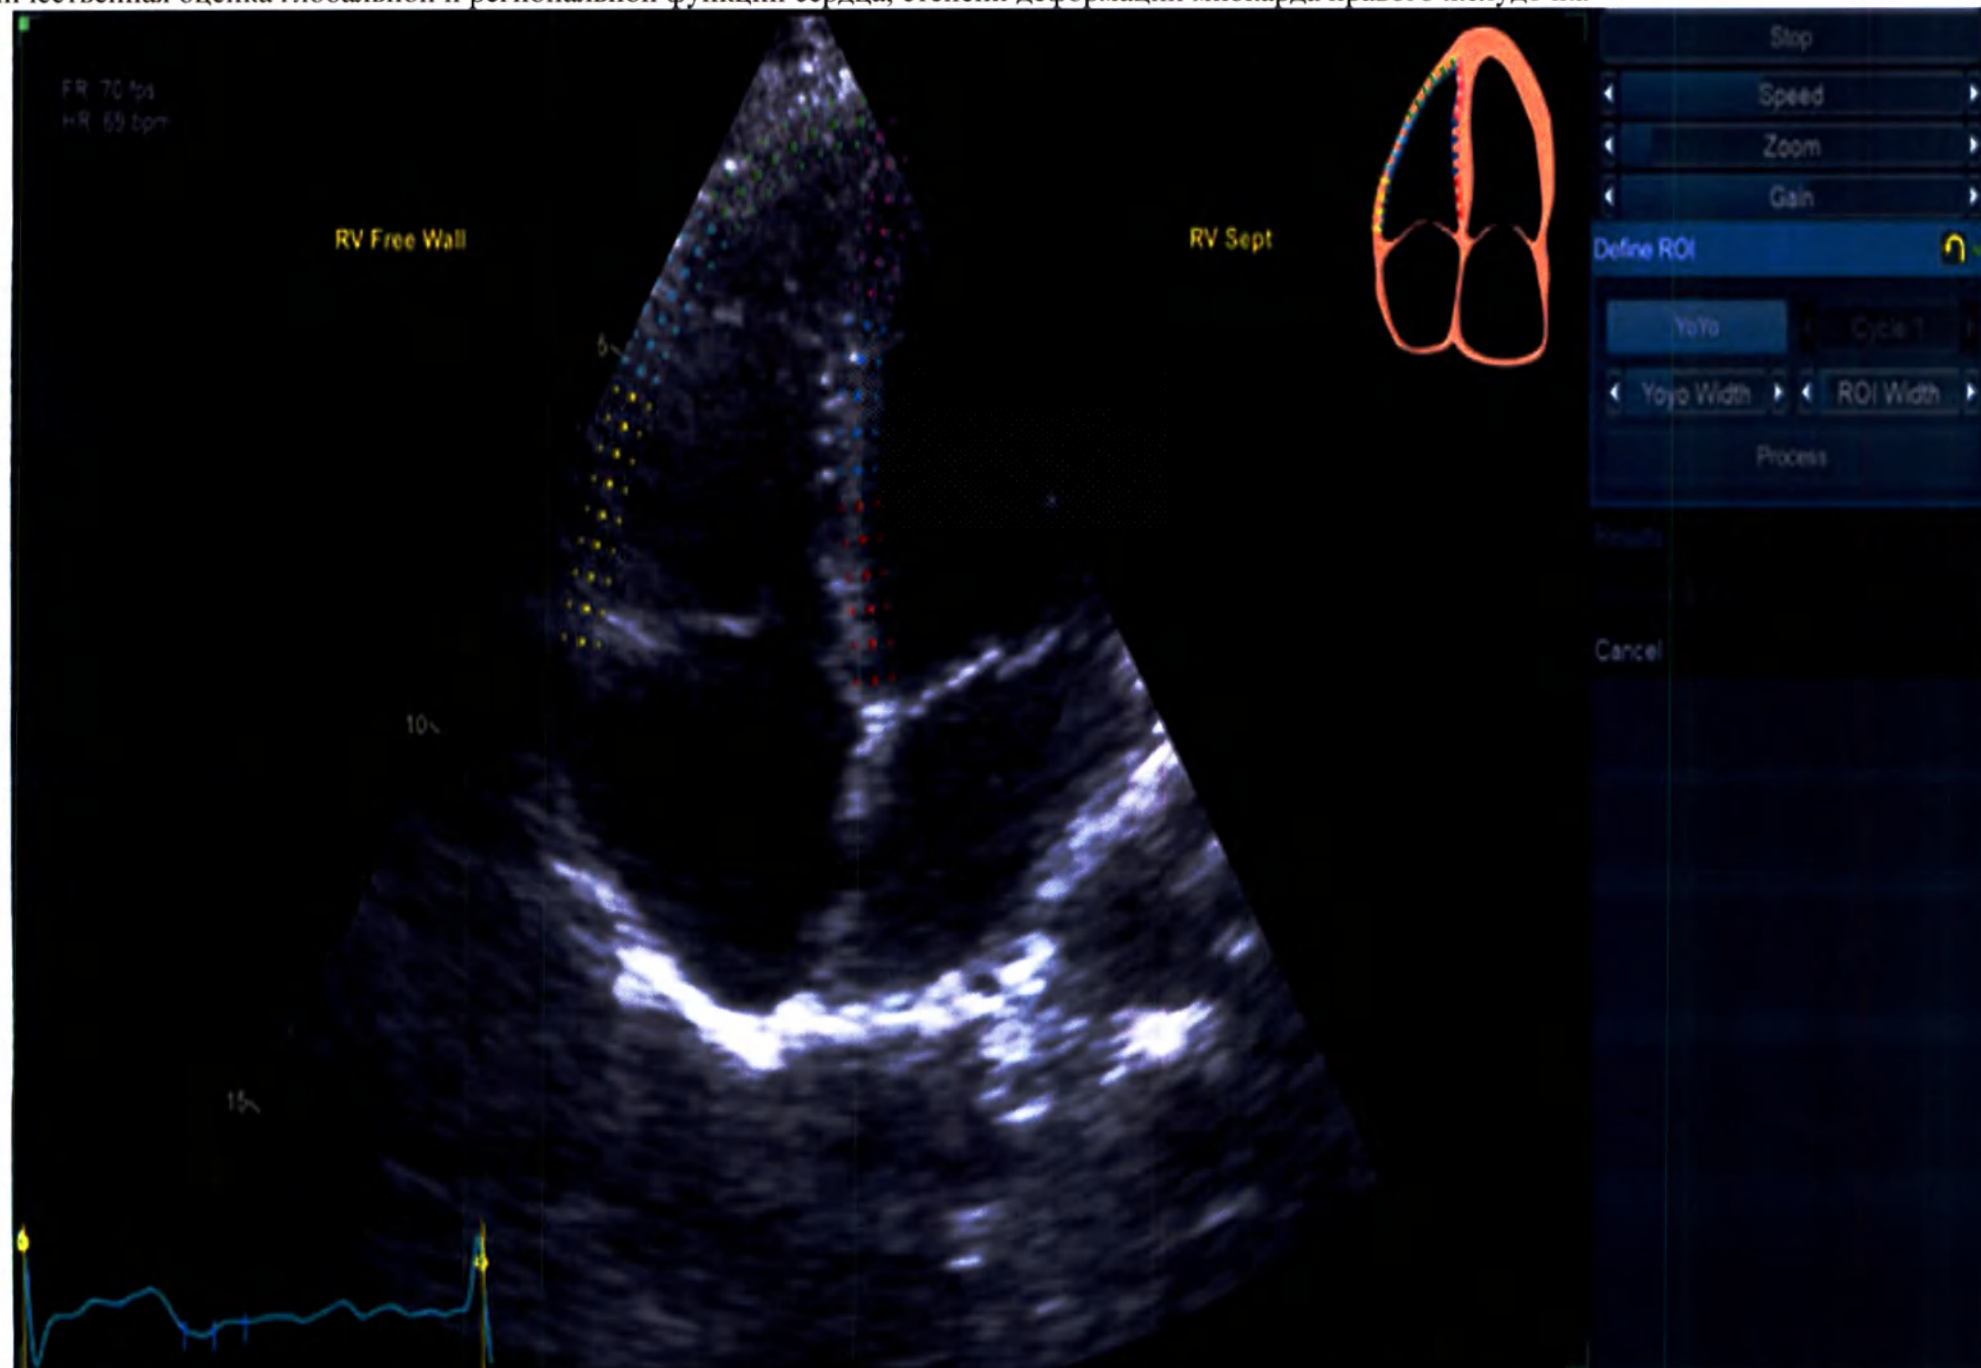

Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований, неоплеровская качественная и количественная оценка глобальной и региональной функции сердца, степени деформации миокарда правого желудочка

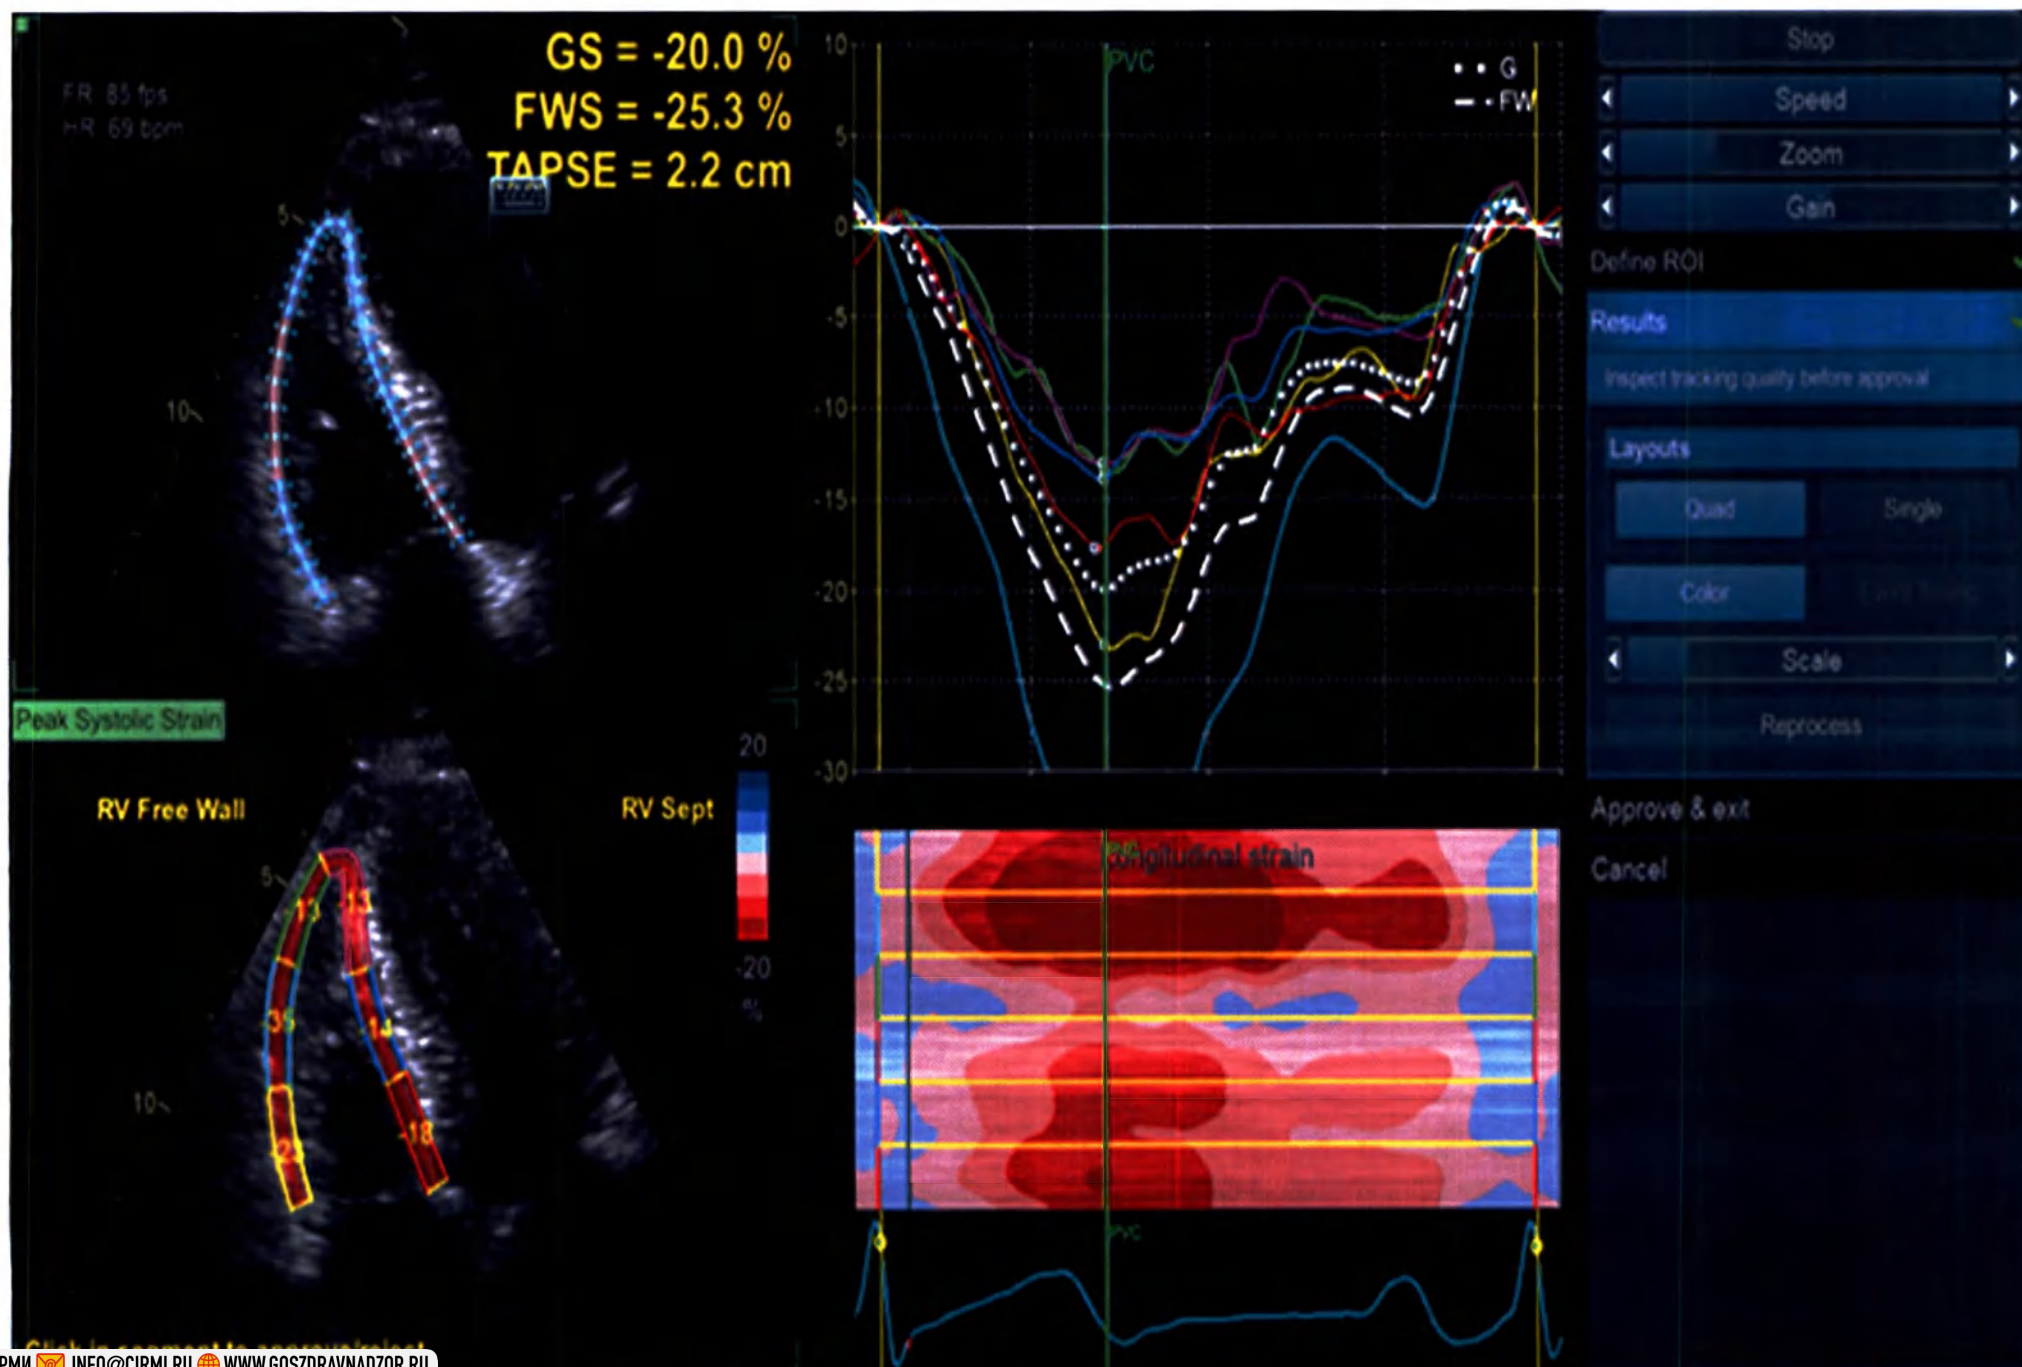


Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований, трехмерный качественный и количественный анализ и моделирование работы митрального клапана.

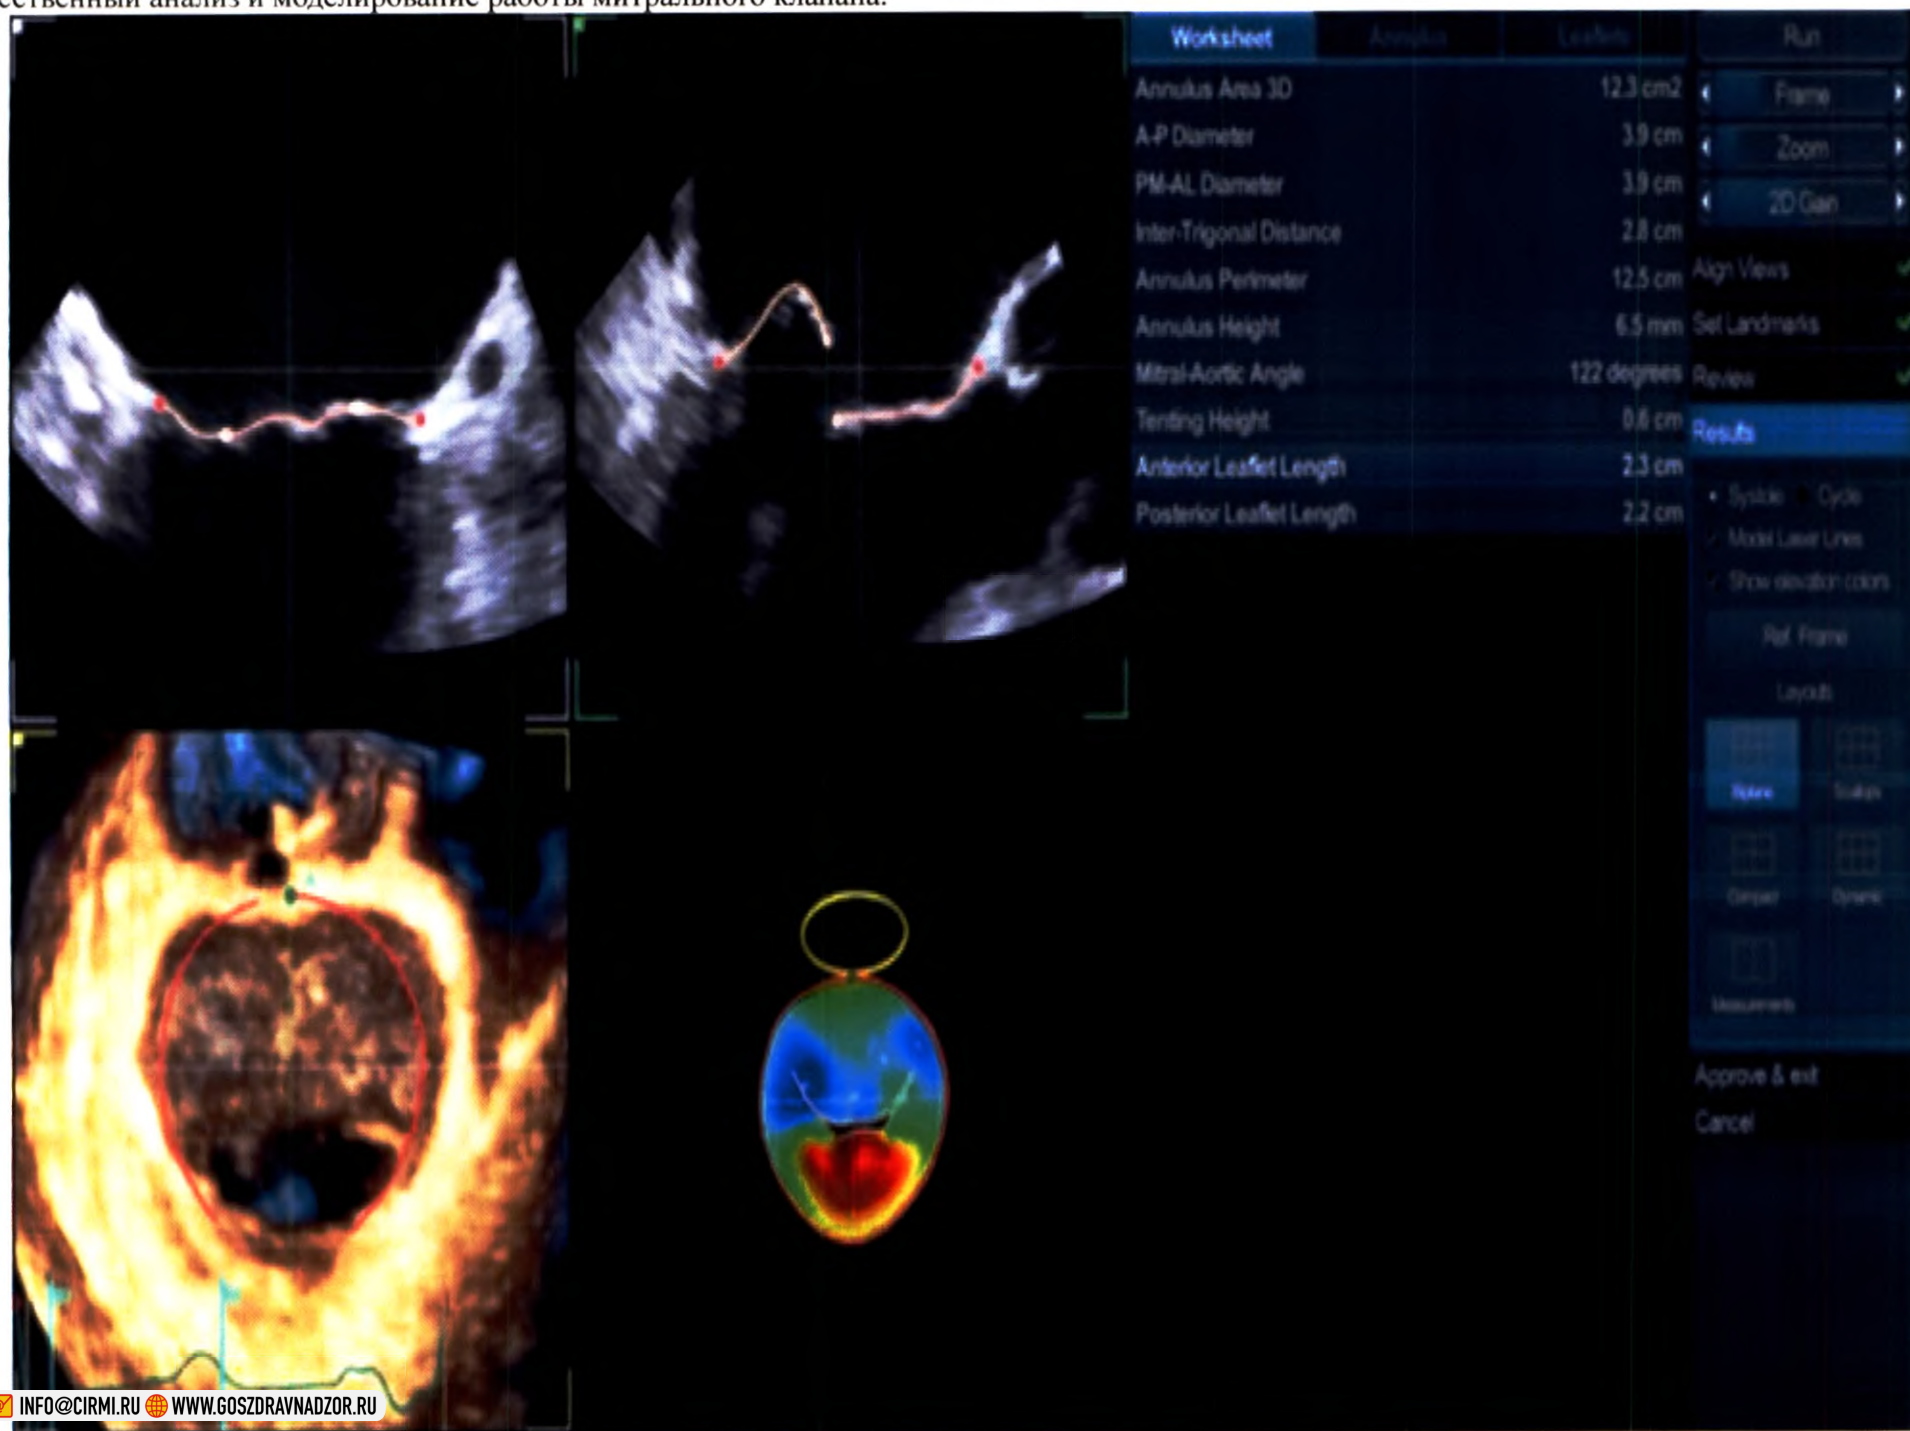


Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований, автоматического анализа и обработки объемных данных, количественной оценки размеров кольца аортального клапана




Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований, трехмерный качественный и количественный анализ и моделирование работы трикуспидального клапана

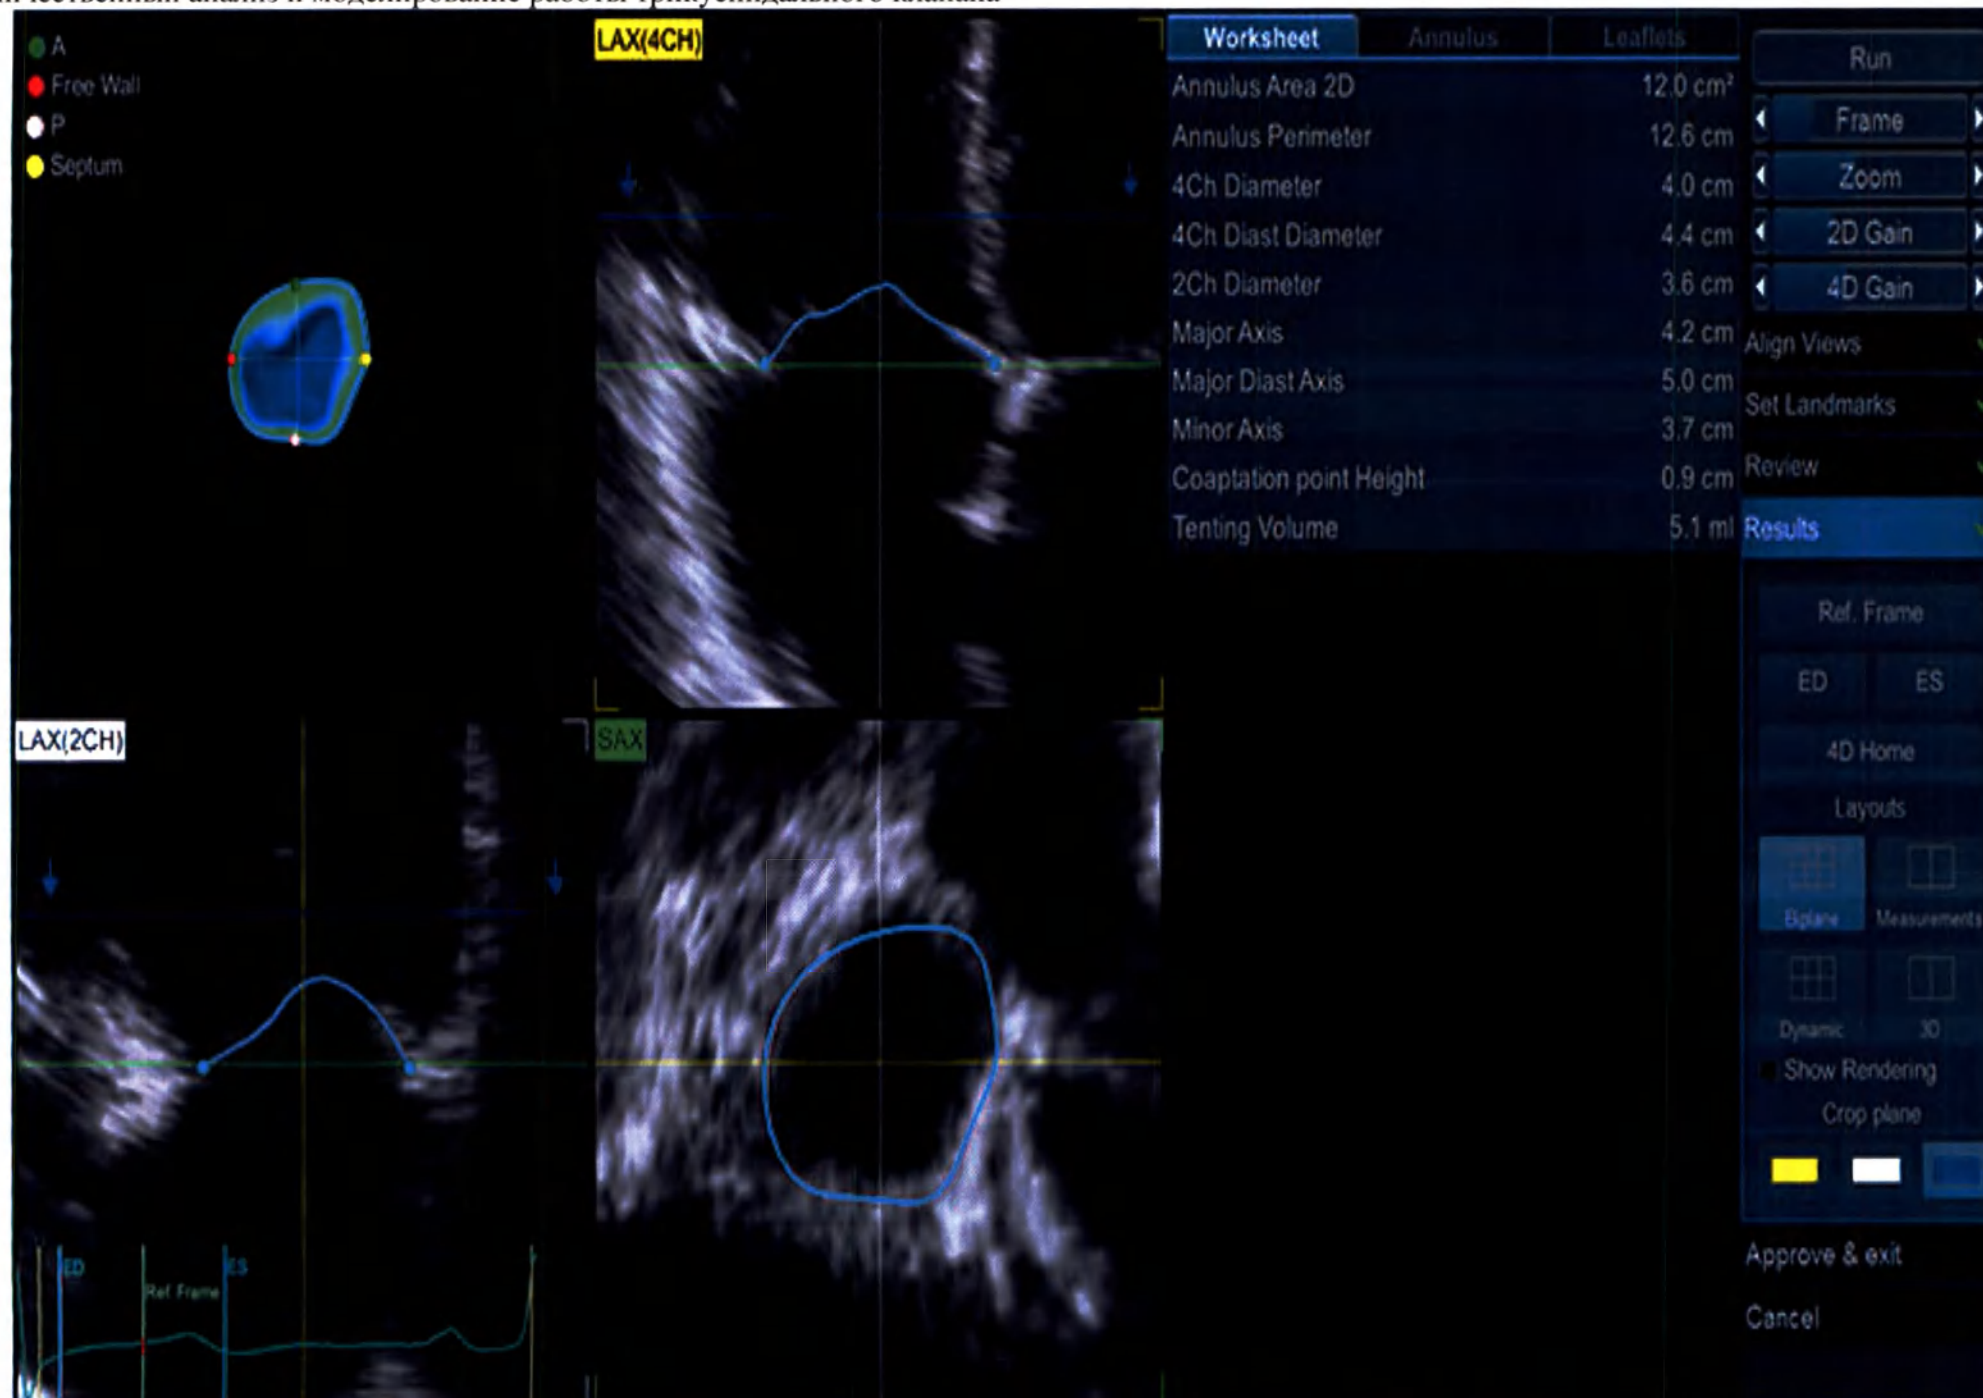


Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований, расширенной неинвазивной качественной и количественной оценки глобальной и регионарной кинетики миокарда

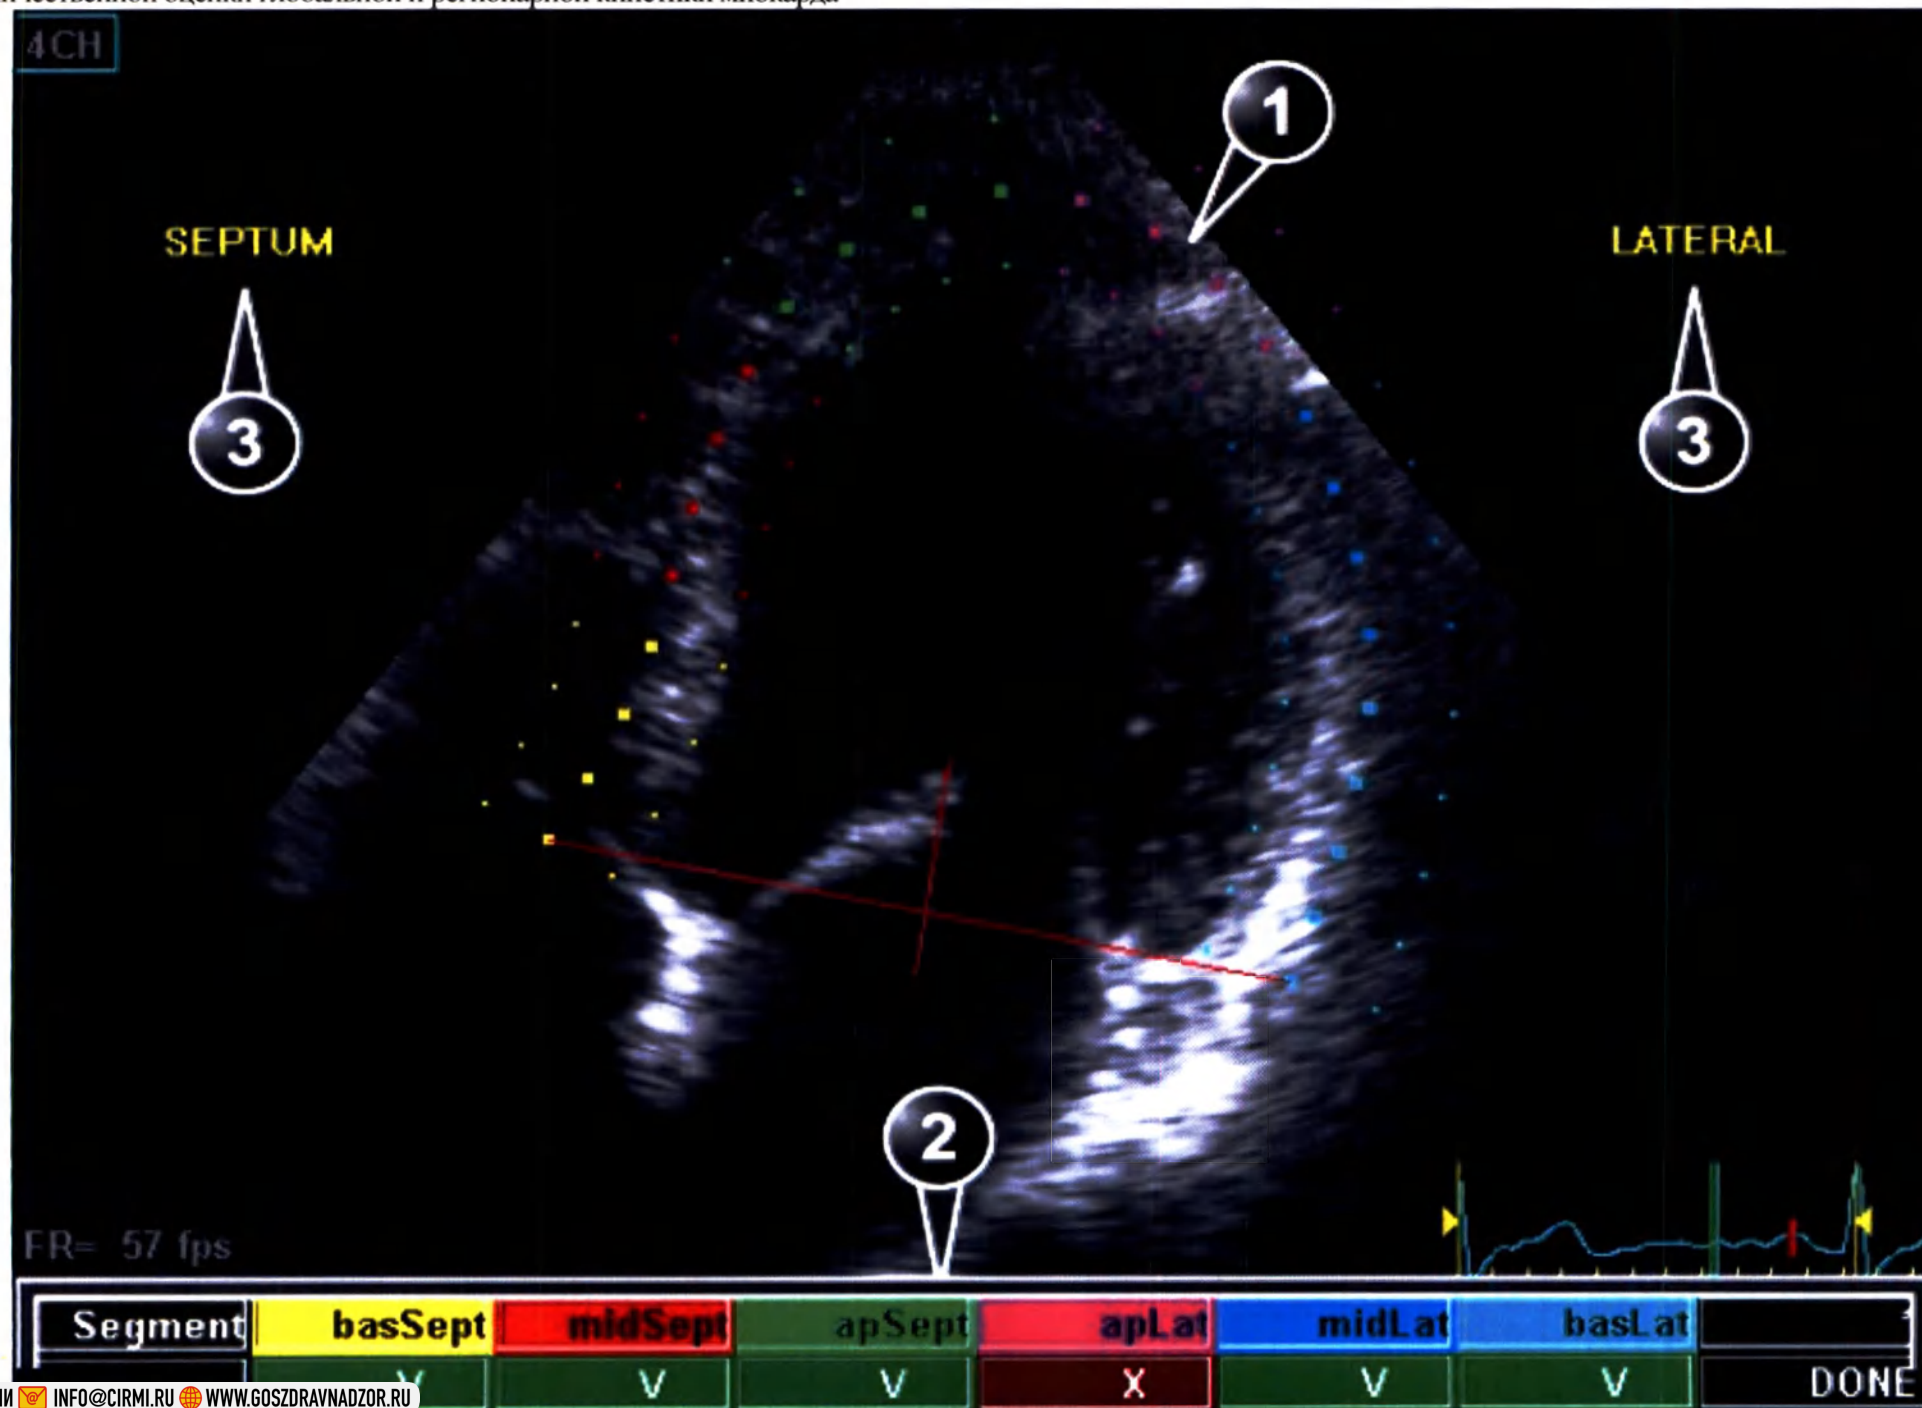



Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований, неоплеровской качественной и количественной оценки региональной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда для оценки результатов стресс-исследования.

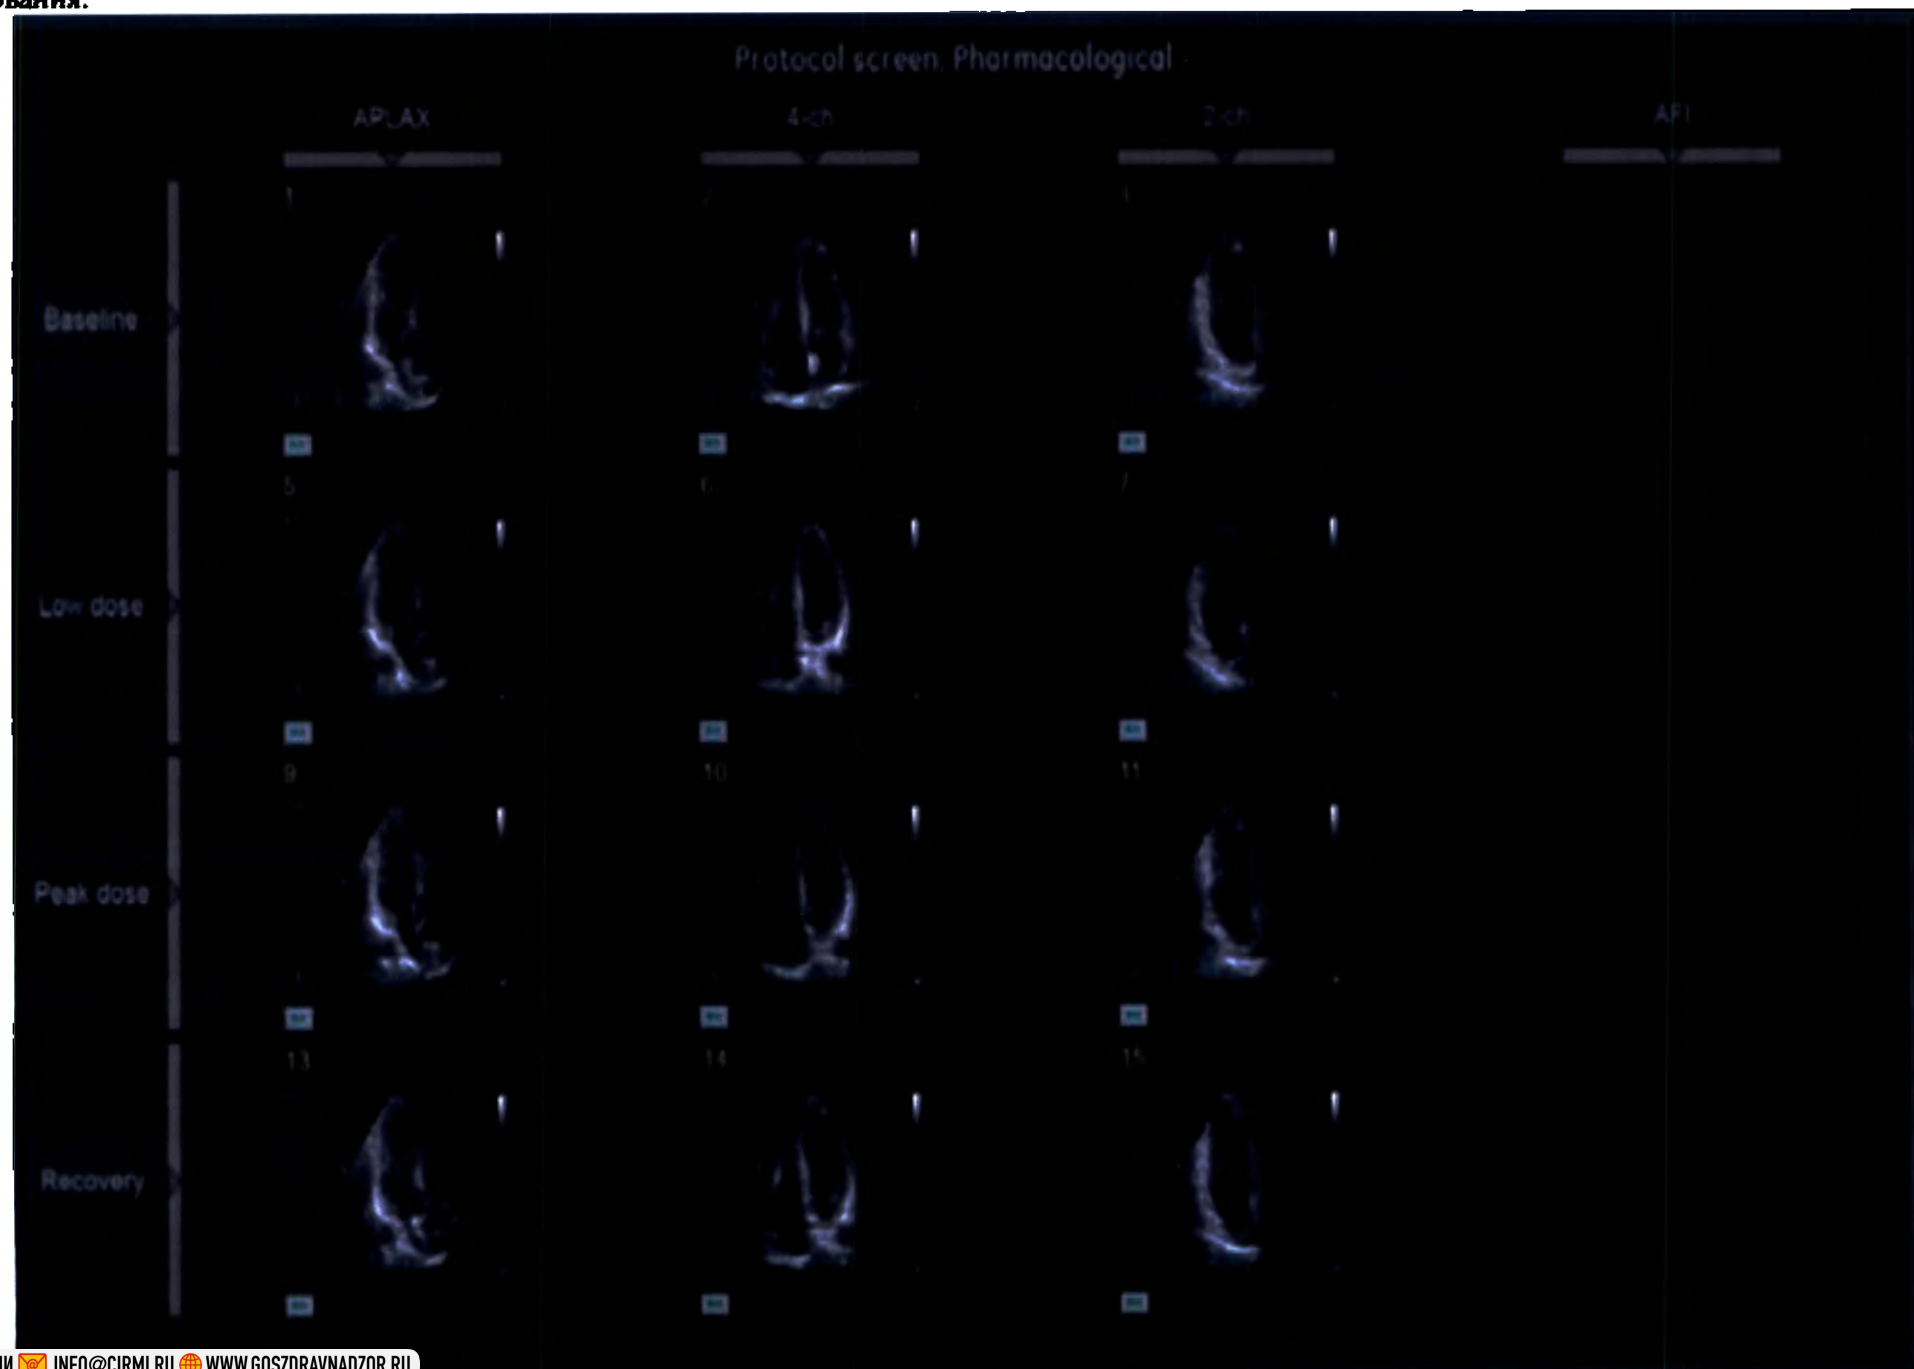


Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований, обработки и улучшенной визуализации объемных структур.

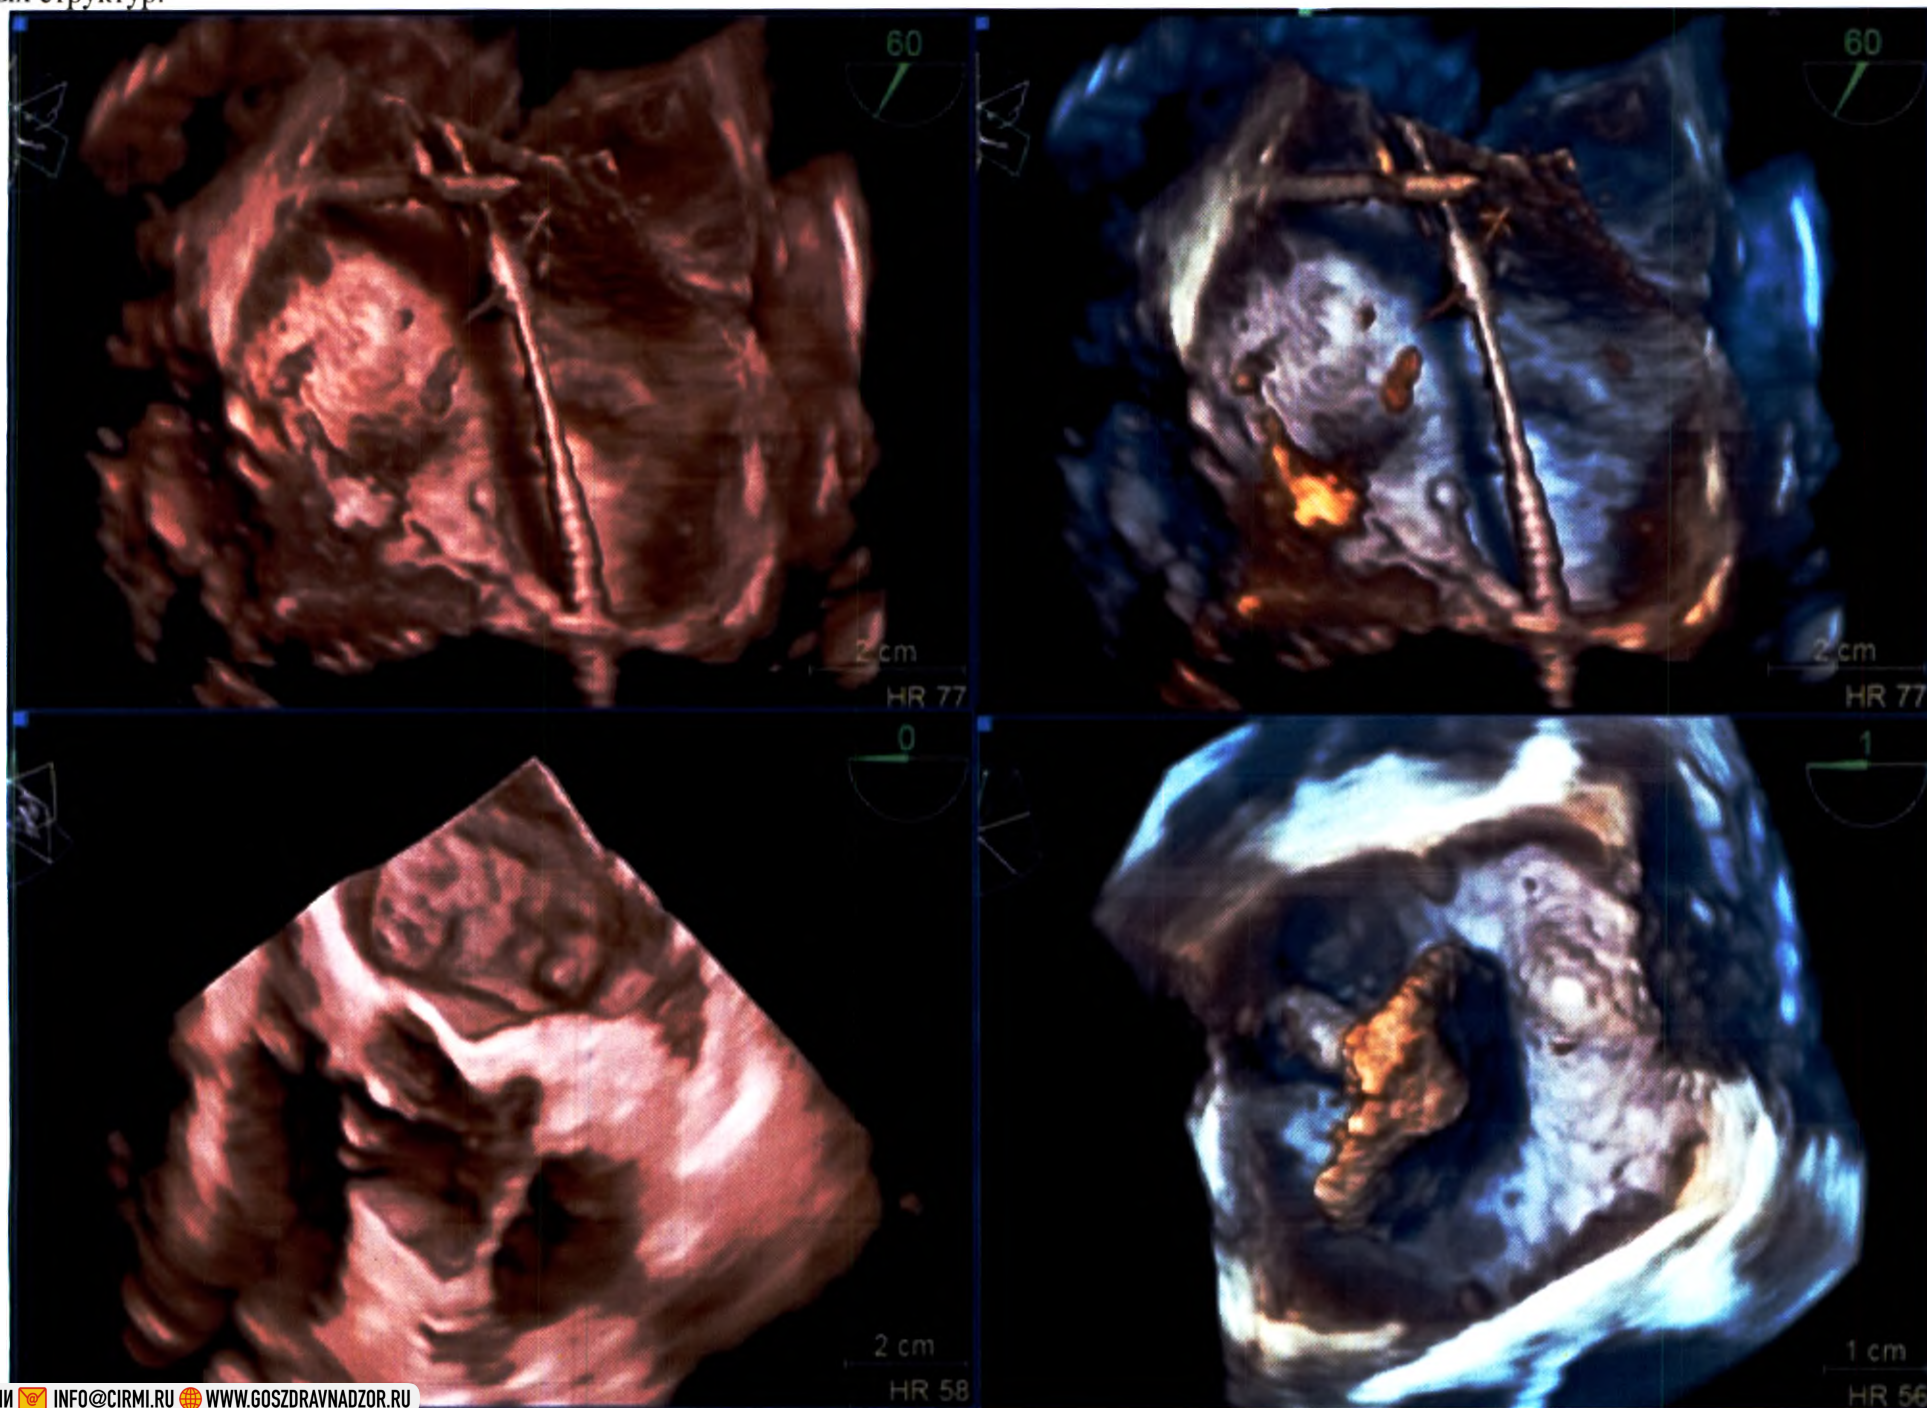


Модуль программного обеспечения для работы в режиме улучшенной 4D-объемной визуализации тканей и данных цветового доплера в реальном времени и постобработке, в том числе с применением технологии перемещаемого источника света

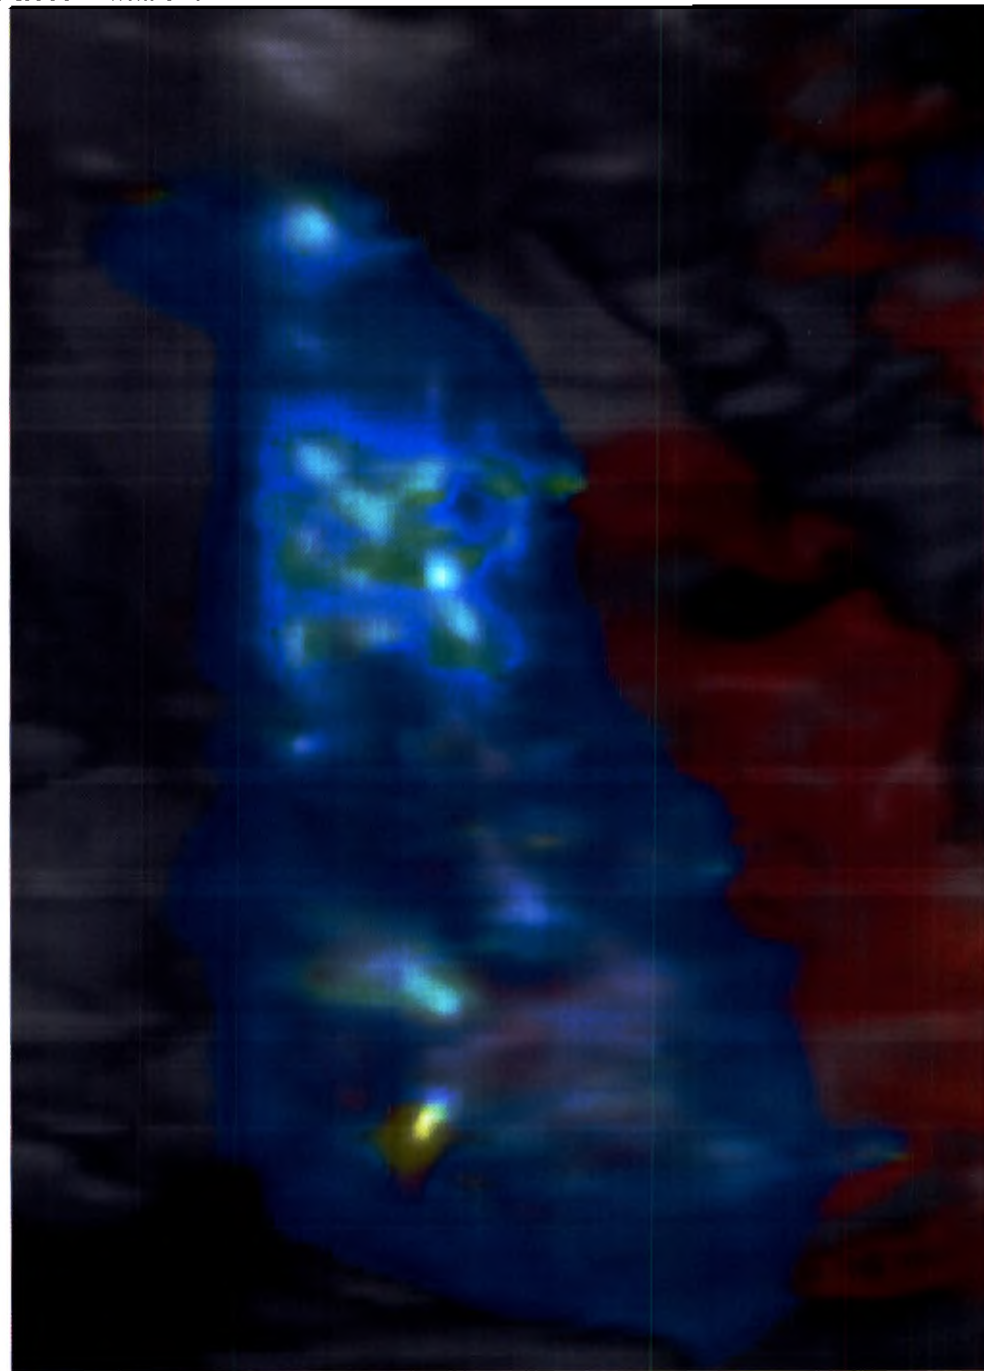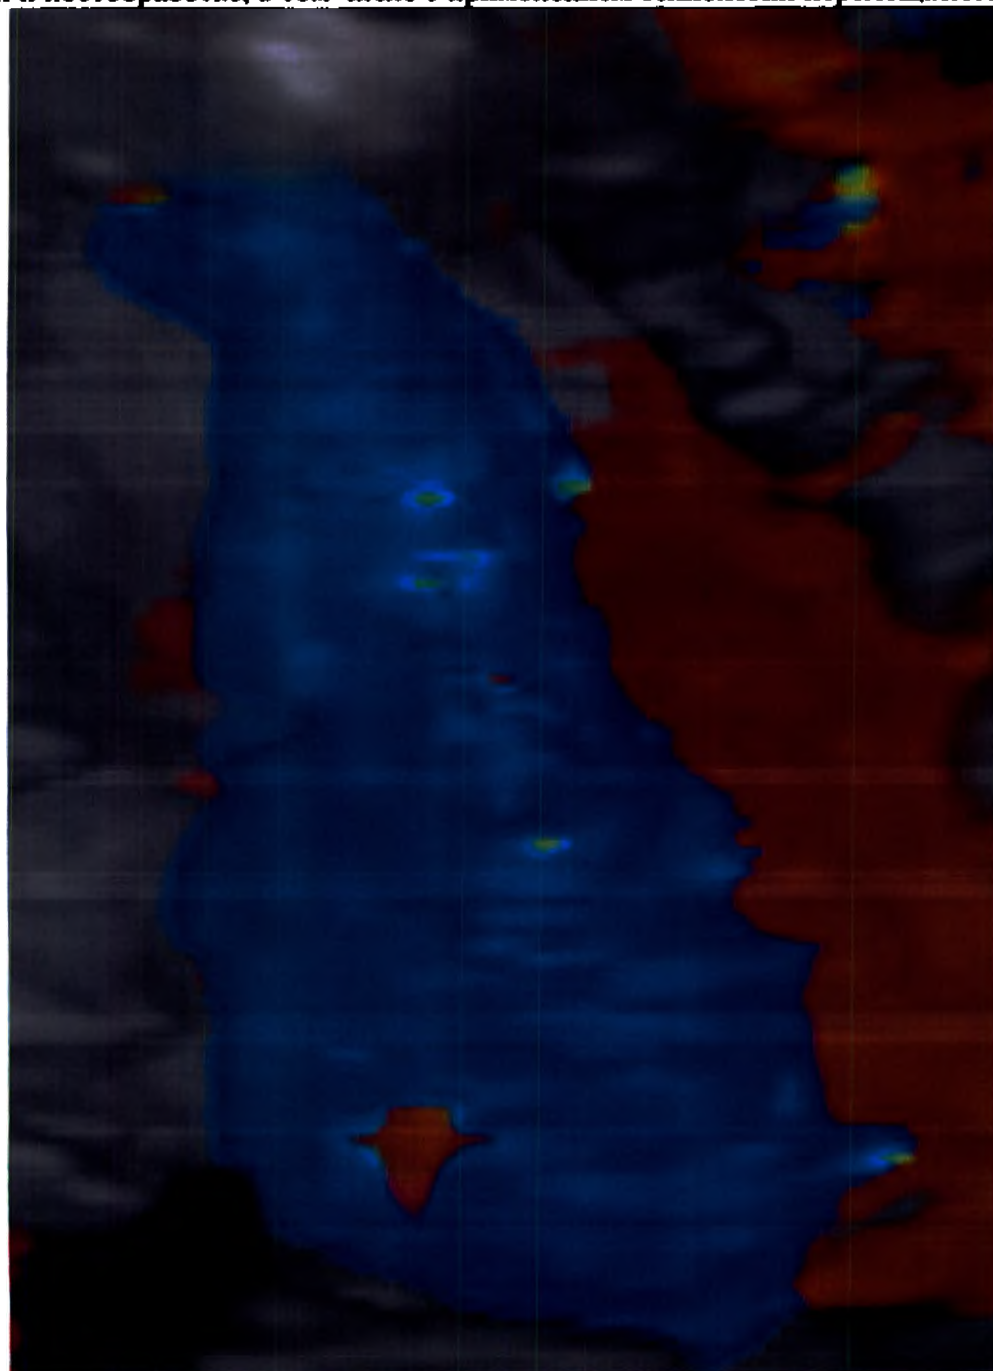


Модуль программного обеспечения для работы в режиме улучшенной 4D-объемной визуализации тканей и данных цветового доплера в реальном времени и постобработке, в том числе с применением технологии перемещаемого источника света

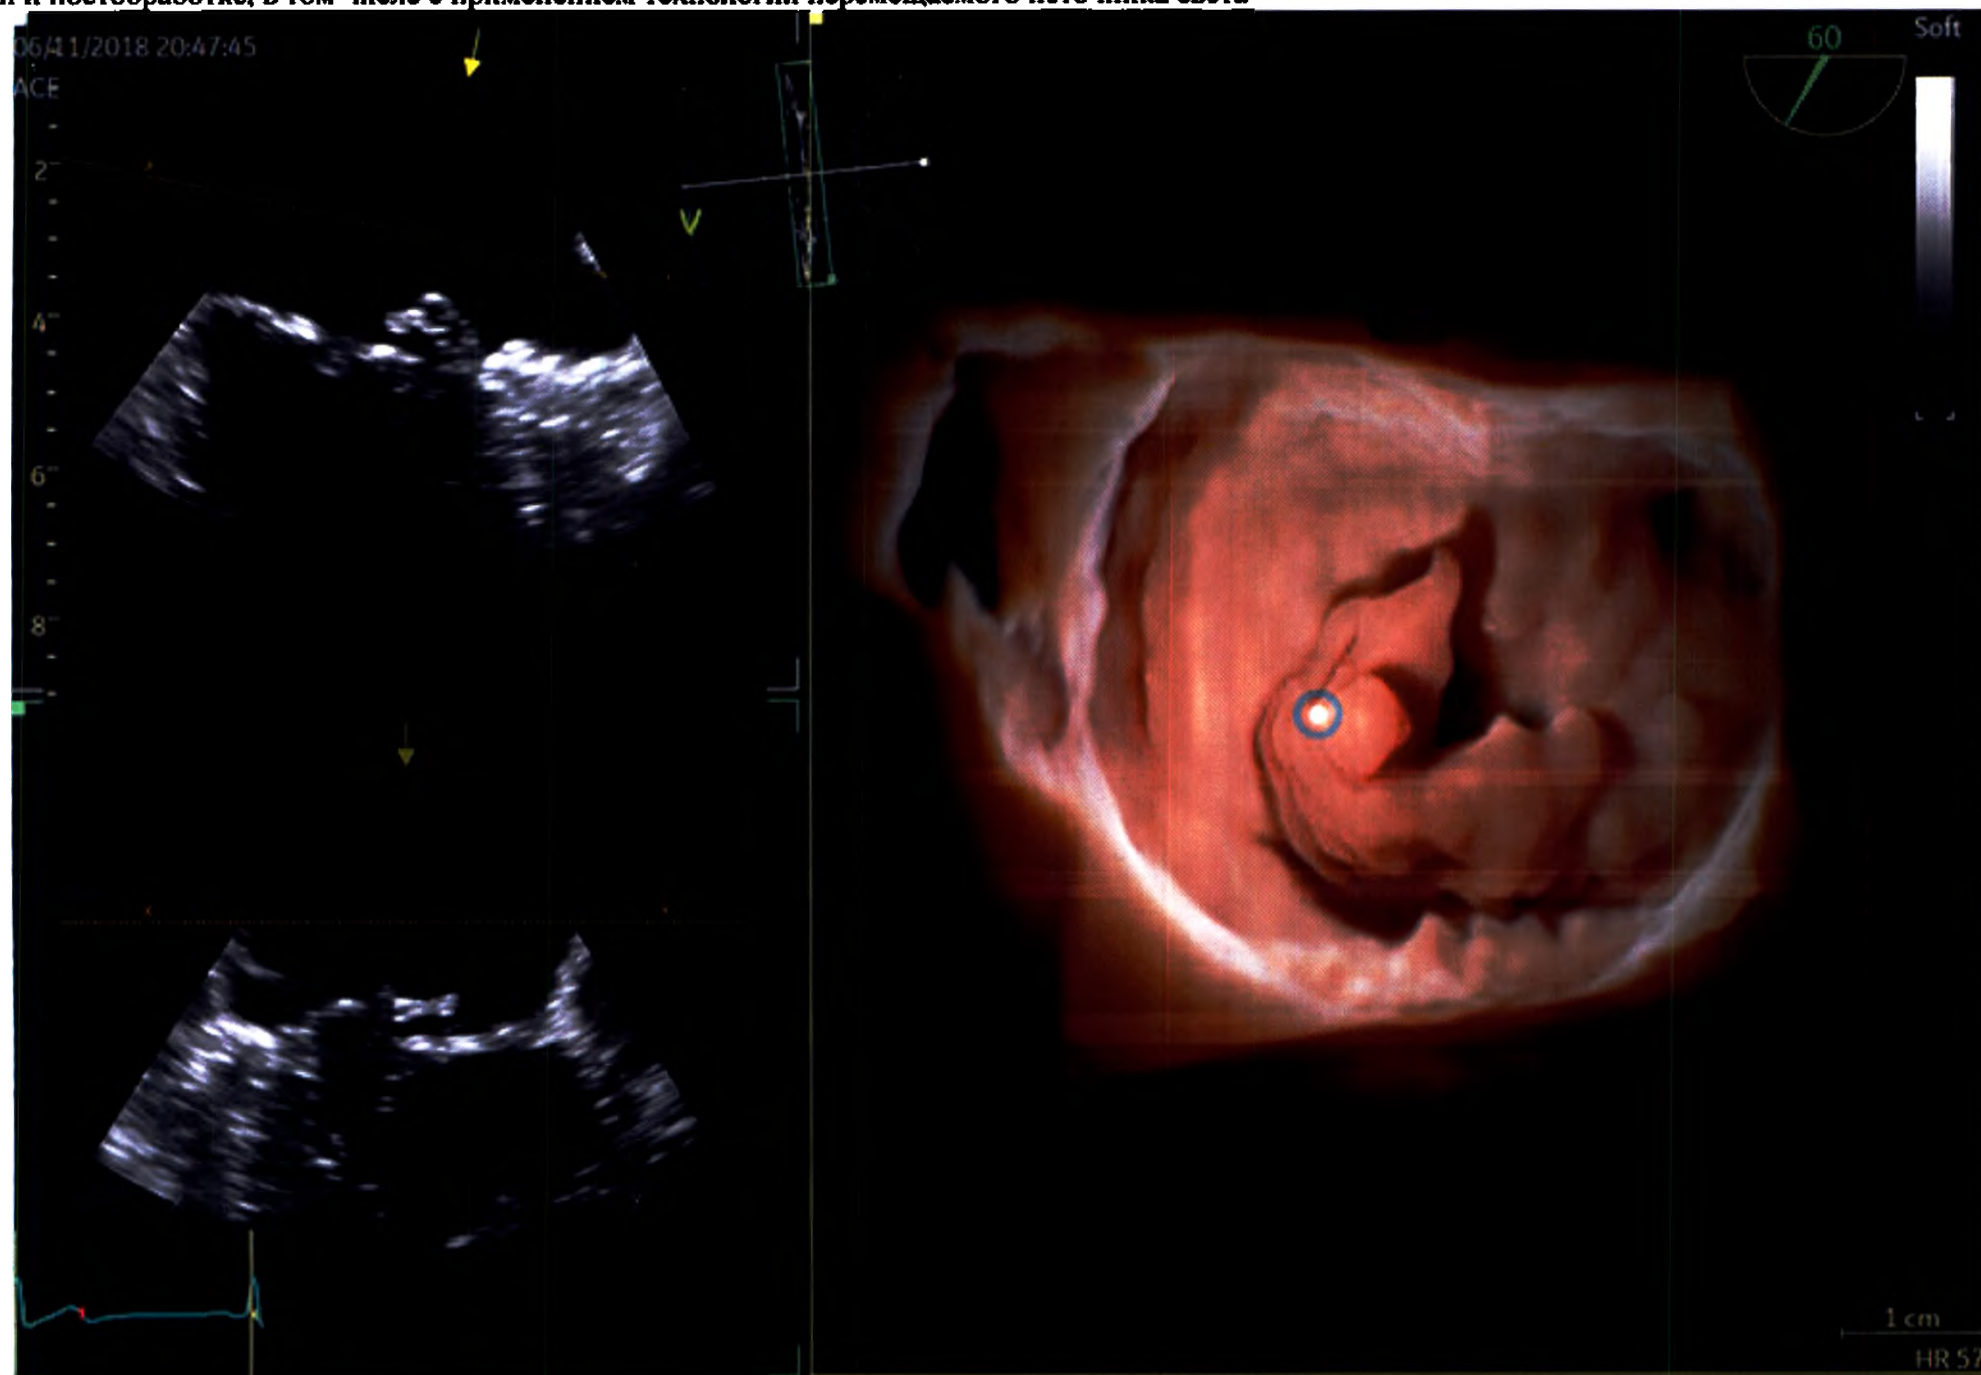

Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований, автоматического анализа работы миокарда на основе данных продольной систолической деформации и артериального давления

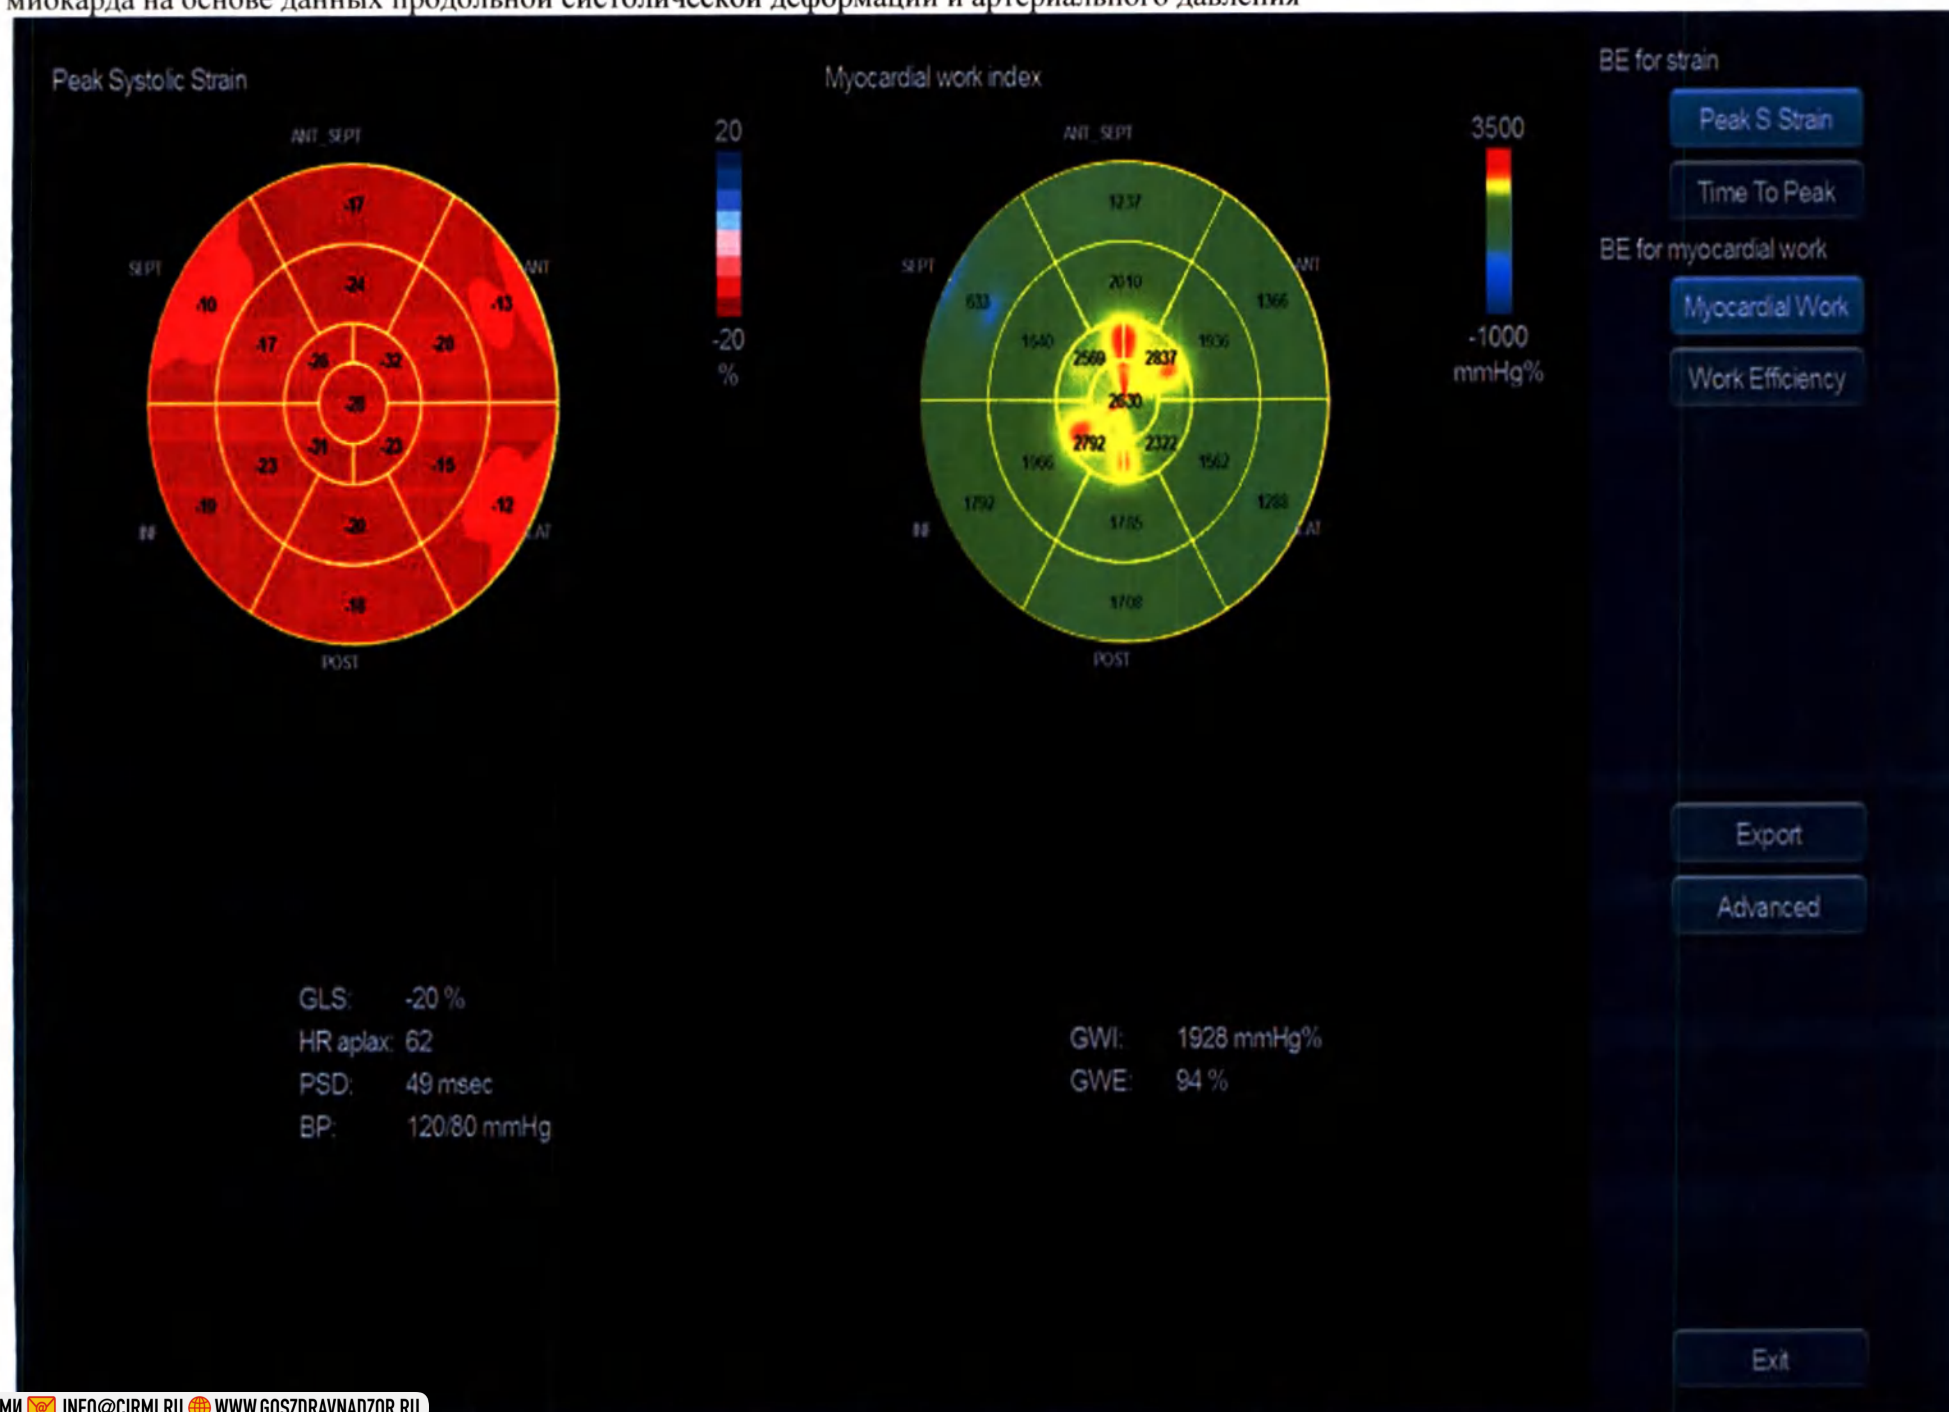


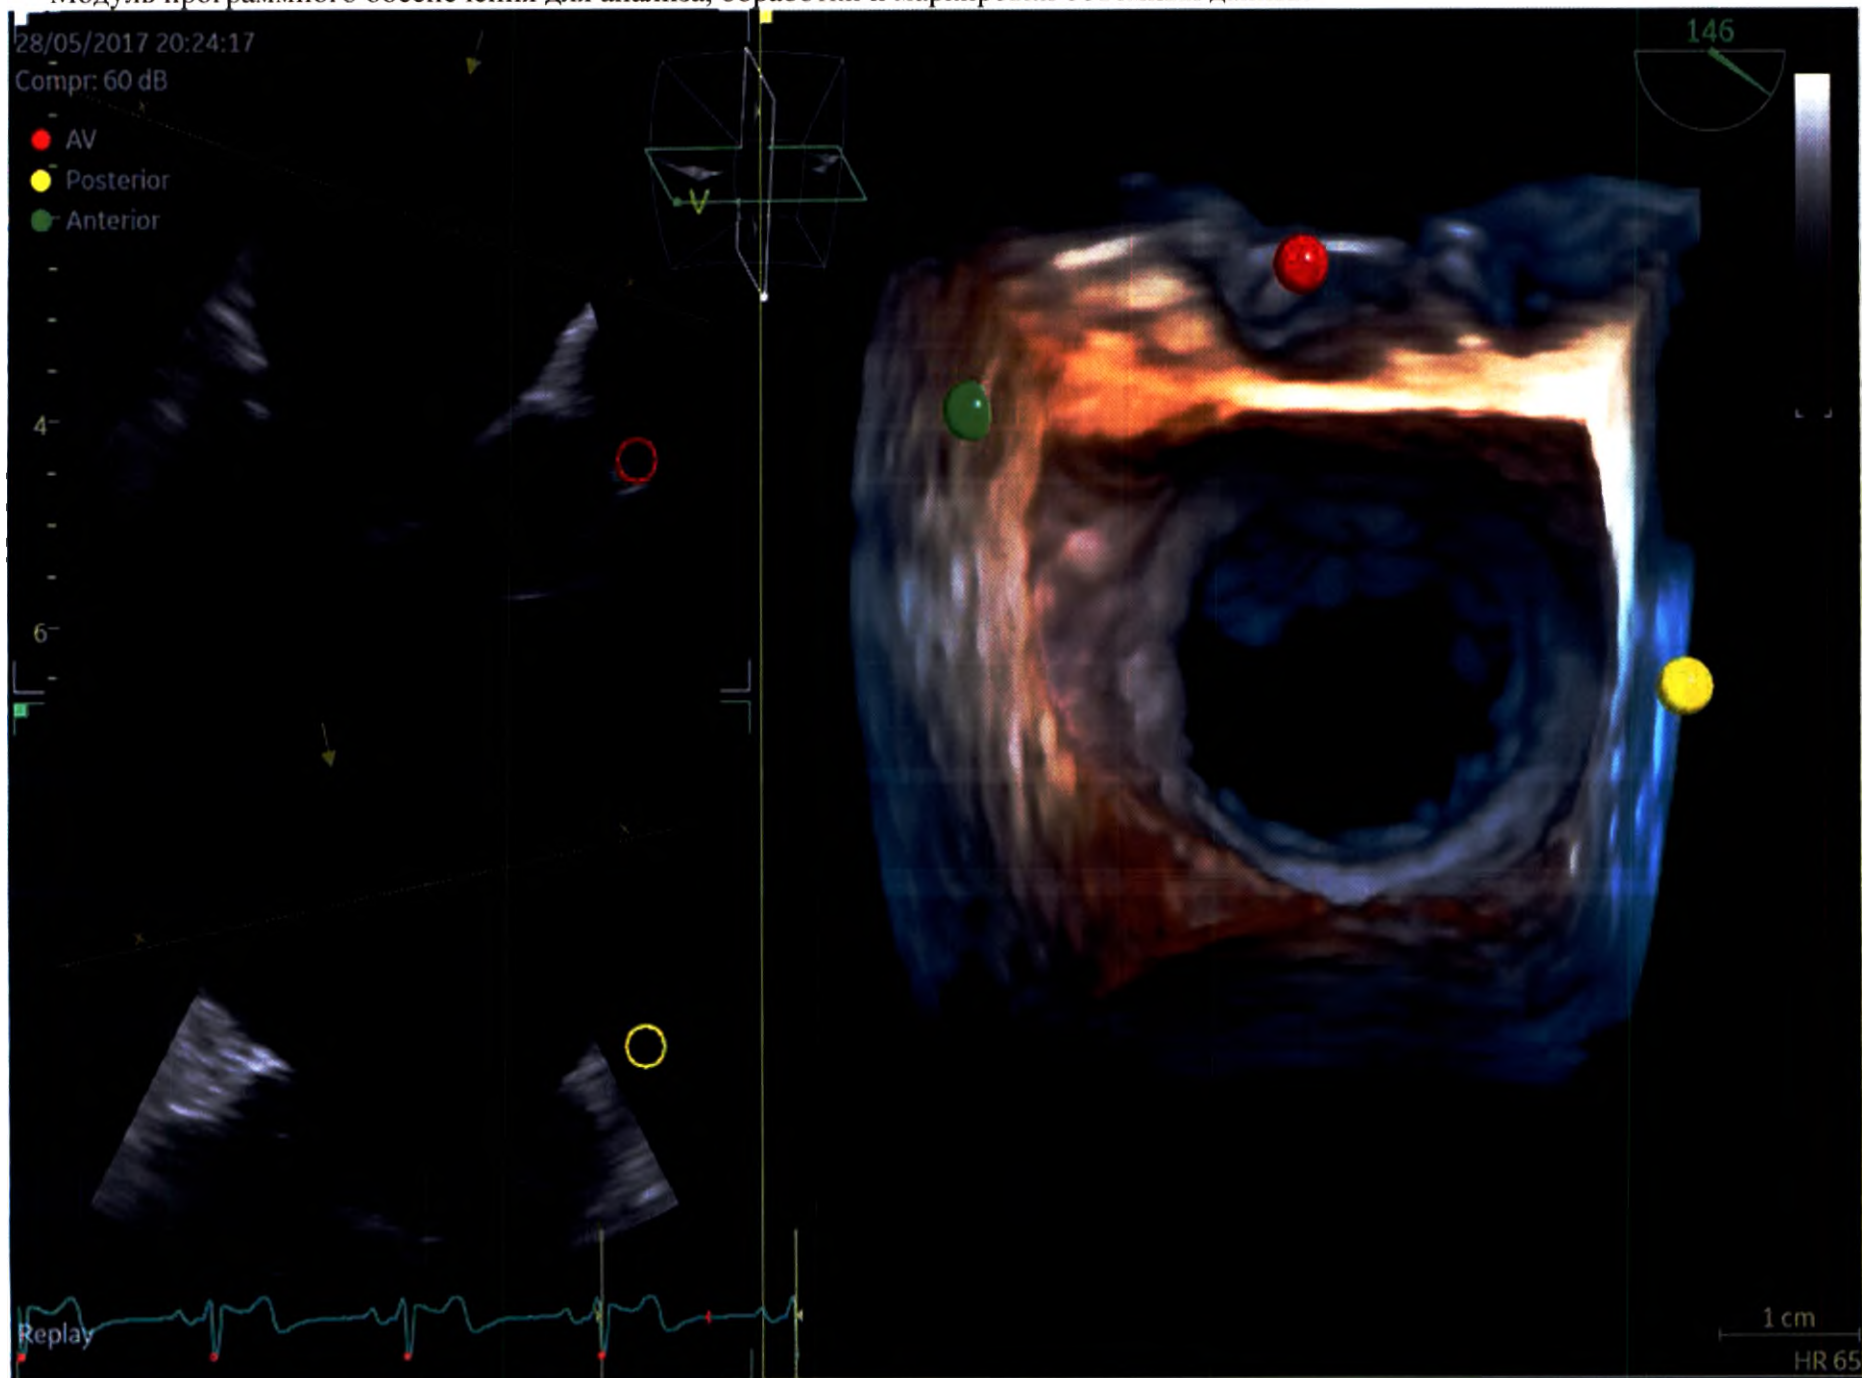



Модуль программного обеспечения для записи изображений пациента в формате DICOM на внешние носители (USB, DVD) со встроенным просмотрщиком для их последующего просмотра на ПК




Модуль программного обеспечения для анализа данных научно-практических ультразвуковых исследований, качественный и количественный анализ на основе сторонних объемных ультразвуковых исходных данных

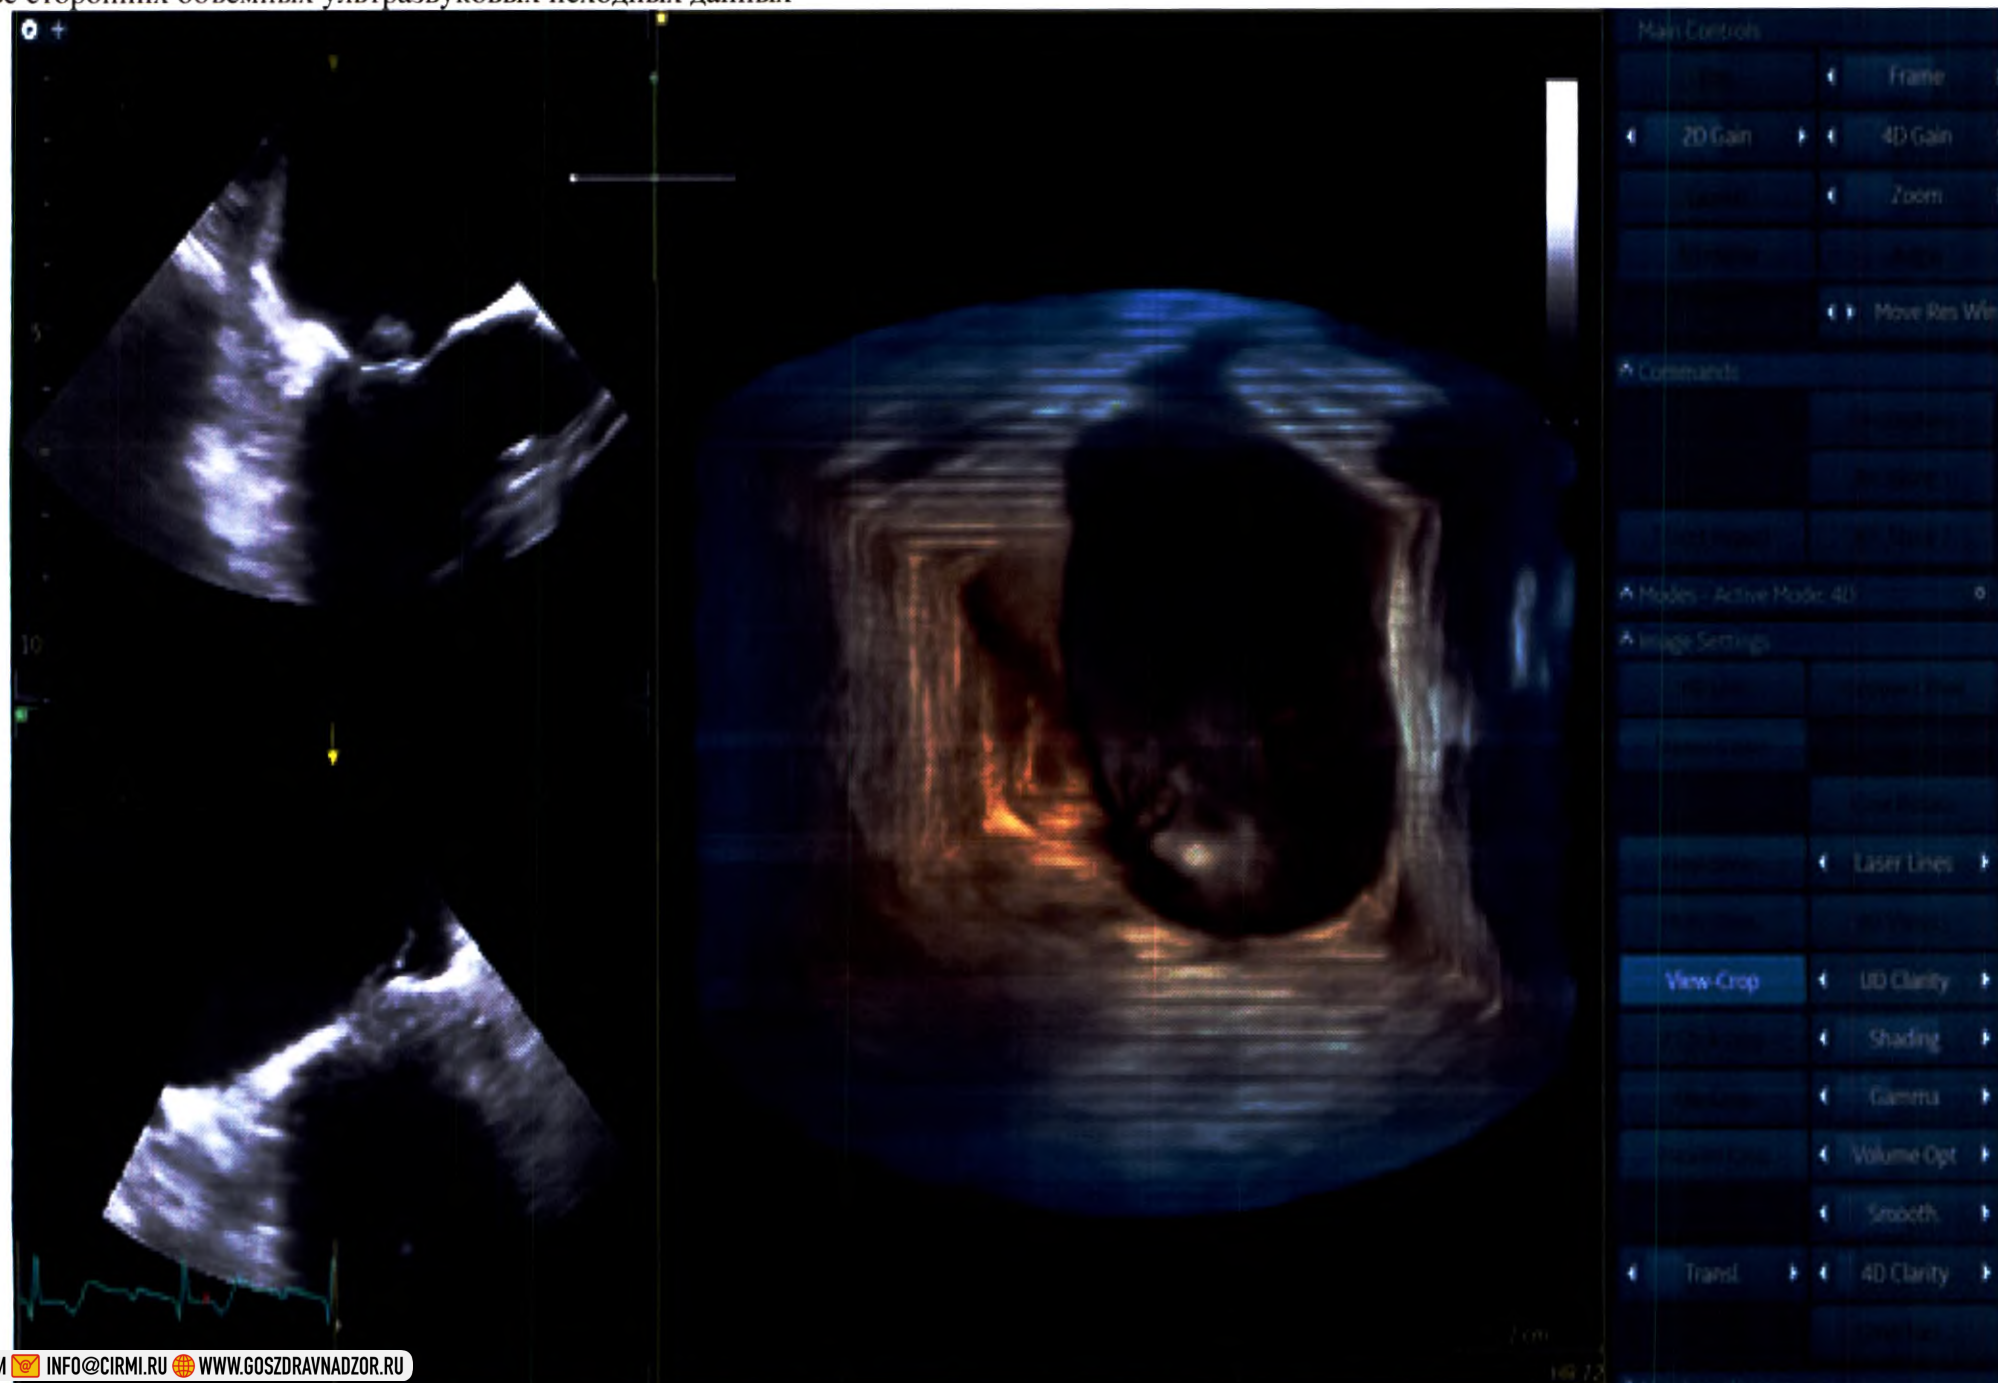


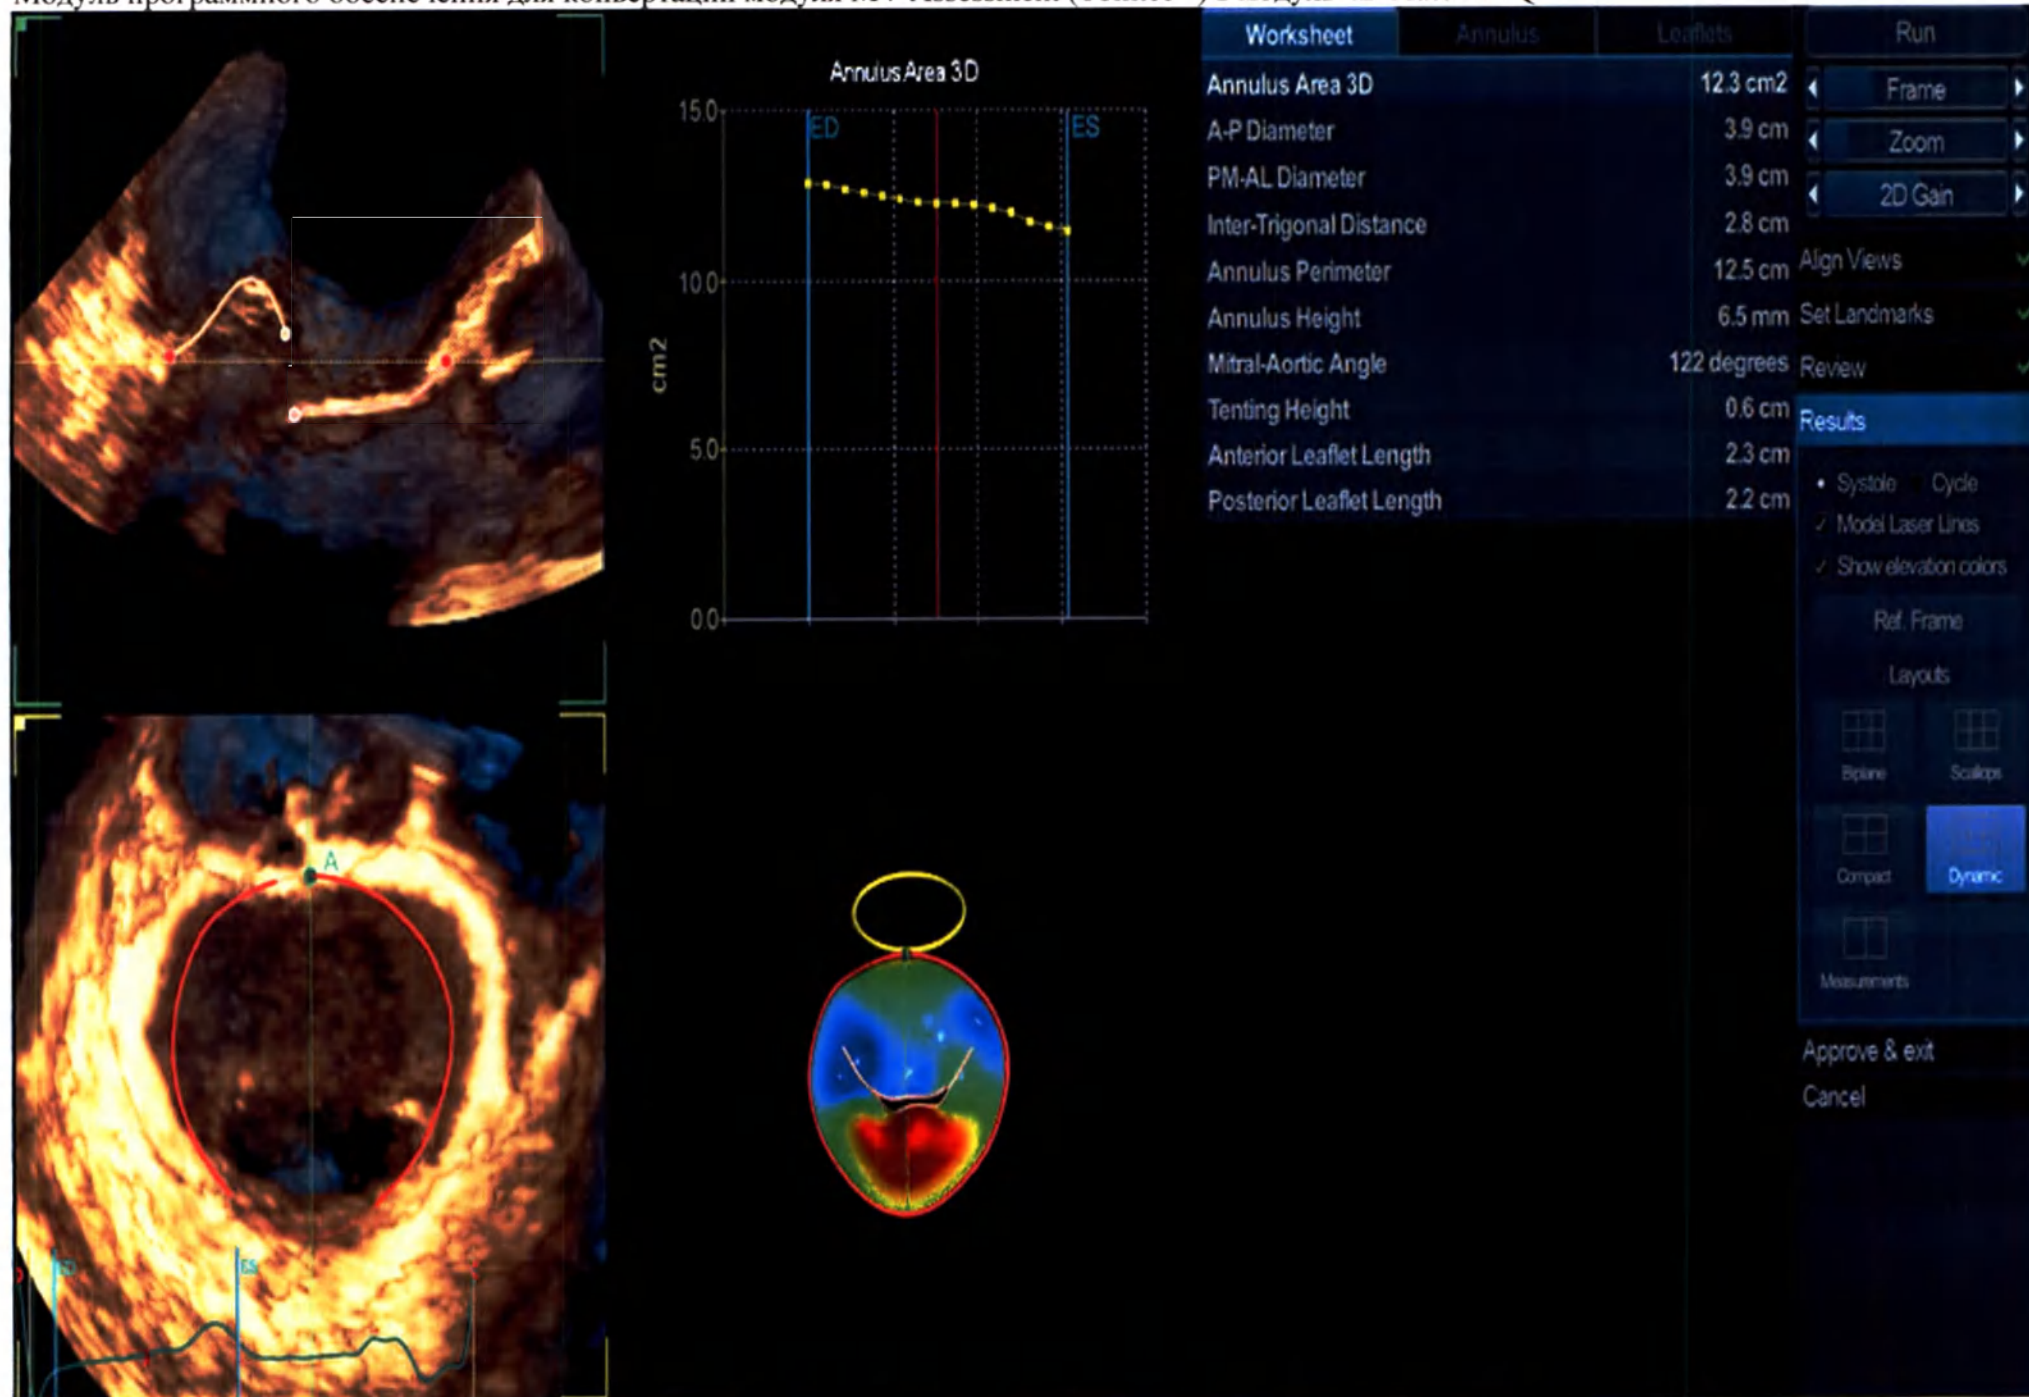

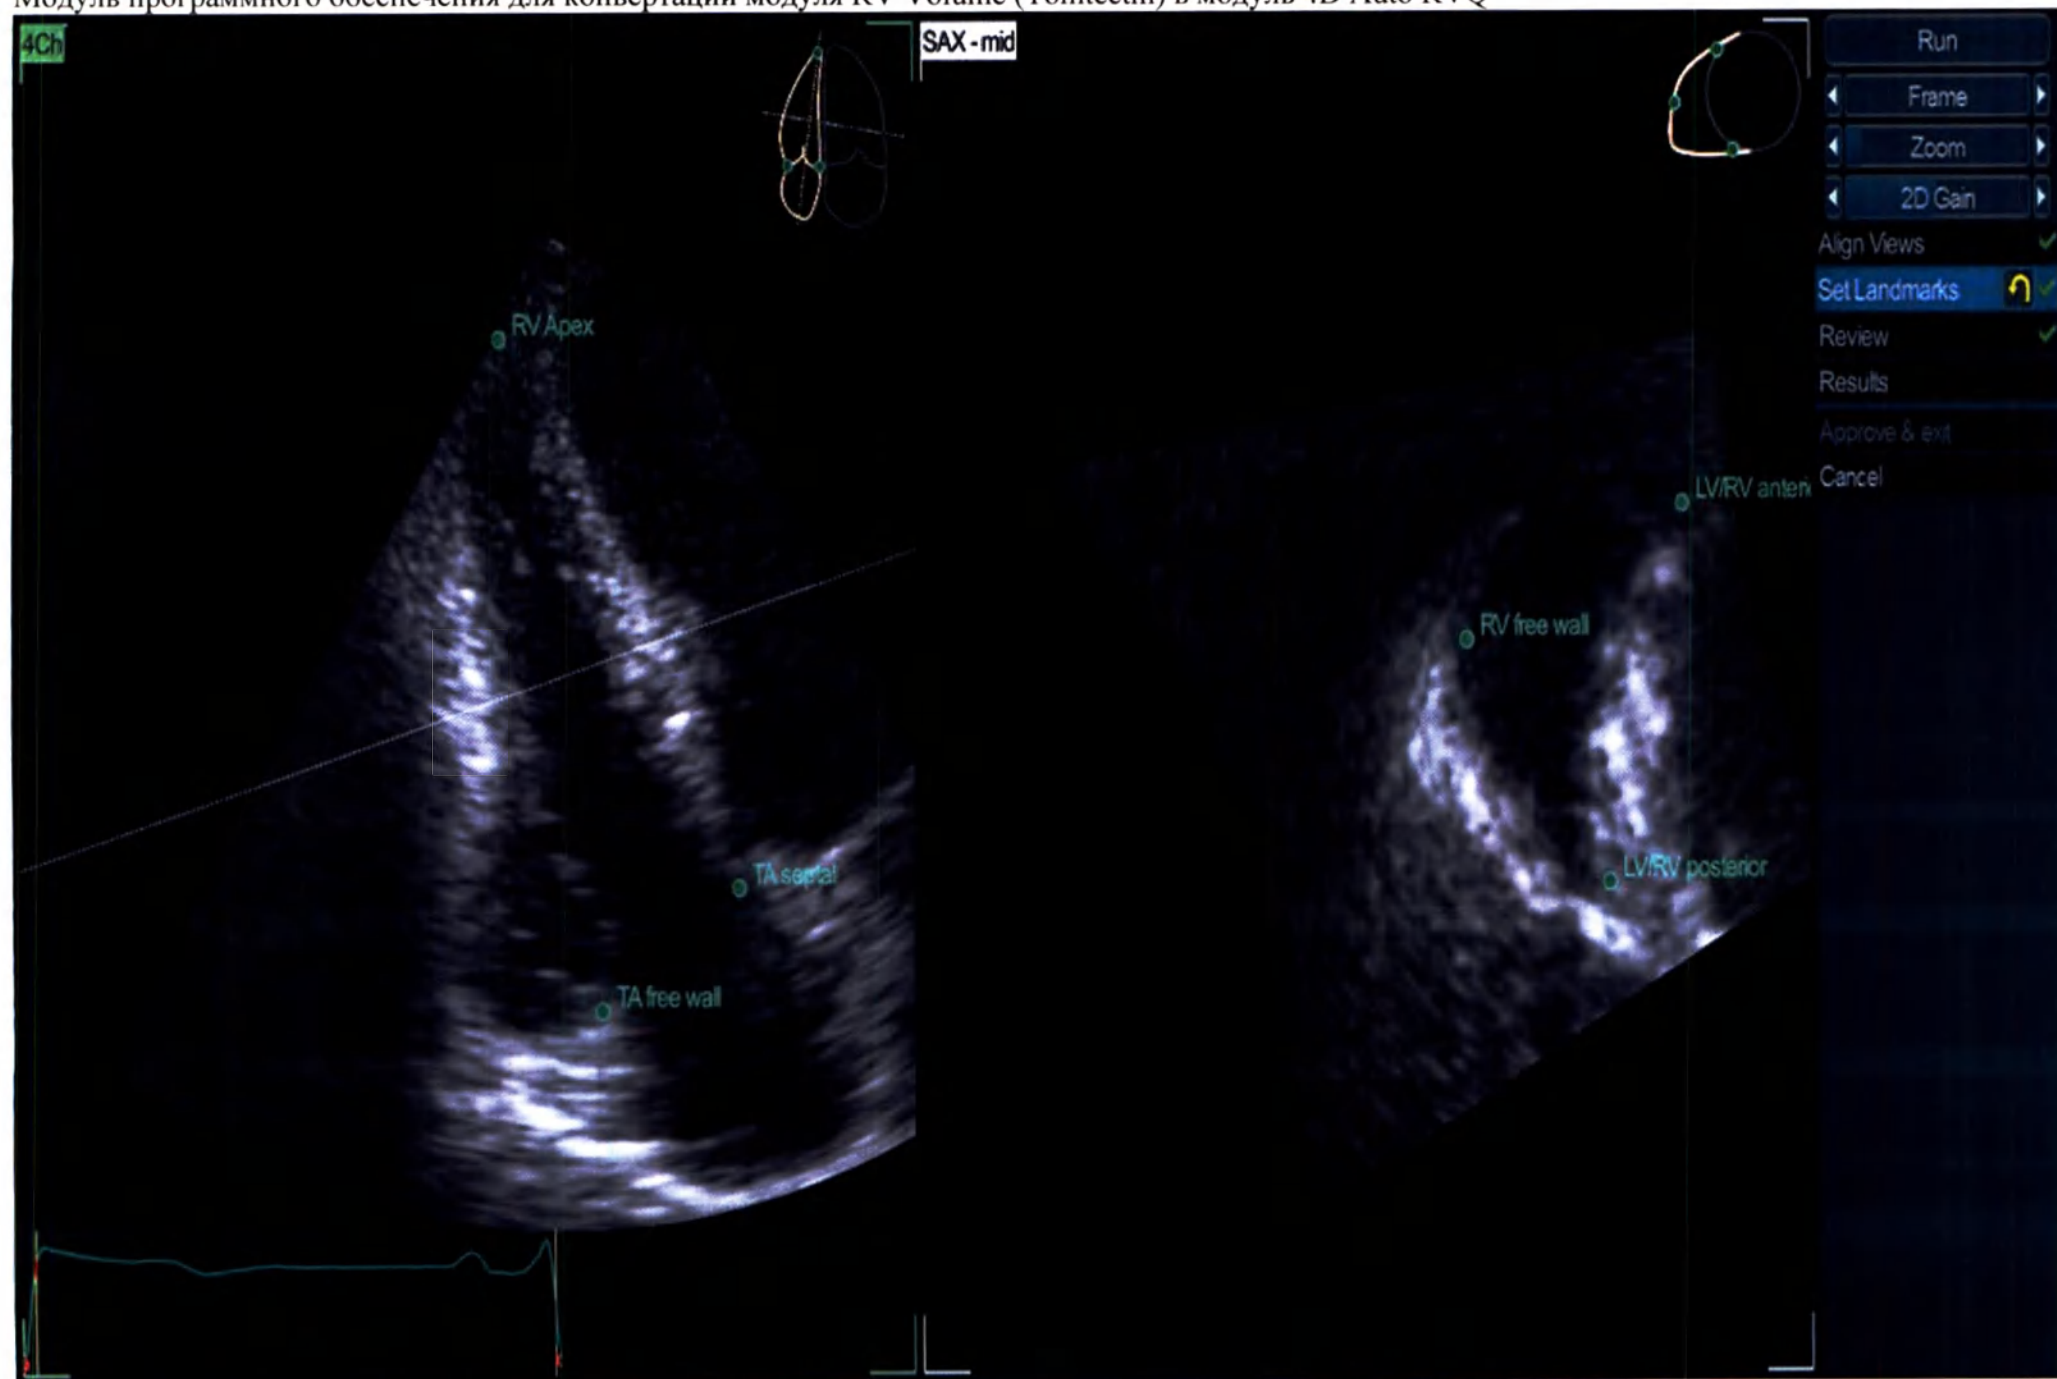



Модуль программный встроенный для анализа данных и формирования отчетов ультразвуковых исследований в кардиологии, активируемый электронным ключом

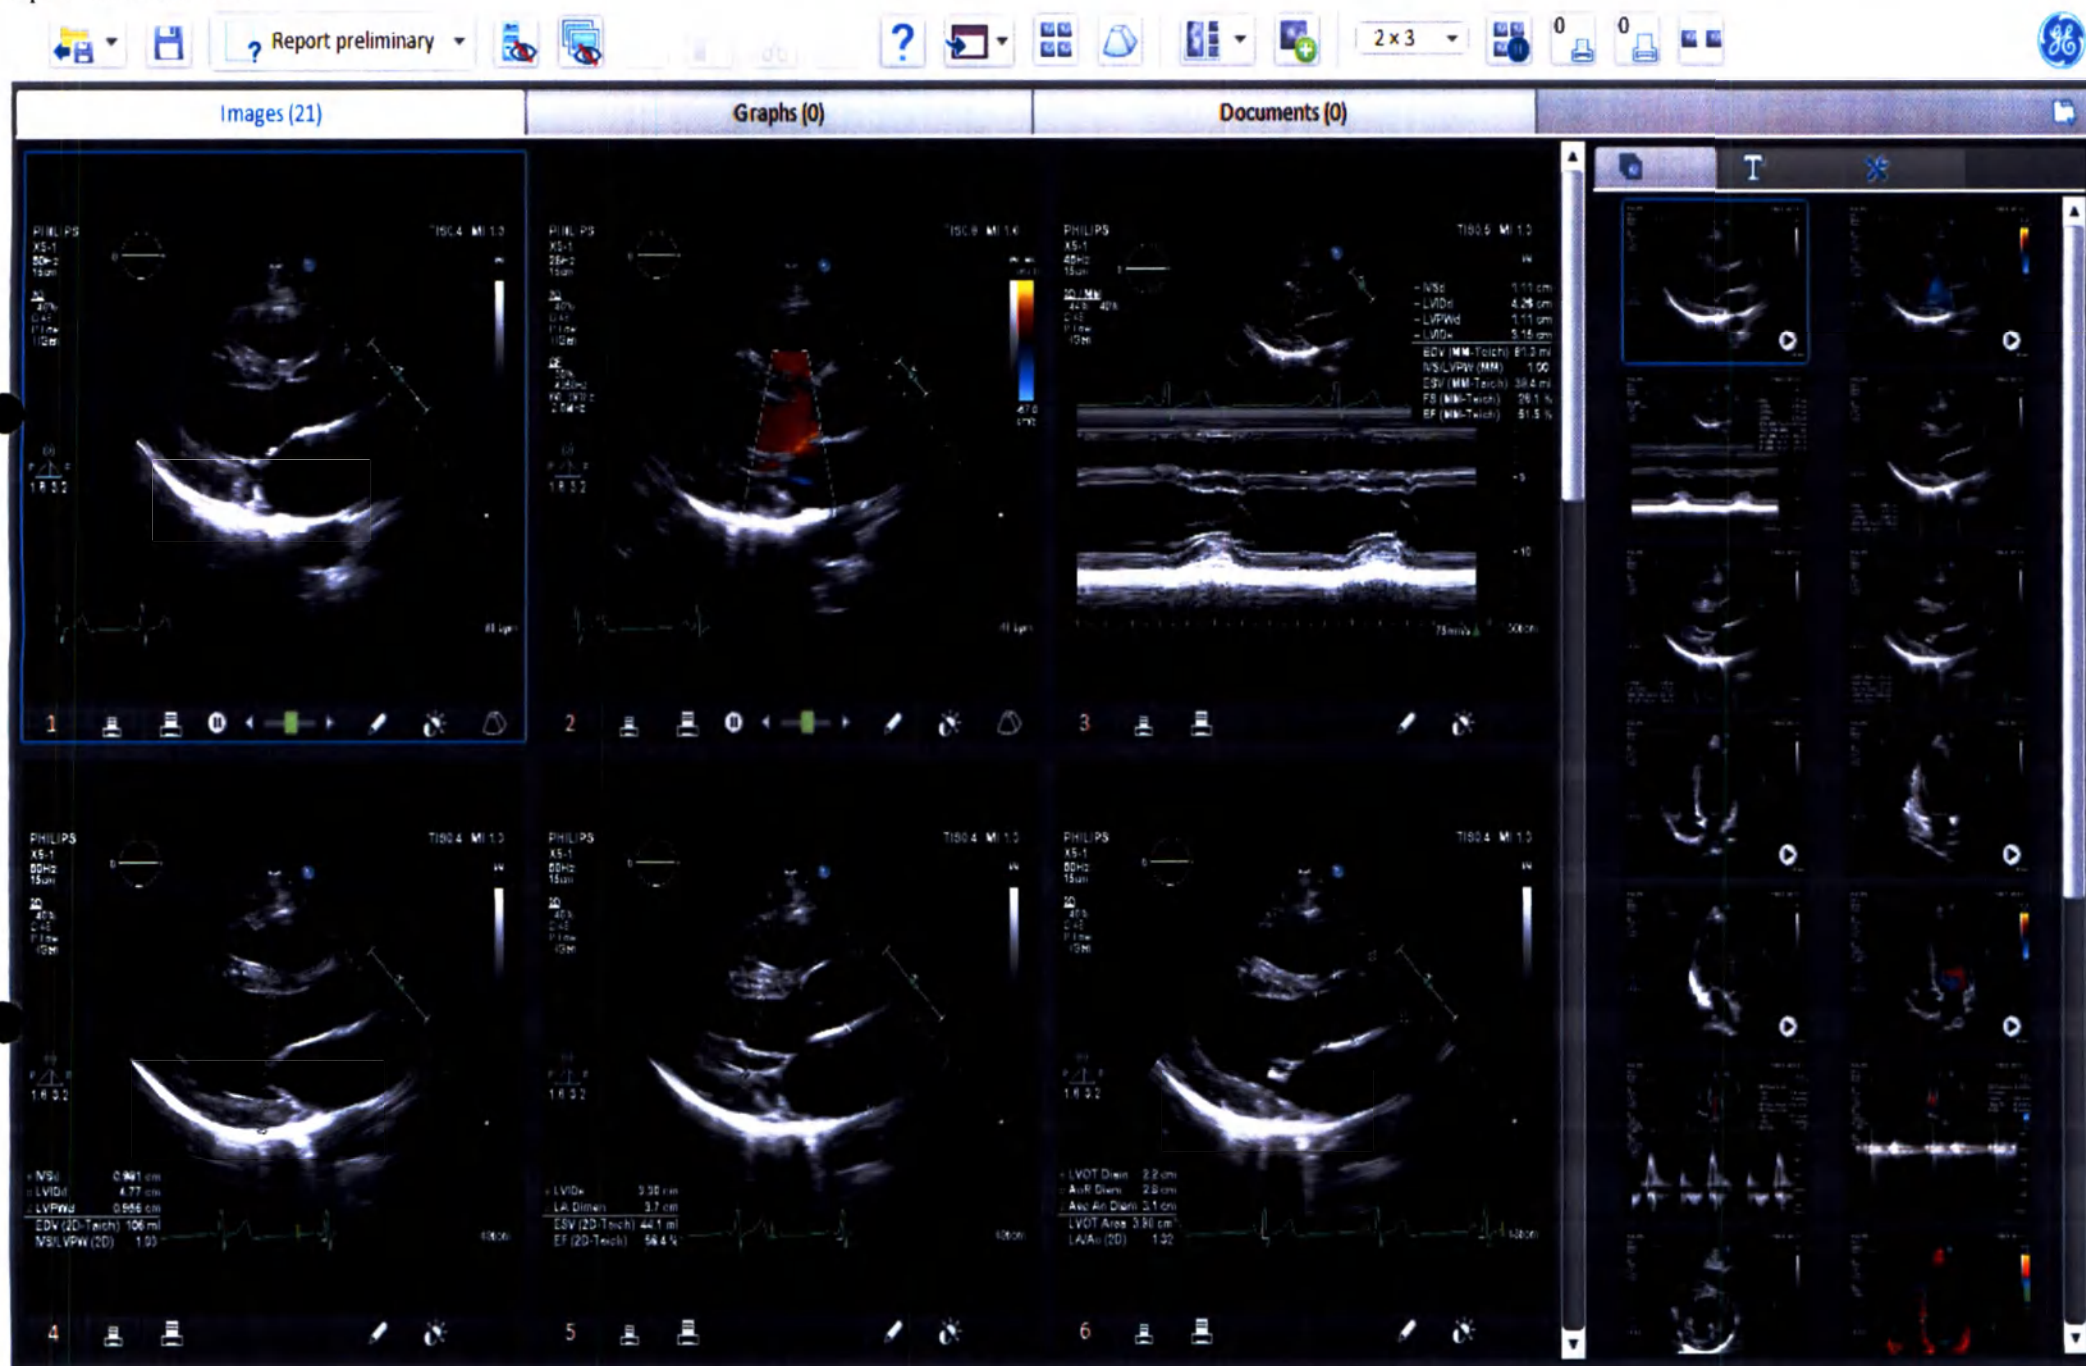

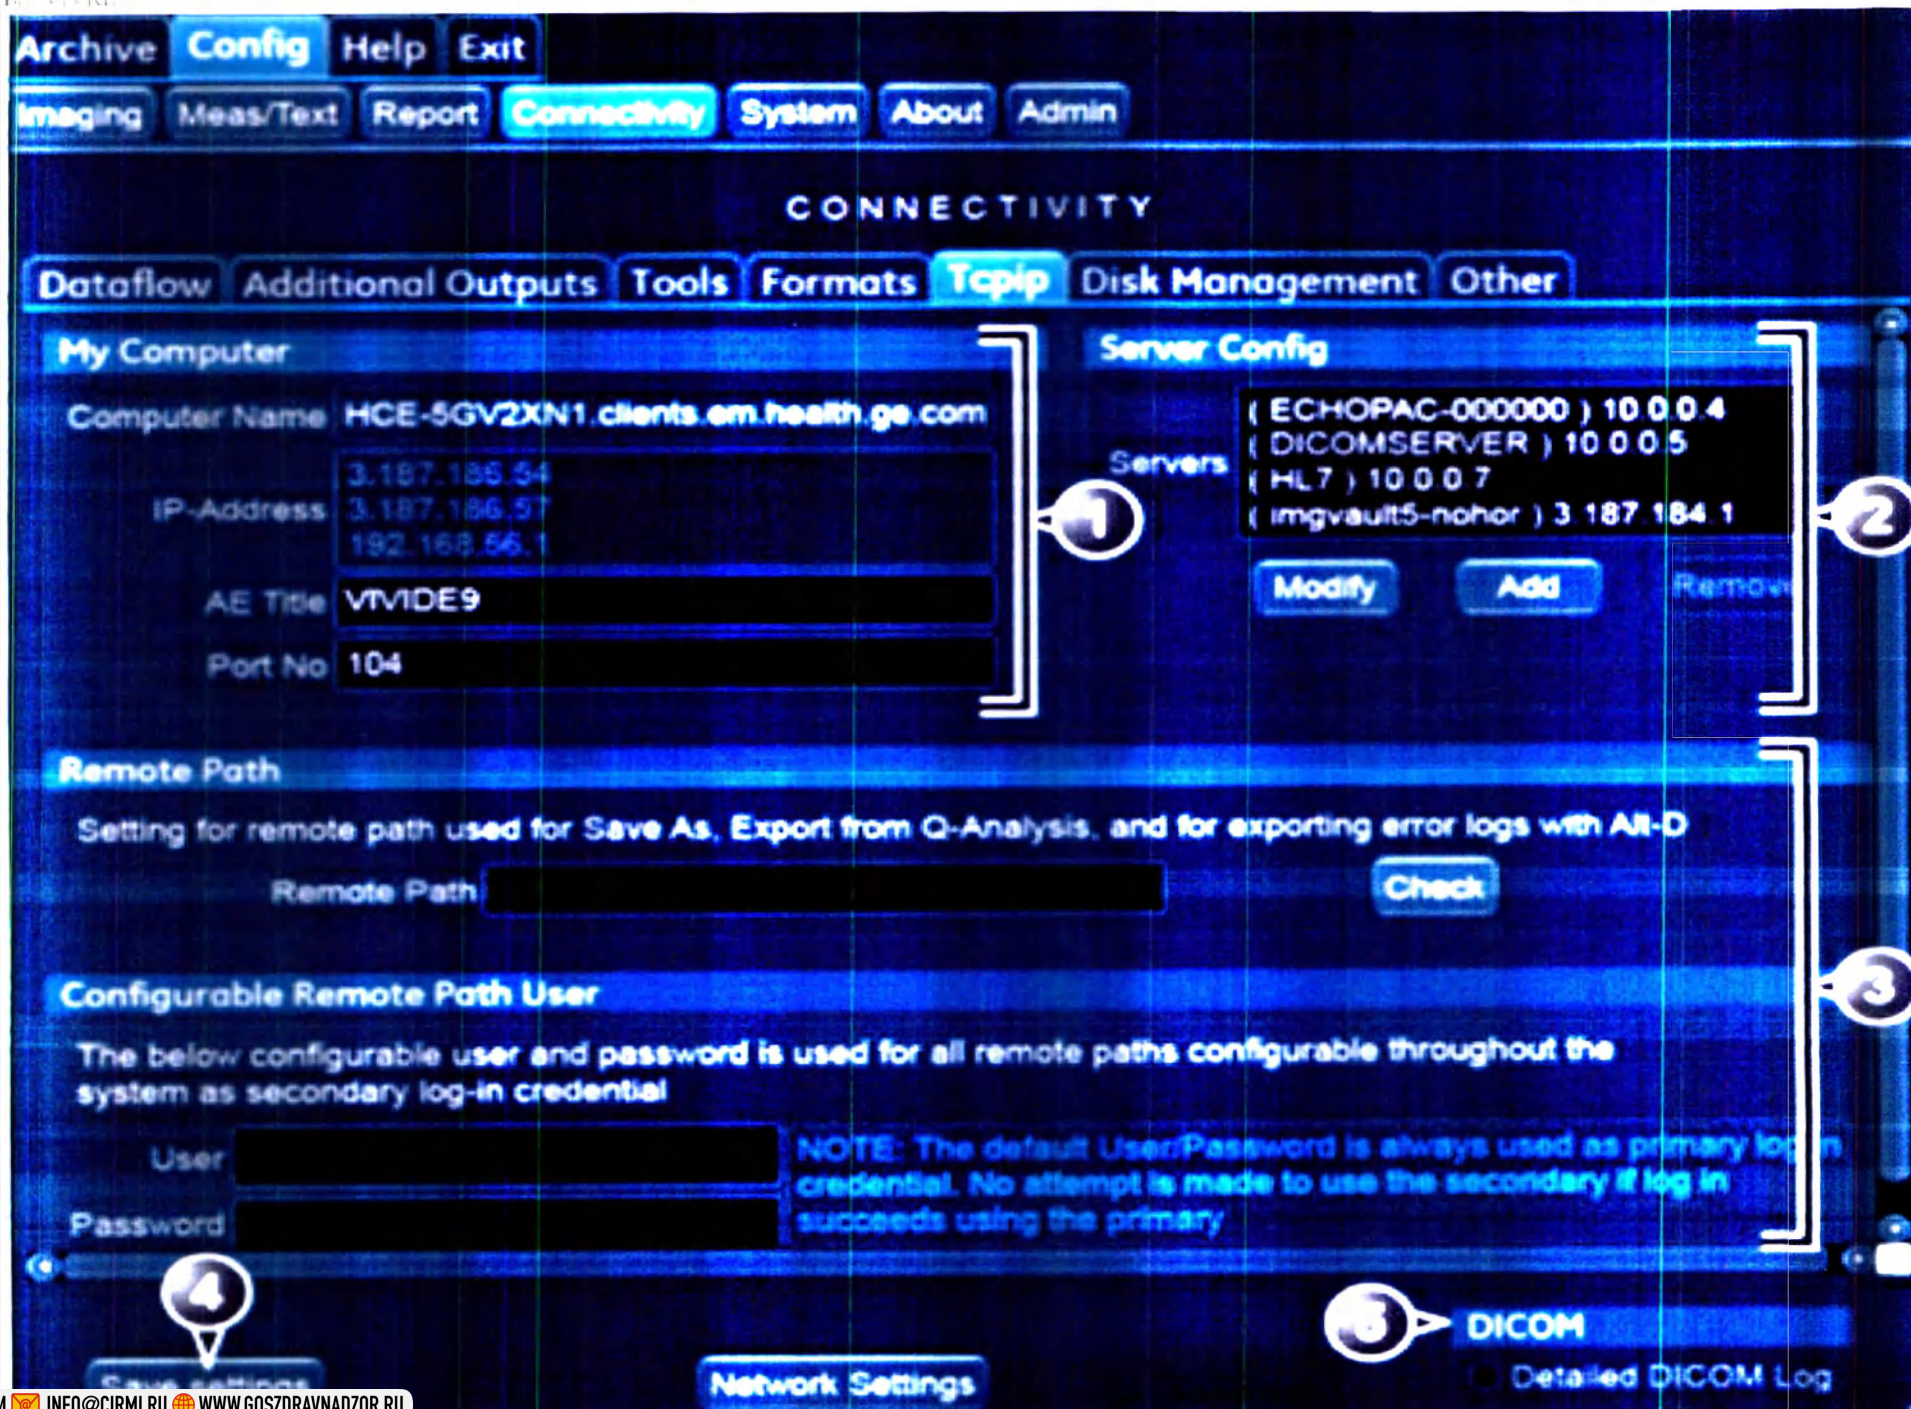


RIGHT

LEFT

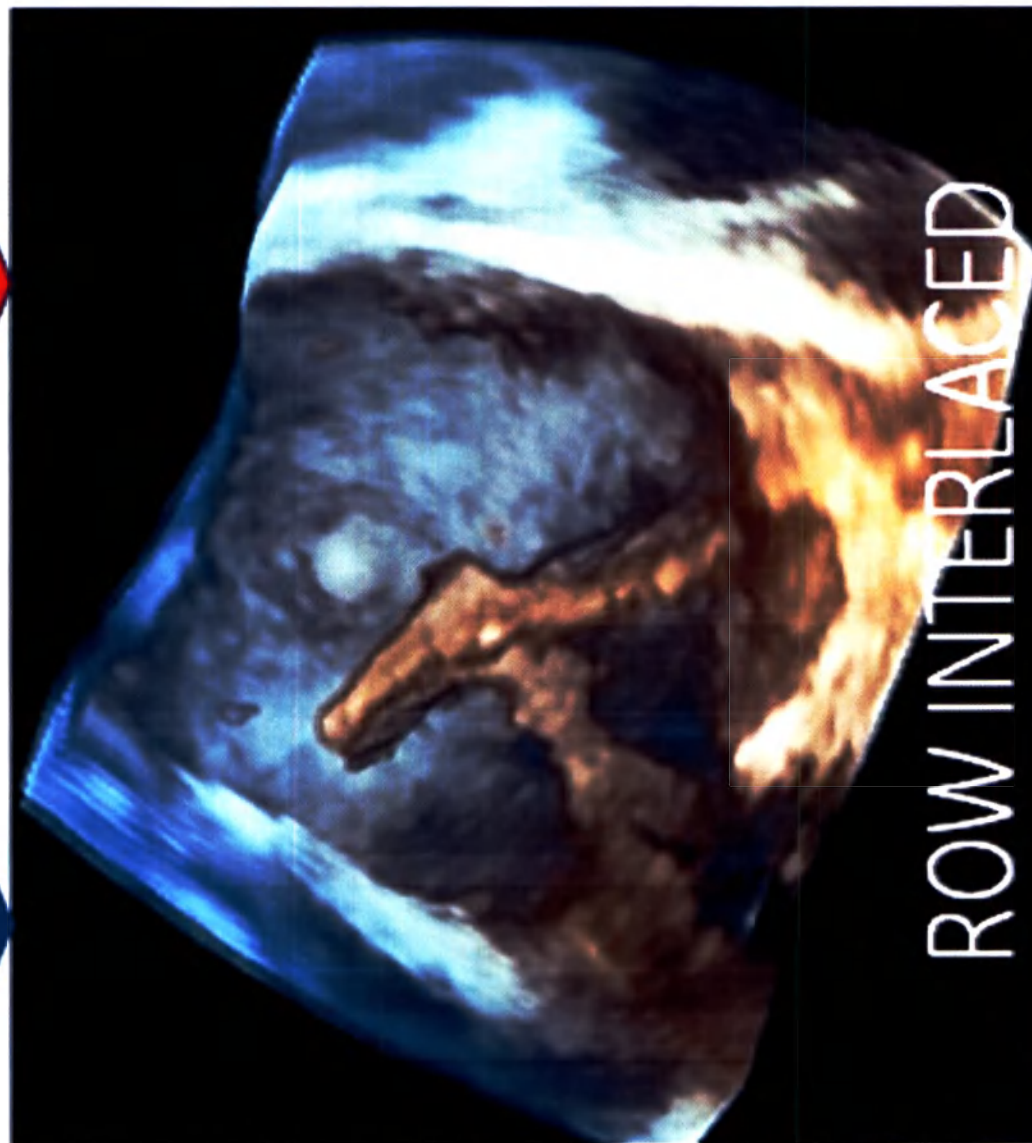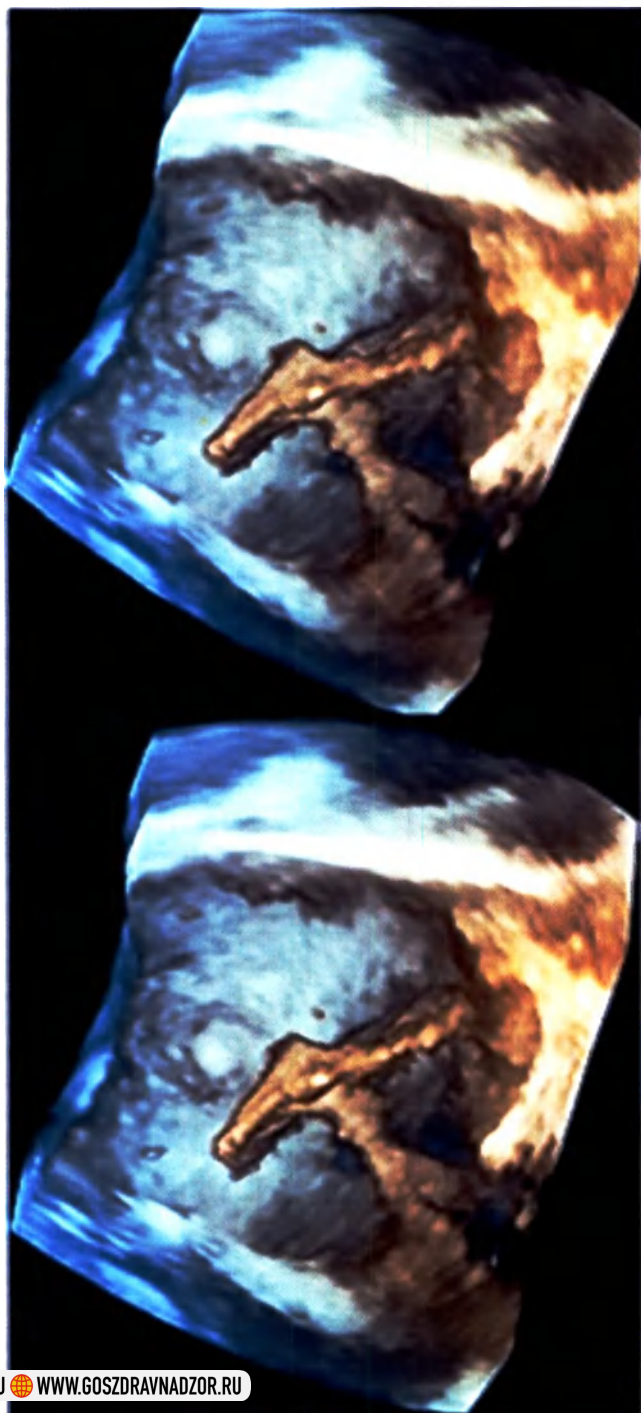

Внешний USB жесткий диск

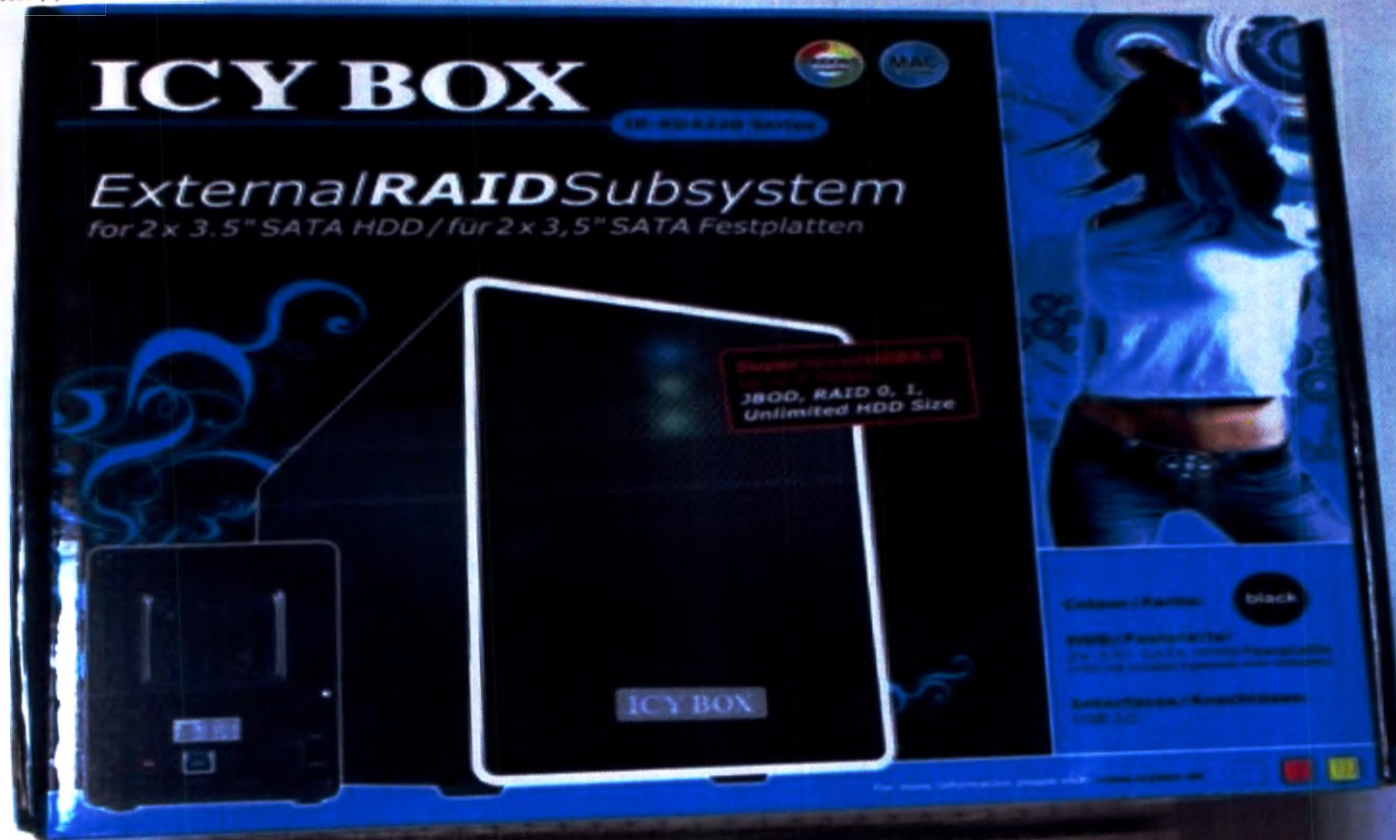

Technical Publication
EchoPAC PC and Vivid E9
Installation Manual for ICY BOX
Director: Vladimir Evtimov
Page 1
Copyright © 2012 by GOSZDRAVNADZOR
All Rights Reserved

Программный модуль для замены версии на оптическом или электронном носителе



Archive

Config

Help

Exit

Search

Last name

First name

Patient ID

Category

Today's exams

Exam after

Exam before

Diag. codes

Images

No reports

Stress

Clear Search

New Patient

Open Patient

Add Exam

Transfer

Delete

Disk Management

Patients

Exams

Last name	First name	Patient ID	Exam date	Exam description
Vivid E9_XDclear		Library Rev 2 XDclear	06/02/2014	
pasient1	en pasient	heihei	20/01/2014	
Doe	John	123	20/01/2014	
TVI		v110b213	15/01/2014	
AFI QTS	Combo	aficombo	17/12/2013	
Doe	John	123	16/12/2013	
pasient1	en pasient	heihei	09/12/2013	
Vivid E9_XDclear		Library Rev 2 XDclear	09/09/2013	
Vivid E9_XDclear		Library Rev 2 XDclear	28/08/2013	
Vivid E9_XDclear		Library Rev 2 XDclear	28/08/2013	
Vivid E9_XDclear		Library Rev 2 XDclear	27/08/2013	
Vivid E9_XDclear		Library Rev 2 XDclear	25/08/2013	
Vivid E9_XDclear		Library Rev 2 XDclear	25/08/2013	
Vivid E9_XDclear		Library Rev 2 XDclear	12/04/2012	
Vivid E9_XDclear		Library Rev 2 XDclear	11/04/2012	
TVI		v110b213	11/02/2010	
AFI QTS	Combo	aficombo	20/09/2007	

Dataflow

Local Archive - Int. HD

Operator

ADM

Archive
Patient
Img Browser
Review
Protocol
Analysis
Worksheet
Report
Config
Help
Exit

Patient Info

Patient data

Last name: Vivid E9_XDclear
Middle name:
First name:
Sex:
Patient ID: Library Rev.2 XDclear
Birthdate:
Age:

Exams

06/02/2014 16:53
28/08/2013 15:13
28/08/2013 13:33
27/08/2013 33:33
25/08/2013 20:20

Procedure

Ref. reason:
Description:
Ref. phys:
Location:

Physical

Height: cm m
Weight: g kg
BSA:

Details

BP:
Contr. agent:
Category: Cardiac
Diagn. Phys:
Operator: GRL

Results

Findings:
Comments:
Diagnosis:

Add Exam
Delete Exam
Archive

Patient Info
Exams
Physical

Patient data
Request
Results
St (Metric)
Contact info
Procedure
US
Additional info
Details
Storage

1
2
3

4
5
6

Archive
Config
Help
Exit

Imaging
Meas/Text
Report
Connectivity
System
About
Admin

CONNECTIVITY

Dataflow
Additional Outputs
Tools
Formats
Tcpip
Disk Management
Other

Media	CD/DVD Writable (E:\)	Refresh
Label		Format
Capacity	4.38 GB	Re-Open Media
Free space	4.38 GB	
Formatted	BLANK	
Database present		
DICOMDIR present		Repair DICOMDIR
Finalized (CD/DVD only)	Yes	
Write-protected	Yes	

Import Templates



Select Source Device:

USB HD/Memstick A-DATA UFD (F:)



Ok

Cancel

Программы для обновления версии программного обеспечения прибора



Page Setup

Paper

Size

Default

Margins (millimeters)

Left

25.4

Right

25.4

Top

25.4

Bottom

25.4

Orientation

☒ Portrait

☐ Landscape

Header and footer

Header

{pnm}{c}{pid}{r}Page {cp} of {tp}

Footer

{exd} {r} Print Date: {prd}

☒ Different for first page

Header

Footer

{r} Print Date: {prd}

OK

Cancel

ООО ЦРМИ

INFO@CIRMI.RU

WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 58 лист(ов)
Руководитель отдела регистрации
и сертификации Россия и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»
Харитонов А.П.

А.П. Харитонов

