


## **Фотографические изображения**

**«Реагенты в кассете для количественного определения свободного  
протеина S в цитратной плазме крови на анализаторах гемостаза  
автоматических cobas t (Free Protein S cobas t systems)»**

...енты в кассете для количественного определения свободного протеина S в цитратной плазме крови на  
...анализаторах гемостаза автоматических cobas t (Free Protein S cobas t systems)

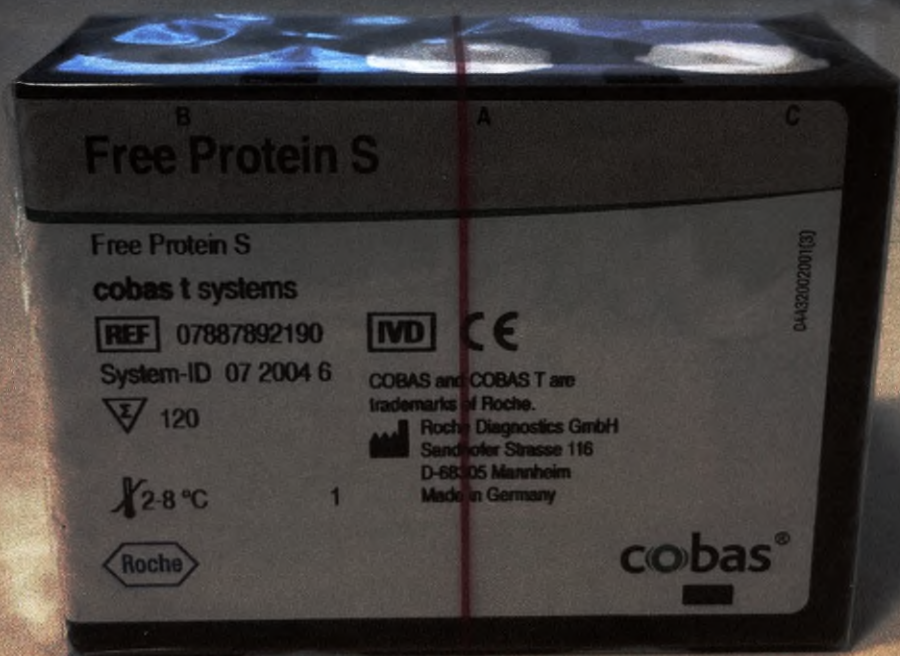

Free Protein S



REF 07887892190

GTIN 07613336153574



07887892190 ≥ V1 CE  
<http://e-labdoc.roche.com>




EU: +800 5505 6606

LOT 51910101

2022-06-30

2020-12-14



02

Ser.No. 00629

Free Protein S

07887892190 01





ИЗ360

Реагенты в кассете для количественного определения свободного  
протеина S в цитратной плазме крови на анализаторах гемостаза  
автоматических cobas t (Free Protein S cobas t systems)

Регистрационное удостоверение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116,  
68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной  
ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная  
площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: [moscow.reception2\\_dia@roche.com](mailto:moscow.reception2_dia@roche.com)

Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для  
запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты  
см. выше)

Кат. номер 07887892190

Всё, что проведено  
скрупулезно  
и ответственно  
«Рос  
Диагностика  
Рус»  
Ф. И. О. Н. П. И. О. В. А.

по доверенности  
от 11.02.2022 г.