

Фото 1. Набор реагентов «Trialab NK». Потребительская упаковка.



Фото 2. Набор реагентов «Ttrialab NK». Состав набора.



Фото 3. Набор реагентов «Trialab NK». Изотонический раствор (BioDil-5 NK)



Фото 4. Набор реагентов «Trialab NK». Лизирующий реагент для определения лейкоцитов и гемоглобина (BioLyse NK)

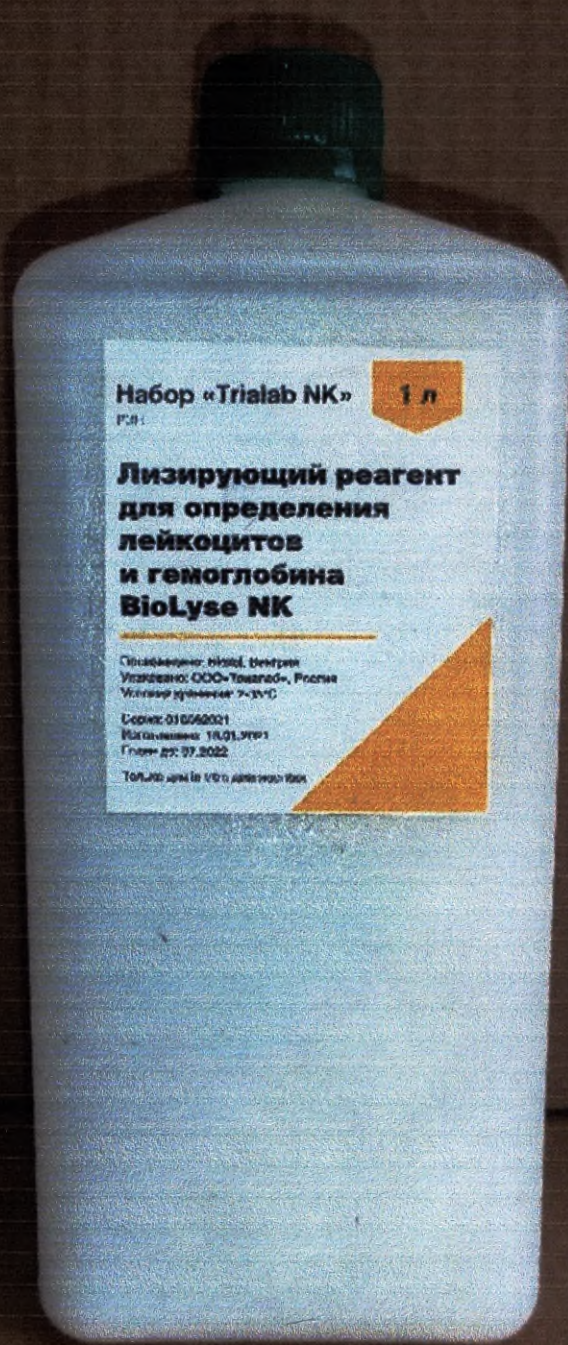


Фото 5. Набор реагентов «Trialab NK». Лизирующий реагент для определения лейкоформулы (BioLyse-5NK)

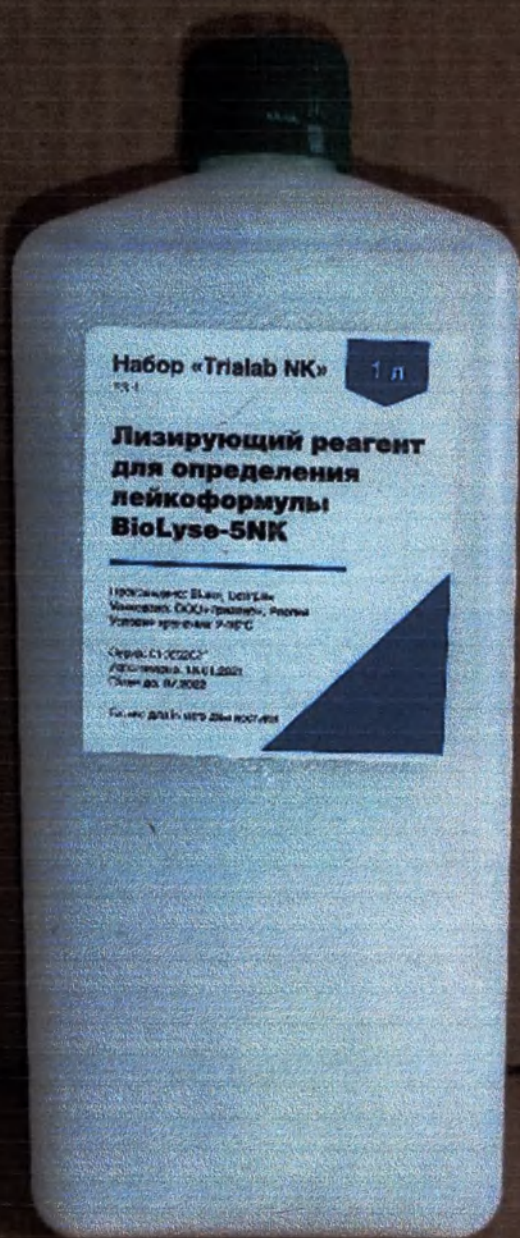


Фото 6. Набор реагентов «Trialab NK». Промывающий раствор (BioClean NK).



Фото 7. Набор реагентов «Ttrialab NK». Промывающий раствор (BioHypoclean).



В настоящем документе
проверено, прошито и
скреплено печатью

74 листов

Генеральный директор
ООО «Триалаб»

Прозоровский Н.С.



Набор реагентов для автоматических гематологических анализаторов **МЕК-7222К, МЕК-8222К** **Trialab NK**

Комплектация на 1500 исследований

Состав набора

1. Изотонический раствор (BioDil-5 NK)	Канистра 20 л	4 шт
2. Лизирующий реагент для определения лейкоцитов и гемоглобина (BioLyse NK)	Флакон 1 л	1 шт
3. Лизирующий реагент для определения лейкоформулы (BioLyse-5 NK)	Флакон 1 л	1 шт
4. Промывающий раствор (BioClean NK)	Канистра 5 л	1 шт
5. Промывающий раствор (BioHypoclean)	Флакон 1 л	2 шт

Производитель: ООО «Триалаб»

117321, Москва, ул. Профсоюзная, 152-3, оф. 100
info@trialab.ru

ТУ-21.20.23-006-13296835-2021
РУ

Для профессионального применения.

Только для in vitro диагностики.

Обратитесь к инструкции по применению.

Серия: 010062021

Изготовлено: 18.01.2021 г.

Годен до: 07.2022 г.

Хранить: при 2-35 °С

Транспортировать: при 2-35 °С

Набор «Trialab NK»

РЗН

20 л

**Изотонический раствор
BioDil-5 NK**

Произведено: Biohol, Венгрия

Серия: 010062021

Упаковано: ООО «Триалаб», Россия

Изготовлено: 18.01.2021

Условия хранения: 2-35°C

Годен до: 07.2022

Только для in vitro диагностики

Набор «Trialab NK»

РЗН

5 л

**Промывающий раствор
BioClean NK**

Произведено: Biohol, Венгрия

Упаковано: ООО «Триалаб», Россия

Условия хранения: 2-35°C

Серия: 010062021

Изготовлено: 18.01.2021

Годен до: 07.2022

Только для in vitro диагностики

Набор «Trialab NK»
РЗН

1 л

**Промывающий
раствор
BioHuroclean**

Произведено: Biohol, Венгрия
Упаковано: ООО «Триалаб», Россия
Условия хранения: 2-35°C

Серия: 010062021
Изготовлено: 18.01.2021
Годен до: 07.2022

Только для in vitro диагностики

Набор «Trialab NK»
РЗН

1 л

**Лизирующий реагент
для определения
лейкоформулы
BioLyse-5NK**

Произведено: Висока, Венгрия
Упаковано: ООО «Триалаб», Россия
Условия хранения: 2-35°C

Серия: 010062021
Изготовлено: 18.01.2021
Годен до: 07.2022

Только для in vitro диагностики

Набор «Trialab NK»

РЗН

1 л

**Лизирующий реагент
для определения
лейкоцитов
и гемоглобина
BioLyse NK**

Произведено: Biohol, Венгрия
Упаковано: ООО «Триалаб», Россия
Условия хранения: 2-35°C

Серия: 010062021
Изготовлено: 18.01.2021
Годен до: 07.2022

Только для in vitro диагностики

В настоящем документе
проверено, прошито и
скреплено печатью

4 листов

Генеральный директор
ООО «Триалаб»

Прозоровский Н.С.





«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Триалаб»

Н.С. Прозоровский



2021г.

МАРКИРОВКА

медицинского изделия

Набор реагентов для автоматических гематологических анализаторов

МЕК-7222К, МЕК-8222К

«Trialab NK»

Маркировка набора реагентов

Набор реагентов для автоматических гематологических анализаторов МЕК-7222К, МЕК-8222К Trialab NK

Комплектация на 1500 исследований

Состав набора

1. Изотонический раствор (BioDil-5 NK)	Канистра 20 л	4 шт
2. Лизирующий реагент для определения лейкоцитов и гемоглобина (BioLyse NK)	Флакон 1 л	1 шт
3. Лизирующий реагент для определения лейкоформулы (BioLyse-5 NK)	Флакон 1 л	1 шт
4. Промывающий раствор (BioClean NK)	Канистра 5 л	1 шт
5. Промывающий раствор (BioHypoclean)	Флакон 1 л	2 шт

Производитель: ООО «Триалаб»

117321, Москва, ул. Профсоюзная, 152-3, оф. 100

info@trialab.ru

ТУ-21.20.23-006-13296835-2021

РУ

Серия: 010062021

Изготовлено: 18.01.2021 г.

Годен до: 07.2022 г.

Хранить: при 2-35 °С

Транспортировать: при 2-35 °С

Для профессионального применения.

Только для in vitro диагностики.

Обратитесь к инструкции по применению.

Маркировка компонентов набора.

Набор «Trialab NK»

РЗН

5 л

Промывающий раствор BioClean NK

Произведено: Biochol, Венгрия

Серия: 010062021

Упаковано: ООО «Триалаб», Россия

Изготовлено: 18.01.2021

Условия хранения: 2-35°C

Годен до: 07.2022

Только для in vitro диагностики

Набор «Trialab NK»

РЗН

20 л

Изотонический раствор BioDil-5 NK

Произведено: Biochol, Венгрия

Серия: 010062021

Упаковано: ООО «Триалаб», Россия

Изготовлено: 18.01.2021

Условия хранения: 2-35°C

Годен до: 07.2022

Только для in vitro диагностики

Набор «Trialab NK»
РЗН

1 л

**Лизирующий реагент
для определения
лейкоформулы
BioLyse-5NK**

Произведено: Biohol, Венгрия
Упаковано: ООО «Триалаб», Россия
Условия хранения: 2-35°С

Серия: 010062021
Изготовлено: 18.01.2021
Годен до: 07.2022

Только для in vitro диагностики

Набор «Trialab NK»
РЗН

1 л

**Промывающий
раствор
BioHypoclean**

Произведено: Biohol, Венгрия
Упаковано: ООО «Триалаб», Россия
Условия хранения: 2-35°С

Серия: 010062021
Изготовлено: 18.01.2021
Годен до: 07.2022

Только для in vitro диагностики

Набор «Trialab NK»
РЗН

1 л

**Лизирующий реагент
для определения
лейкоцитов
и гемоглобина
BioLyse NK**

Произведено: Biohol, Венгрия
Упаковано: ООО «Триалаб», Россия
Условия хранения: 2-35°С

Серия: 010062021
Изготовлено: 18.01.2021
Годен до: 07.2022

Только для in vitro диагностики

В настоящем документе
проверено, прошито и
скреплено печатью

_____ листов

Генеральный директор
ООО «Триалаб»

Прозоровский Н.С.

