

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «СПА ИННОВАЦИИ»

Юдина С.В.



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


**«Аппарат для экстракорпоральной ударно-волновой терапии D-АСТОР 200 с
принадлежностями»**

производства Storz Medical AG (Шторц Медикал АГ), Швейцария


Аппарат для экстракорпоральной ударно-волновой терапии D-ACTOR 200 с принадлежностями




Блок аппарата основной

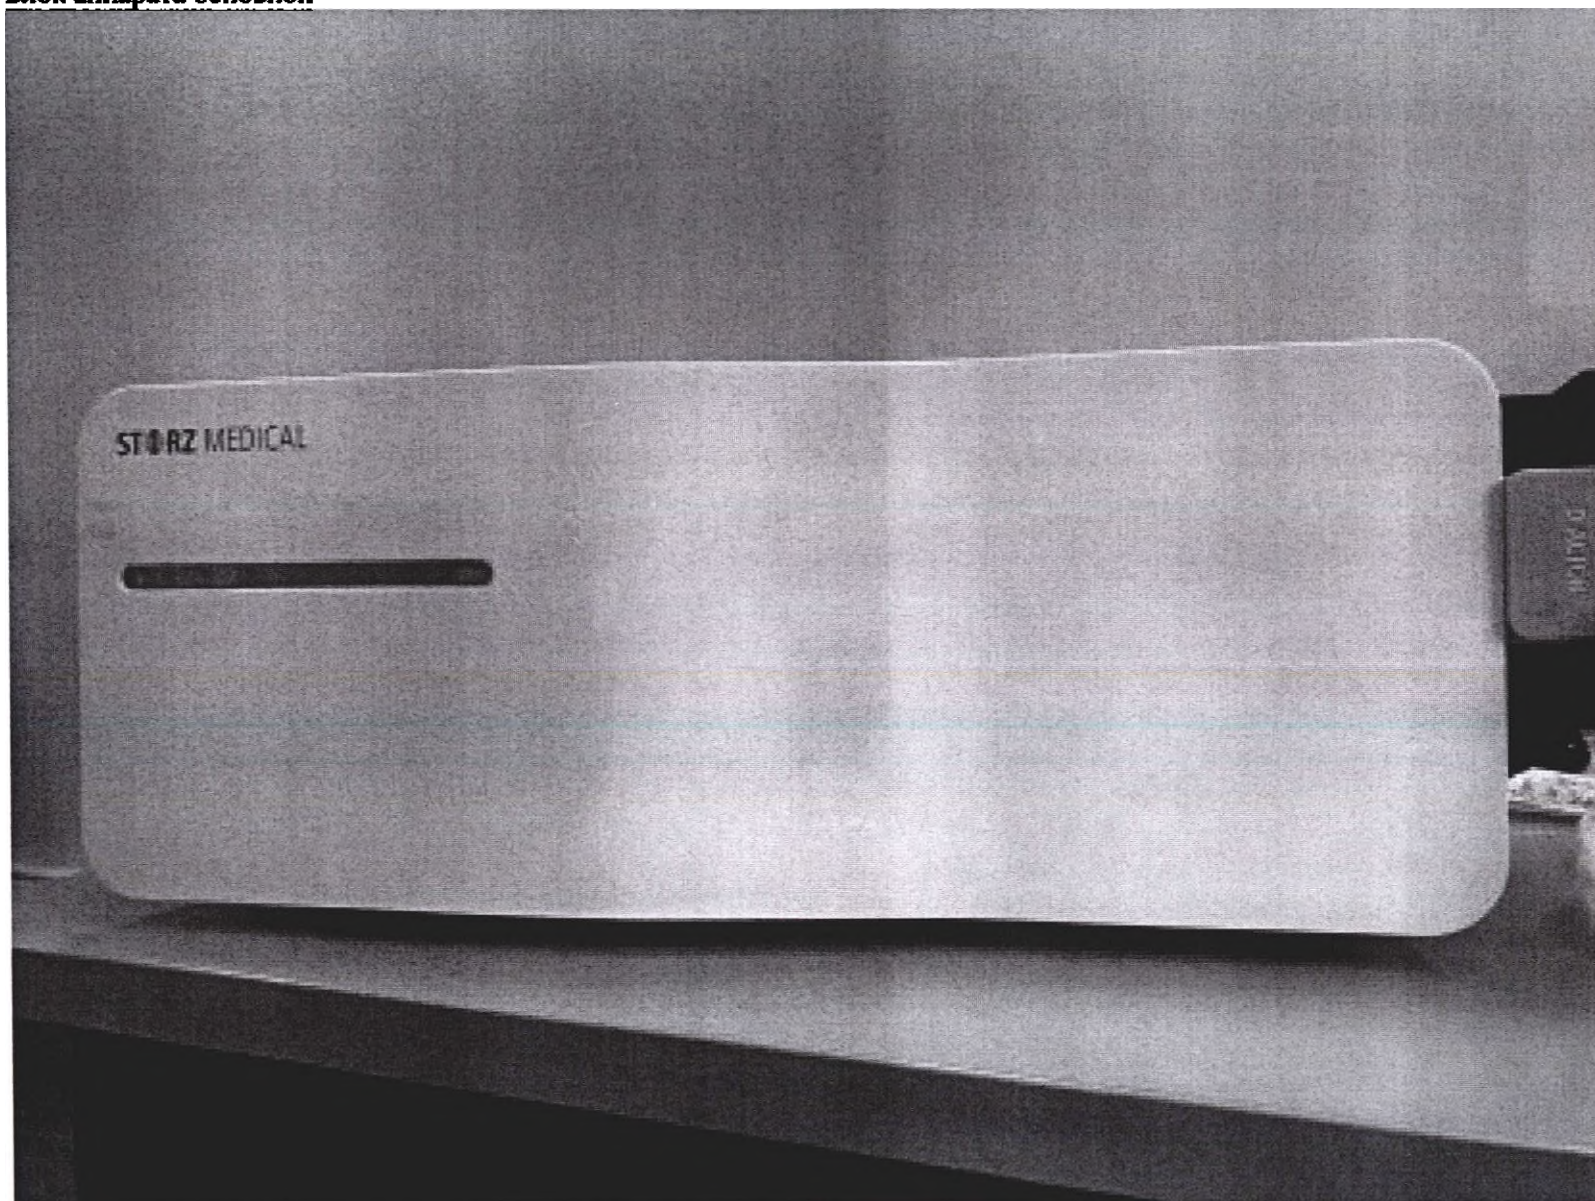


Шнур сетевой

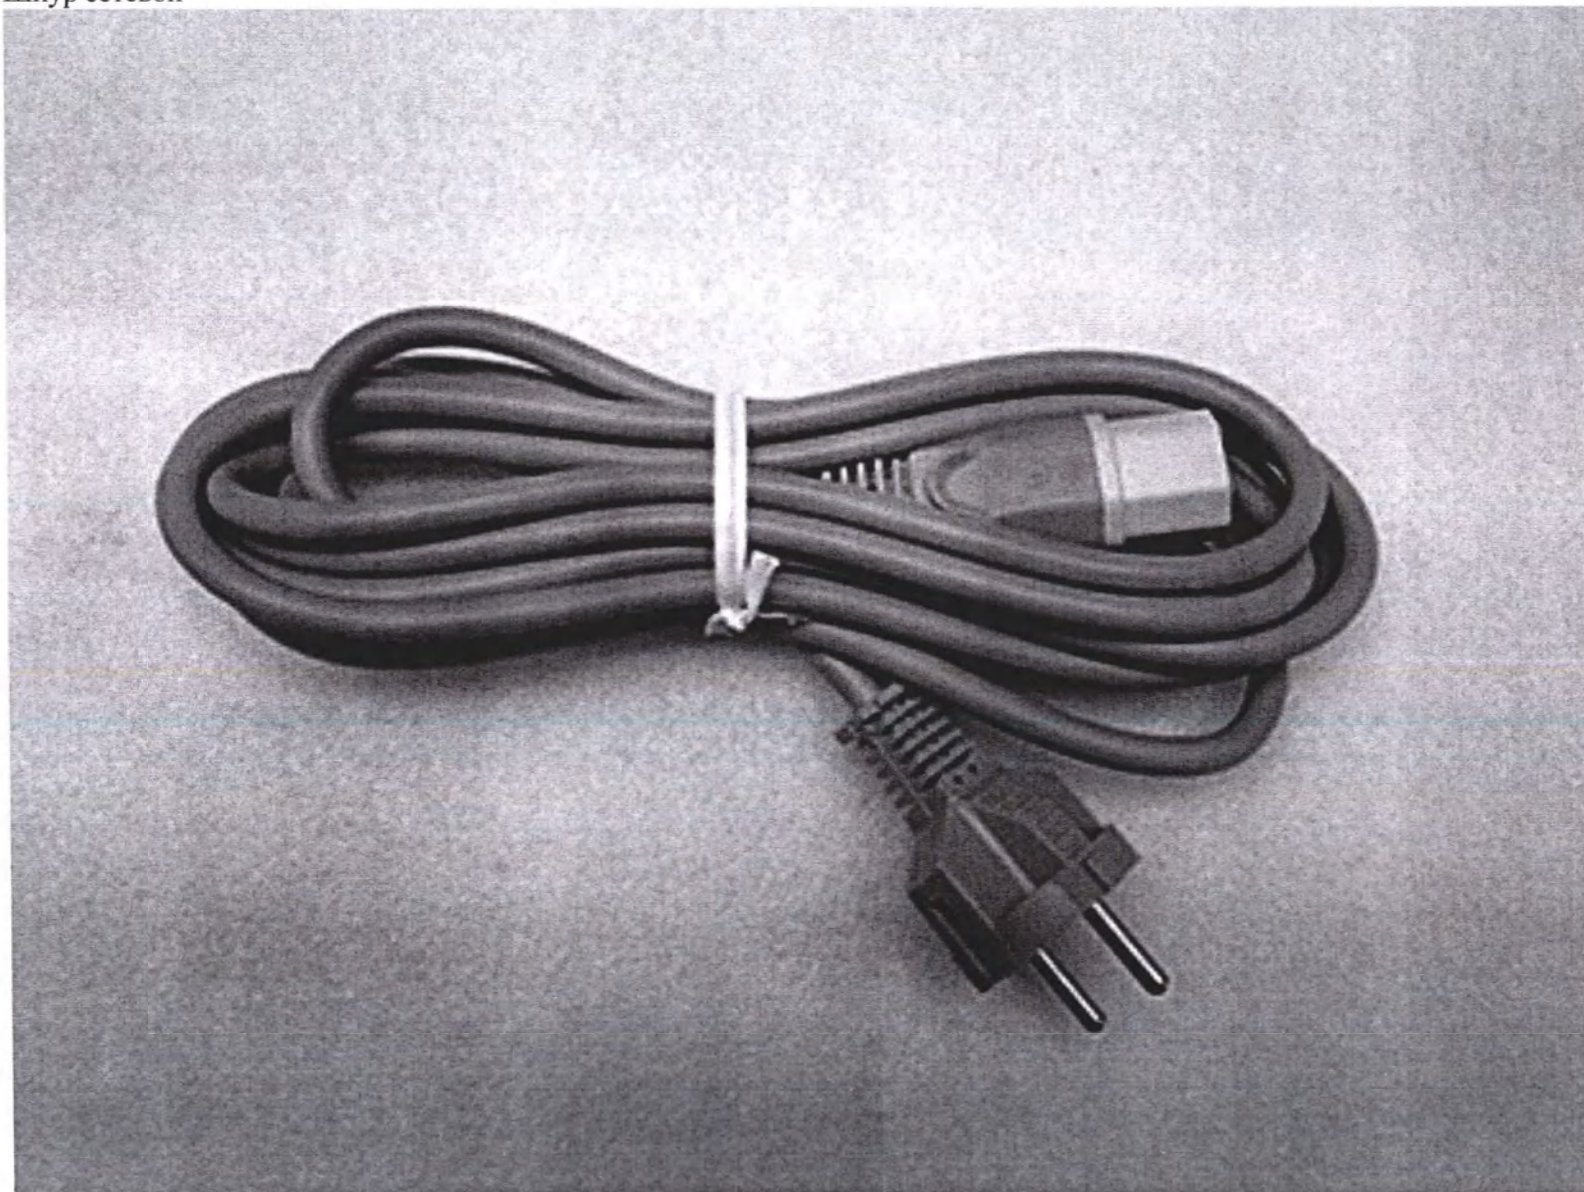


Наклейка декоративная

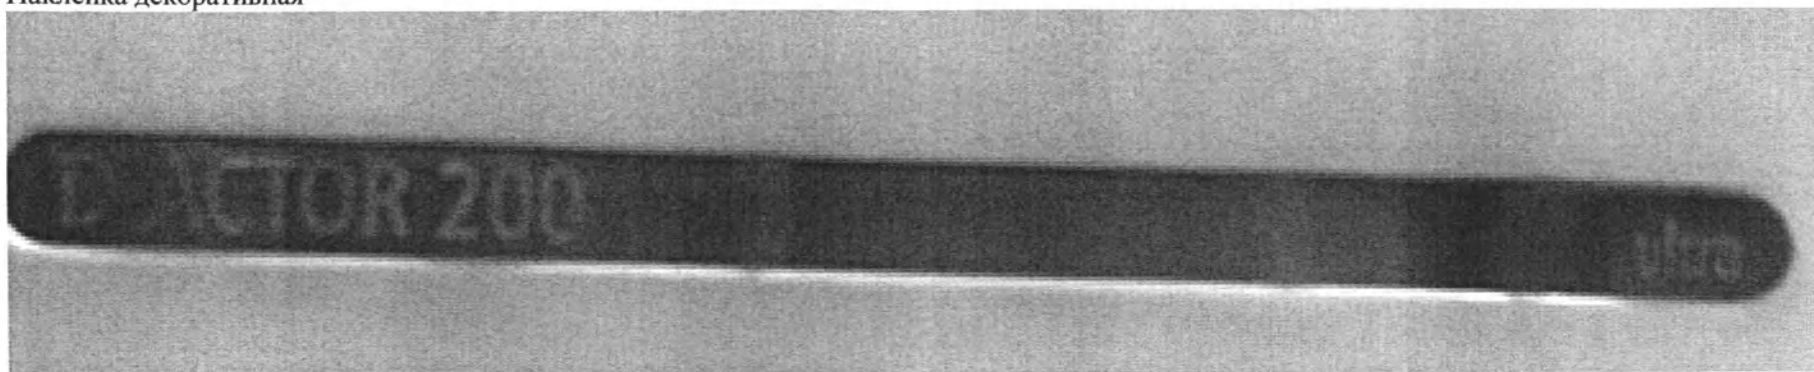


Монитор управления, в составе:- кабель соединительный USB 2.0; - адаптер сетевой с проводом соединительным; - шнур сетевой адаптера; - переходник USB 2.0 - USB 2.0 micro; - кабель соединительный USB 2.0 - USB 2.0 micro ; - стилус

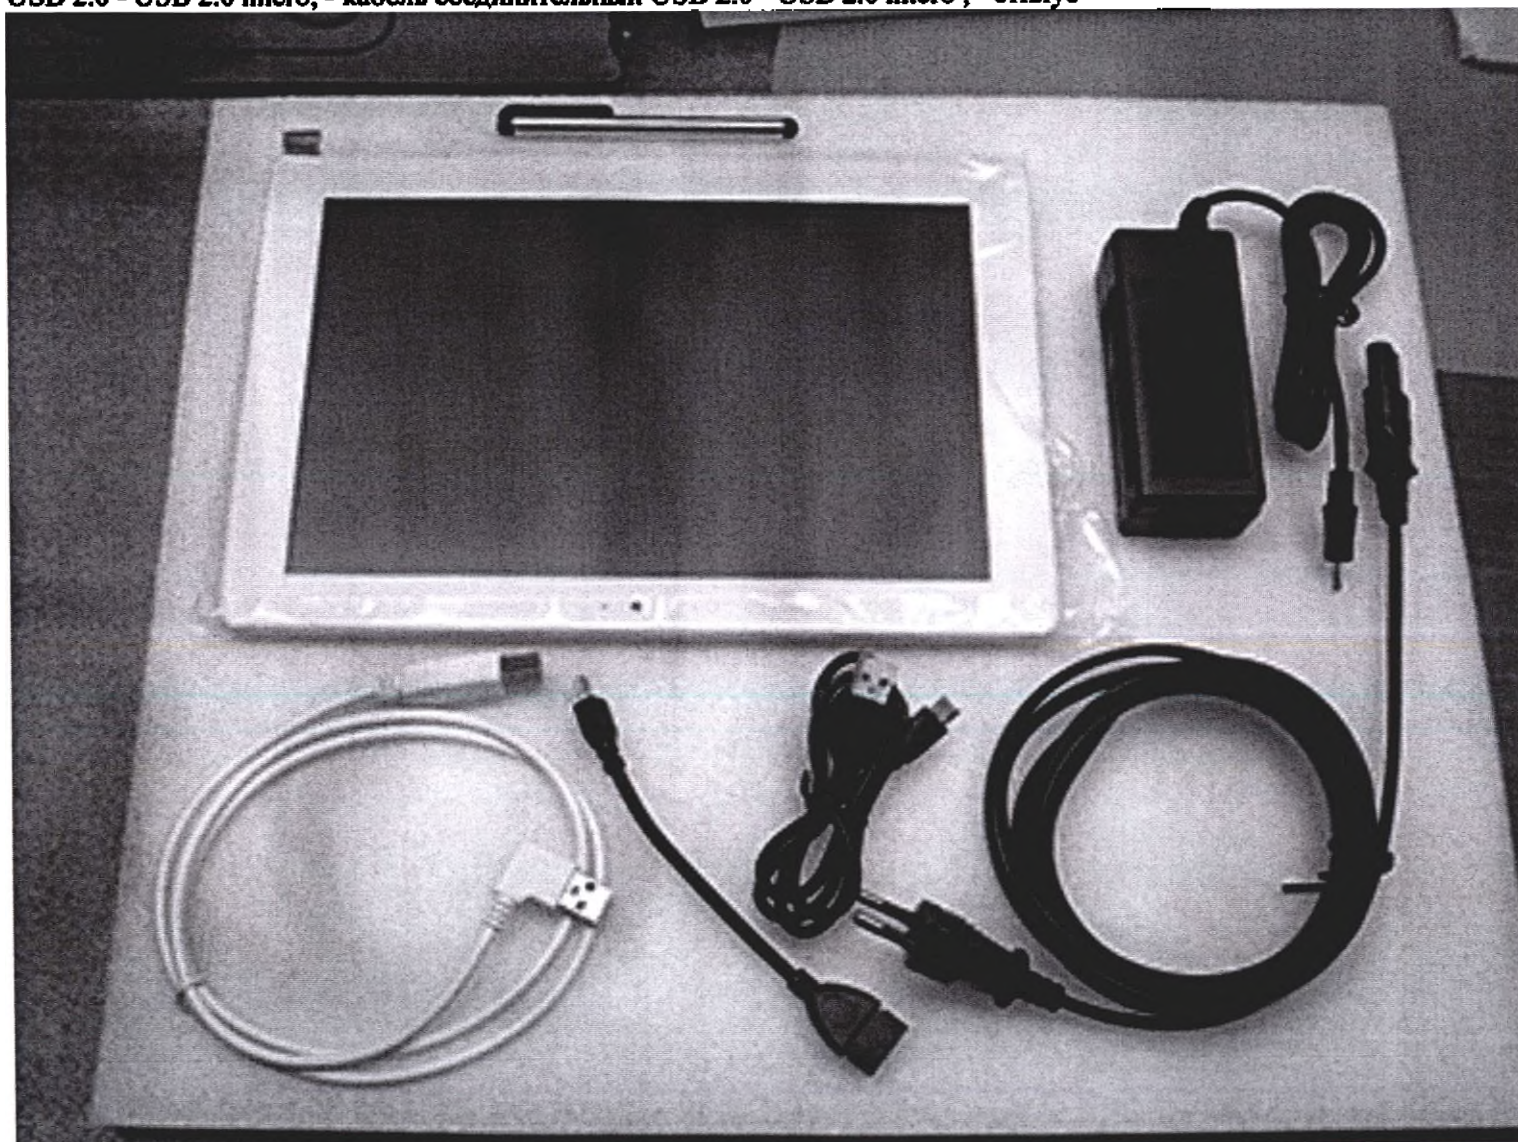


Подставка под монитор управления

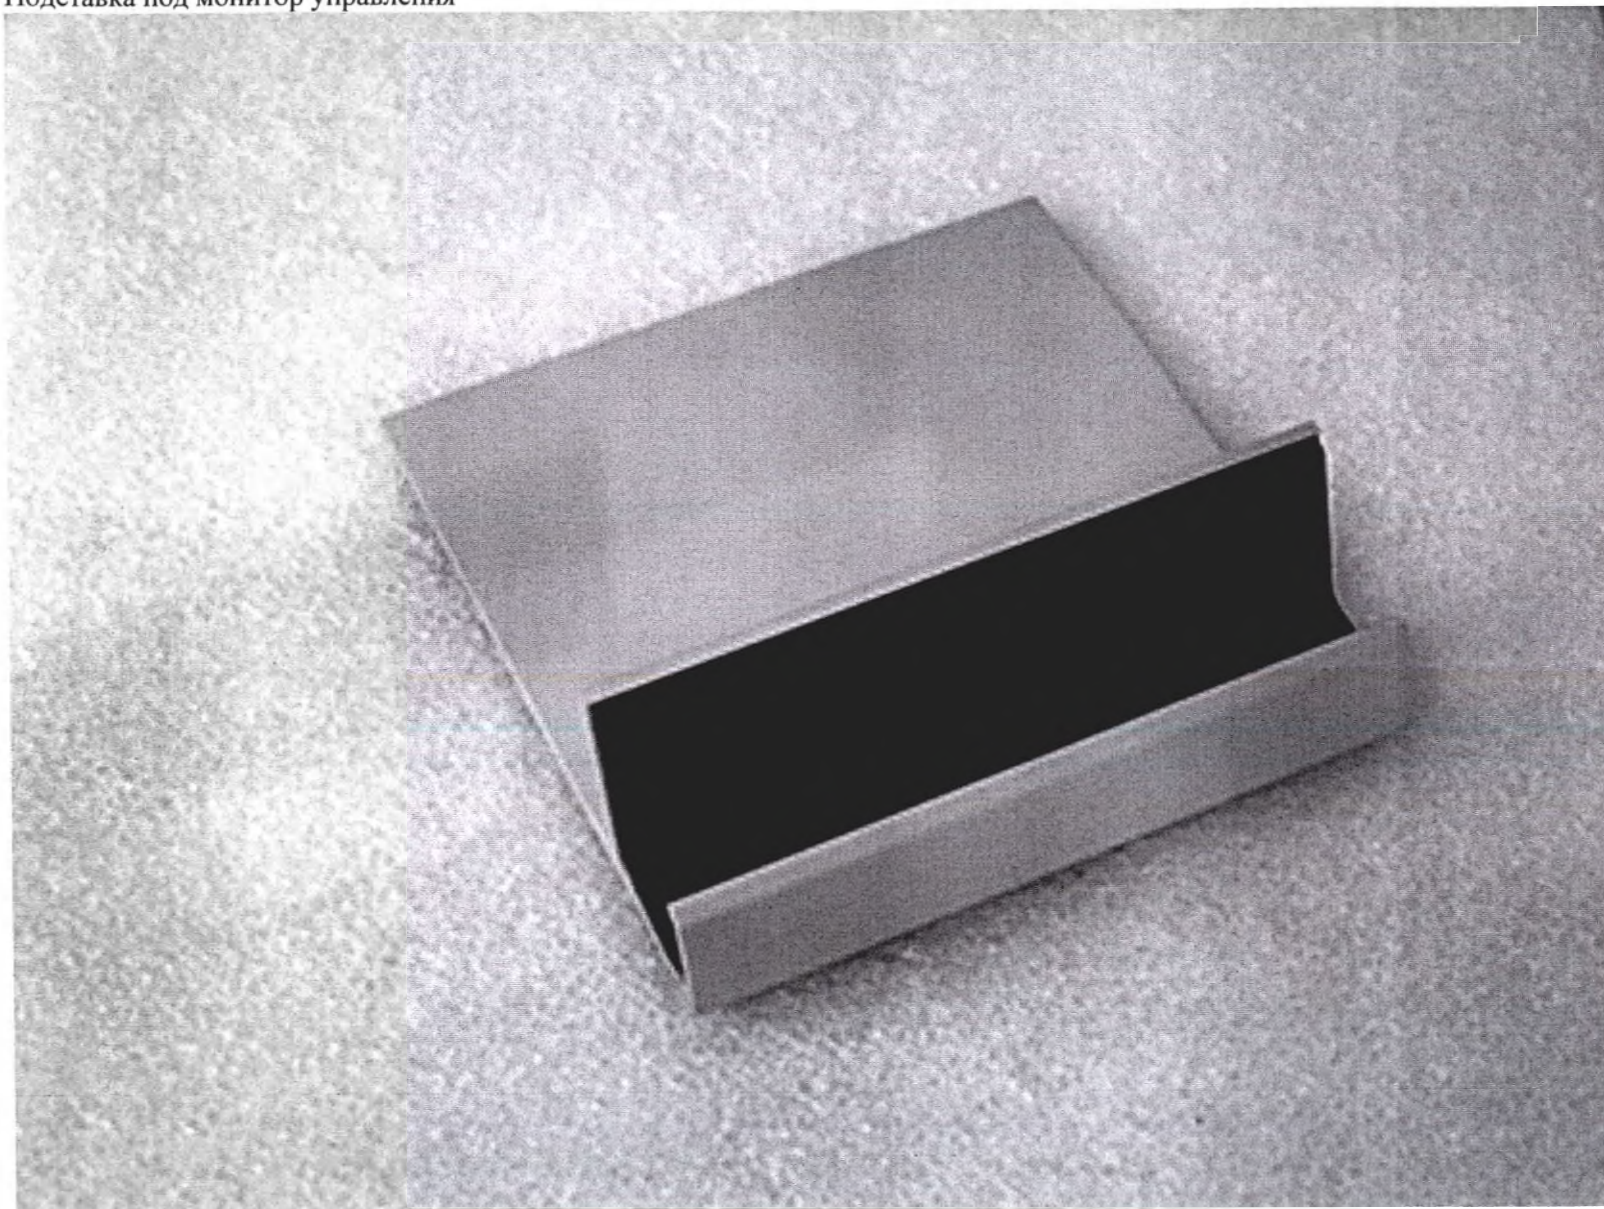


Коврик противоскользящий

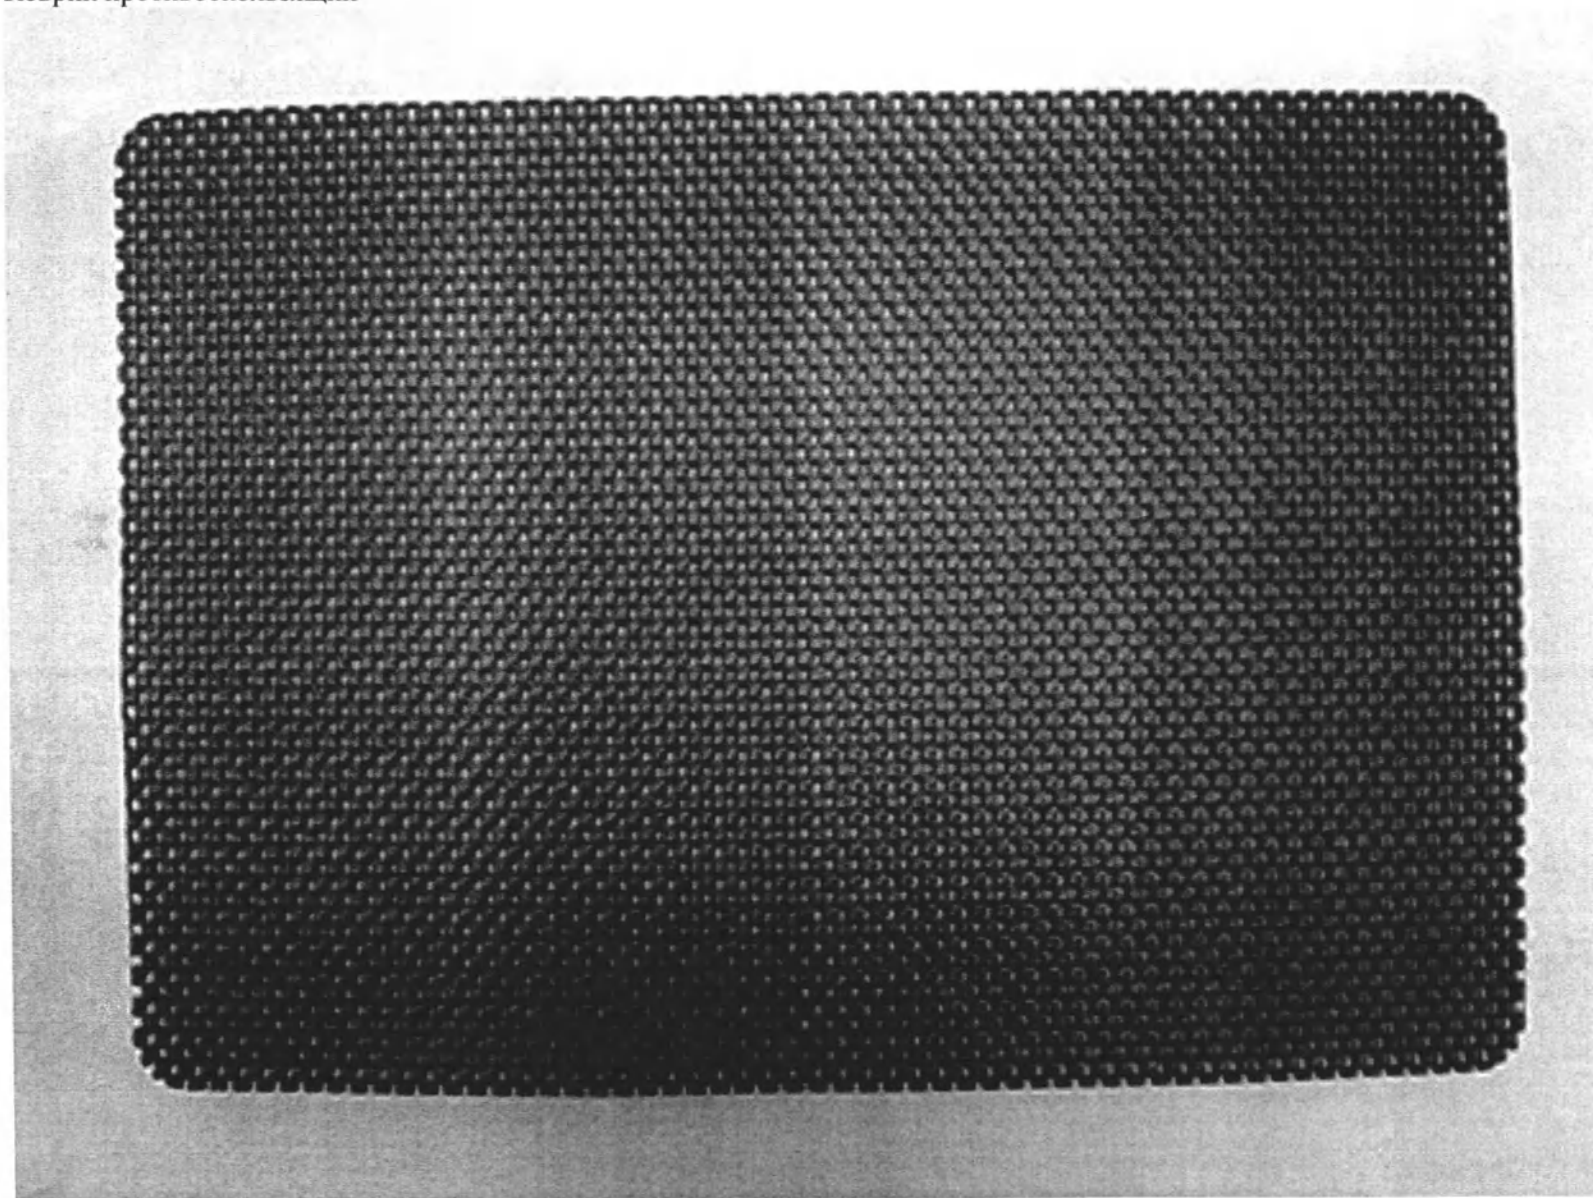

Аппликатор или Аппликатор сменный

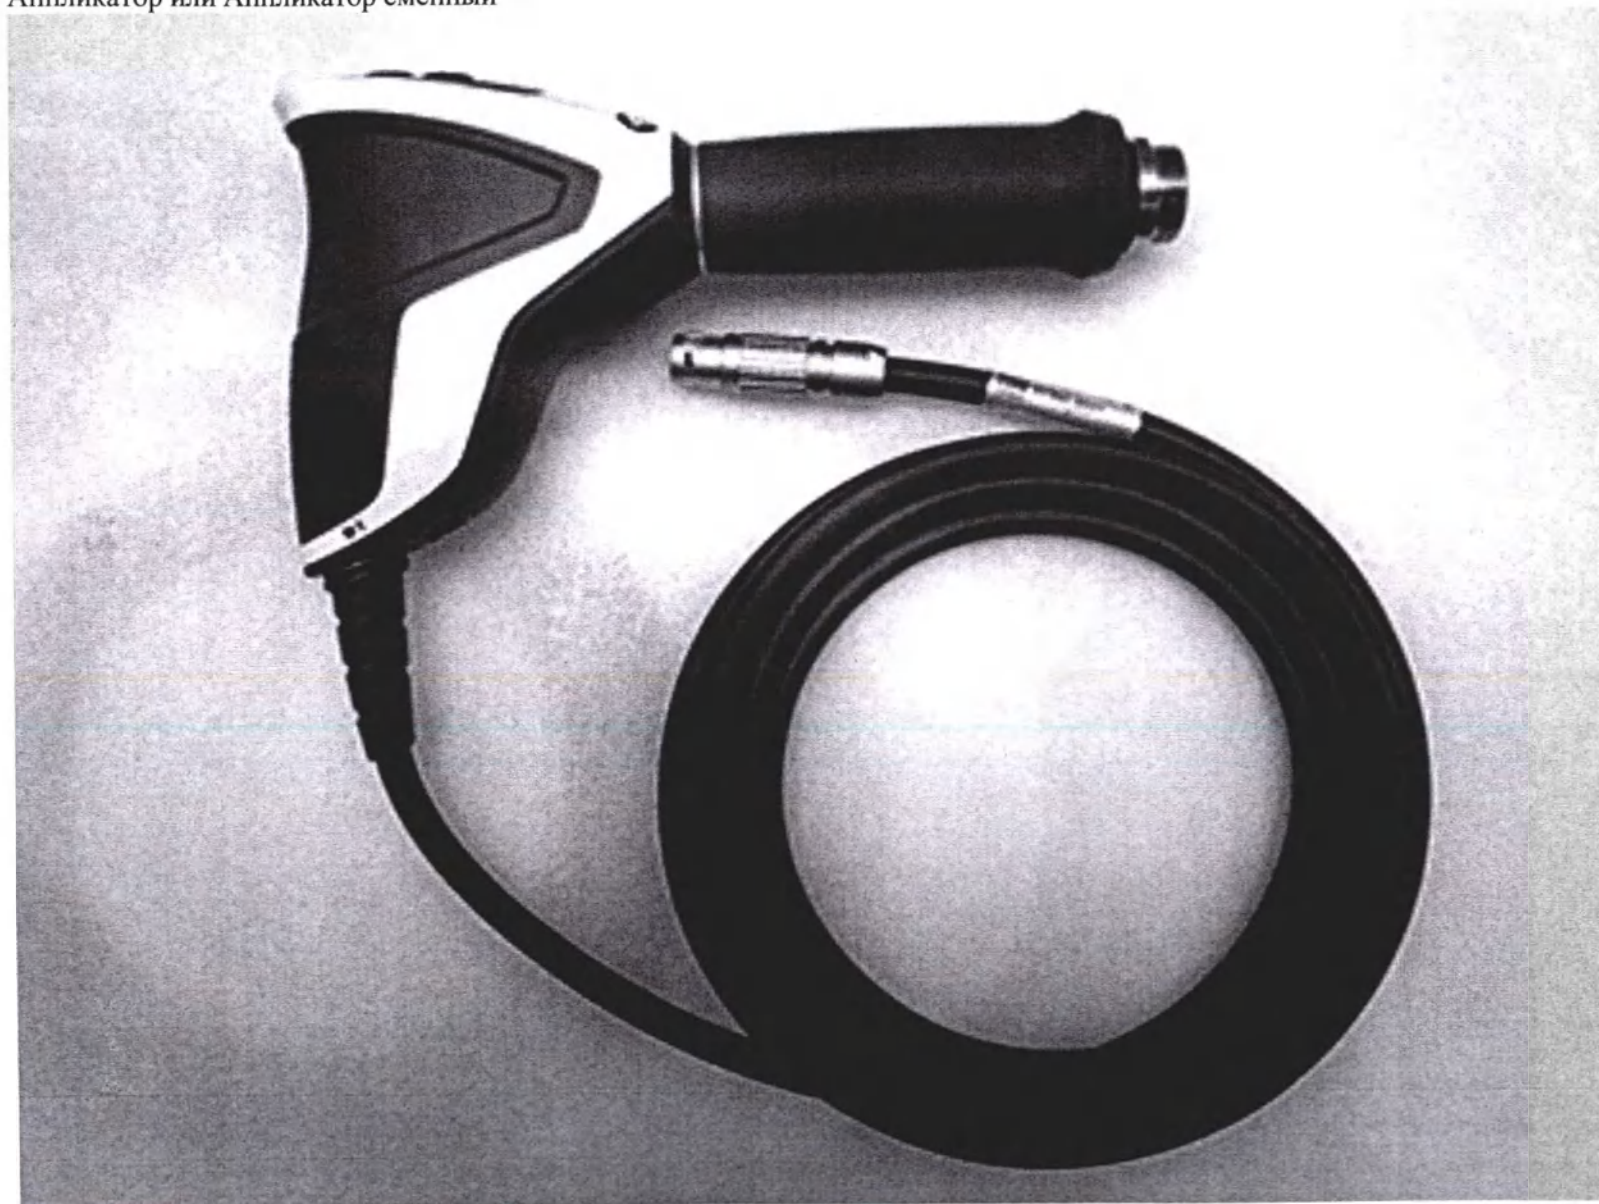


Держатель аппликатора

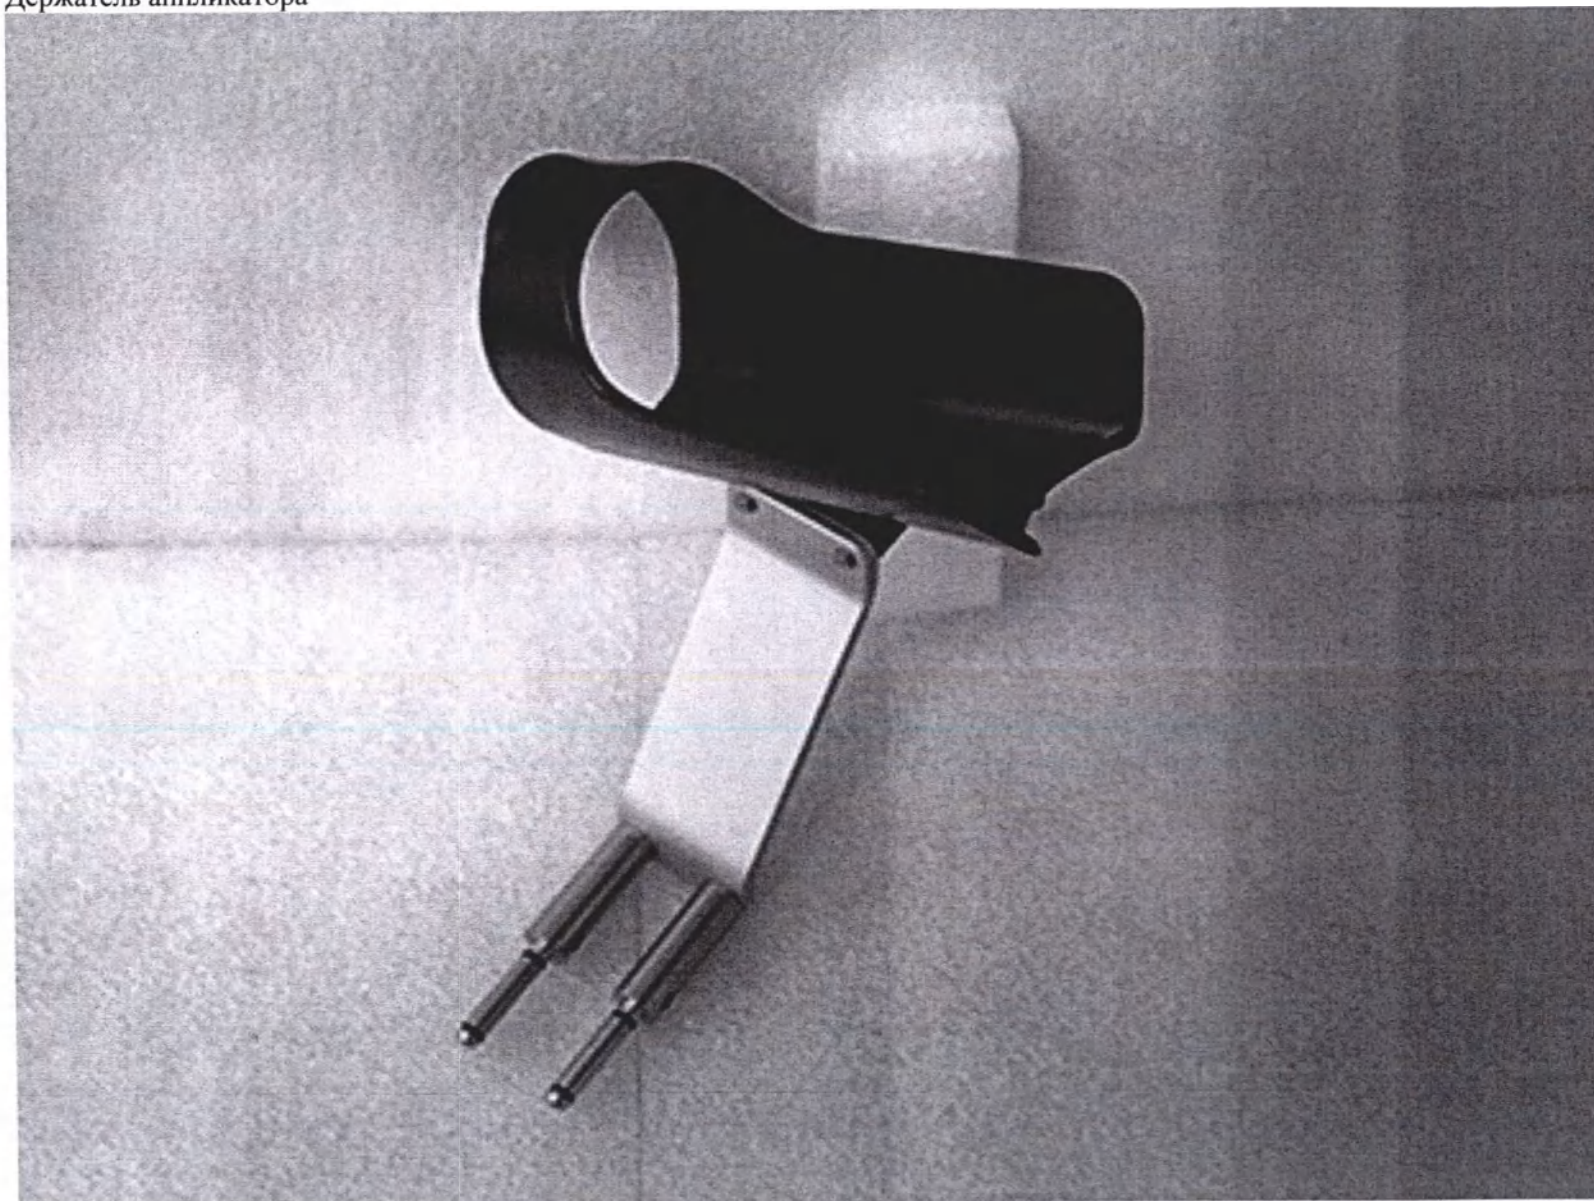


Ключ аппликатора рожковый (22 мм)




Ключ аппликатора шестигранный (2,5 мм)

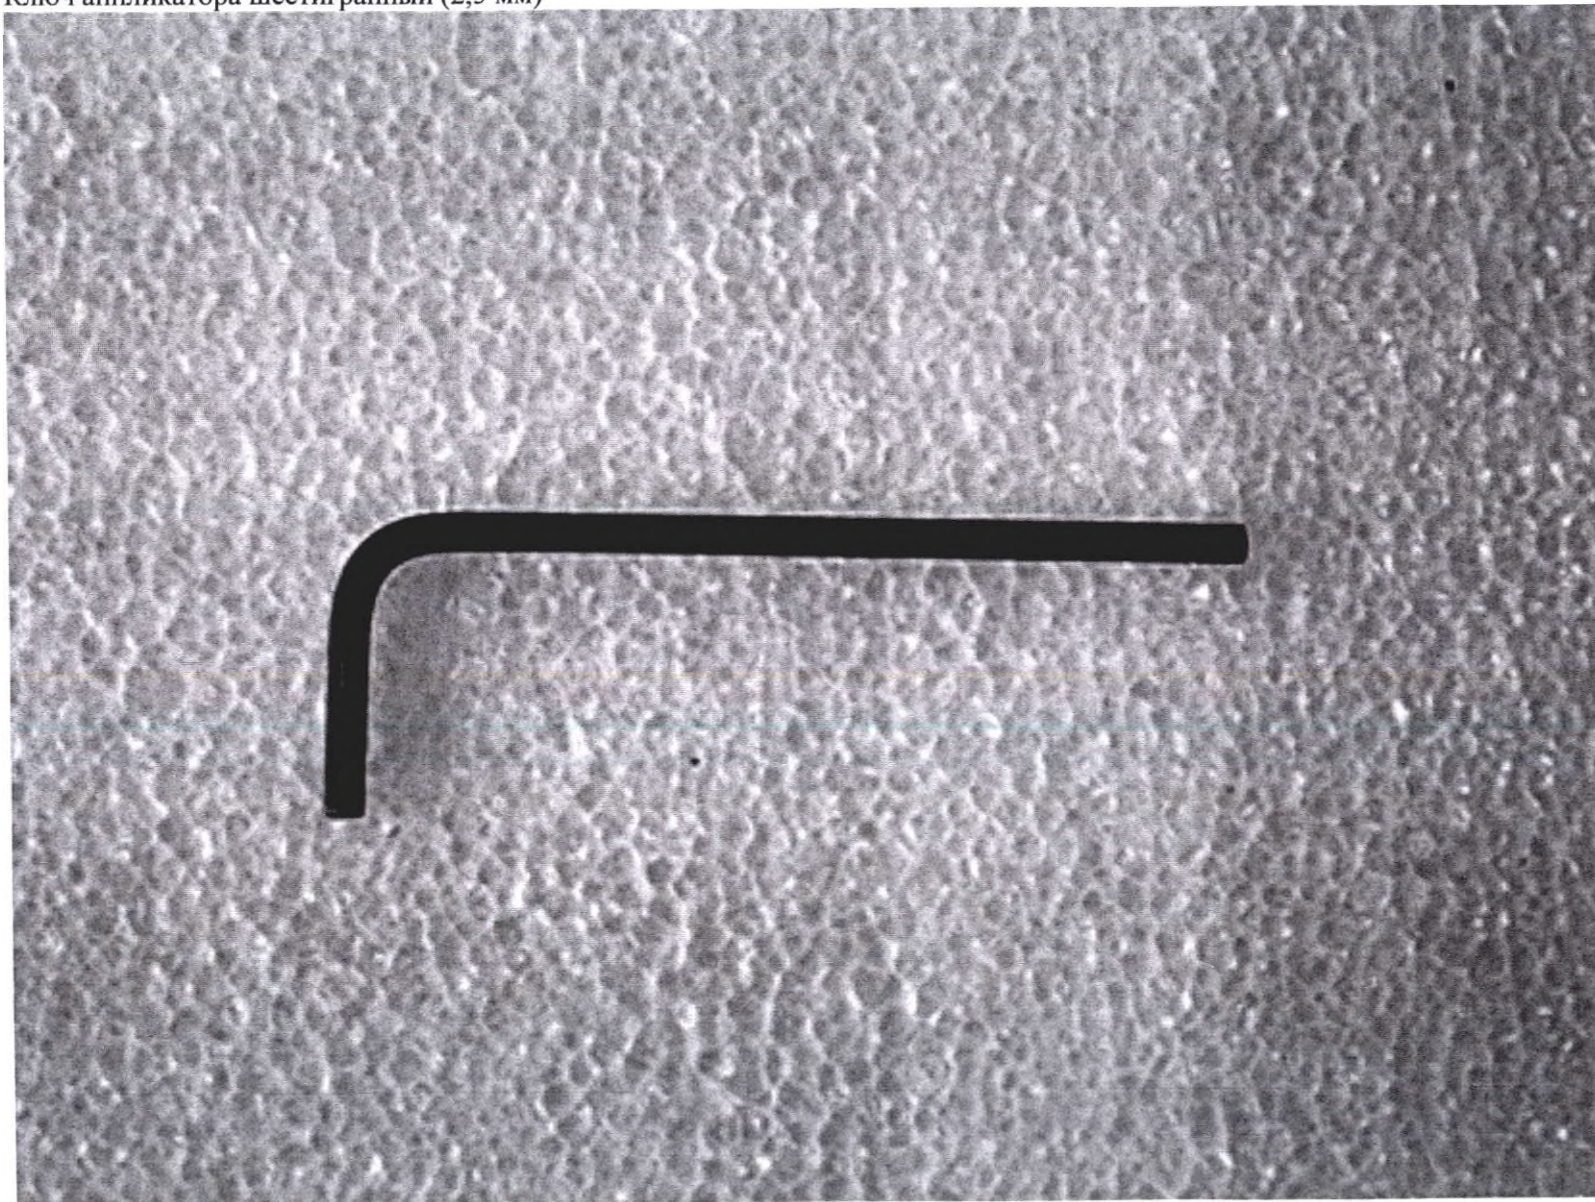


Трубка направляющая

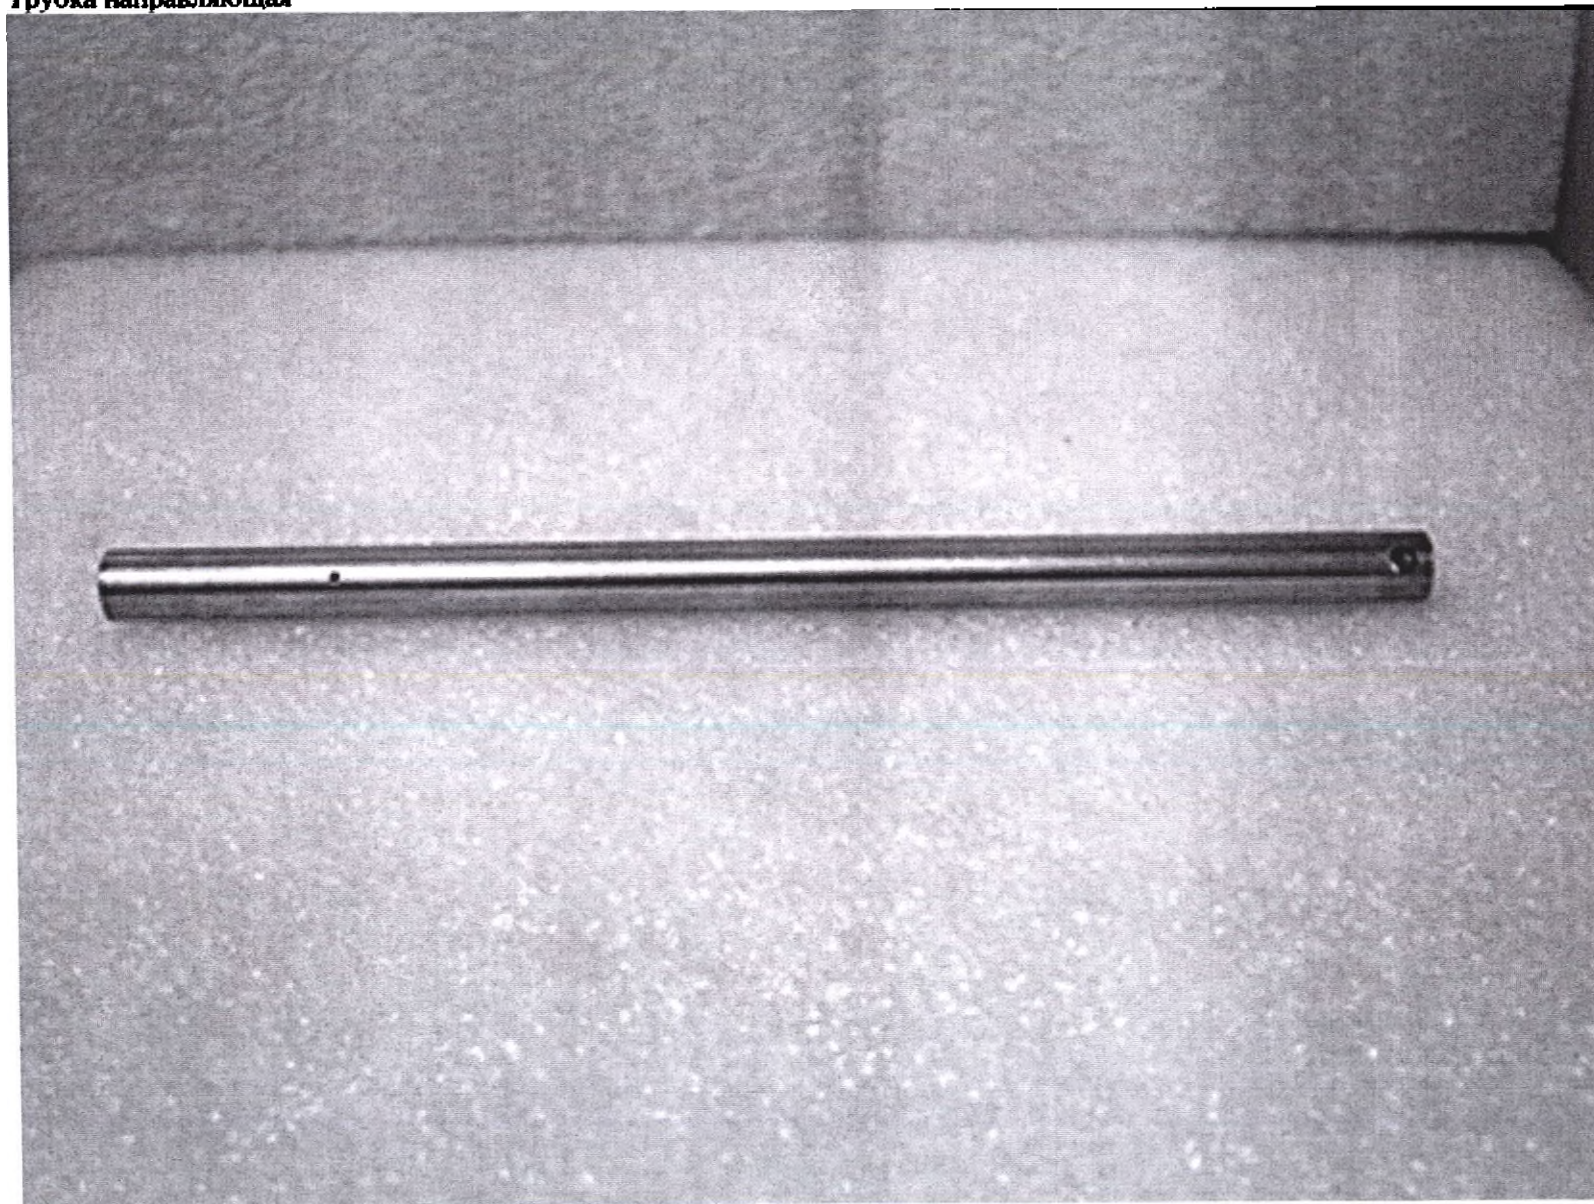


Сердечник ударный

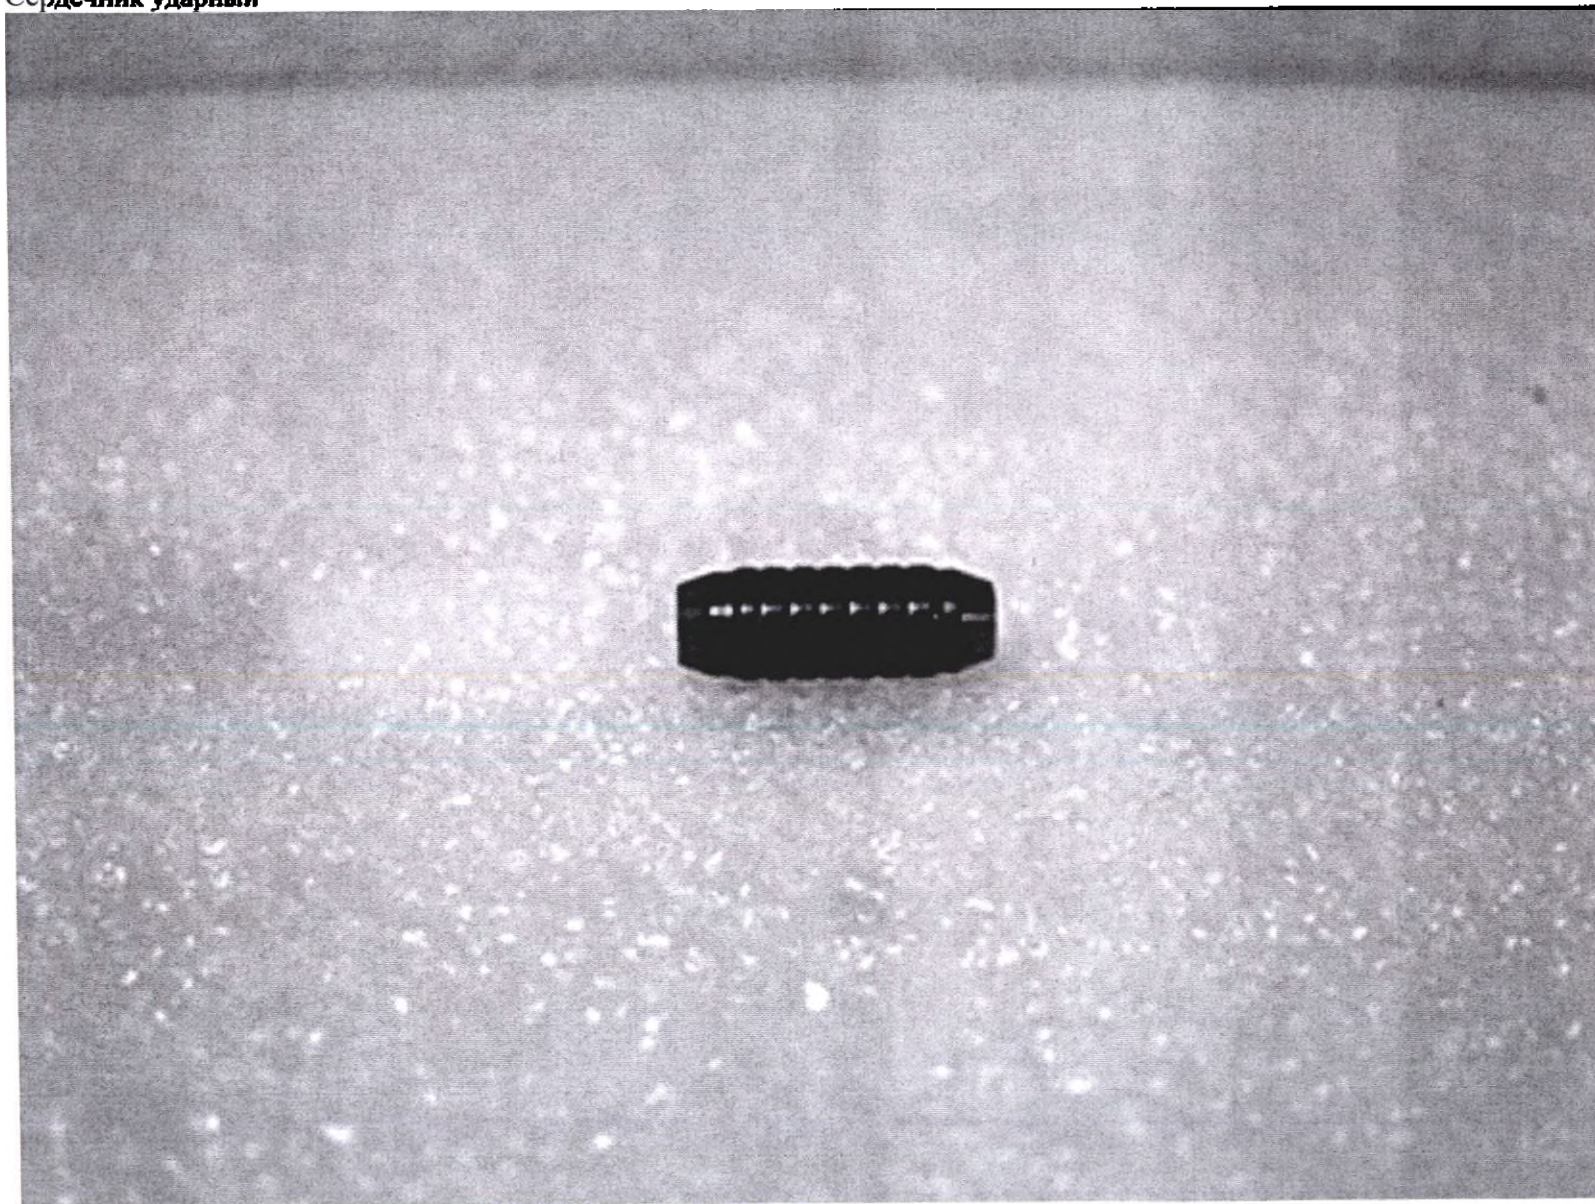

Набор колец уплотнительных в пластиковом контейнере: Ø 11 мм - 2 шт. Ø 12 мм - 2 шт. Ø 13 мм - 2 шт. Ø 14,5 мм - 2 шт. Ø 24 мм - 2 шт

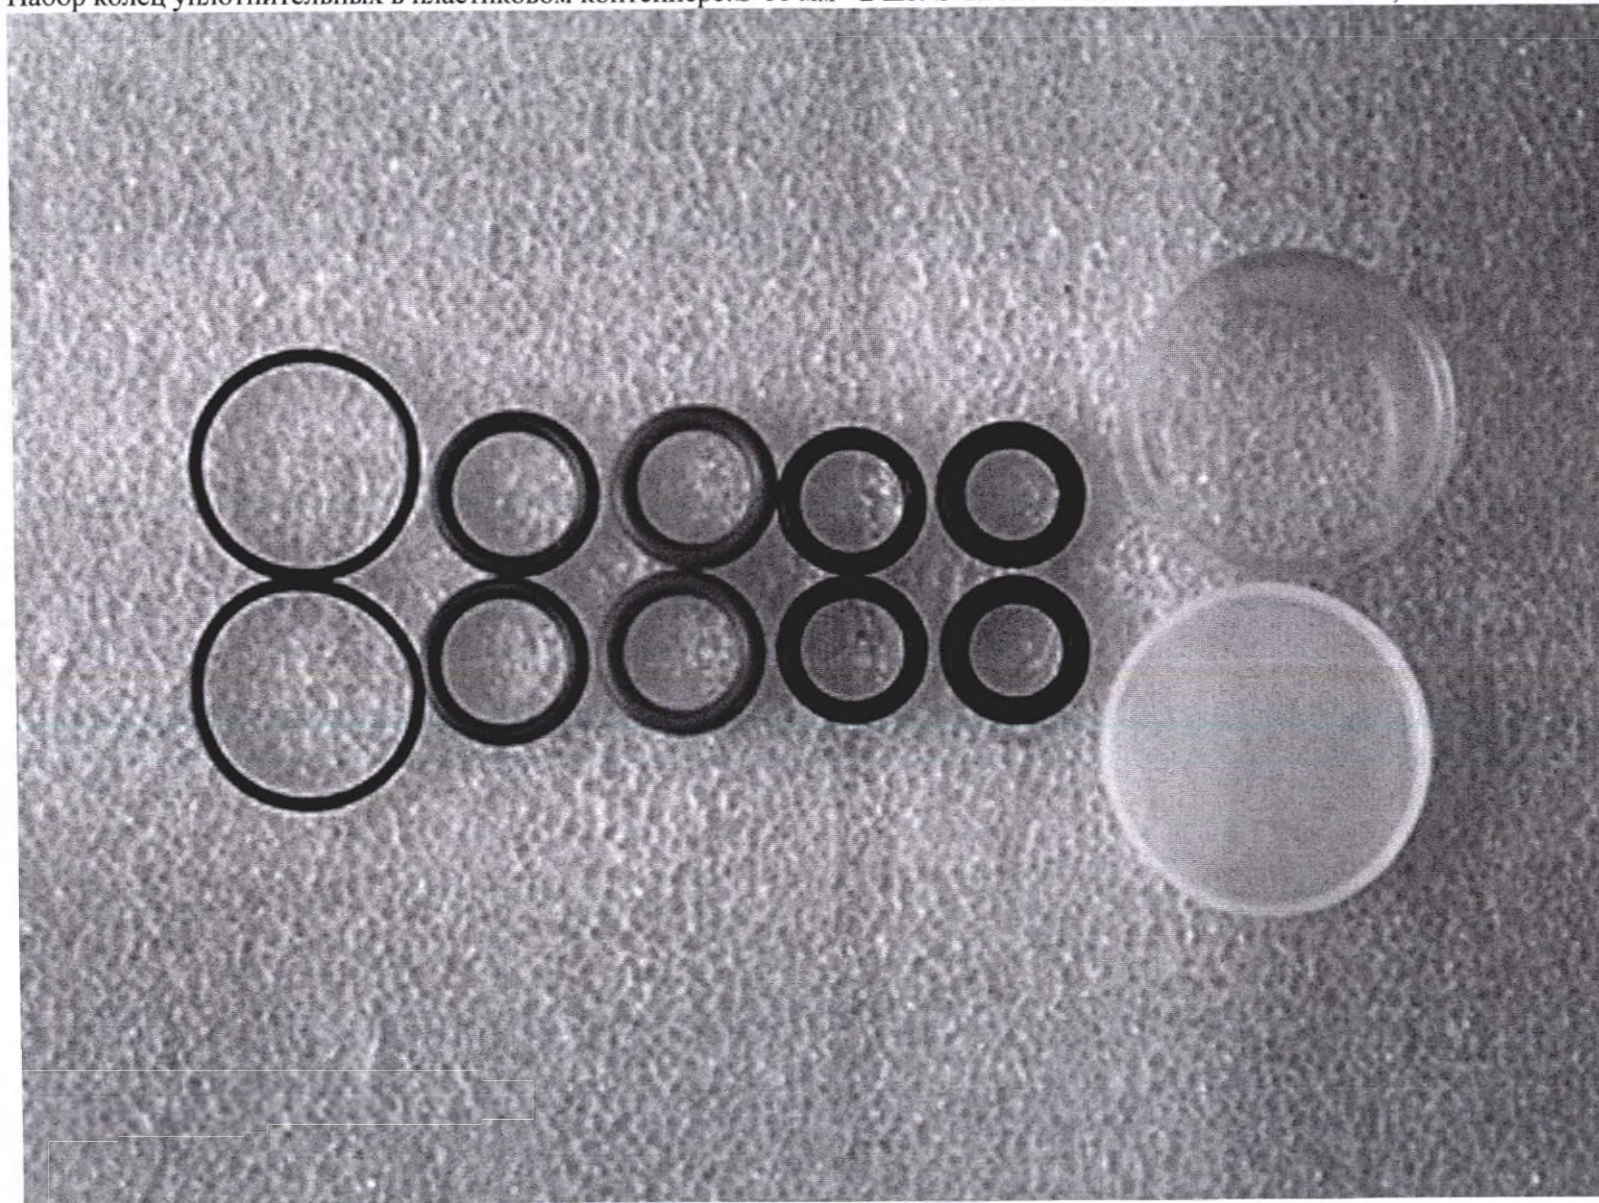




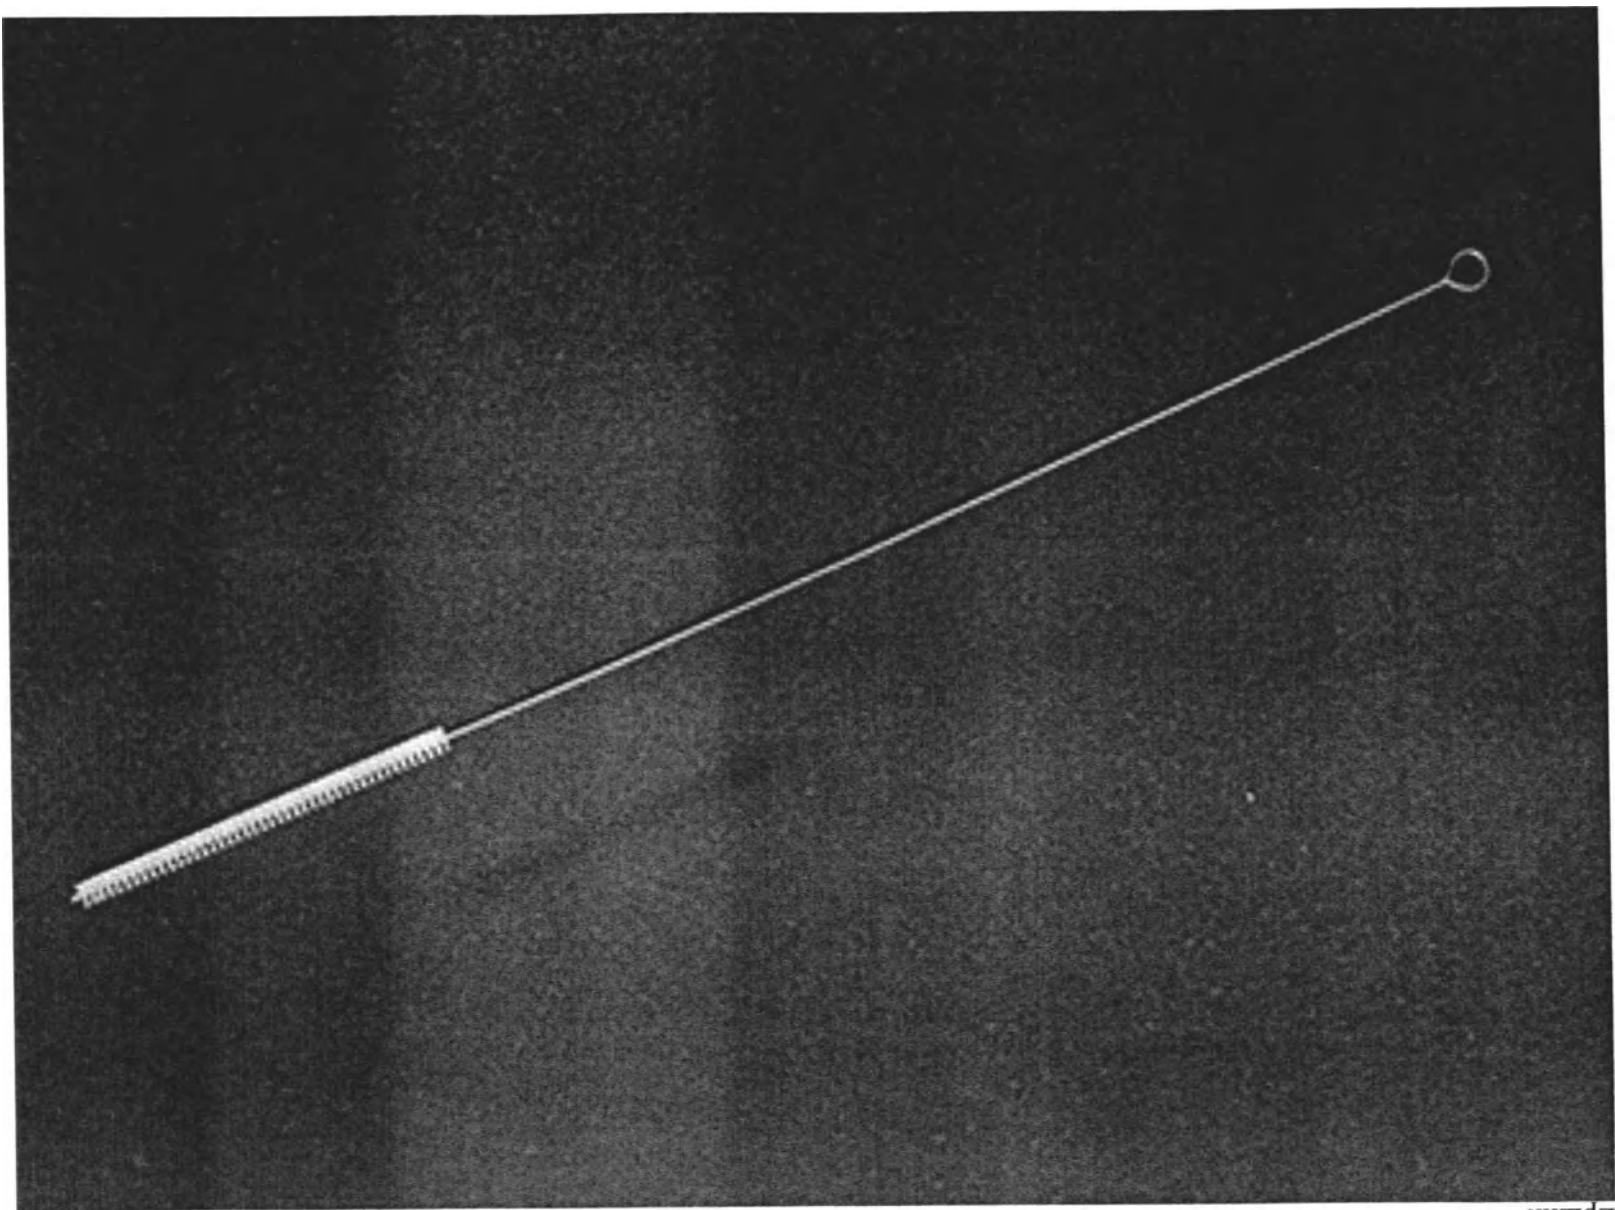


Рисунок

Гель контактный




Комплект документации, в составе: - Инструкция по эксплуатации D-ACTOR 200; - Руководство по эксплуатации «Аппликатор»; - Руководство по эксплуатации «Виброаппликатор» (при необходимости); -Руководство пользователя «Адиометр» (при необходимости)

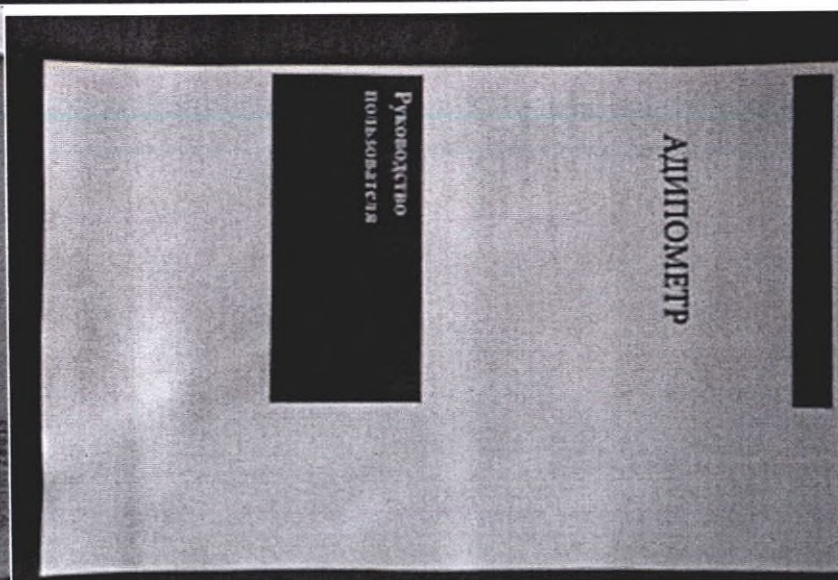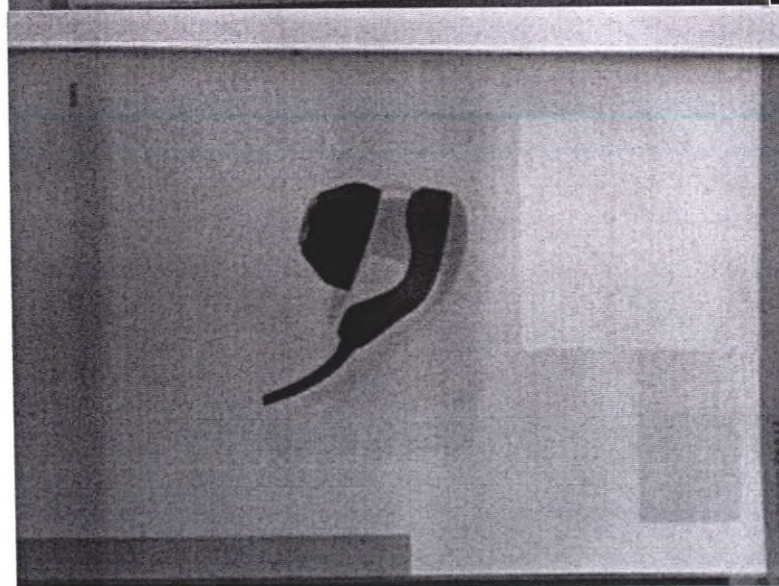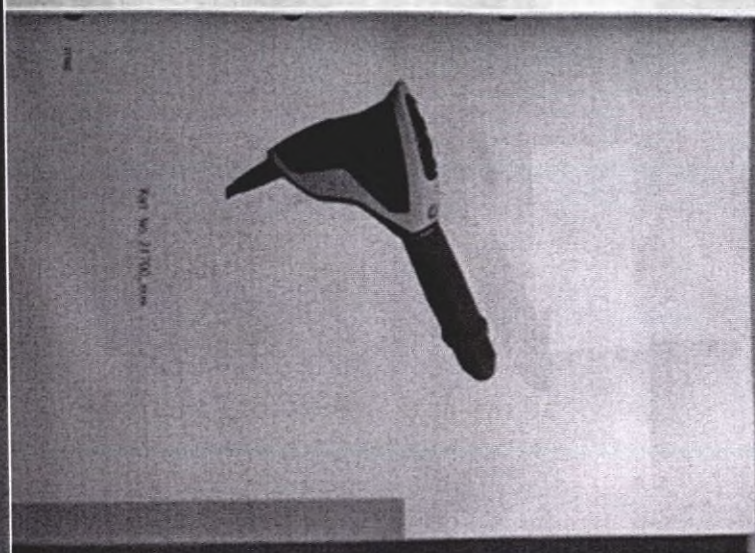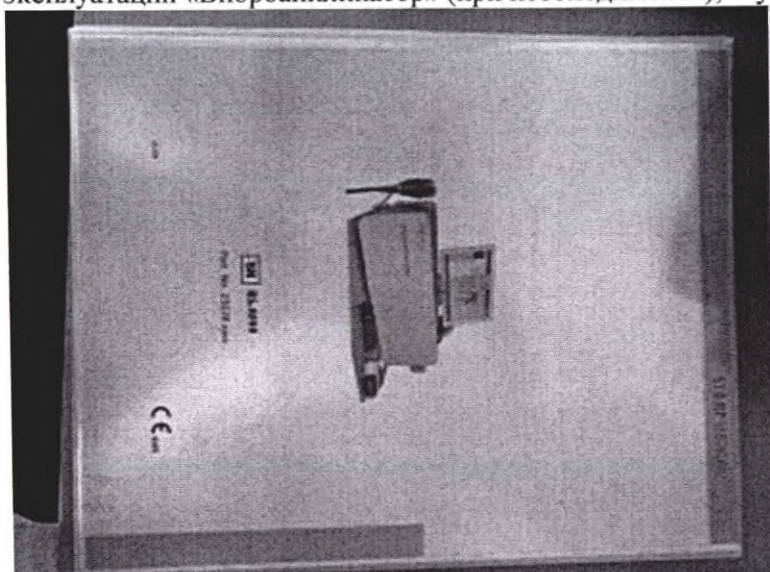


Виброаппликатор или Виброаппликатор сменный




Держатель виброаппликатора

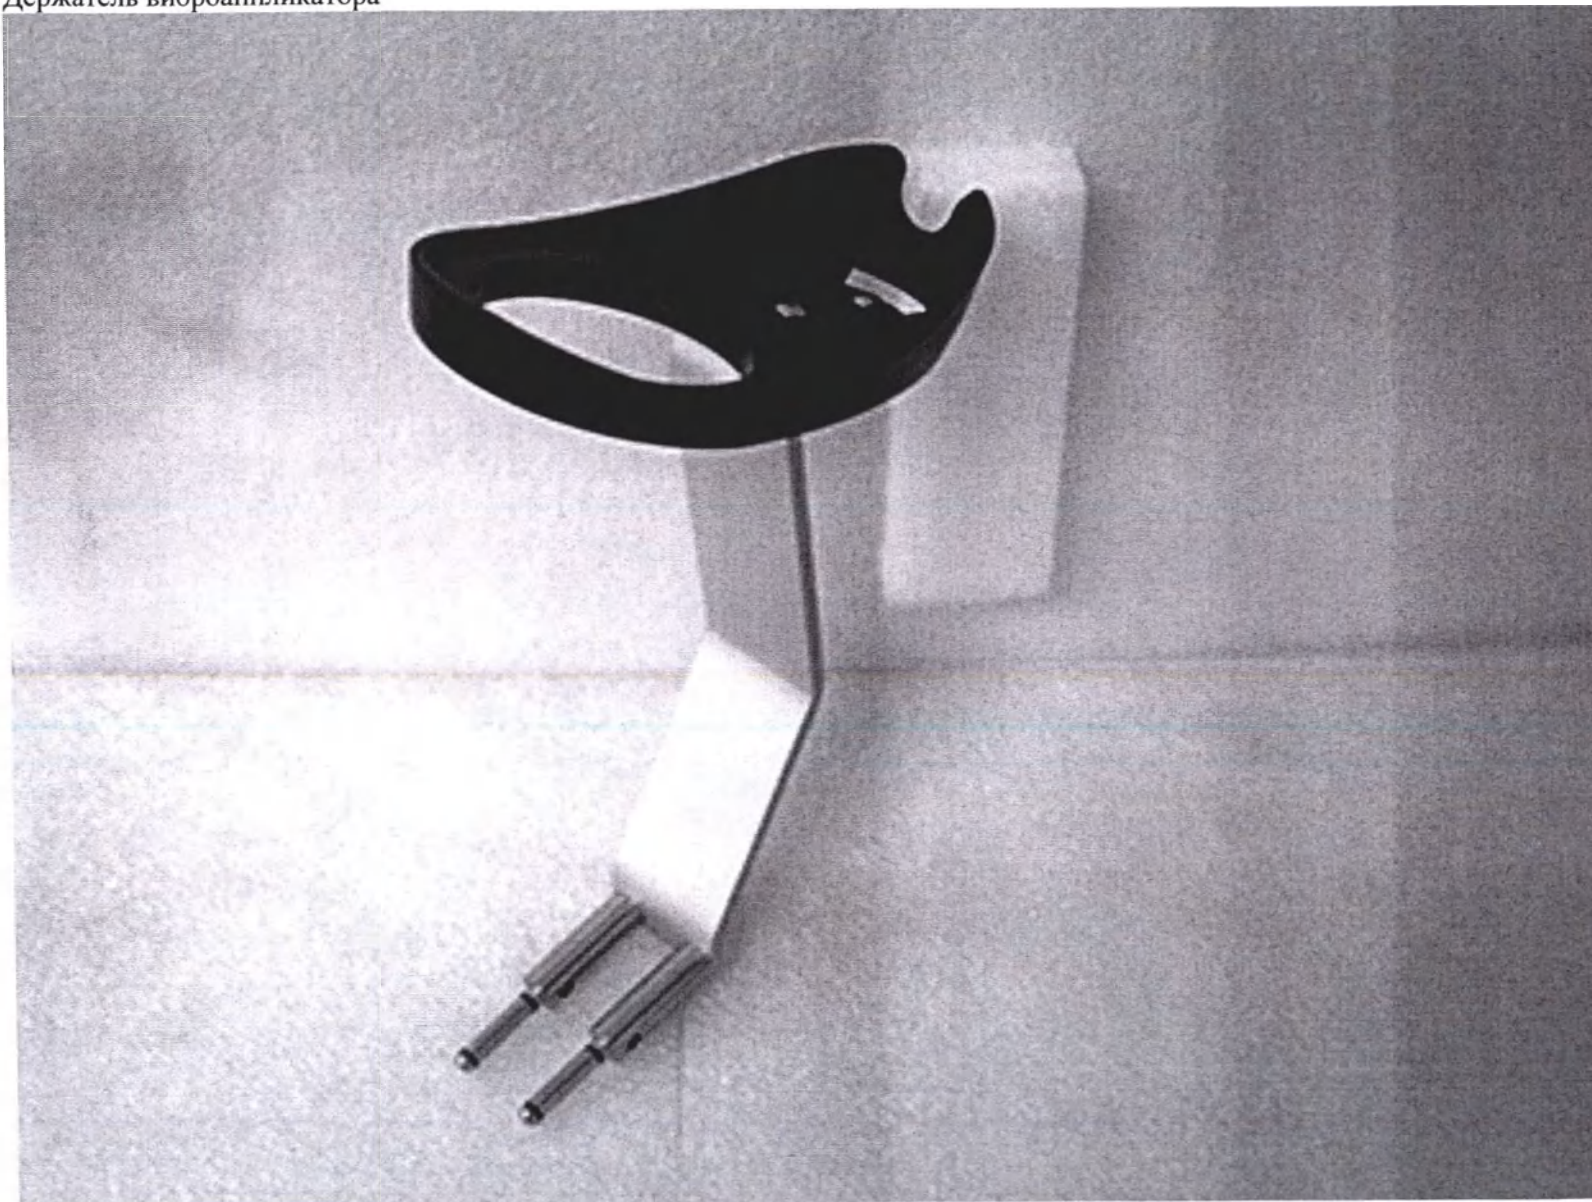


Головка Ø 25 мм

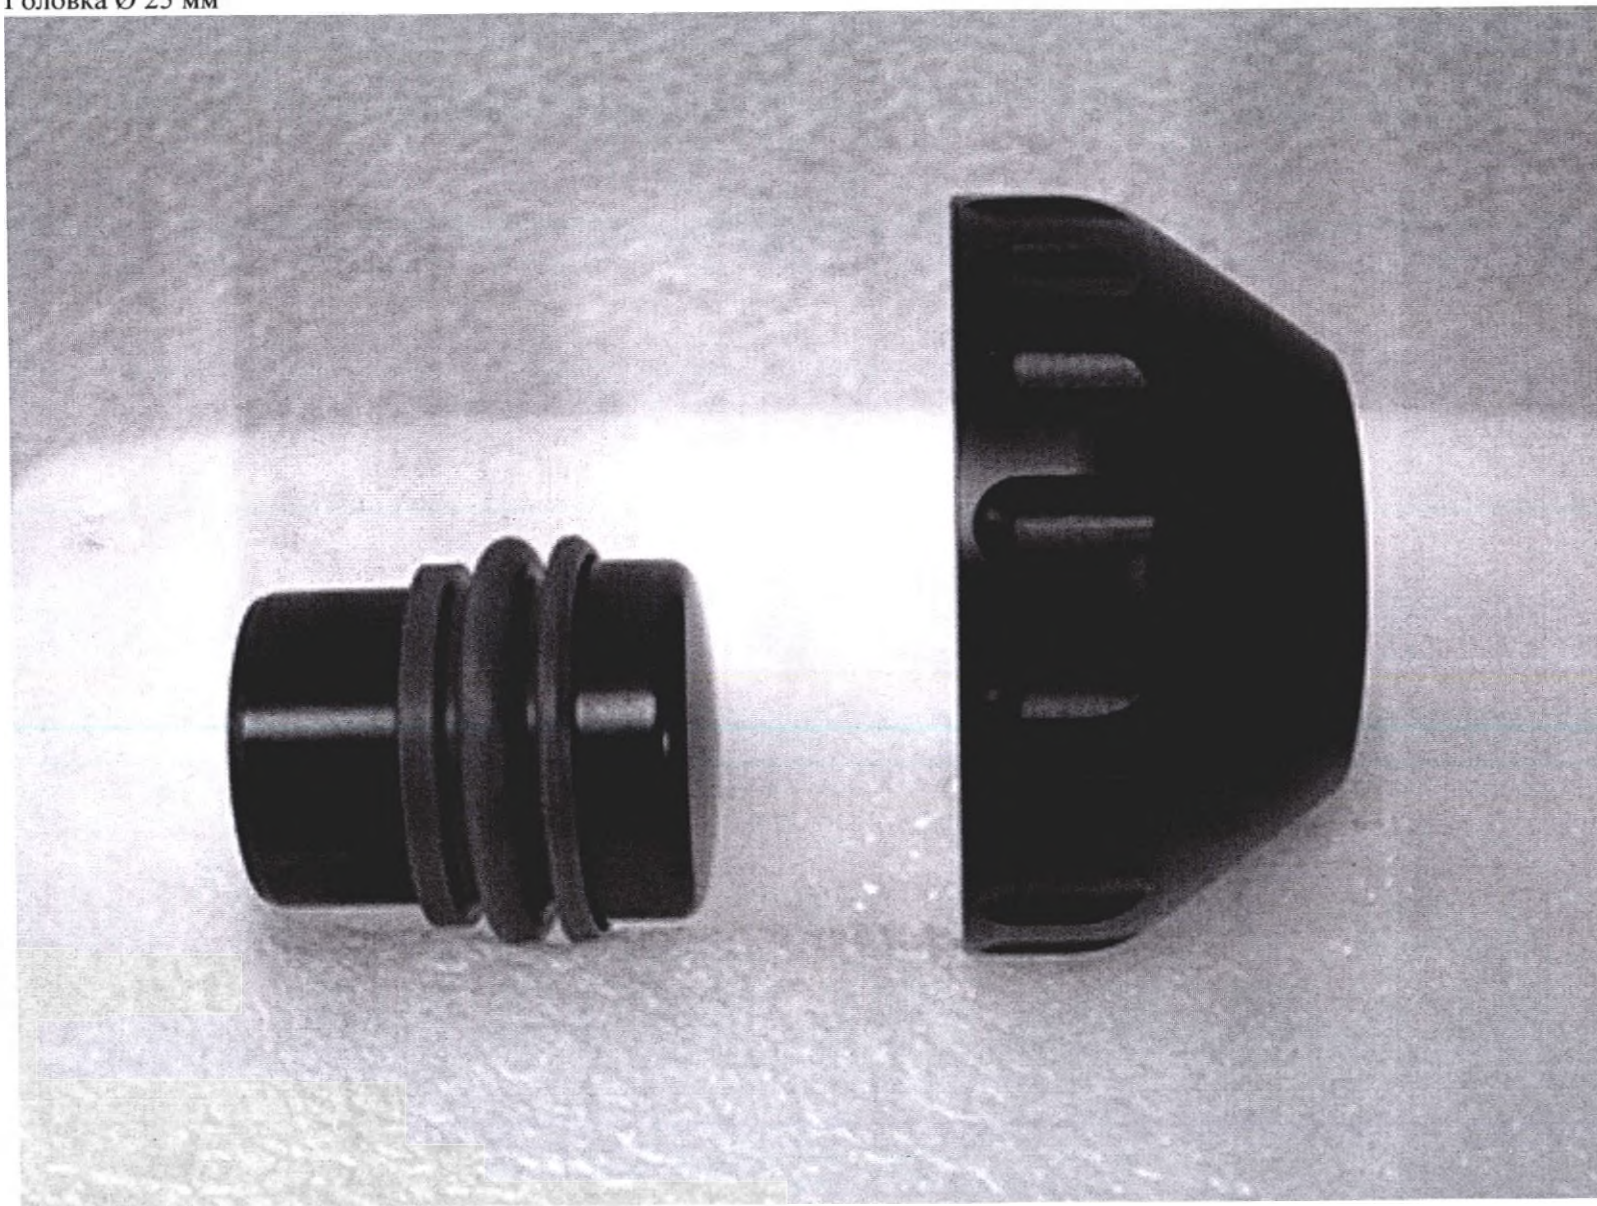


Головка Ø 40 мм

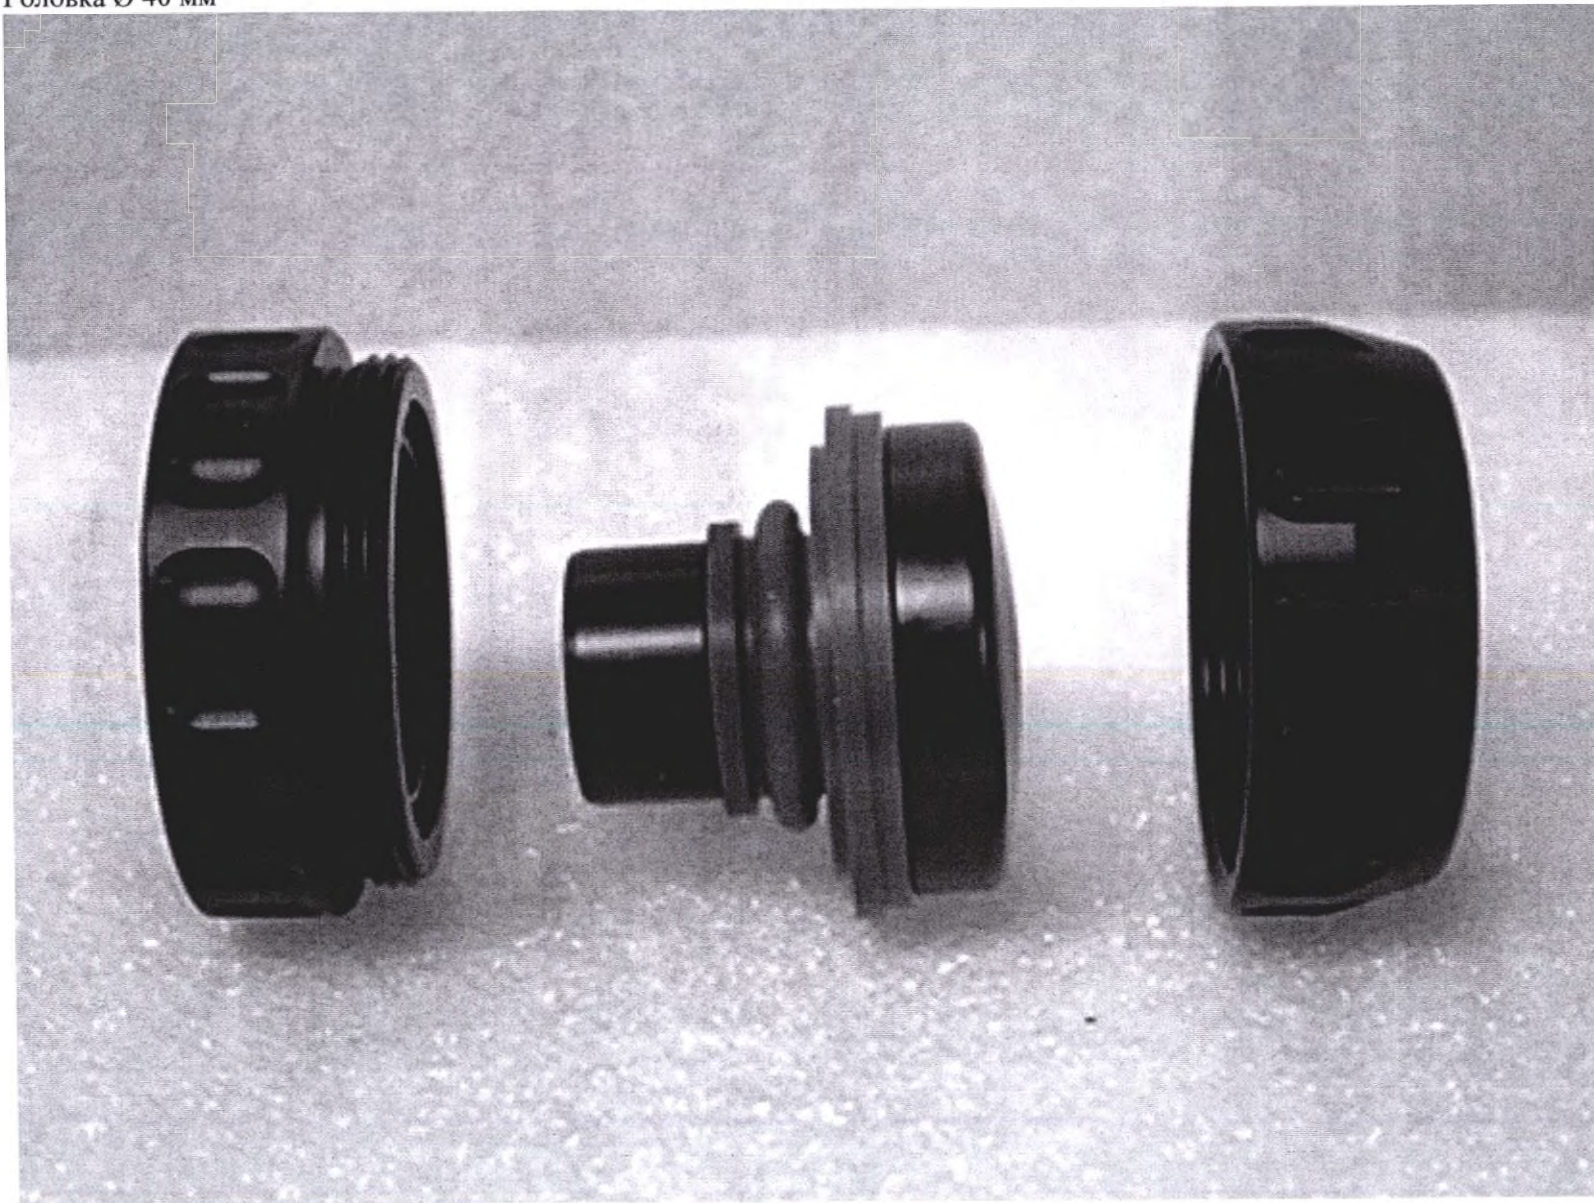


Начальный комплект VACU-ACTOR, в составе: - комплект банок различных размеров: XS, S, M, L; - полка для хранения банок; - держатель банки; - контейнер для транспортировки; - воздушный шланг с антибактериальным фильтром – не более 10 шт

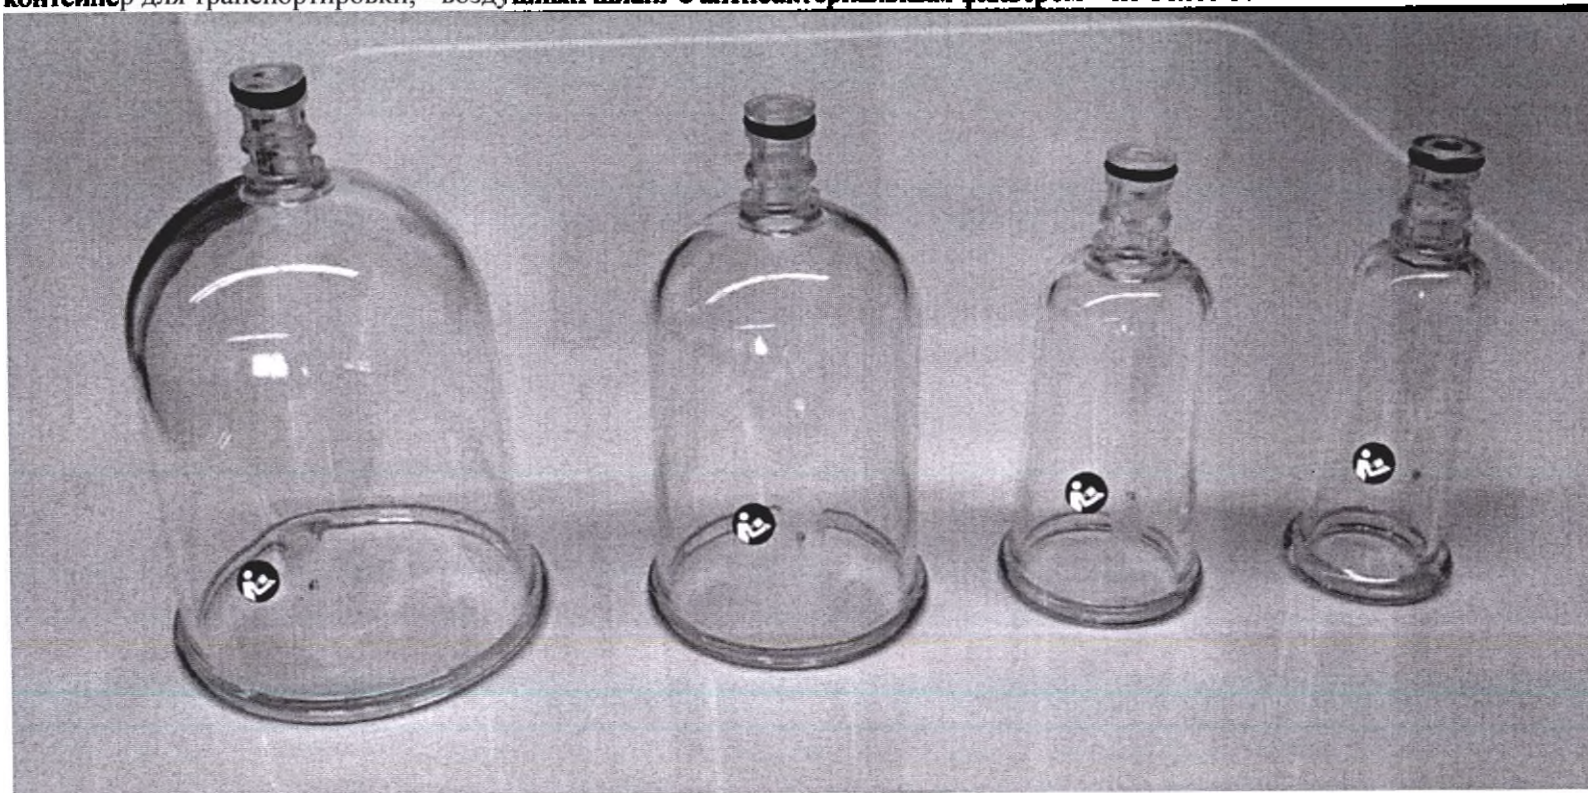




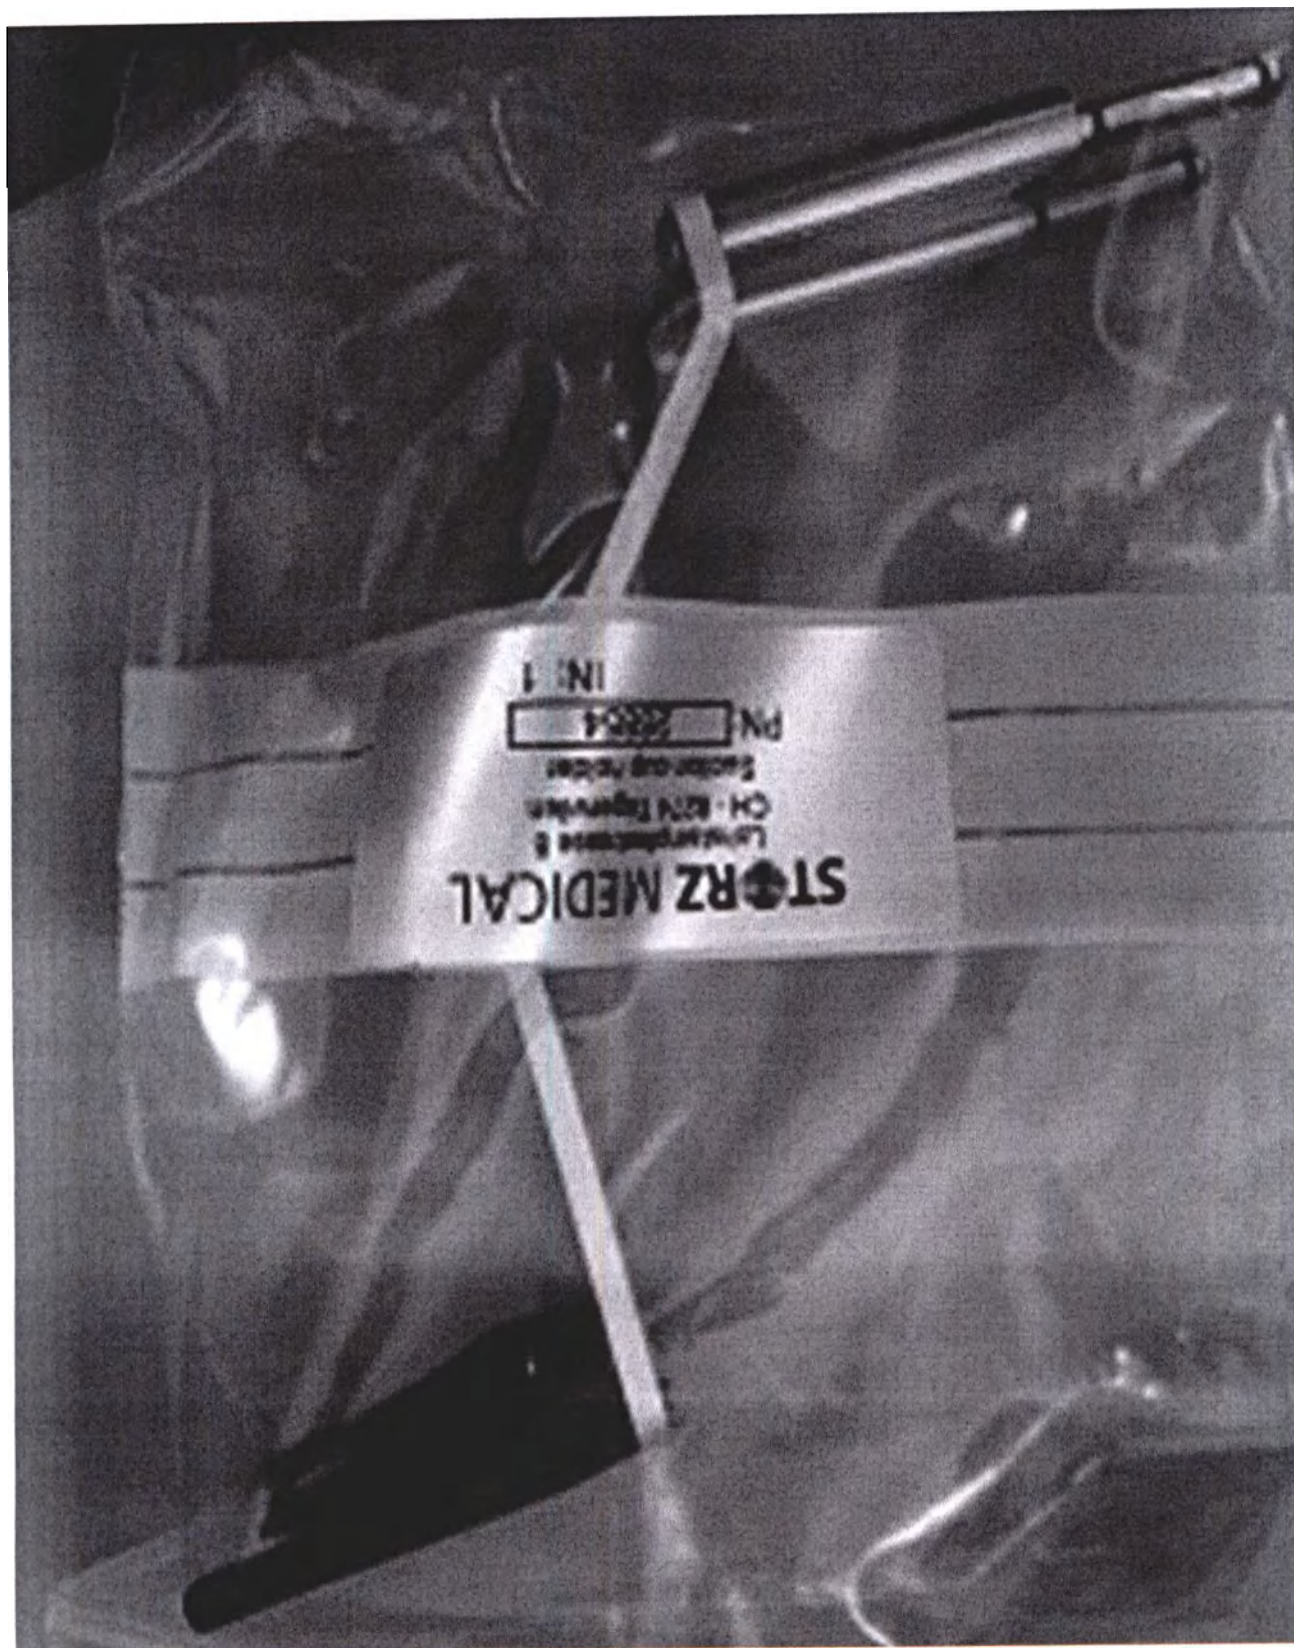


STORZ MEDICAL

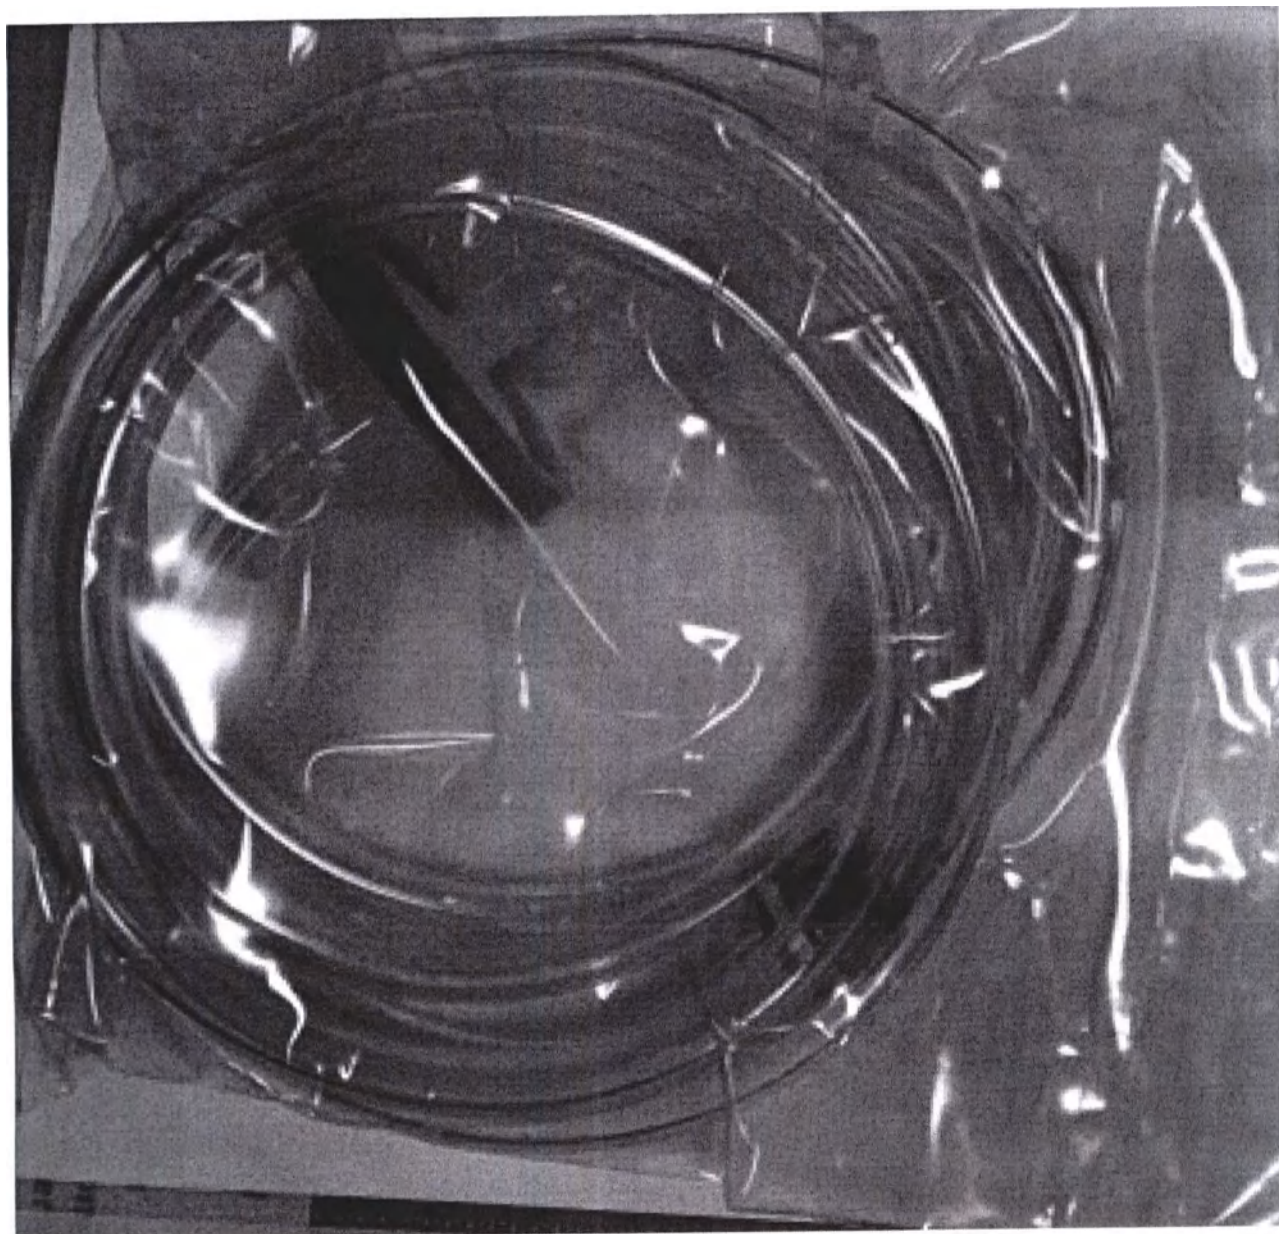


Головка Ø 15 мм

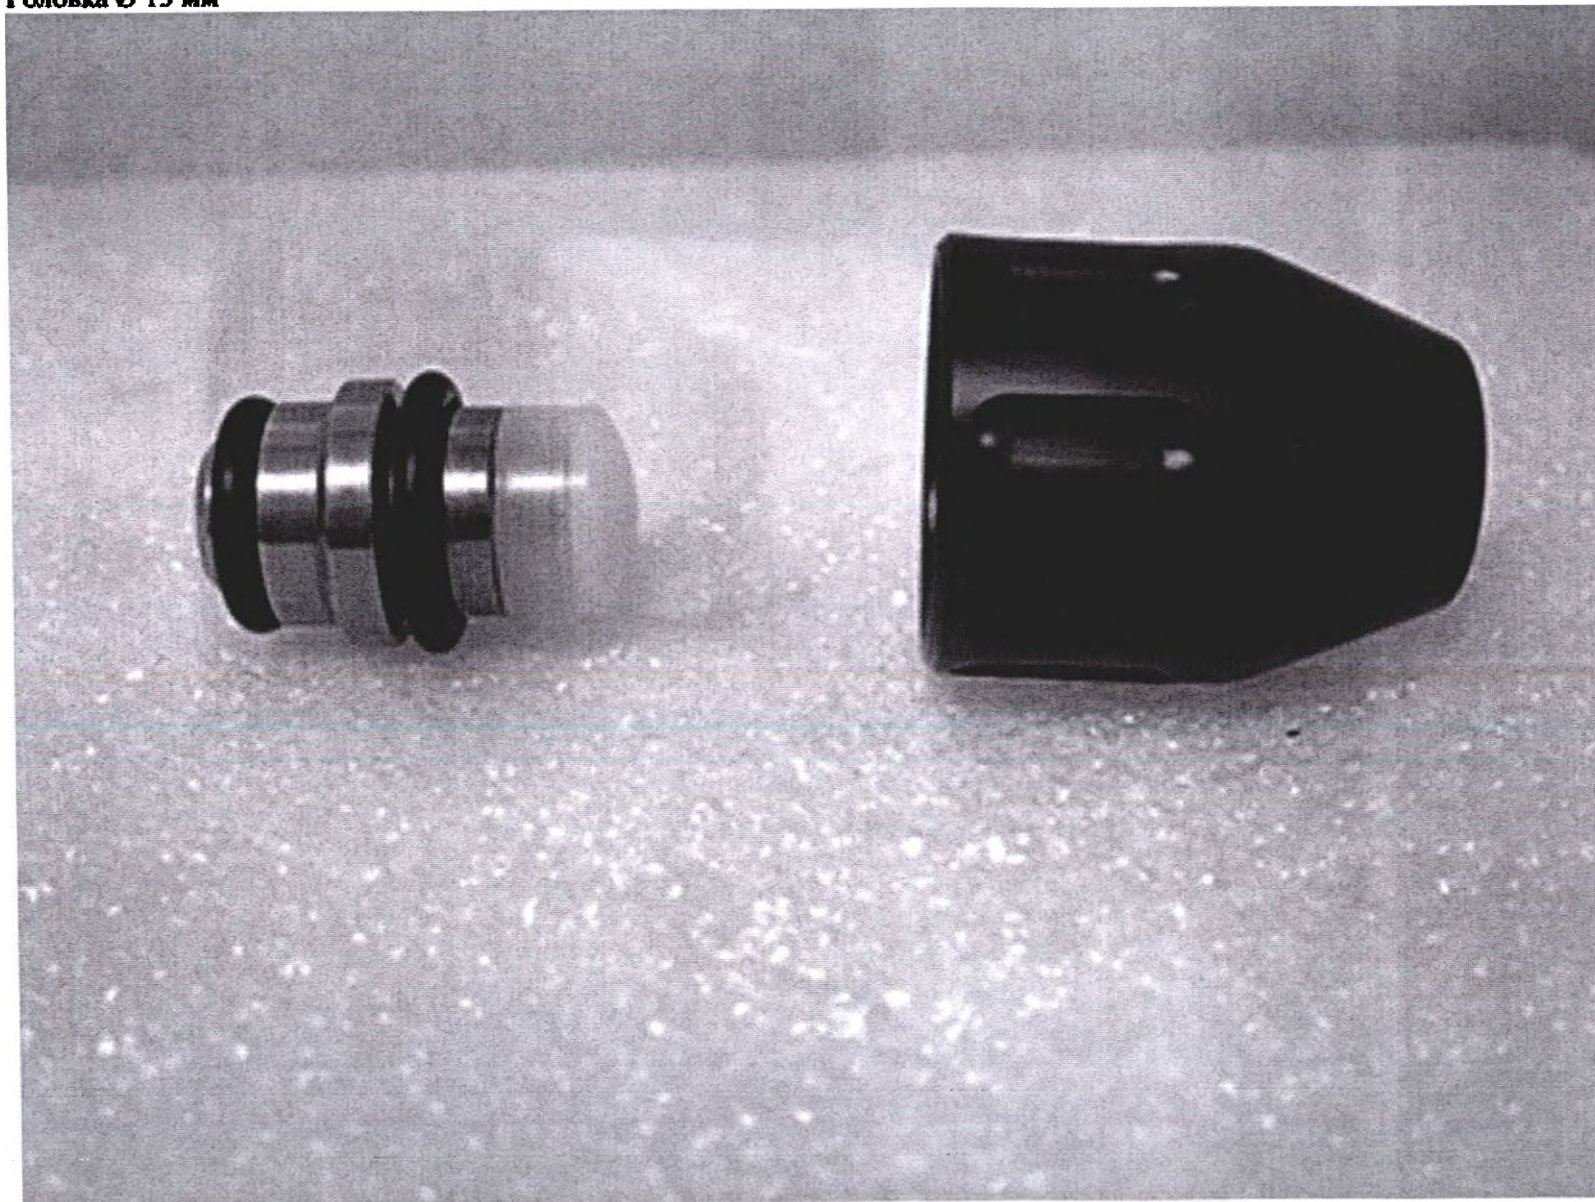


Головка Ø 15 мм усиленная

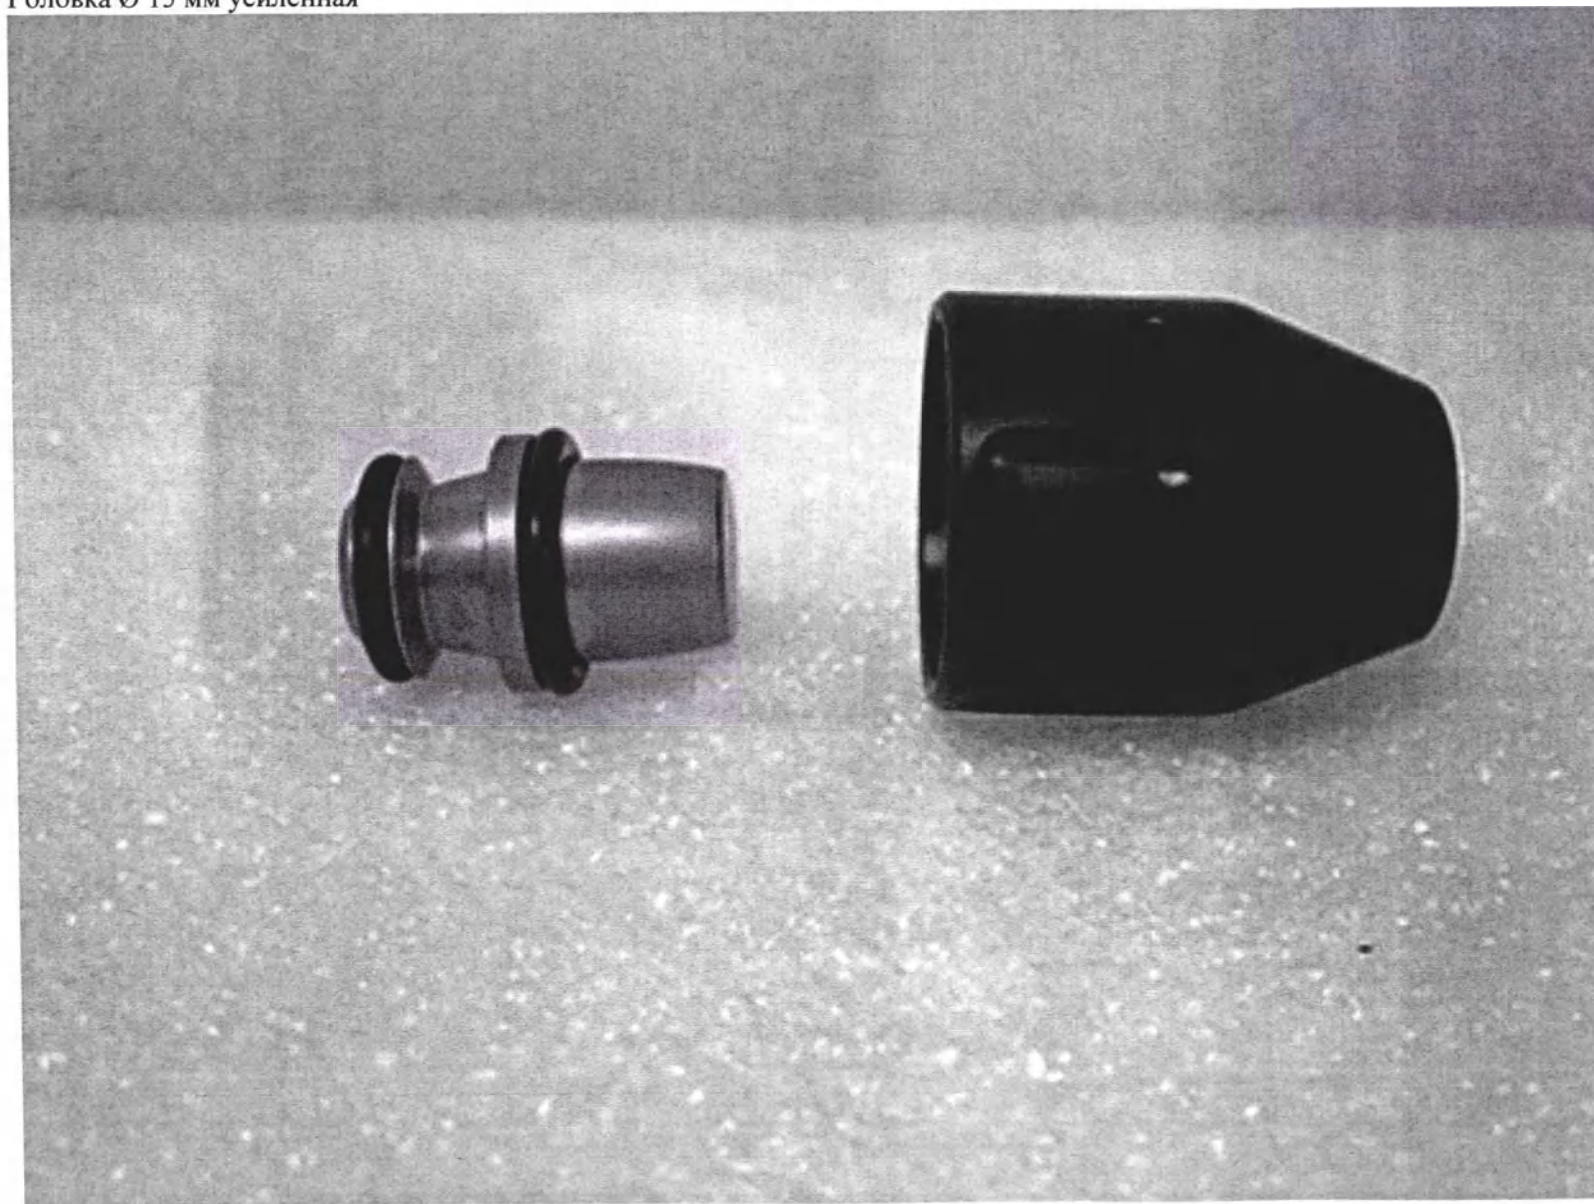


Головка Ø 20 мм

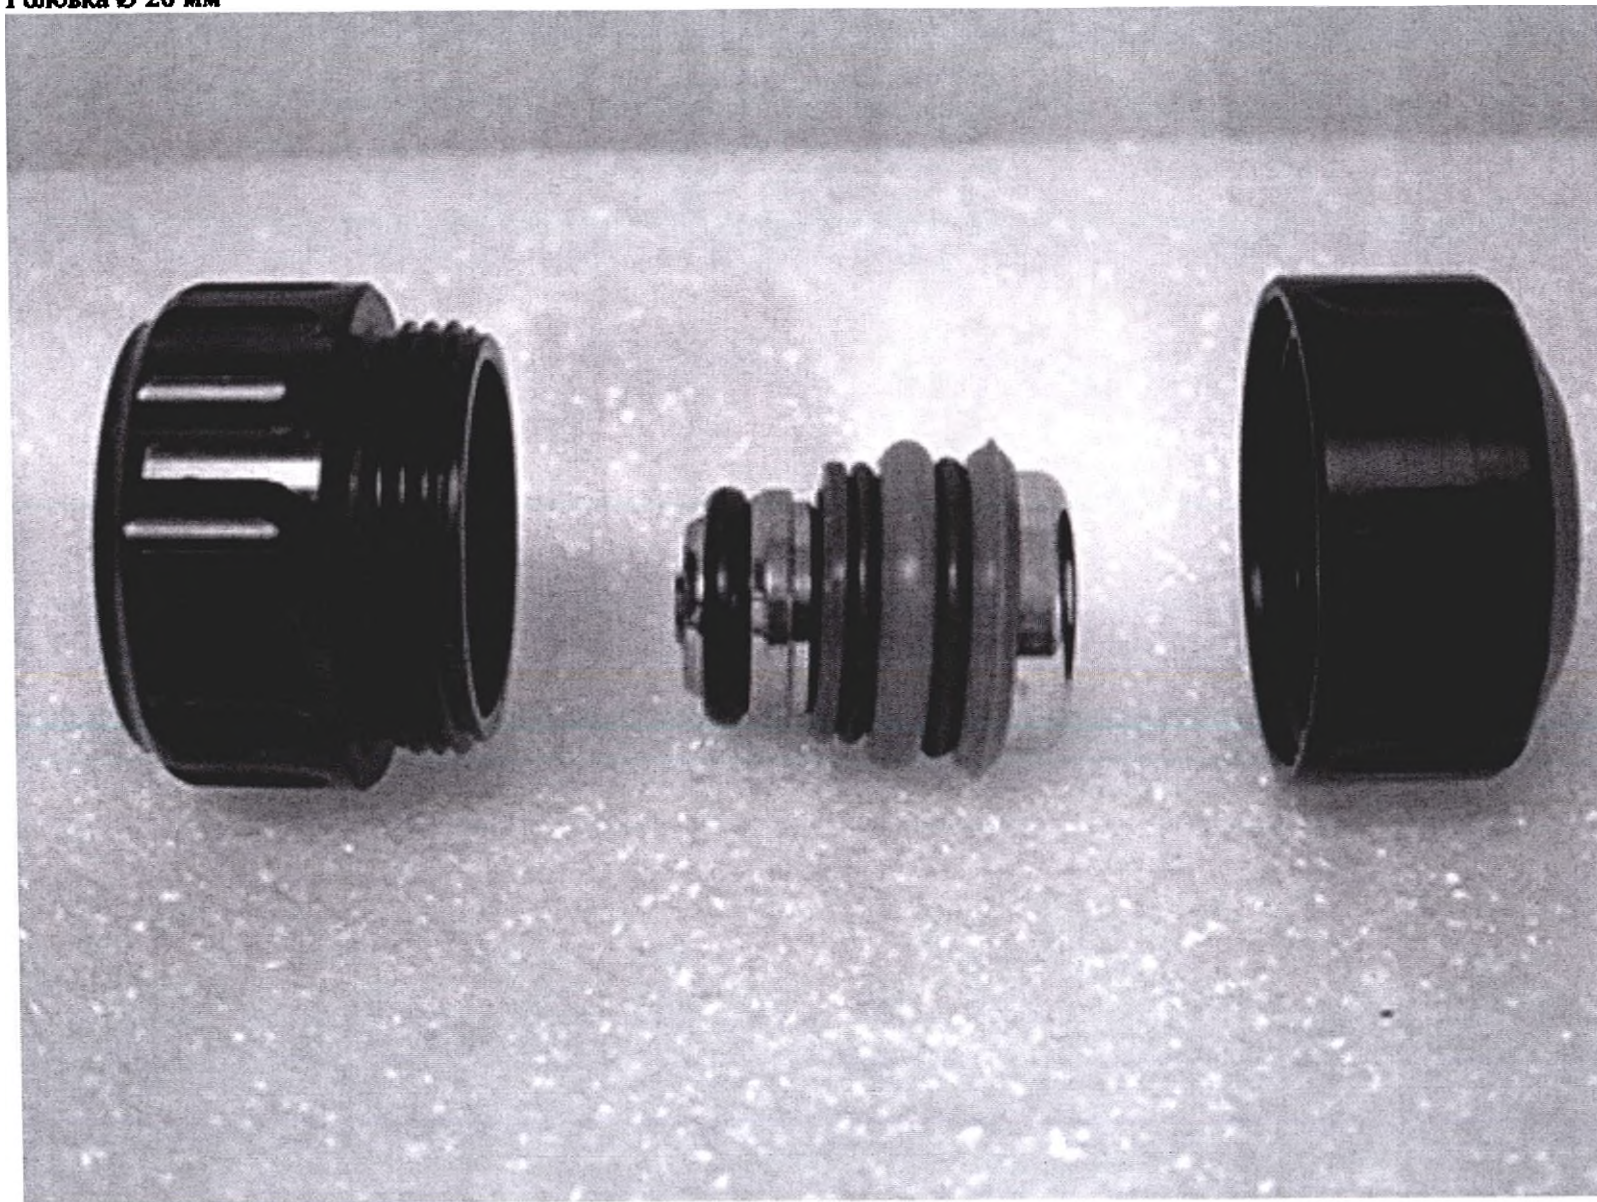


Головка Ø 20 мм усиленная

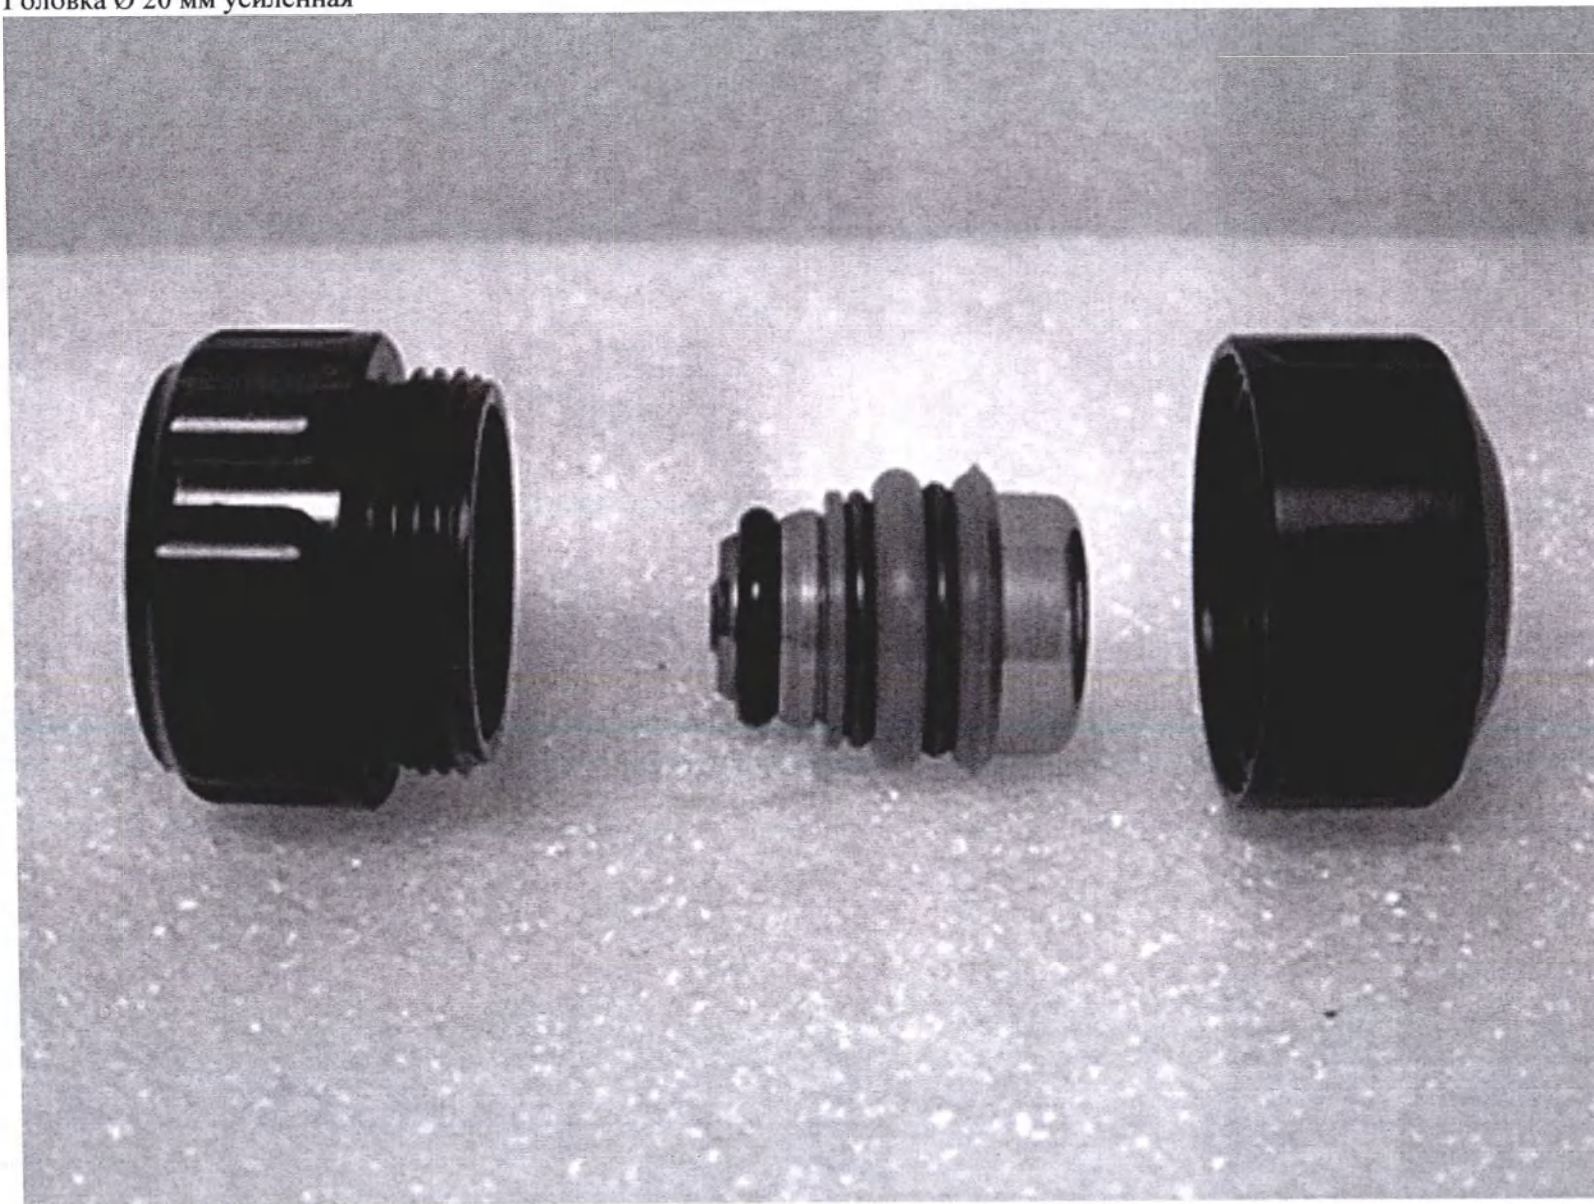


Головка Ø 35 мм

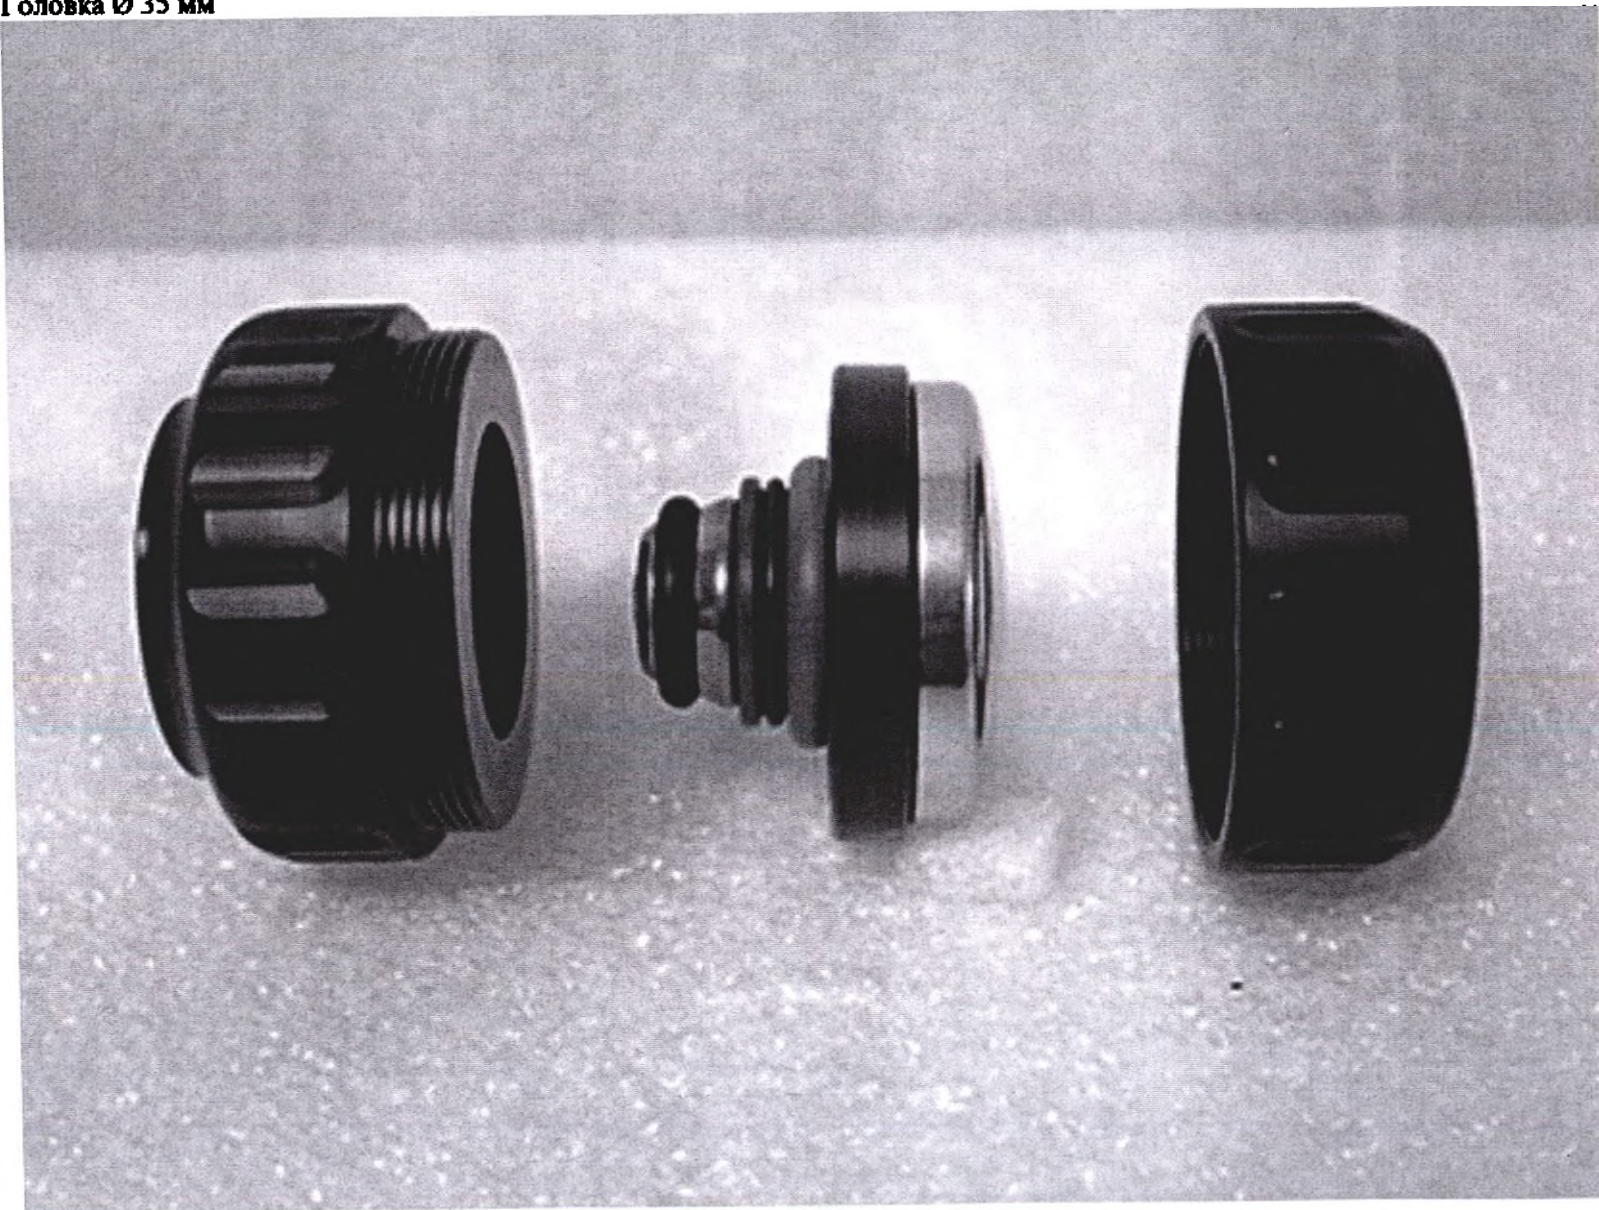


Банка XS

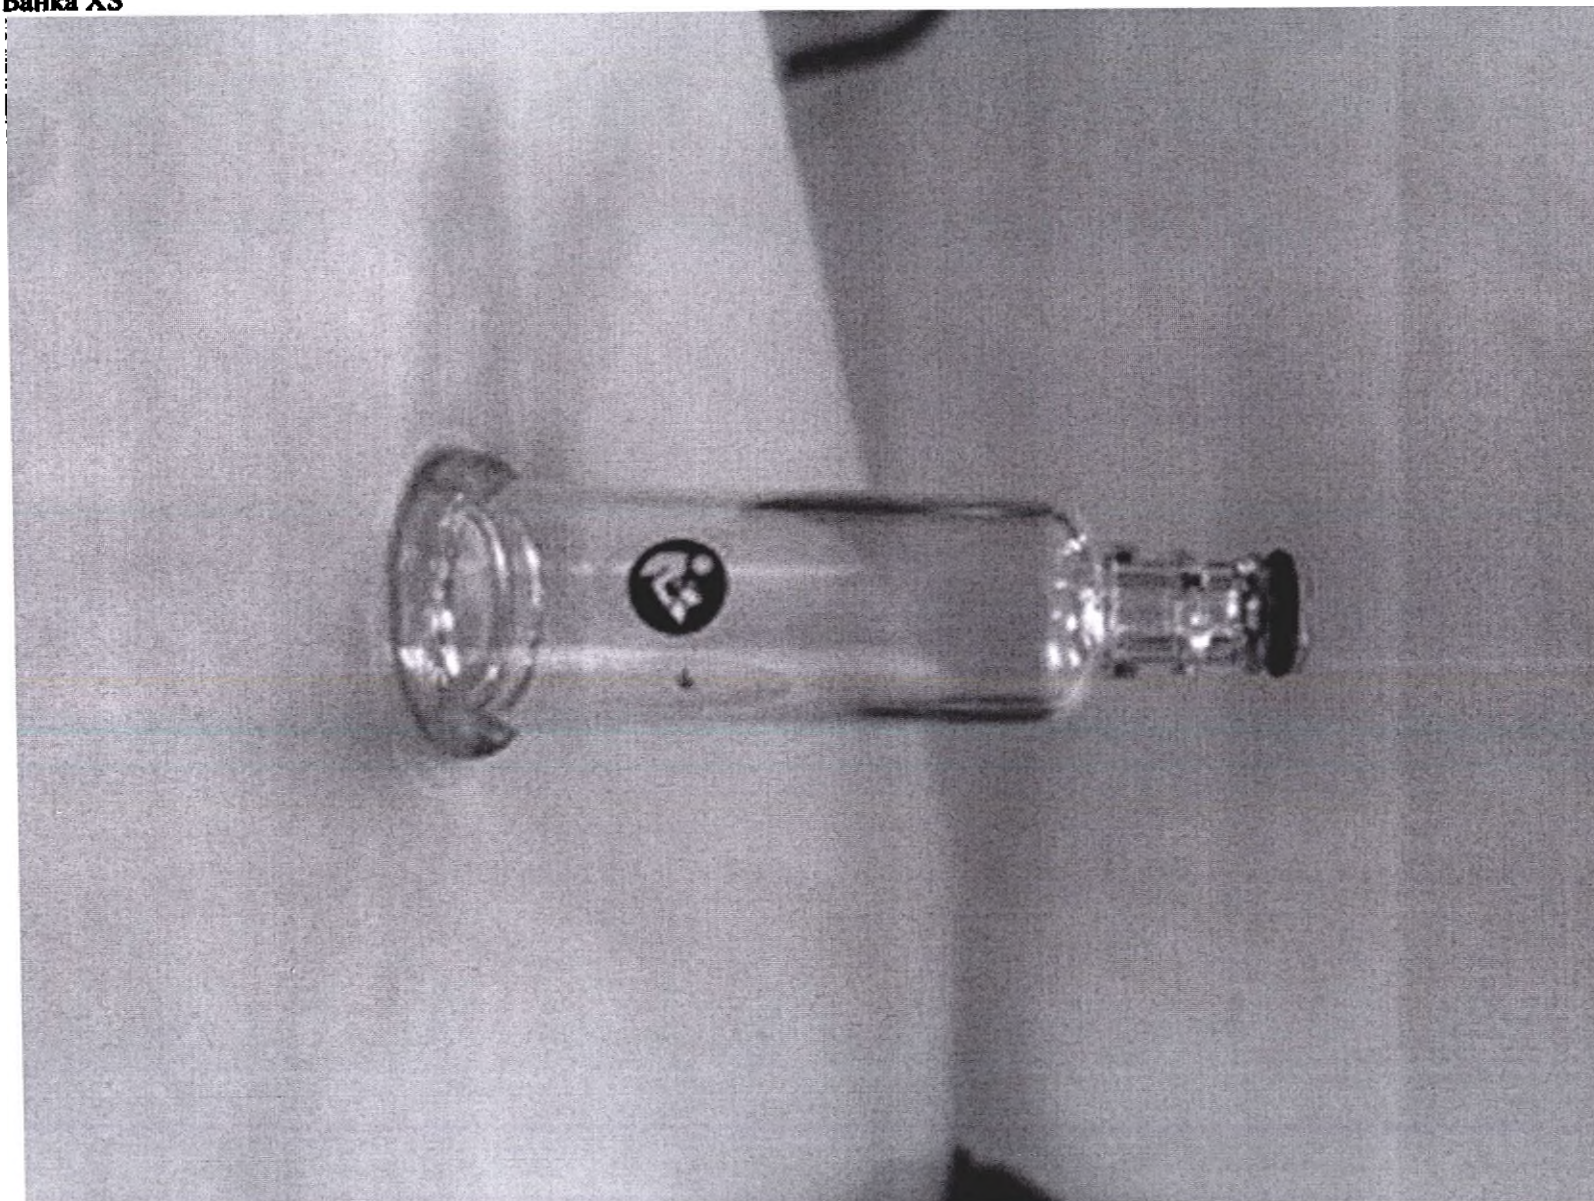


Банка S

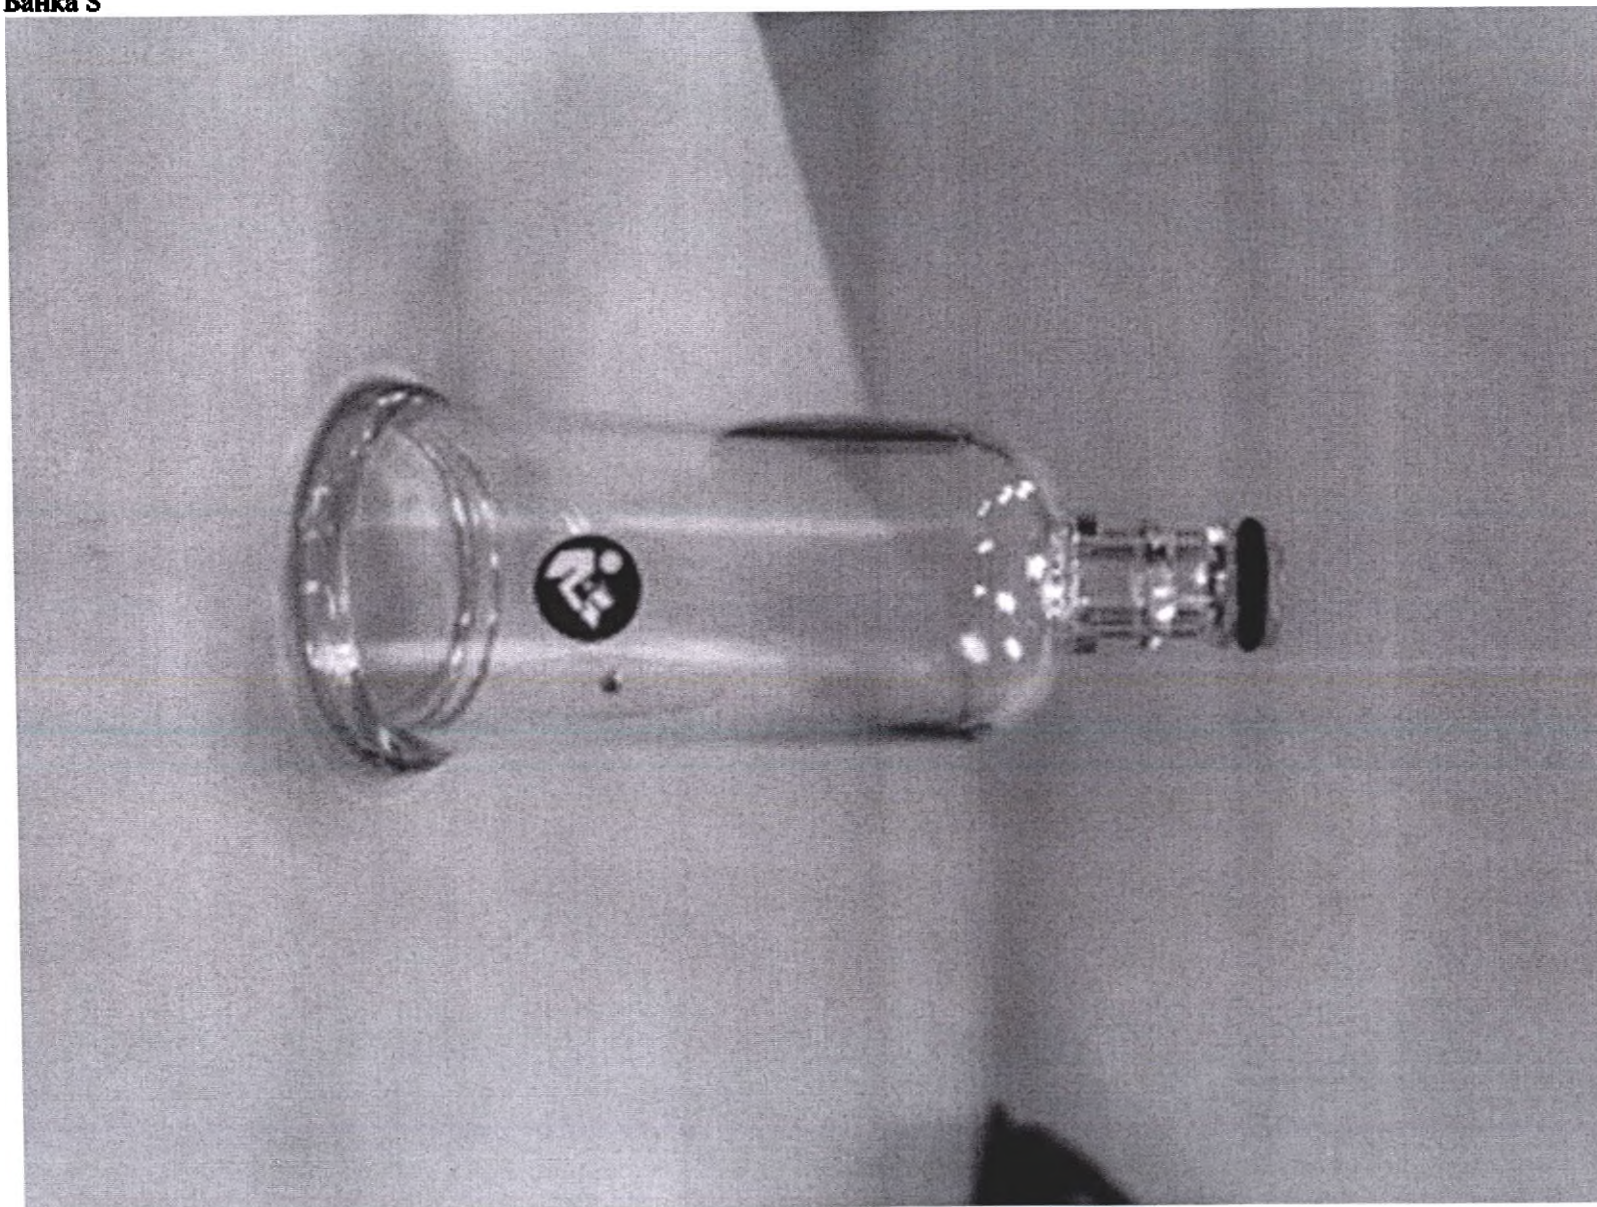


Банка М

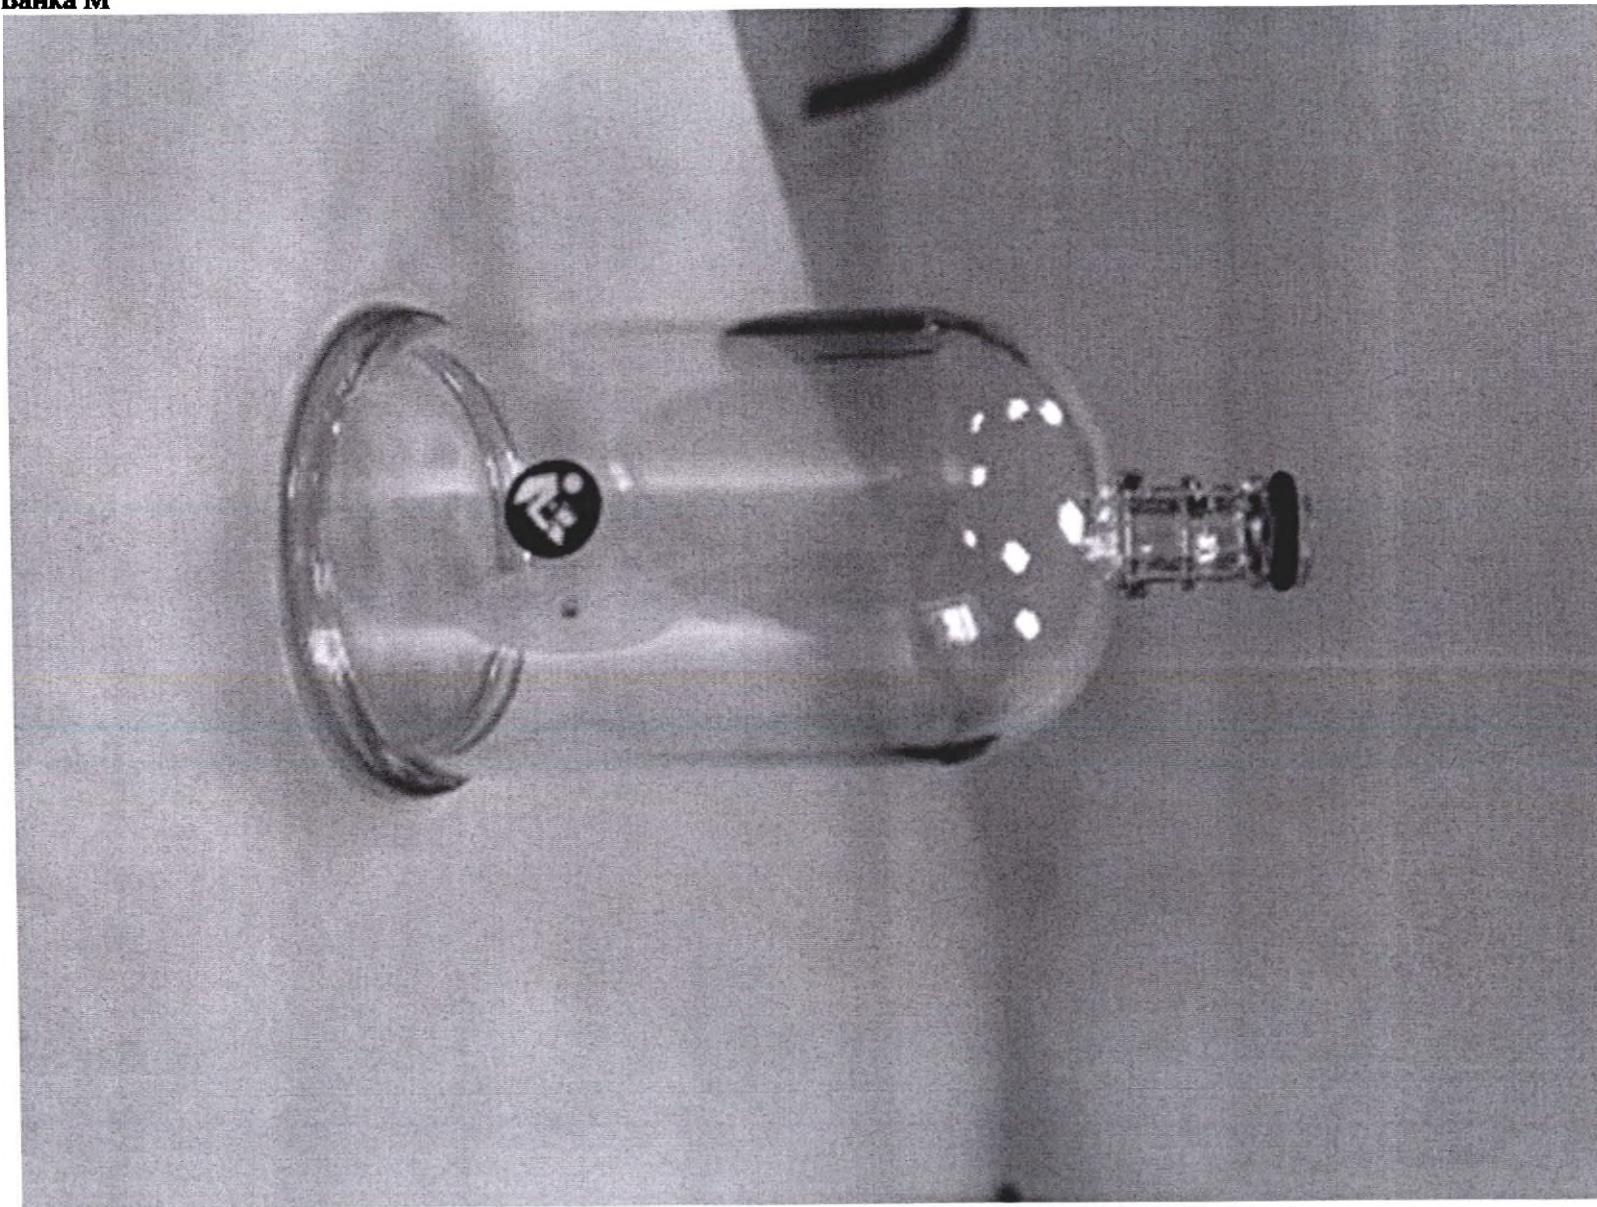


Банка L

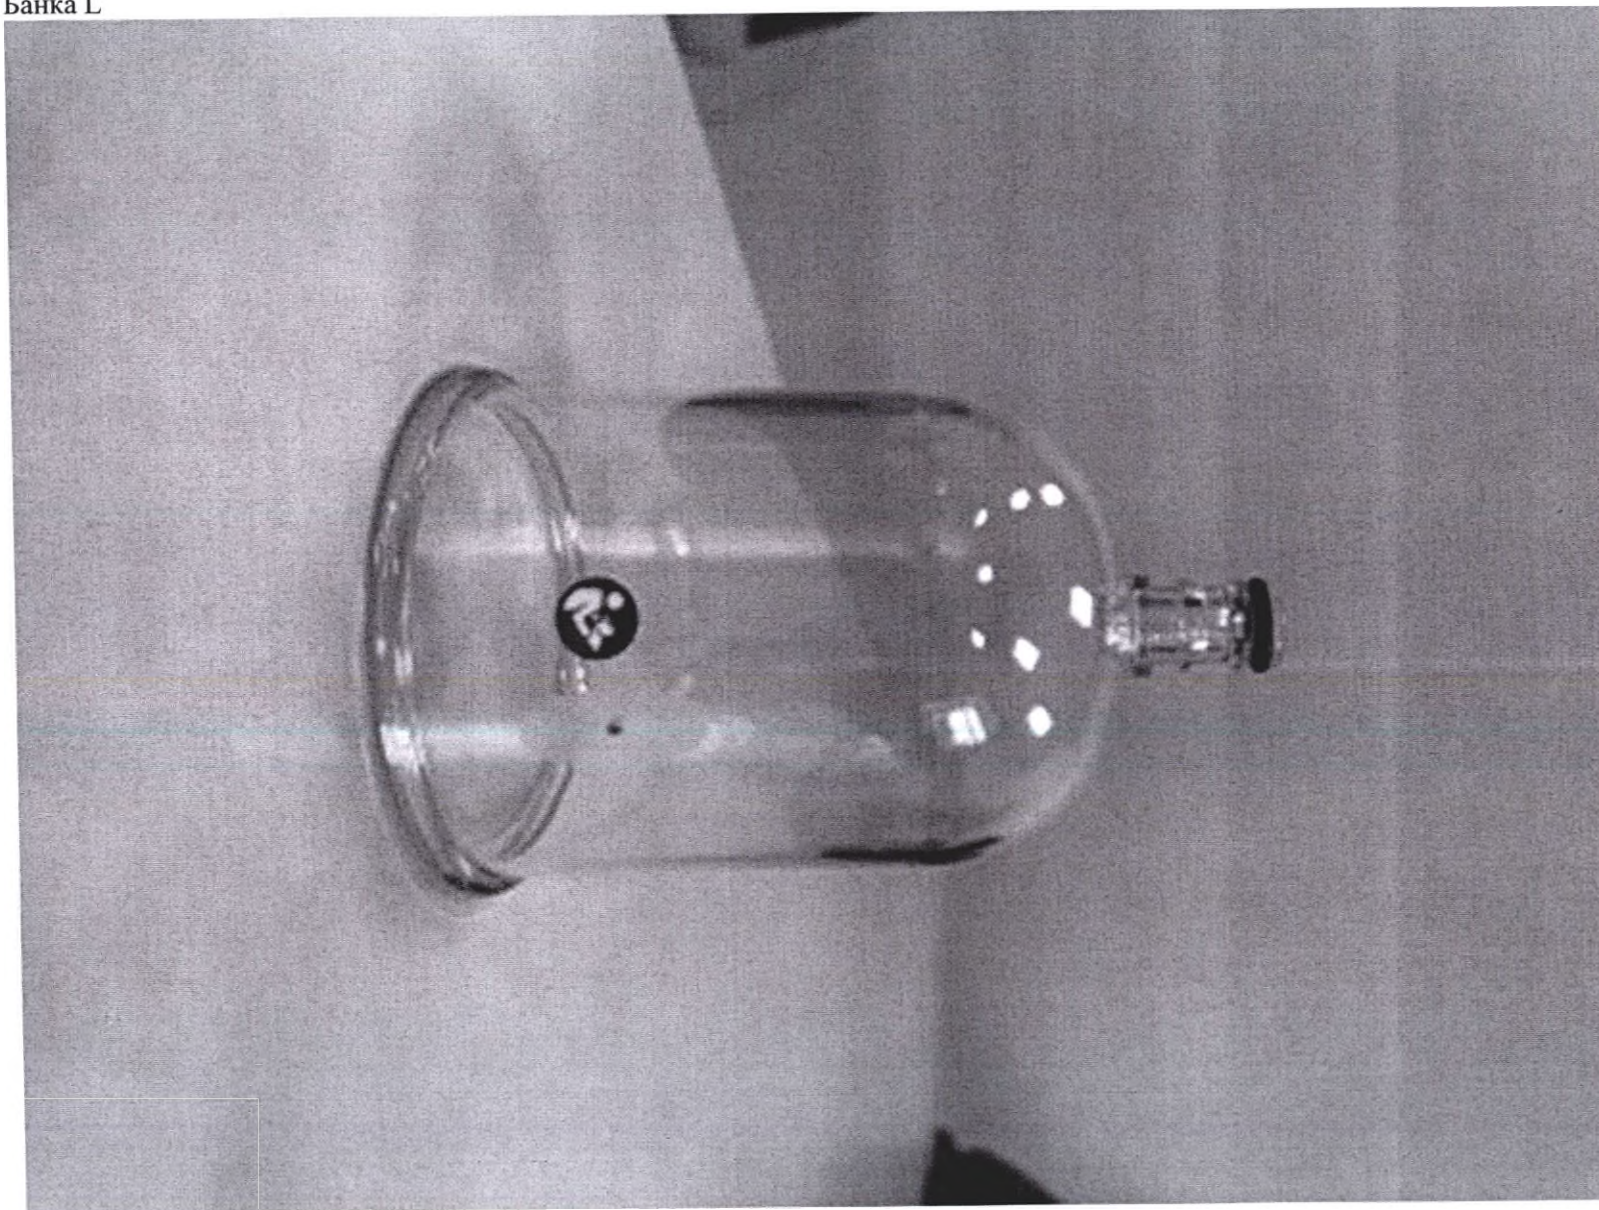


Силиконовый колпачок

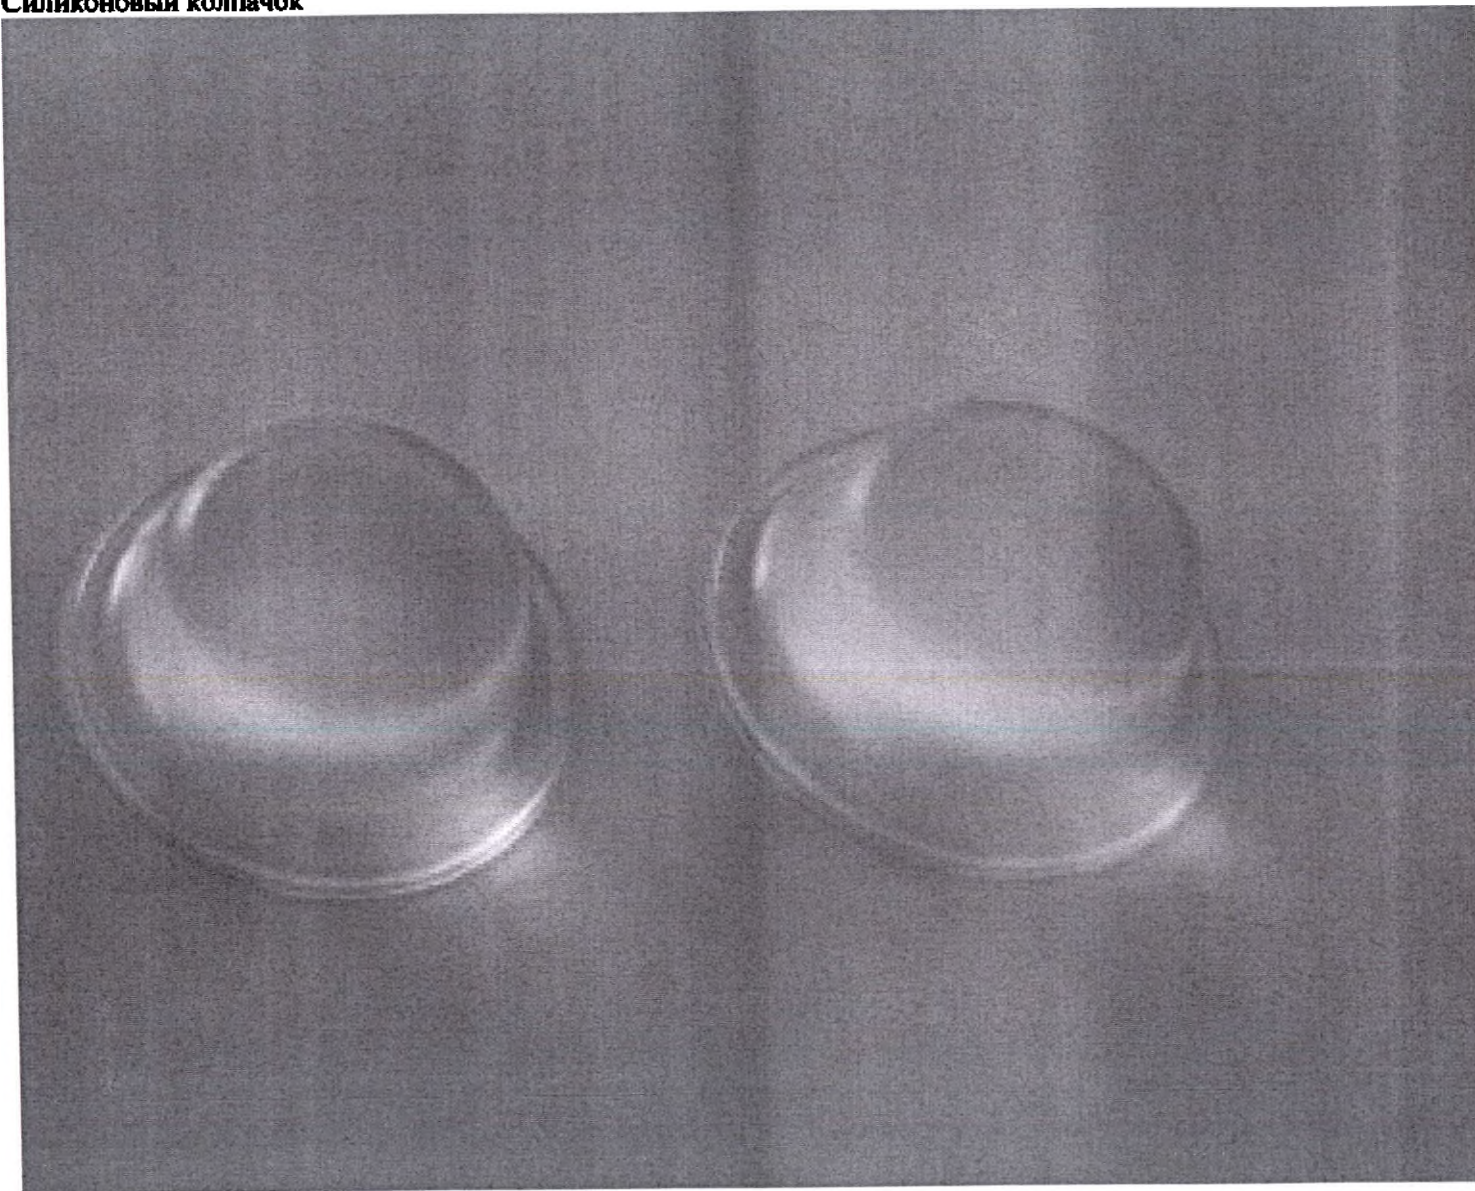


Воздушный шланг с антибактериальным фильтром

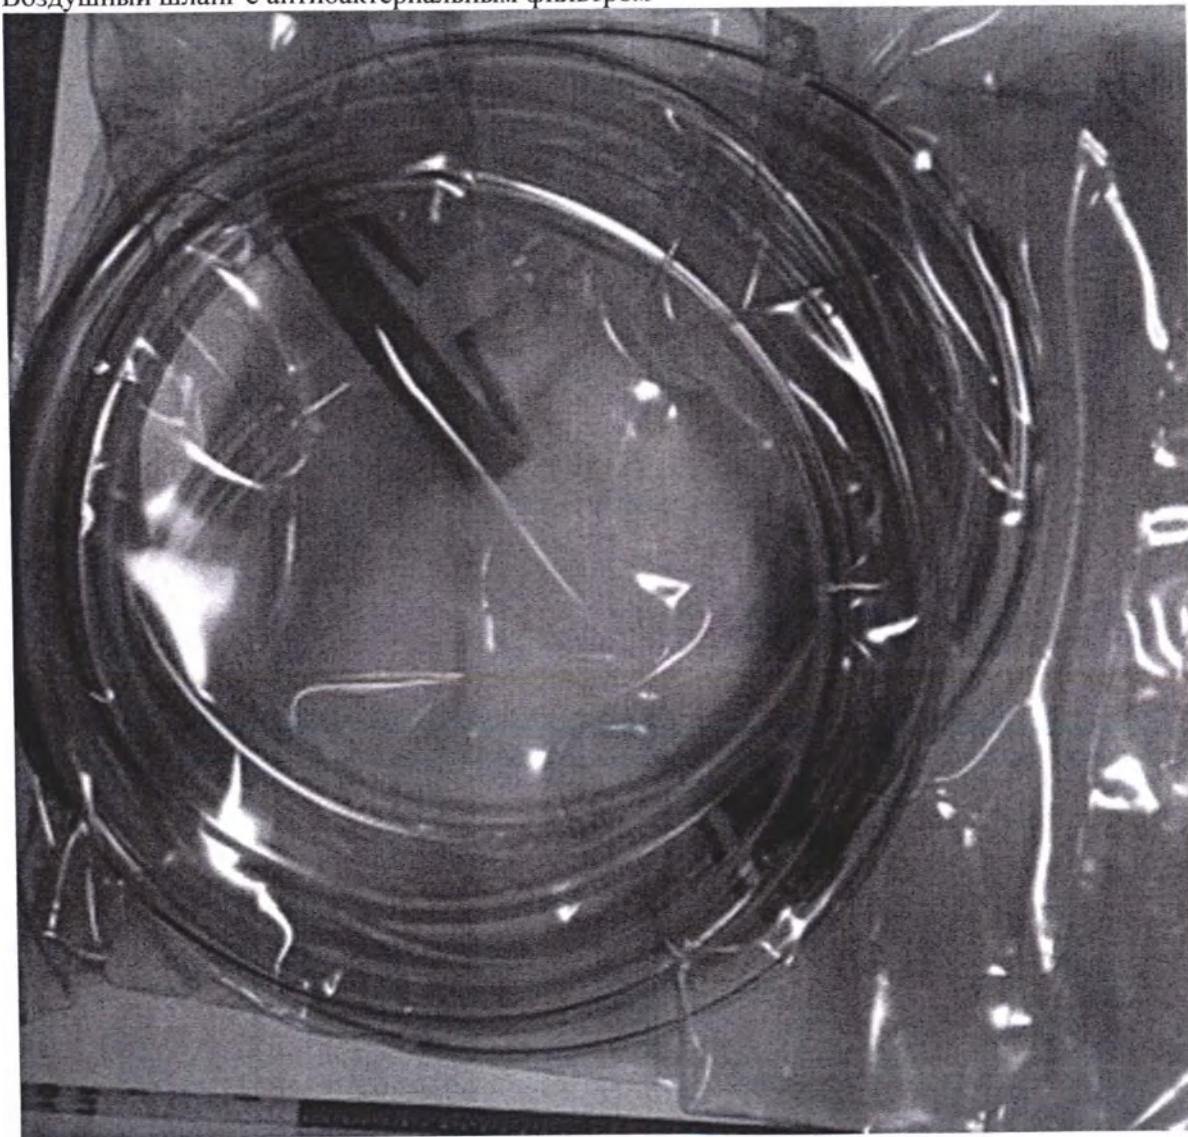


Ади́пометр

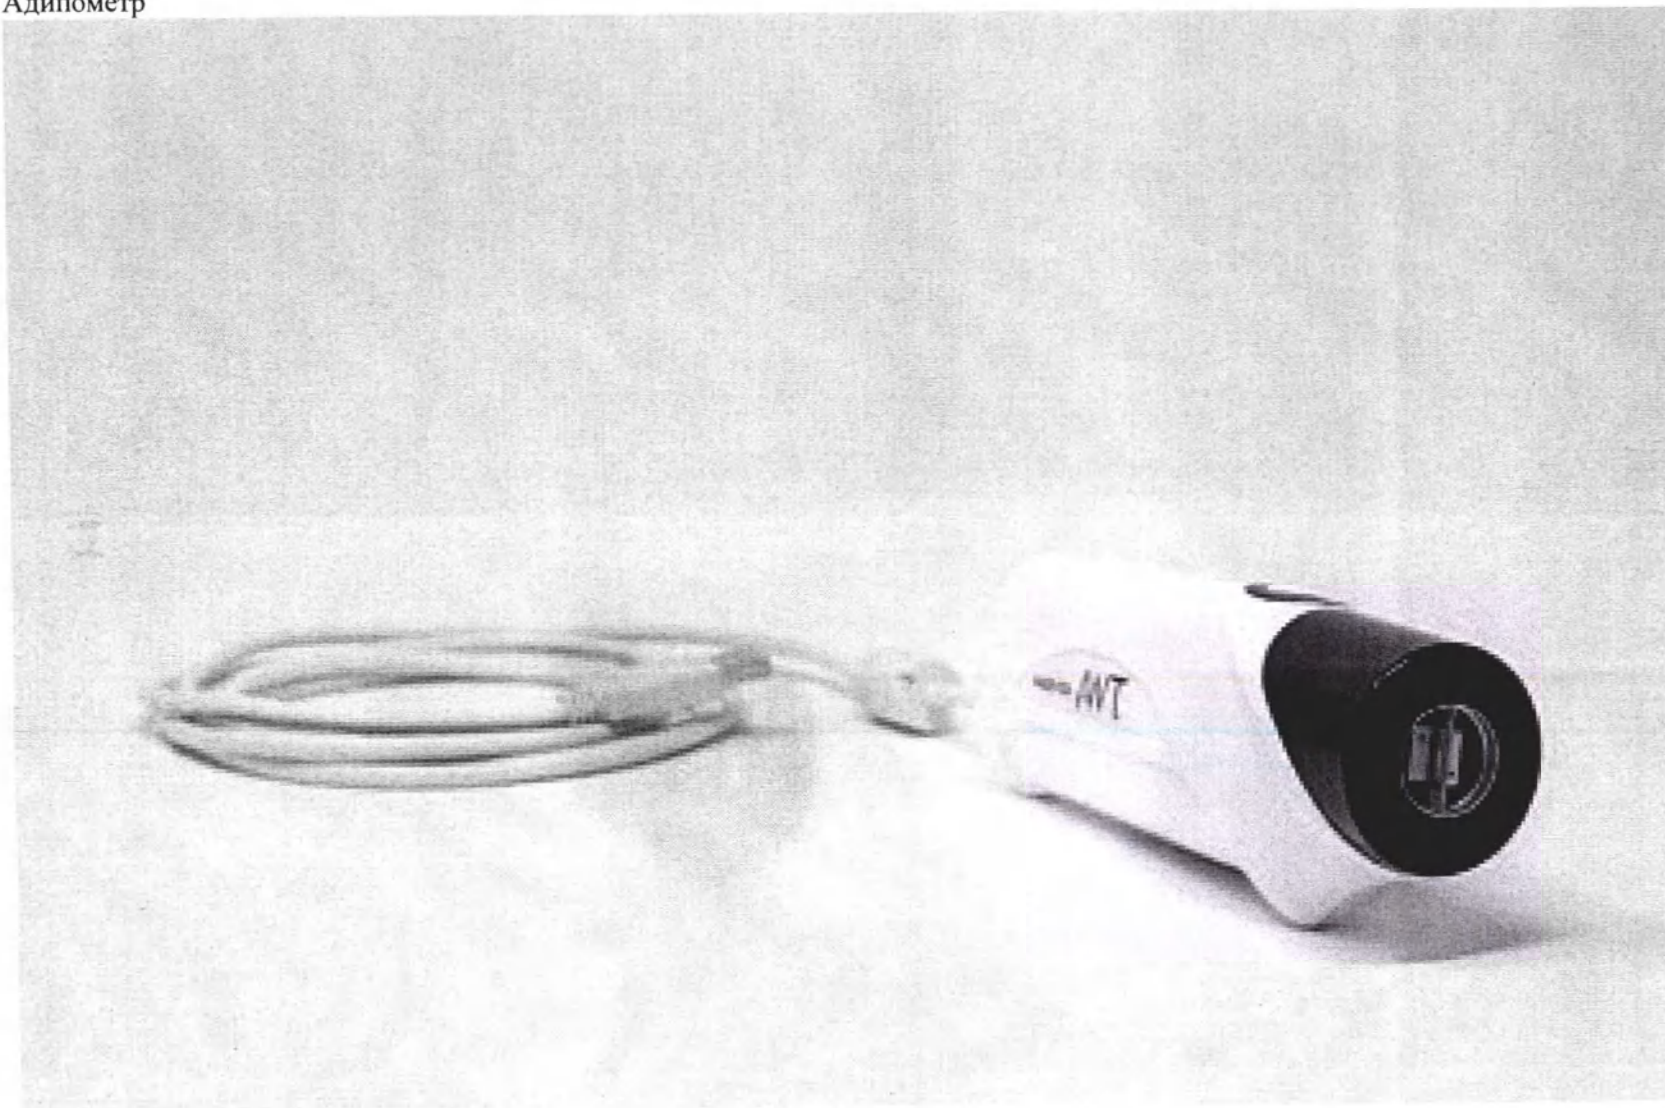


Фиксатор головок сменный

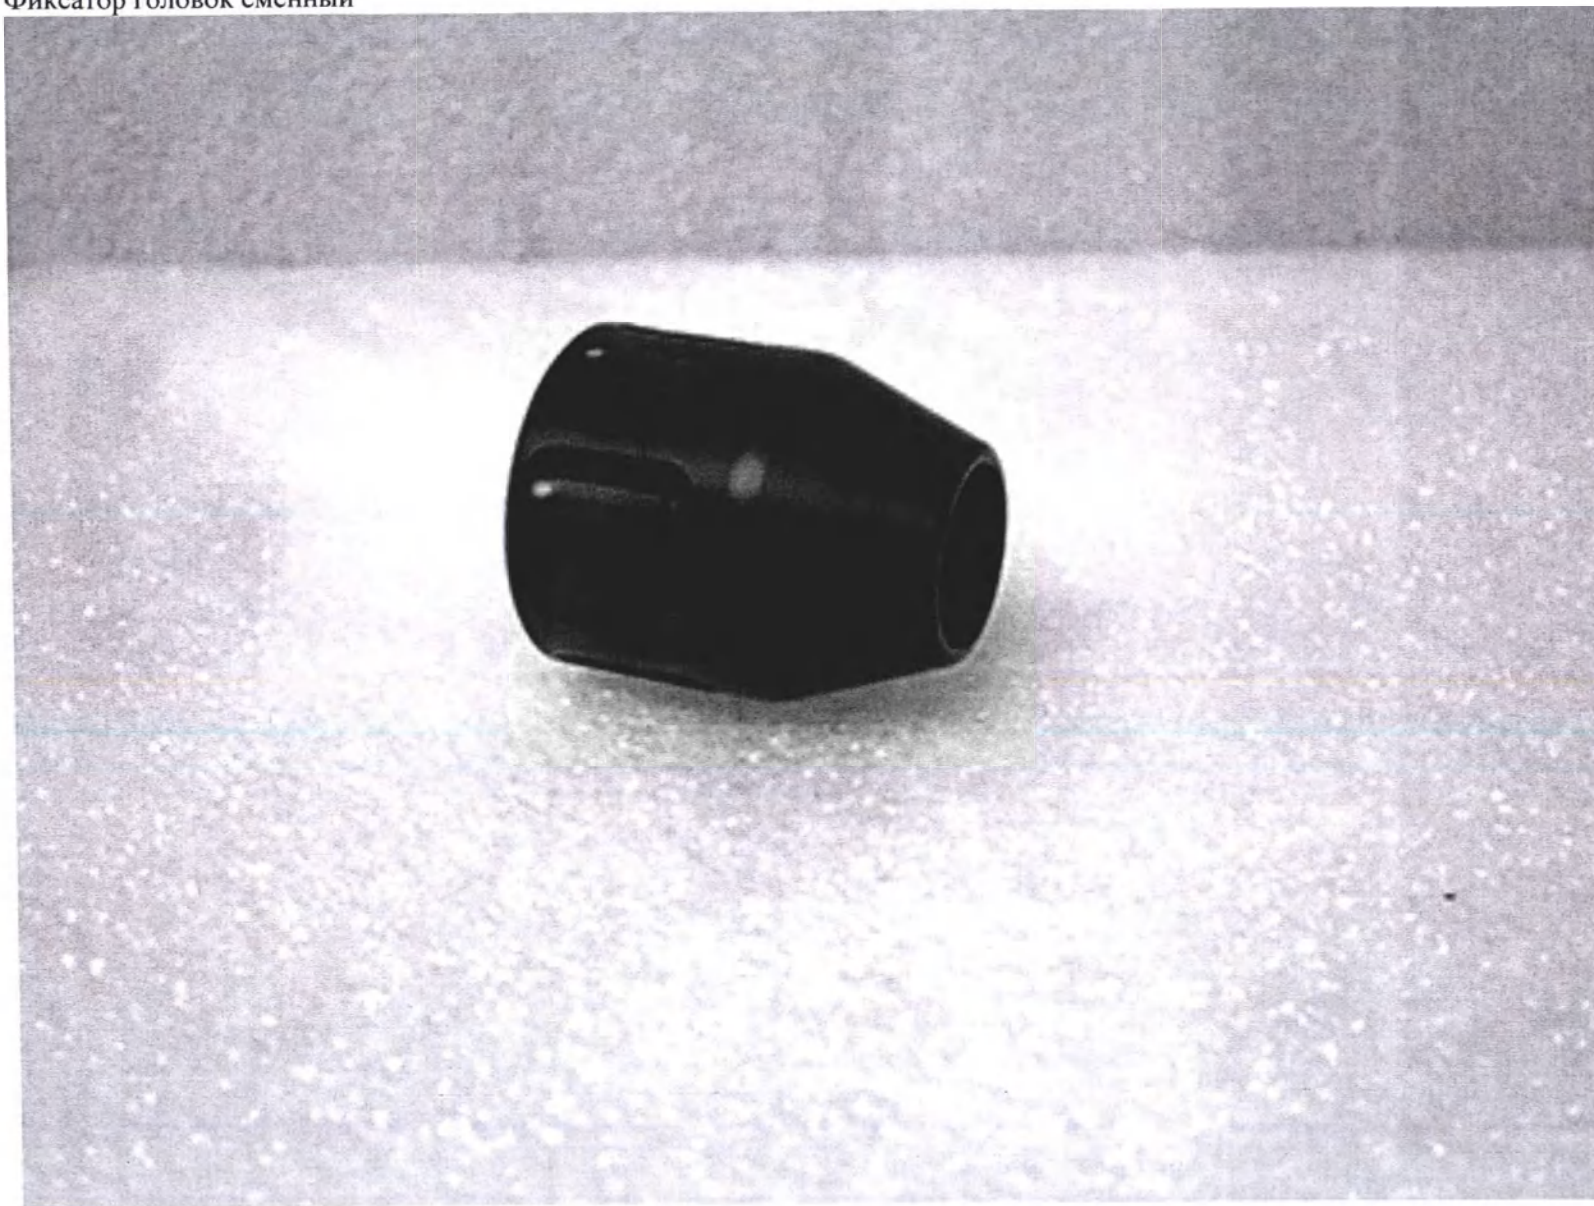


Фиксатор головок большой сменный

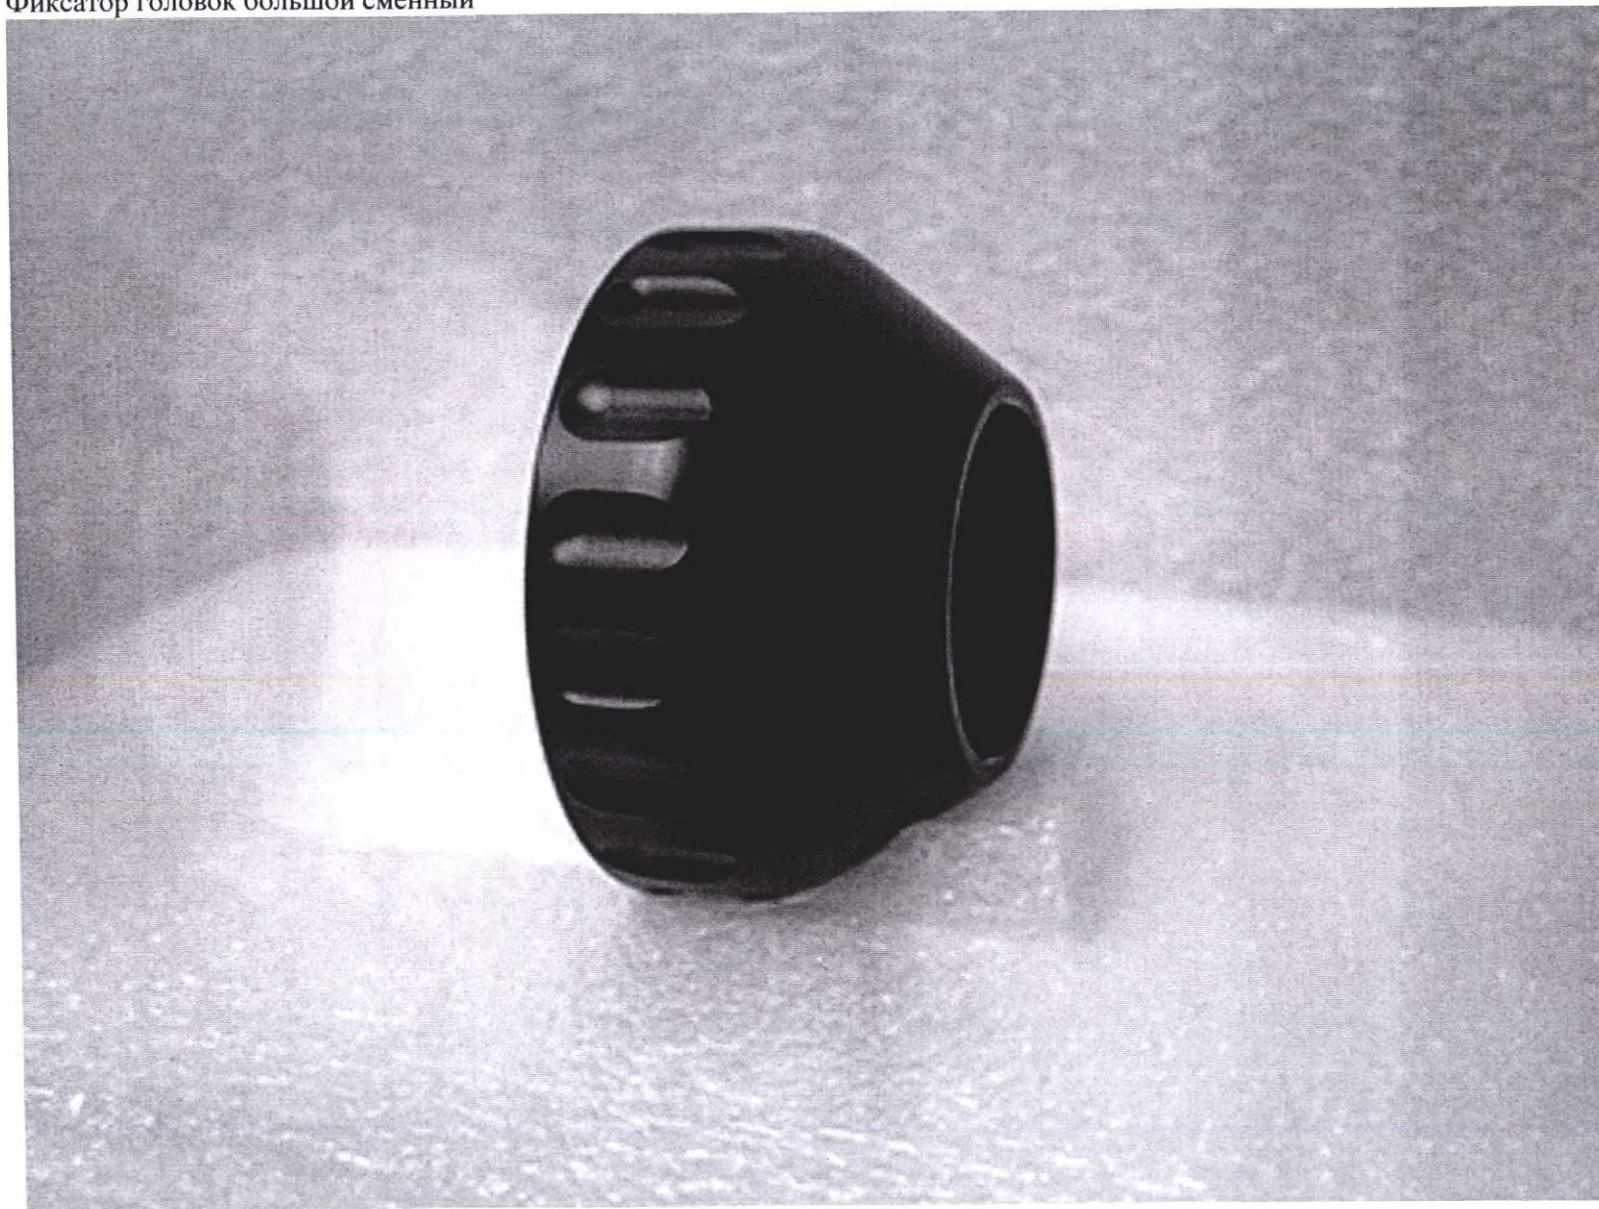


Фиксатор головок двойной малый сменный

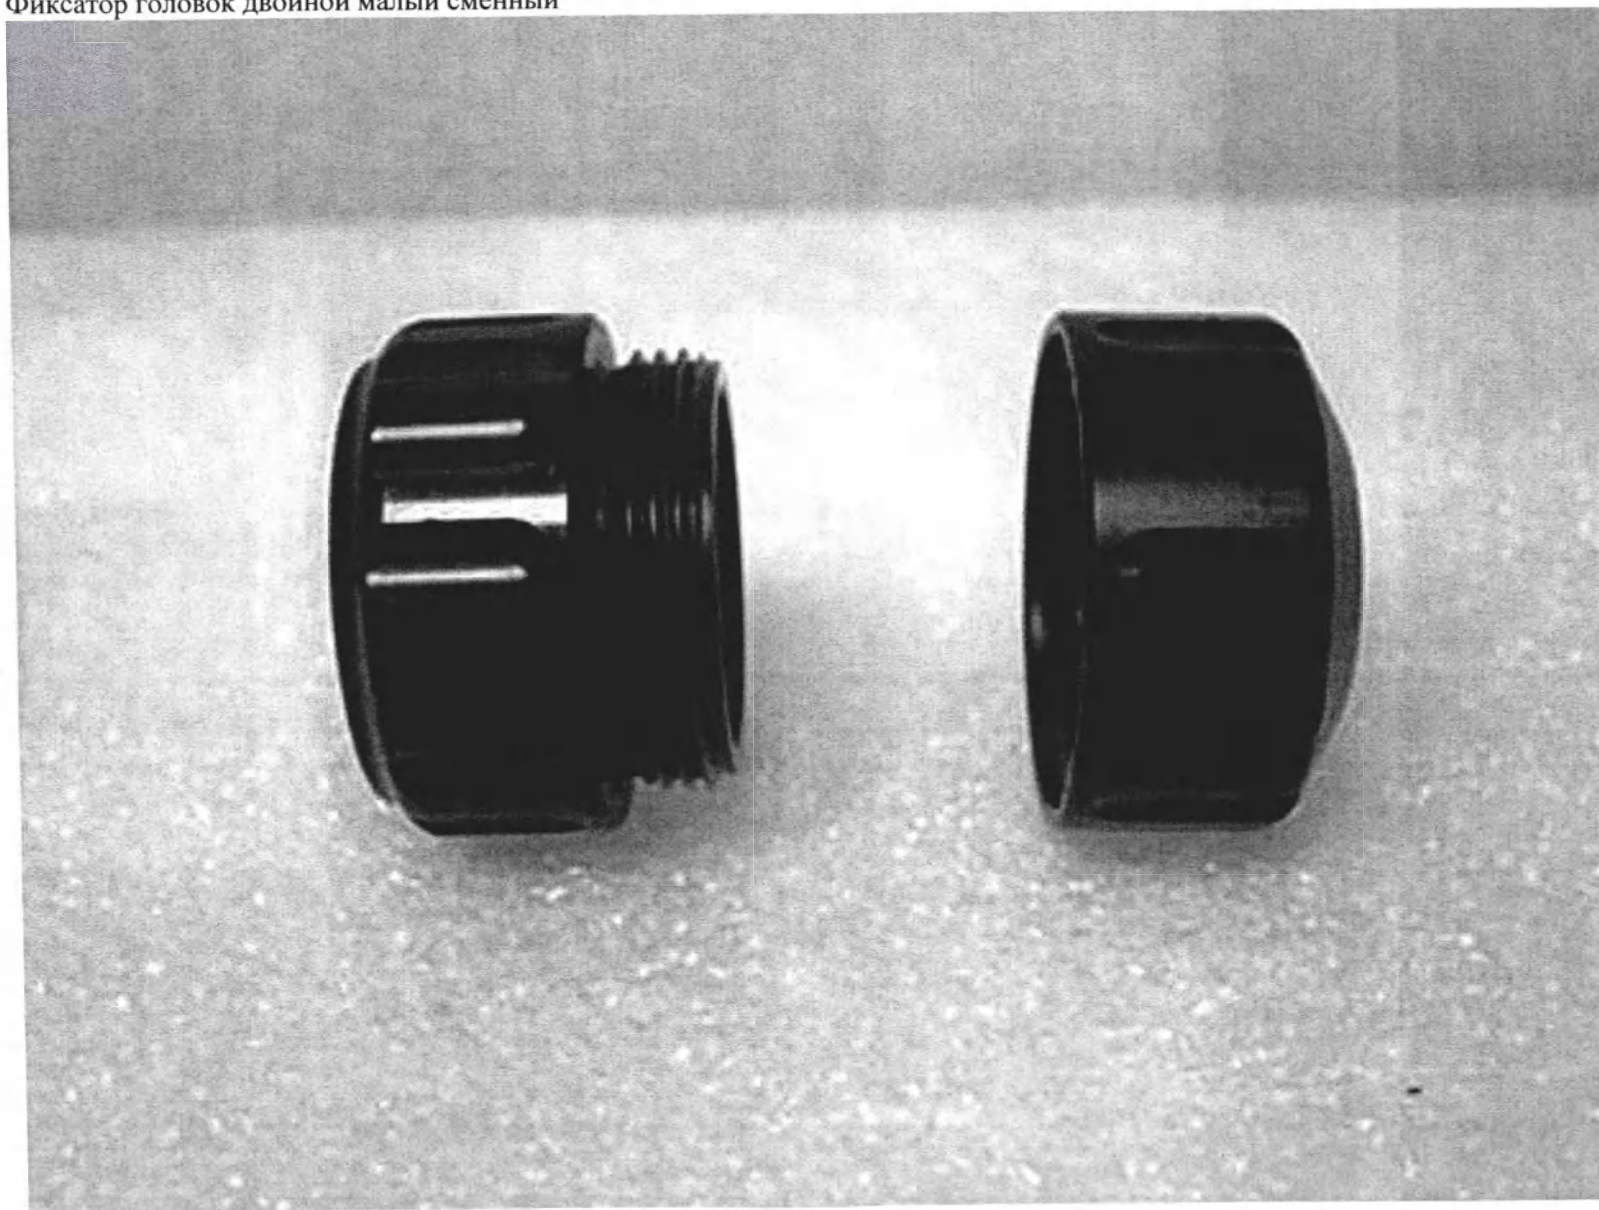


Фиксатор головок двойной средний сменный

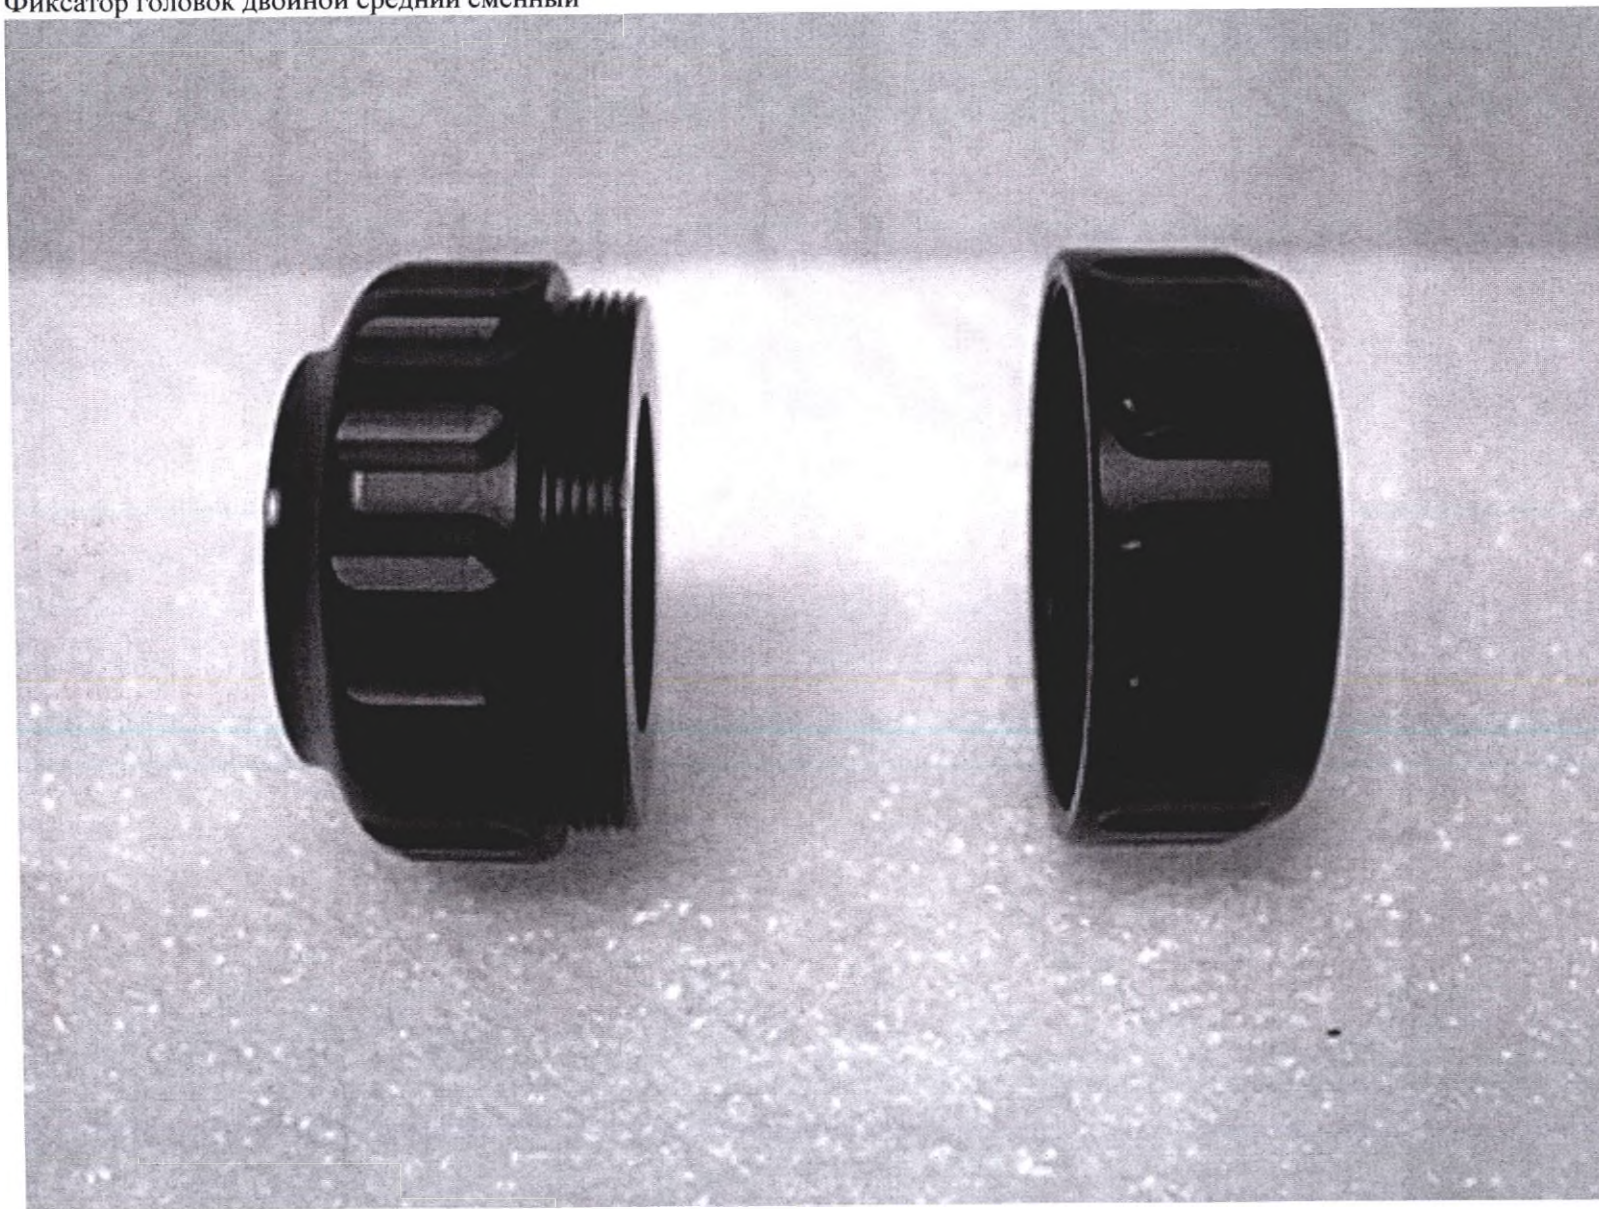

Фиксатор головок двойной большой сменный

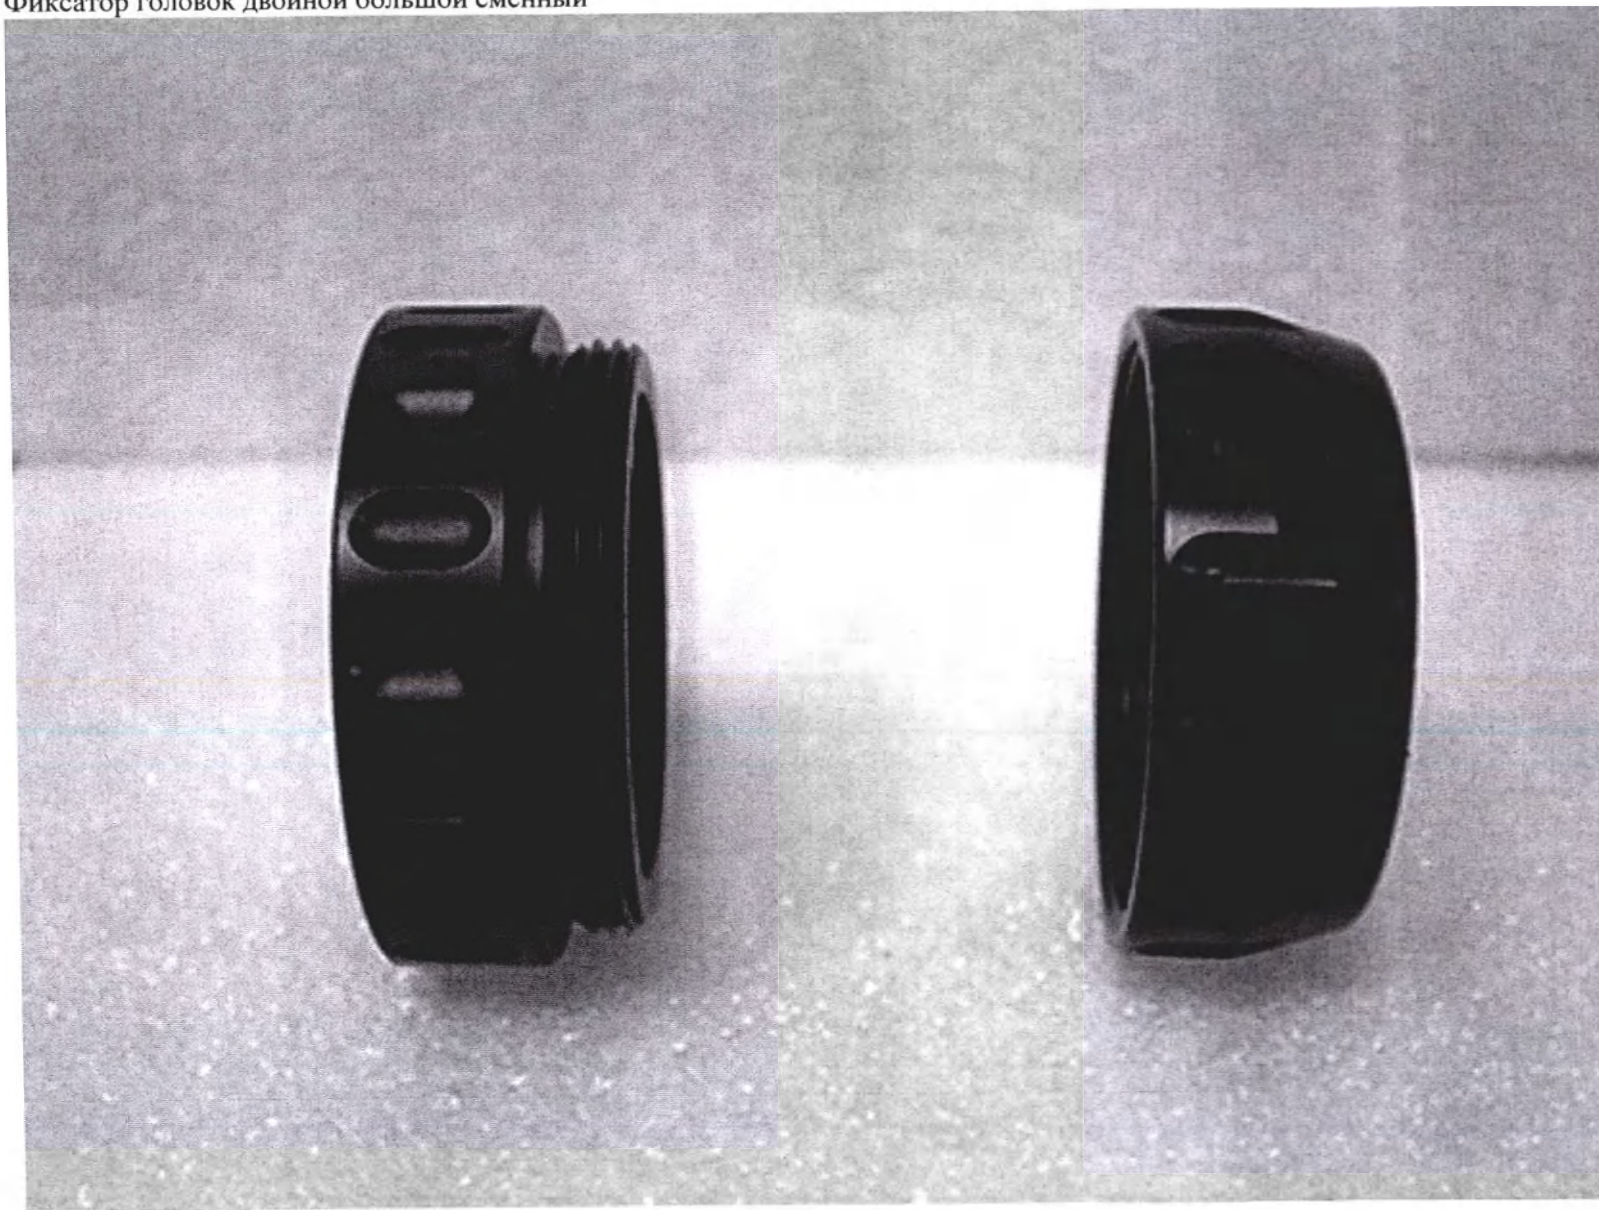

Прокладка разрезная сменная

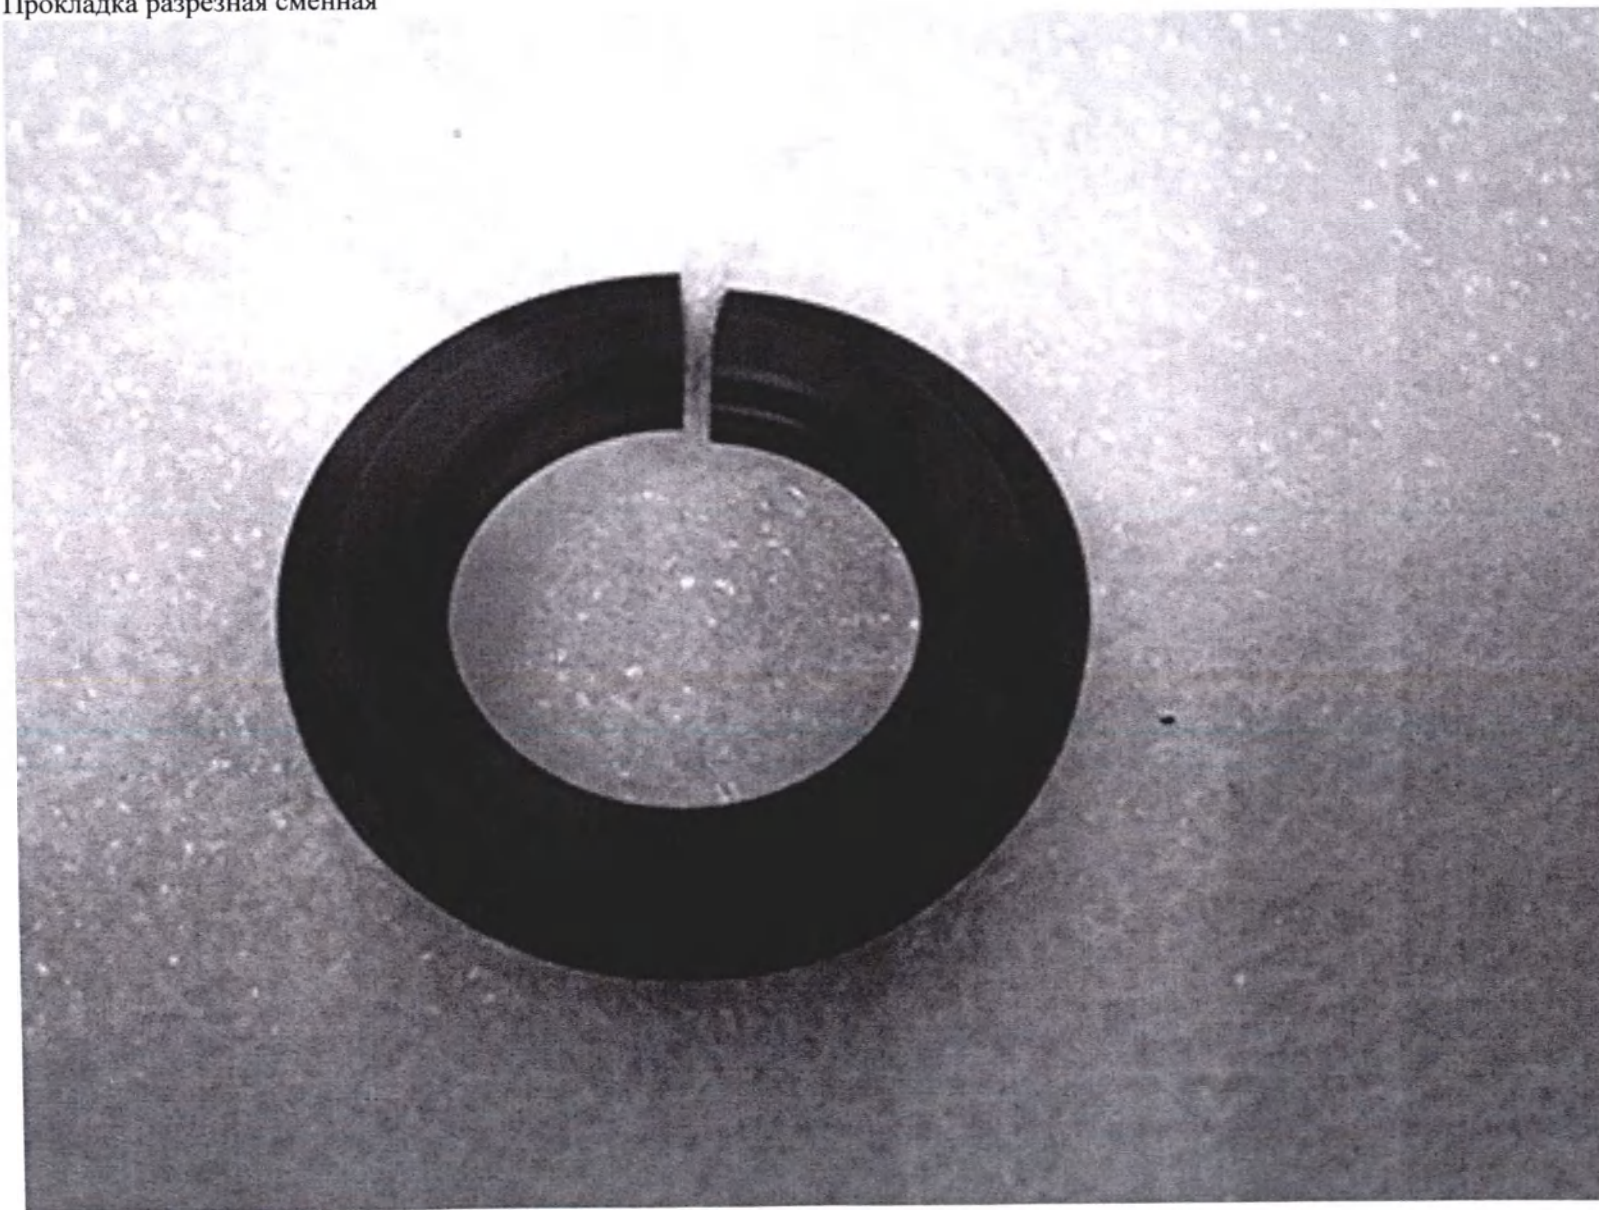

Комплект сменных частей аппликатора - не более 10 шт. (при необходимости): - трубка направляющая - 2 шт.
- сердечник ударный - 2шт. - набор колец уплотнительных в пластиковом контейнере - 2 шт.: Ø11 мм Ø12 мм Ø13 мм Ø14,5 мм Ø24 мм




Рукоятка аппликатора с кабелем сменная




Ловушка сердечника ударного сменная



Уплотнитель кольцевой ловушки сердечника ударного

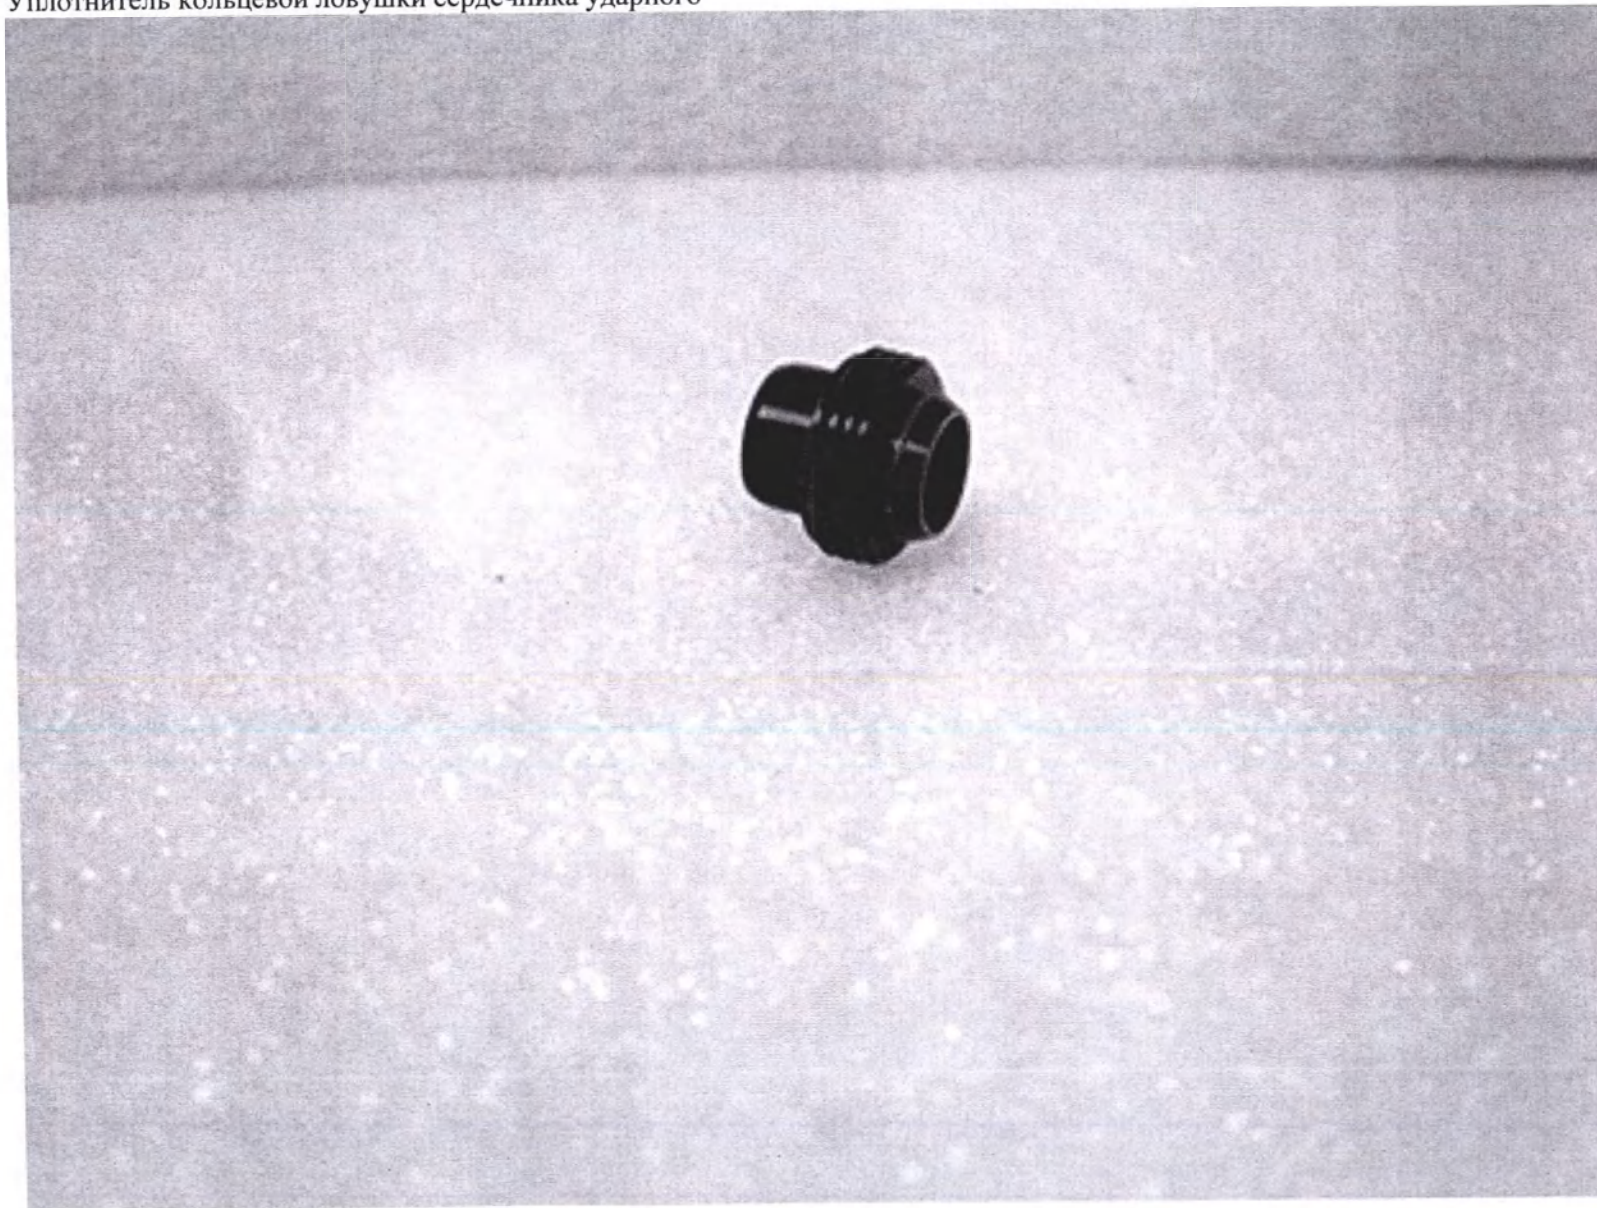

Амортизатор ствола с кольцевым упором сменный

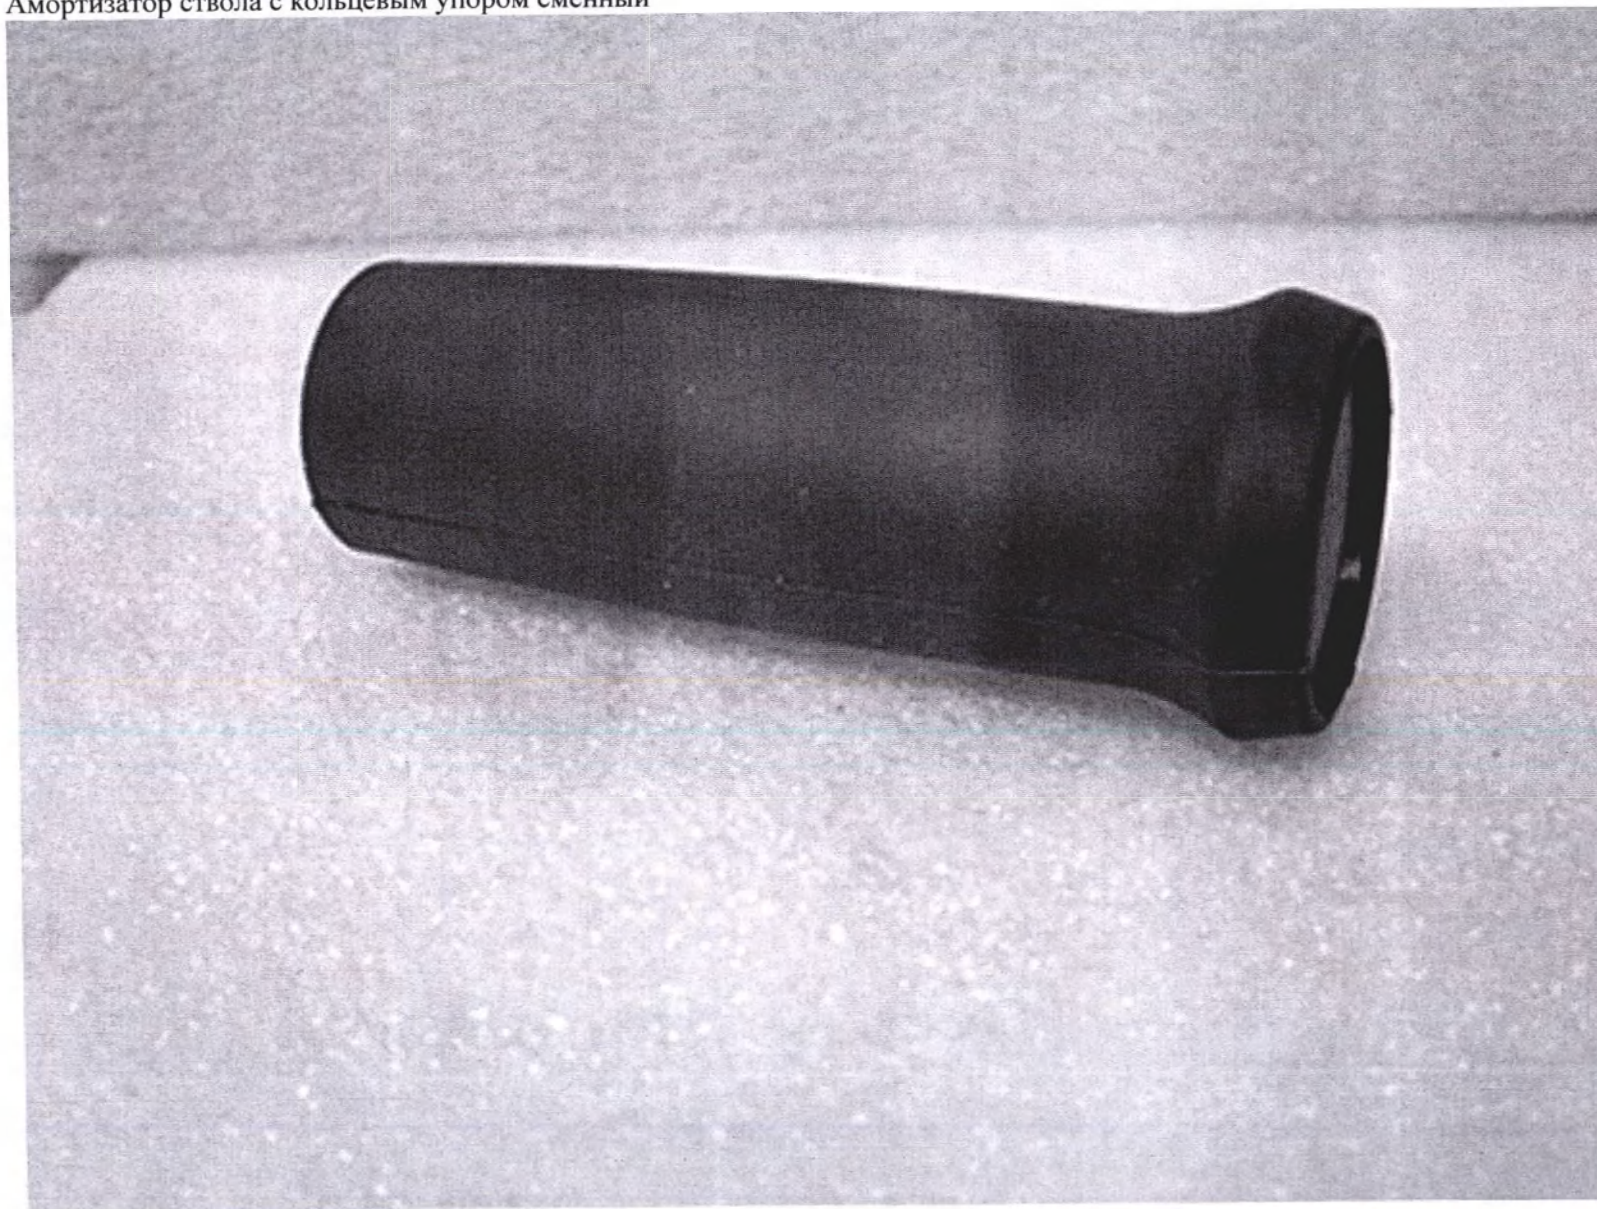

Тележка аппаратная




Демпфер малый сменный



Демпфер **большой сменный**



Подставка настольная под головки

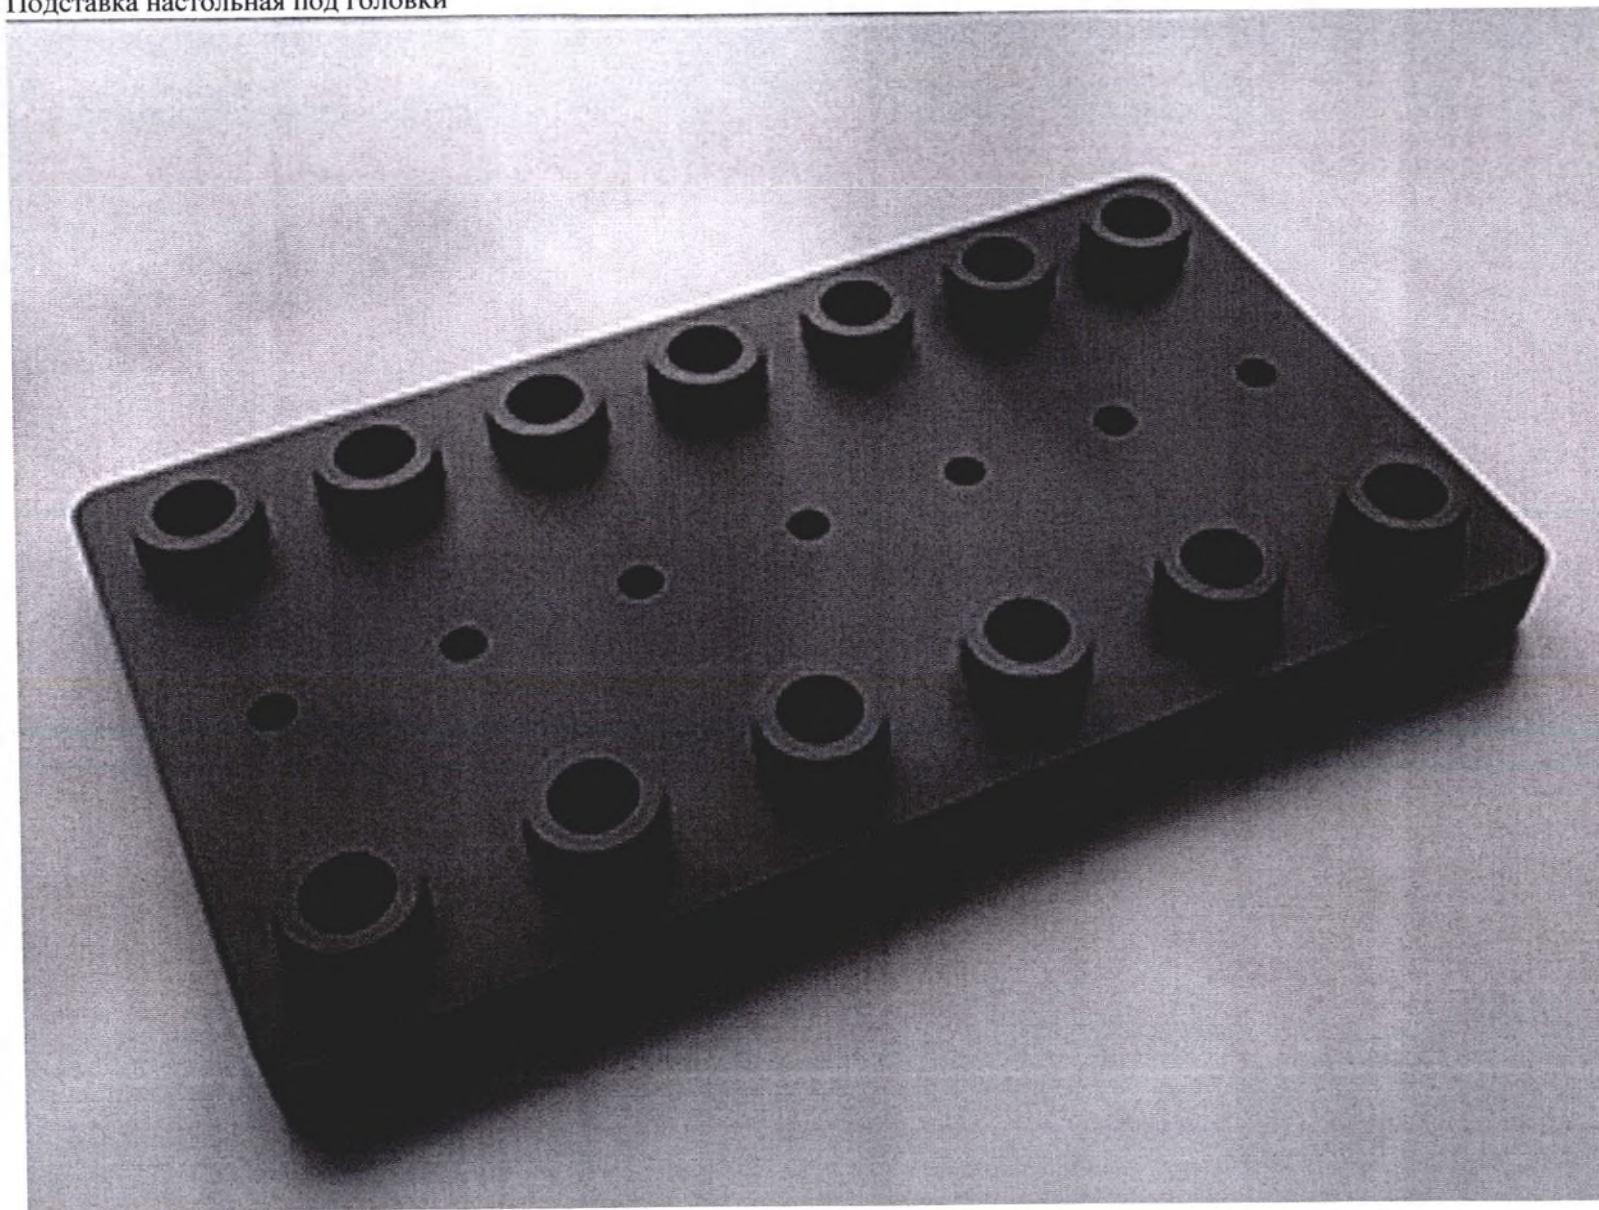

Принадлежности: Чемодан транспортировочный для блока аппарата основного и комплектующих





Прочитаю и сиренно
переложу 56 лист
Информационный директор
ООО «С. Д. ИННОВАЦИИ»
Нурма С.В.

