


Фотографии общего вида медицинского изделия

Анализатор дискретный автоматизированный клинической химии NS-Prime AA01
для количественного in vitro определения и мониторинга концентраций аналитов
в кале человека


1. Анализатор 01 – Вид спереди

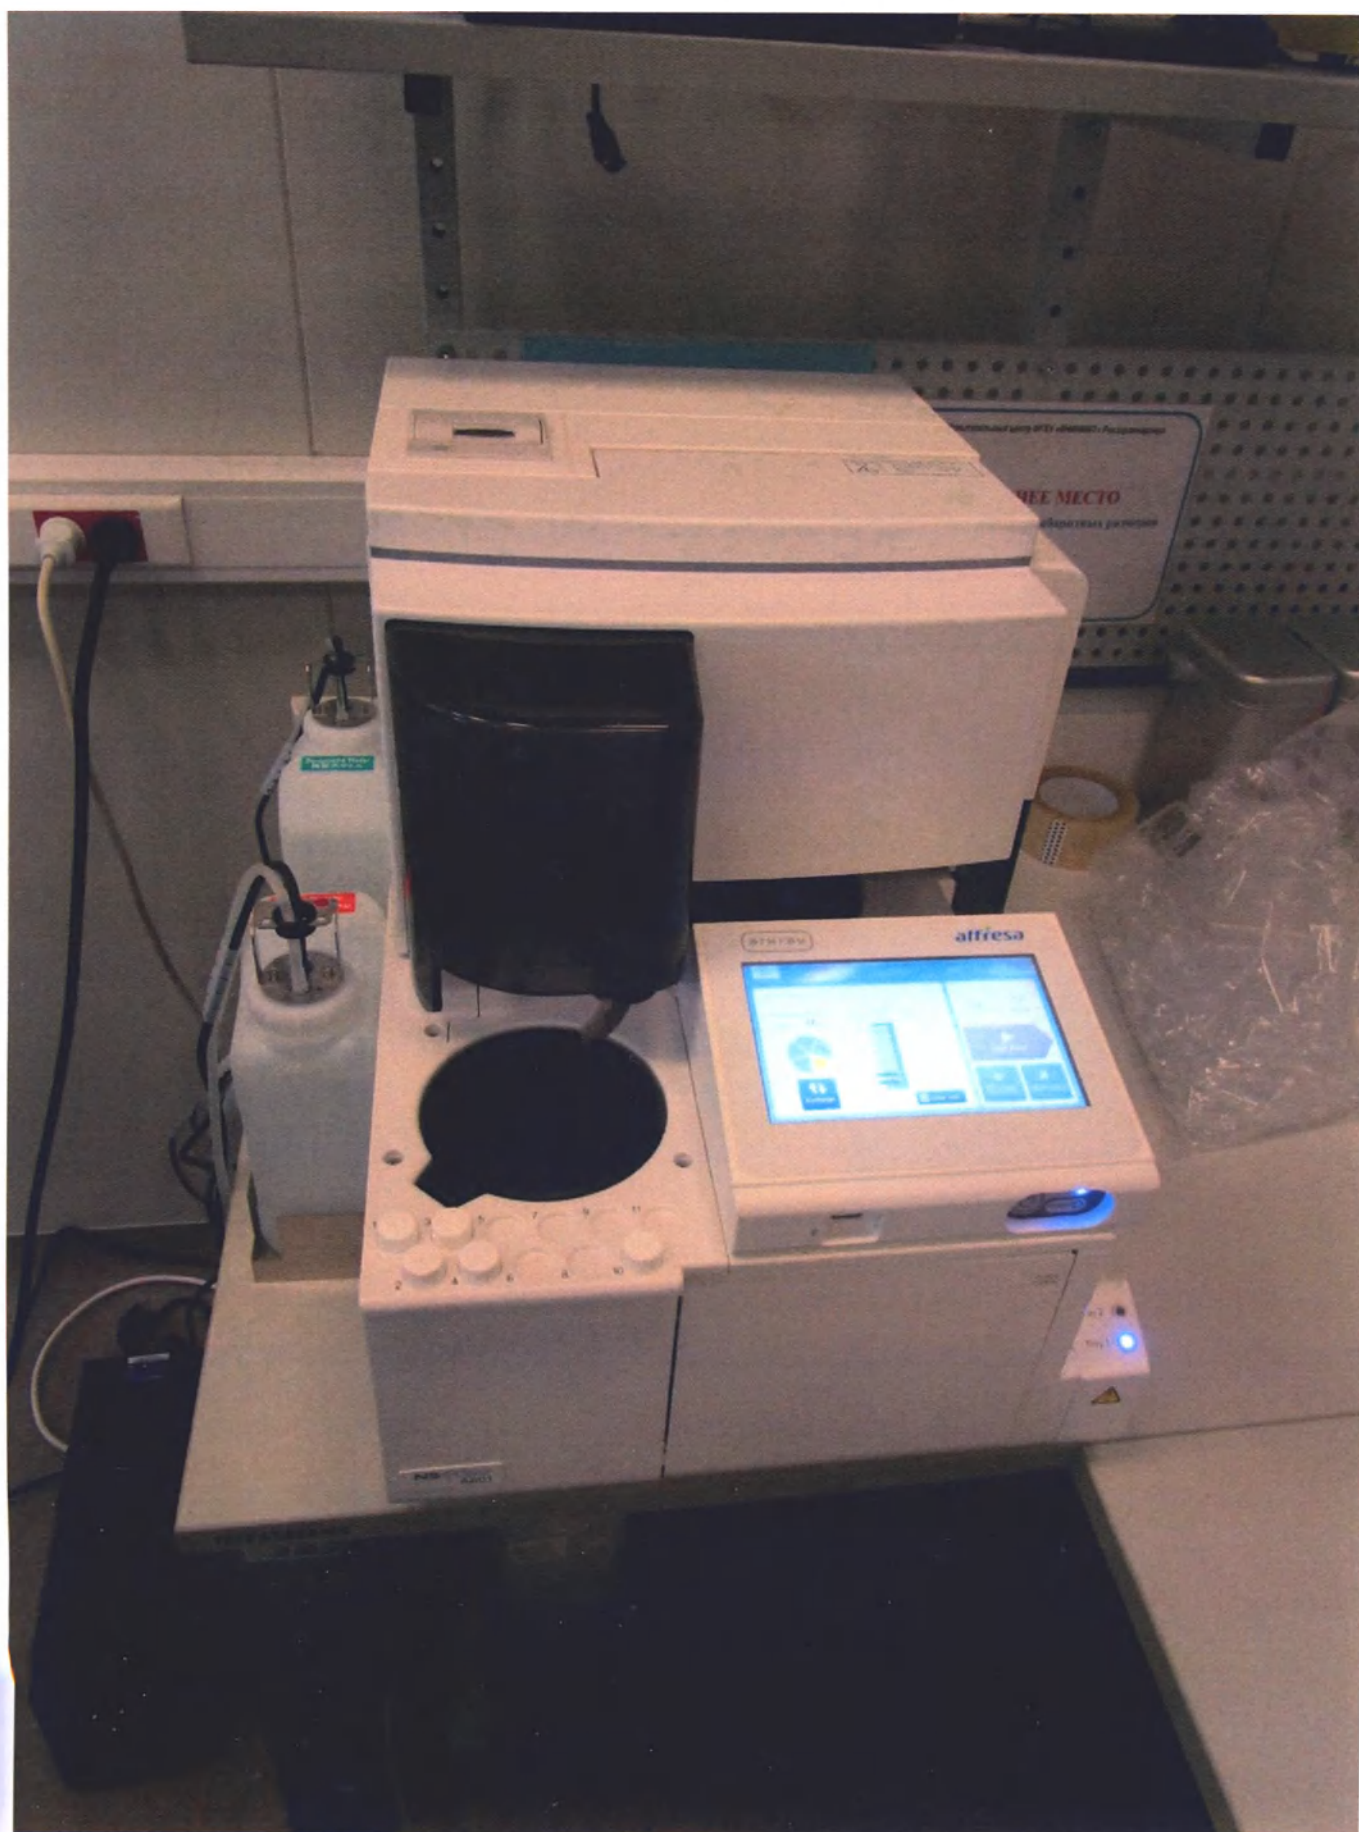

1. Анализатор 01 – Вид спереди



2. Анализатор 02 – Вид спереди

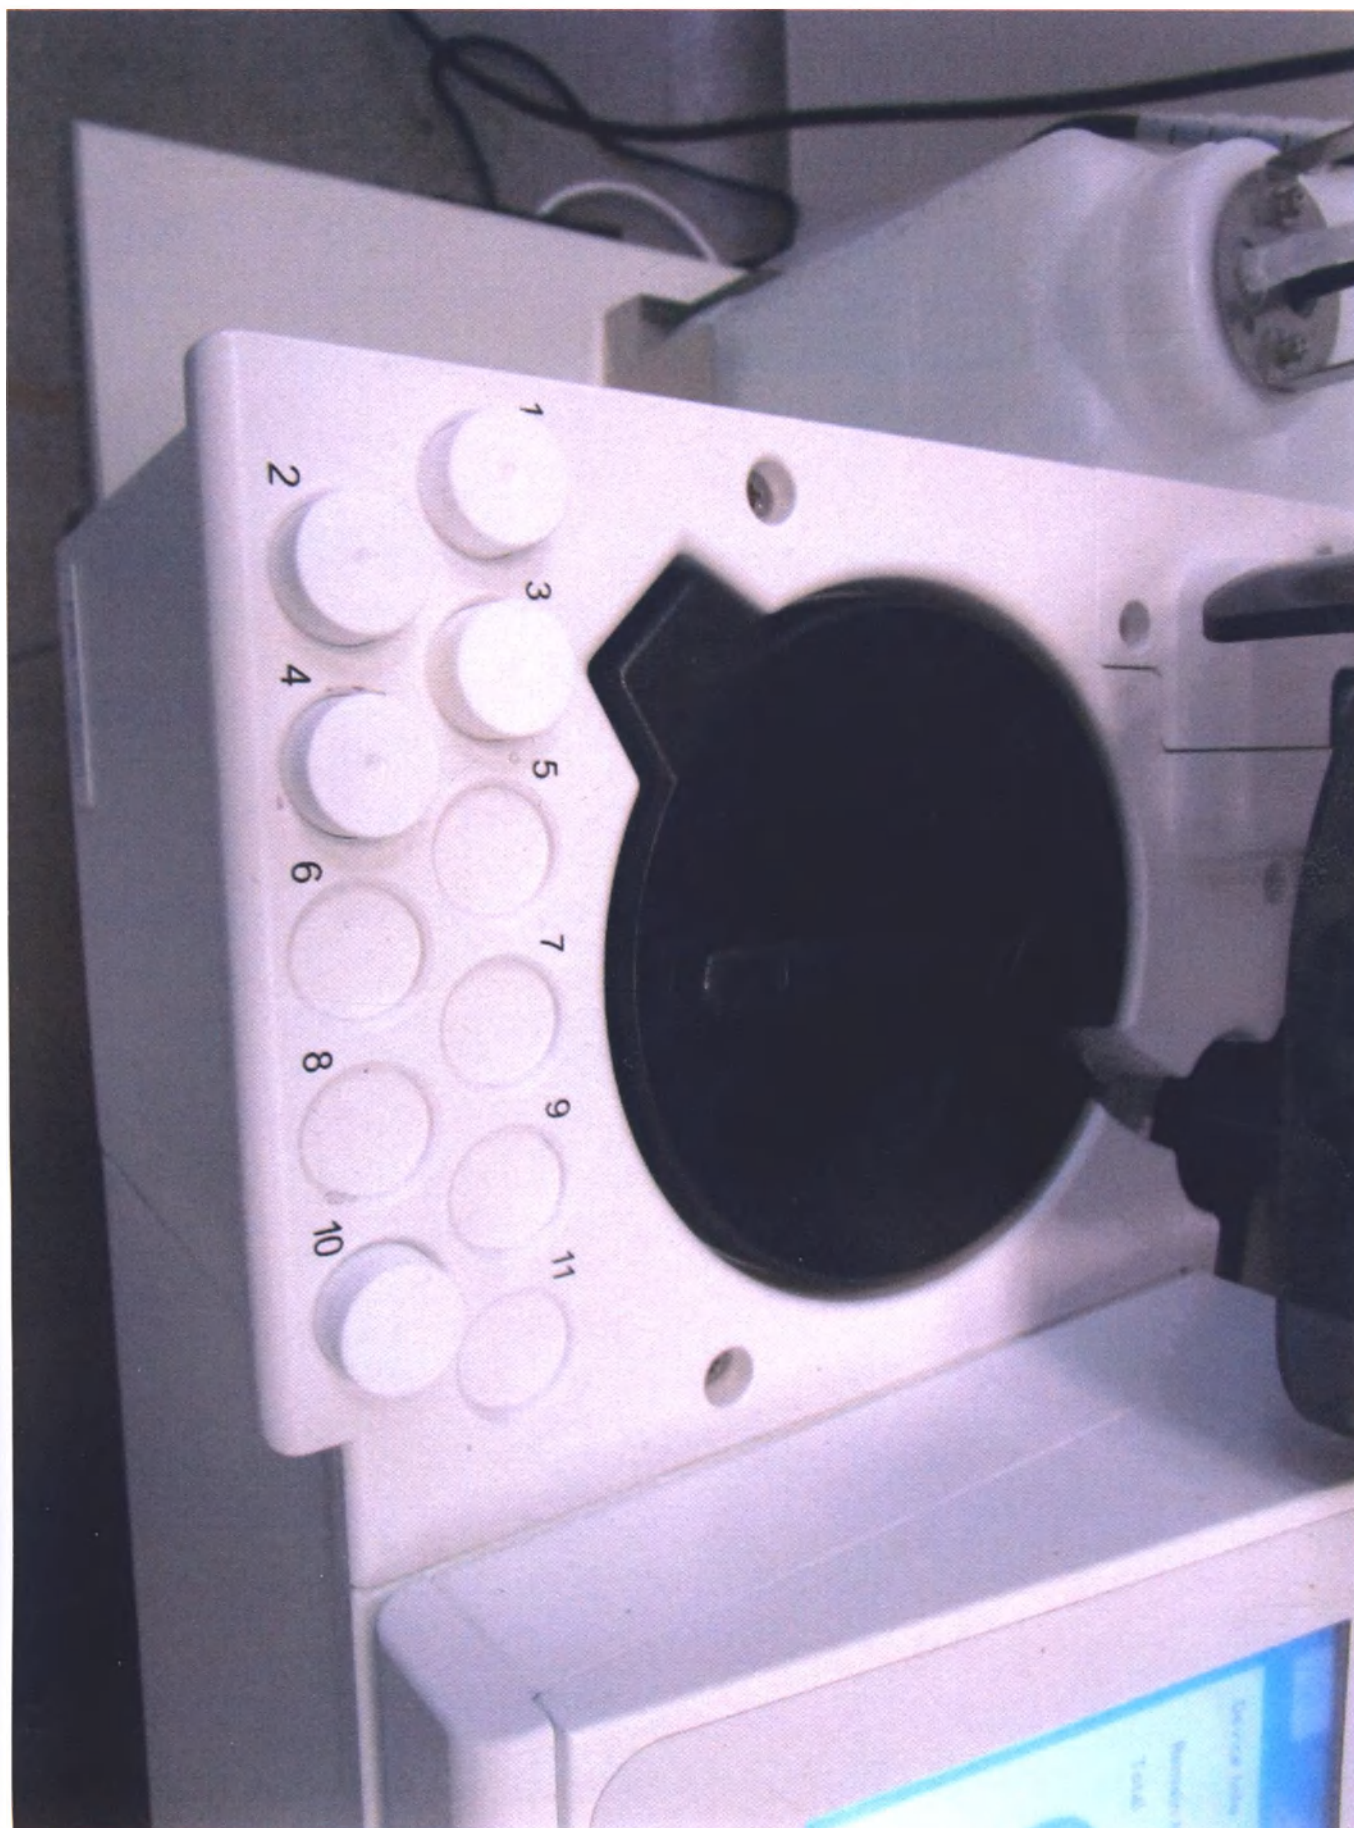


3. Анализатор 03 – Название анализатора



4. Анализатор 04 – Вид спереди




5. Анализатор 05 – Вид спереди

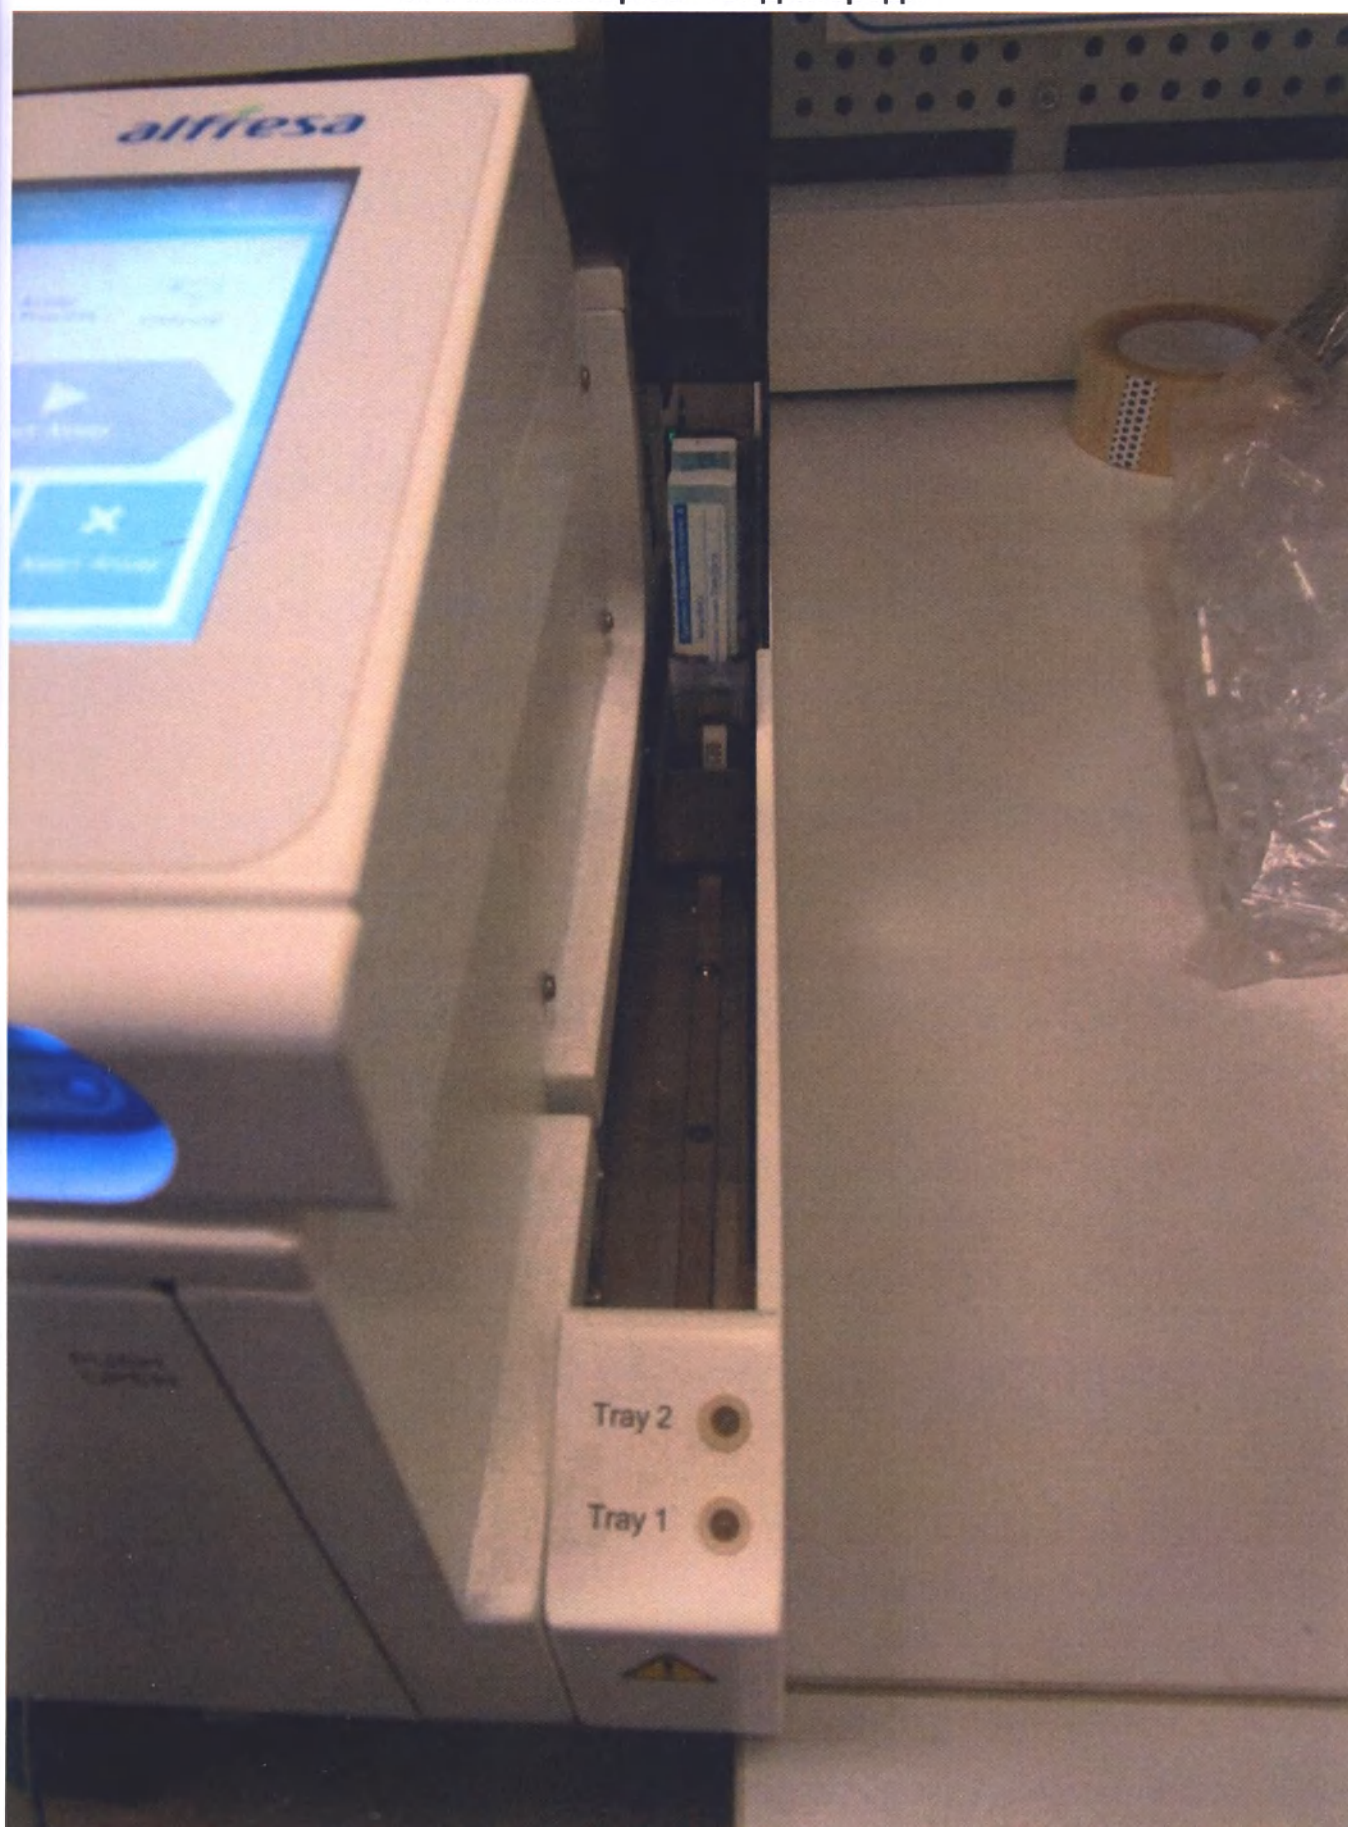


6. Анализатор 06 – Вид спереди




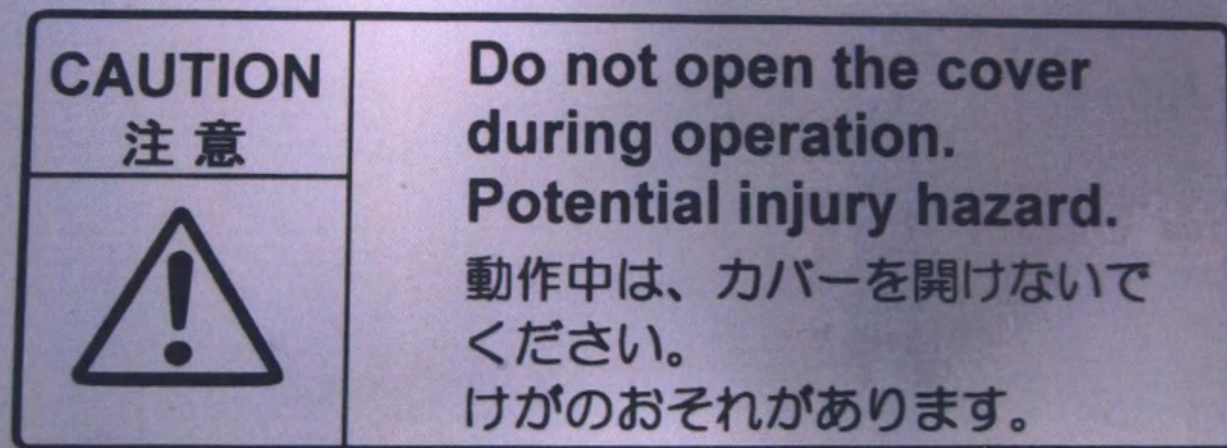

8. Анализатор 08 – Встроенный принтер

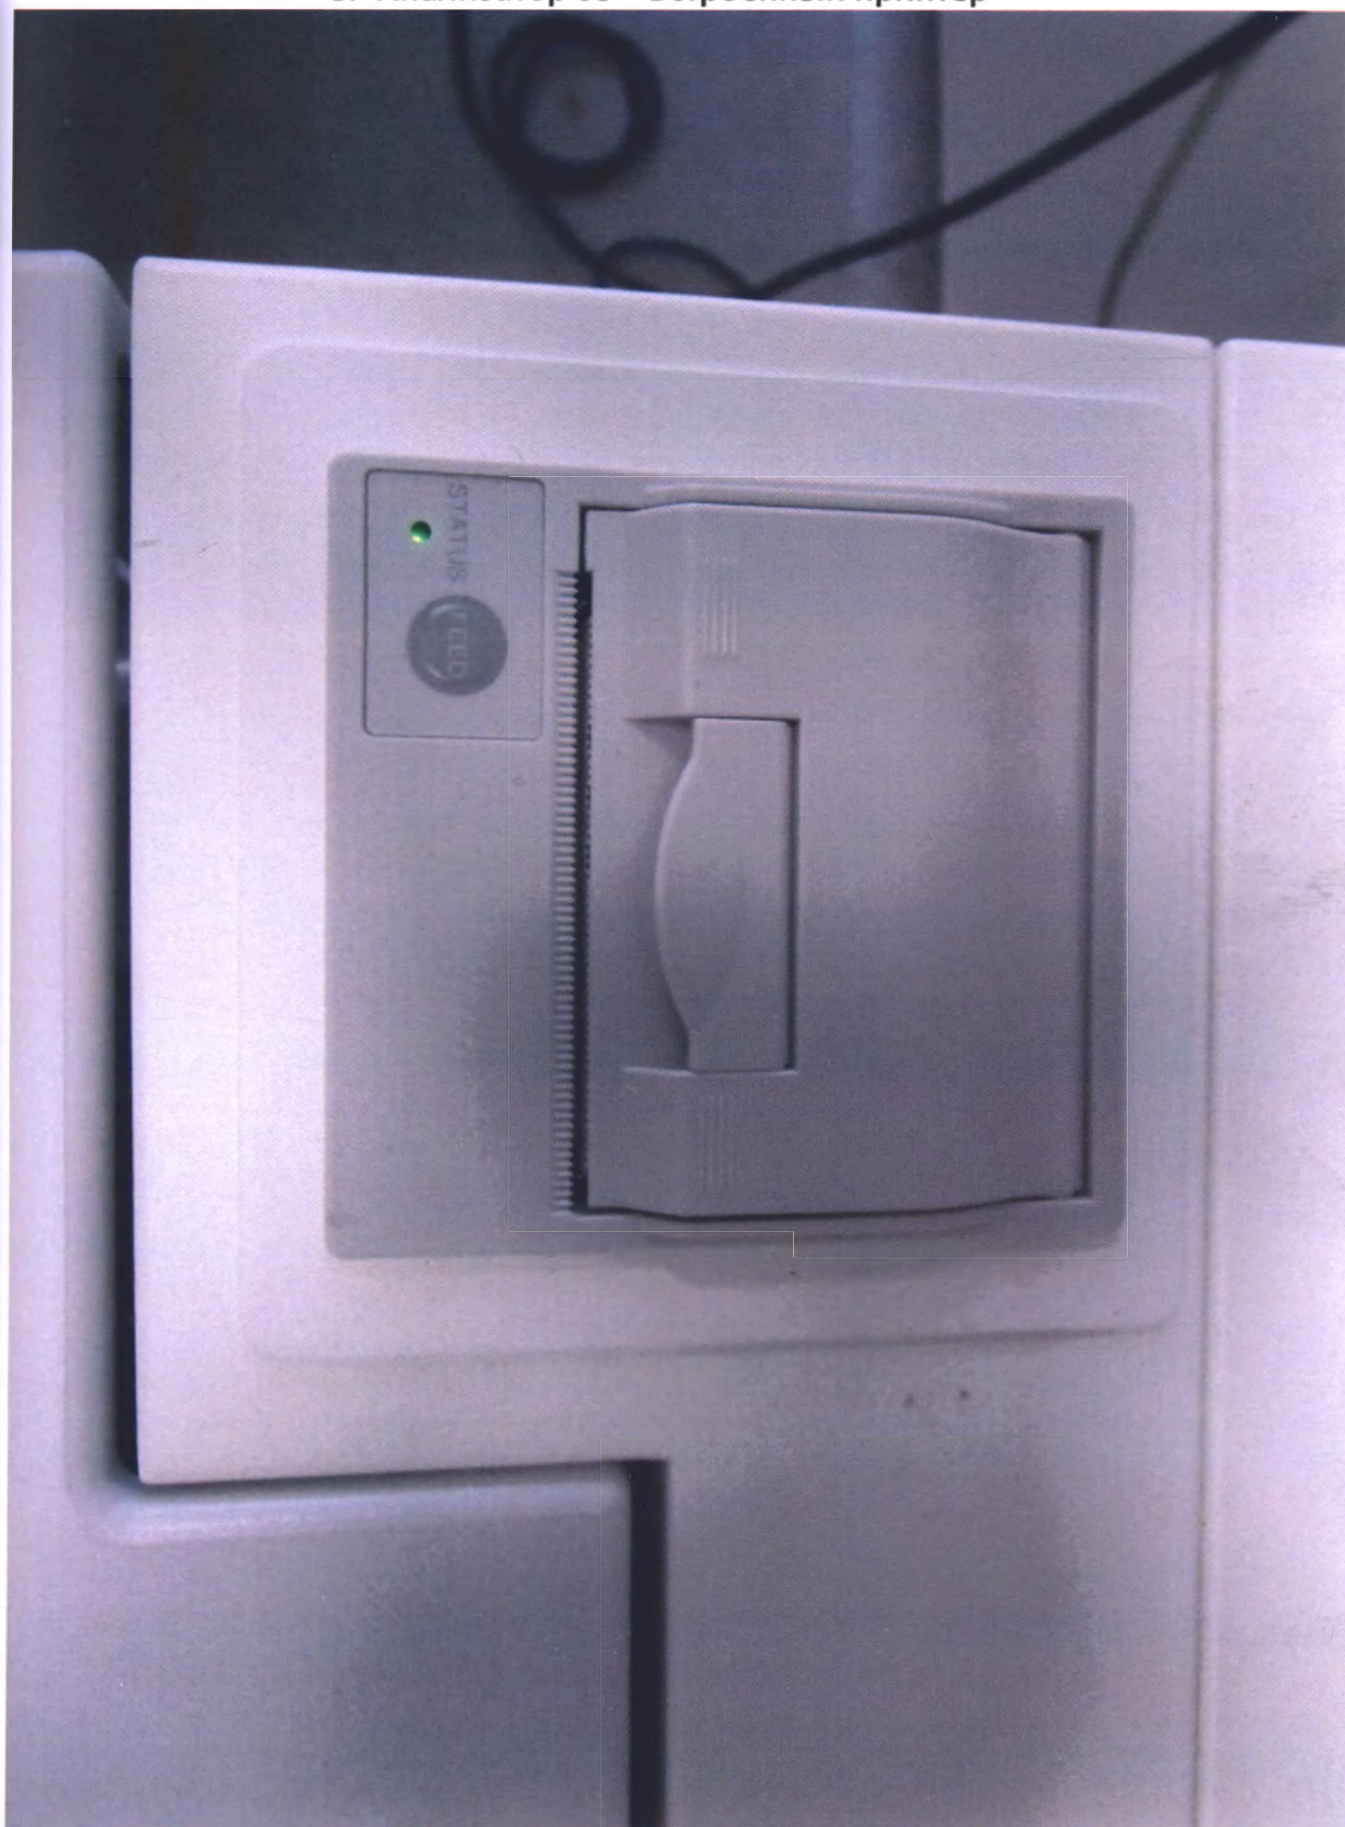


9. Анализатор 09 – Предупредительная маркировка

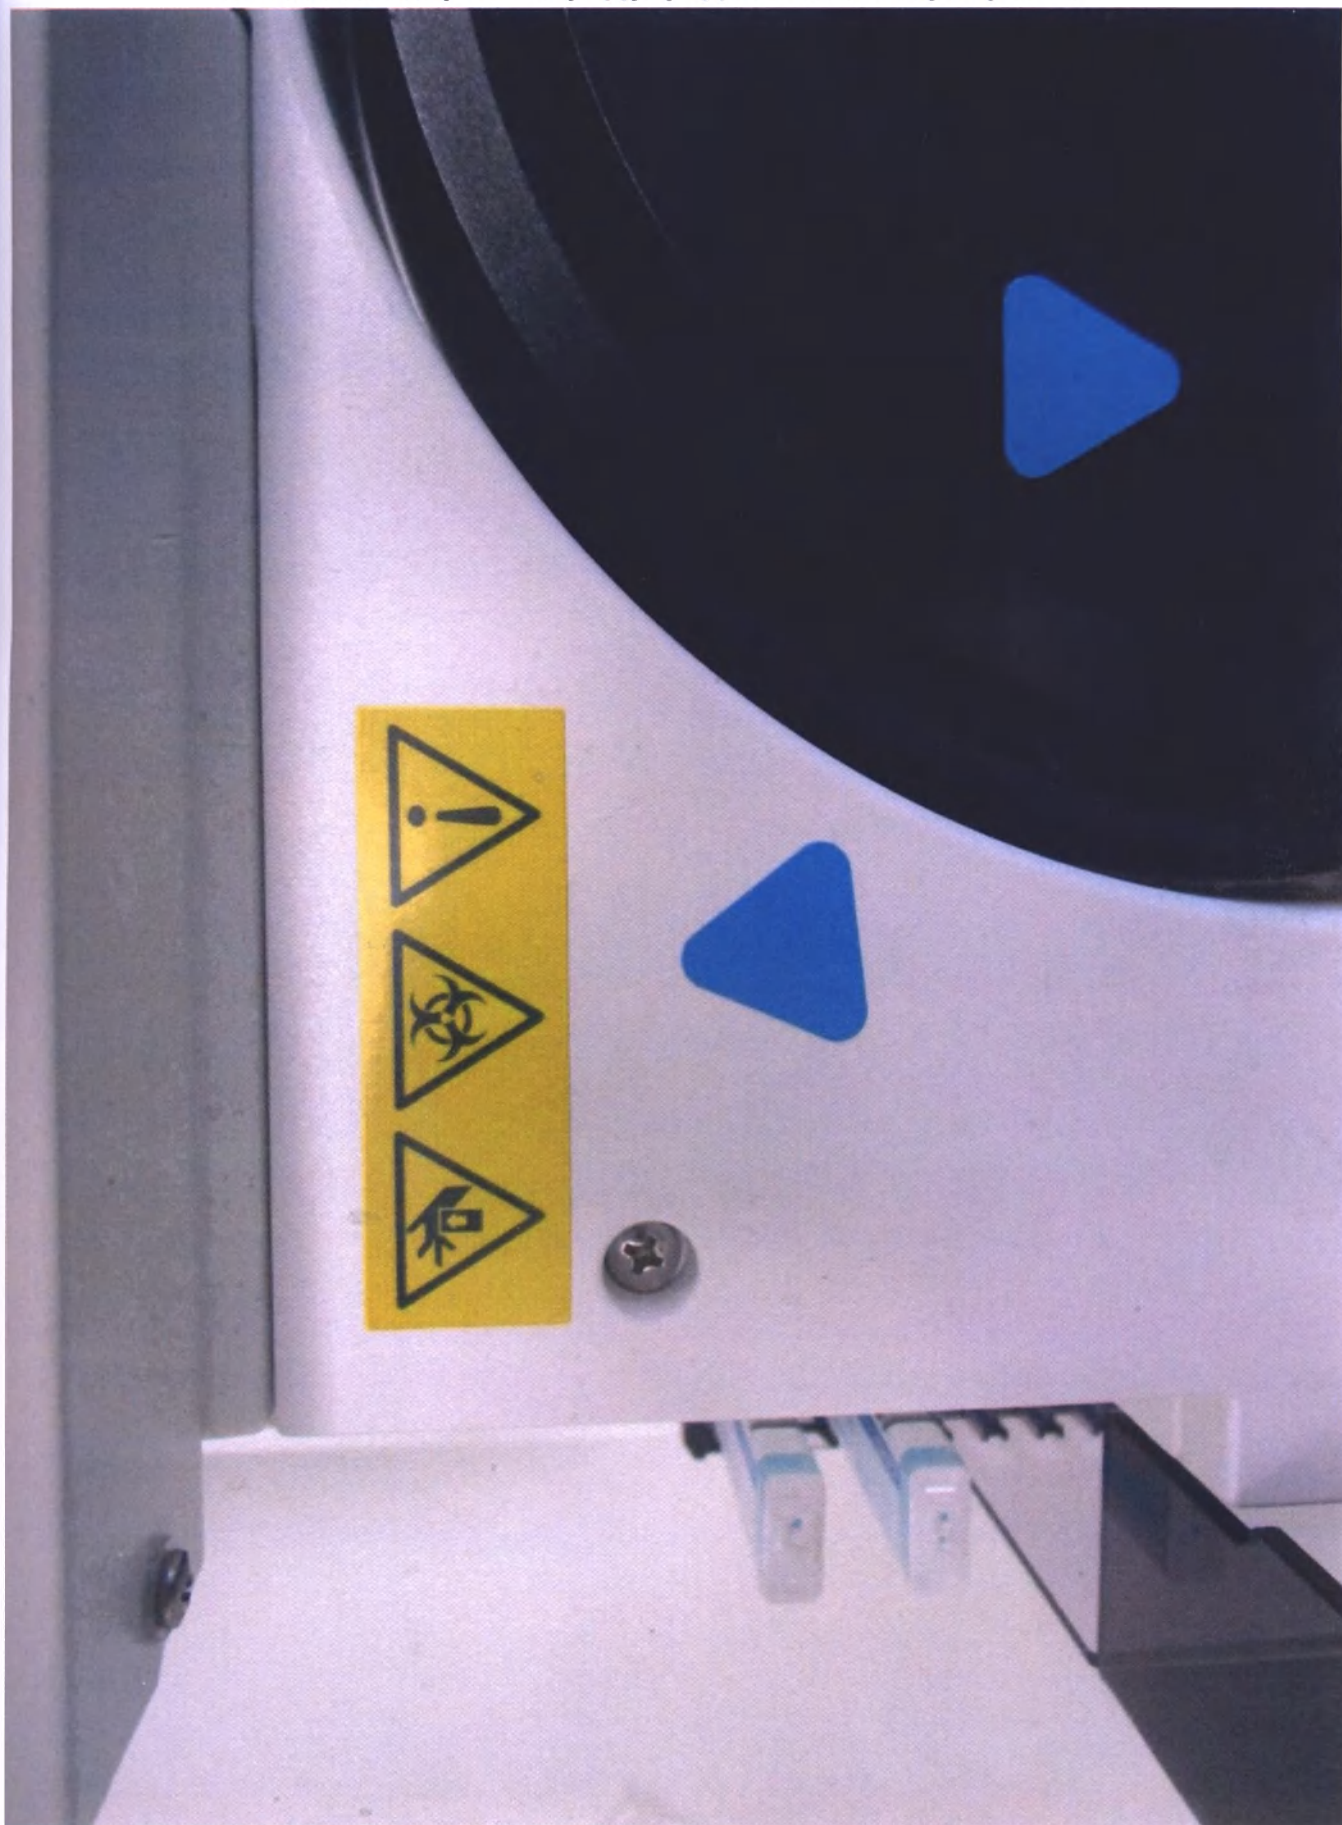


Discrete Clinical
Chemistry Analyzer

AA01




SN 71910011



INPUT POWER AC100-240V 300VA

FREQUENCY 50/60Hz



Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague,
The Netherlands



Otsuka Electronics Co., Ltd.
3-26-3 Shodaitajika, Hirakata-shi
Osaka, 573-1132, Japan

MADE IN JAPAN


11.Анализатор 11 – Вид сзади



12. Анализатор - Общий вид




13. Емкость для дистиллированной и/или деионизированной воды, включая соединительные кабели и один комплект трубок

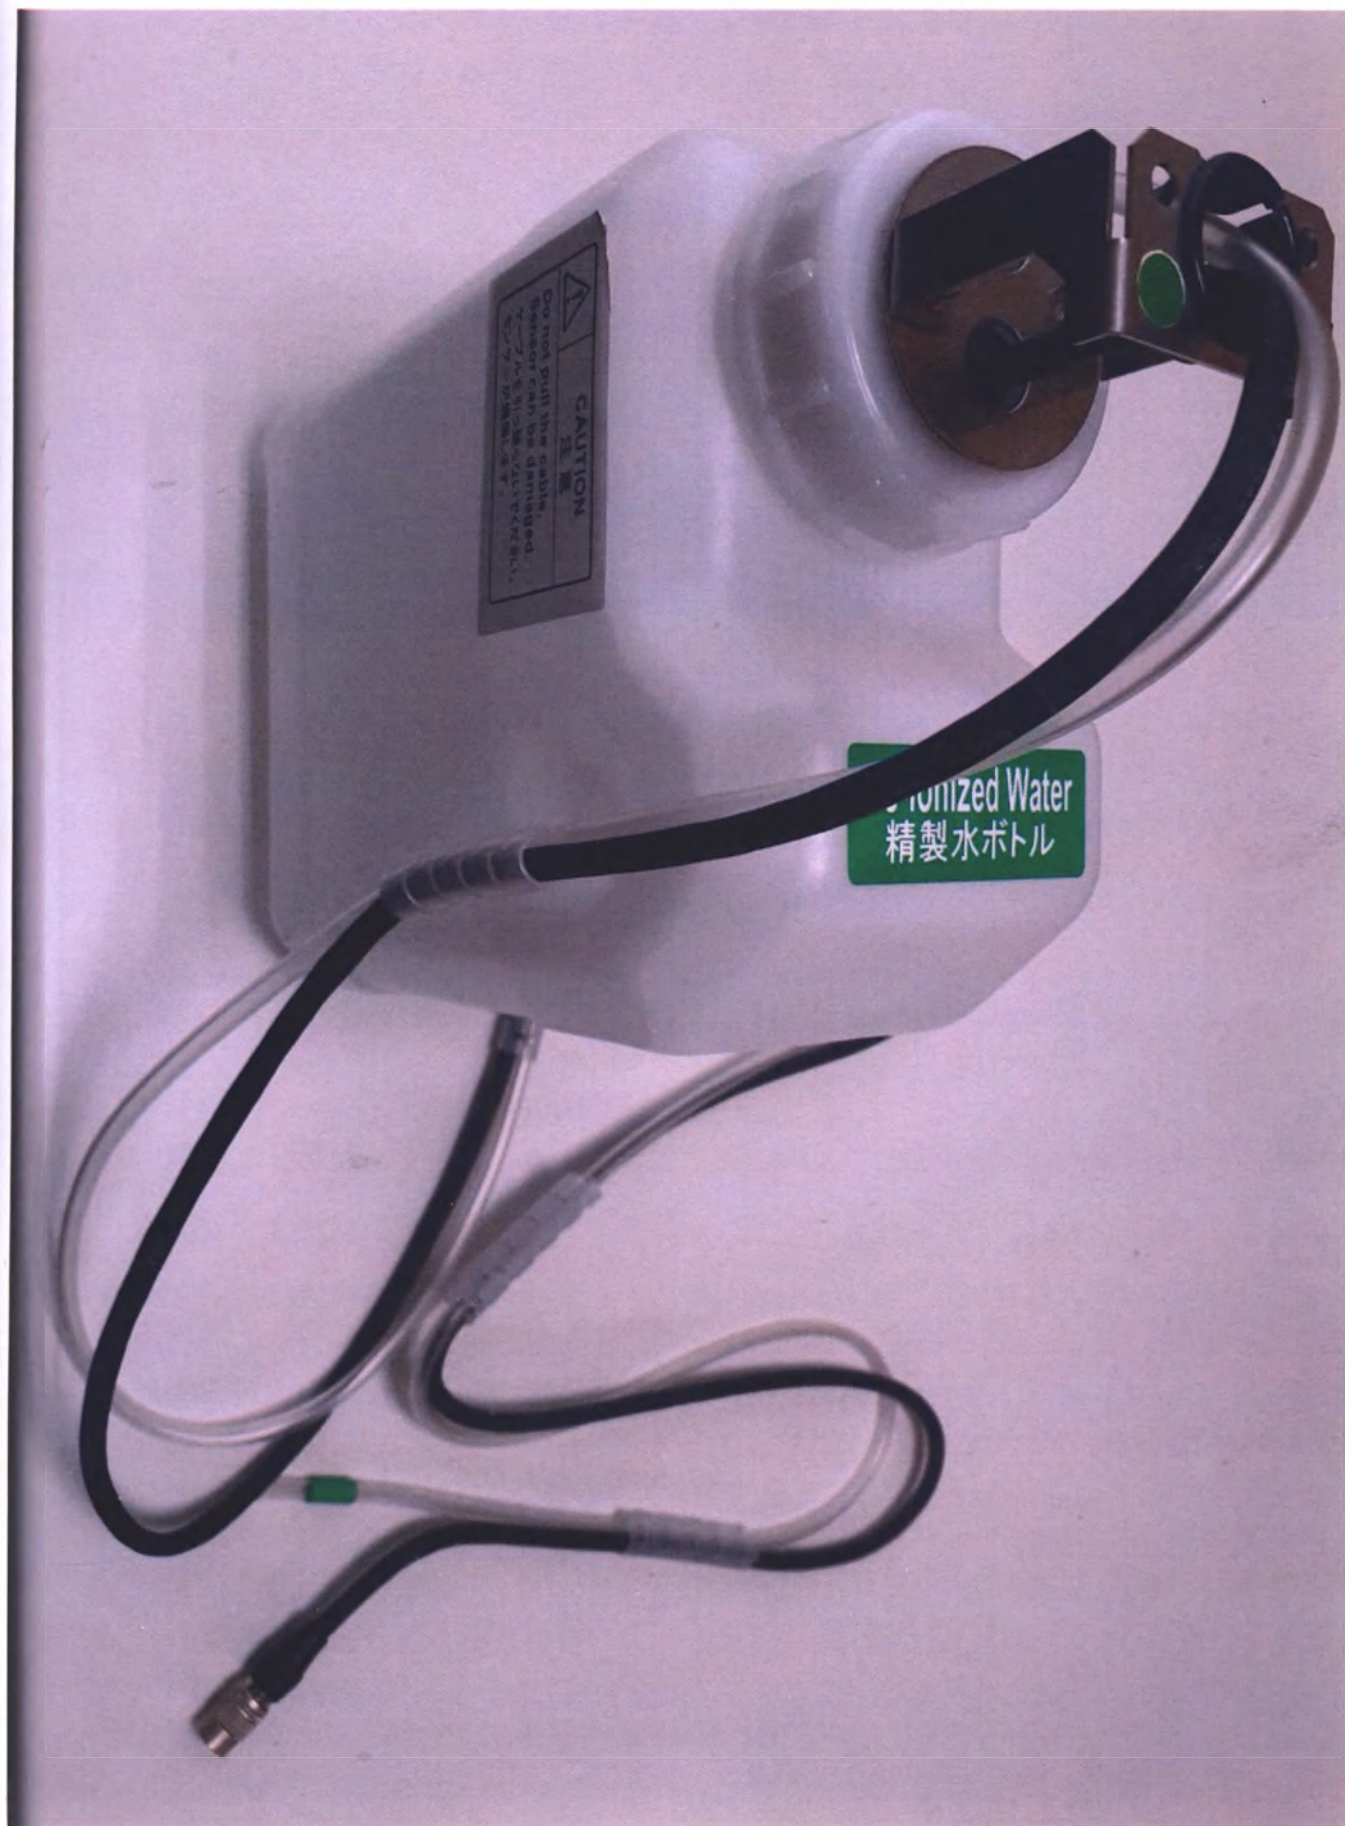

14. Емкость для промывающего раствора, включая соединительные кабели и один комплект трубок




15. Емкость для отработанной жидкости, включая соединительные кабели и один комплект трубок

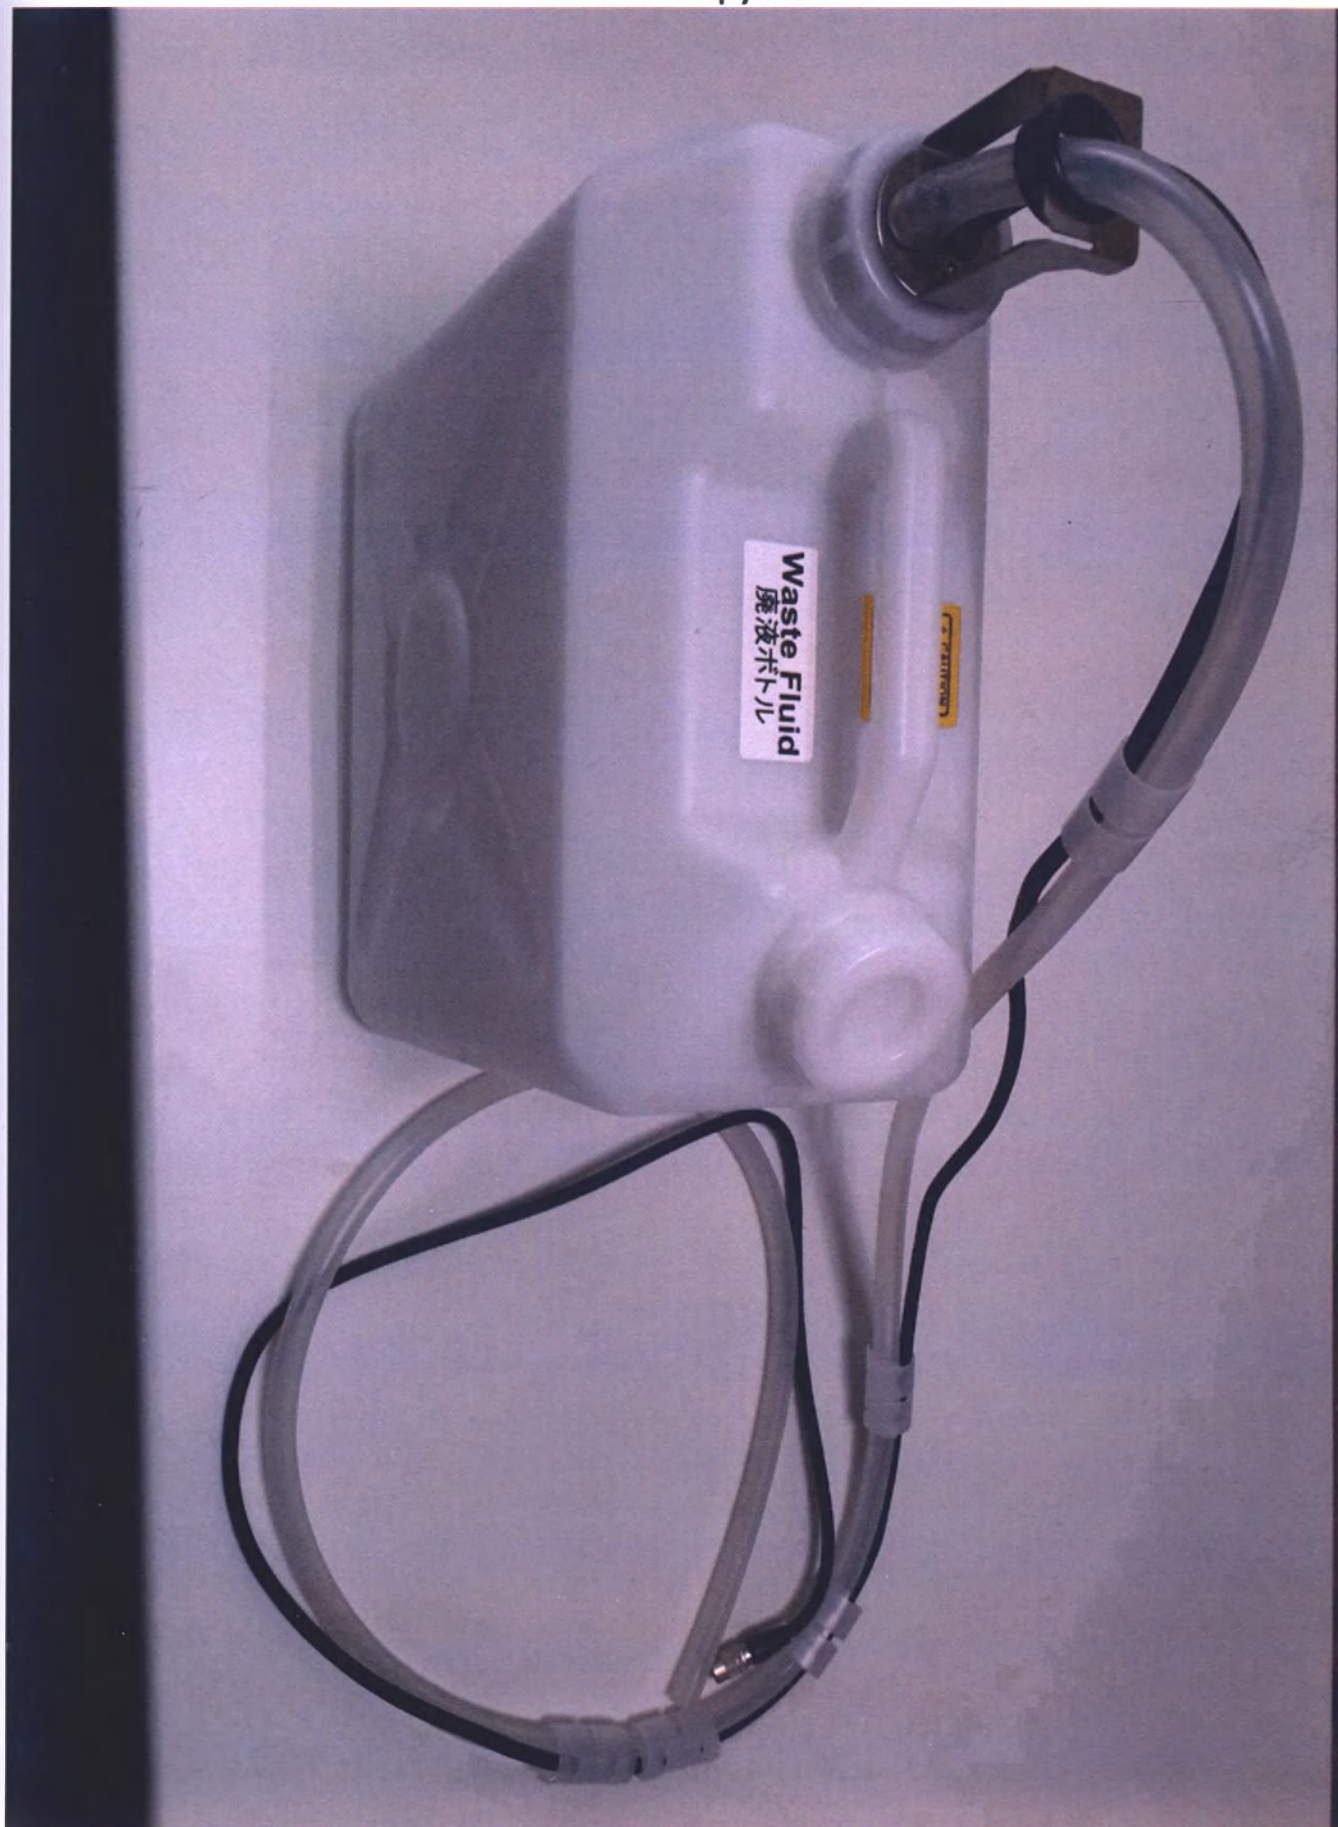


16. Место подключения трубок и предупредительная маркировка




17.Модуль реакционного столика – Фотография 1

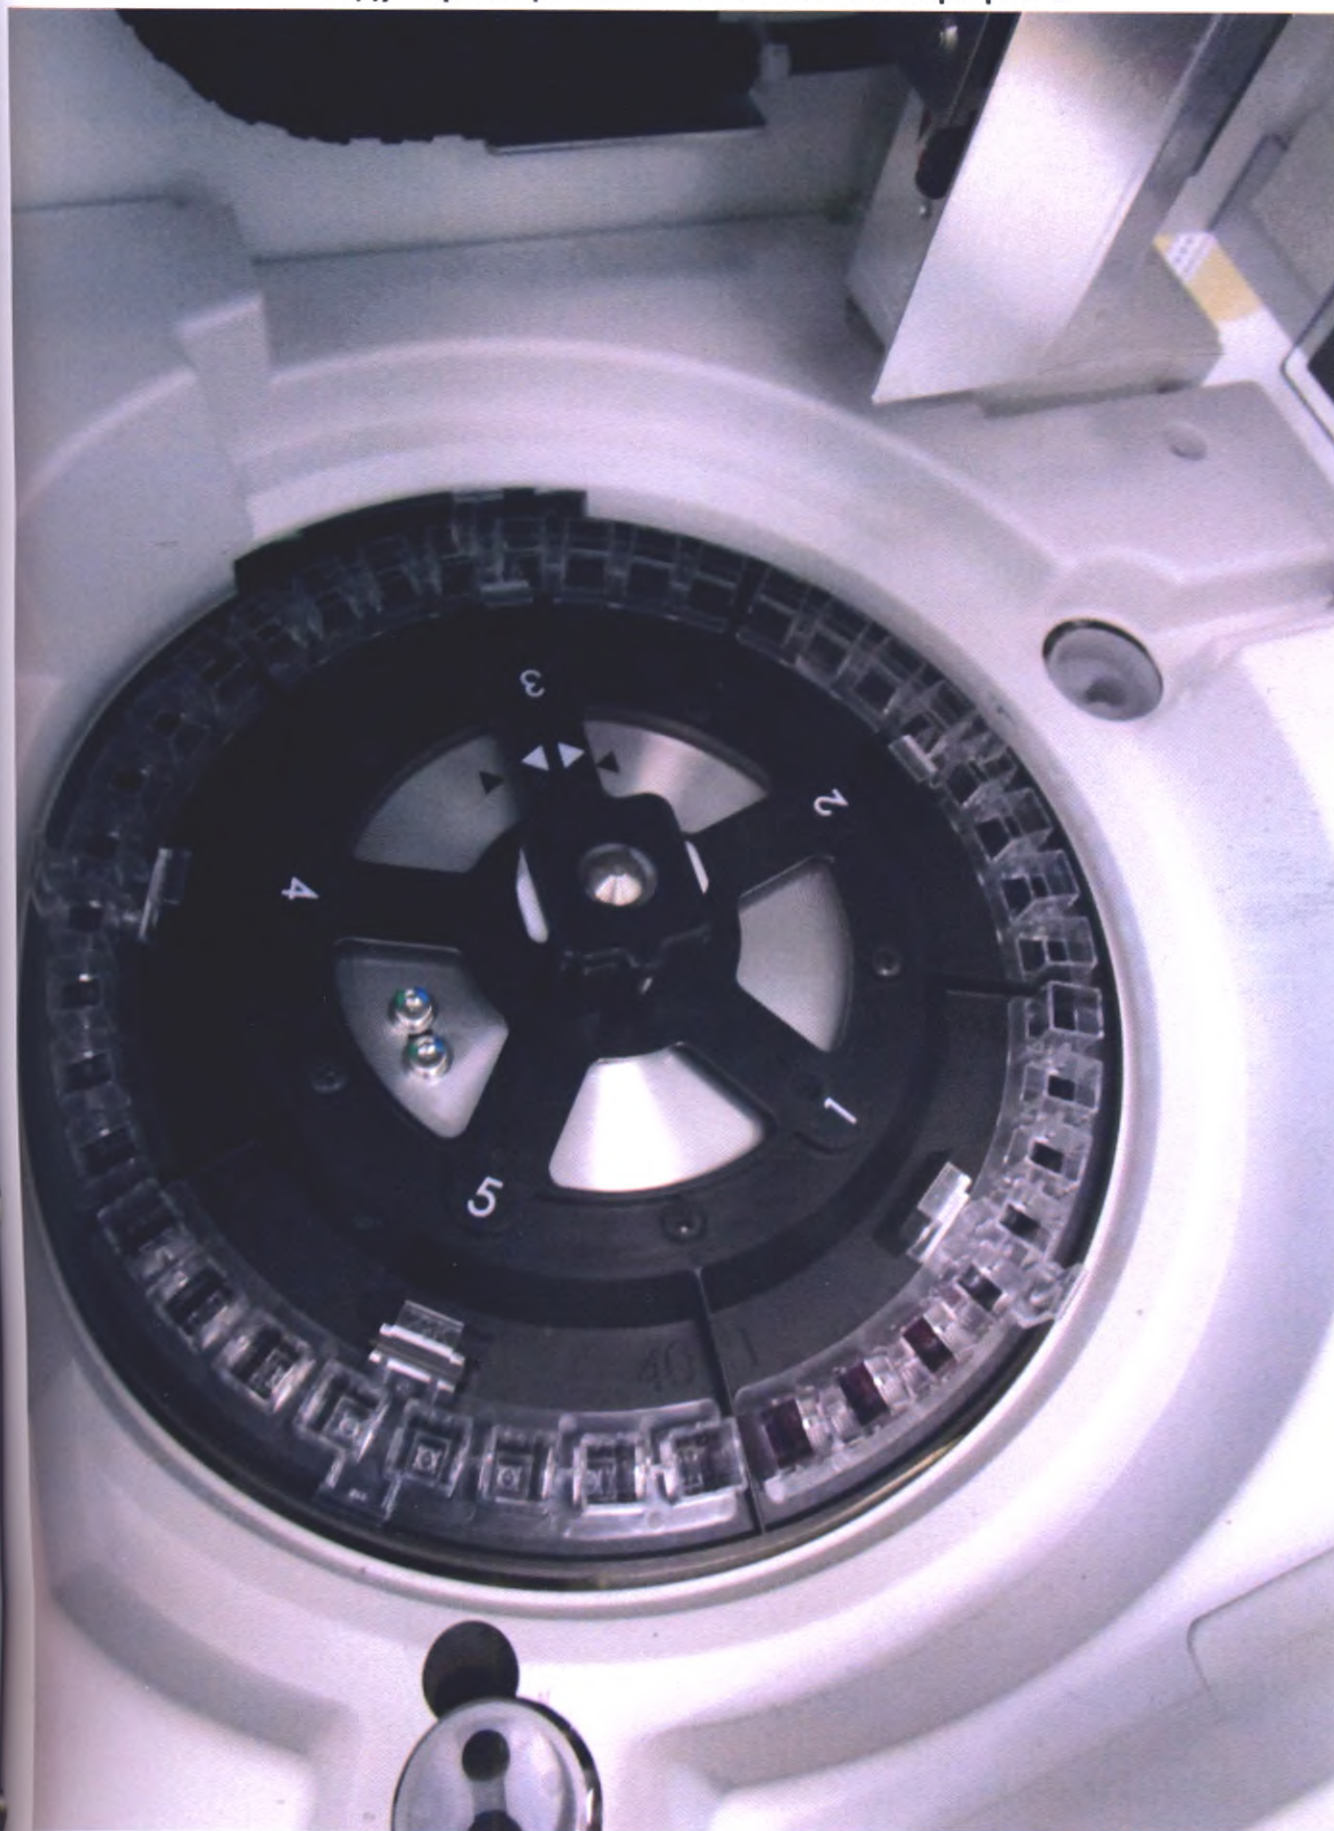


18.Модуль реакционного столика – Фотография 2

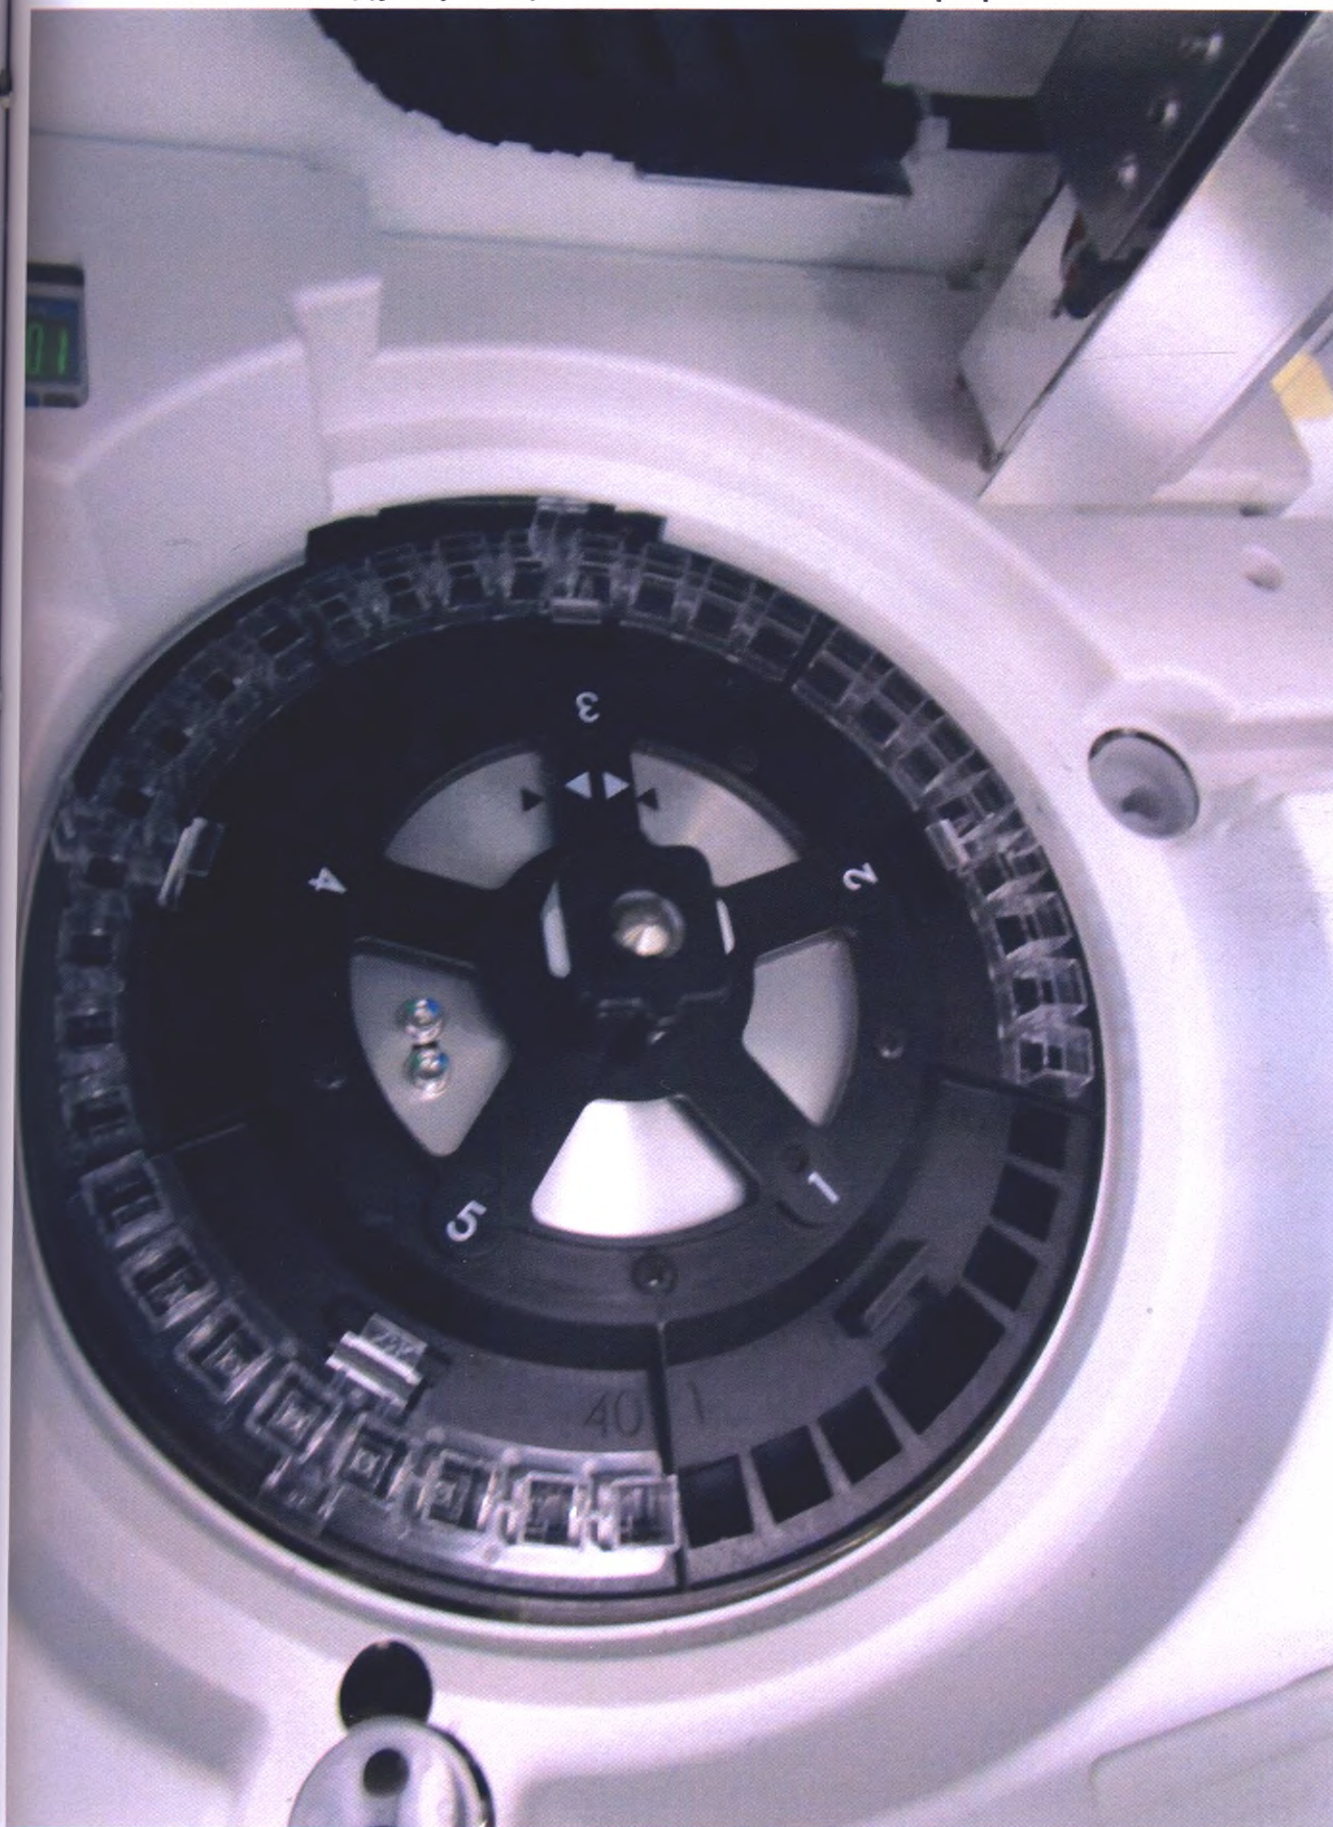


19.Модуль реакционного столика – Фотография 3

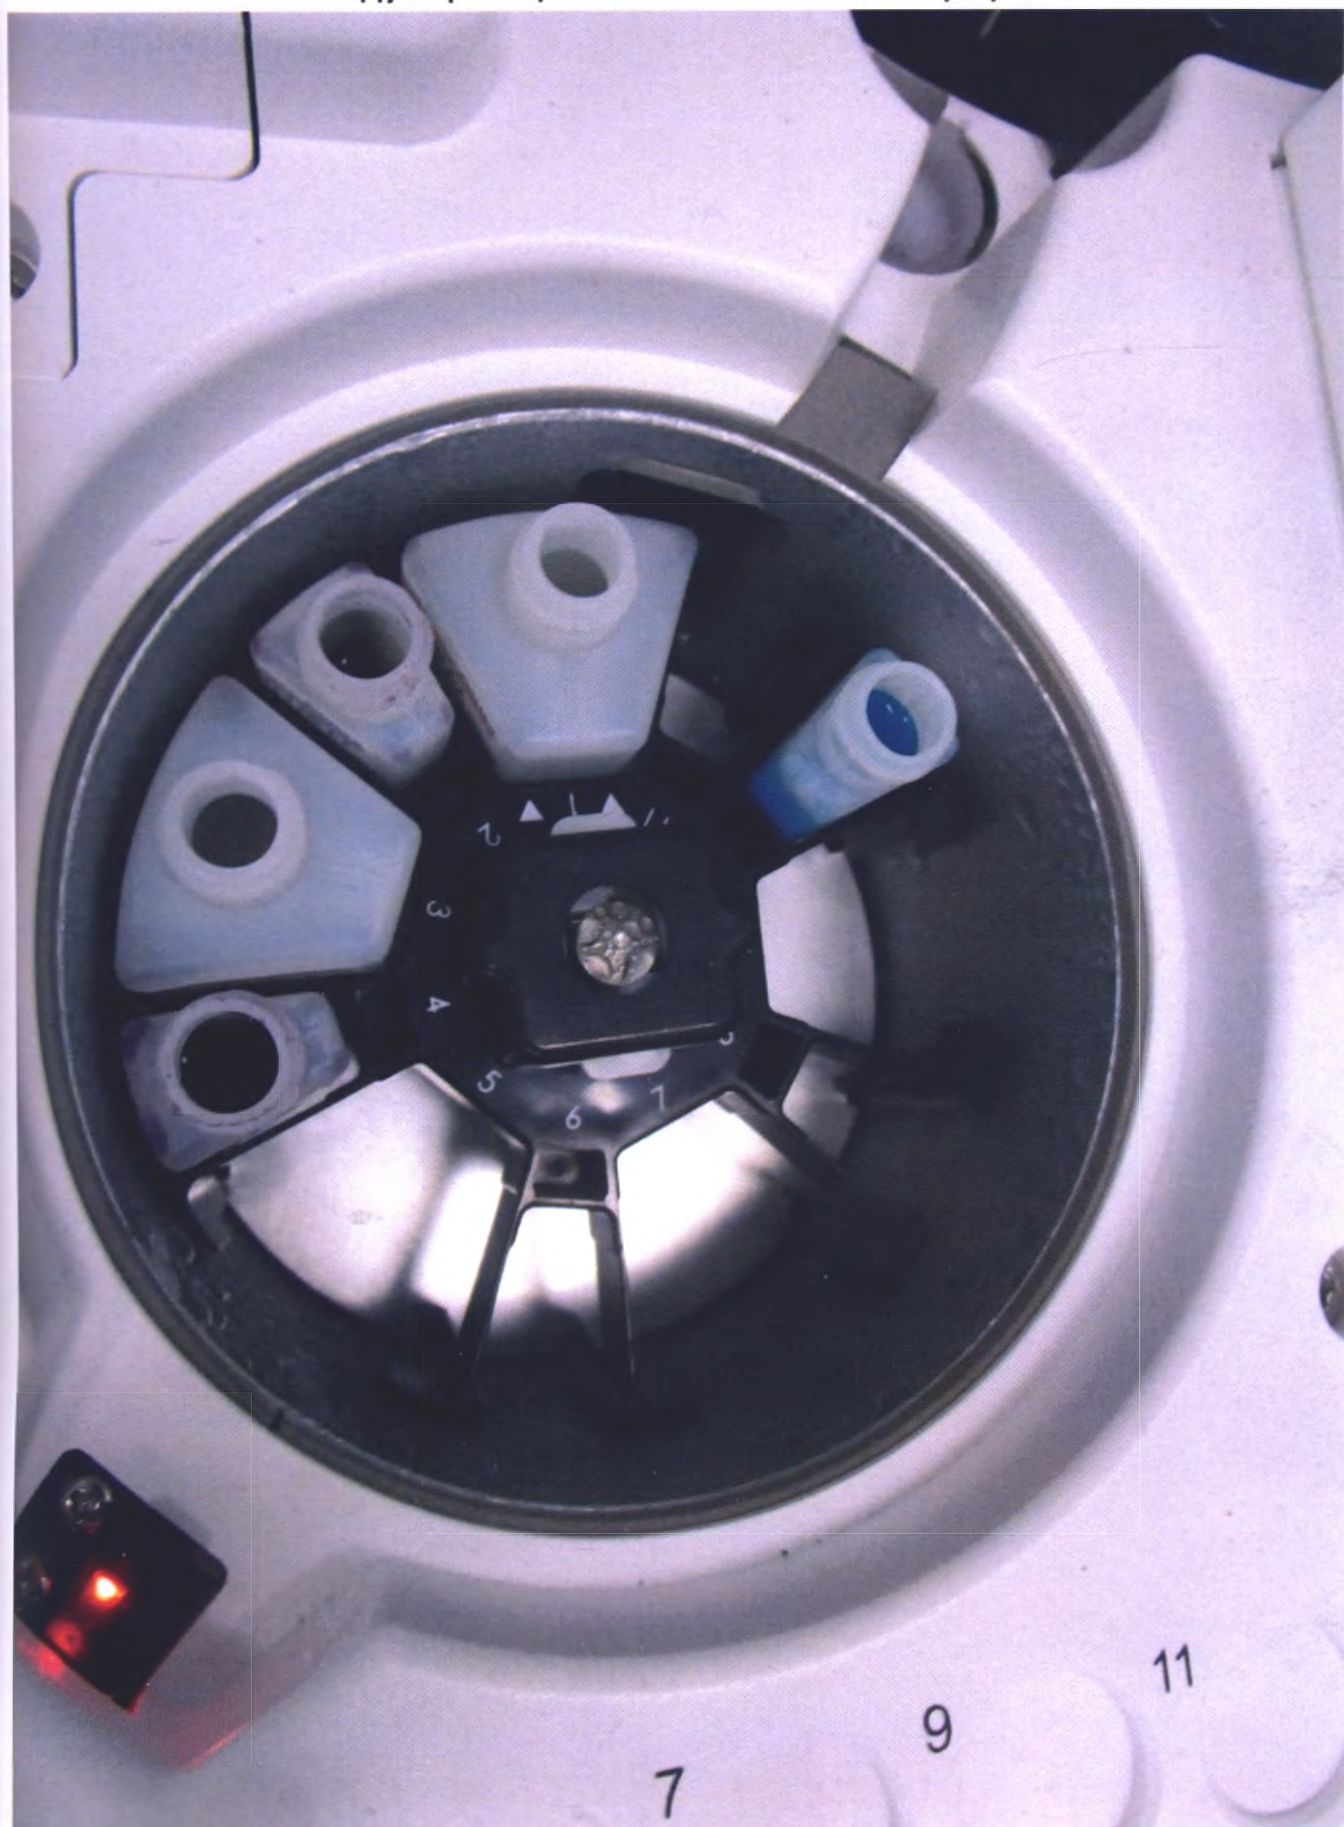


20. Модуль реакционного столика – Фотография 4

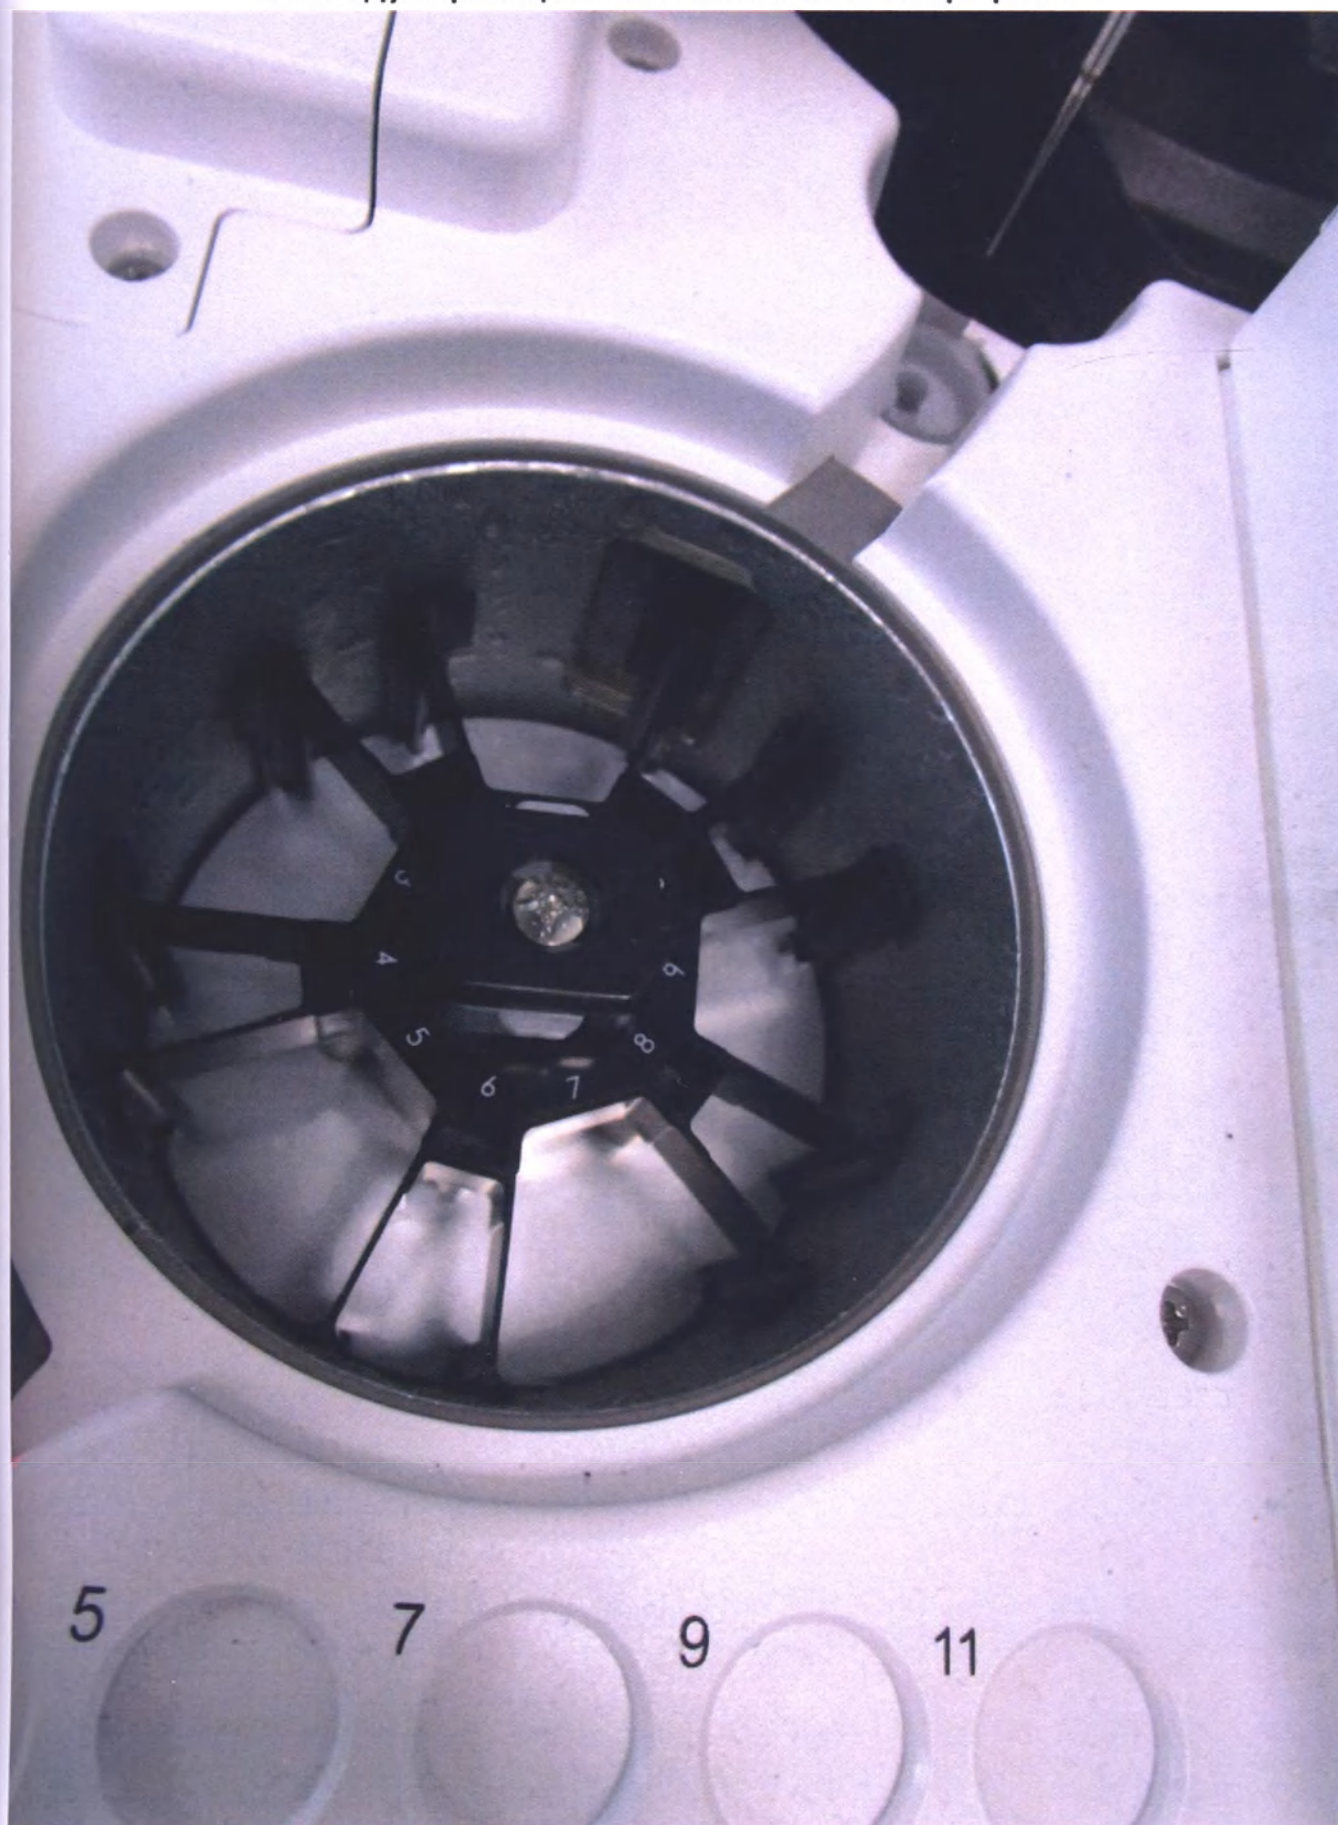


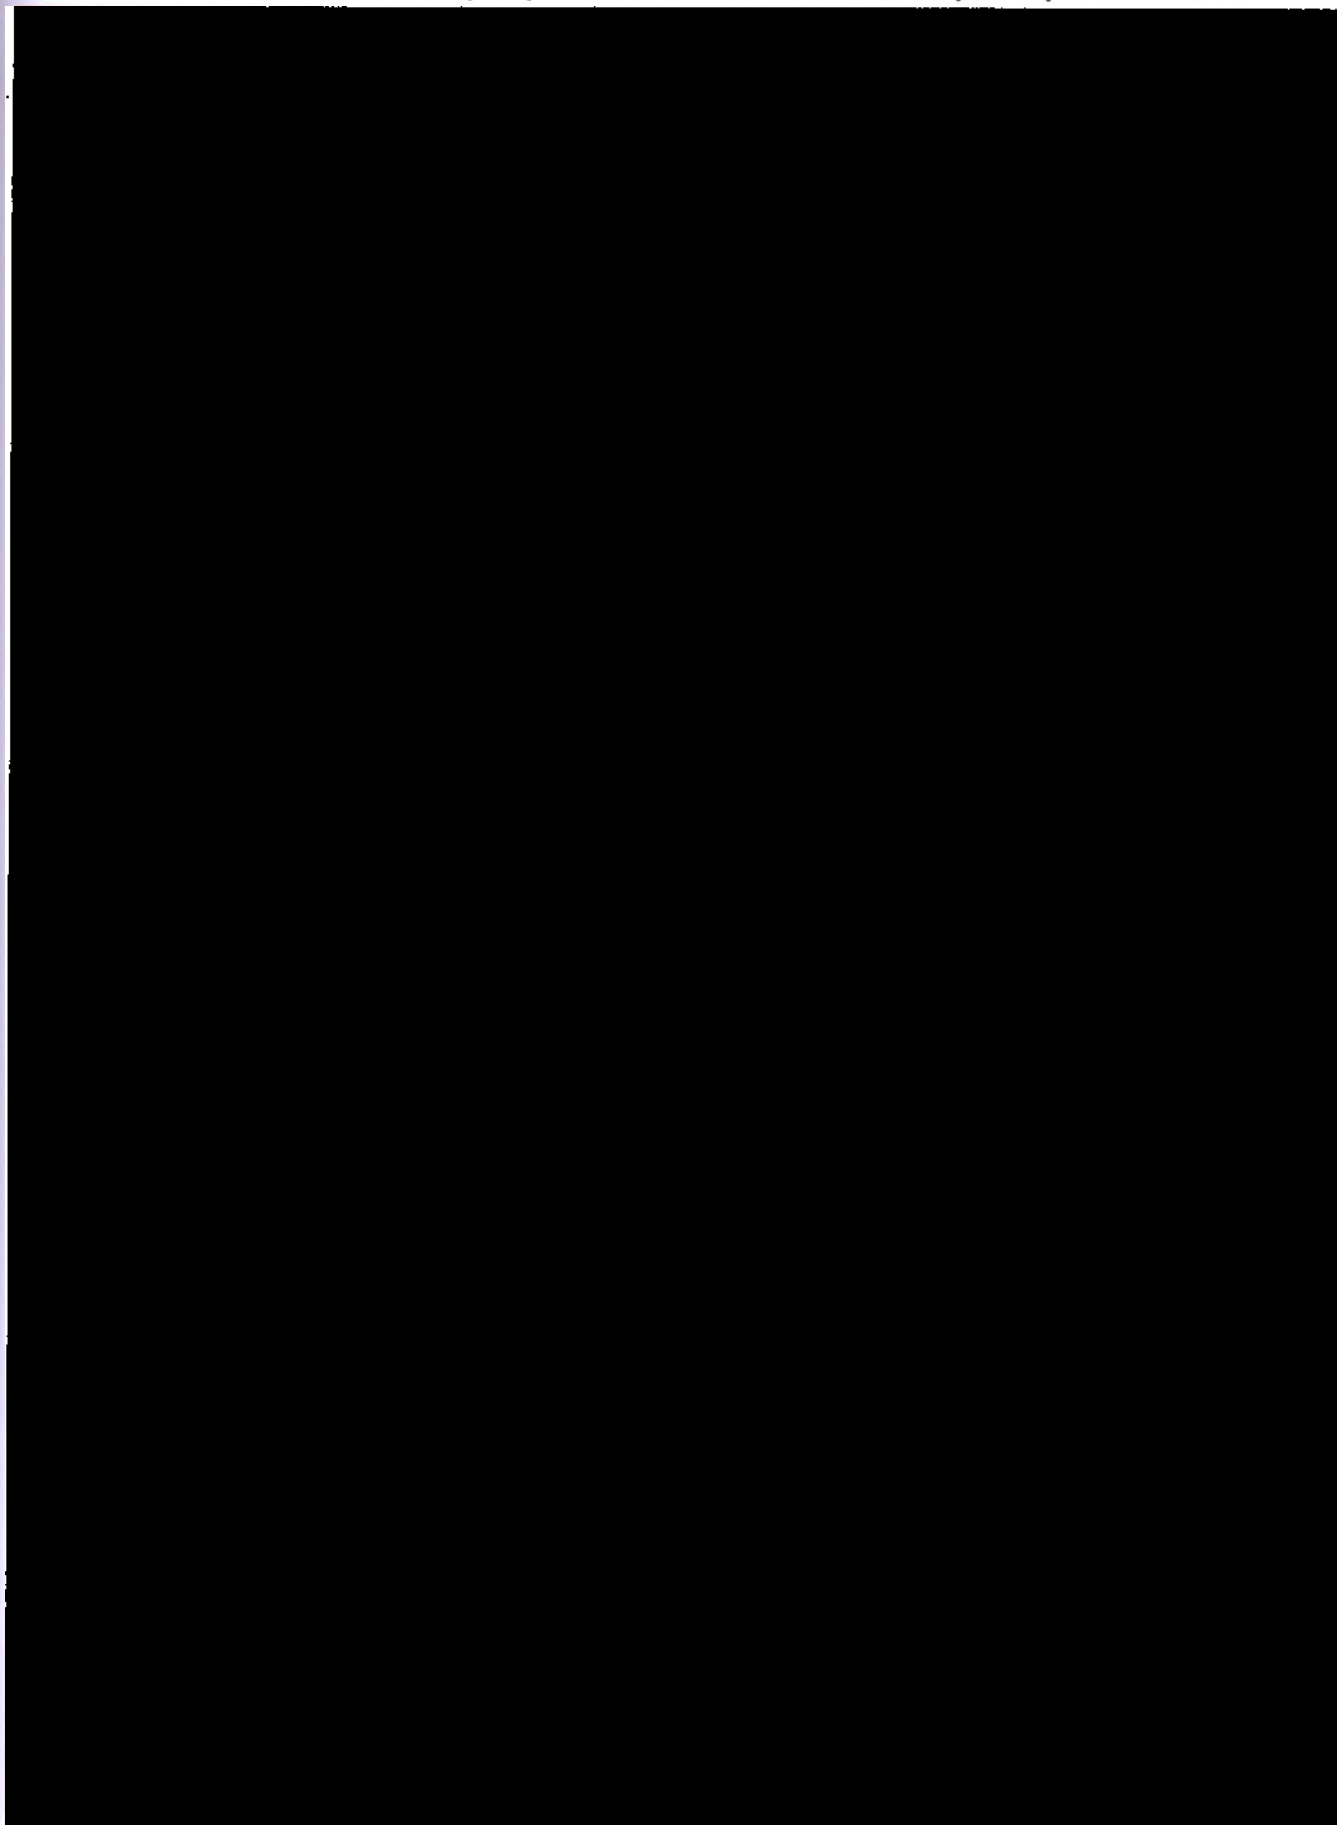


22.Маркировка с номинальными характеристиками

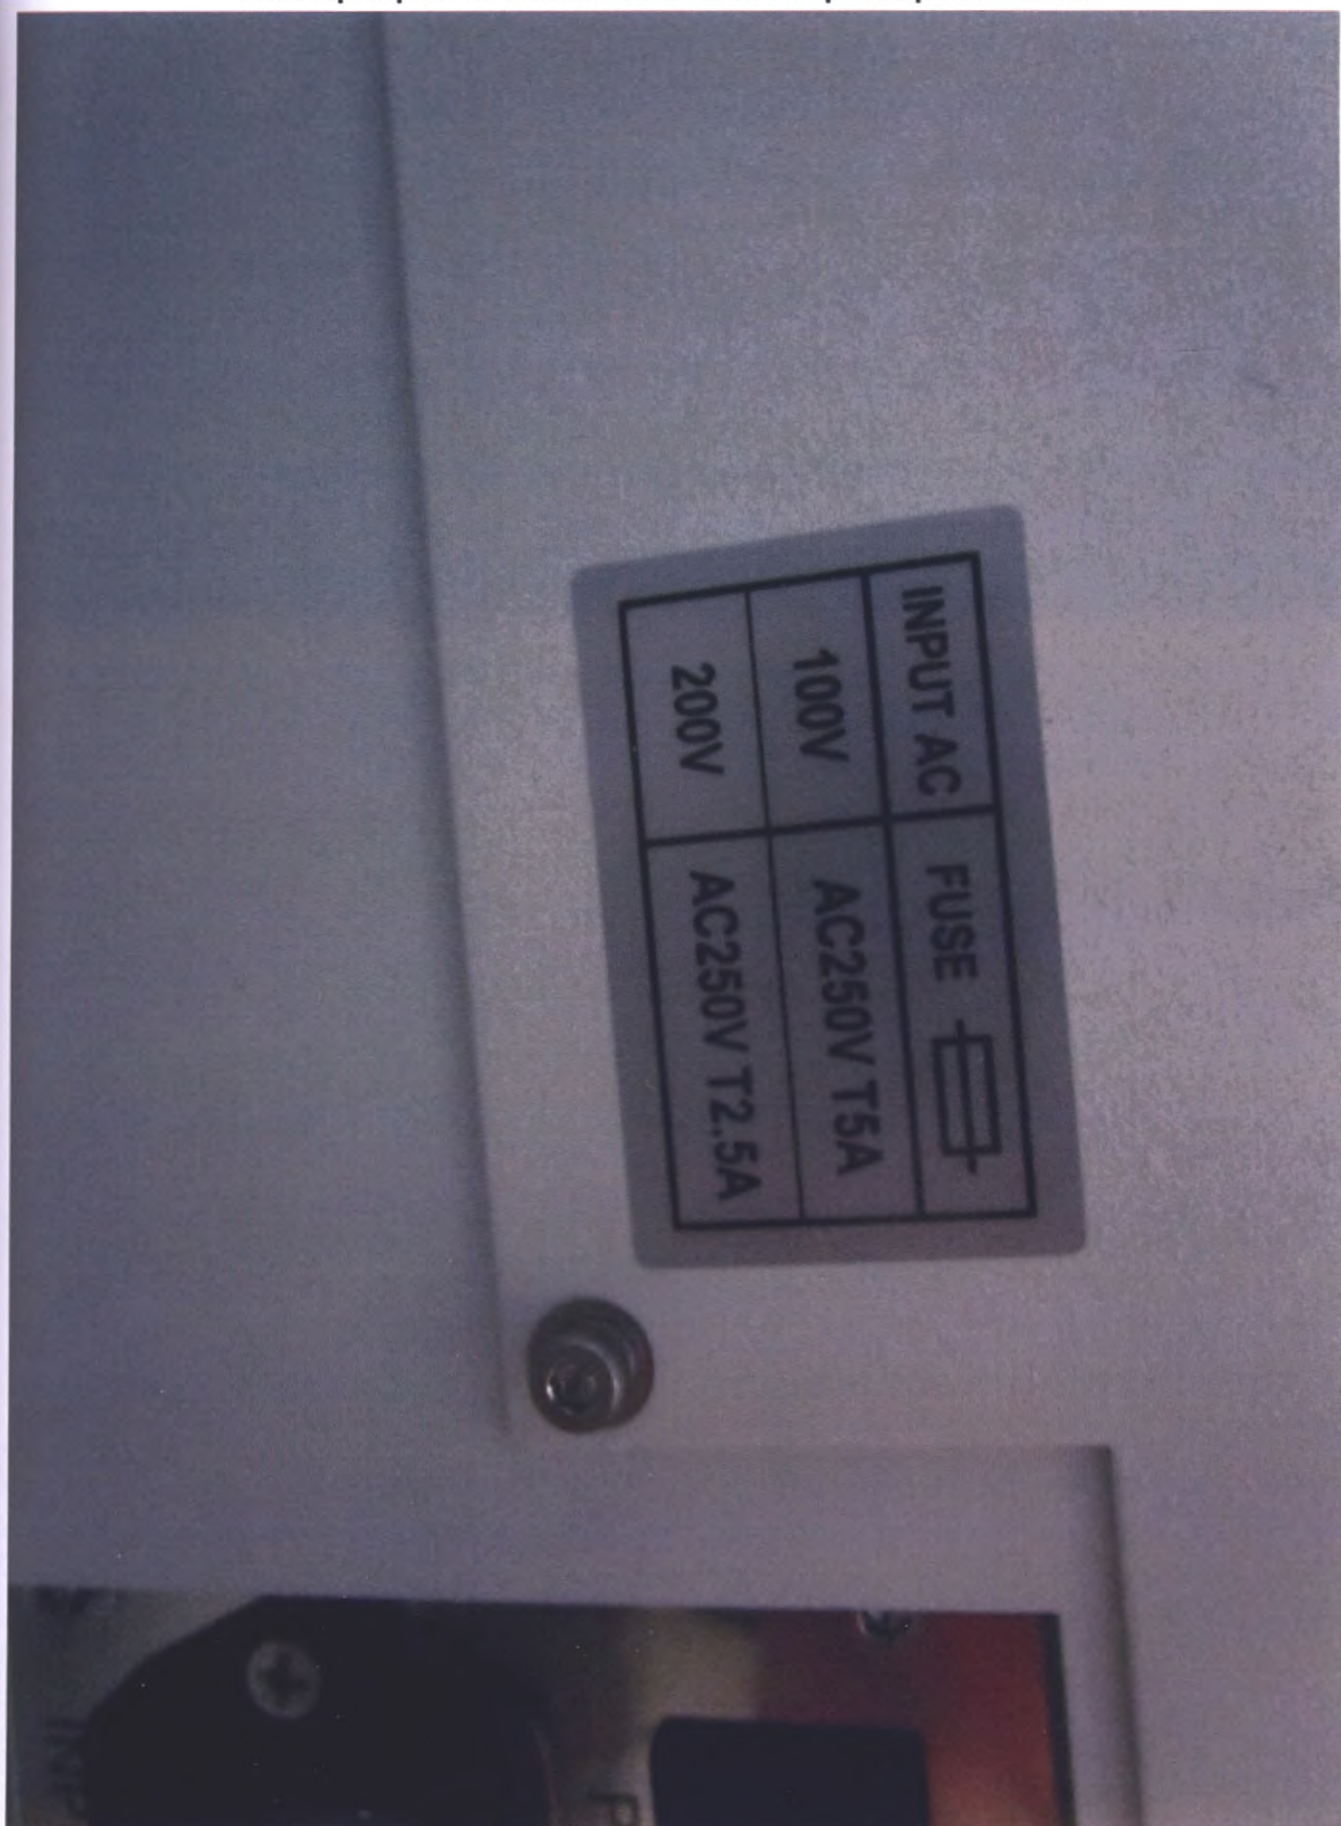


23.Штативы для контейнеров для сбора образцов

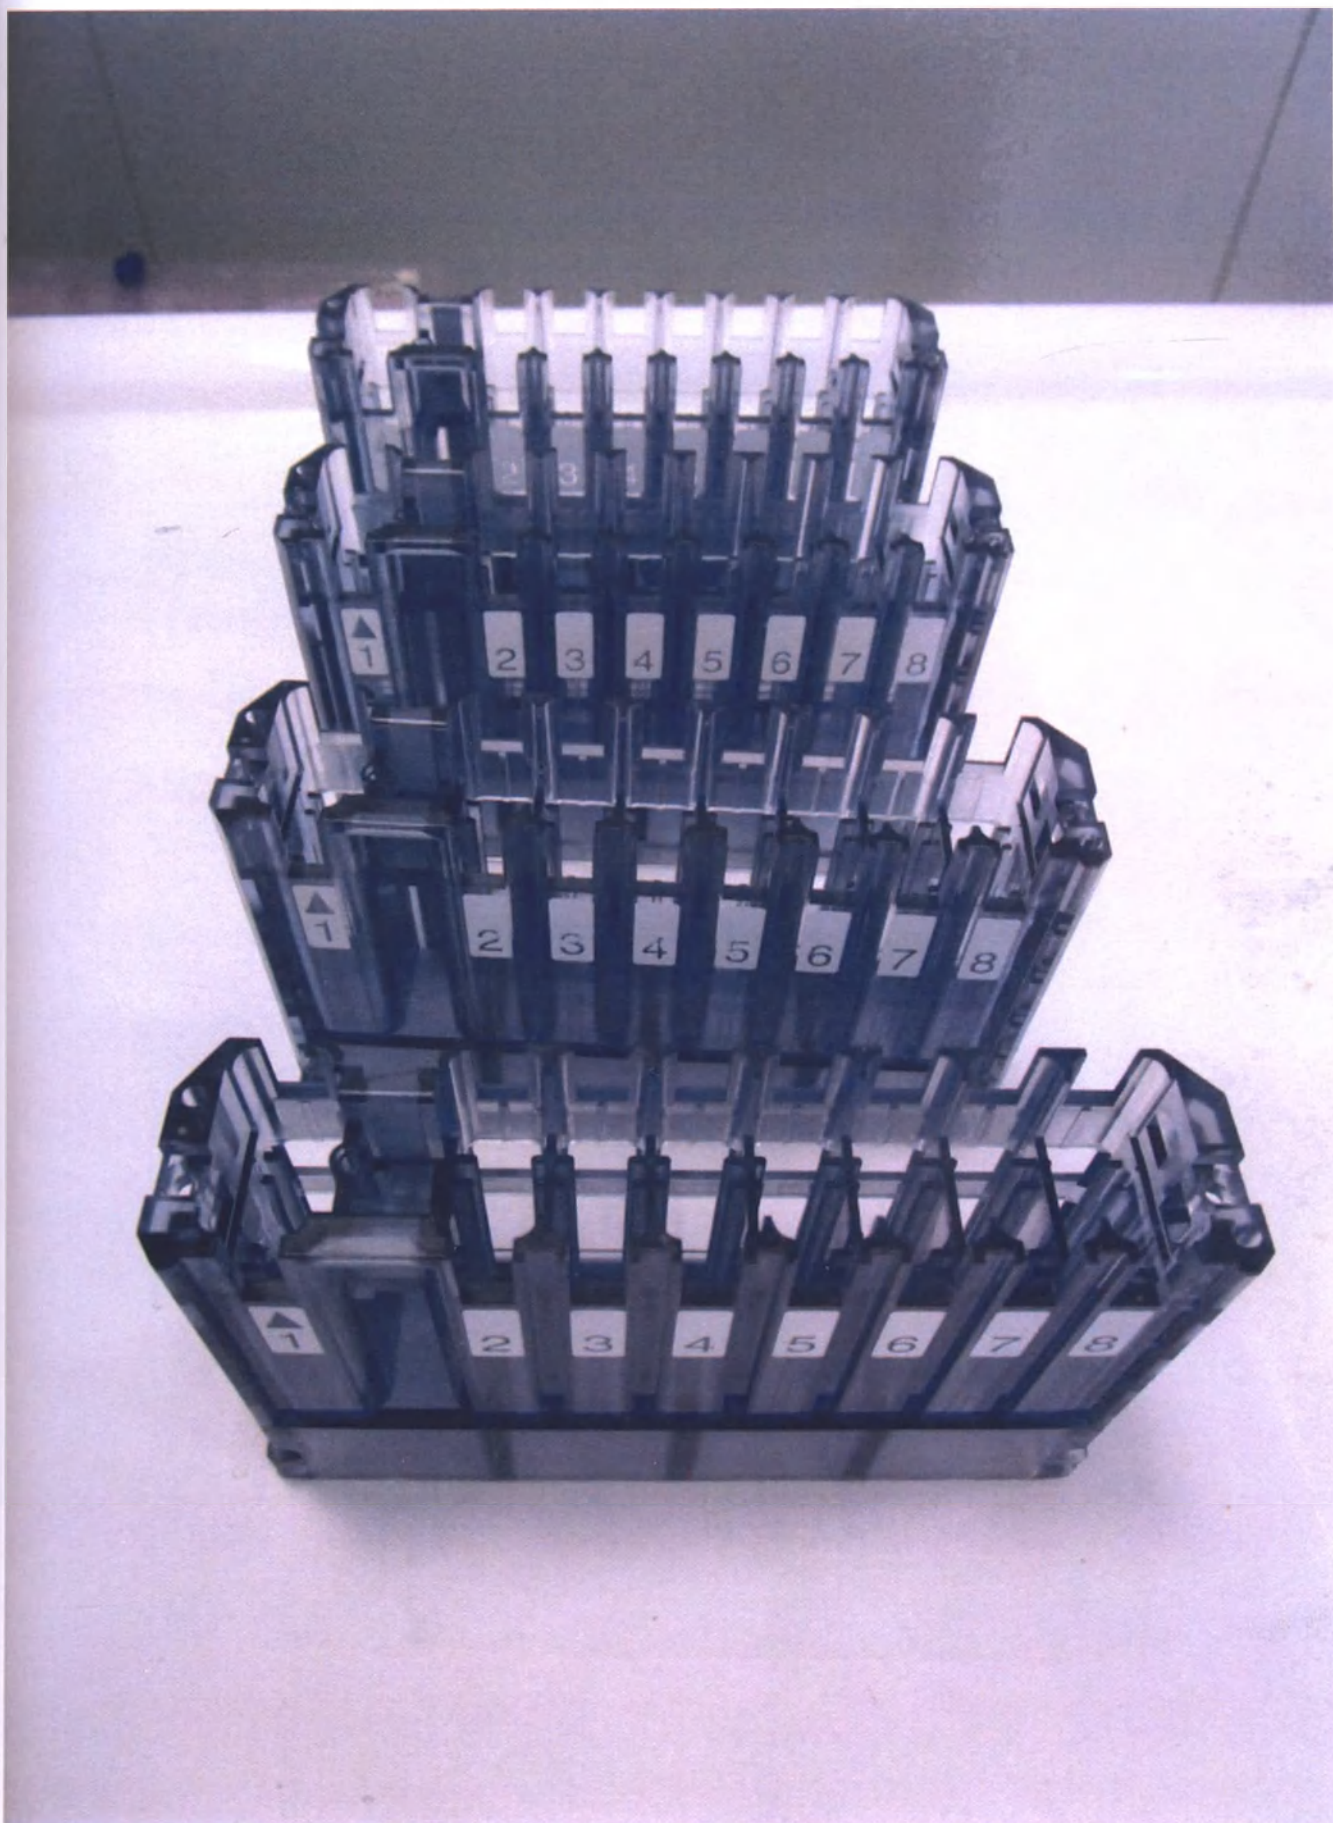


24.Штатив для контейнеров для сбора образцов (малый) – Вид спереди

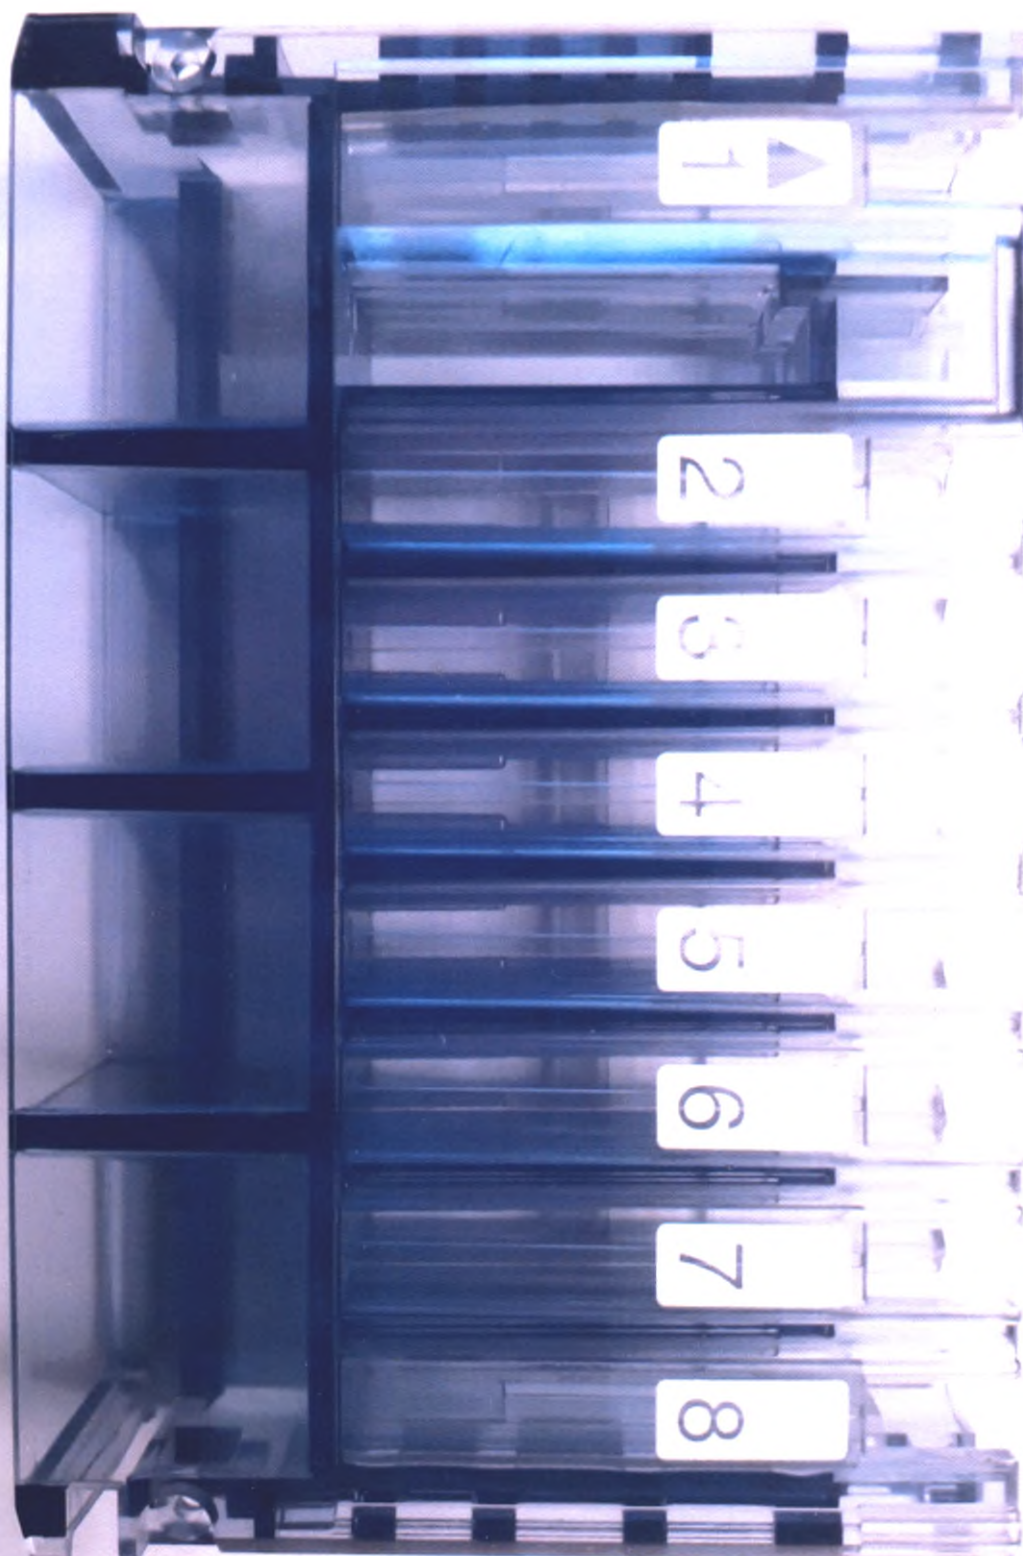


25.Штатив для контейнеров для сбора образцов (малый) - Вид сзади

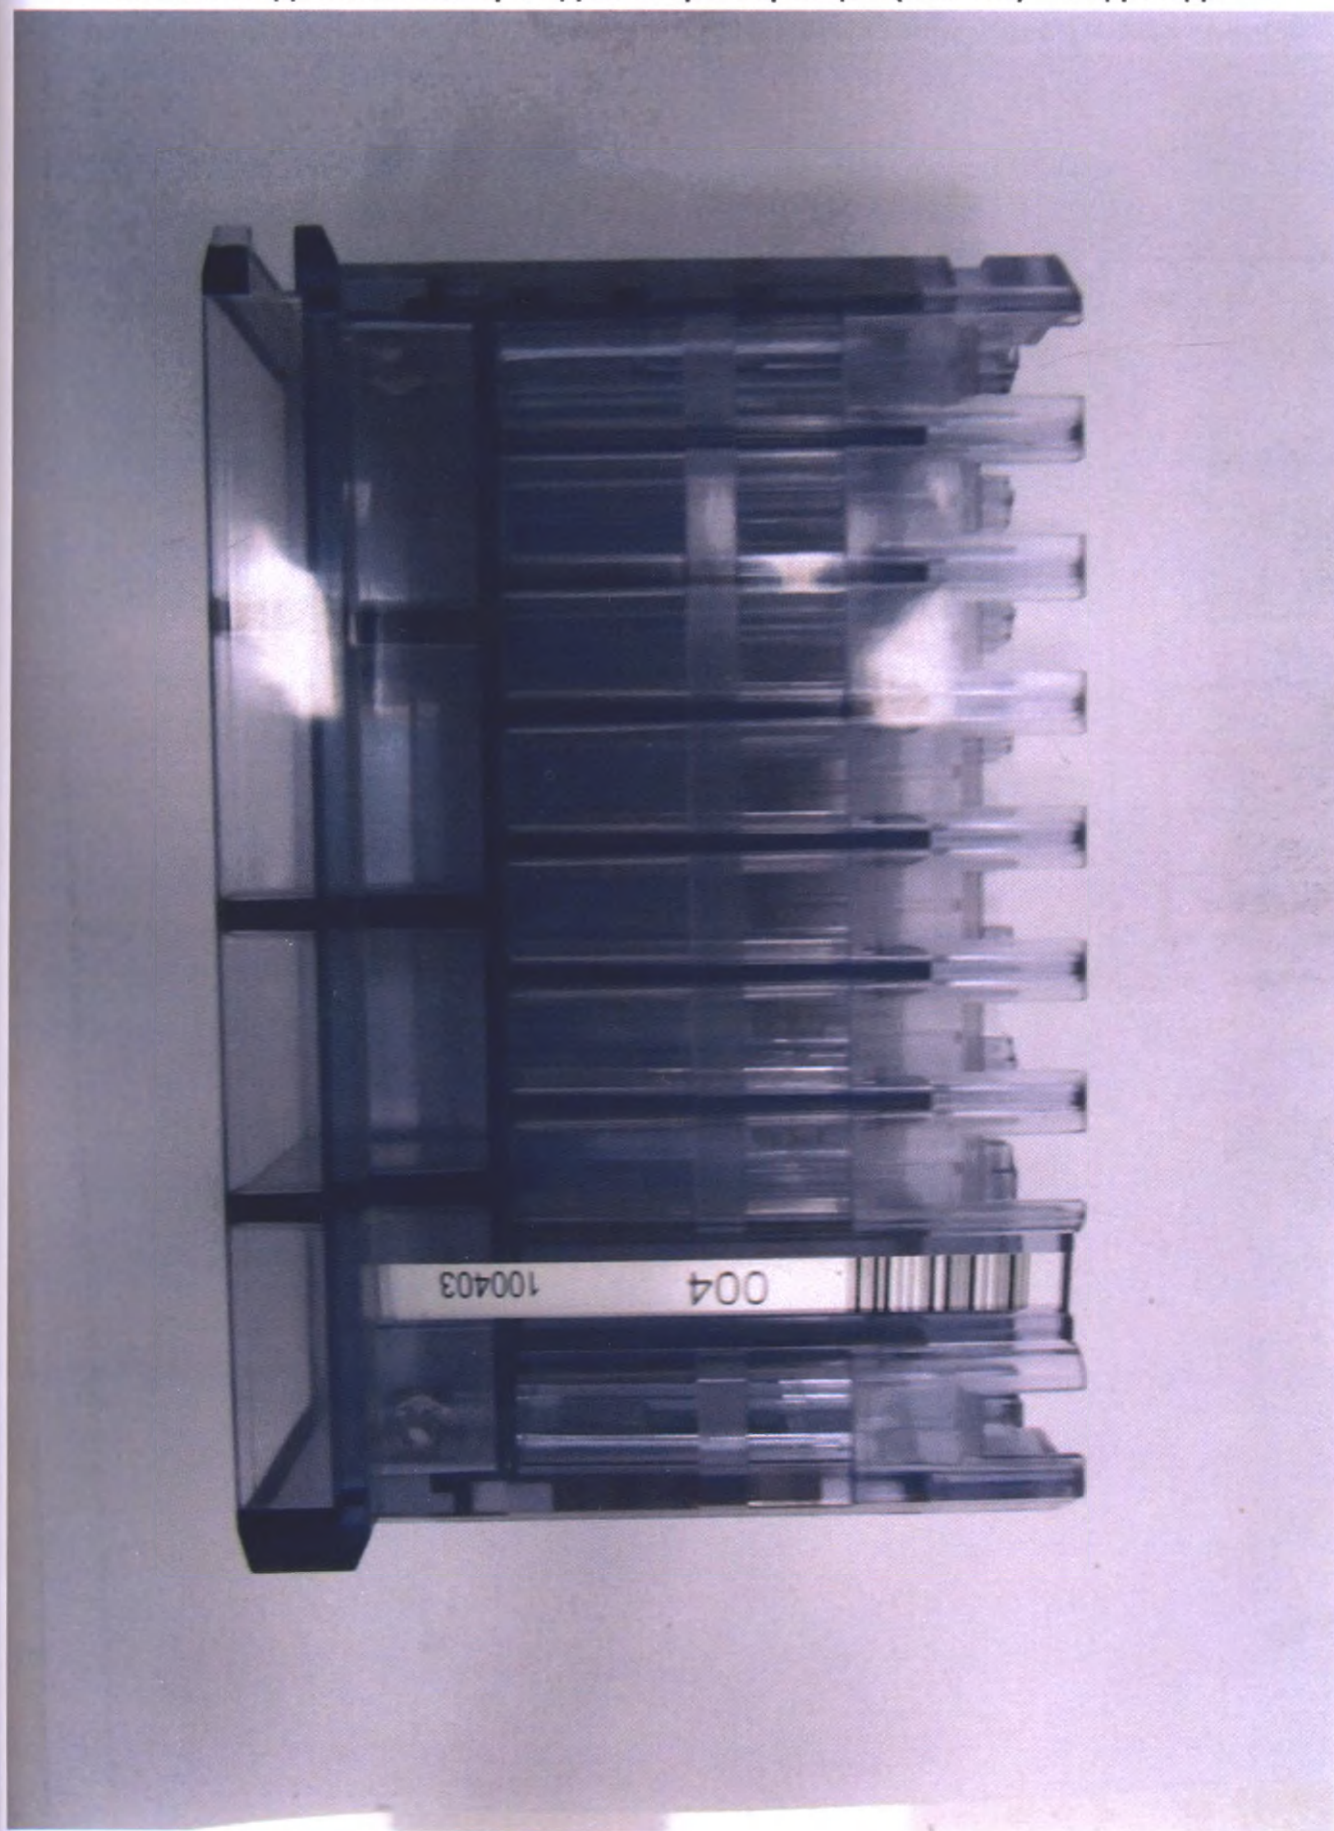


26.Штатив для калибраторов/контролей для метода с автоматическим разбавлением для метода с автоматическим разбавлением 1 – Вид сверху

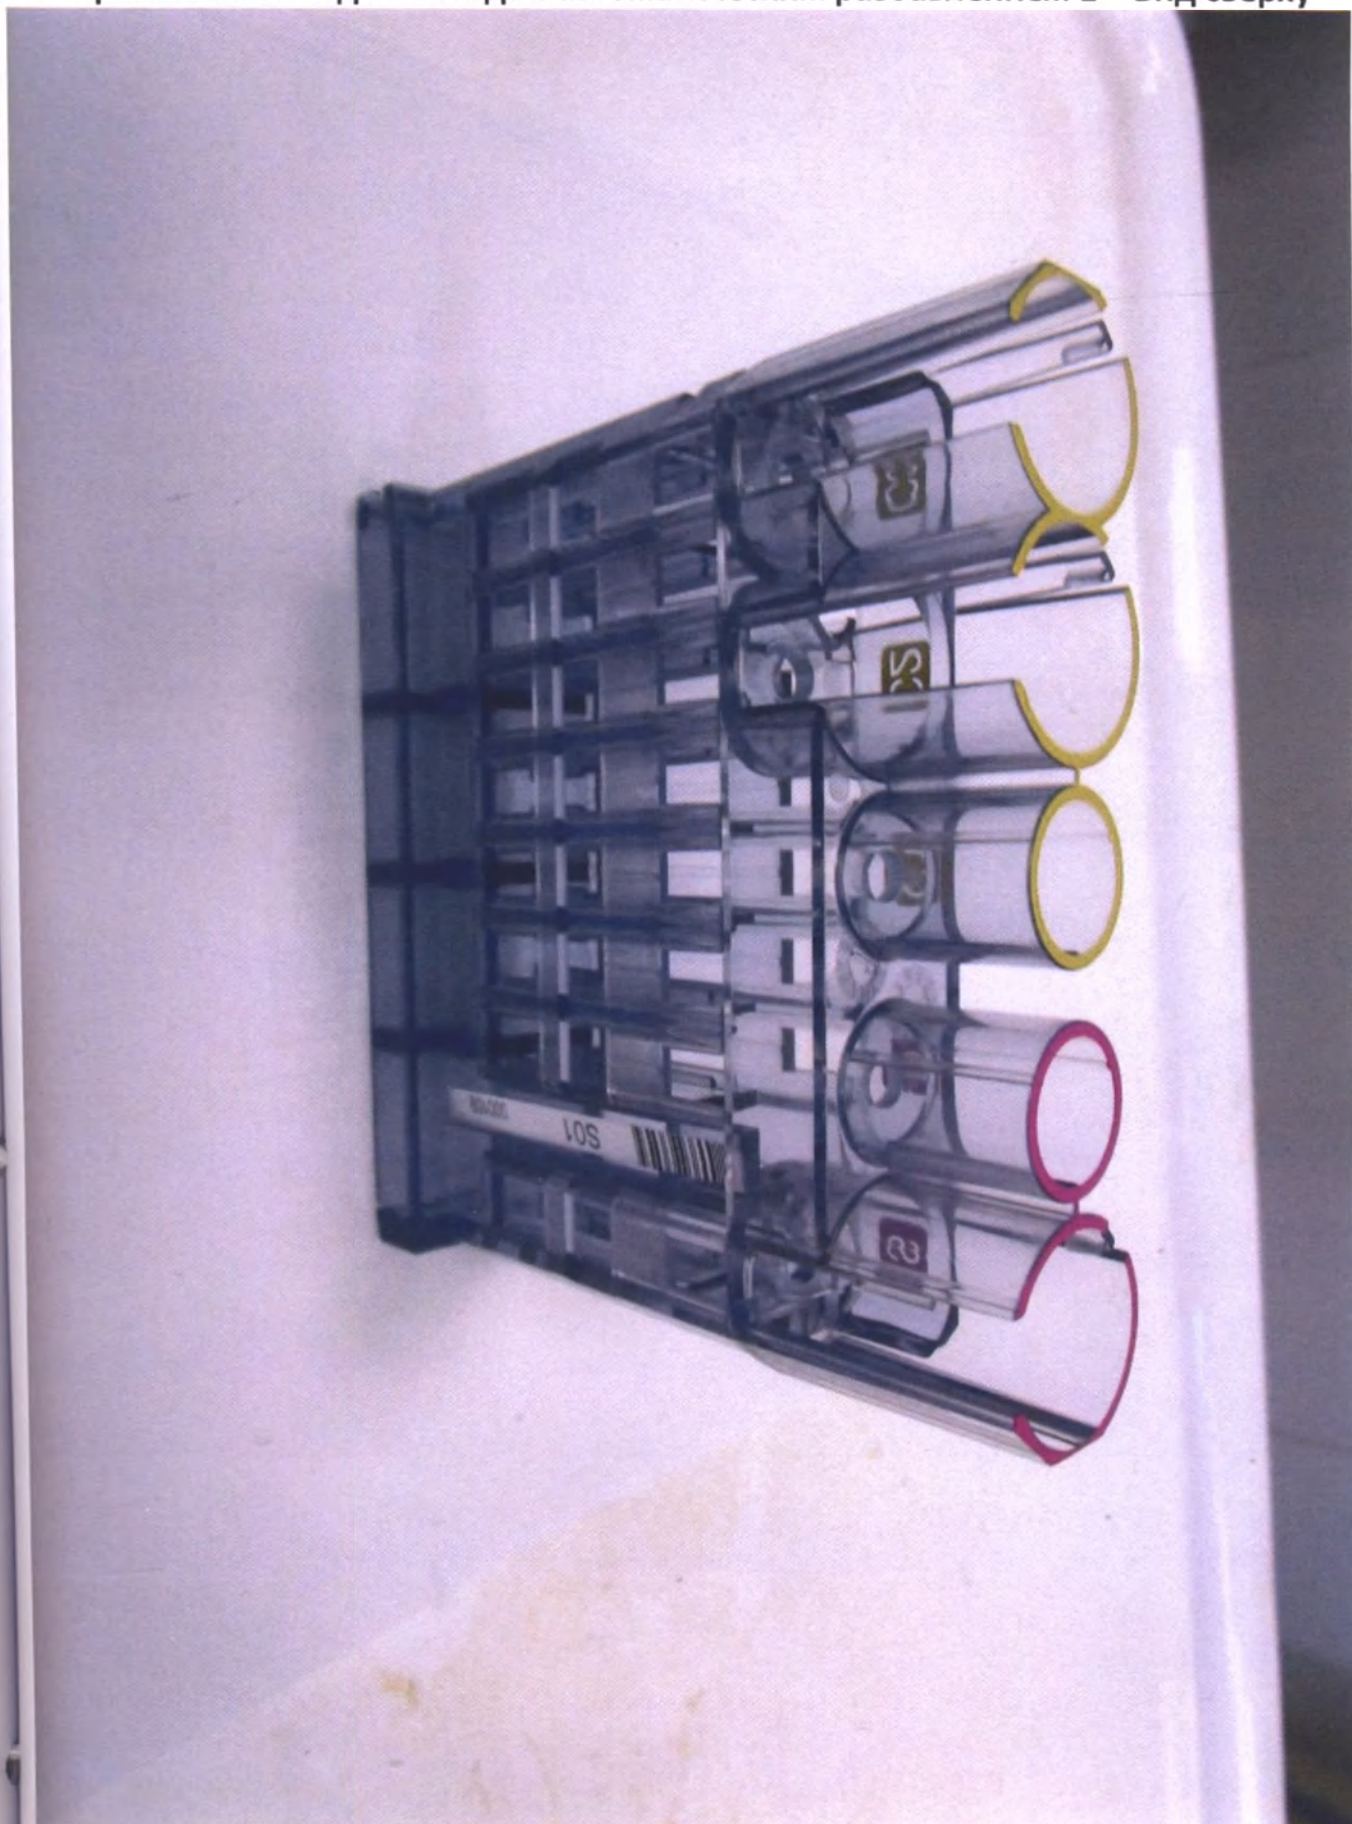


27.Штатив для калибраторов/контролей для метода с автоматическим разбавлением для метода с автоматическим разбавлением 2 – Вид сзади

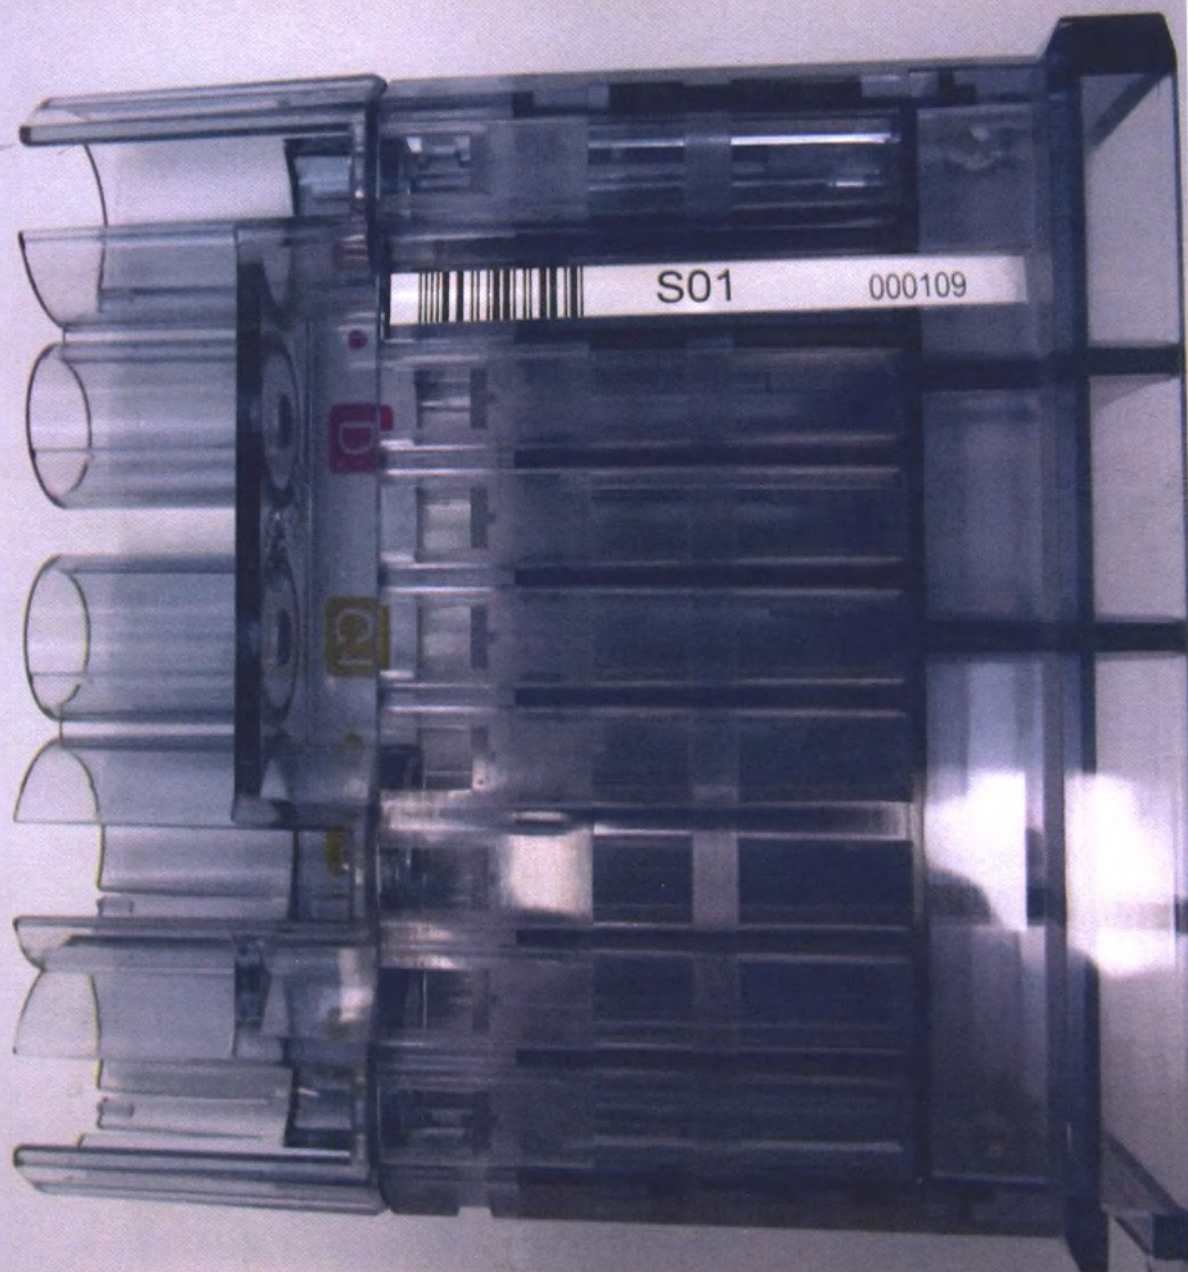


28.Штатив для калибраторов/контролей для метода с автоматическим разбавлением для метода с автоматическим разбавлением – Вид спереди

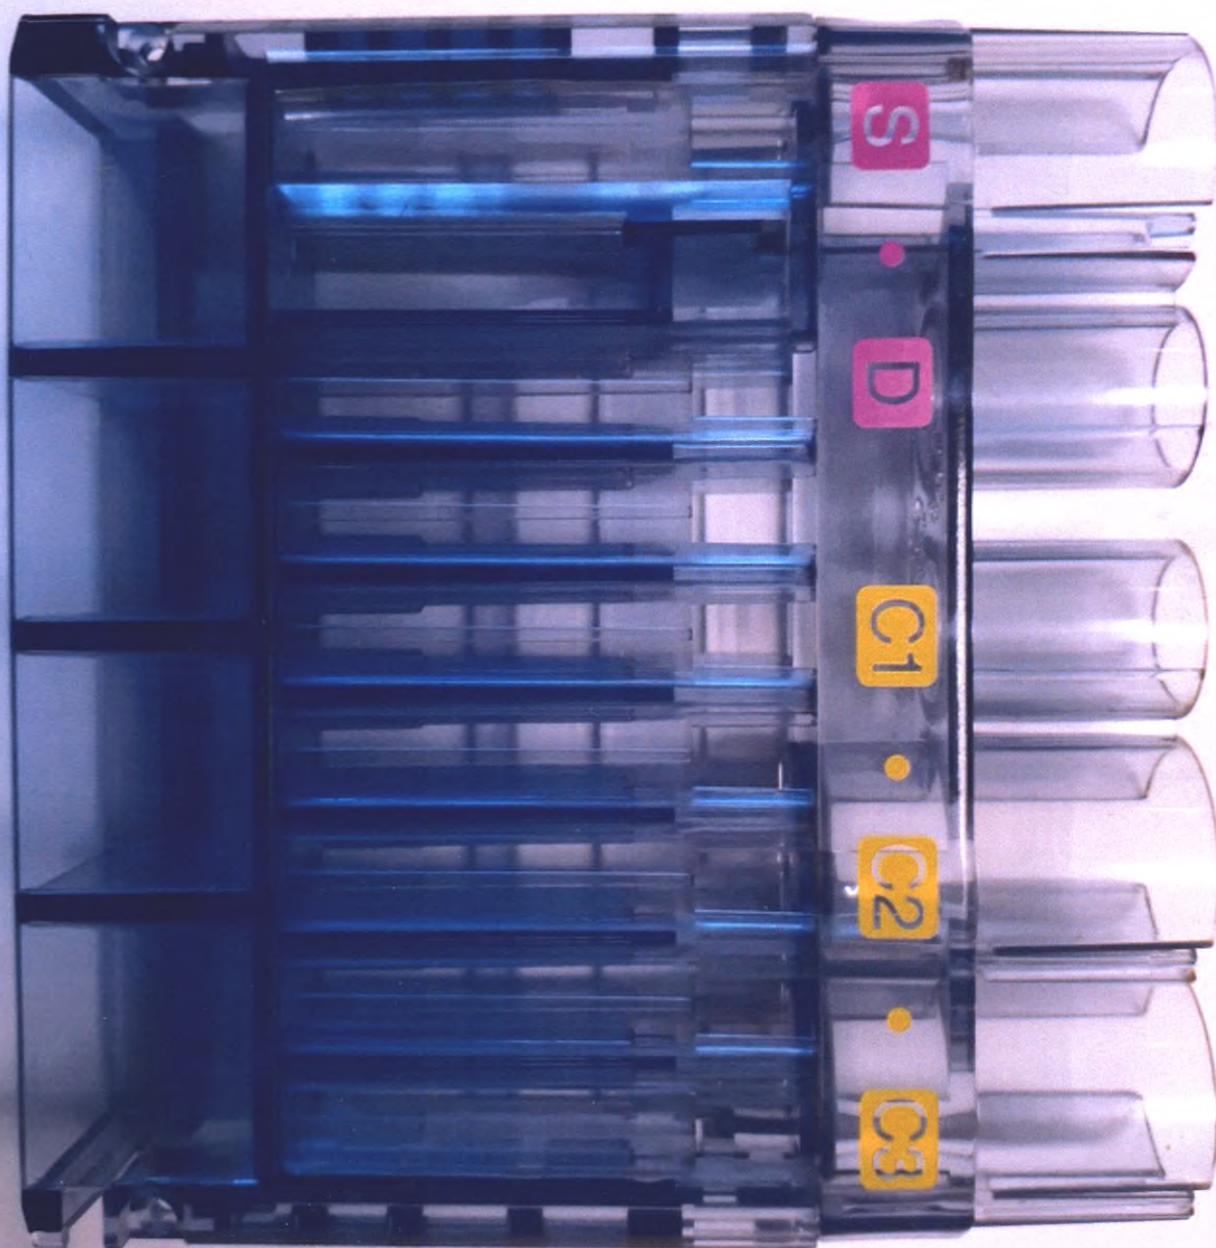


29. Емкость для промывающего раствора - Вид спереди

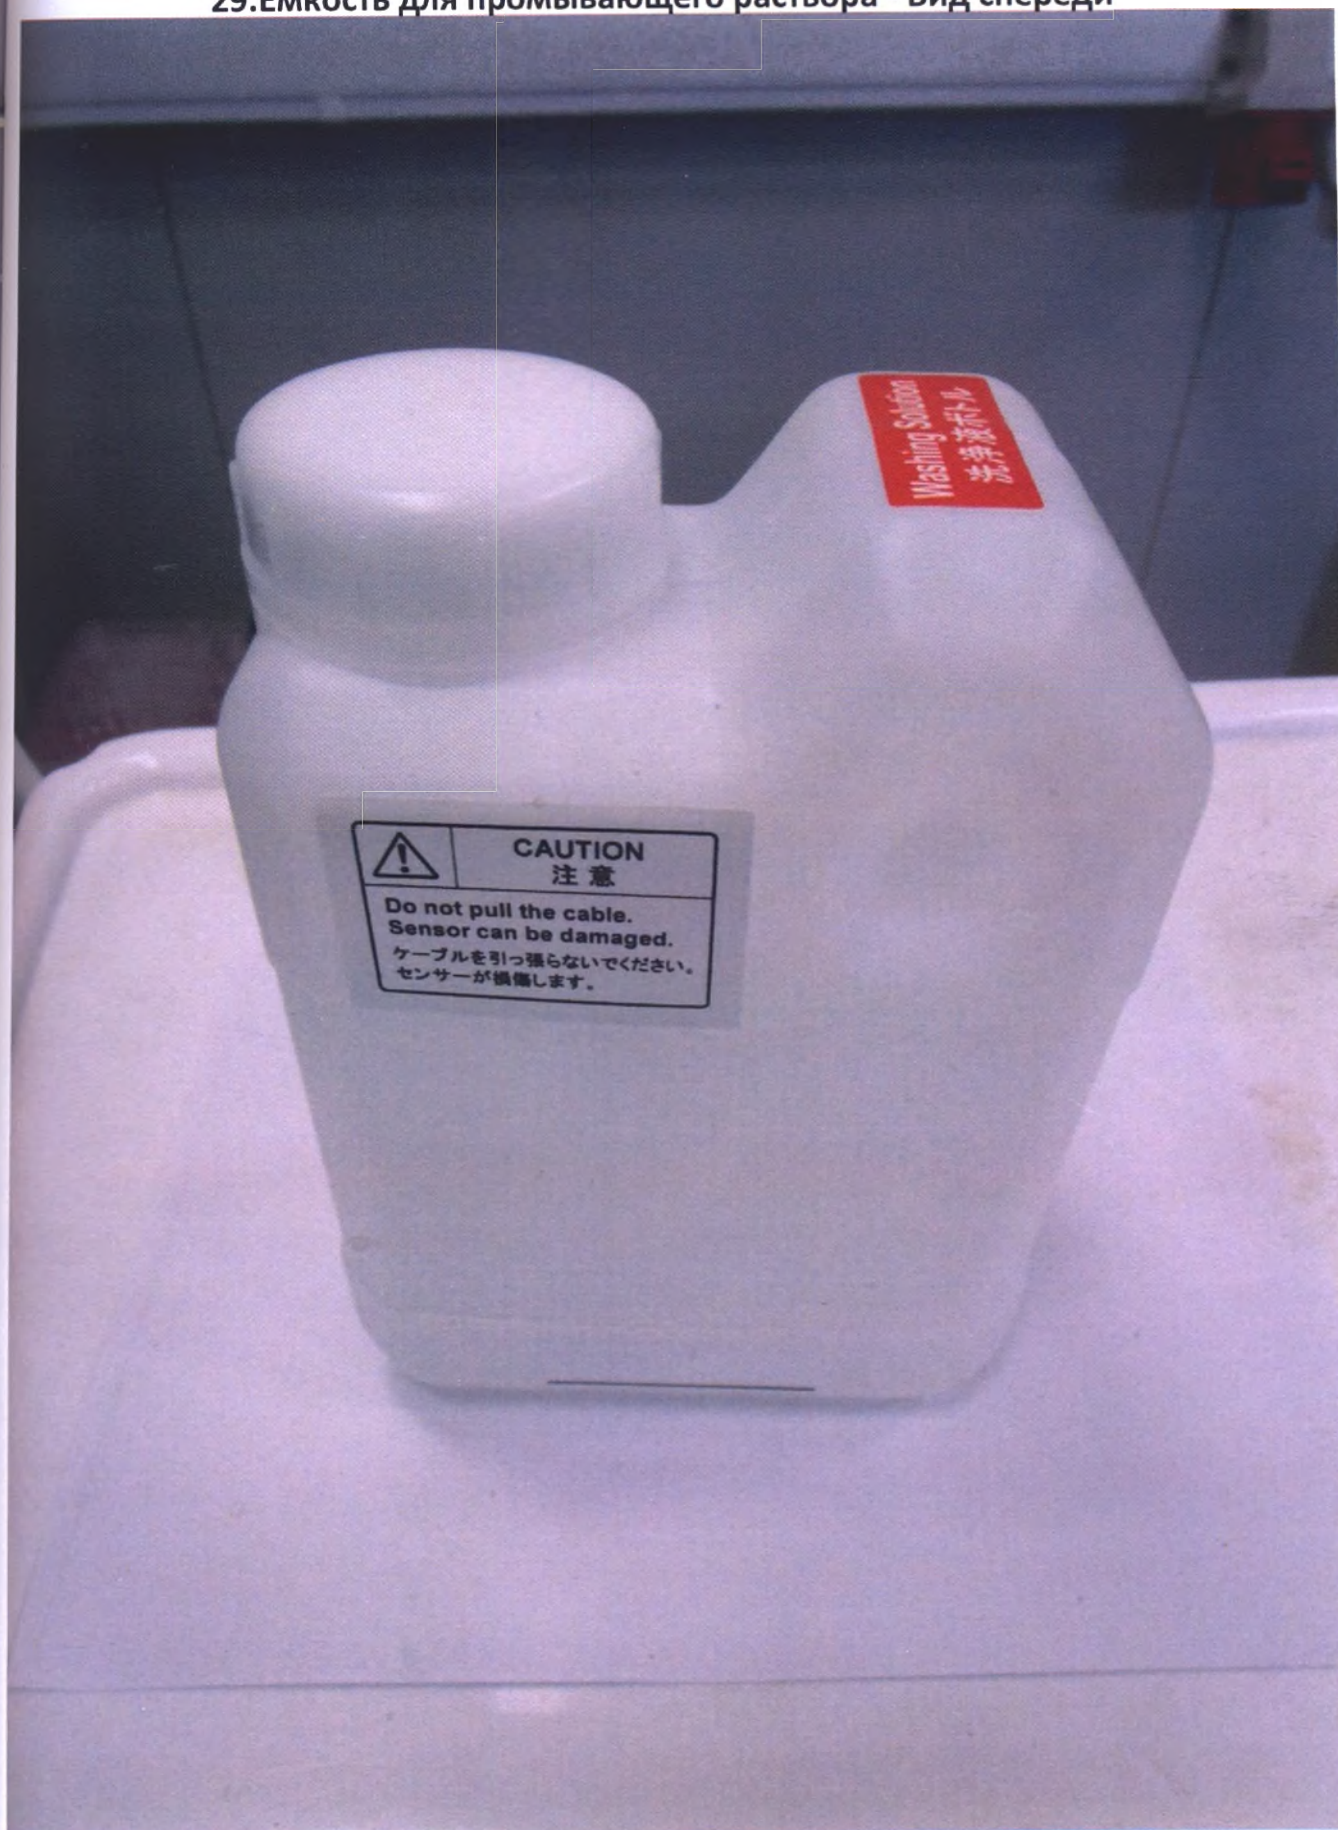


30. Емкость для промывающего раствора - Вид сзади

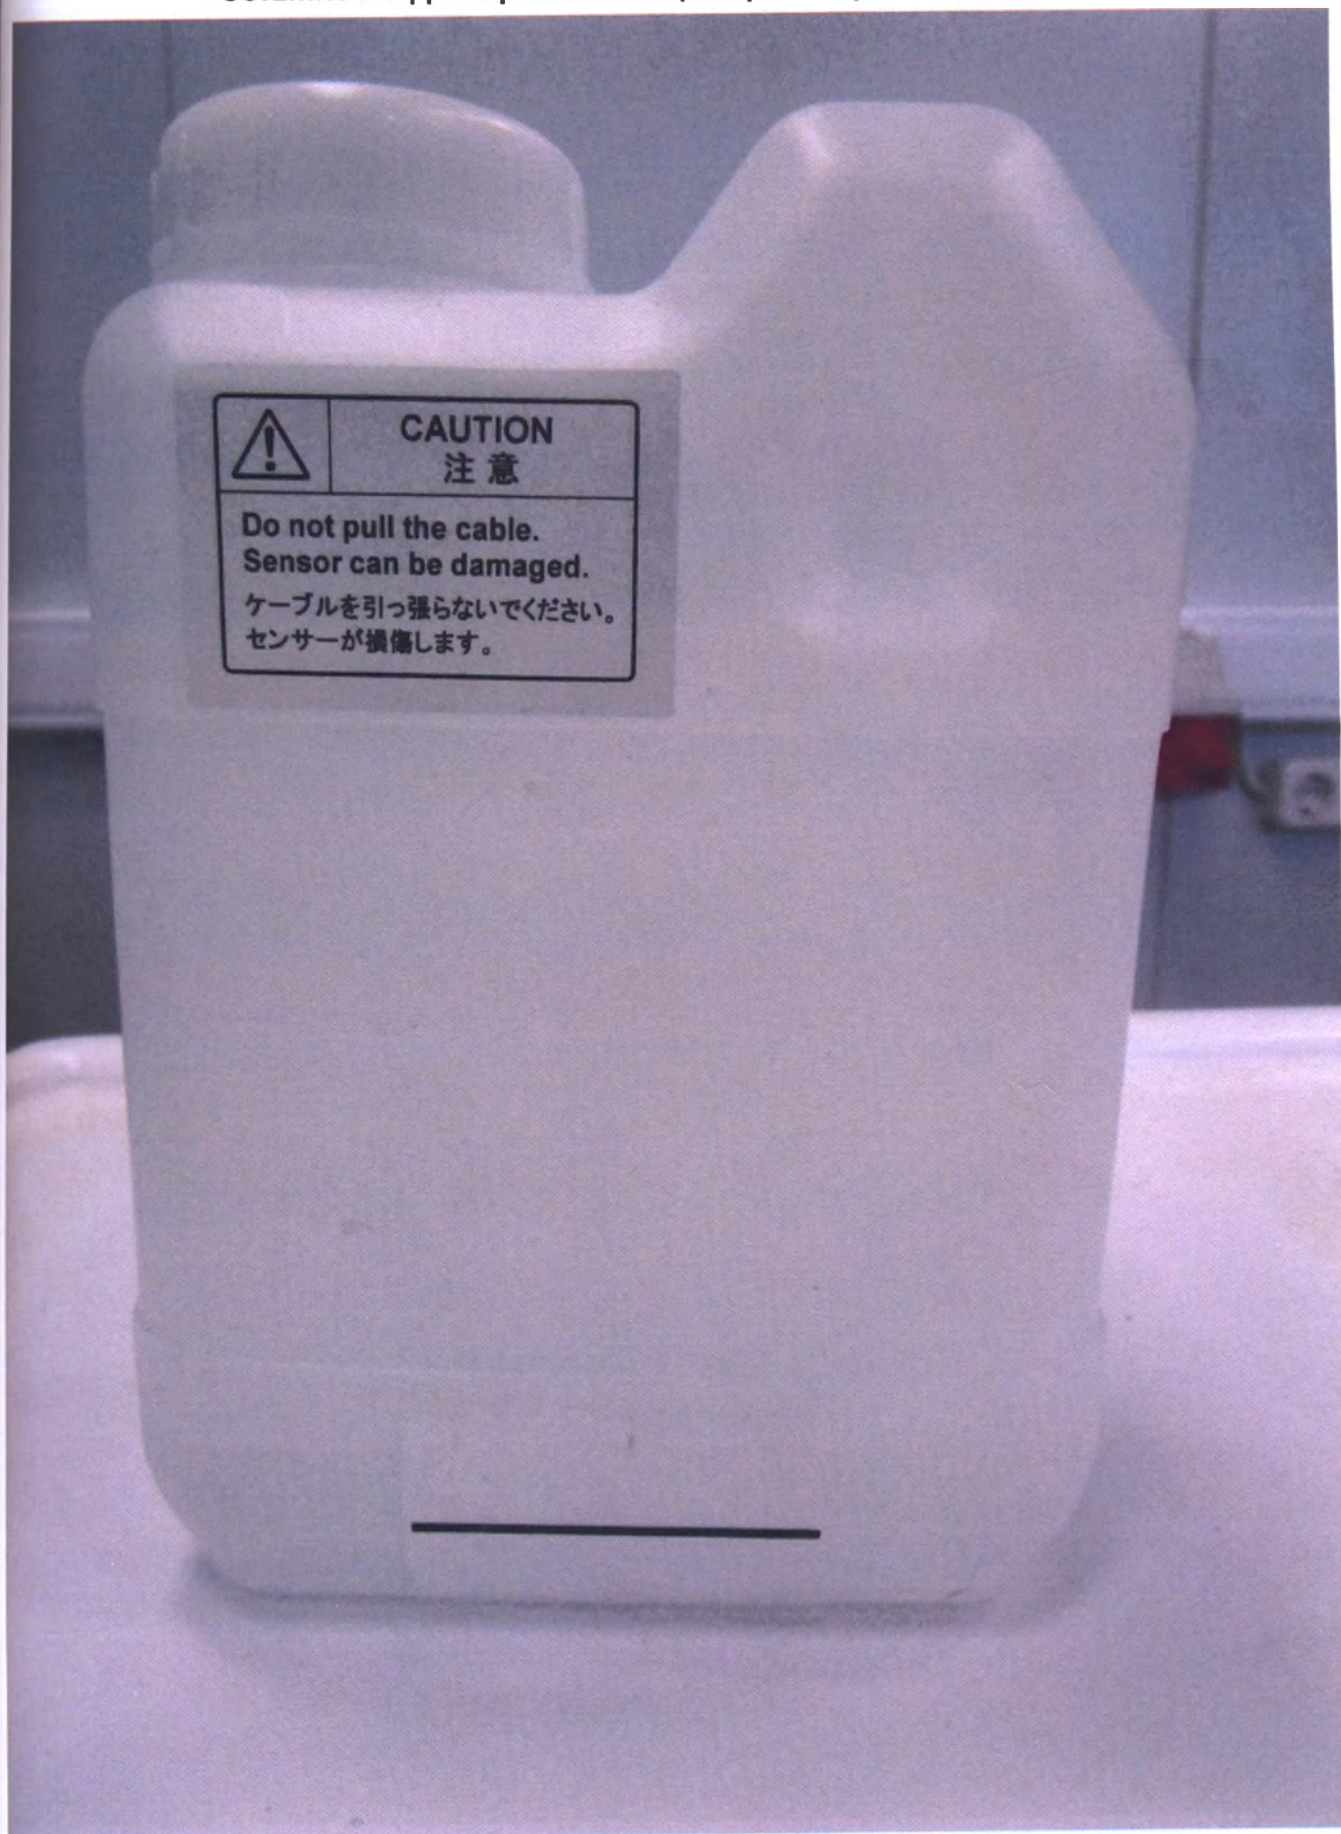

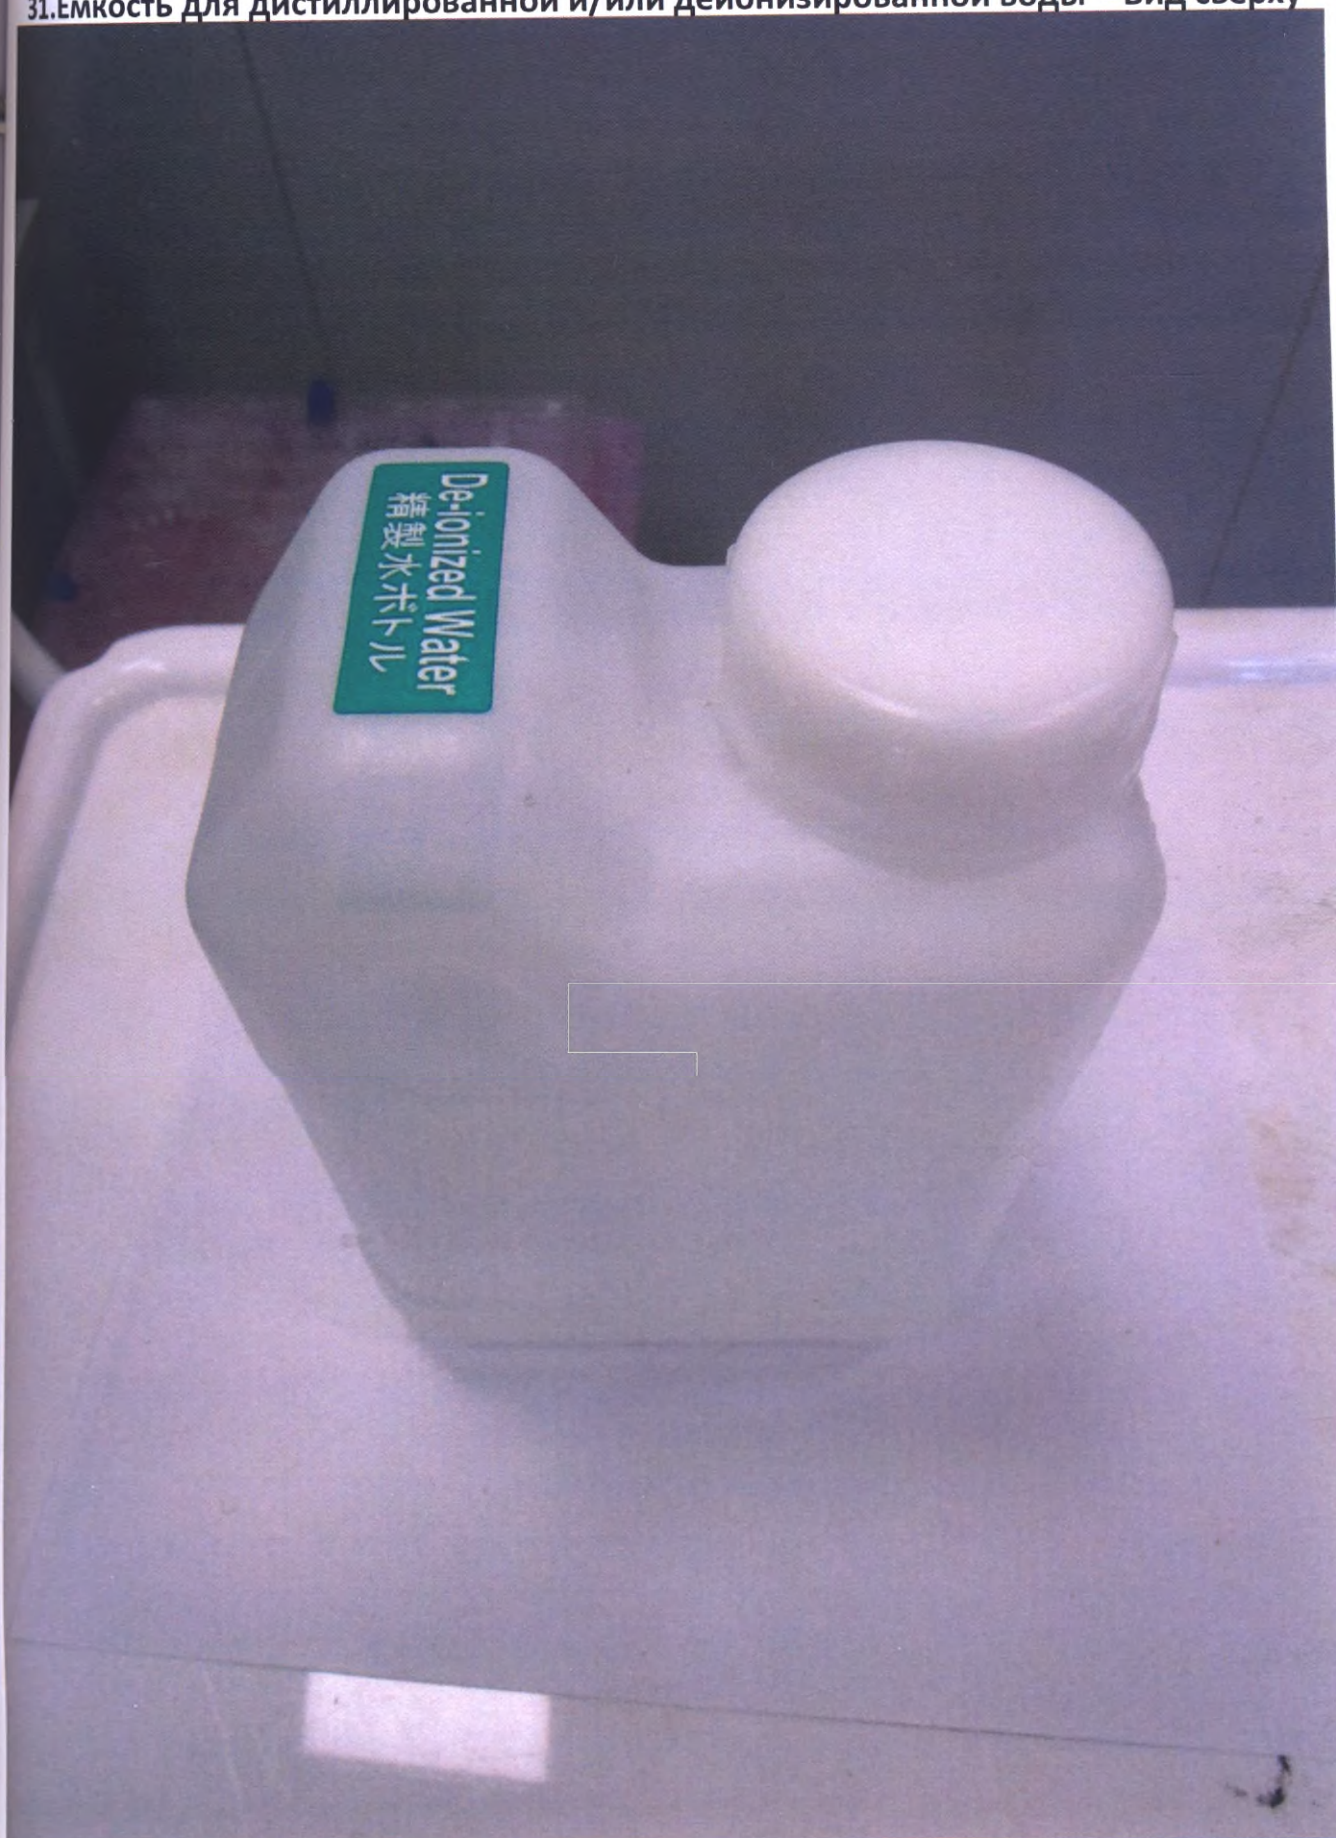




33. Емкость для дистиллированной и/или деионизированной воды - Вид сзади

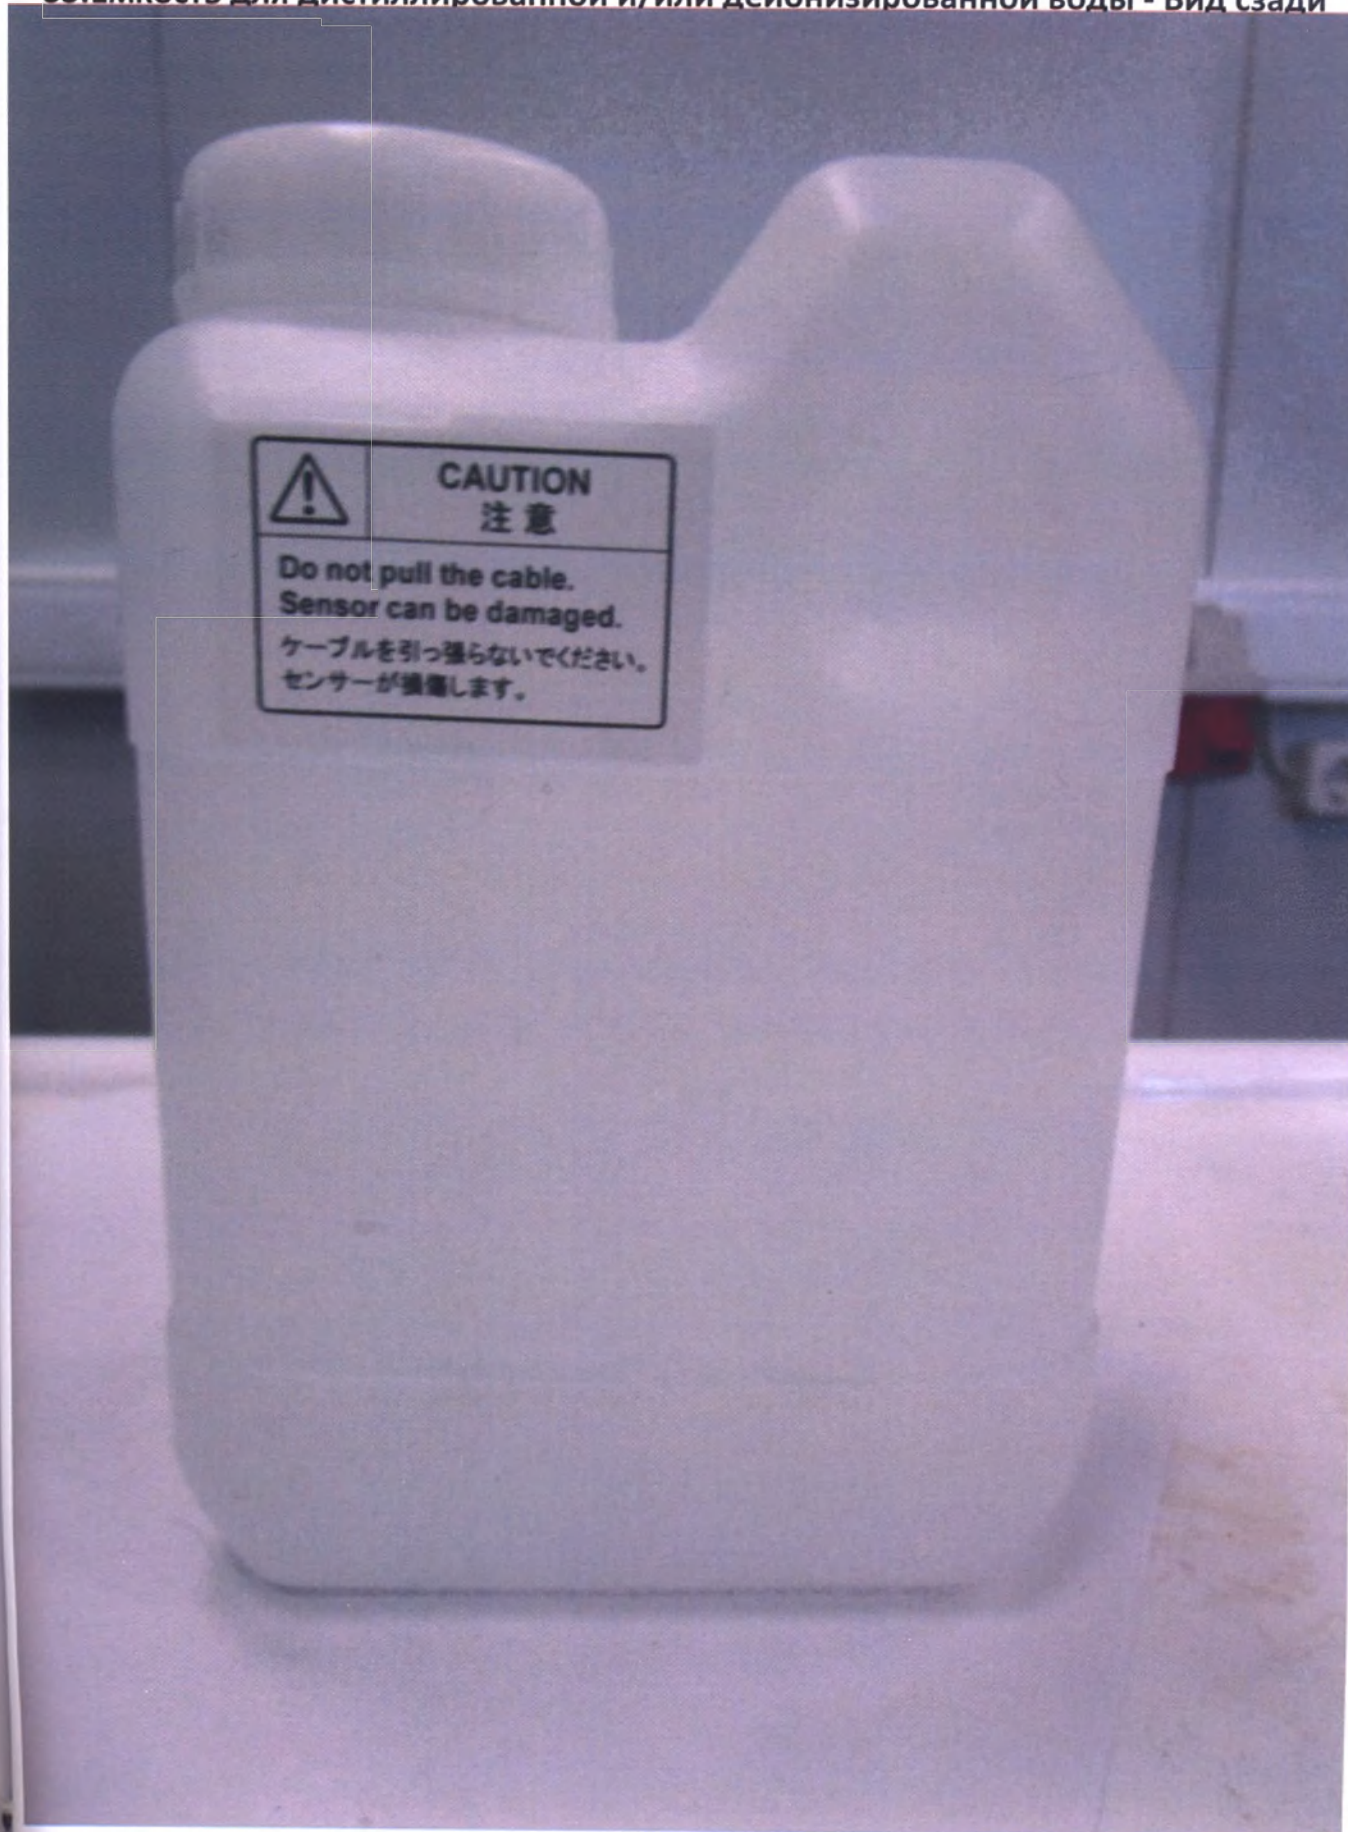

34.Емкость для промывающего раствора (для пополнения) - Вид сверху

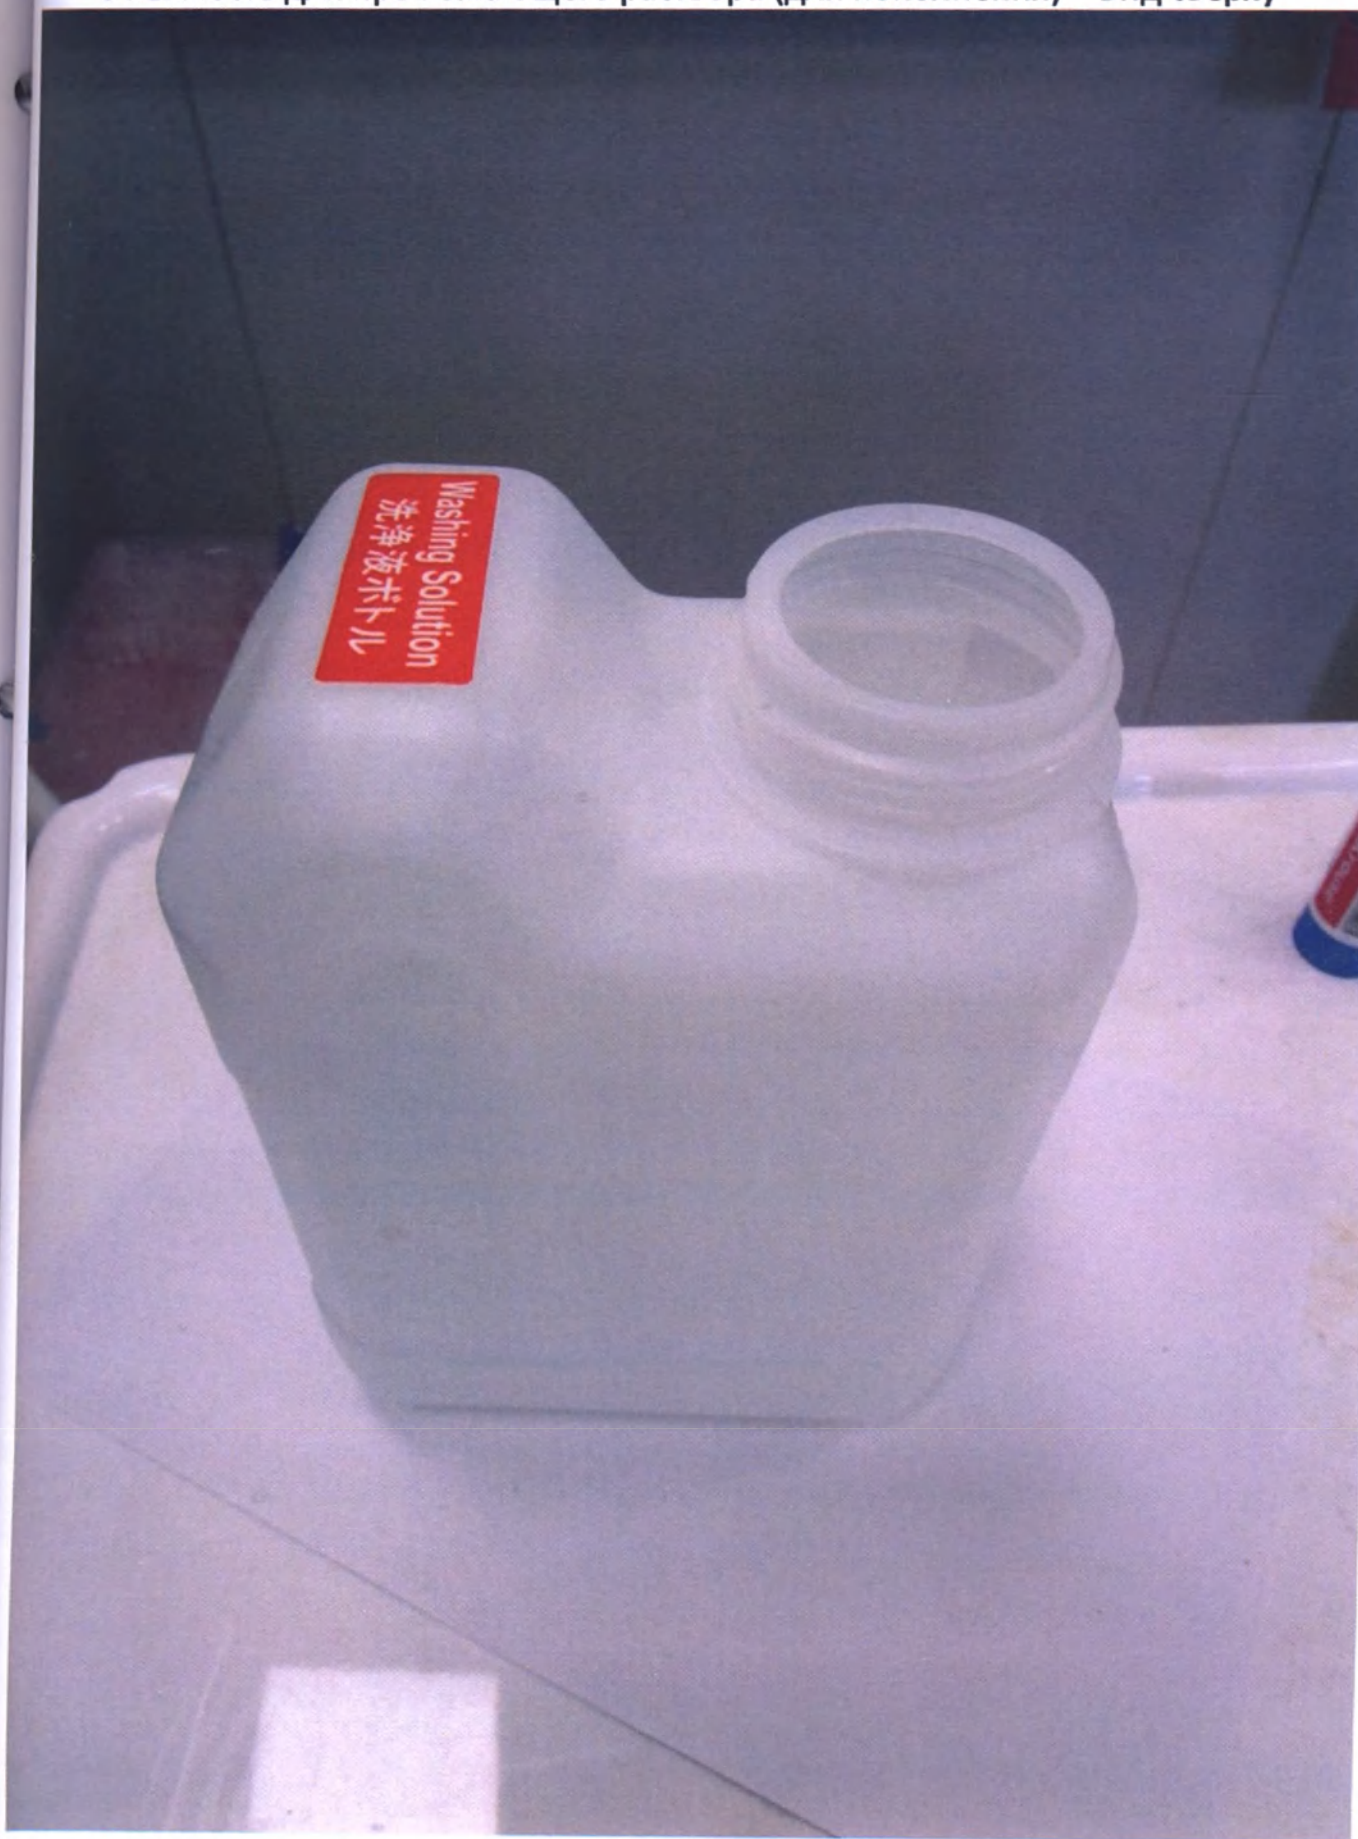

35.Емкость для промывающего раствора (для пополнения) - Вид сбоку




36. Емкость для отработанной жидкости - Вид сверху




37. Емкость для отработанной жидкости - Вид сверху




38.Соединительные кабели и один комплект трубок 1

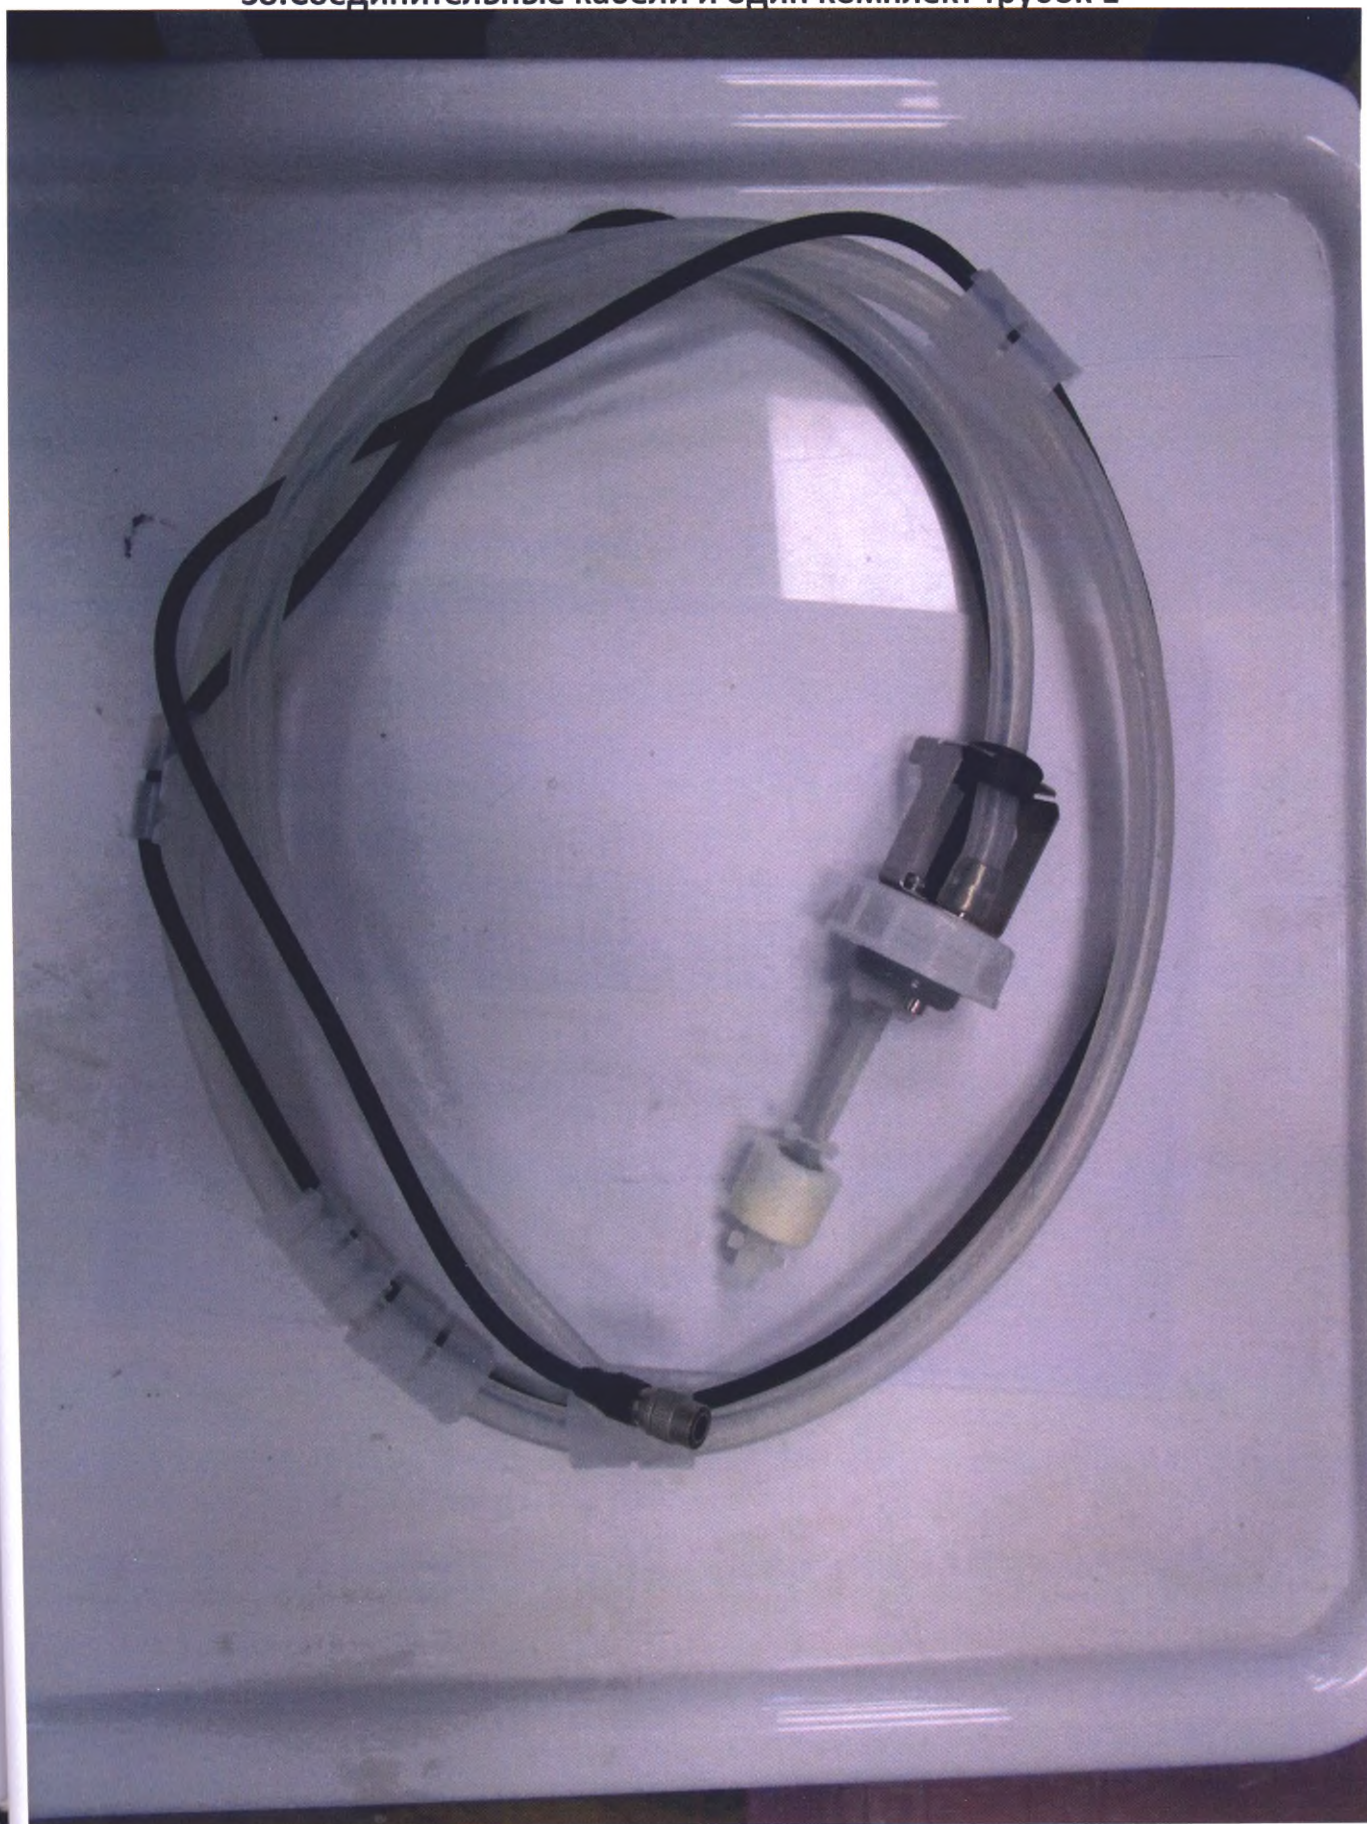


39.Соединительные кабели и один комплект трубок 2

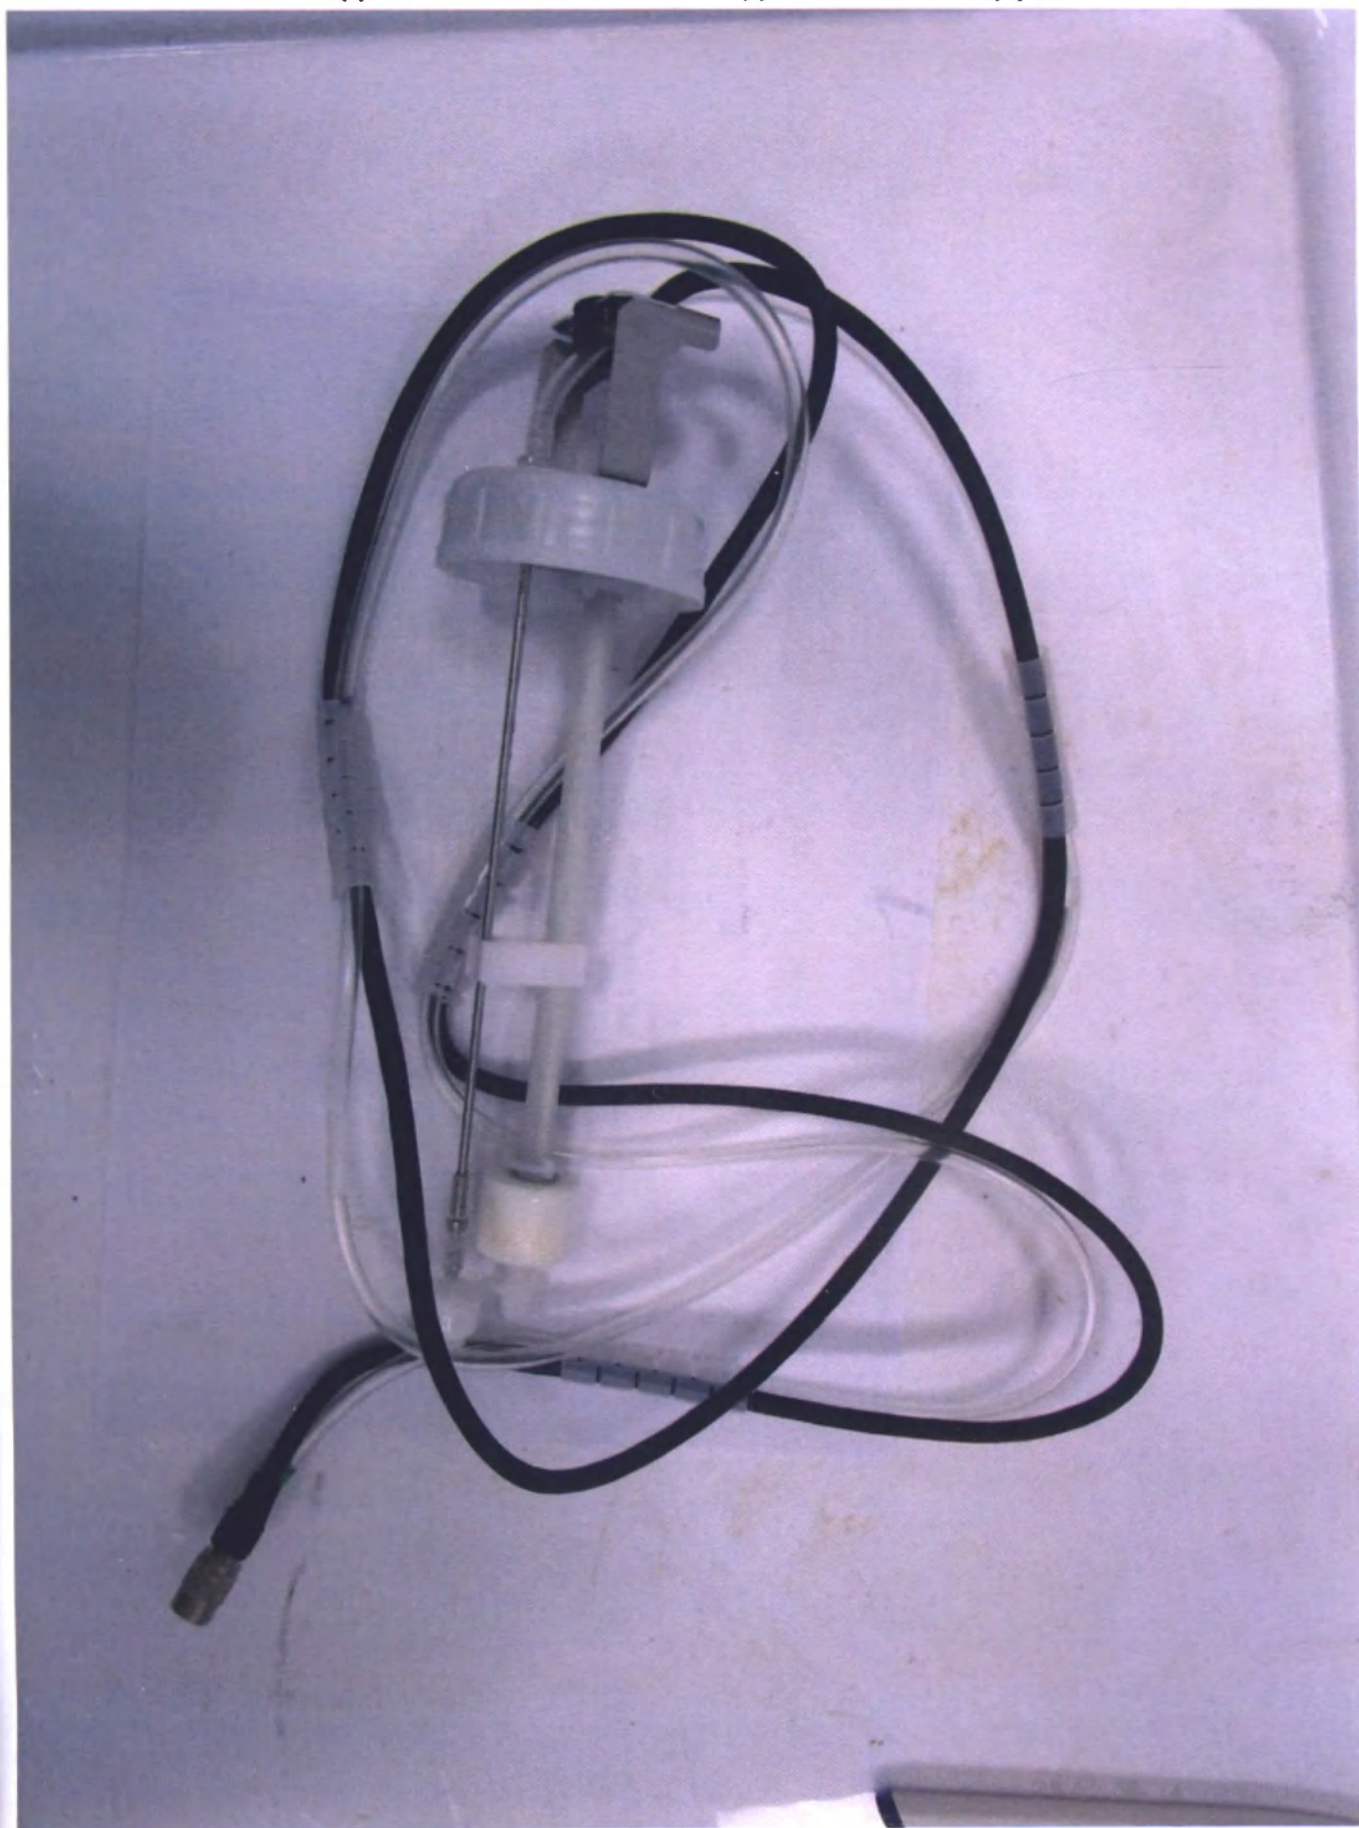

40.Соединительные кабели и один комплект трубок 3

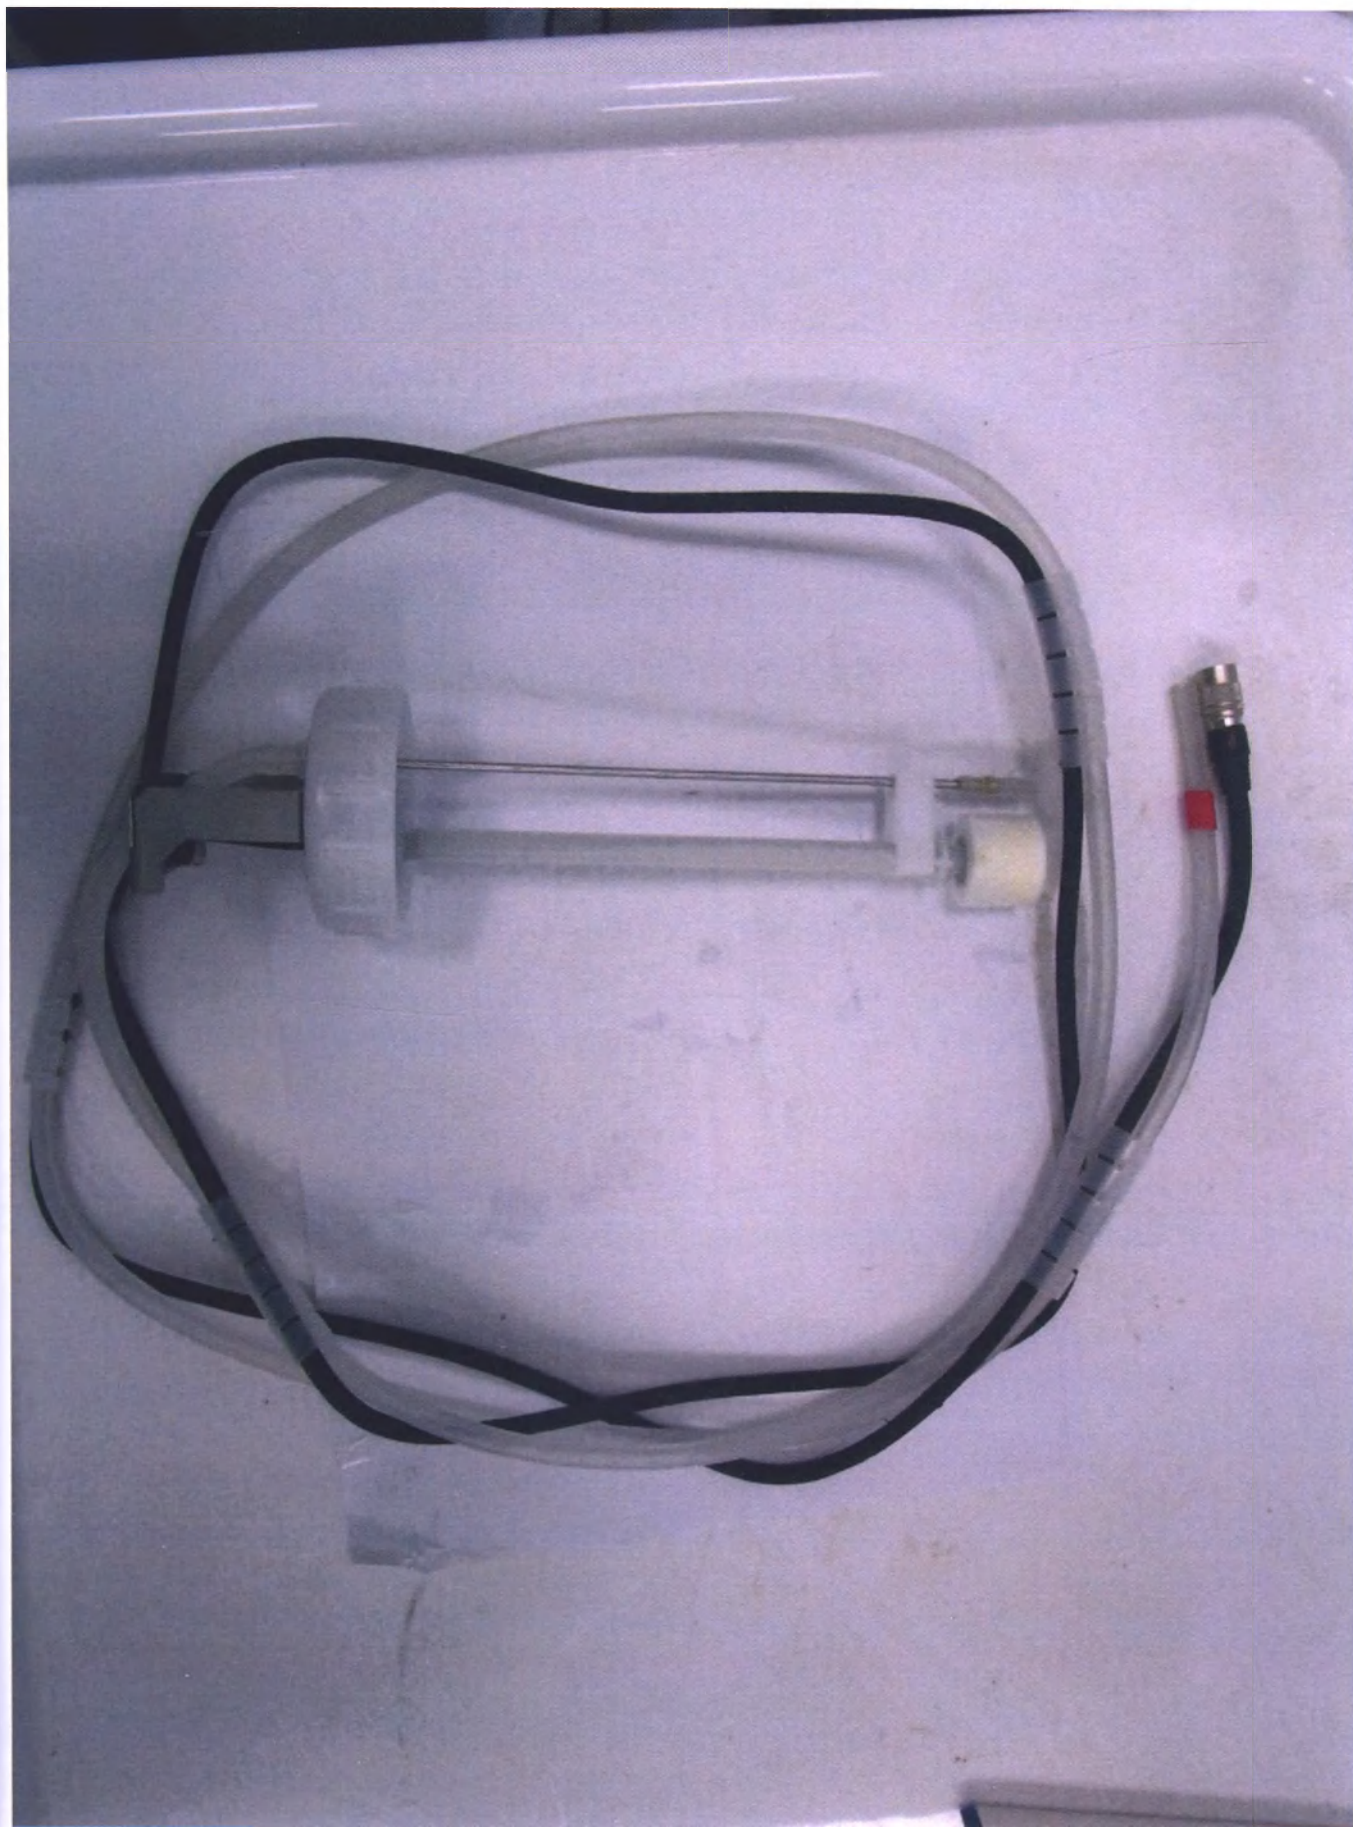

**41.Подставка для емкостей с дистиллированной и/или деионизированной
водой/промывающим раствором**

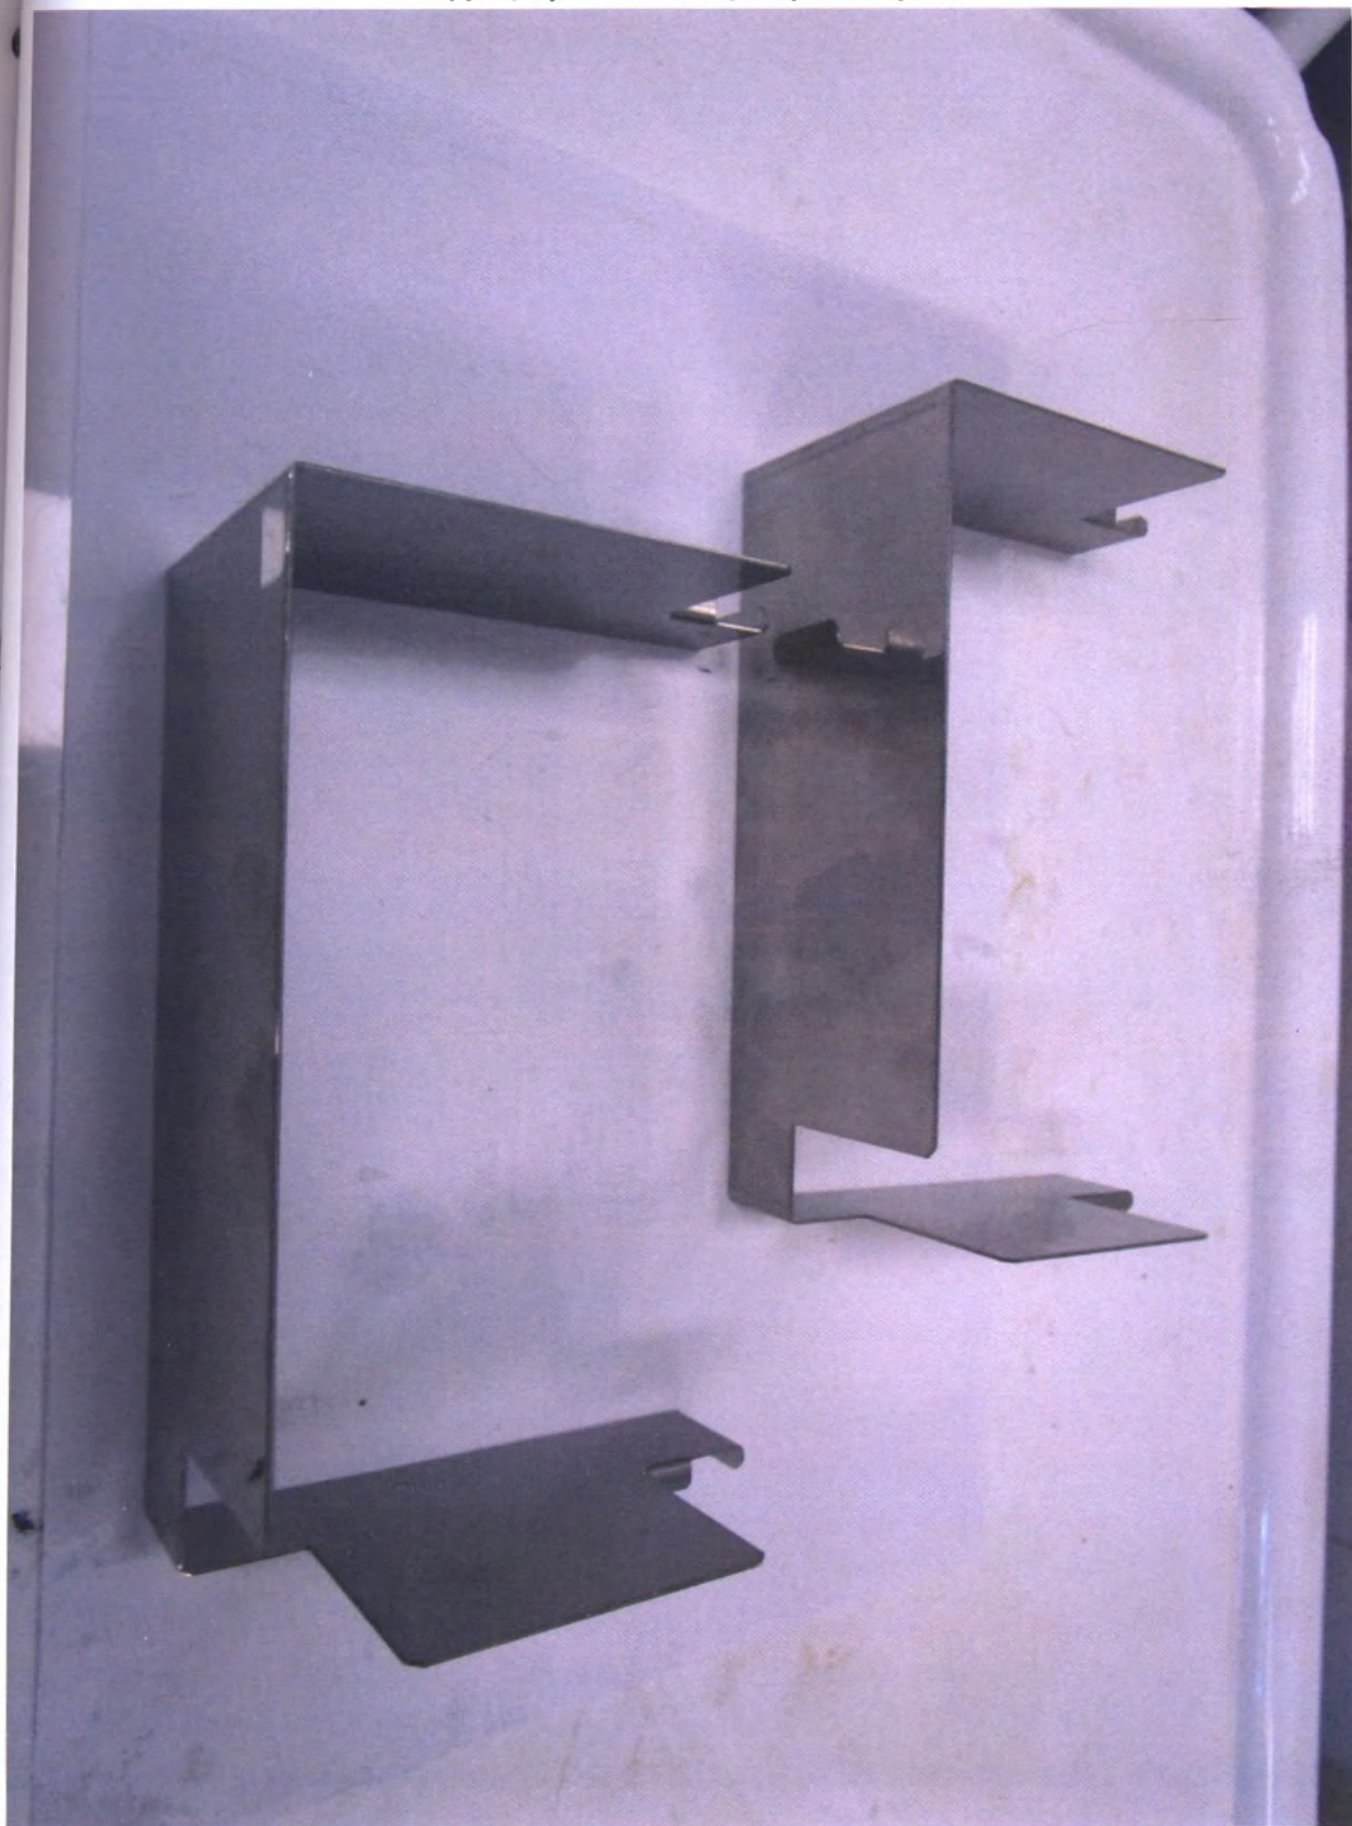


42.Реакционная кювета (базовая комплектация)



43.Руководство пользователя




44. Программное обеспечение (на CD-диске)

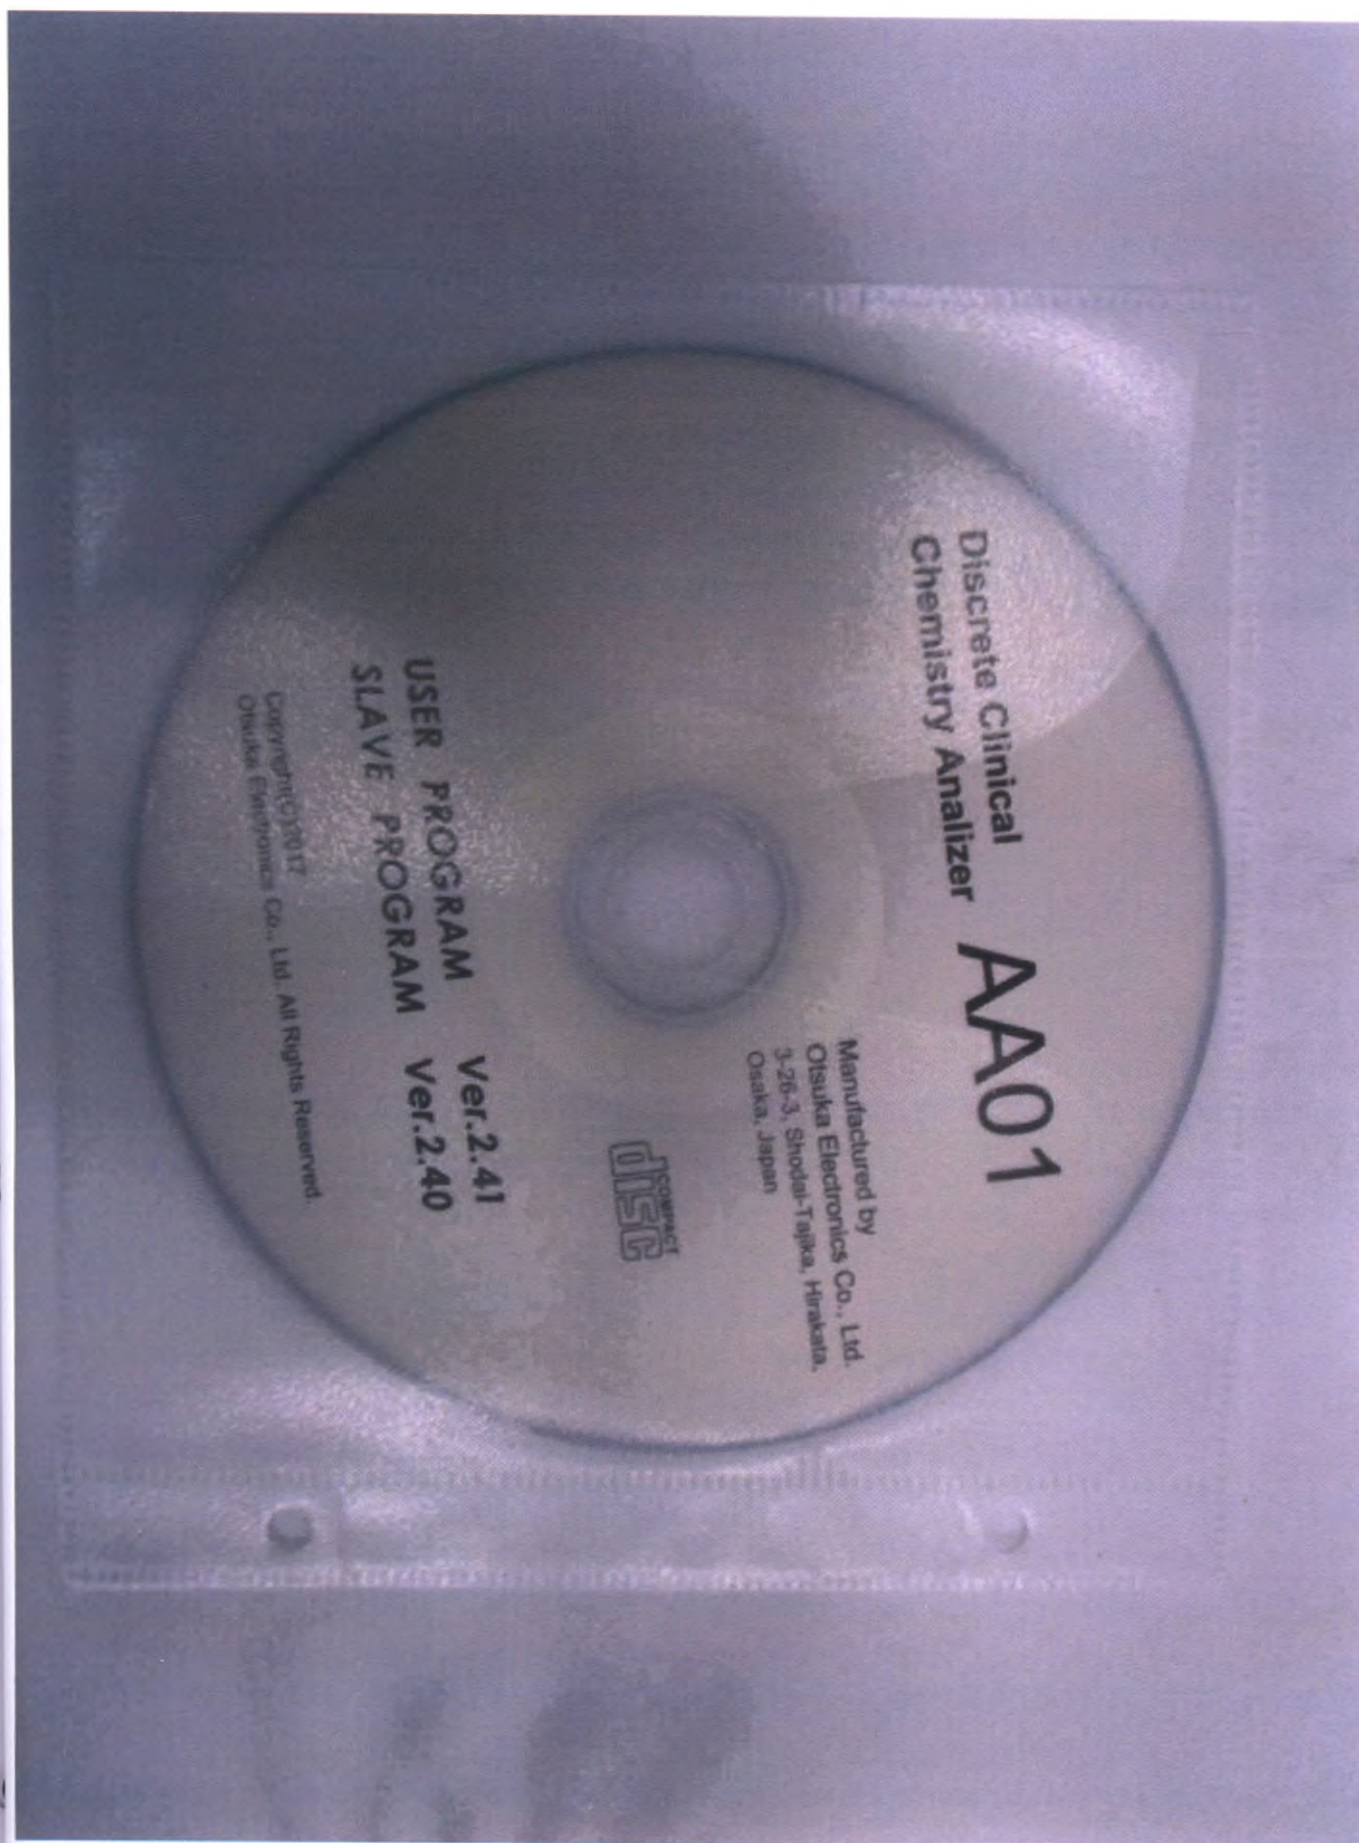

45. Кабель питания



46. Зонд для очистки дозирующих игл

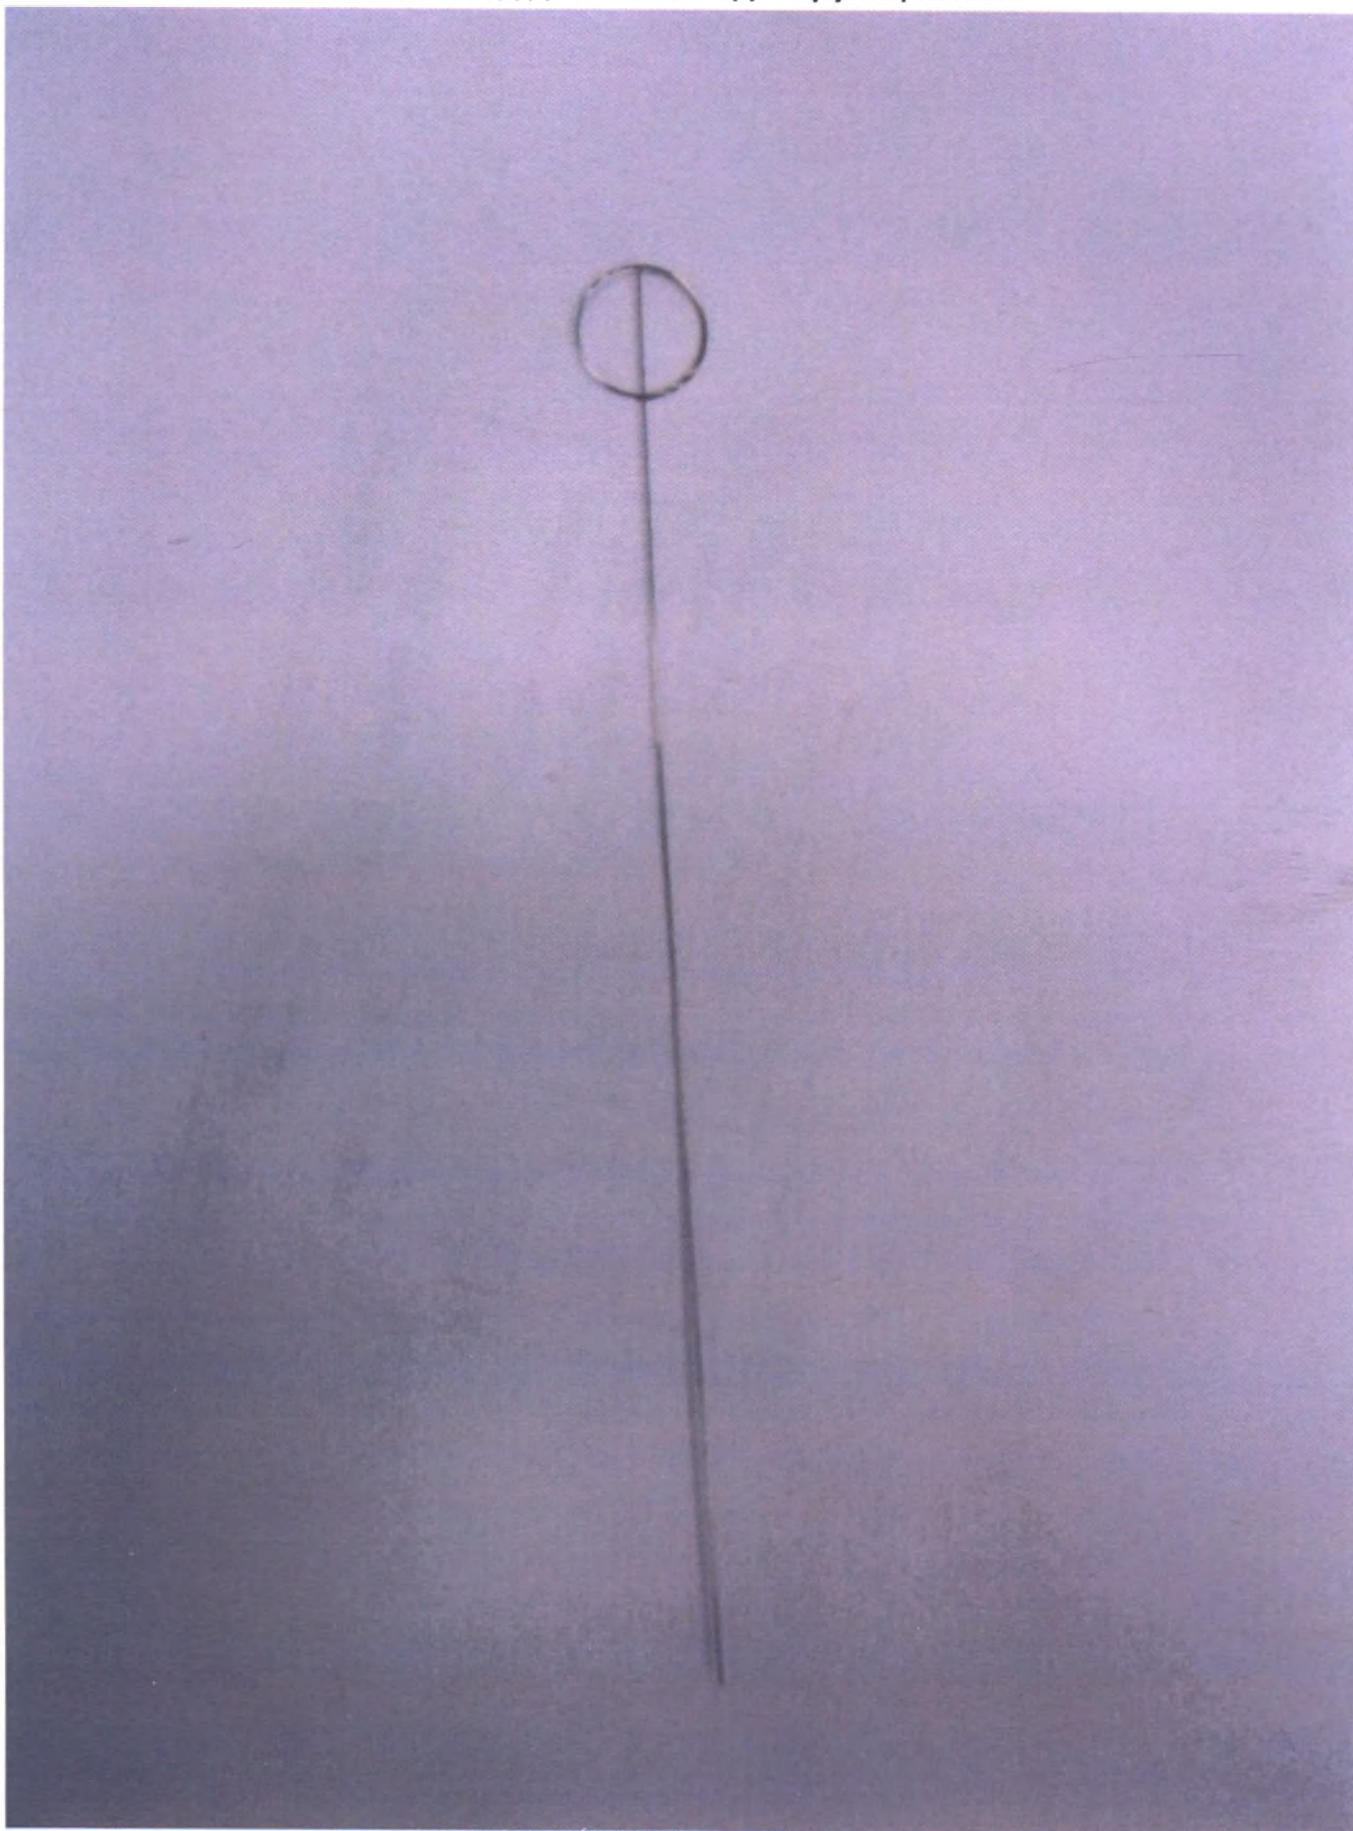


47.Маркировка со штрихкодами с ИД для штатива для пробирок для образца

 501 150101	 S51 005104	<u>S51</u>	<u>S52</u>	<u>S53</u>
 502 150200	 S52 005203	<u>S54</u>	<u>S55</u>	<u>S76</u>
 503 150309	 S53 005302	<u>S77</u>	<u>S78</u>	<u>S79</u>
 504 150408	 S54 005401	<u>S80</u>	<u>501</u>	<u>502</u>
 505 150507	 S55 005500	<u>503</u>	<u>504</u>	<u>505</u>
 752 175203	 S76 007603		<u>752</u>	<u>753</u>
 753 175302	 S77 007702	<u>754</u>	<u>755</u>	
 754 175401	 S78 007801			
 755 175500	 S79 007900			
	 S80 008006			

48. Запасной плавкий предохранитель 1



49. Запасной плавкий предохранитель 2

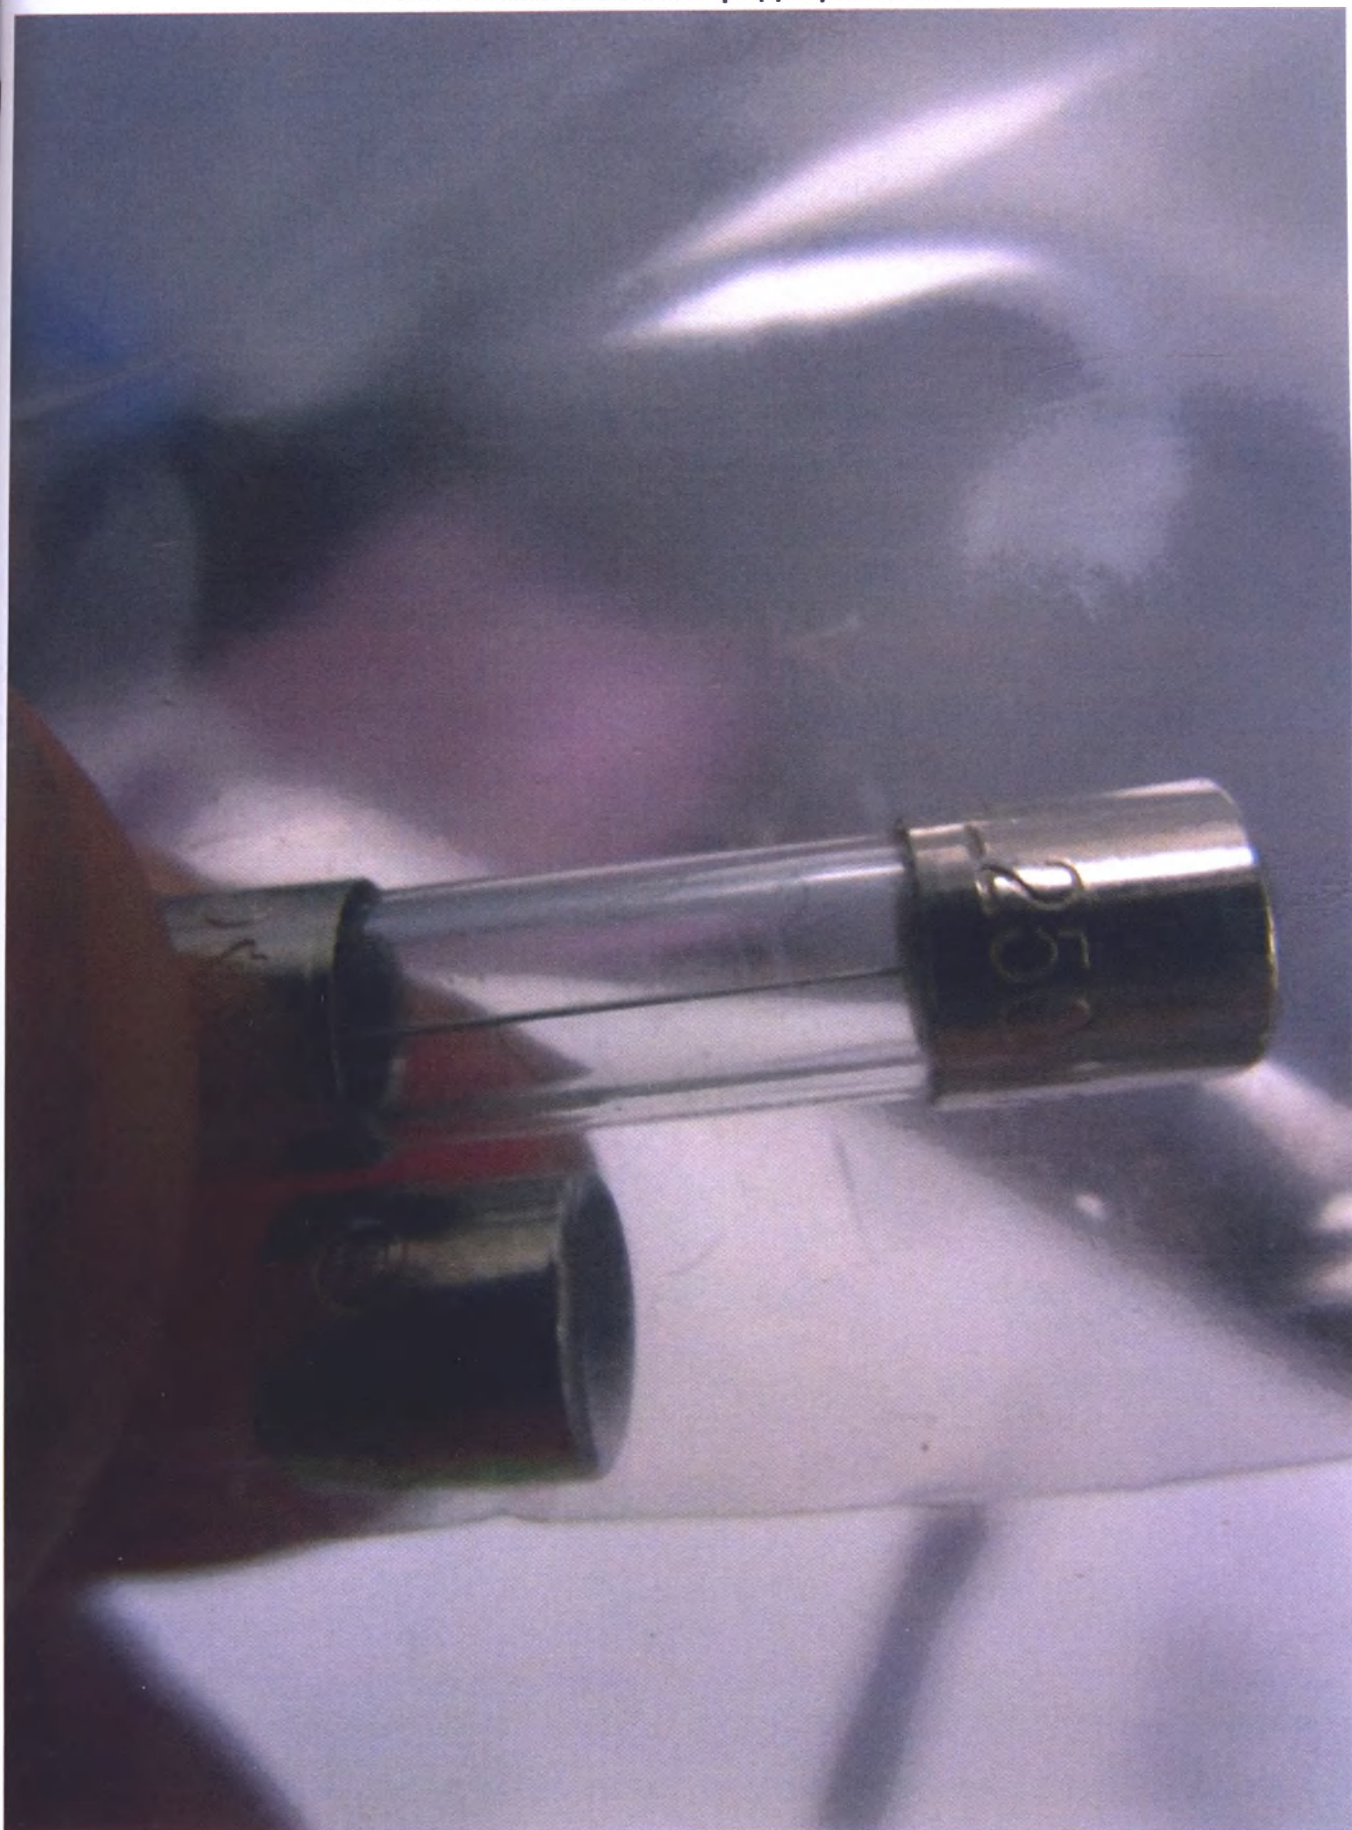

50. Бумага для принтера



51.Комплектующие к анализатору в транспортной упаковке



52.Маркировка транспортной упаковки




53.Маркировка транспортной упаковки – вид сверху




**Discrete Clinical
Chemistry Analyzer**

AA01



SN 71910011




Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague,
The Netherlands





Otsuka Electronics Co., Ltd.
3-26-3 Shodaitajika, Hirakata-shi
Osaka, 573-1132, Japan

MADE IN JAPAN

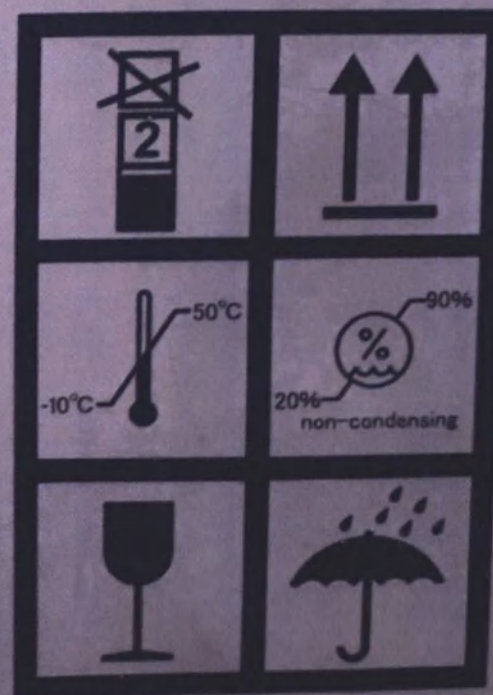


Discrete Clinical
Chemistry Analyzer

AA01



71910011




Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague,
The Netherlands



Otsuka Electronics Co., Ltd.
3-26-3 Shodaitajika, Hirakata-shi
Osaka, 573-1132, Japan

MADE IN JAPAN

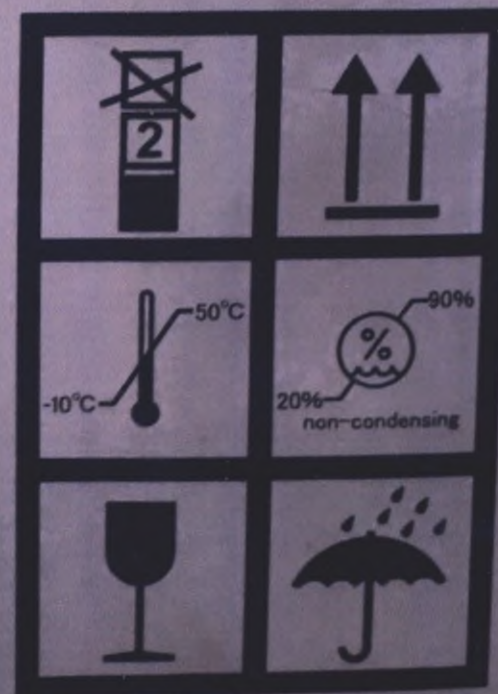

Прошито и пронумеровано

55 (подпись) (подпись)

листа (00)

Генеральный директор
ООО «АГРОИНТЕРНЕЙШНЛ»

Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов

И.И. Коновалов