



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

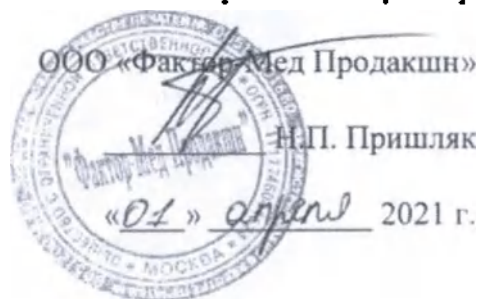


Фотографические изображения: «Анализатор для определения наличия наркотических и психоактивных веществ в моче и других биологических жидкостях «АМ 770» по ТУ 26.51.53 -002-69721380-2020»:


Анализатор для определения наличия наркотических и психоактивных веществ в моче и их биологических жидкостях «АМ 770

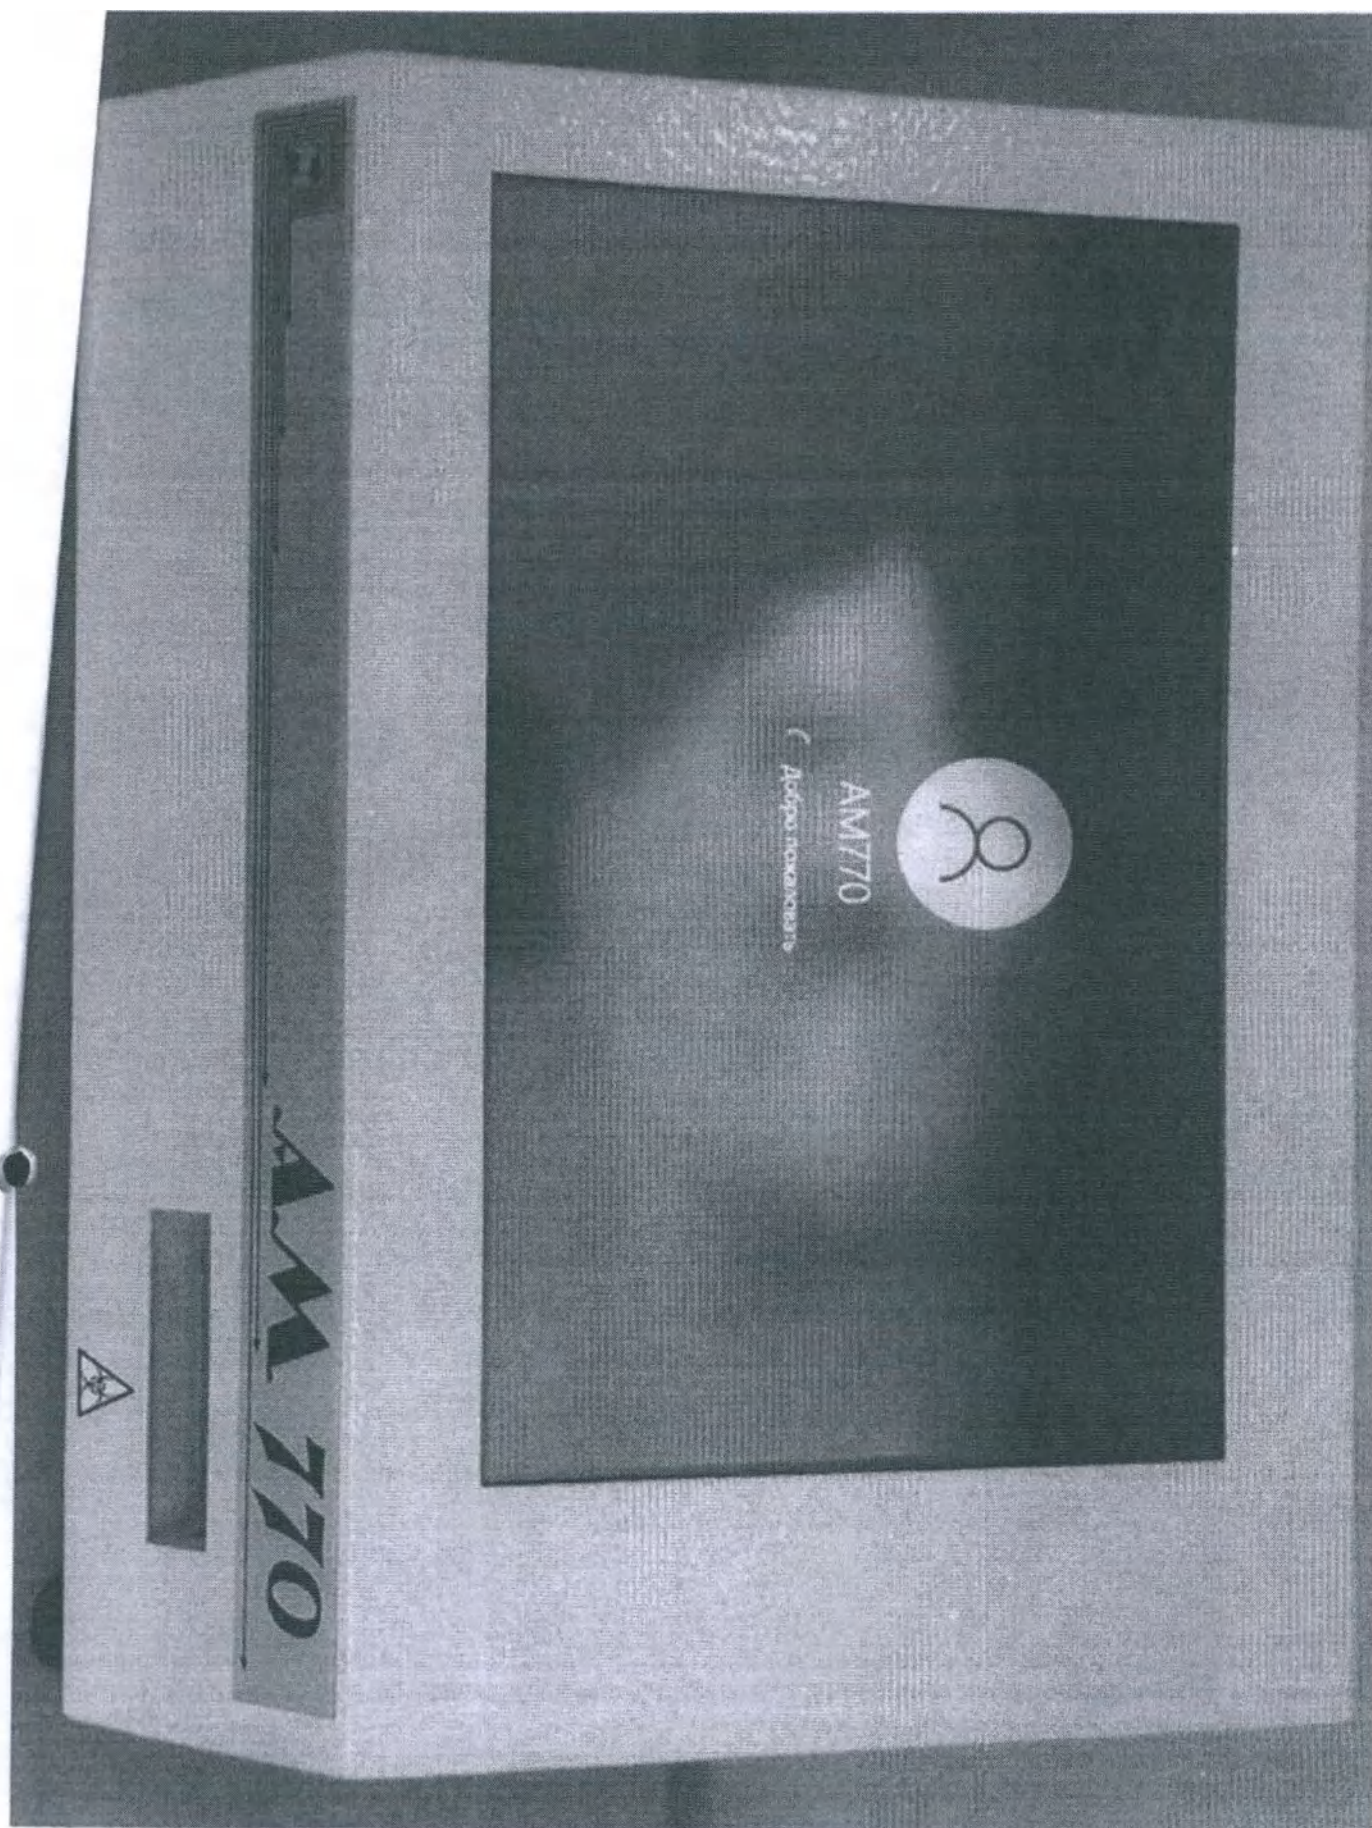

2. Приемный лоток для теста (тест-полосок)

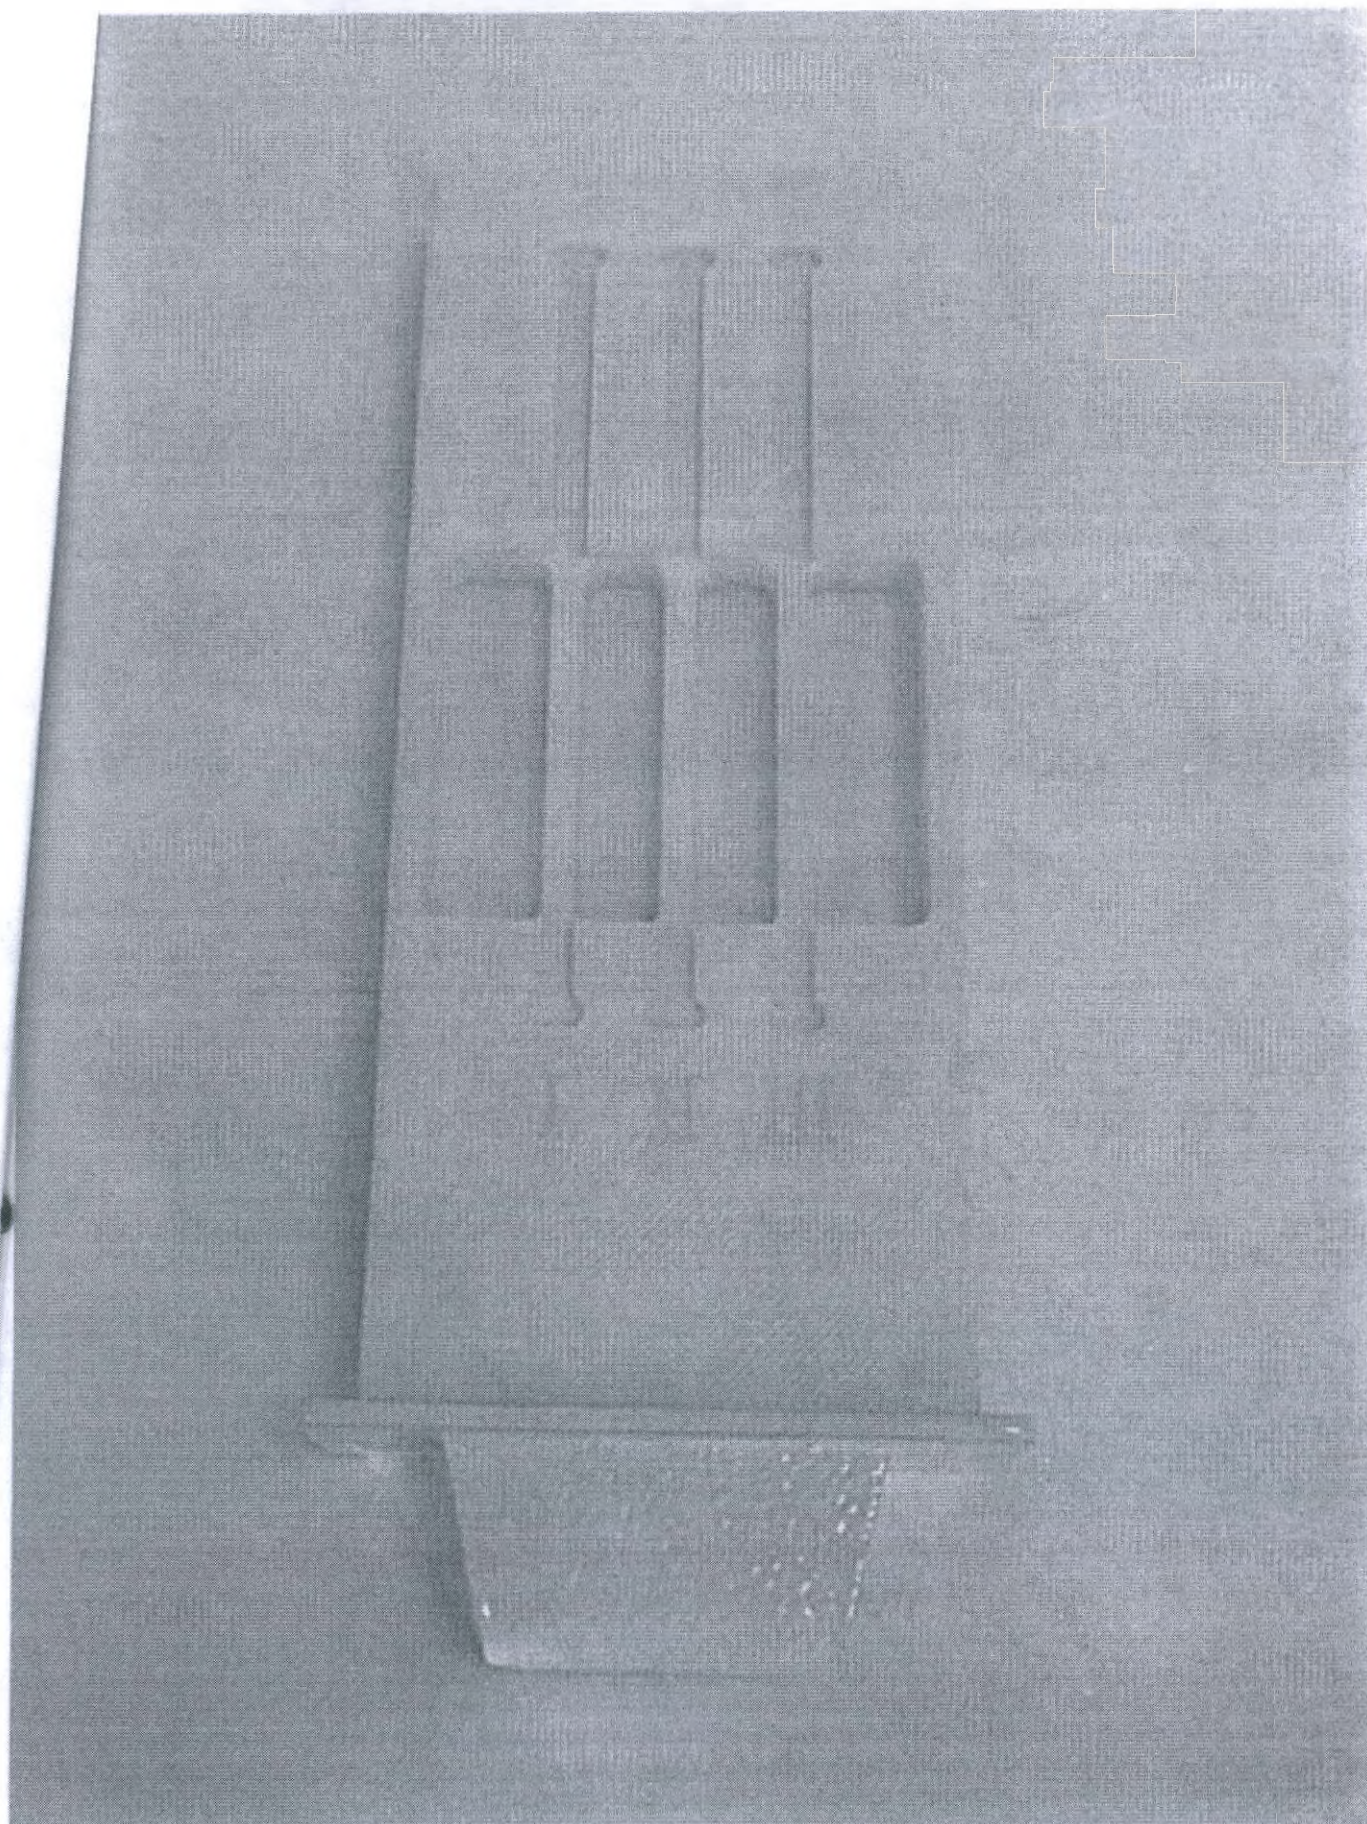

3. Приемный лоток для мультитеста;

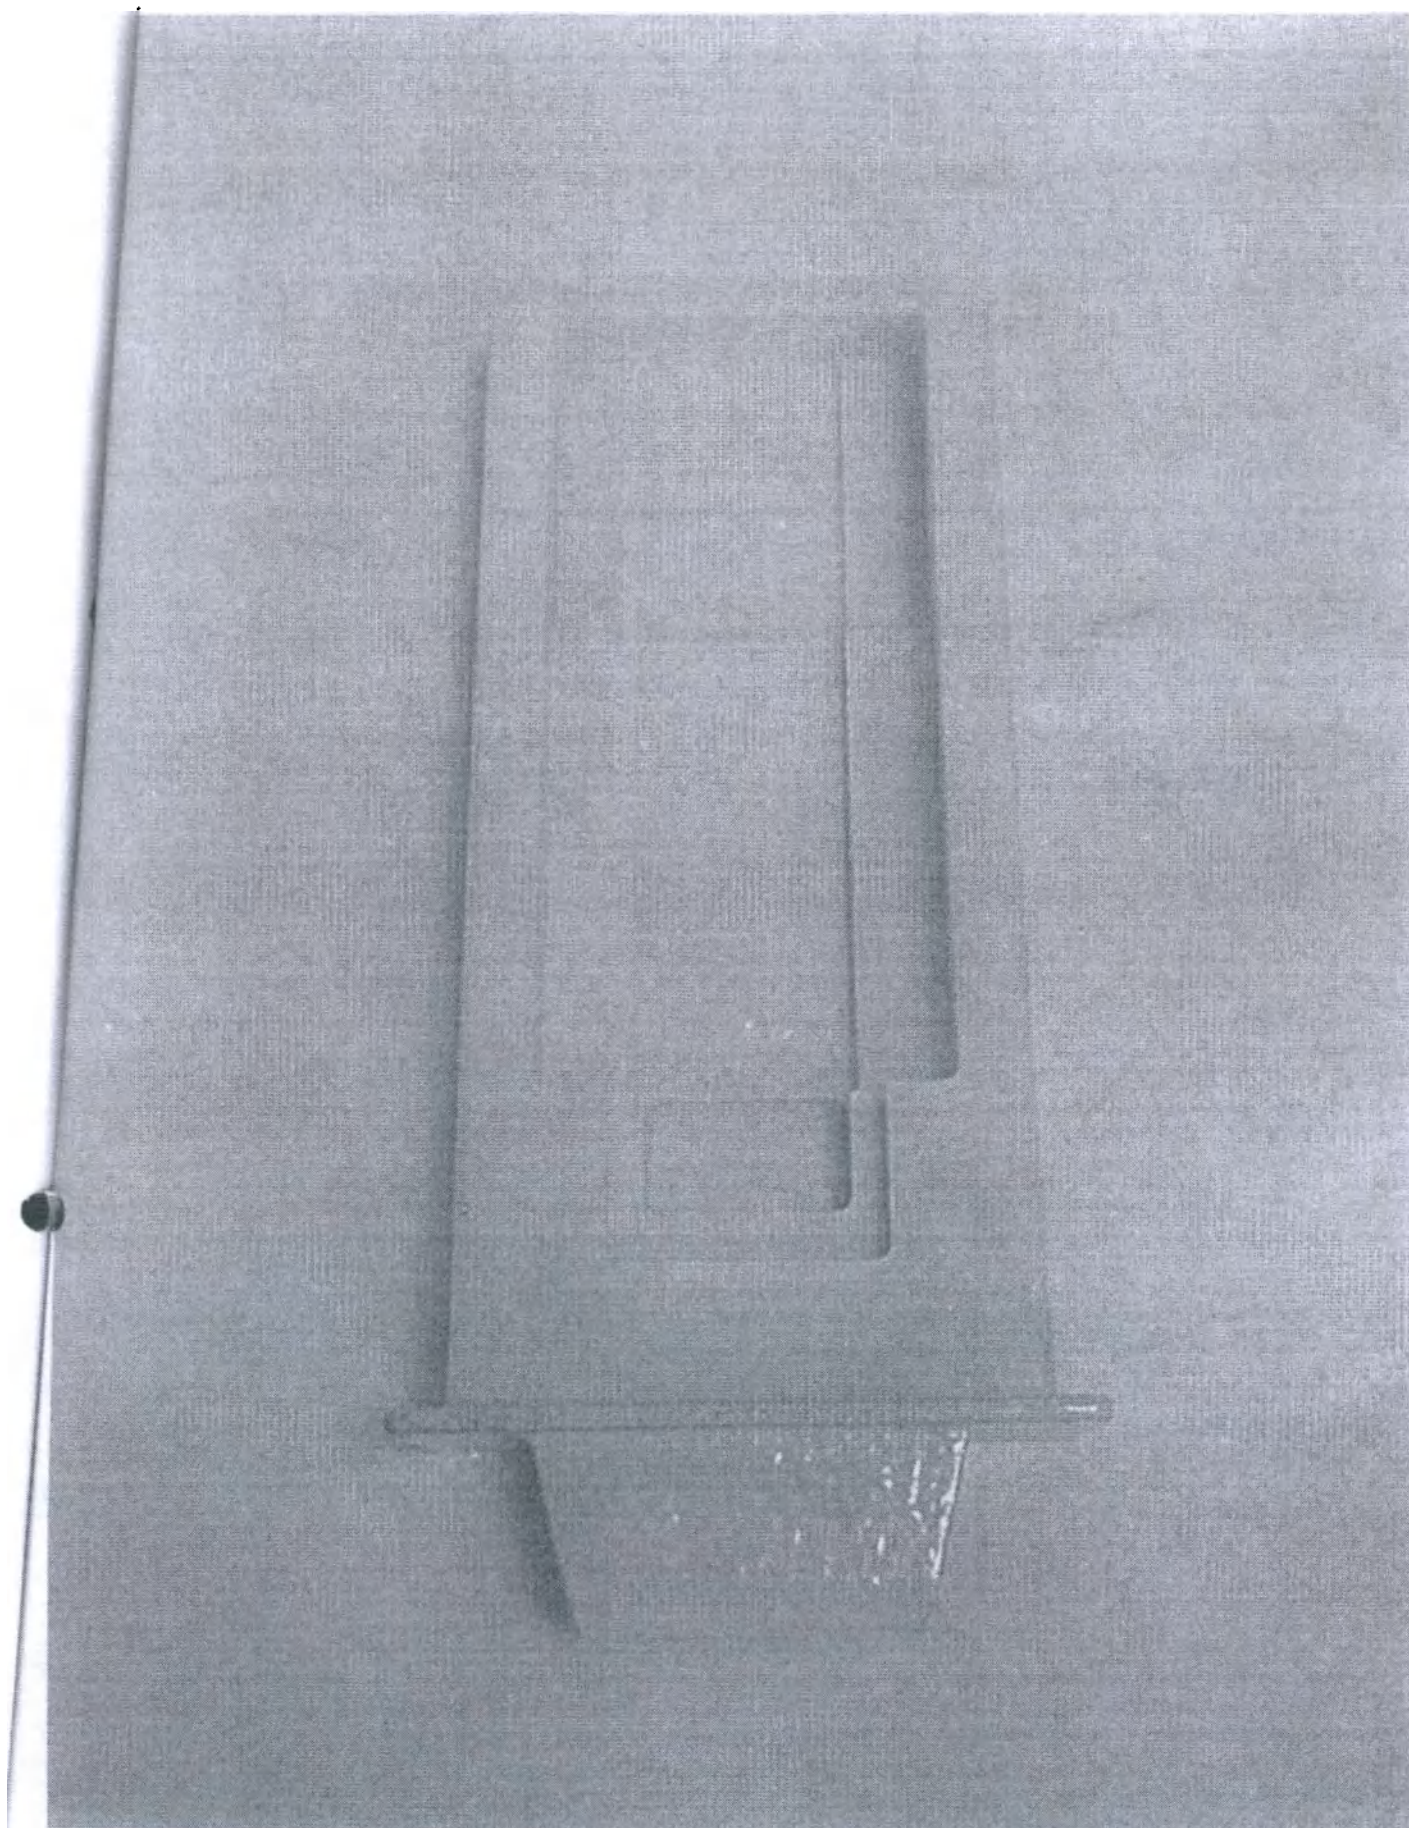

4. Контрольная панель для проверки прибора;



Контрольная
панель для
проверки прибора

1	2	3	4	5	6
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

5. Сканер для ввода кода теста оптический CL-2210 P2D (Mercury) (при необходимости);




6. Комплект: клавиатура и мышь KBS-7001 (Gembird) (при необходимости);

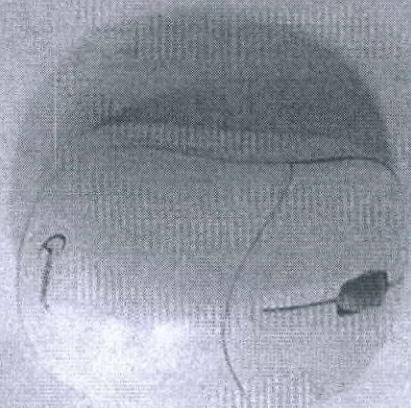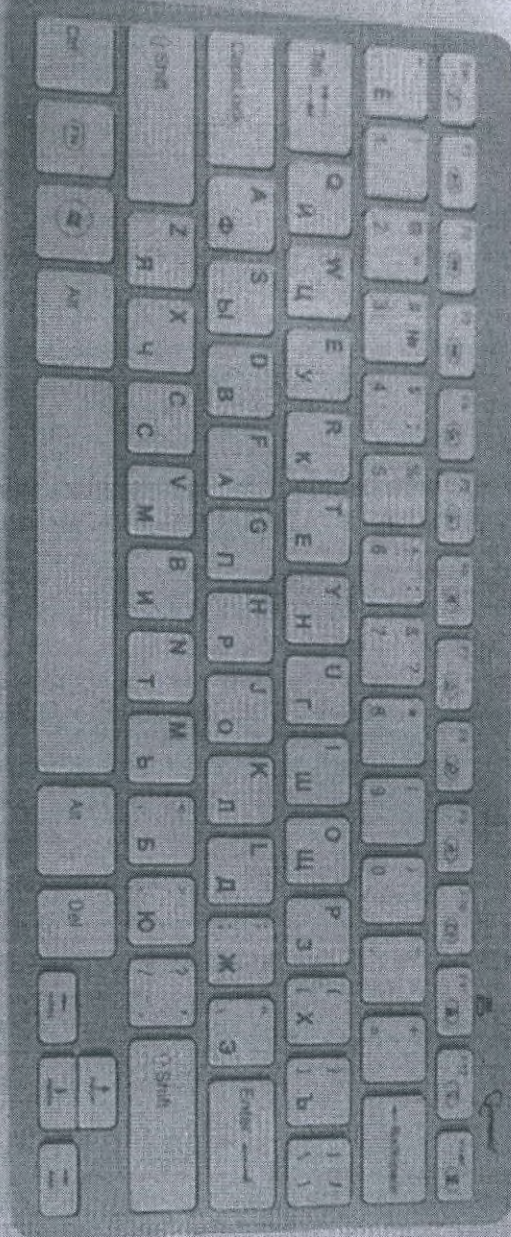

7. Стилус (при необходимости)



8. Блок питания с кабелем питания для прибора PA-08 (ORIENT HERO INTERNATIONAL);

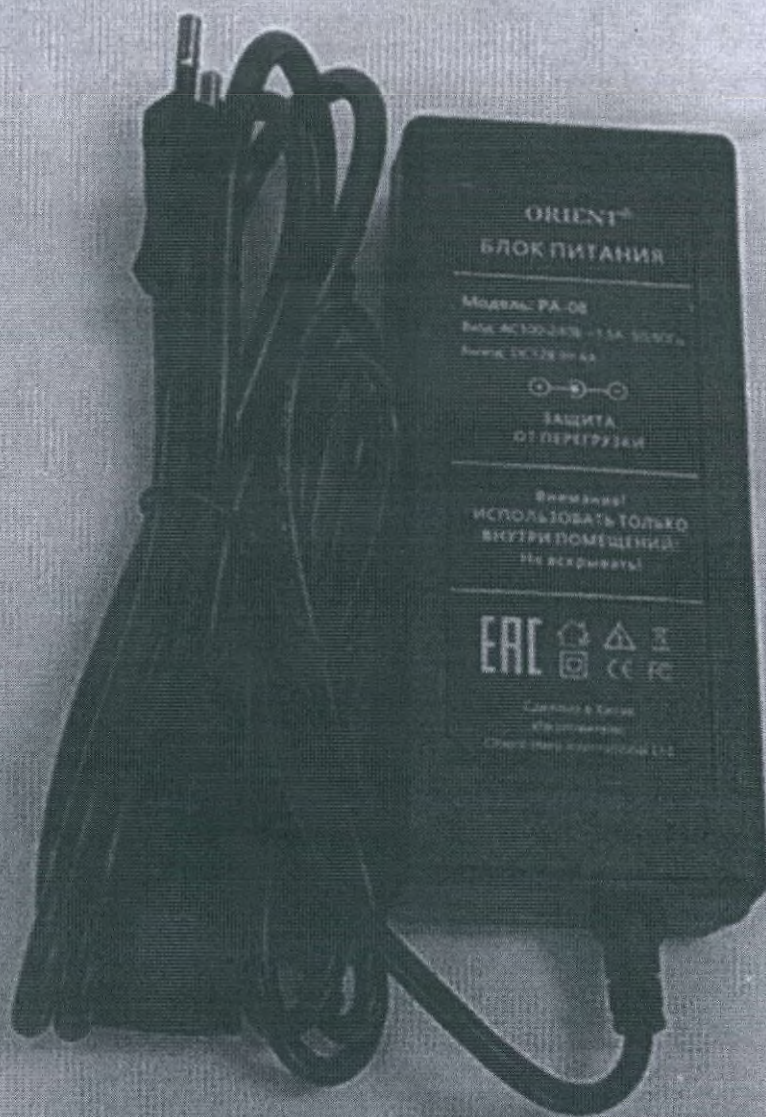

9. Руководство по эксплуатации

 **АМ 770**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Анализатор для определения
наркотических и психоактивных веществ
в моче и других биологических жидкостях

IVD

10. Упаковка

