


Фотографии общего вида медицинского изделия


Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения гемоглобина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – FIT Hemoglobin AA01 (ФИТ Гемоглобин AA01)

«Альфреза Фарма Корпорейшн» (Alfresa Pharma Corporation), Япония


Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения гемоглобина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – FIT Hemoglobin AA01 (ФИТ Гемоглобин AA01) – Фотография 1

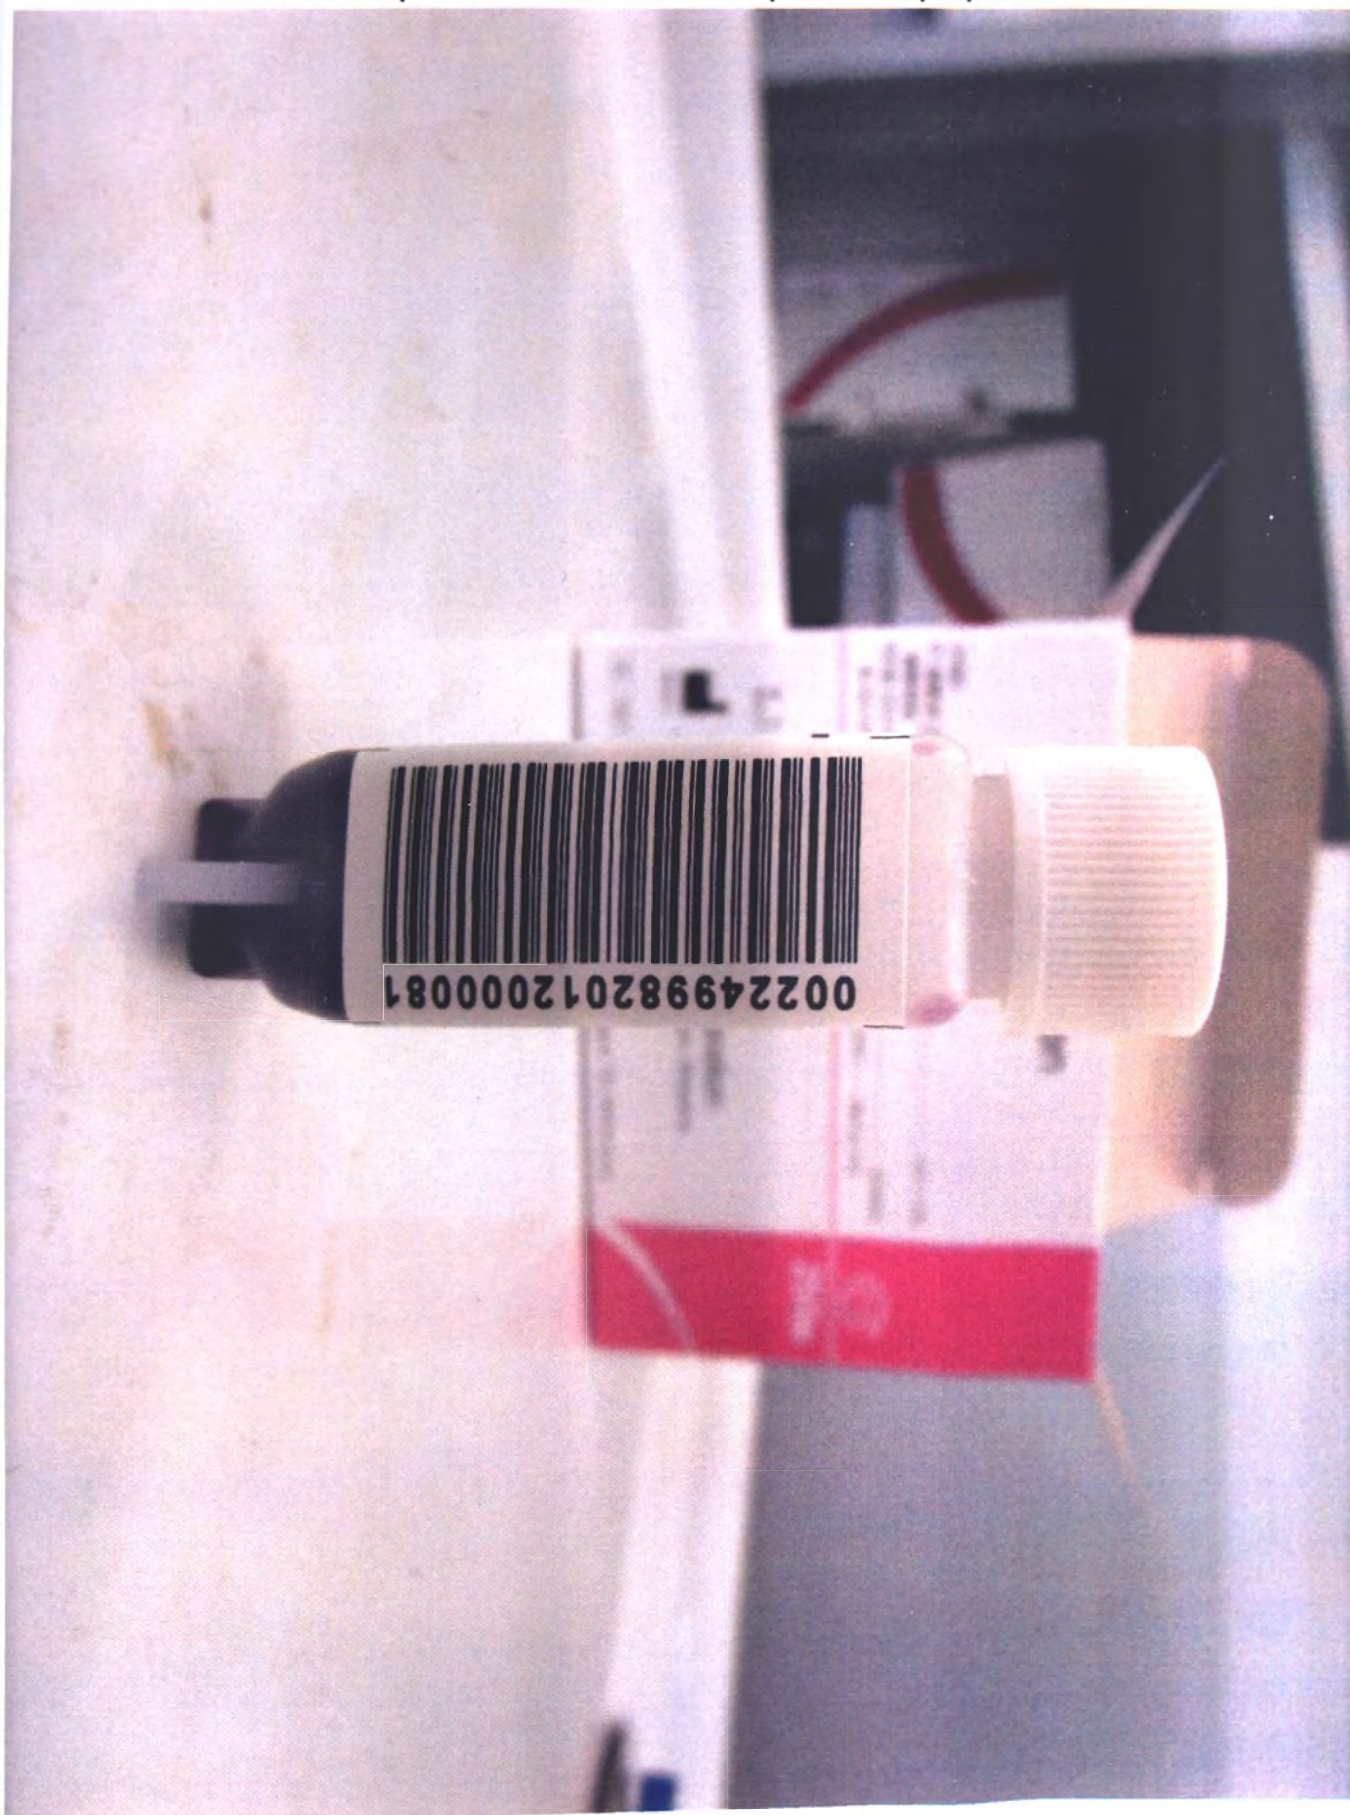


Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения гемоглобина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – FIT Hemoglobin AA01 (ФИТ Гемоглобин AA01) – Фотография 2

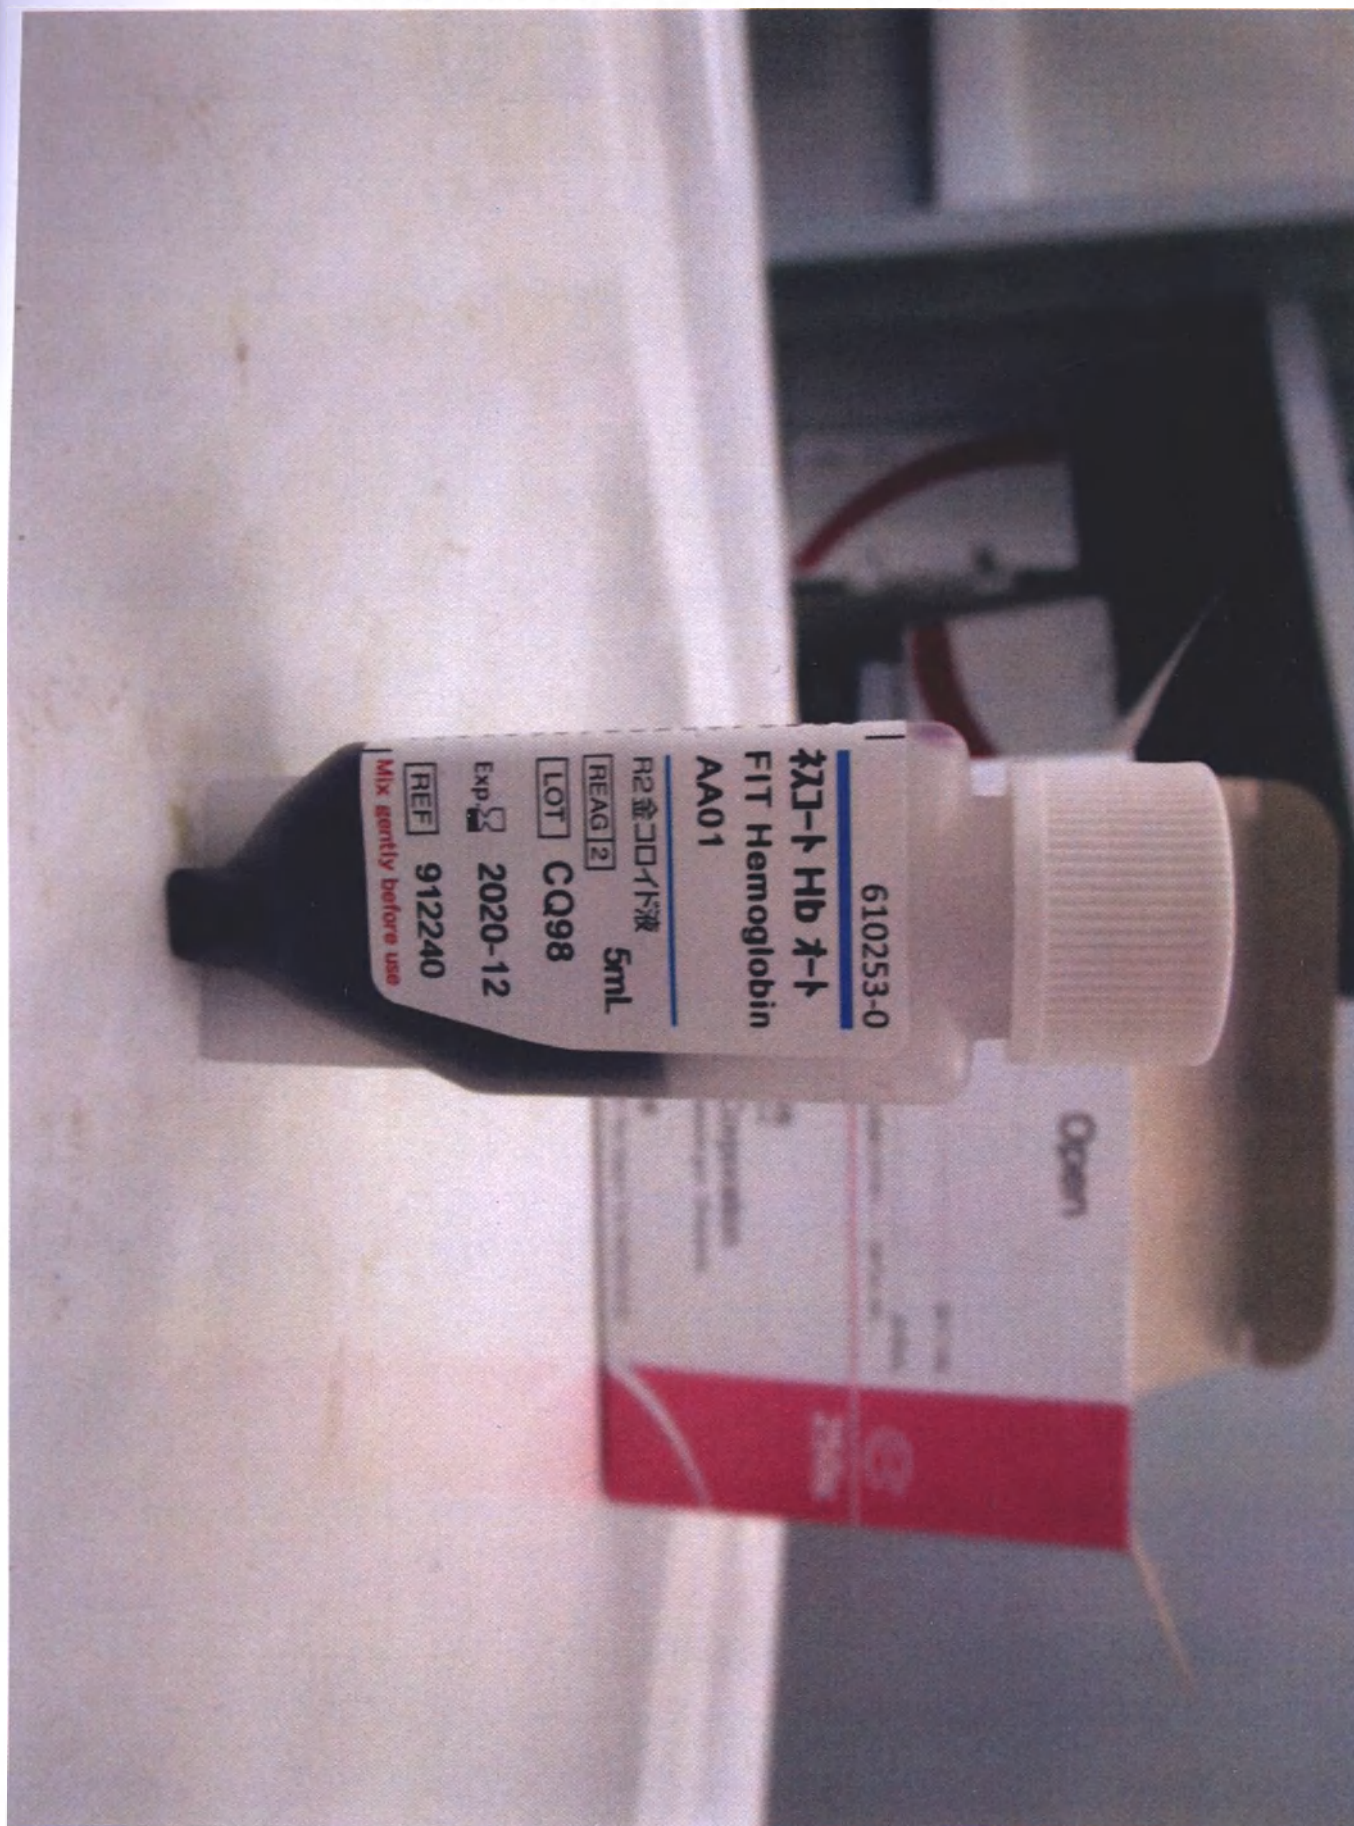

Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения гемоглобина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – FIT Hemoglobin AA01 (ФИТ Гемоглобин AA01) – Фотография 3

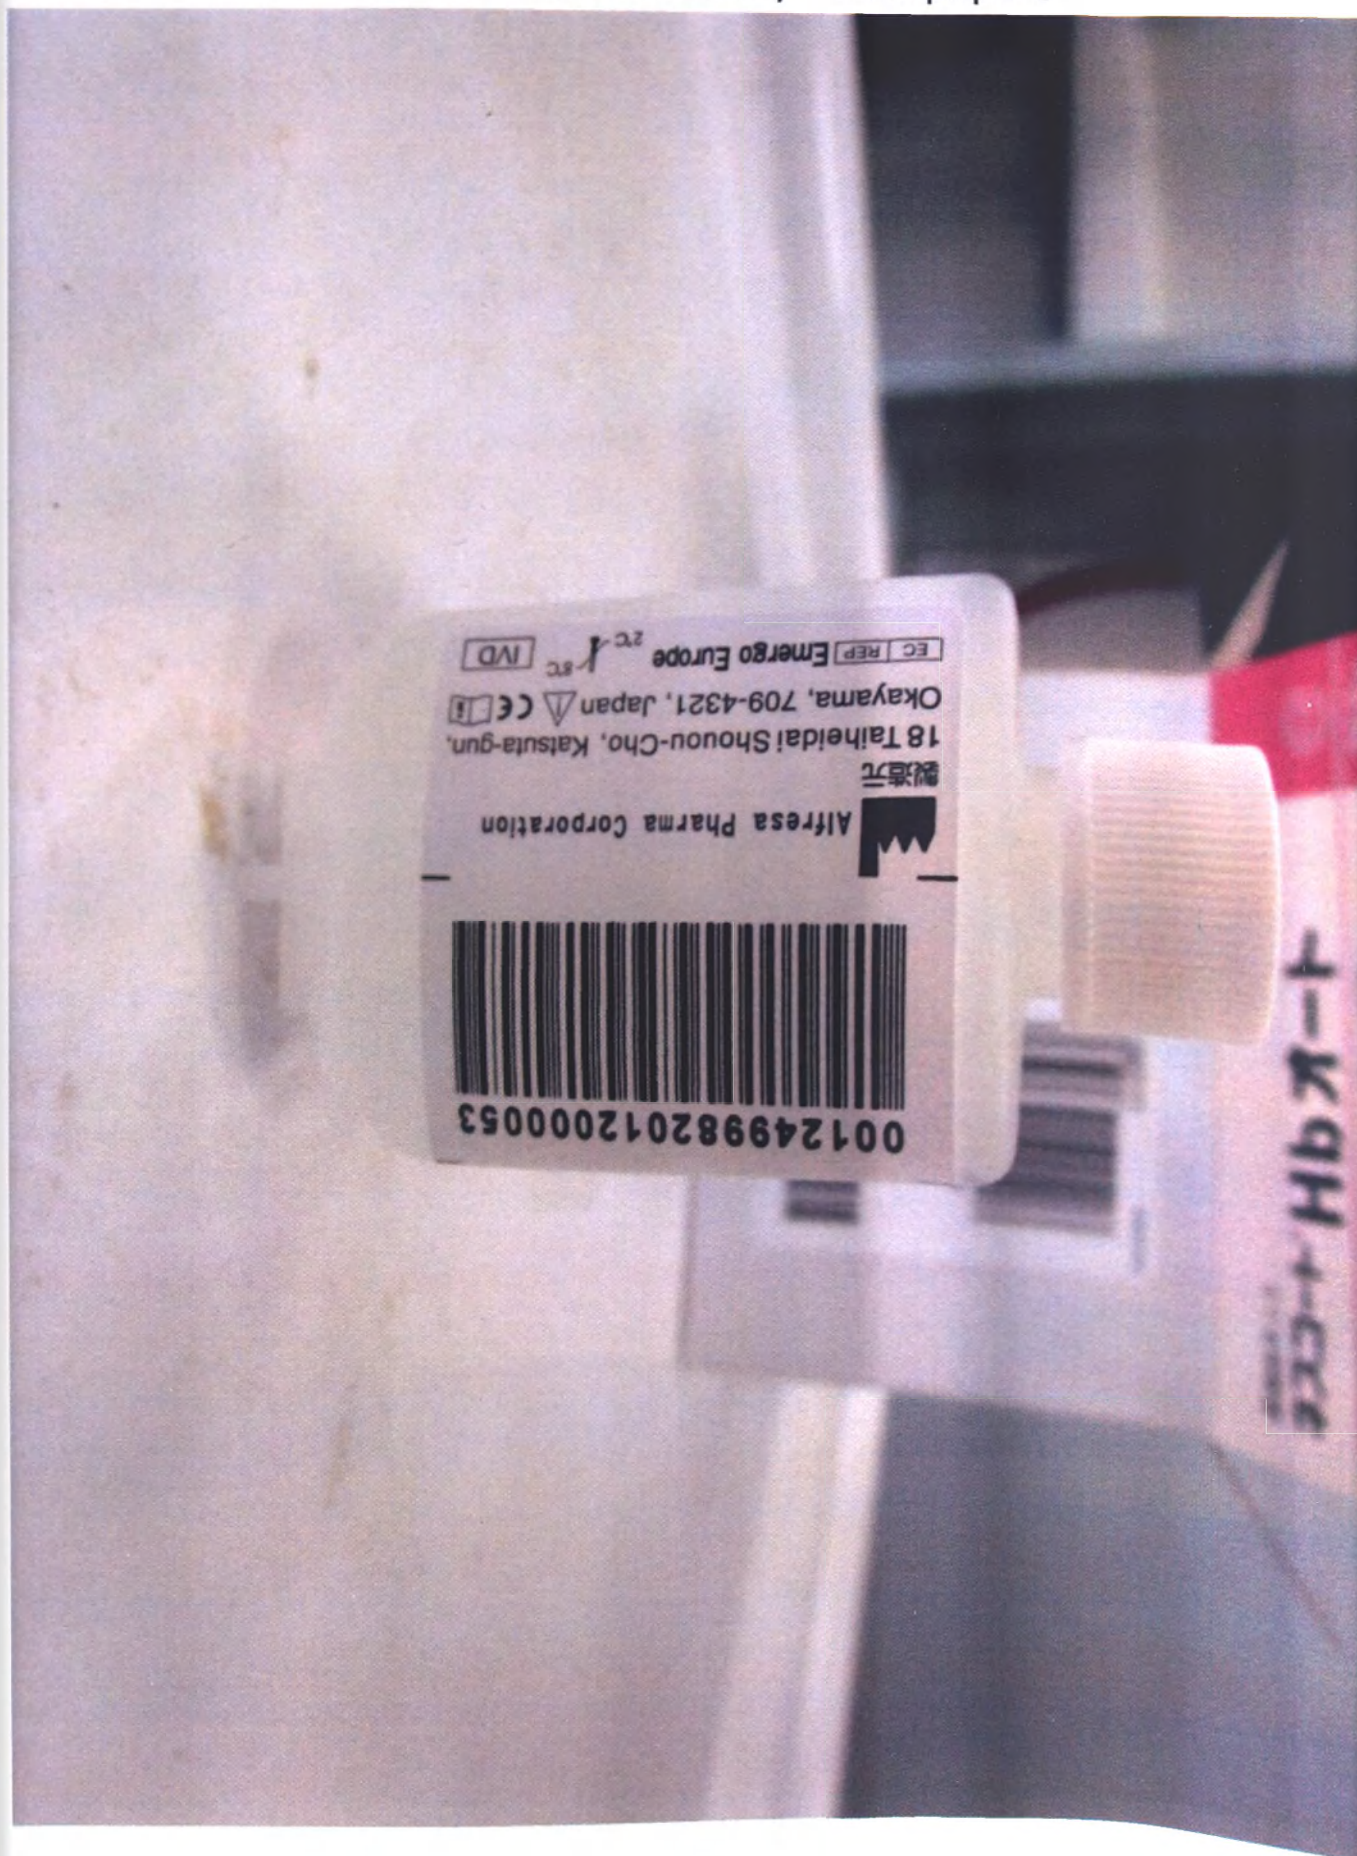

Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения гемоглобина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – FIT Hemoglobin AA01 (ФИТ Гемоглобин AA01) – Фотография 4

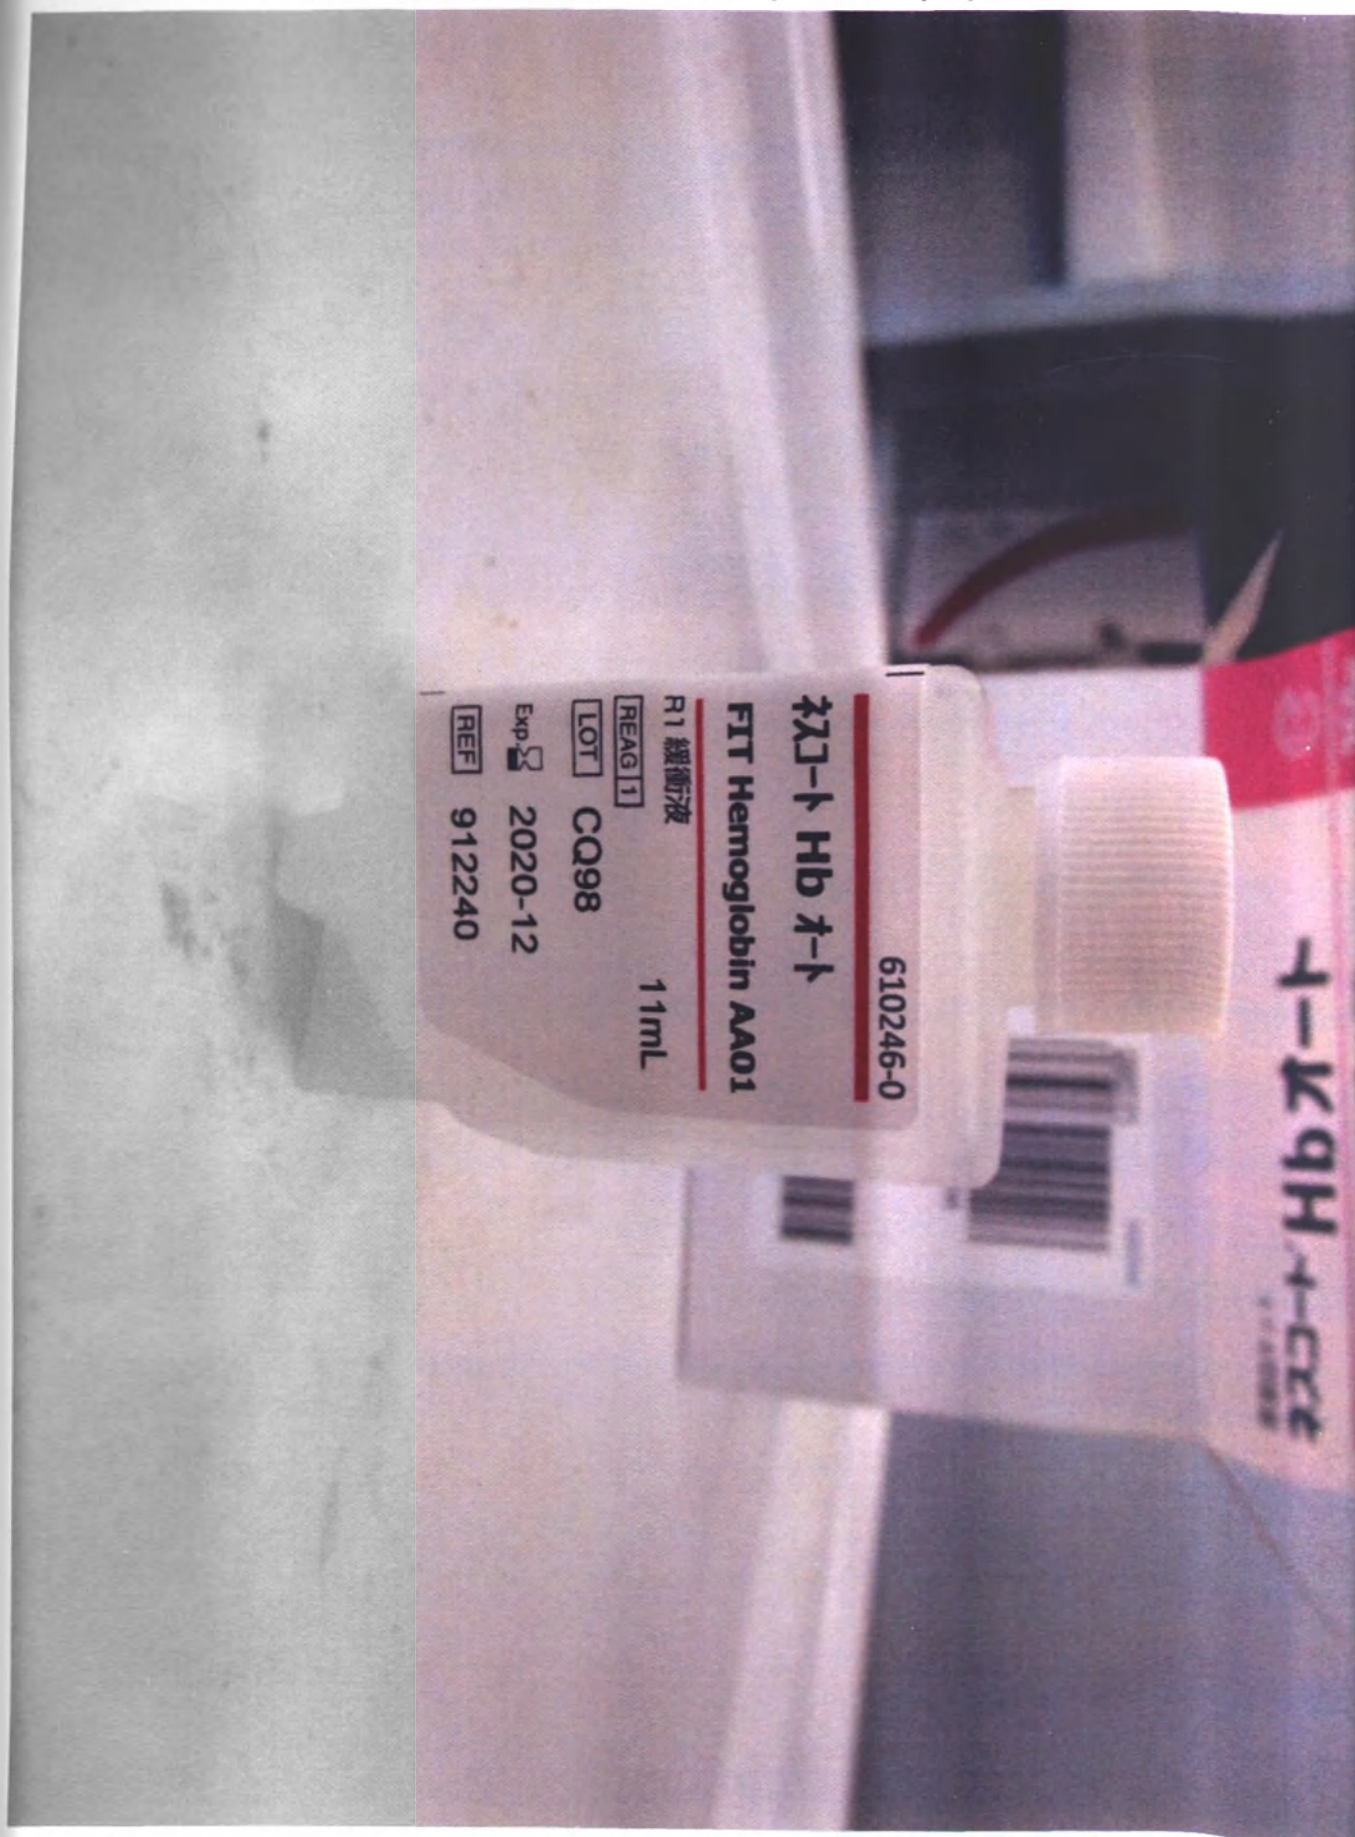

Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения гемоглобина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – FIT Hemoglobin AA01 (ФИТ Гемоглобин AA01) – Фотография 5




Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения гемоглобина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – FIT Hemoglobin AA01 (ФИТ Гемоглобин AA01) – Фотография 6



Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения гемоглобина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – FIT Hemoglobin AA01 (ФИТ Гемоглобин AA01) – Фотография 7




Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения гемоглобина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – FIT Hemoglobin AA01 (ФИТ Гемоглобин AA01) – Фотография 8

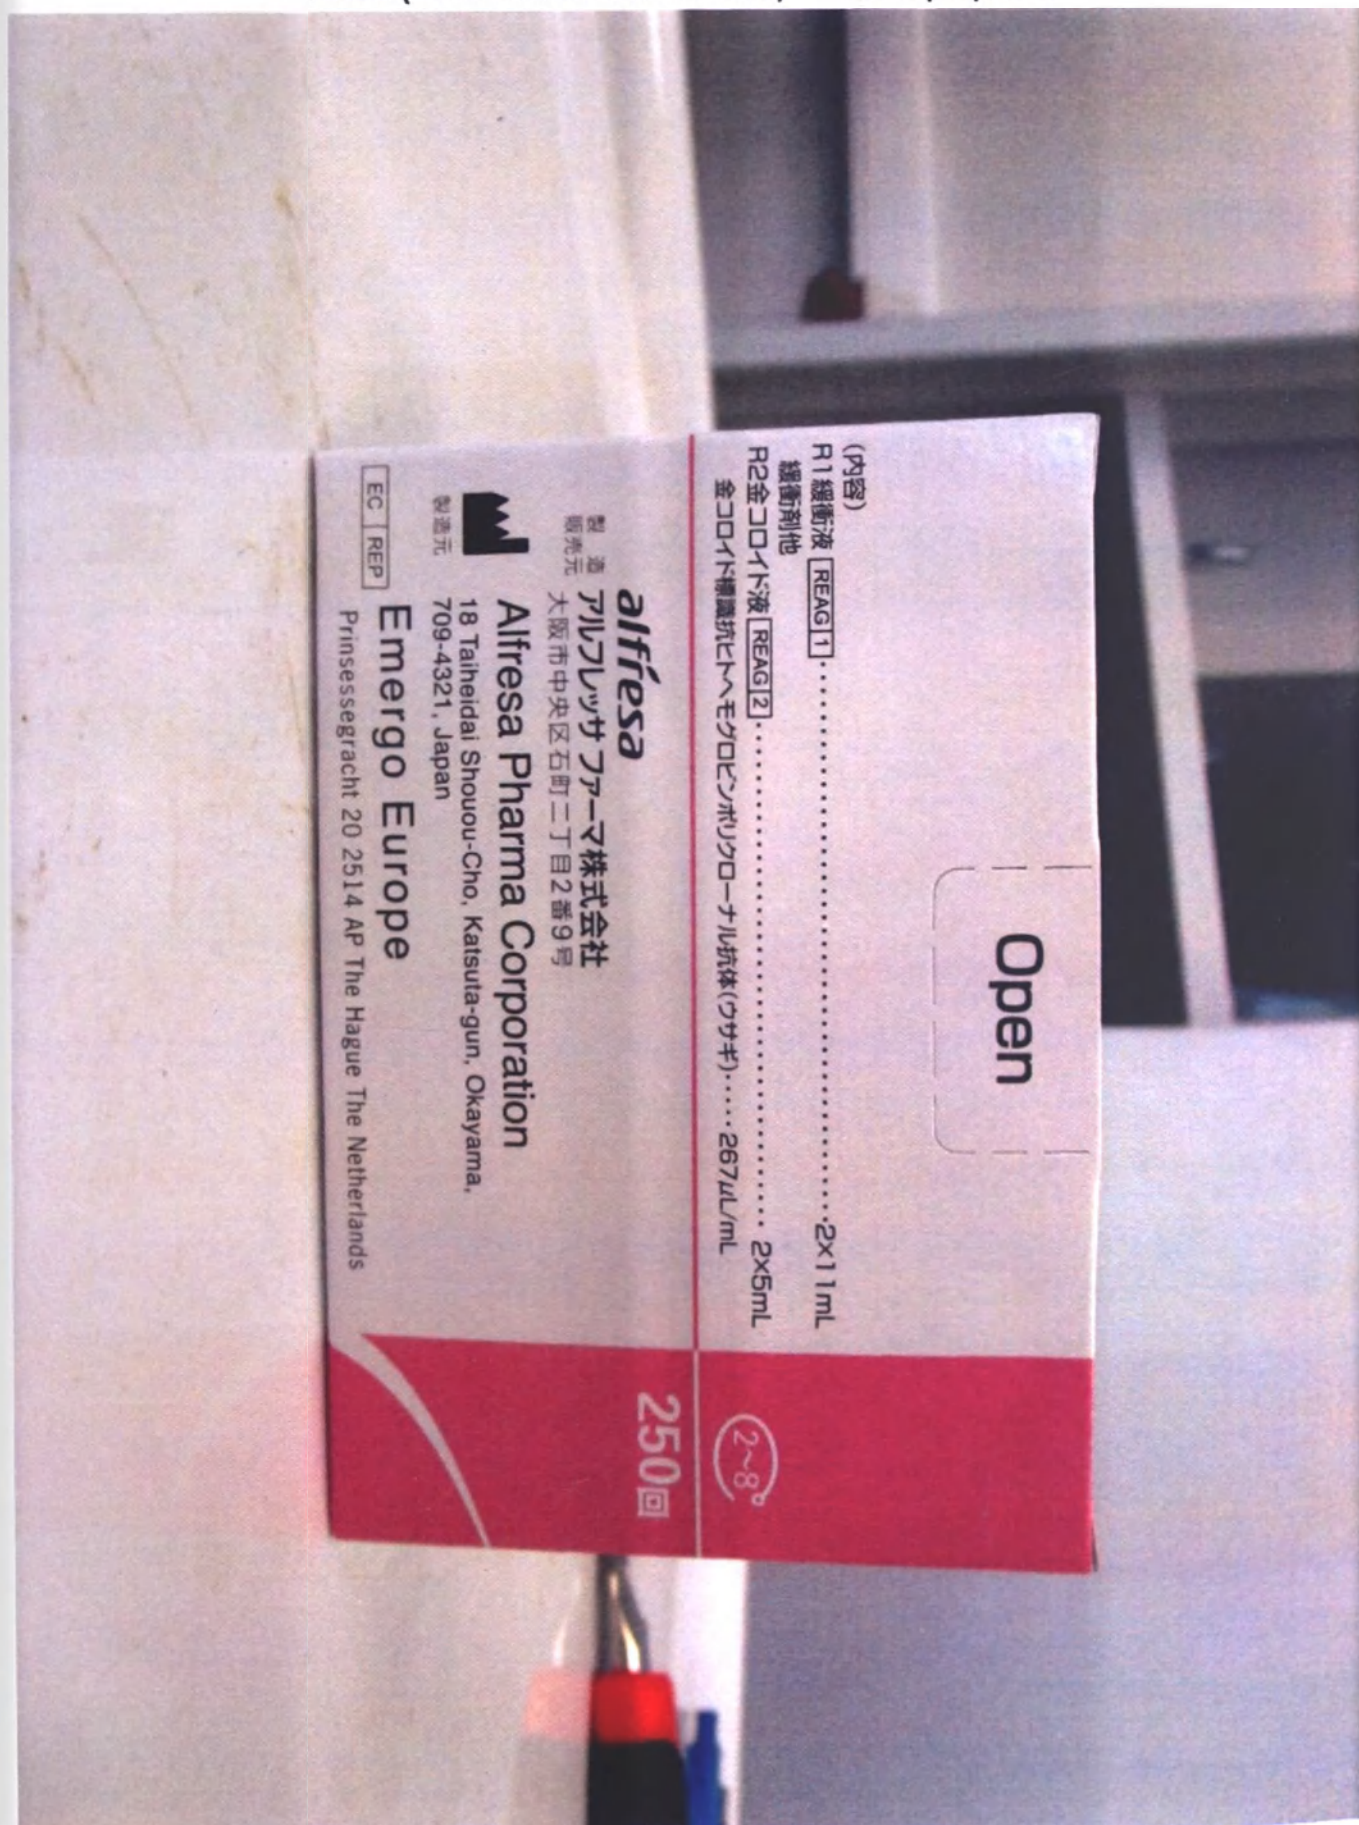


Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения гемоглобина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – FIT Hemoglobin AA01 (ФИТ Гемоглобин AA01) – Фотография 9



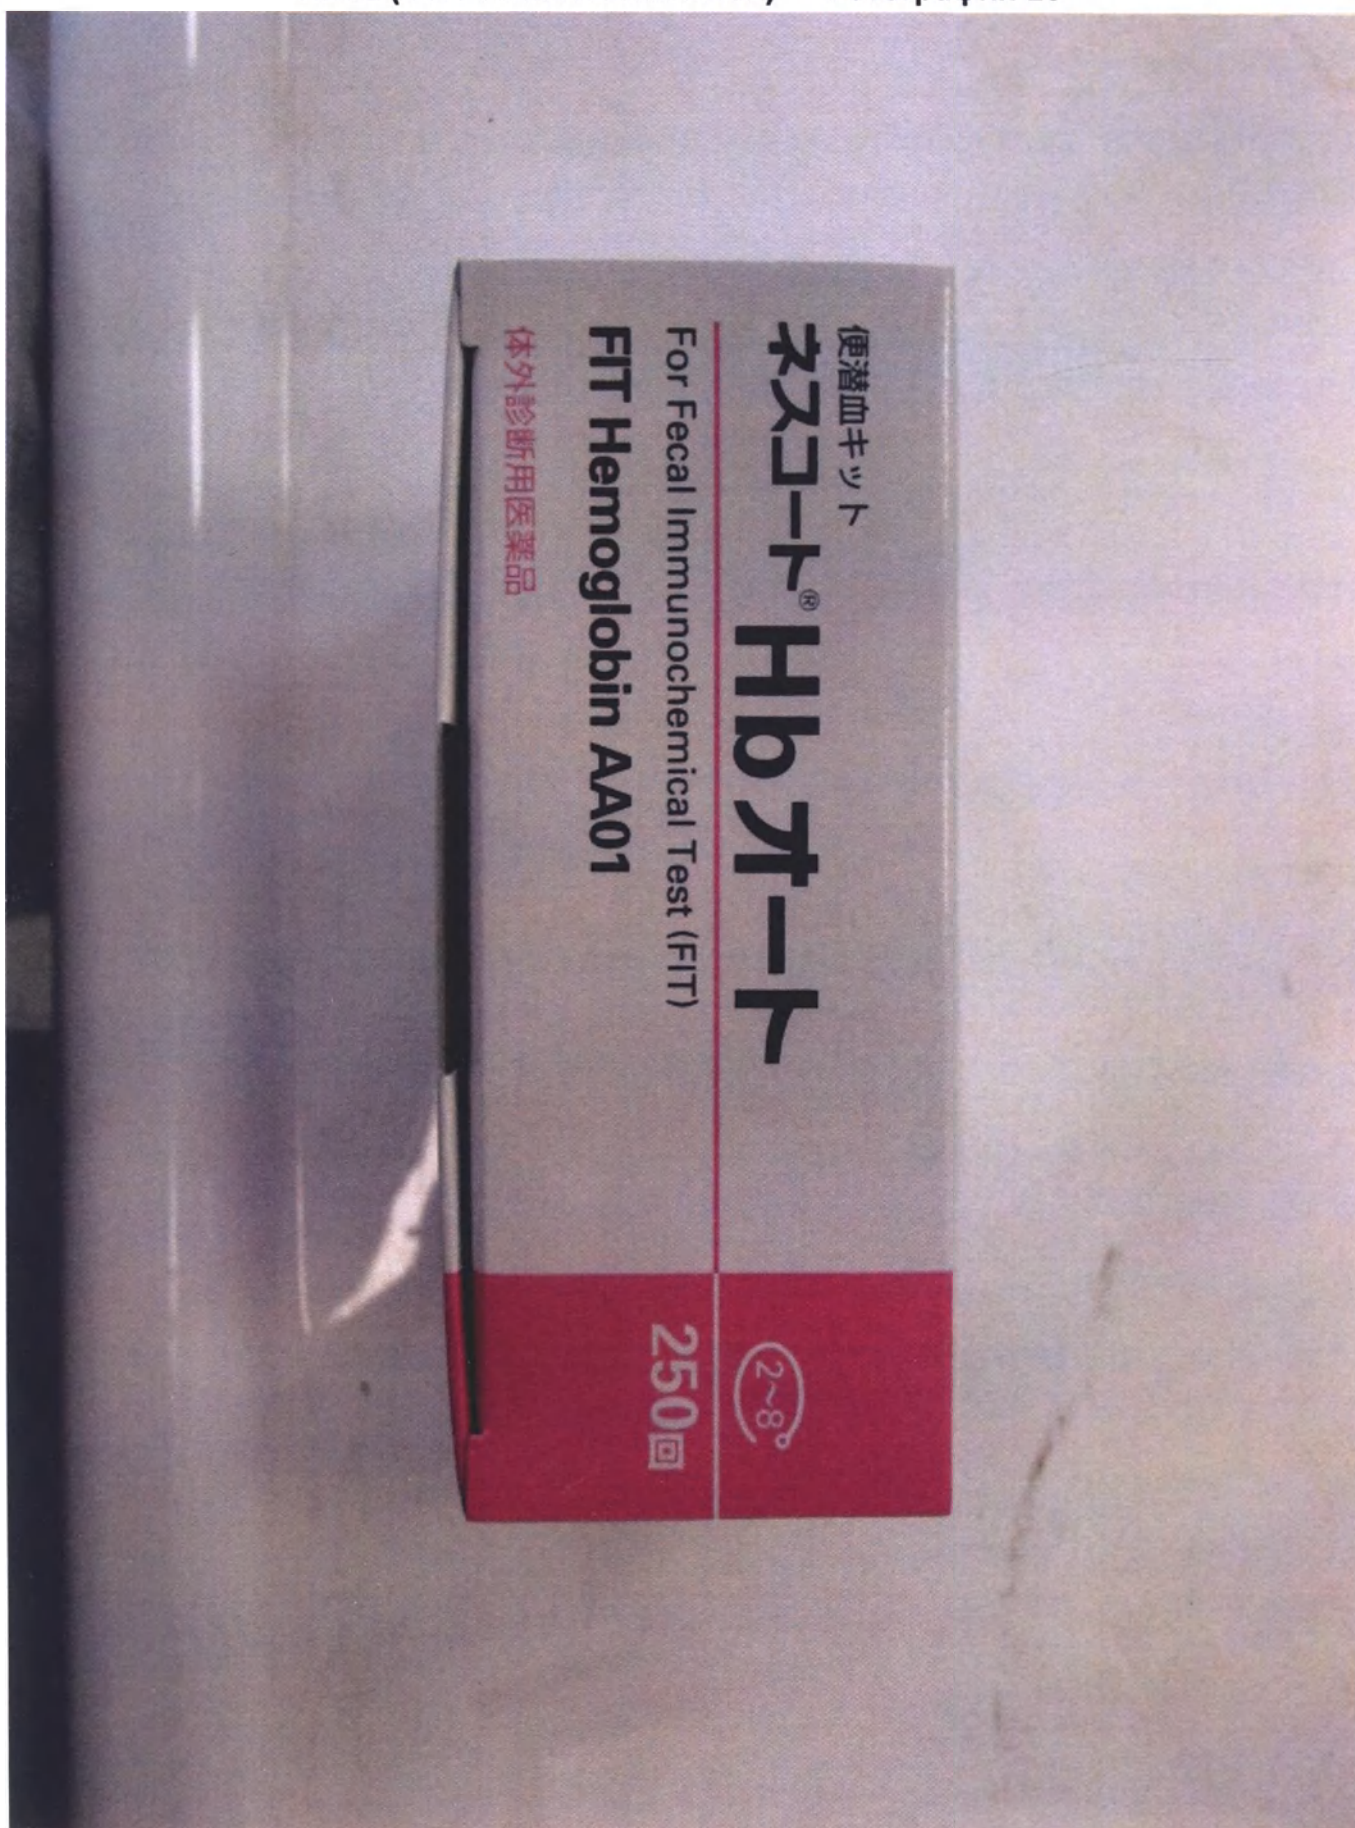


Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения гемоглобина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – FIT Hemoglobin AA01 (ФИТ Гемоглобин AA01) – Фотография 11

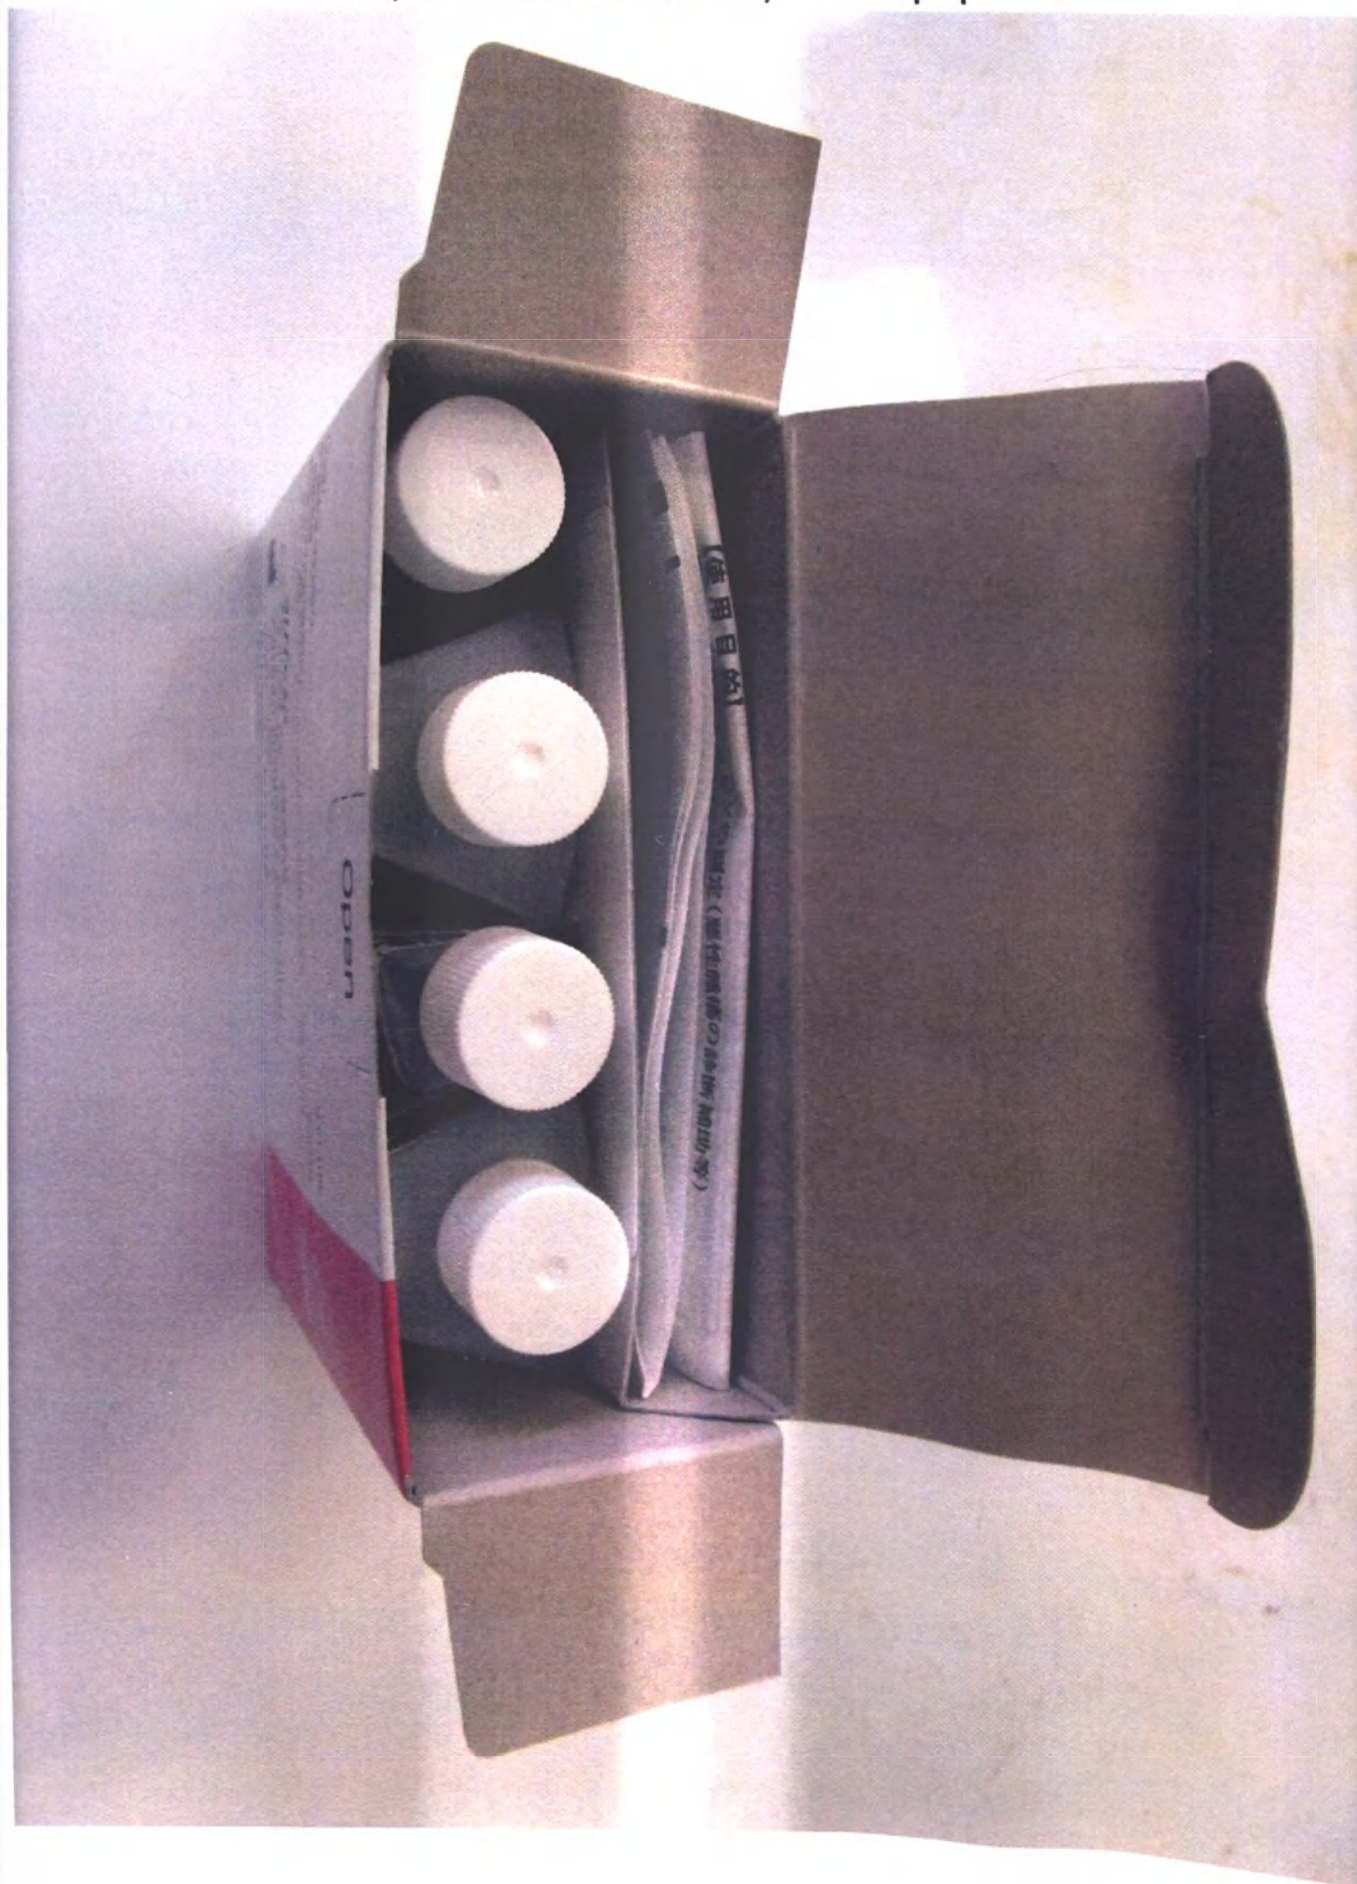


Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения гемоглобина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – FIT Hemoglobin AA01 (ФИТ Гемоглобин AA01) – Фотография 12




Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения гемоглобина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – FIT Hemoglobin AA01 (ФИТ Гемоглобин AA01) – Фотография 13

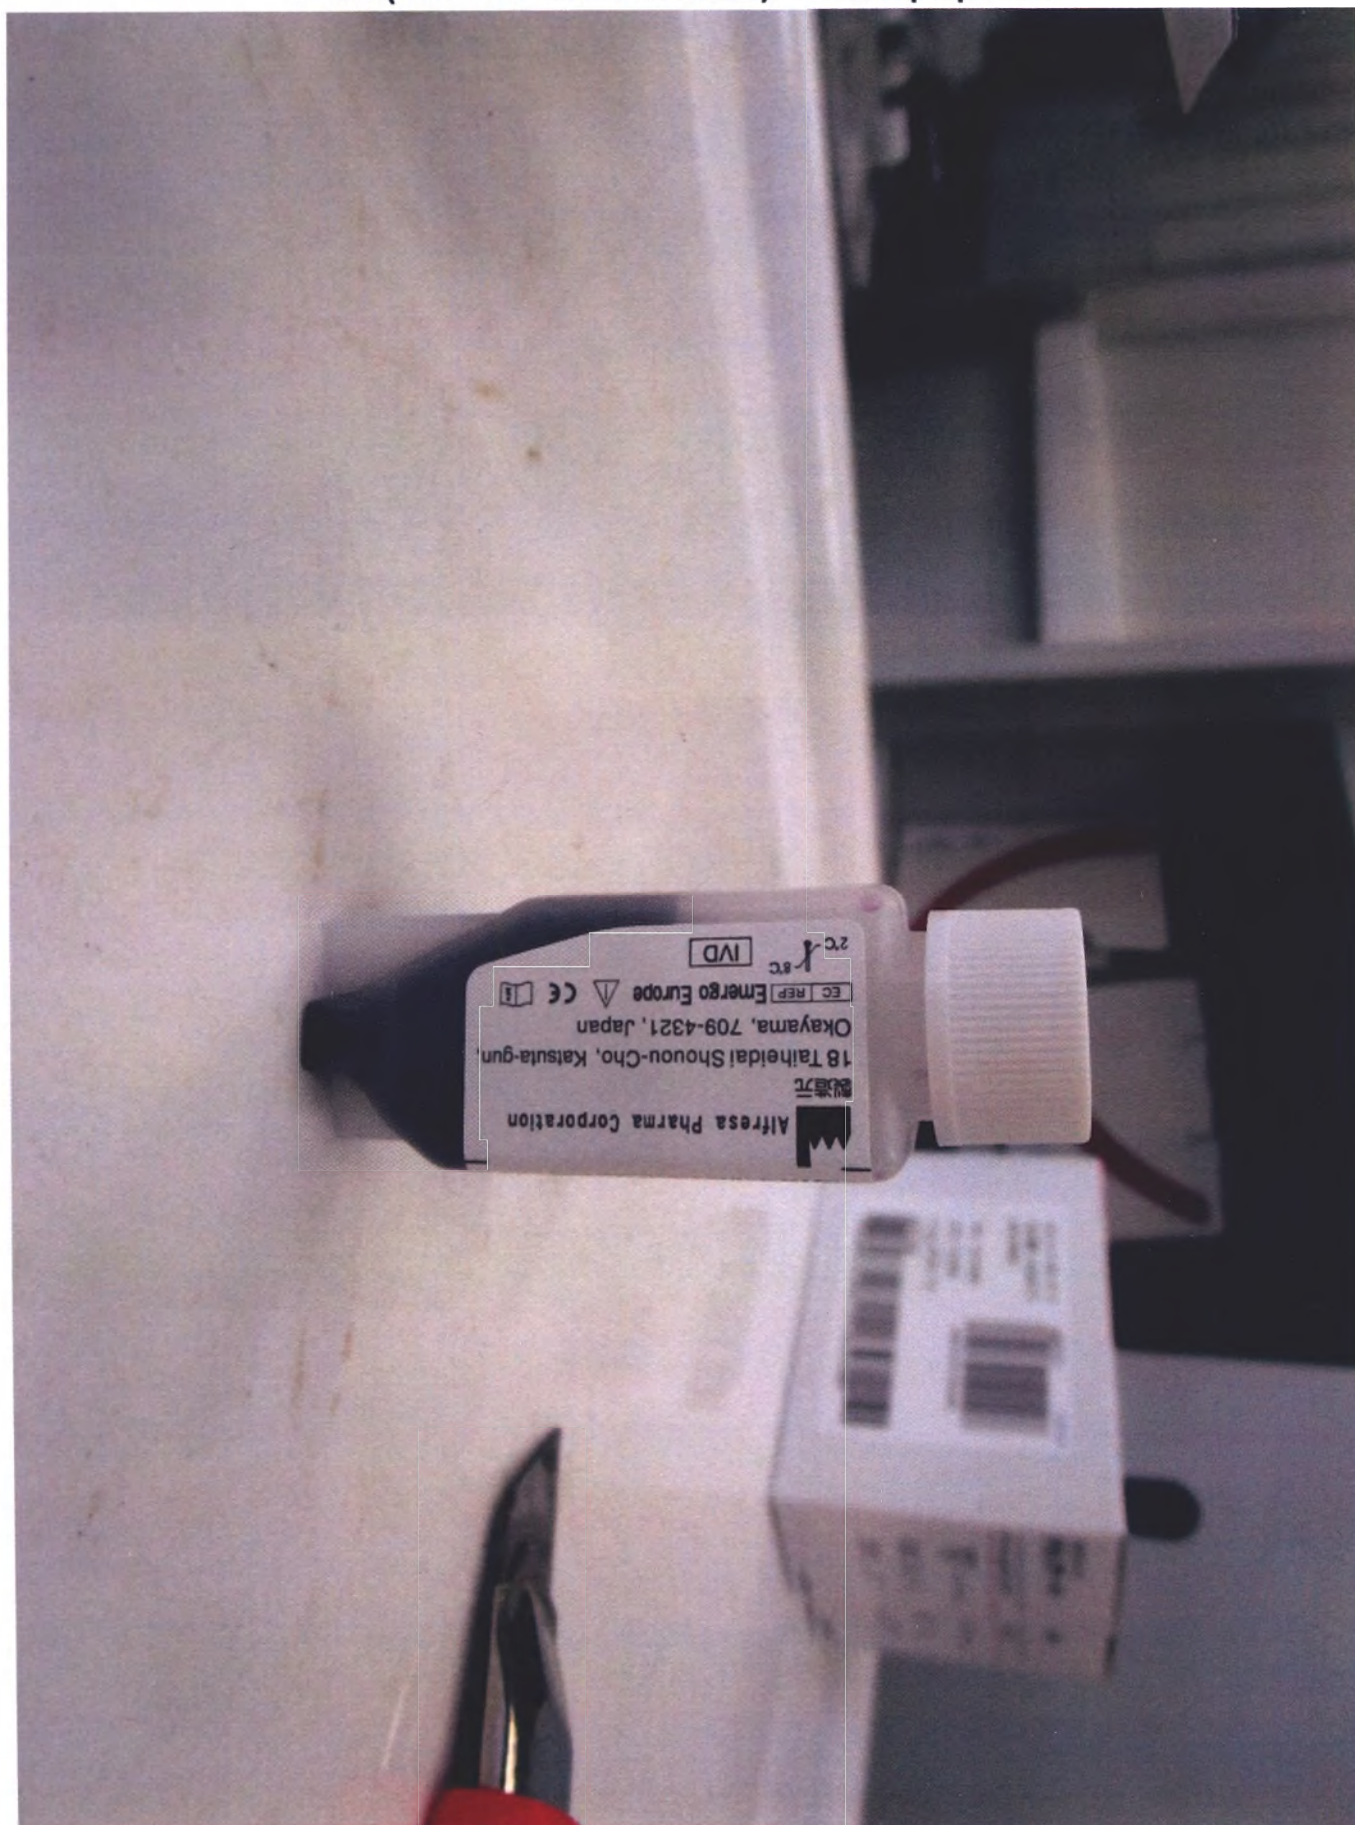

Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения гемоглобина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – FIT Hemoglobin AA01 (ФИТ Гемоглобин AA01) – Фотография 14

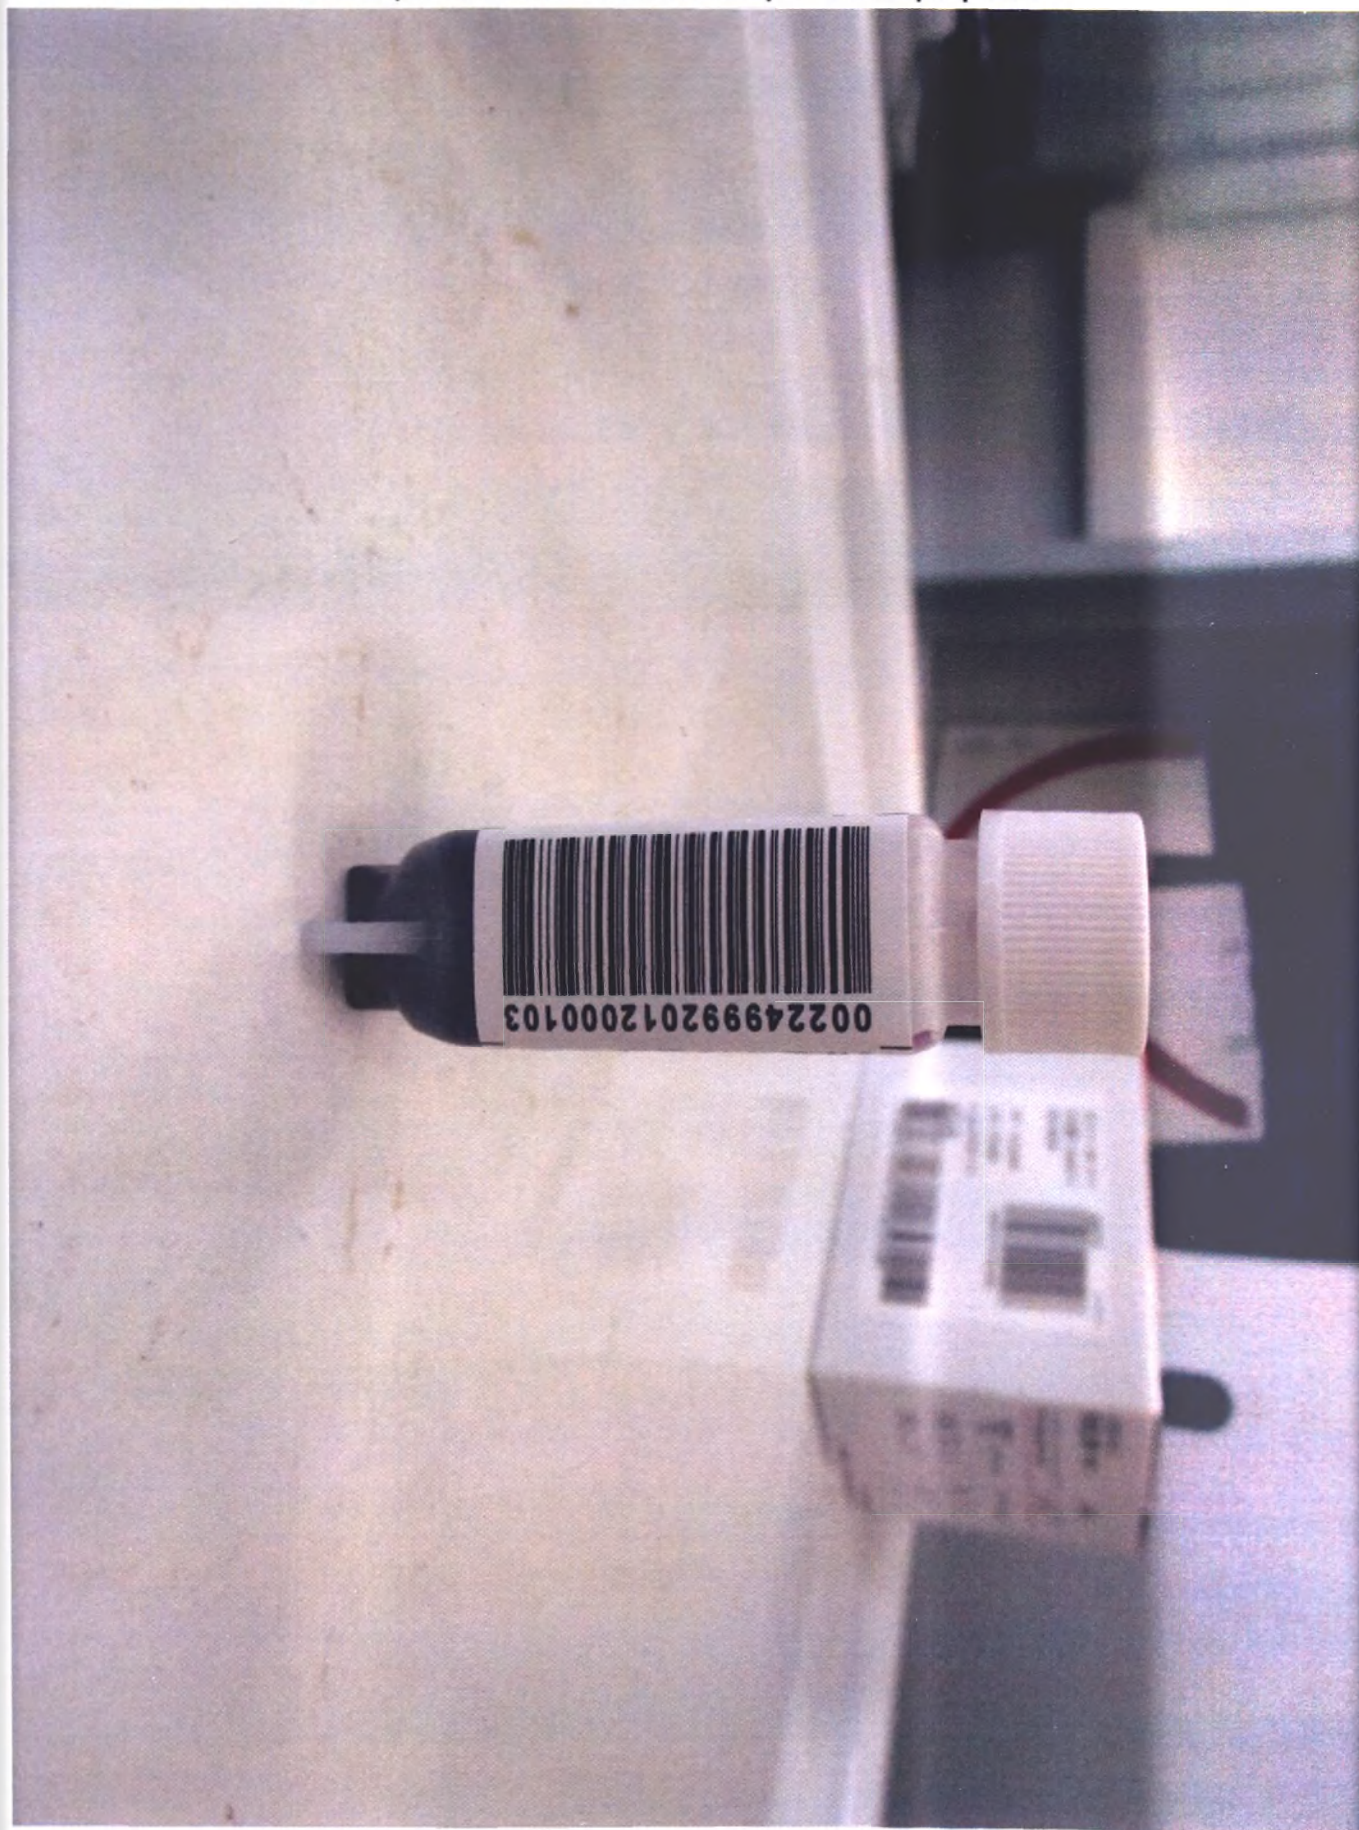


Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения гемоглобина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – FIT Hemoglobin AA01 (ФИТ Гемоглобин AA01) – Фотография 15

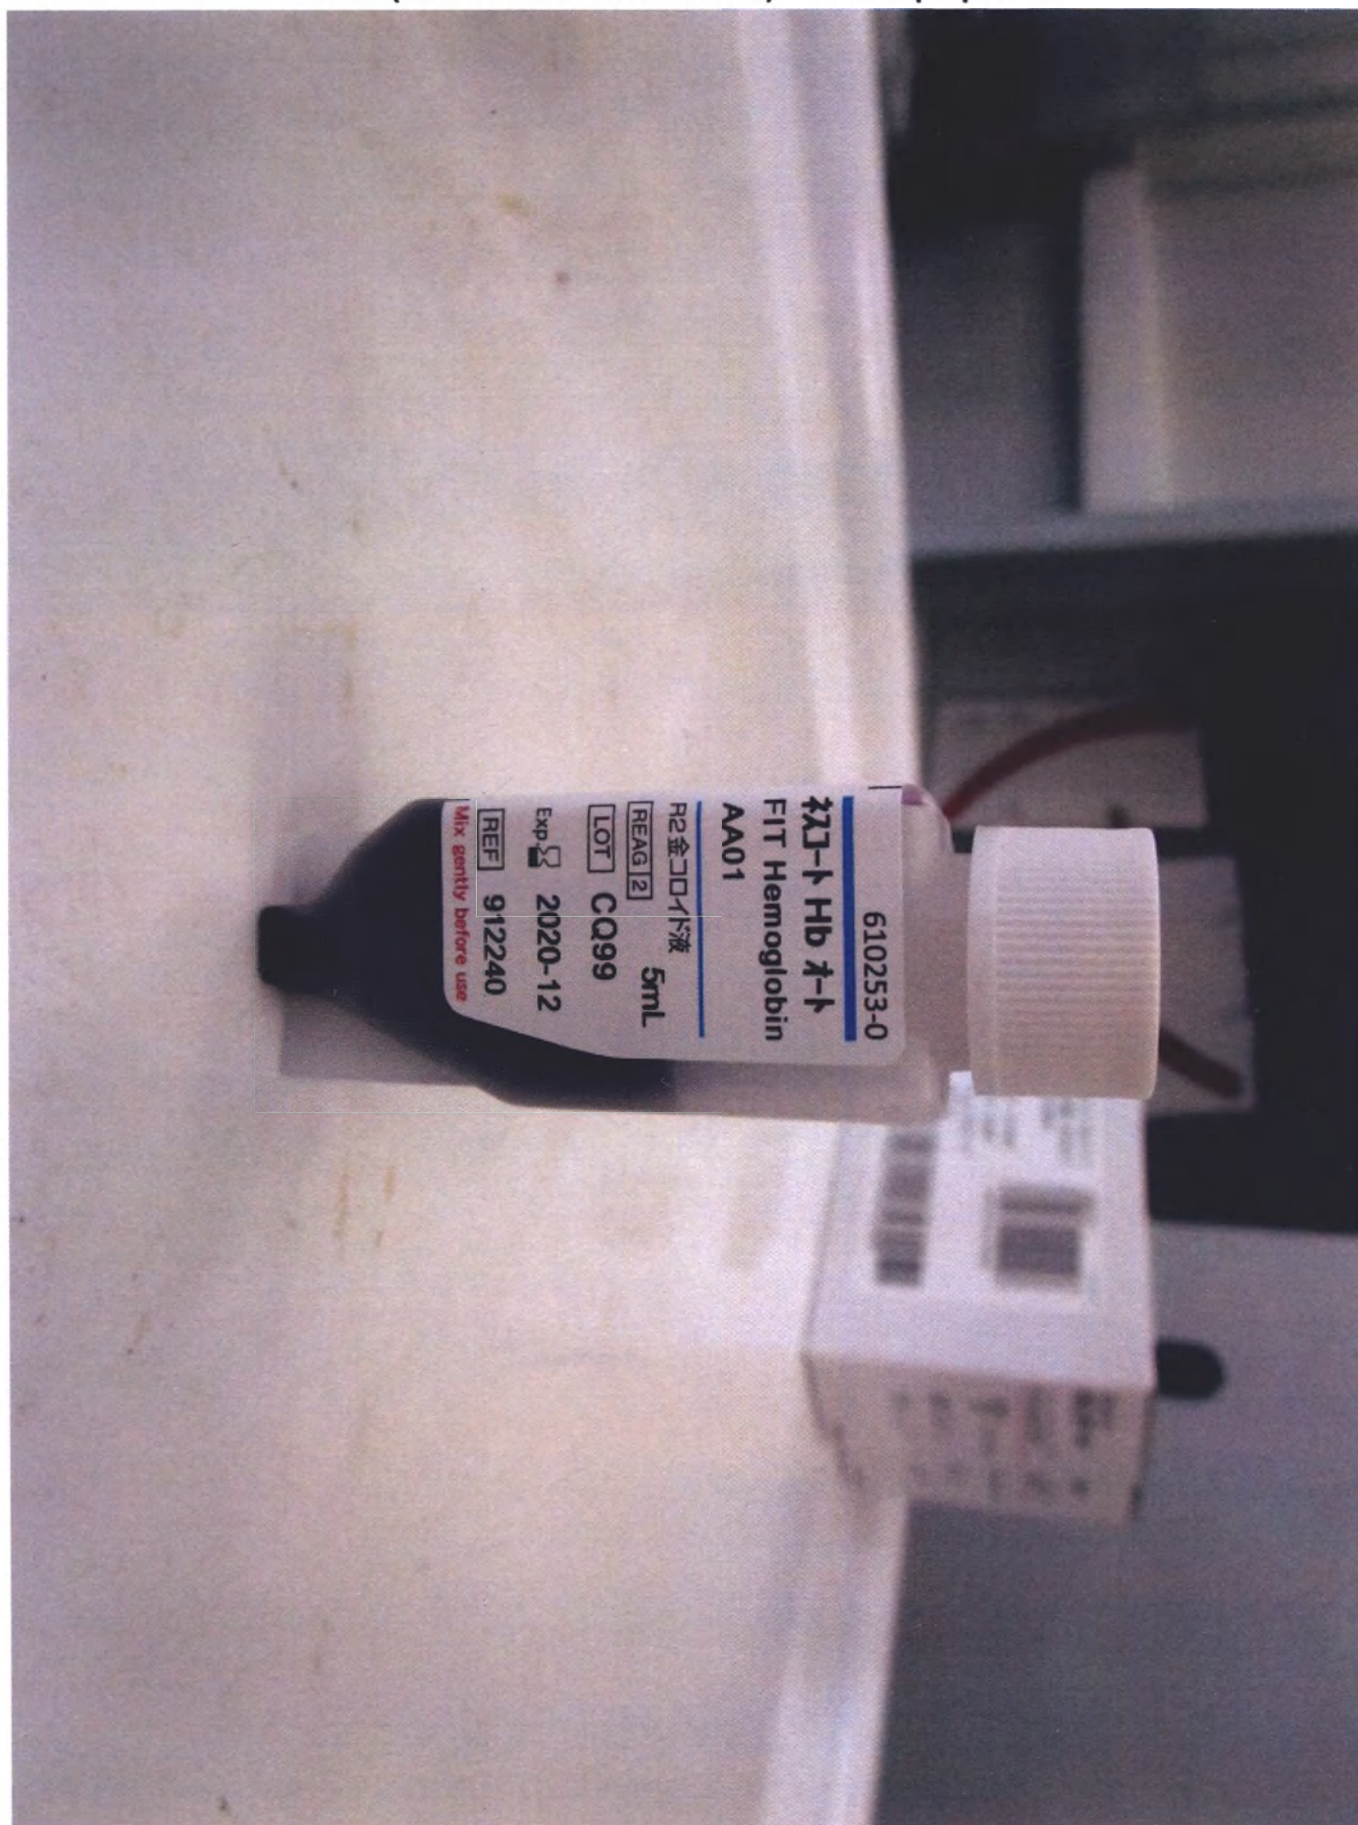


Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения гемоглобина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – FIT Hemoglobin AA01 (ФИТ Гемоглобин AA01) – Фотография 16



Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения гемоглобина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – FIT Hemoglobin AA01 (ФИТ Гемоглобин AA01) – Фотография 17

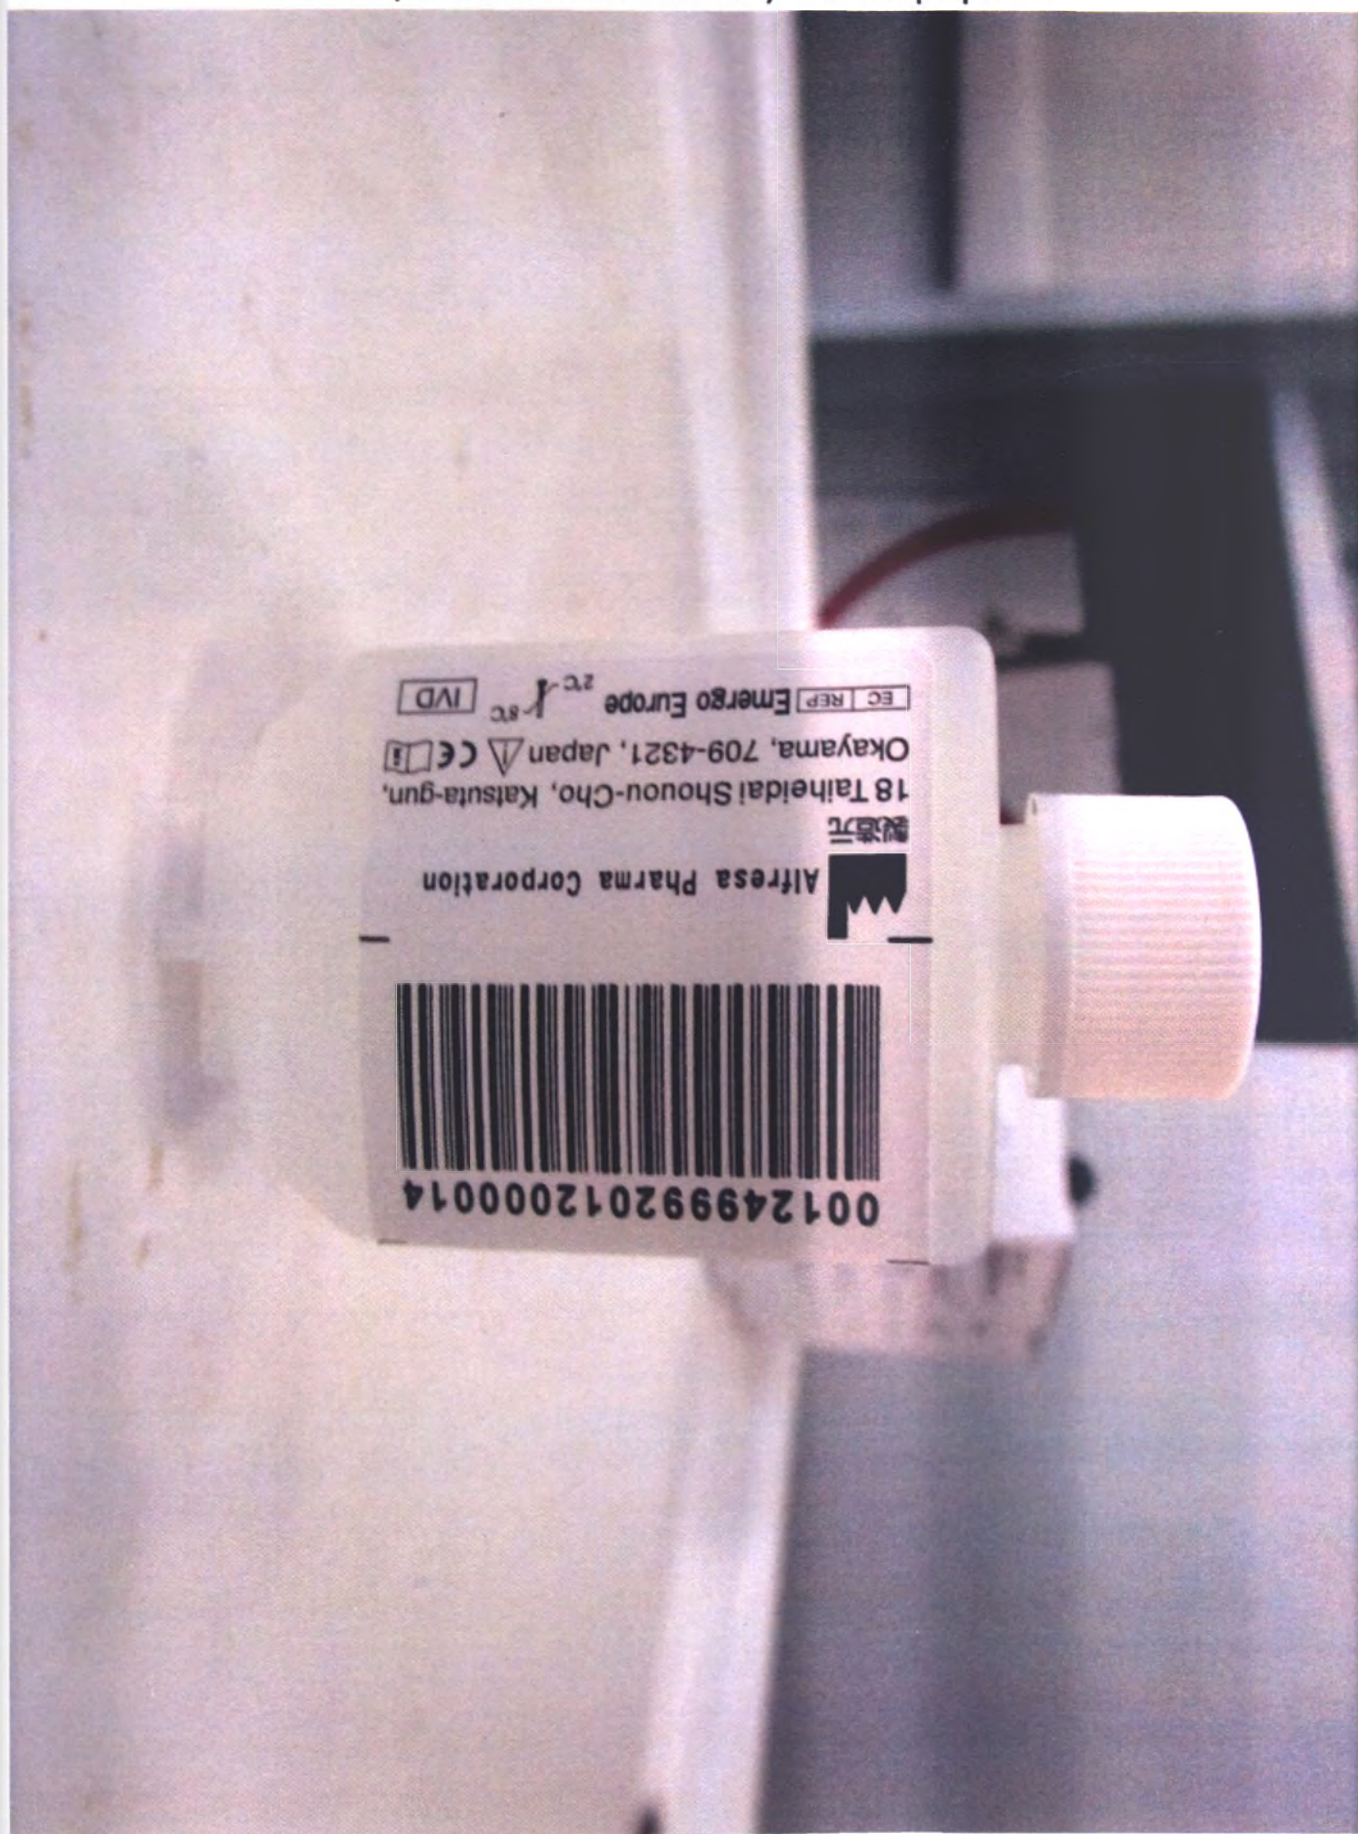

Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения гемоглобина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – FIT Hemoglobin AA01 (ФИТ Гемоглобин AA01) – Фотография 18

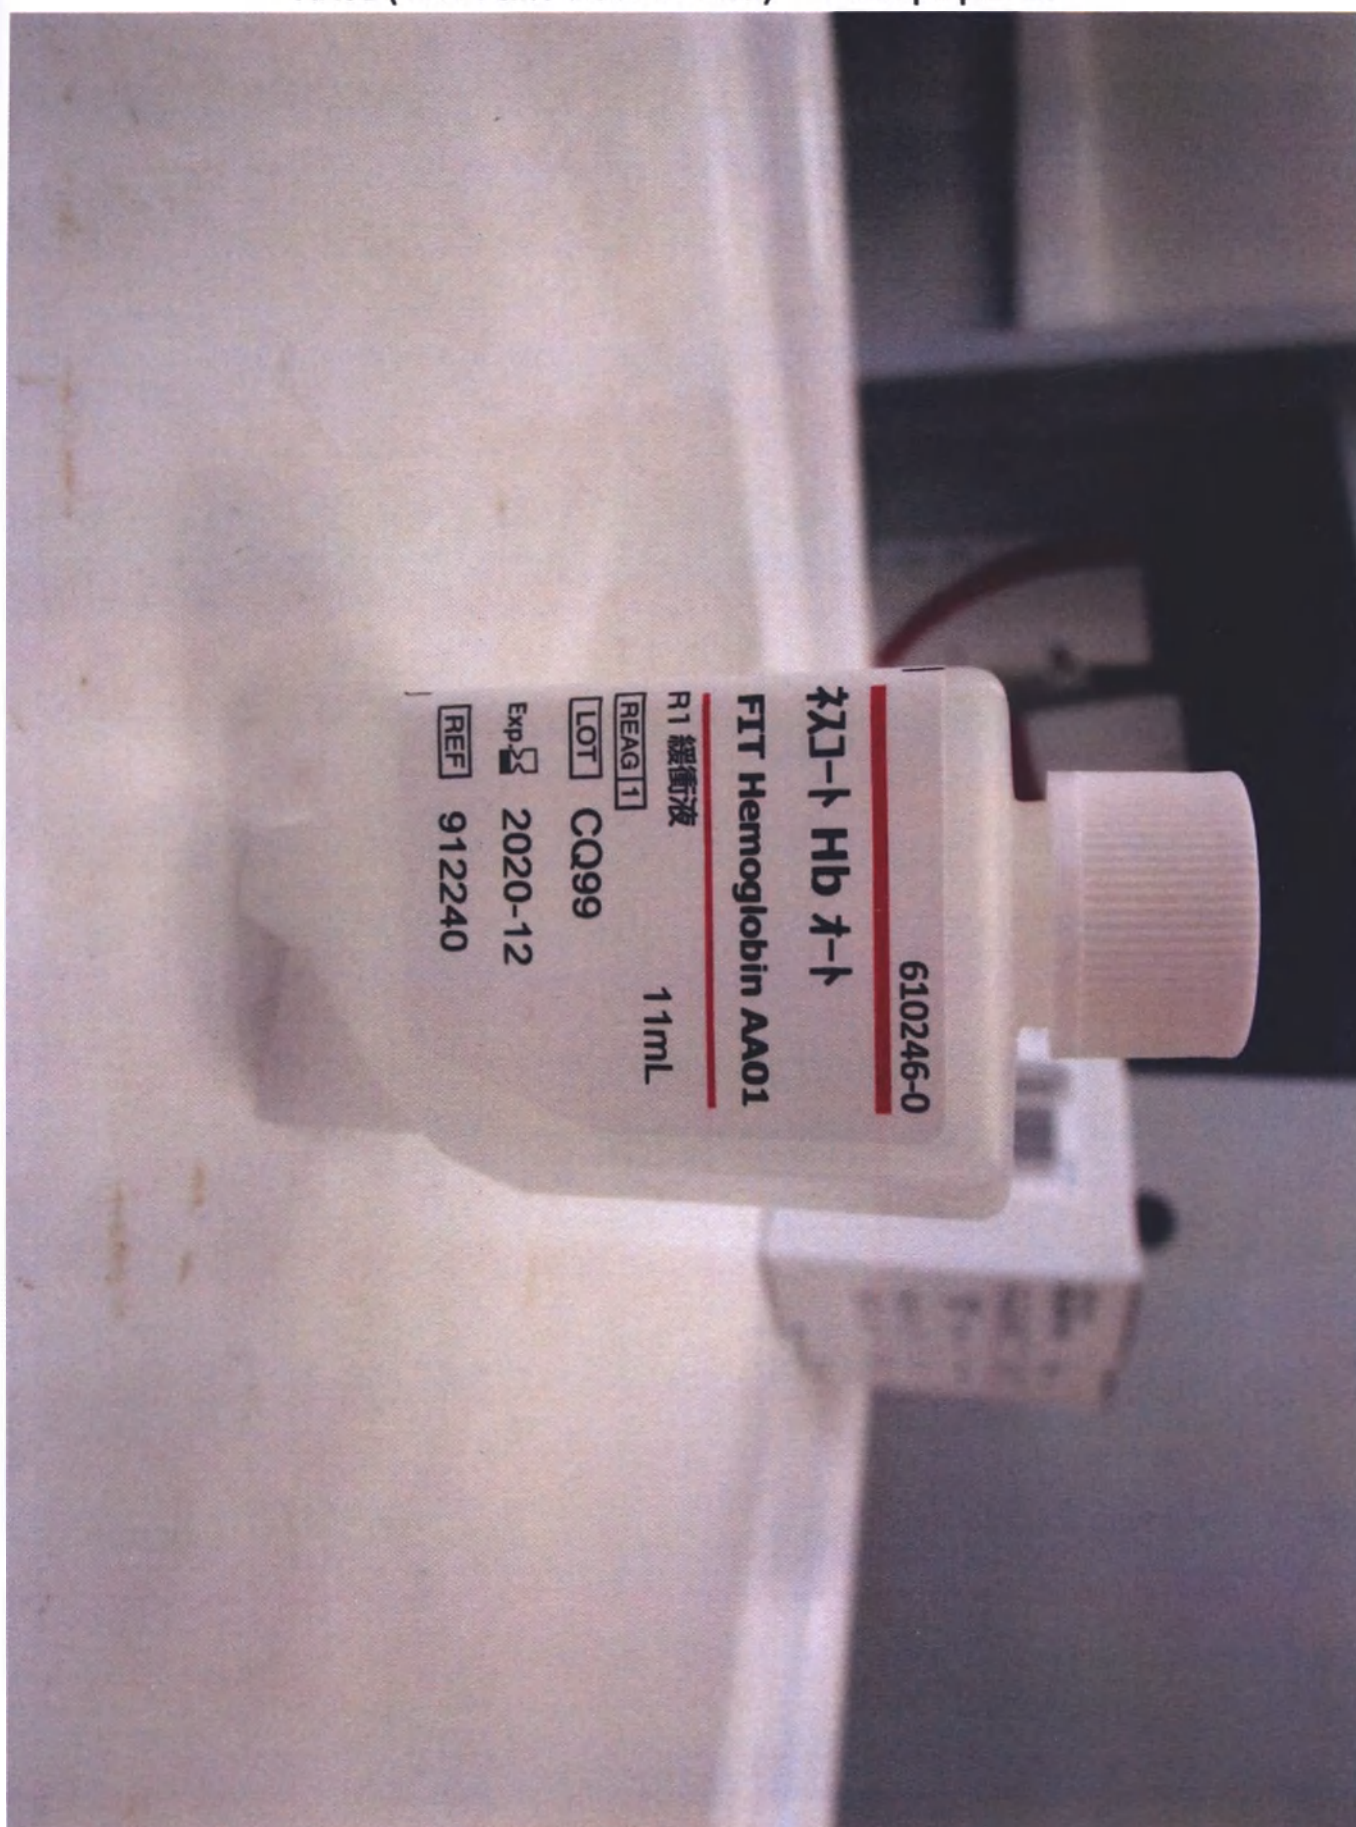

Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения гемоглобина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – FIT Hemoglobin AA01 (ФИТ Гемоглобин AA01) – Фотография 19




Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения гемоглобина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – FIT Hemoglobin AA01 (ФИТ Гемоглобин AA01) – Фотография 20




Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения гемоглобина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – FIT Hemoglobin AA01 (ФИТ Гемоглобин AA01) – Фотография 21



Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения гемоглобина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – FIT Hemoglobin AA01 (ФИТ Гемоглобин AA01) – Фотография 22

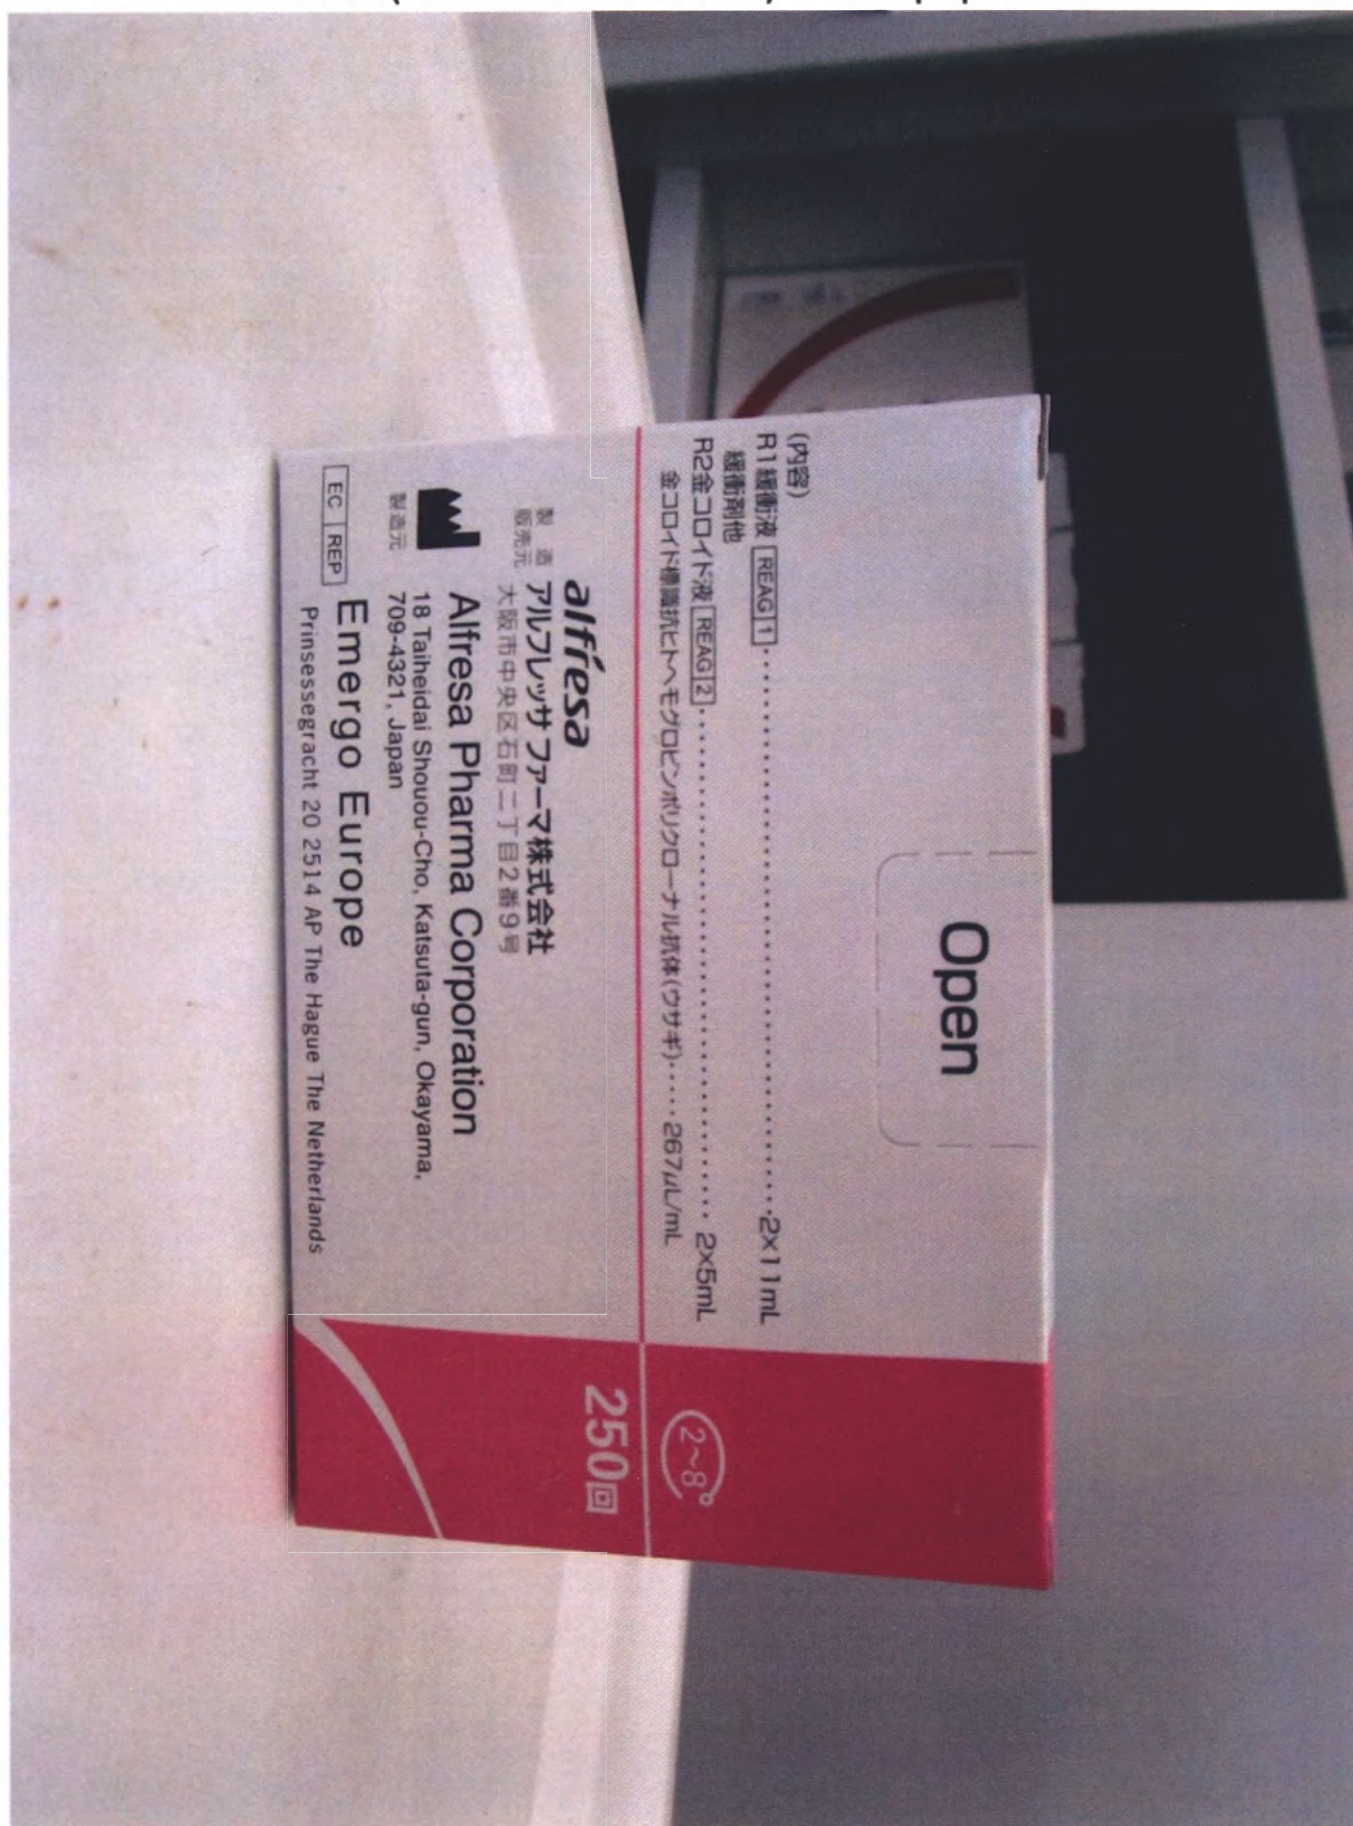


Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения гемоглобина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – FIT Hemoglobin AA01 (ФИТ Гемоглобин AA01) – Фотография 23

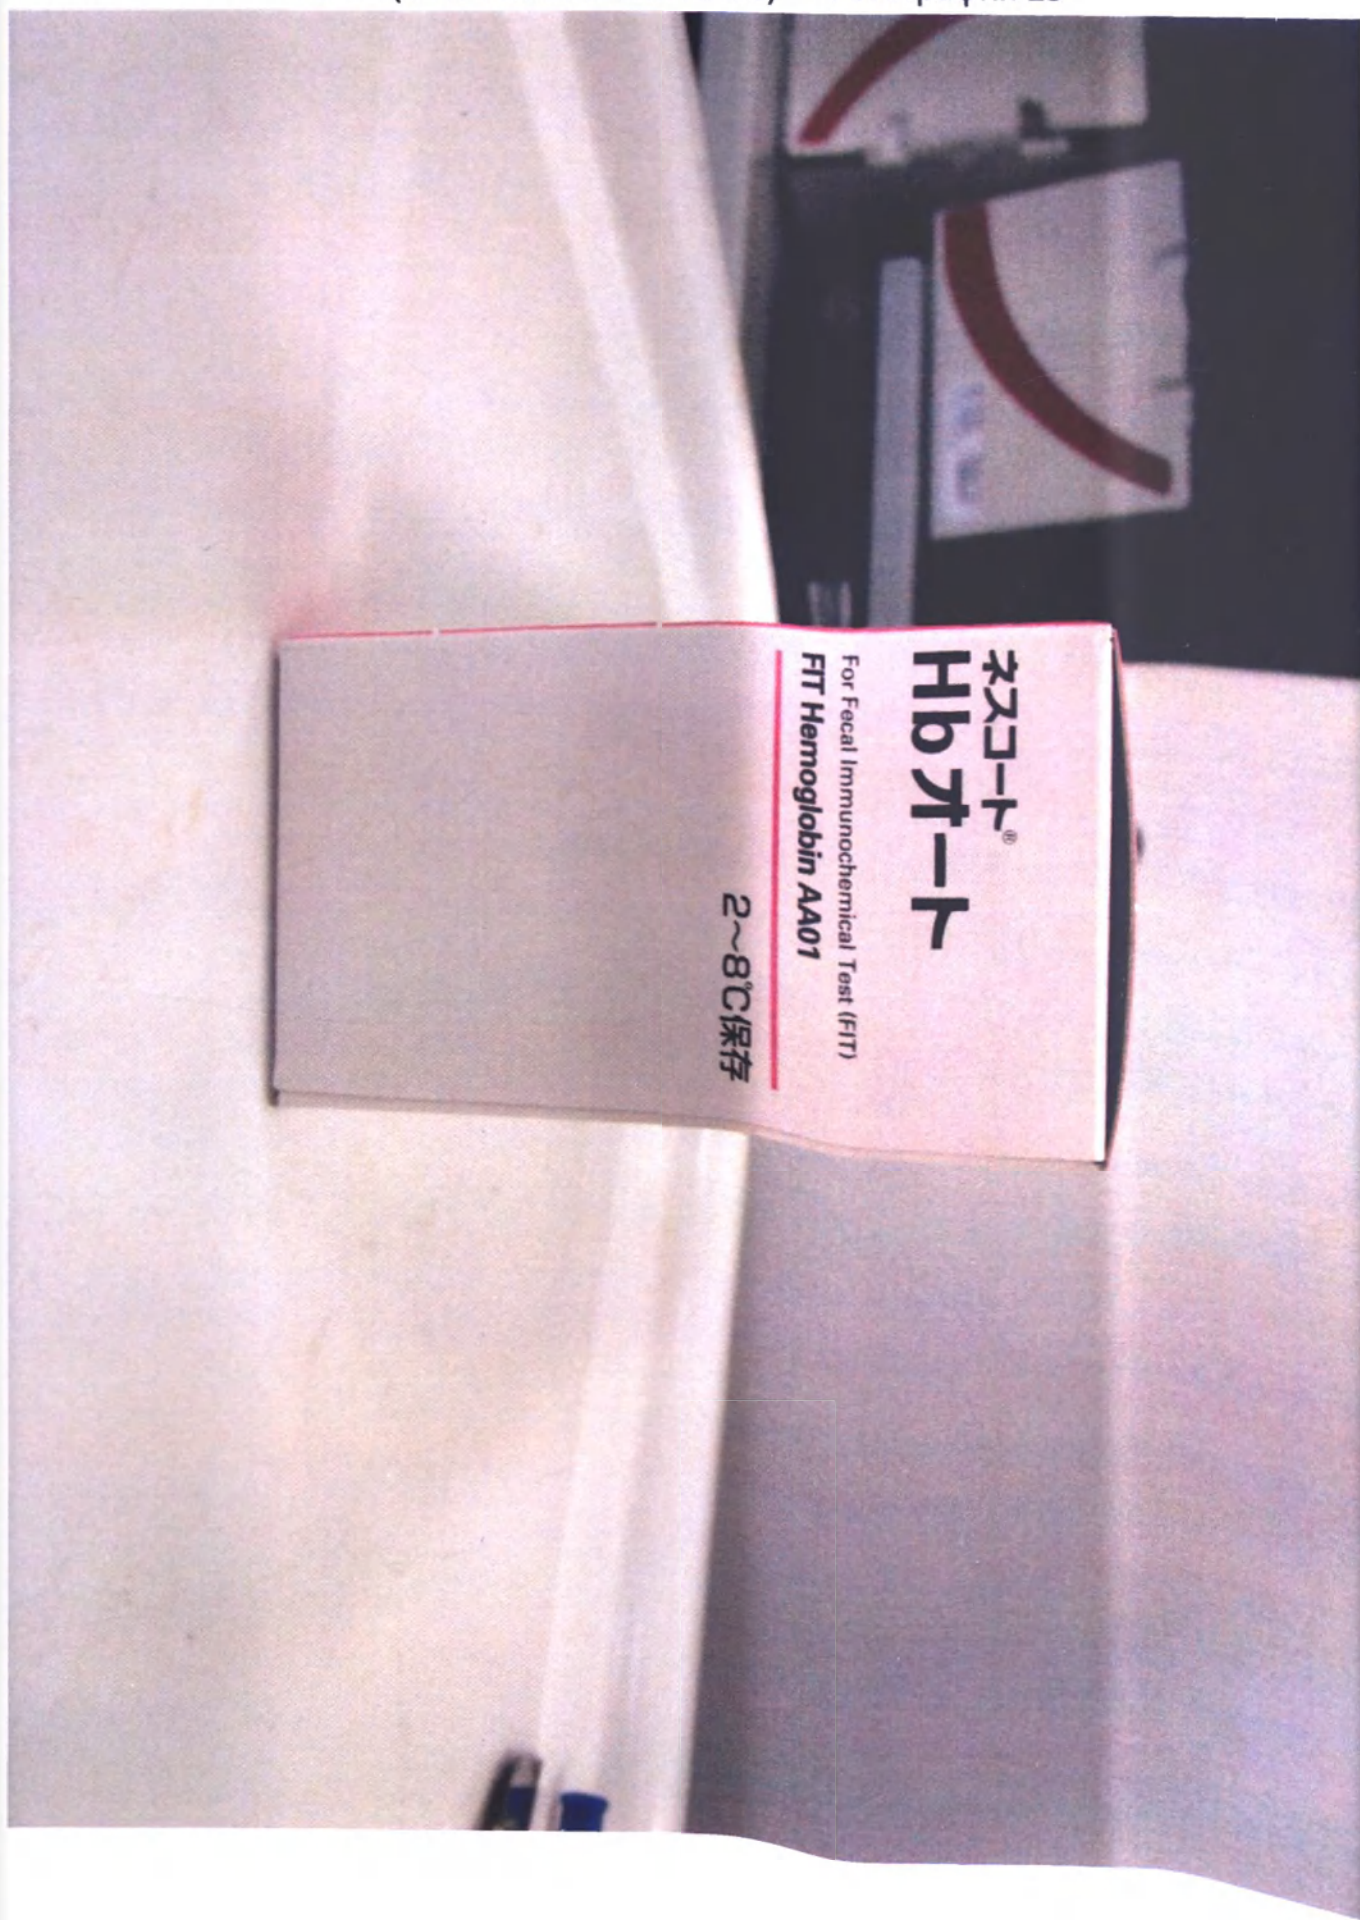

Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения гемоглобина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – FIT Hemoglobin AA01 (ФИТ Гемоглобин AA01) – Фотография 24



Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения гемоглобина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – FIT Hemoglobin AA01 (ФИТ Гемоглобин AA01) – Фотография 25

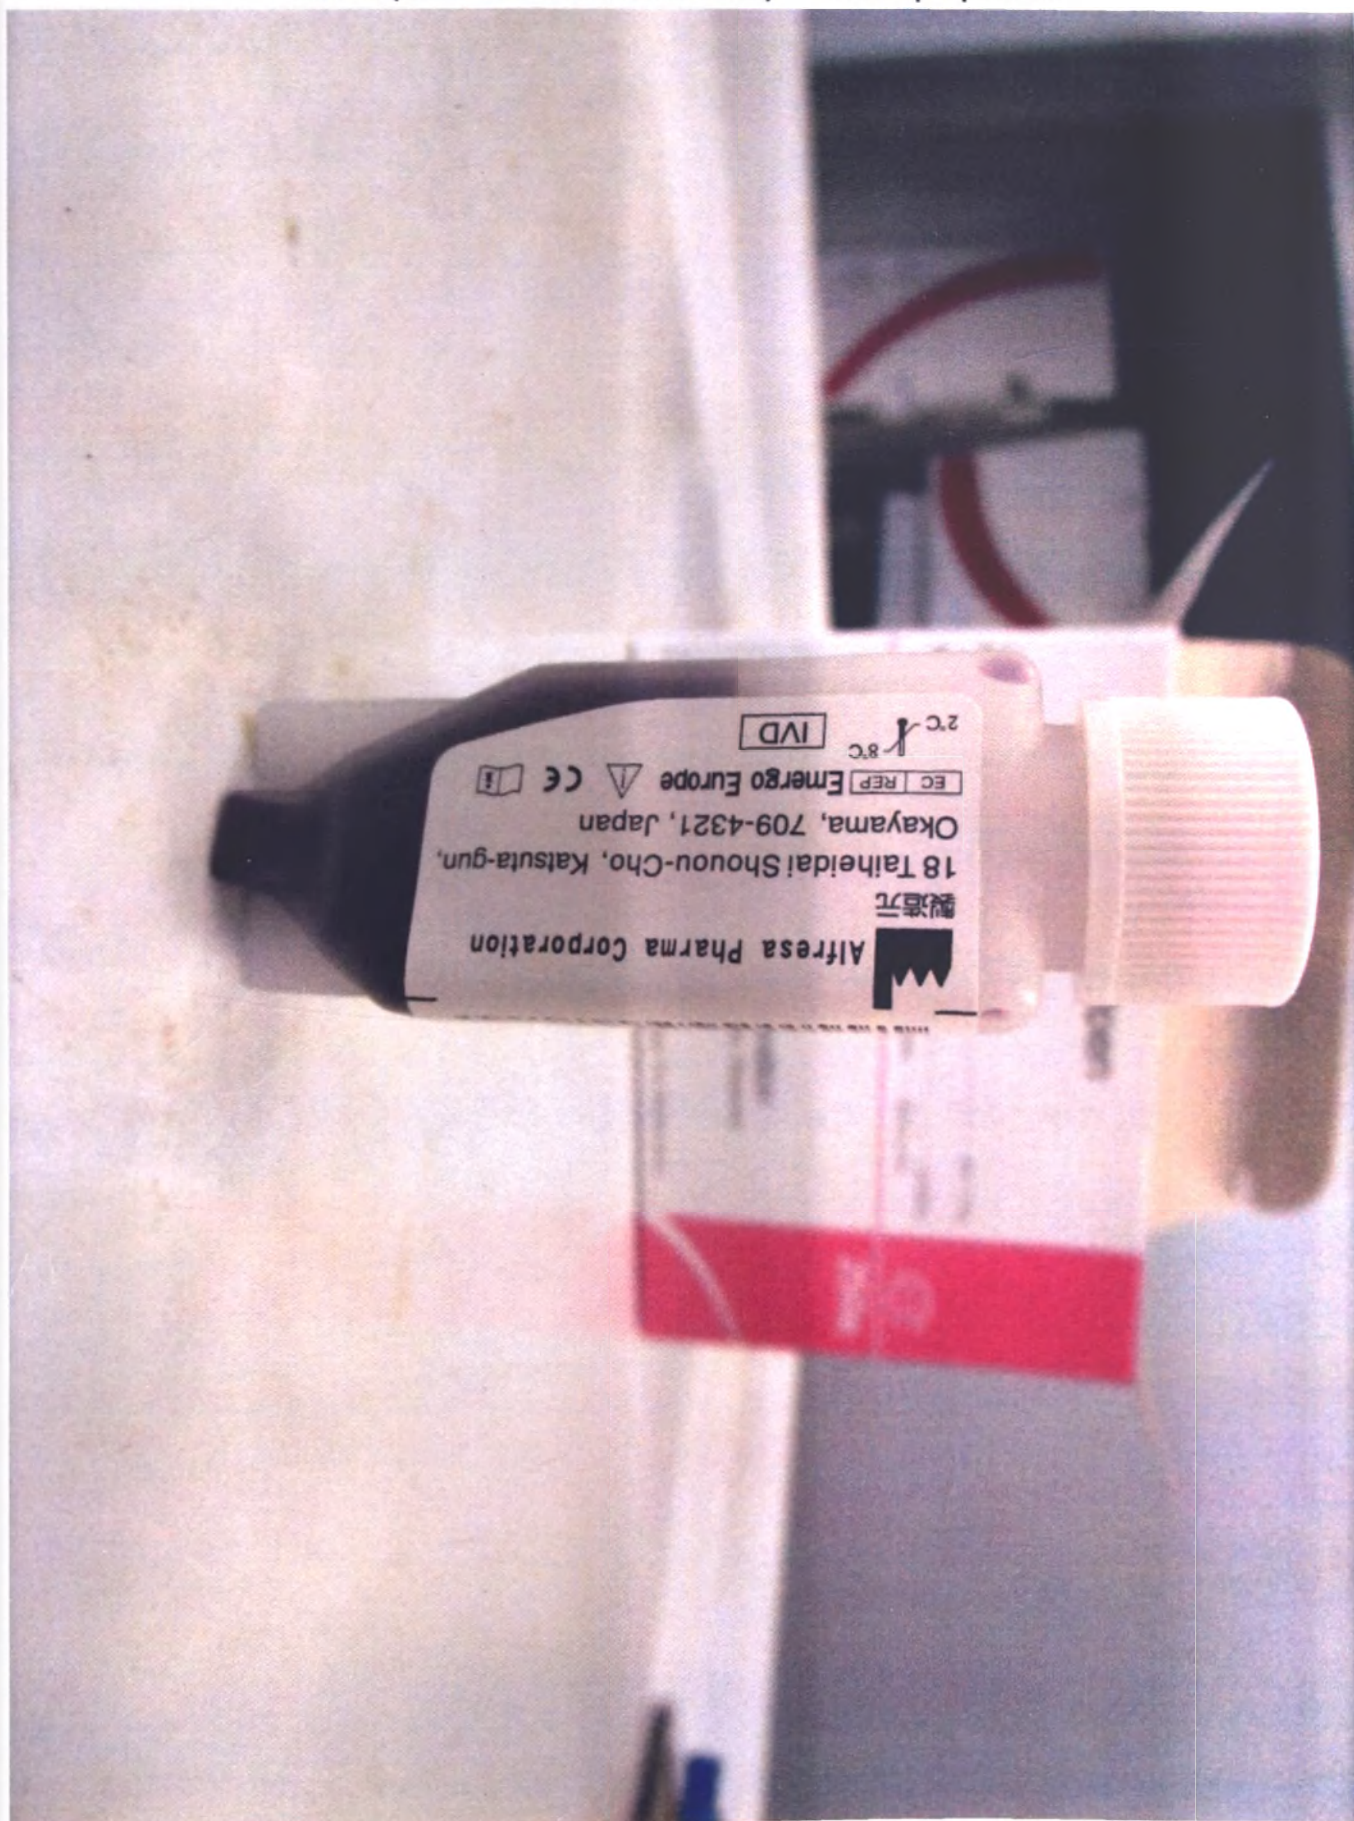

Прошито и пронумеровано

26 (двадцать)

листа(ов)

Генеральный директор

ООО «АГРОС-ИНТЕРНЕЙШНЛ»

Коновалов С.А.

