


Фотографические изображения общего вида

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антител к вирусу гепатита С (ВГС) в сыворотке (плазме) и цельной крови «антиВГС-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-036-41390295-2021

Комплект №1 серия № 210419

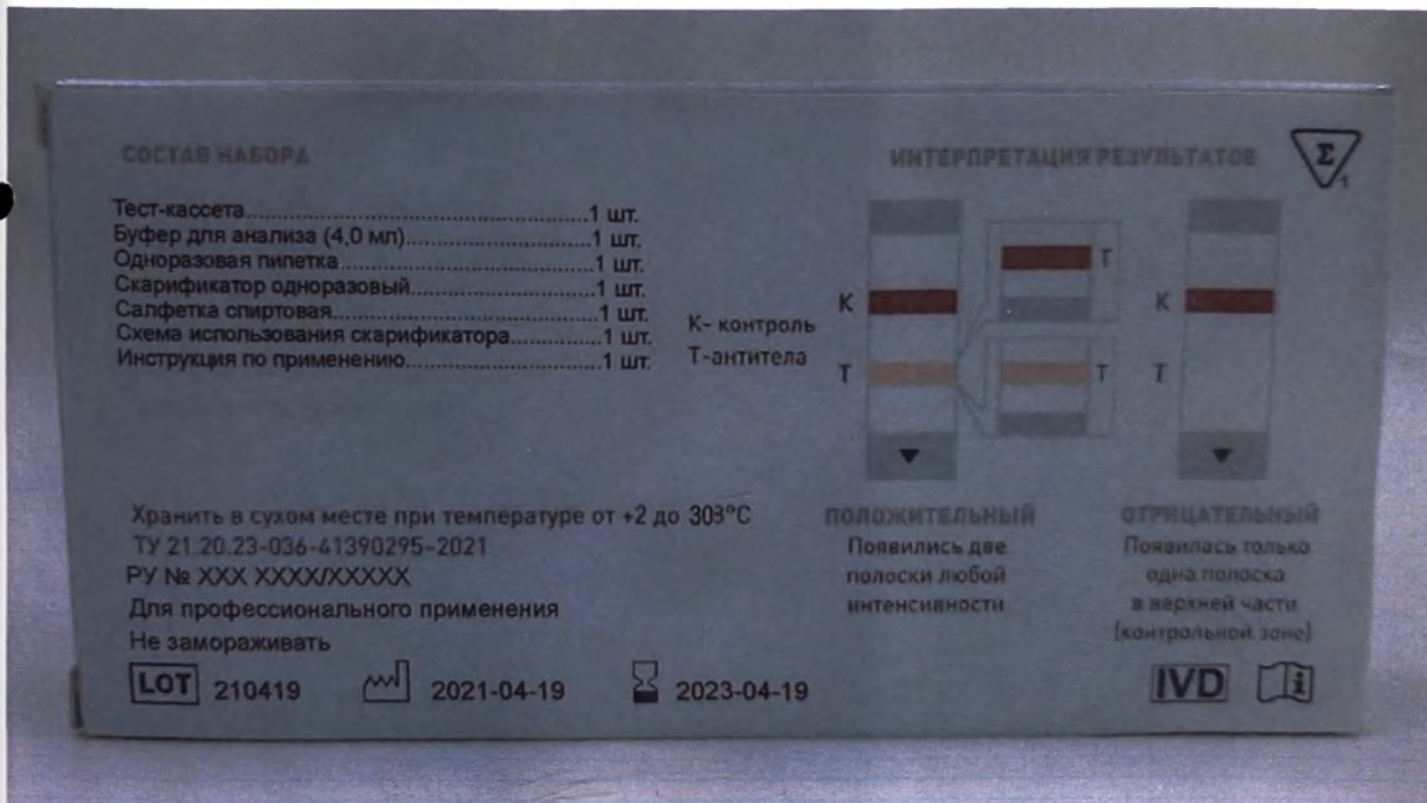

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ГЕПАТИТ С

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антител к вирусу гепатита С (ВГС) в сыворотке (плазме) и цельной крови «антиВГС-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-036-41390295-2021
Комплект №2



3 ТЕСТА

Для диагностики in vitro

СОСТАВ НАБОРА

Тест-кассета.....	3 шт.
Буфер для анализа (4,0 мл).....	1 шт.
Одноразовая пипетка.....	3 шт.
Скарификатор одноразовый.....	3 шт.
Салфетка спиртовая.....	3 шт.
Схема использования скарификатора.....	1 шт.
Инструкция по применению.....	1 шт.

Хранить в сухом месте при температуре от +2 до +30°C
ТУ 21.20.23-036-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

Для профессионального применения

Не замораживать

LOT 210419




2021-04-19



2023-04-19

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

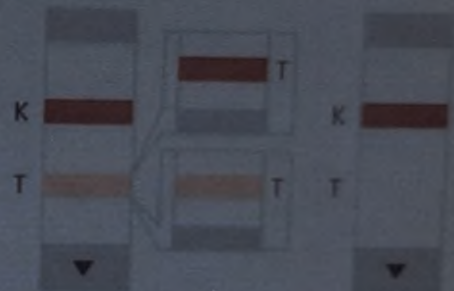

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

Появились две
полоски любой
интенсивности

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

Появилась только
одна полоска
в верхней части
(контрольной зоне)

IVD



СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКРИФИКАТОРА

1 Удалите защитный колпачок

3 Плотнo прижмите к подушечке пальца и нажмите на кнопку.



ИНСТРУКЦИЯ
Использование для скрининга на антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2

Важно!
Использование тест-кассеты возможно только в том случае, если она не была вскрыта ранее. Если упаковка повреждена, тест-кассету использовать нельзя.

Внимание!
Тест-кассета предназначена для скрининга на антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Она не предназначена для диагностики ВИЧ-инфекции. Для диагностики ВИЧ-инфекции необходимо использовать другие методы.

Применение:
1. Подготовка тест-кассеты.
2. Подготовка образца для анализа.
3. Проведение теста.

Противопоказания:
1. Использование тест-кассеты после истечения срока годности.
2. Использование тест-кассеты после вскрытия упаковки.
3. Использование тест-кассеты для диагностики ВИЧ-инфекции.

Другие противопоказания отсутствуют, за исключением случаев, когда набор материалов не может быть использован.



антиВГС- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 3

Набор реагентов для иммунохроматографического
выявления антител к вирусу гепатита С (ВГС)
в сыворотке (плазме) и цельной крови
«антиВГС-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-036-41390295-2021 РУ №

Набор реагентов содержит:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1 Тест-полоска | 25 шт |
| 2 Буфер для анализа (10,0 мл) | 1 шт |
| 3 Пробирка для проведения анализа | 25 шт |
| 4 Подставка для пробирок | 1 шт |
| 5 Скарификатор одноразовый | 25 шт |
| 6 Салфетка спиртовая | 25 шт |
| 7 Схема использования скарификатора | 1 шт |
| 8 Инструкция по применению | 1 шт |

25 шт

1 шт

25 шт

1 шт

25 шт

25 шт

1 шт

1 шт

LOT

210419

REF

SR-003/25

2021-04-19

2023-04-19



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630550, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7,
8(383)209-34-54, 8-800-800-80-77,
info@imbian.ru

Для профессионального применения
Не замораживать



25


2°C



30°C



IVD

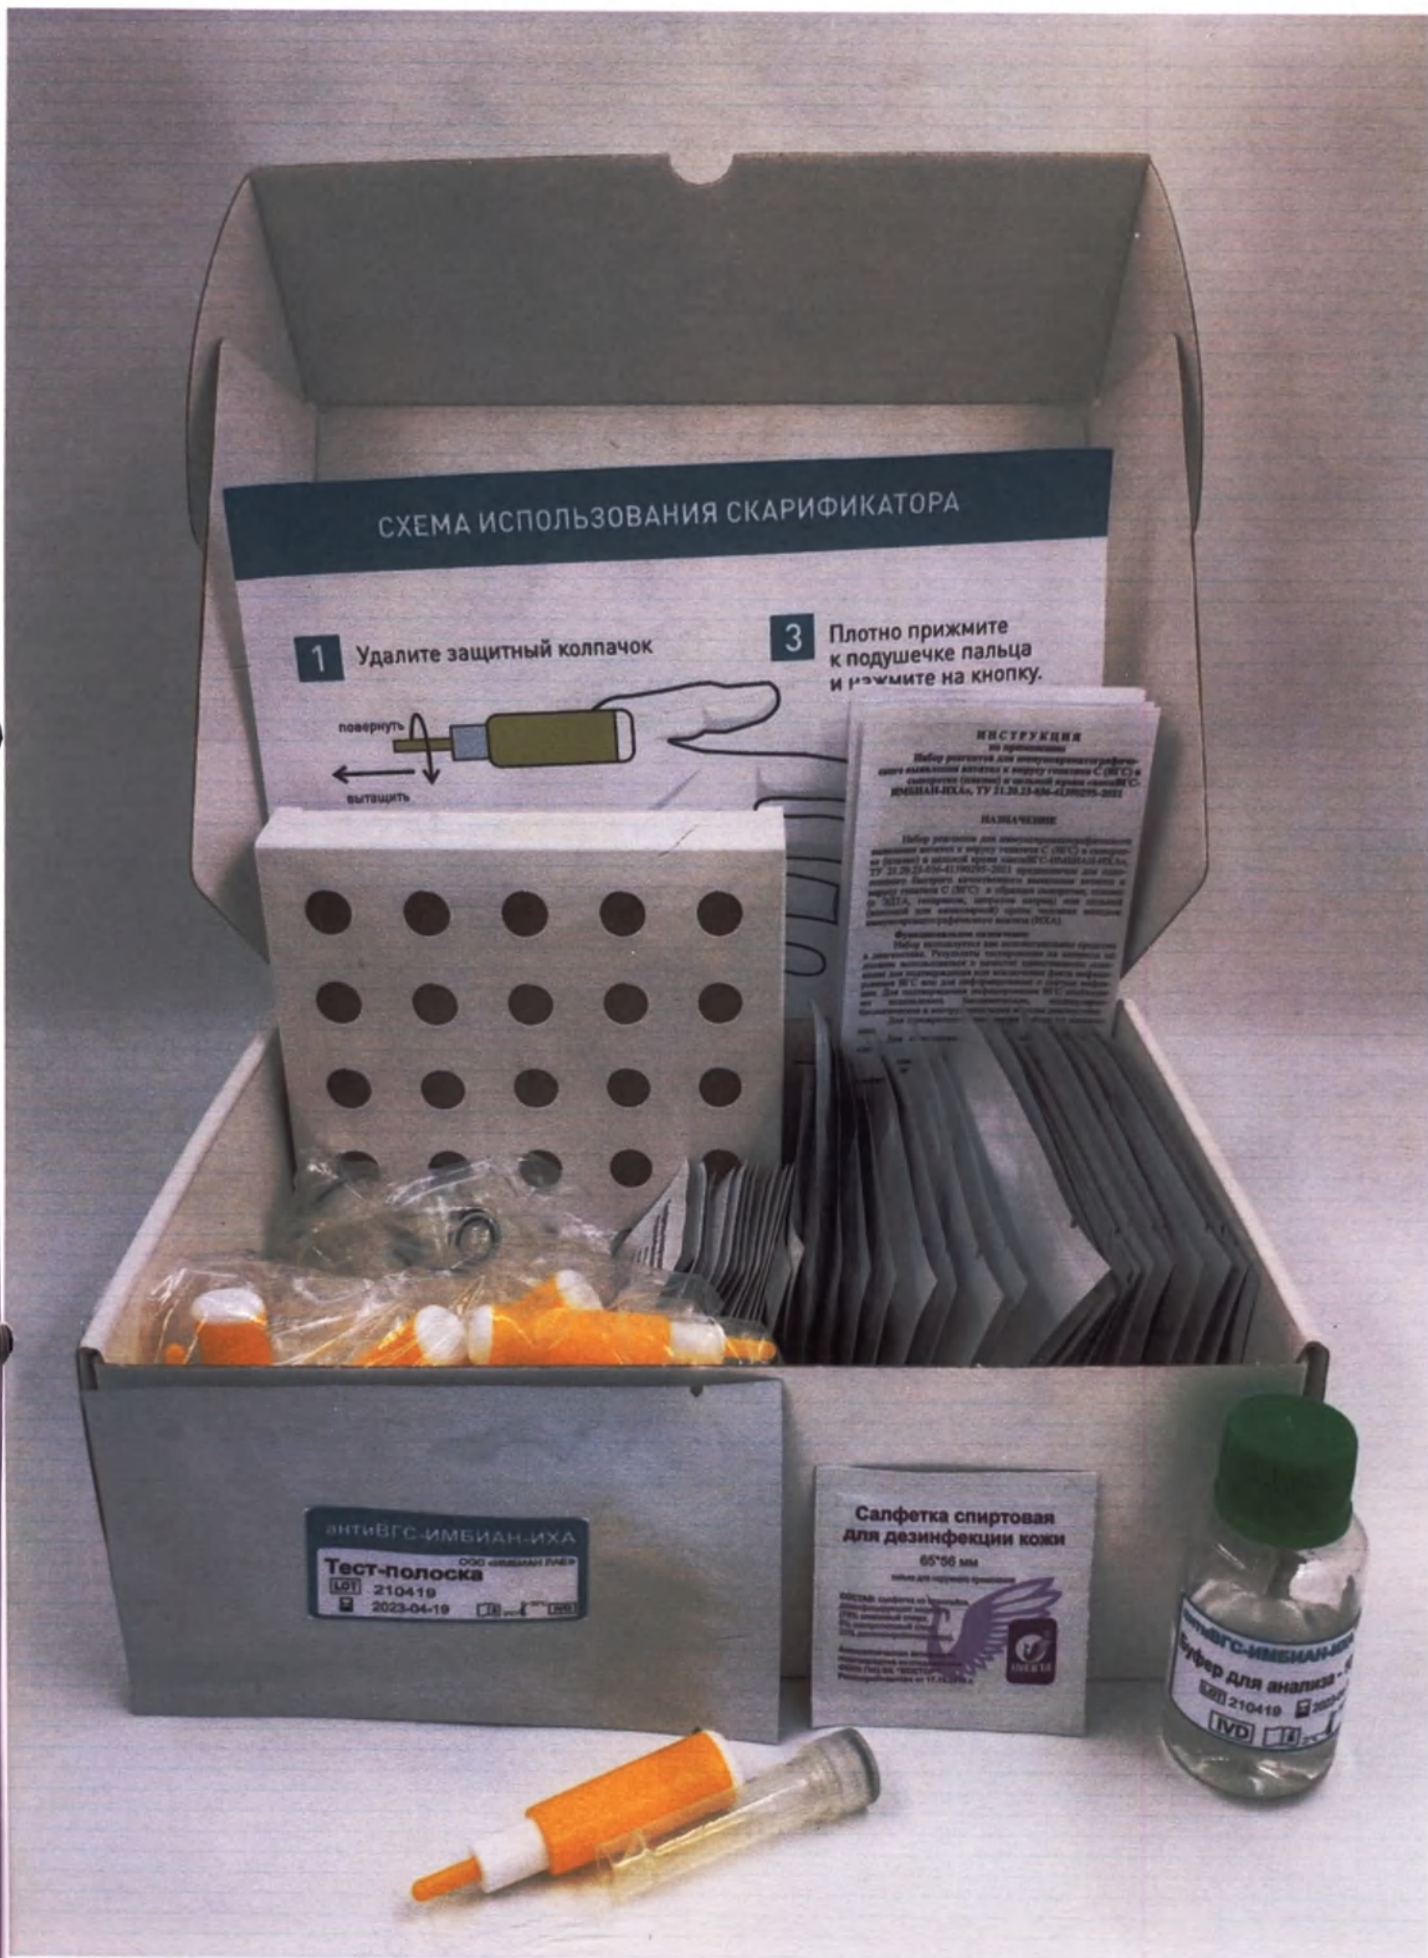

антиВГС- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 4

Набор реагентов для иммунохроматографического
выявления антител к вирусу гепатита С (ВГС)
в сыворотке (плазме) и цельной крови
«антиВГС-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-036-41390295-2021 РУ № XXX XXXX/XXXXX

Набор реагентов содержит:

- 1 Тест-полоска
- 2 Буфер для анализа (20,0 мл)
- 3 Пробирка для проведения анализа
- 4 Подставка для пробирок
- 5 Скарификатор одноразовый
- 6 Салфетка спиртовая
- 7 Схема использования скарификатора
- 8 Инструкция по применению

50 шт

1 шт

50 шт

2 шт

50 шт

50 шт

1 шт

1 шт

LOT

210419

REF

SR-003/50



2021-04-19



2023-04-19

Imbian



Для профессионального применения
Не замораживать



2°C

30°C



IVD

ООО «ИМБИАН ПАК»
630559, Новосибирская область,
г. Кольцово, ул. Саломеев 2/7,
8(383)269-34-54, 8-800-500-80-77,
info@imbian.ru



антиВГС- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 5

Набор реагентов для иммунохроматографического
выявления антител к вирусу гепатита С (ВГС)
в сыворотке (плазме) и цельной крови
«антиВГС-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-036-41390295-2021

Набор реагентов содержит:

1 Тест-полоска	100 шт
2 Буфер для анализа (40,0 мл)	1 шт
3 Пробирка для проведения анализа	100 шт
4 Подставка для пробирок	4 шт
5 Скарификатор одноразовый	100 шт
6 Салфетка спиртовая	100 шт
7 Схема использования скарификатора	1 шт
8 Инструкция по применению	1 шт

РУ № XXX XXXX/XXXXX


LOT 210419

REF SR-003/100

 2021-04-19

 2023-04-19


Для профессионального применения
Не замораживать



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7,
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru



антиВГС- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 6

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антител к вирусу гепатита С (ВГС) в сыворотке (плазме) и цельной крови «антиВГС-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-036-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Набор реагентов содержит:

- 1 Тест-кассета
- 2 Буфер для анализа (4,0 мл)
- 3 Одноразовая пипетка
- 4 Скарификатор одноразовый
- 5 Салфетка спиртовая
- 6 Схема использования скарификатора
- 7 Инструкция по применению

100 шт

4 шт

100 шт

100 шт

100 шт

1 шт

1 шт

LOT

210419

REF

SR-003/100.1



2021-04-19



2023-04-19

Imbian



Для профессионального применения
Не замораживать



100

2°C



30°C



IVD

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7,
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 06
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В. Осипова
"26" января 2022 г



Образцы маркировки

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антител к вирусу гепатита С (ВГС) в сыворотке (плазме) и цельной крови «антиВГС-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-036-41390295-2021

Комплект №1

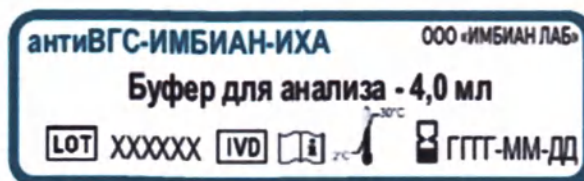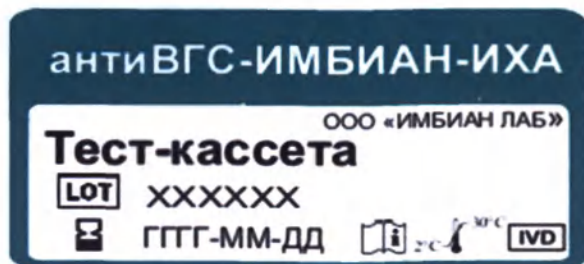

REF

SR-003/3

3 ТЕСТА



Набор реагентов для иммунохроматографического
выявления антител к вирусу гепатита С (ВГС) в сыворотке
(плазма) и цельной крови «антиВГС-ИМБИАН-ИХА».
ТУ 21.20.23-036-41390295-2021
Комплект №2

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ГЕПАТИТ С



ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ГЕПАТИТ С

СОСТАВ НАБОРА

Тест-кассета	3 шт
Буфер для анализа (4,0 мл)	1 шт
Одноразовая пипетка	3 шт
Скарификатор одноразовый	3 шт
Салфетка спиртовая	3 шт
Схема использования скарификатора	1 шт
Инструкция по применению	1 шт

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



Хранить в сухом месте при температуре от +2 до +30°C
ТУ 21.20.23-036-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Для профессионального применения

Не замораживать

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД ГГГГ-ММ-ДД

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
Появились две
полоски любой
интенсивности

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
Появилась только
одна полоска
в верхней части
(контрольной зоне)

IVD

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
ГЕПАТИТ С

антиВГС-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-кассета

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

2-30°C IVD

антиВГС-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Буфер для анализа - 4,0 мл

LOT XXXXXX

IVD

ГГГГ-ММ-ДД

антиВГС- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 3

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антител к вирусу гепатита С (ВГС) в сыворотке (плазме) и цельной крови «антиВГС-ИМБИАН-ИХА»,

ТУ 21.20.23-036-41390295-2021 РУ № XXX XXXX/XXXXX

Набор реагентов содержит:

- 1 Тест-полоска
- 2 Буфер для анализа (10,0 мл)
- 3 Пробирка для проведения анализа
- 4 Подставка для пробирок
- 5 Скарификатор одноразовый
- 6 Салфетка спиртовая
- 7 Схема использования скарификатора
- 8 Инструкция по применению

25 шт
1 шт
25 шт
1 шт
25 шт
25 шт
1 шт
1 шт

LOT XXXXXX

REF SR-003/25

ГТГГ-ММ-ДД

ГТГГ-ММ-ДД

Imbian



Для профессионального применения
Не замораживать



30°C



IVD

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7,
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru

антиВГС-ИМБИАН-ИХА

Буфер для анализа - 10,0 мл

LOT XXXXXX ГТГГ-ММ-ДД

IVD

30°C

антиВГС-ИМБИАН-ИХА

Тест-полоска

LOT XXXXXX

ГТГГ-ММ-ДД

30°C

IVD

Комплект №4

антиВГС- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 4

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антител к вирусу гепатита С (ВГС) в сыворотке (плазме) и цельной крови «антиВГС-ИМБИАН-ИХА»,

ТУ 21.20.23-036-41390295-2021 РУ № XXX XXXX/XXXXX

Набор реагентов содержит:

- 1 Тест-полоска
- 2 Буфер для анализа (20,0 мл)
- 3 Пробирка для проведения анализа
- 4 Подставка для пробирок
- 5 Скарификатор одноразовый
- 6 Салфетка спиртовая
- 7 Схема использования скарификатора
- 8 Инструкция по применению

50 шт
1 шт
50 шт
2 шт
50 шт
50 шт
1 шт
1 шт

LOT XXXXXX

REF SR-003/50

ГТГГ-ММ-ДД

ГТГГ-ММ-ДД

Imbian



Для профессионального применения
Не замораживать



30°C



IVD

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7,
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru

антиВГС-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-полоска - 50 шт

LOT XXXXXX



ГТГГ-ММ-ДД



30°C

IVD

антиВГС-ИМБИАН-ИХА

Буфер для анализа - 20,0 мл

LOT XXXXXX ГТГГ-ММ-ДД

IVD

30°C

IVD

антиВГС- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 5

Набор реагентов для иммунохроматографического
выявления антител к вирусу гепатита С (ВГС)
в сыворотке (плазме) и цельной крови
«антиВГС-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-036-41390295-2021

Набор реагентов содержит:

1 Тест-полоска	100 шт
2 Буфер для анализа (40,0 мл)	1 шт
3 Пробирка для проведения анализа	100 шт
4 Подставка для пробирок	4 шт
5 Скарификатор одноразовый	100 шт
6 Салфетка спиртовая	100 шт
7 Схема использования скарификатора	1 шт
8 Инструкция по применению	1 шт

РУ № XXX XXXX/XXXXX

LOT XXXXXX


REF SR-003/100

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД



Для профессионального применения
Не замораживать



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7,
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru


антиВГС-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-полоска - 100 шт

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



IVD

антиВГС-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Буфер для анализа - 40,0 мл

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД

IVD ГГГГ-ММ-ДД

антиВГС- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 6

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антител к вирусу гепатита С (ВГС) в сыворотке (плазме) и цельной крови «антиВГС-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-036-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

Набор реагентов содержит:

- 1 Тест-кассета
- 2 Буфер для анализа (4,0 мл)
- 3 Одноразовая пипетка
- 4 Скарификатор одноразовый
- 5 Салфетка спиртовая
- 6 Схема использования скарификатора
- 7 Инструкция по применению

100 шт

4 шт

100 шт

100 шт

100 шт

1 шт

1 шт

LOT

XXXXXX

REF

SR-003/100.1



ГГГГ-ММ-ДД



ГГГГ-ММ-ДД


Imbian


Для профессионального применения
Не замораживать



100

2°C



IVD

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7,
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru

антиВГС-ИМБИАН-ИХА

Тест-кассета

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



2°C

30°C



IVD

антиВГС-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Буфер для анализа - 4,0 мл

LOT XXXXXX

IVD



2°C

30°C



ГГГГ-ММ-ДД

IVD

Генеральный директор ООО "ИМБИАН ЛАБ"



В.В. Осипова

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 06

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова
"26 Сентября" 2022 г

