


Фотографические изображения общего вида

Набор реагентов для иммунохроматографического определения наличия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке (плазме) и цельной крови «HBsAg-ИМБИАН-ИХА», ТУ 21.20.23-035-41390295-2021

Комплект №1

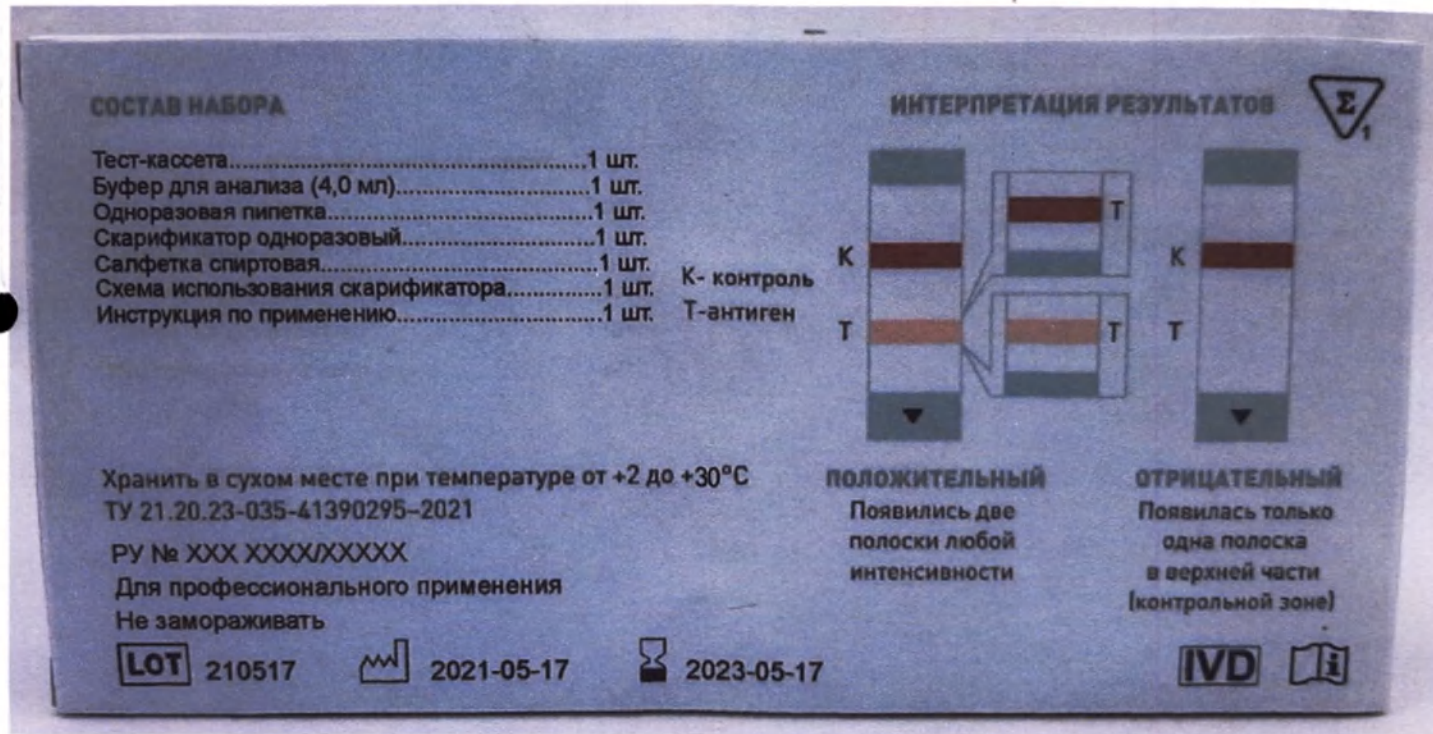

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ГЕПАТИТ В

Набор реагентов для иммунохроматографического
определения наличия поверхностного антигена
вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке (плазме)
и цельной крови «HBsAg-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-035-41390295-2021
Комплект №2


3 ТЕСТА

Для диагностики in vitro

СОСТАВ НАБОРА

Тест-кассета.....	3 шт.
Буфер для анализа (4,0 мл).....	1 шт.
Одноразовая пипетка.....	3 шт.
Скарификатор одноразовый.....	3 шт.
Салфетка спиртовая.....	3 шт.
Схема использования скарификатора.....	1 шт.
Инструкция по применению.....	1 шт.

Хранить в сухом месте при температуре от +2 до +30°C
ТУ 21.20.23-035-41390295-2021

РУ № XXX XXXXXXXXXX

Для профессионального применения

Не замораживать

LOT

210517




2021-05-17



2023-05-17

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

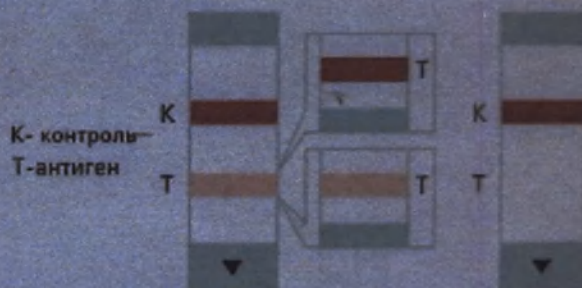

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

Появились две
полоски любой
интенсивности

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

Появилась только
одна полоска
в верхней части
(контрольной зоне)

IVD


СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКАРИФИКАТОРА

1 Удалите защитный колпачок


3 Плотнo прижмите к подушечке пальца и нажмите на кнопку.





СОСТАВ НАБОРА


Тест-система	3 шт
Буфер для анализа (4,0 мл)	1 шт
Стерильная палочка	3 шт
Салфетка спиртовая	3 шт
Салфетка спиртовая	3 шт
Салфетка спиртовая	3 шт
Инструкция по применению	1 шт

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ




Хранить в сухом месте при температуре от +2 до +30°C
 ТУ 21.20.23-030-41390295-2021
 РУ № XXX XXXXXXXXXX
 Для профессионального применения
 Не использовать
 LDT 210517 2021-05-17 2023-05-17 IVD



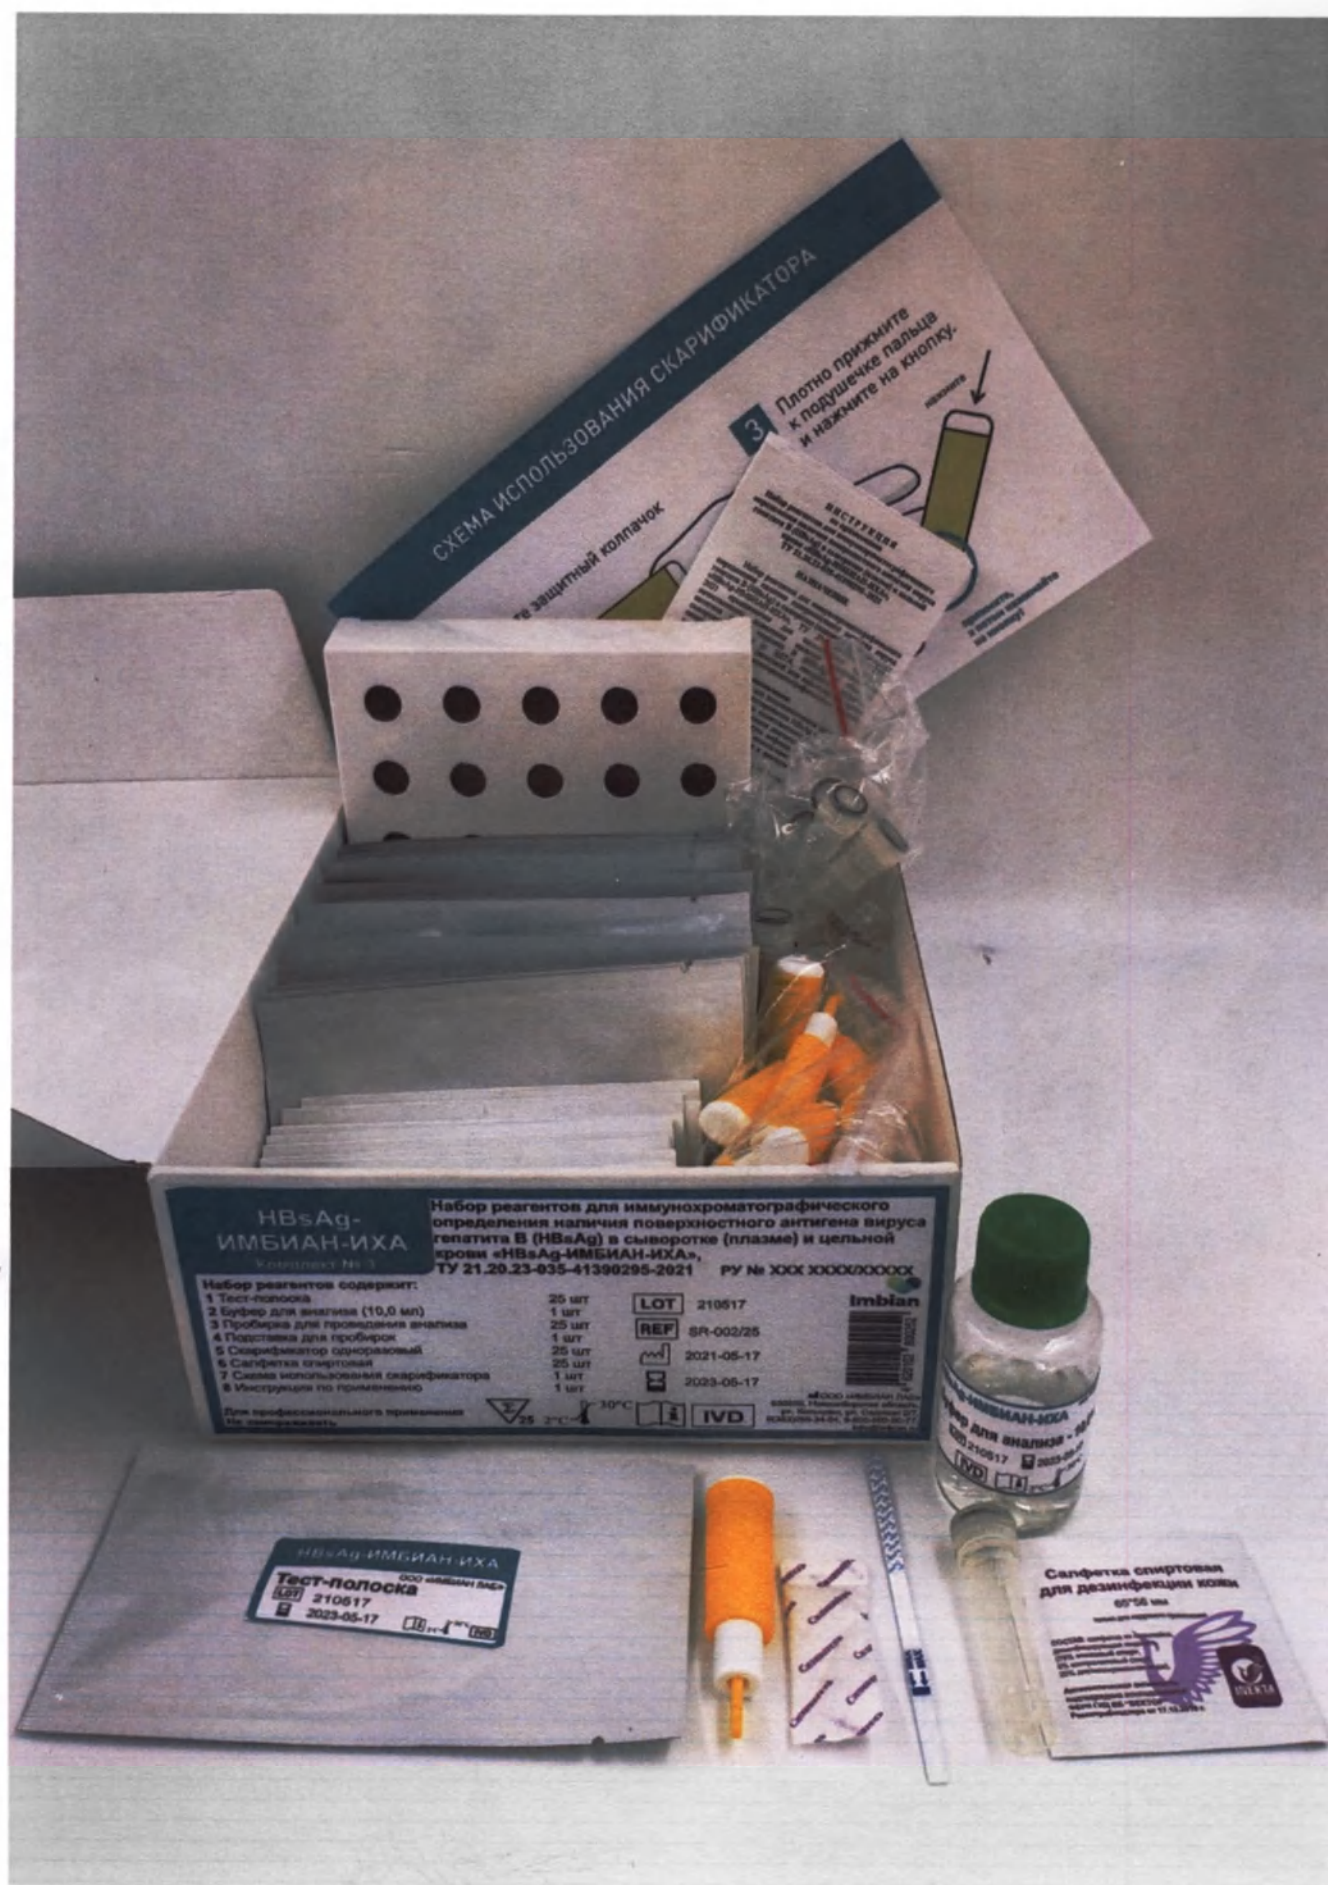

Комплект №4

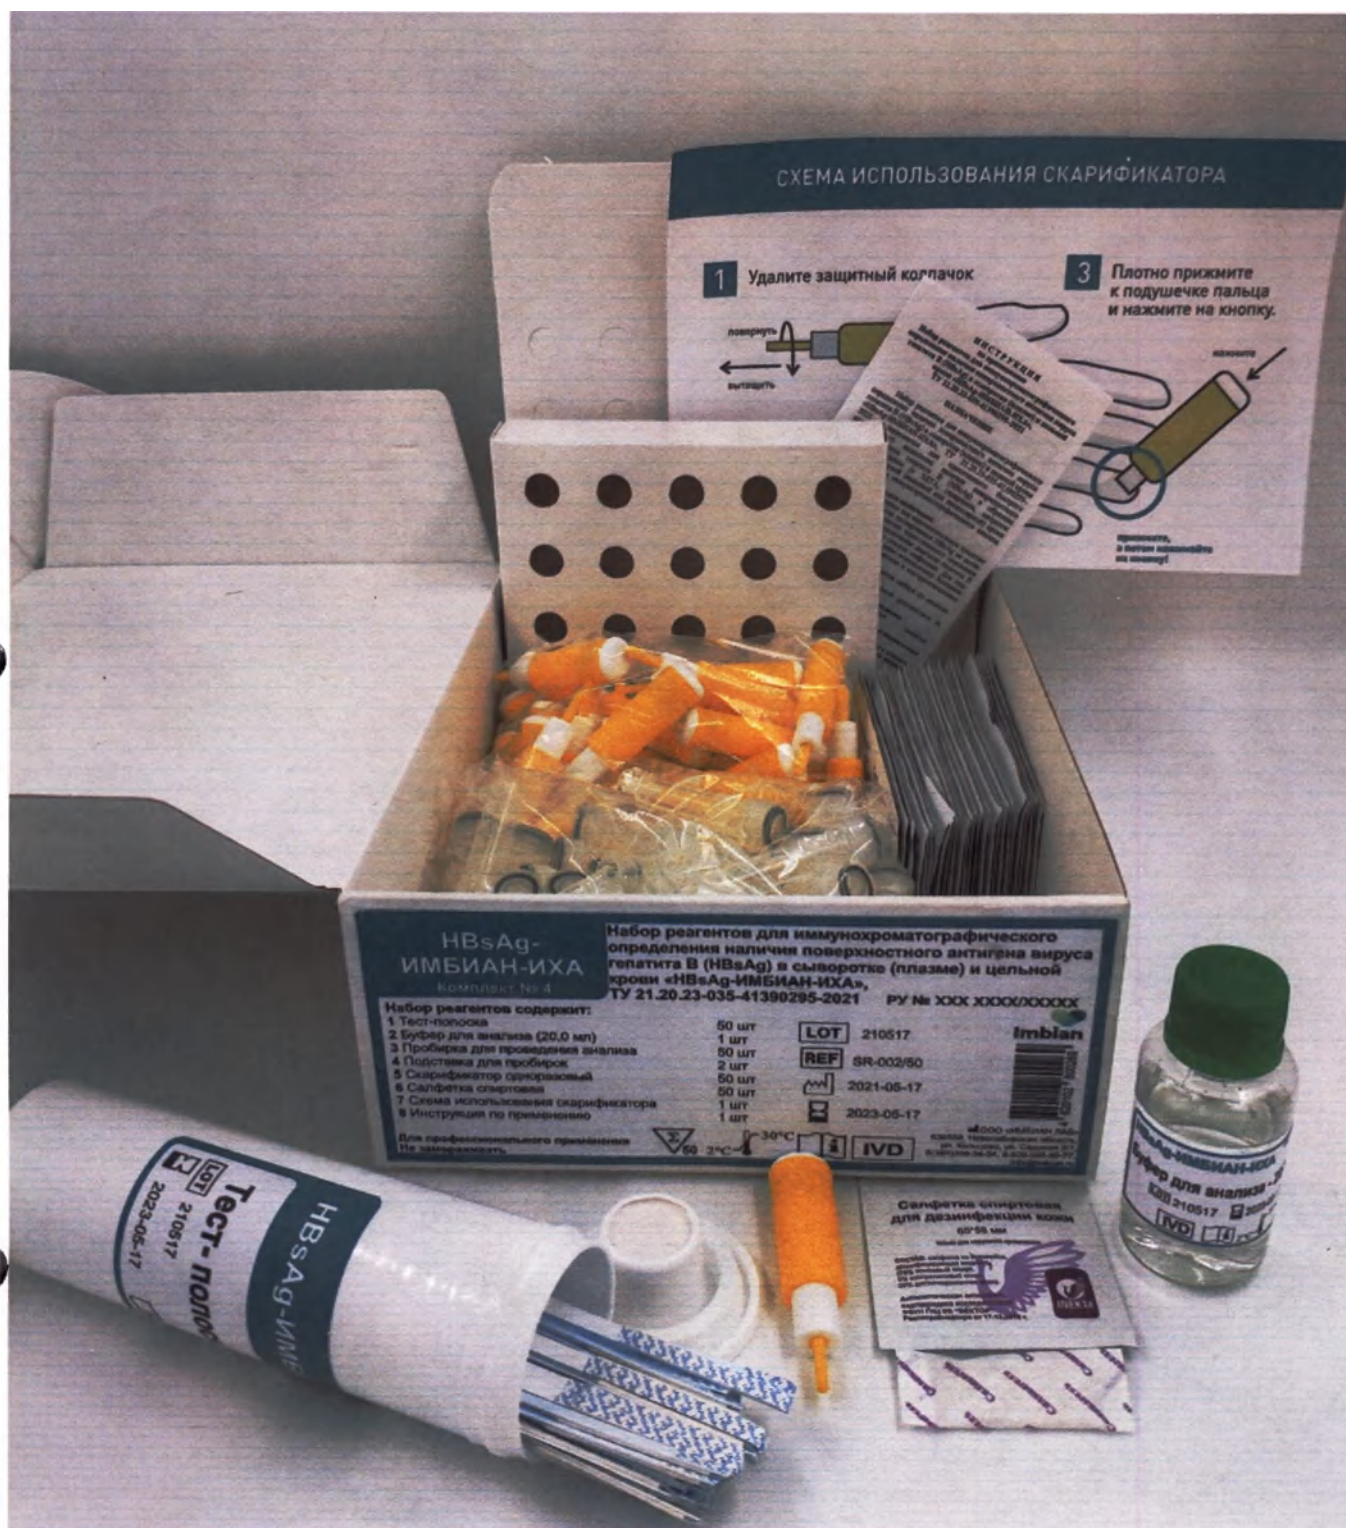





Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 16

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова



26 января 2022 г



Образцы маркировки


Набор реагентов для иммунохроматографического определения наличия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке (плазме) и цельной крови
«HBsAg-ИМБИАН-ИХА», ТУ 21.20.23-035-41390295-2021

Комплект №1

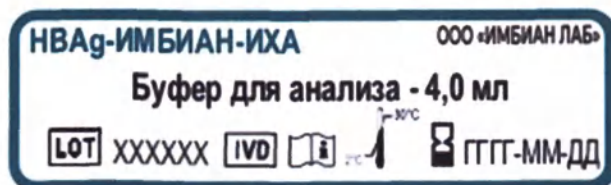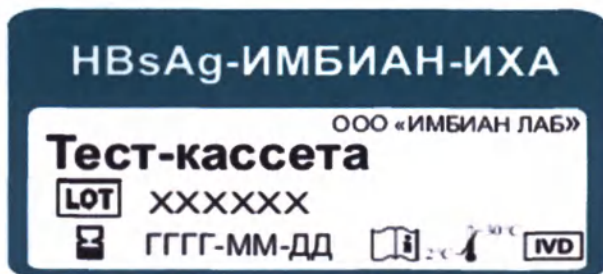

REF

SR-002/3

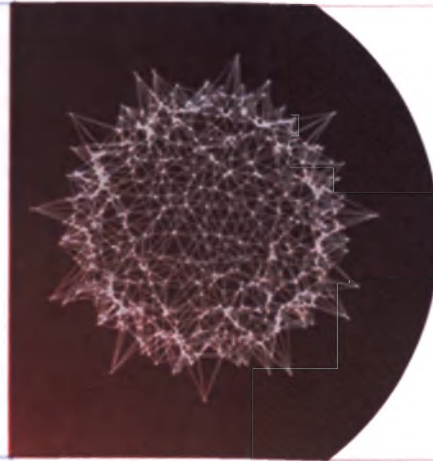

3 ТЕСТА

Imbian

Набор реагентов для иммунохроматографического определения наличия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке (плазме) и цельной крови «HBsAg-ИМБИАН-ИХА».

ТУ 21.20.23-035-41390295-2021

Комплект №2

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ГЕПАТИТ В

Imbian



ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ГЕПАТИТ В

СОСТАВ НАБОРА

Тест-кассета	3 шт
Буфер для анализа (4,0 мл)	1 шт
Одноразовая пипетка	3 шт
Скарификатор одноразовый	3 шт
Салфетка спиртовая	3 шт
Схема использования скарификатора	1 шт
Инструкция по применению	1 шт

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
Появились две
полоски любой
интенсивности

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
Появилась только
одна полоска
в верхней части
(контрольной зоне)

Хранить в сухом месте при температуре от +2 до +30°C
ТУ 21.20.23-035-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Для профессионального применения

Не замораживать

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД ГГГГ-ММ-ДД

IVD

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Юридический адрес: Россия 630559, Новосибирская обл.,
р.п. Кольцово, ул. Садовая, дом 2/7, этаж 2, помещение 2

Почтовый адрес: Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7
8 (383) 209-34-54, 8-800-600-90-77 info@imbian.ru

HBsAg-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-кассета

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

HBsAg-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Буфер для анализа - 4,0 мл

LOT XXXXXX

IVD

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

HBsAg- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 3

Набор реагентов для иммунохроматографического определения наличия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке (плазме) и цельной крови «HBsAg-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-035-41390295-2021 РУ № XXX XXXX/XXXXX

Набор реагентов содержит:

- 1 Тест-полоска
- 2 Буфер для анализа (10,0 мл)
- 3 Пробирка для проведения анализа
- 4 Подставка для пробирок
- 5 Скарификатор одноразовый
- 6 Салфетка спиртовая
- 7 Схема использования скарификатора
- 8 Инструкция по применению

25 шт

1 шт

25 шт

1 шт

25 шт

25 шт

1 шт

1 шт

LOT XXXXXX

REF SR-002/25

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

Imbian



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7,
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru

Для профессионального применения
Не замораживать



25

2°C



30°C



IVD


HBsAg-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-полоска

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



IVD

HBsAg-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Буфер для анализа - 10,0 мл

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

IVD



2°C



30°C

HBsAg- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 4

Набор реагентов для иммунохроматографического определения наличия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке (плазме) и цельной крови «HBsAg-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-035-41390295-2021 РУ № XXX XXXX/XXXXX

Набор реагентов содержит:

- 1 Тест-полоска
- 2 Буфер для анализа (20,0 мл)
- 3 Пробирка для проведения анализа
- 4 Подставка для пробирок
- 5 Скарификатор одноразовый
- 6 Салфетка спиртовая
- 7 Схема использования скарификатора
- 8 Инструкция по применению

50 шт

1 шт

50 шт

2 шт

50 шт

50 шт

1 шт

1 шт

LOT XXXXXX

REF SR-002/50

 ГТГ-ММ-ДД

 ГТГ-ММ-ДД


Imbian



Для профессионального применения
Не замораживать



50 2°C


IVD

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
рп. Колызово, ул. Садовая 2/7,
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru

HBsAg-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-полоска - 50 шт

LOT XXXXXX


ГТГ-ММ-ДД



2°C 30°C

IVD

HBsAg-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Буфер для анализа - 20,0 мл

LOT XXXXXX


ГТГ-ММ-ДД

IVD


2°C 30°C

HBsAg- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 5

Набор реагентов для иммунохроматографического определения наличия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке (плазме) и цельной крови «HBsAg-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-035-41390295-2021 РУ № XXX XXXX/XXXXX

Набор реагентов содержит:

- 1 Тест-полоска
- 2 Буфер для анализа (40,0 мл)
- 3 Пробирка для проведения анализа
- 4 Подставка для пробирок
- 5 Скарификатор одноразовый
- 6 Салфетка спиртовая
- 7 Схема использования скарификатора
- 8 Инструкция по применению

100 шт

1 шт

100 шт

4 шт

100 шт

100 шт

1 шт

1 шт

LOT XXXXXX

REF SR-002/100

 ГТГГ-ММ-ДД

 ГТГГ-ММ-ДД




Imbian


Для профессионального применения
Не замораживать



100

2°C



30°C


IVD

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7,
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru

HBsAg-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-полоска - 100 шт

LOT XXXXXX


ГТГГ-ММ-ДД



2°C



30°C

IVD
HBsAg-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Буфер для анализа - 40,0 мл

LOT XXXXXX

 ГТГГ-ММ-ДД

IVD


2°C



30°C

HBsAg- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 6

Набор реагентов для иммунохроматографического определения наличия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке (плазме) и цельной крови «HBsAg-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-035-41390295-2021 РУ № XXX XXXX/XXXXX

Набор реагентов содержит:

- 1 Тест-кассета
- 2 Буфер для анализа (4,0 мл)
- 3 Одноразовая пипетка
- 4 Скарификатор одноразовый
- 5 Салфетка спиртовая
- 6 Схема использования скарификатора
- 7 Инструкция по применению

100 шт

4 шт

100 шт

100 шт

100 шт

1 шт

1 шт

LOT

XXXXXX

REF

SR-002/100.1


ГТГГ-ММ-ДД

ГТГГ-ММ-ДД

Imbian



Для профессионального применения
Не замораживать



IVD

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7,
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru

HBsAg-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-кассета

LOT

XXXXXX



ГТГГ-ММ-ДД



30°C



IVD

HBsAg-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Буфер для анализа - 4,0 мл

LOT

XXXXXX



ГТГГ-ММ-ДД



30°C



IVD

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В. Осипова

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 06

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

"26" января 2022 г

