

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «МедРег Консалтинг»



[Handwritten signature]

Ю. Н. Сергеева

«28» декабря


2015 г.

**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**Система эндоскопическая СЭ-01-«ПРИМА»
в комплекте и по отдельности
по ТУ 9442-014-78698964-2015**

2015 г.

Система эндоскопическая СЭ-01-«ПРИМА»
в комплекте и по отдельности по ТУ 9442-014-78698964-2015: комплект

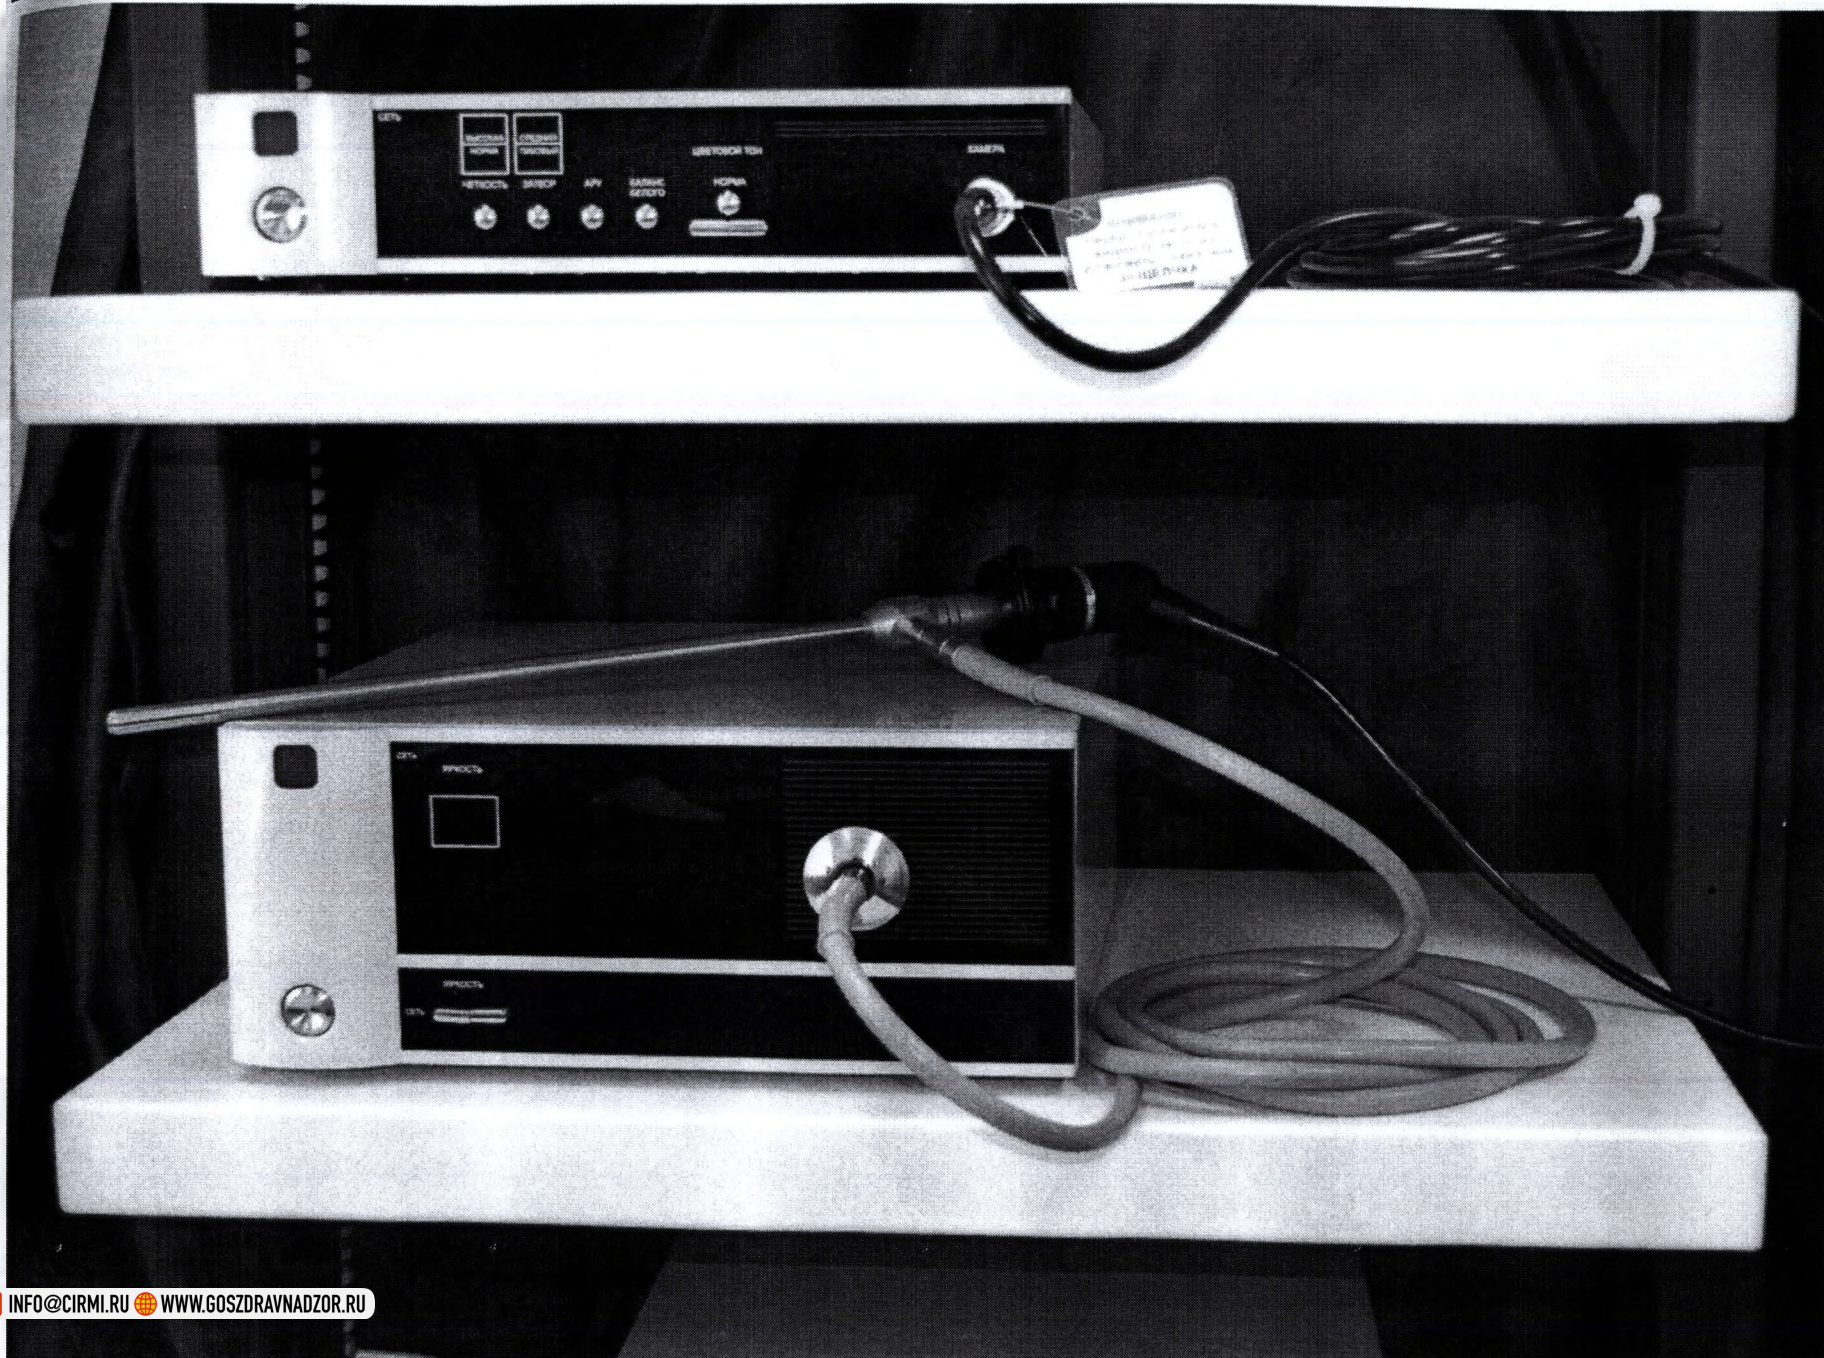


Оптическая ТО-01-«ПРИМА»




Переходник разъем под световодный кабель
STORZ».

- Переходник разъем под световодный кабель «R
WOLF»

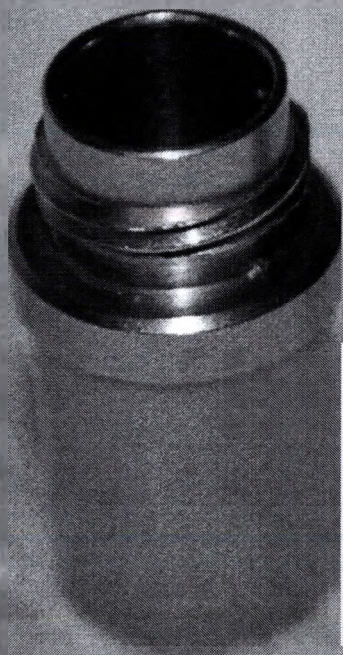

... для подсоединения переходников Трубка оптическая ТО-01-«ПРИМА»

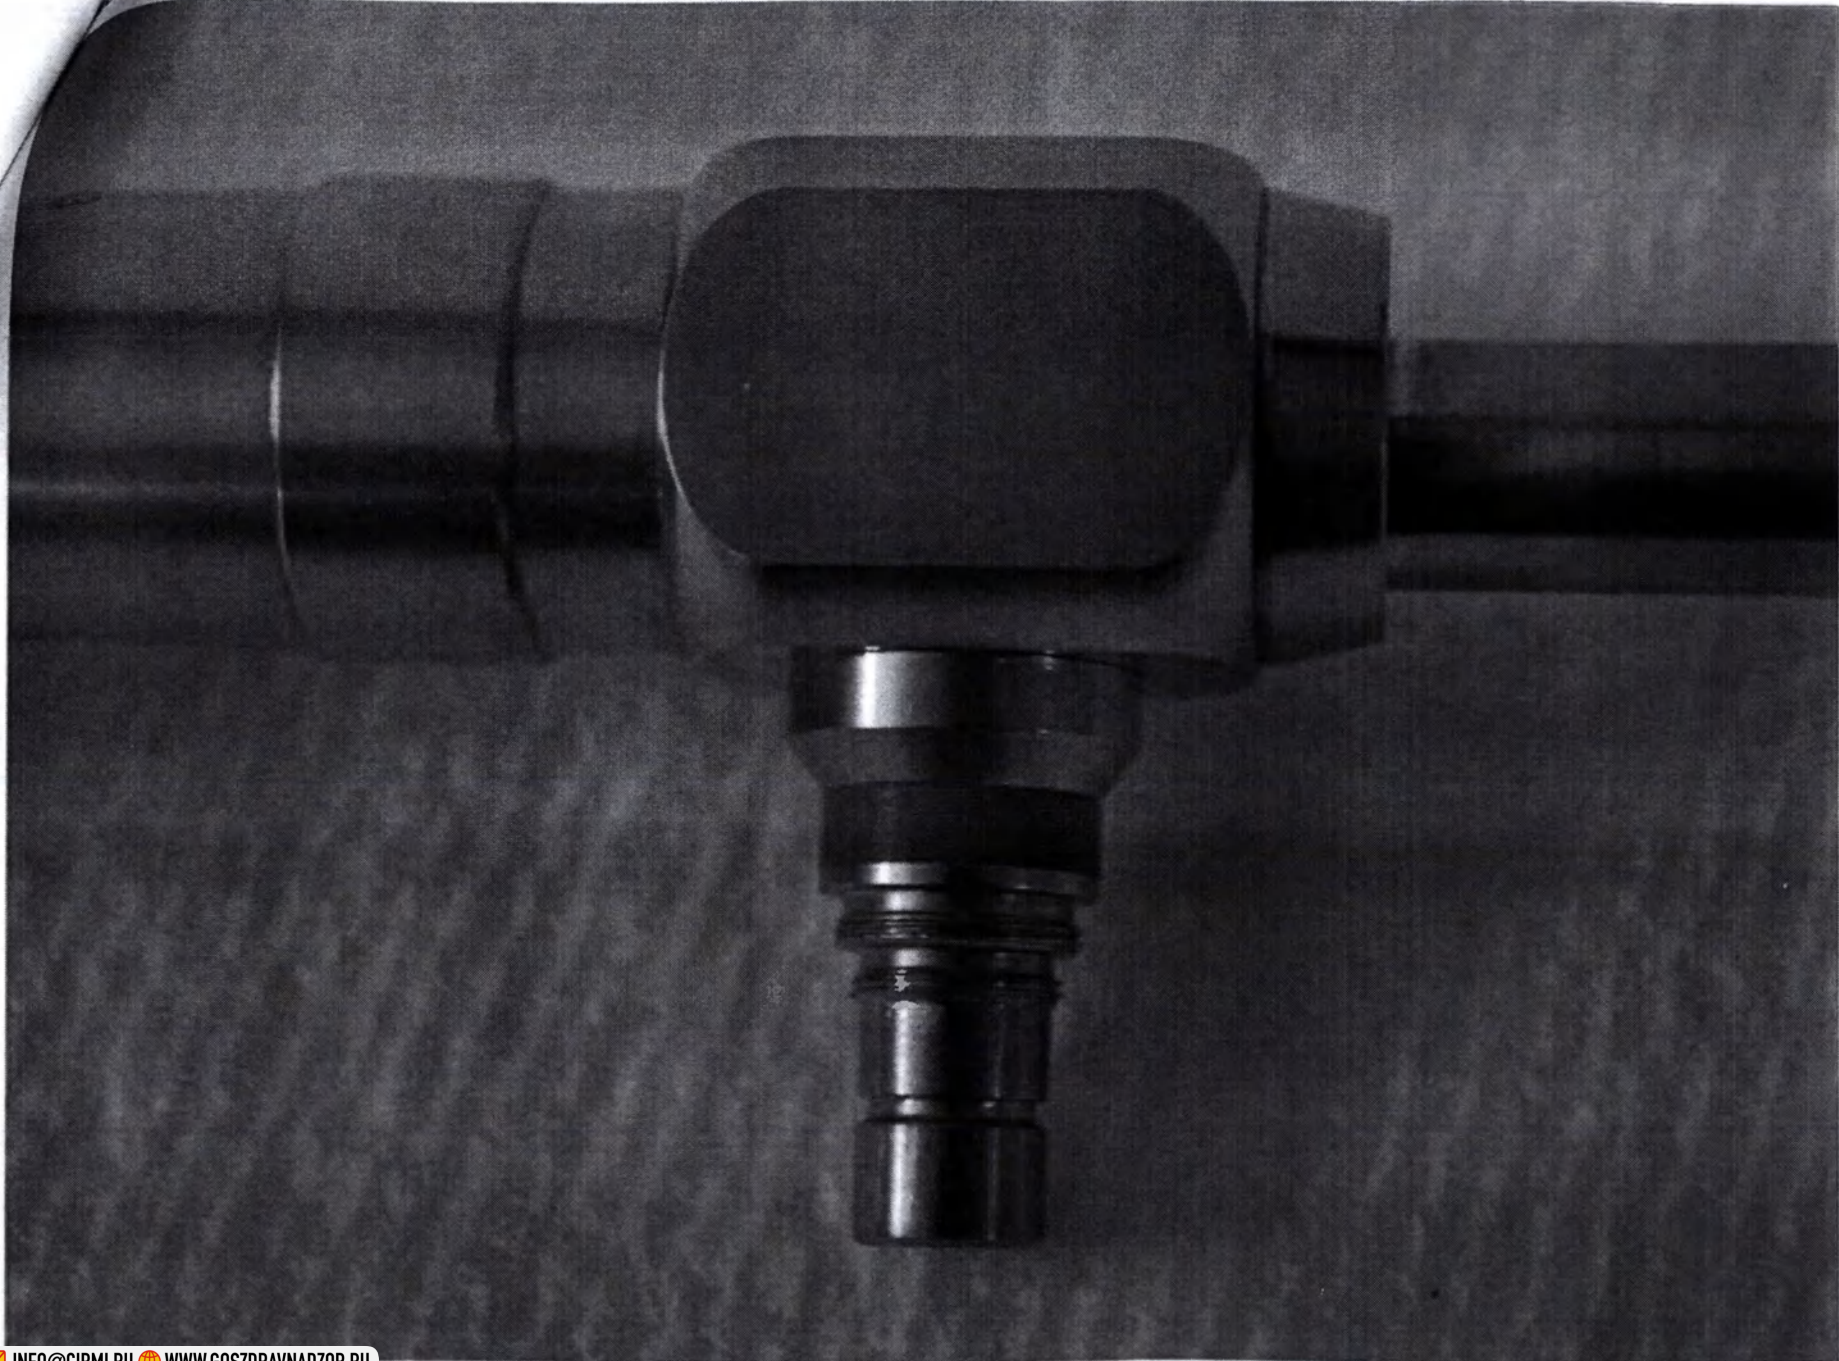




Камера эндоскопическая ВЭ-01-«ПРИМА»: в сборе





Камера эндоскопическая ВЭ-01-«ПРИМА»: вид сзади с подключенными кабелями

- Кабель питания;
- Кабель сигнальный коаксиальный;
- Кабель сигнальный S-Video;

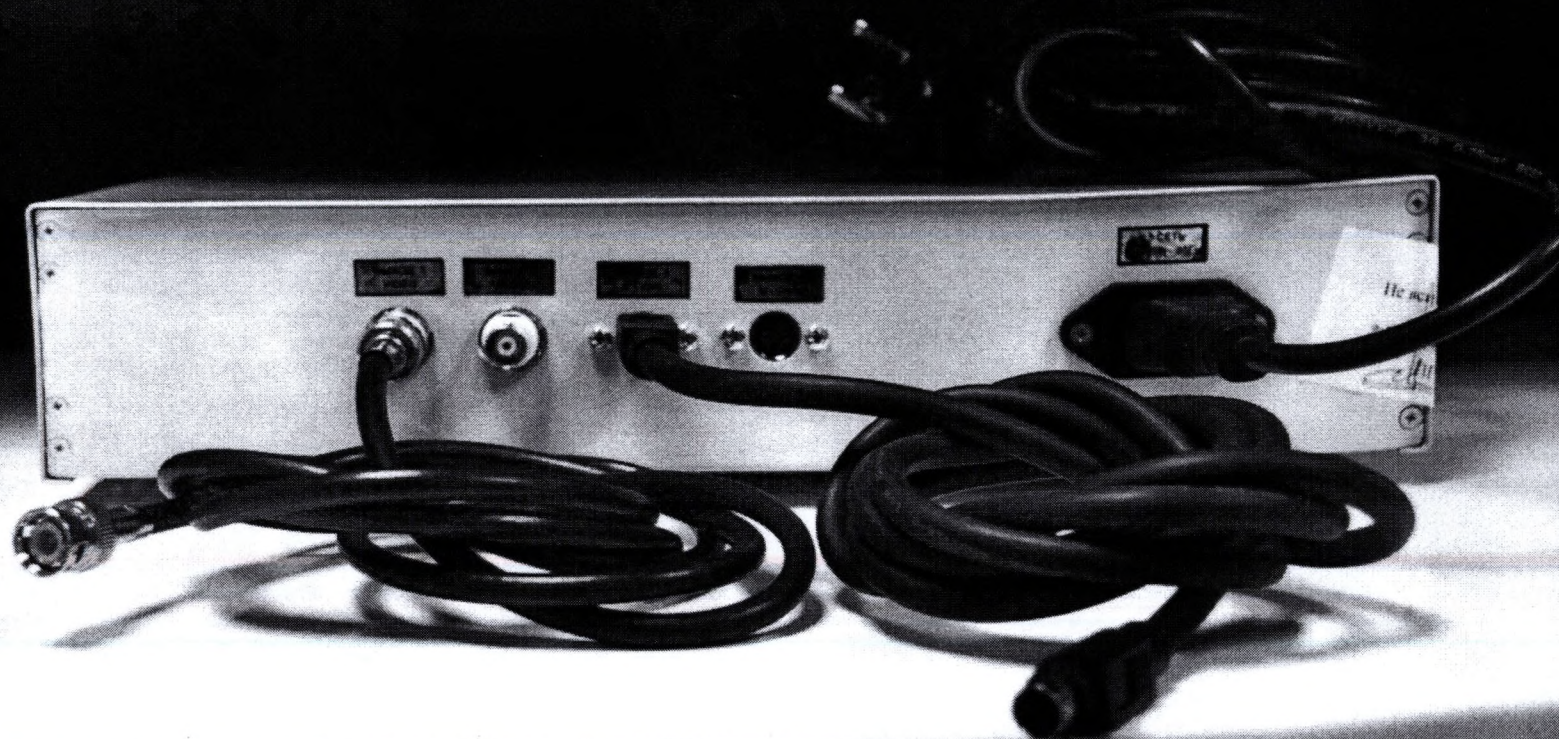


Камера эндоскопическая ВЭ-01-«ПРИМА»: вид сзади

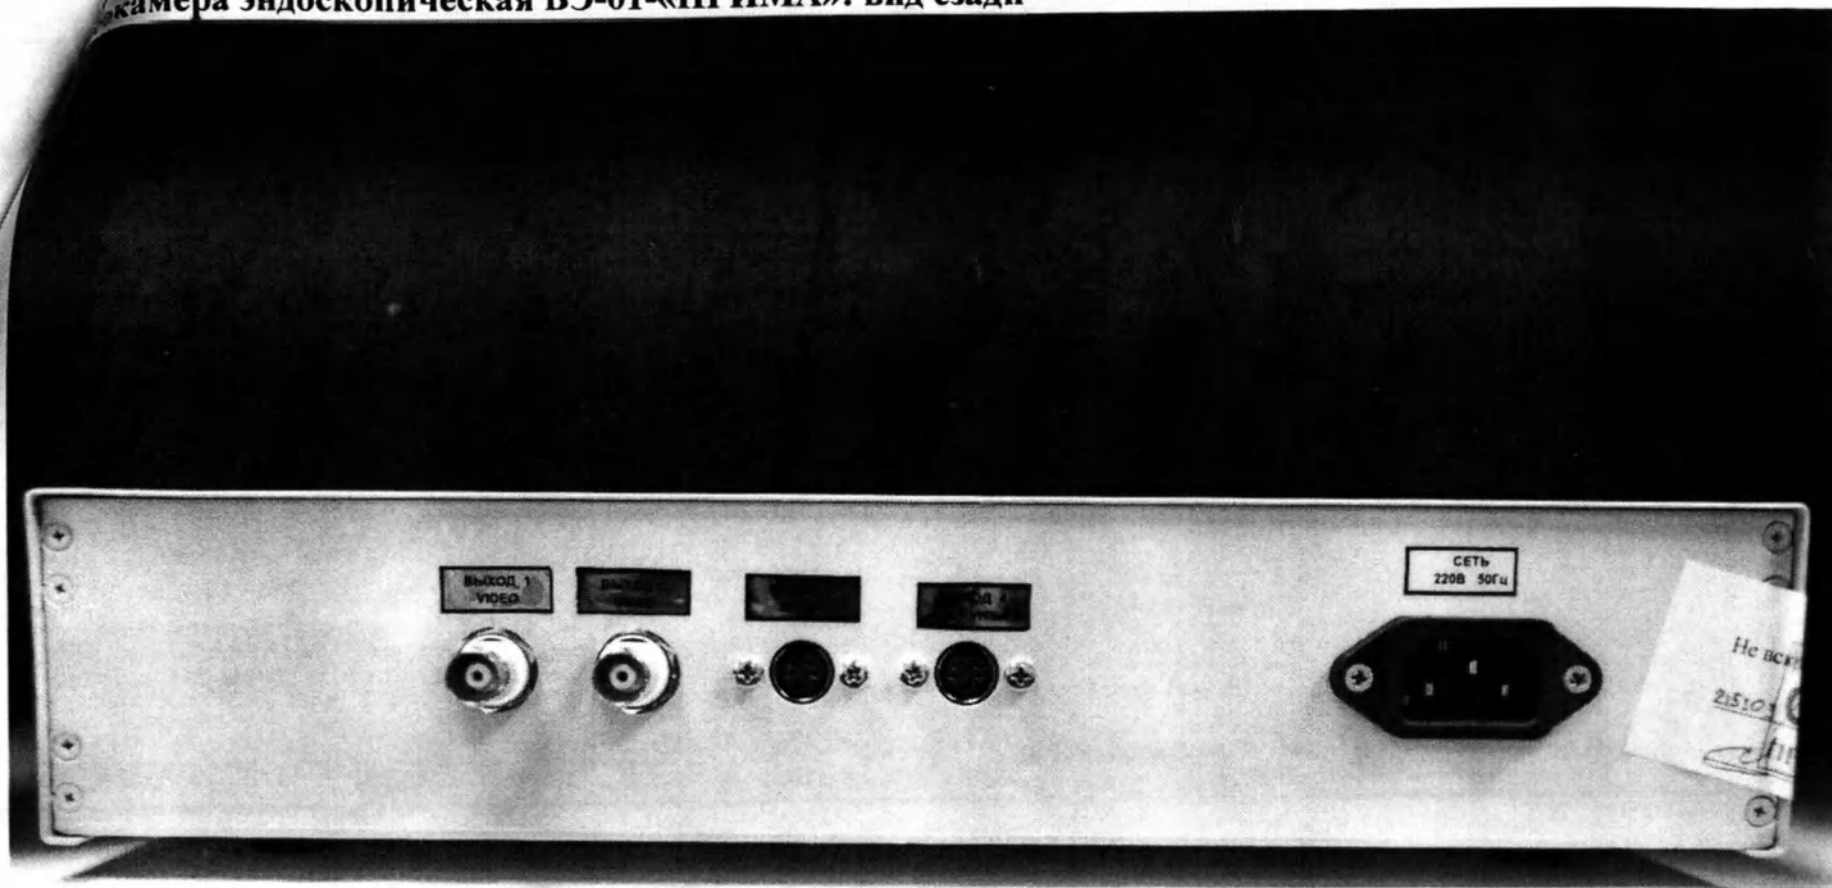

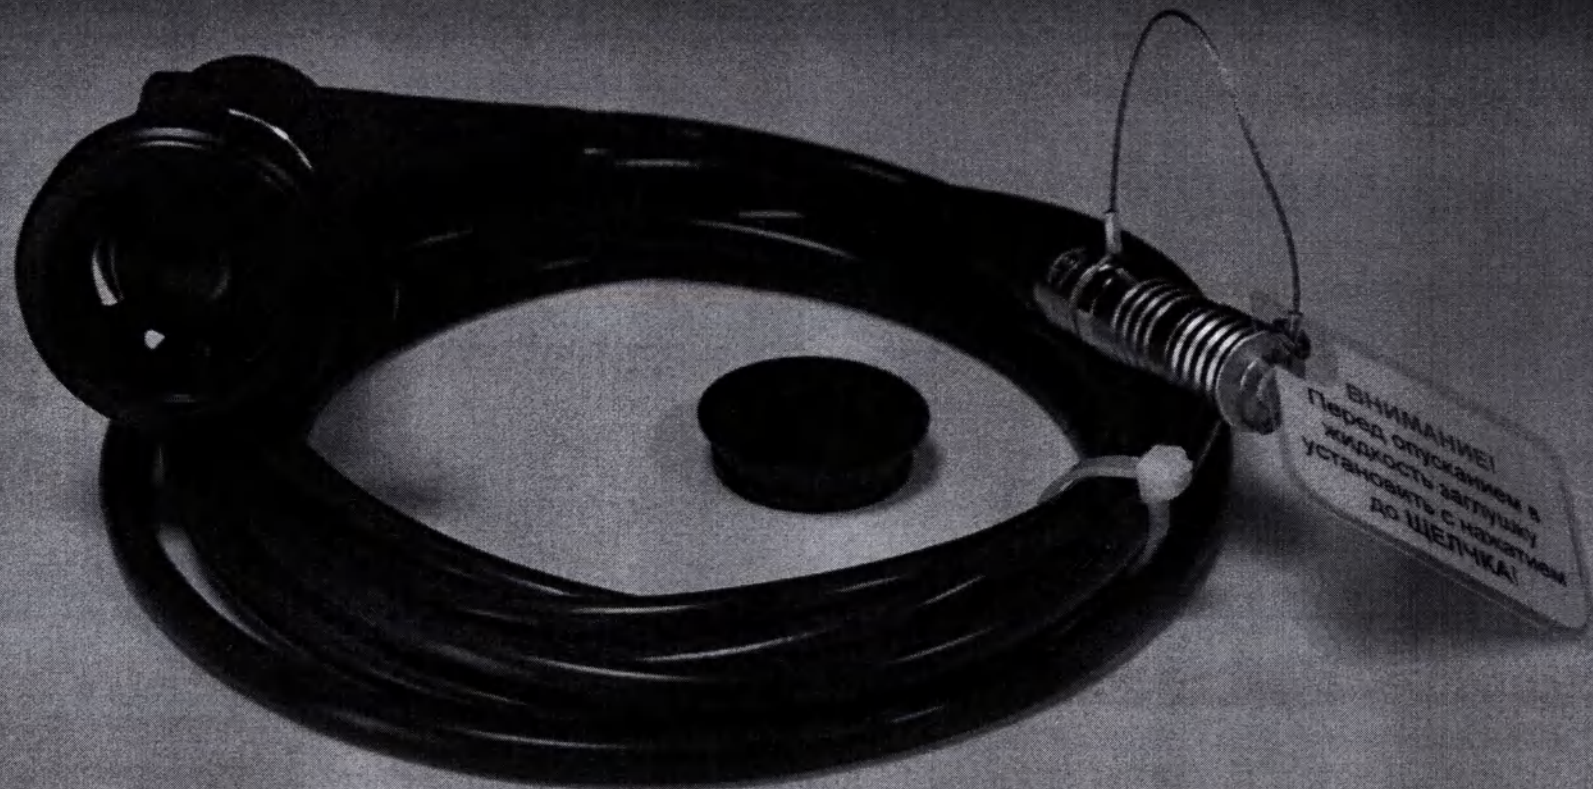


ВНИМАНИЕ!
Перед опусканием в
жидкость заглушку
установить с нажатием
ДО ЩЕЛЧКА!


Осветитель эндоскопический ОЭ-01-«ПРИМА» с кабелем осветительный КО-01-«ПРИМА»

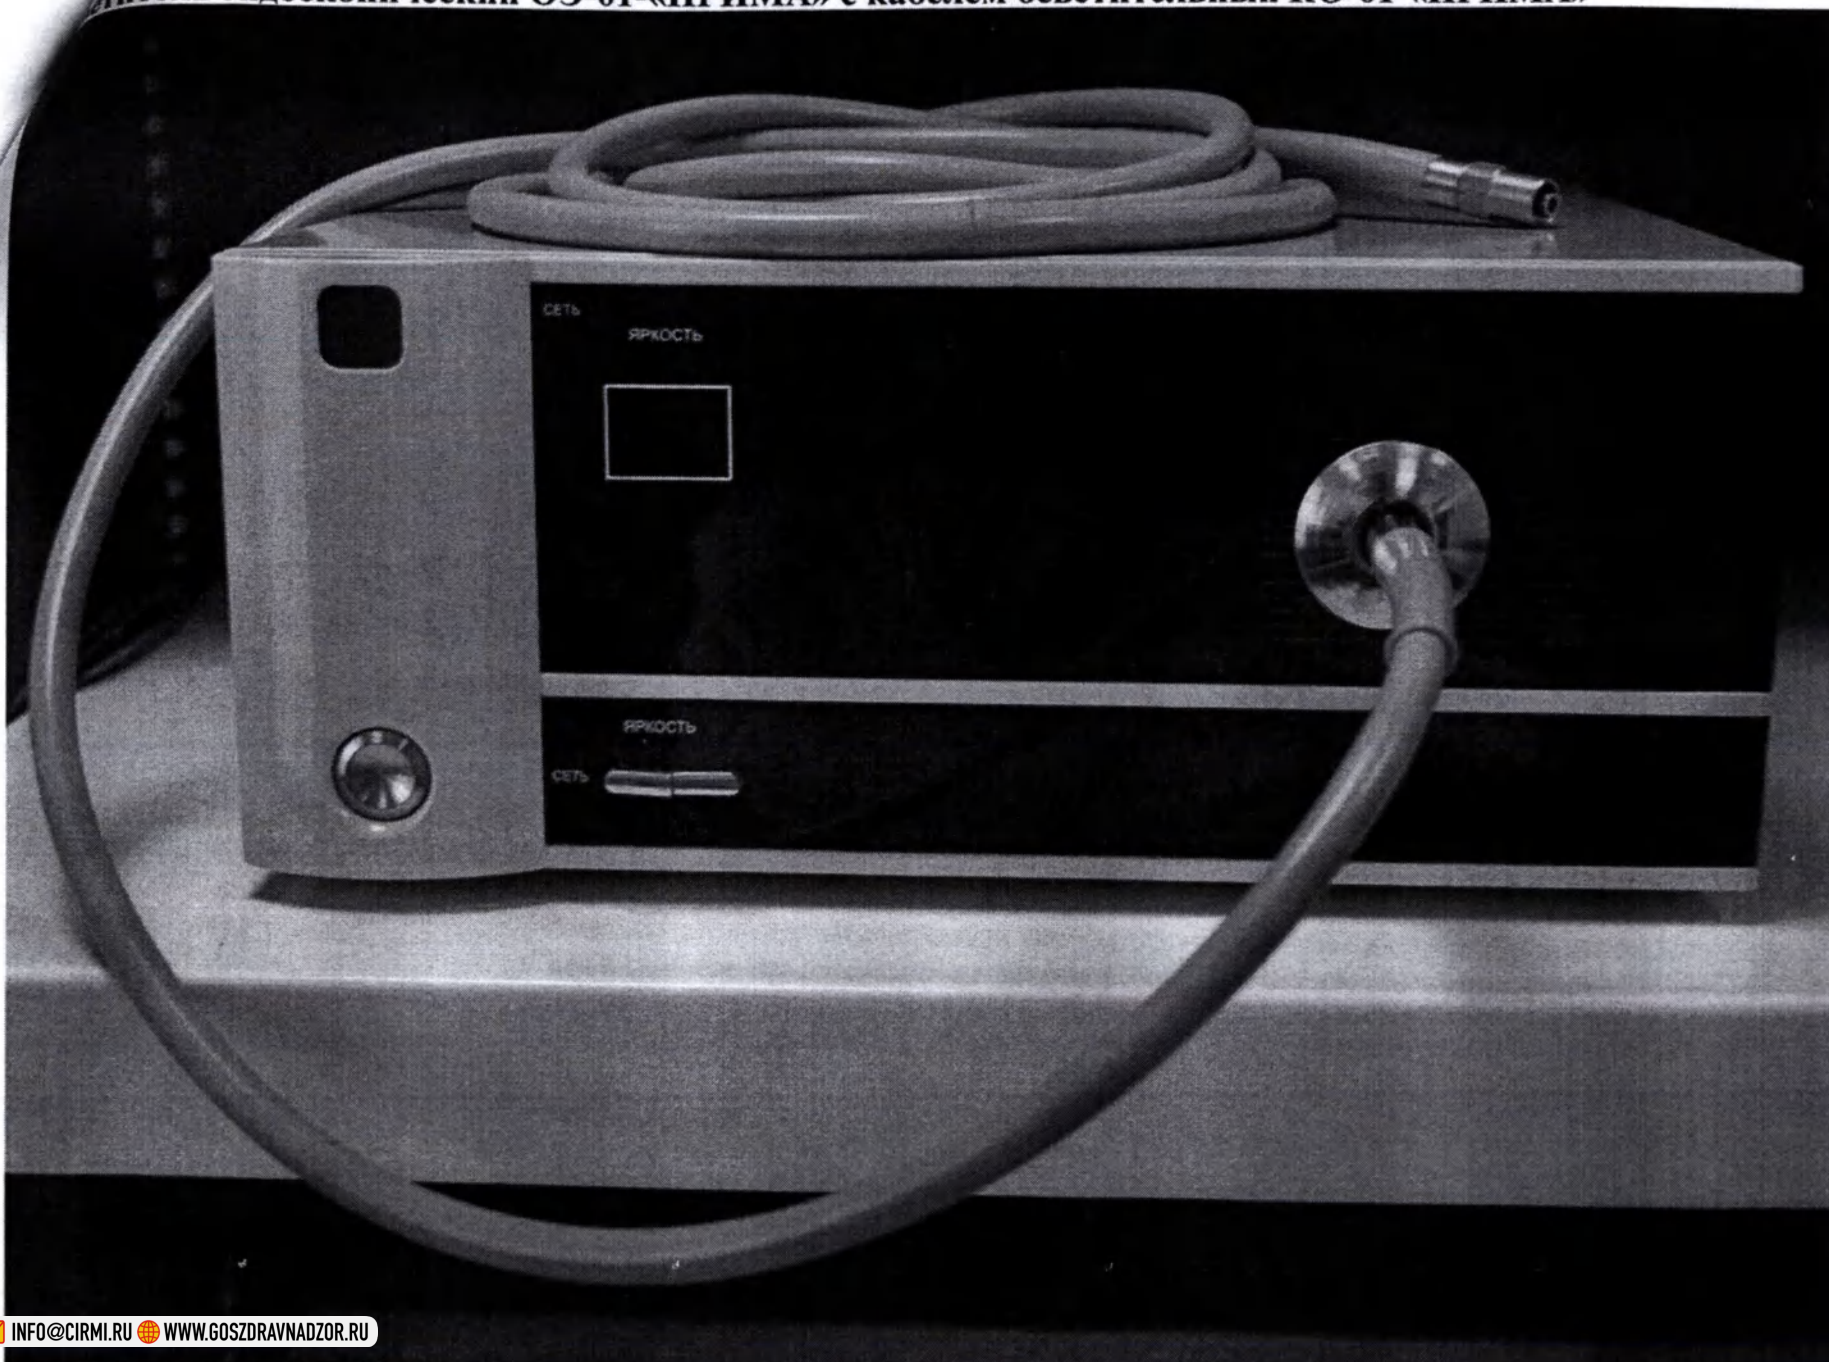


Экран видеотителей эндоскопический ОЭ-01-«ПРИМА»

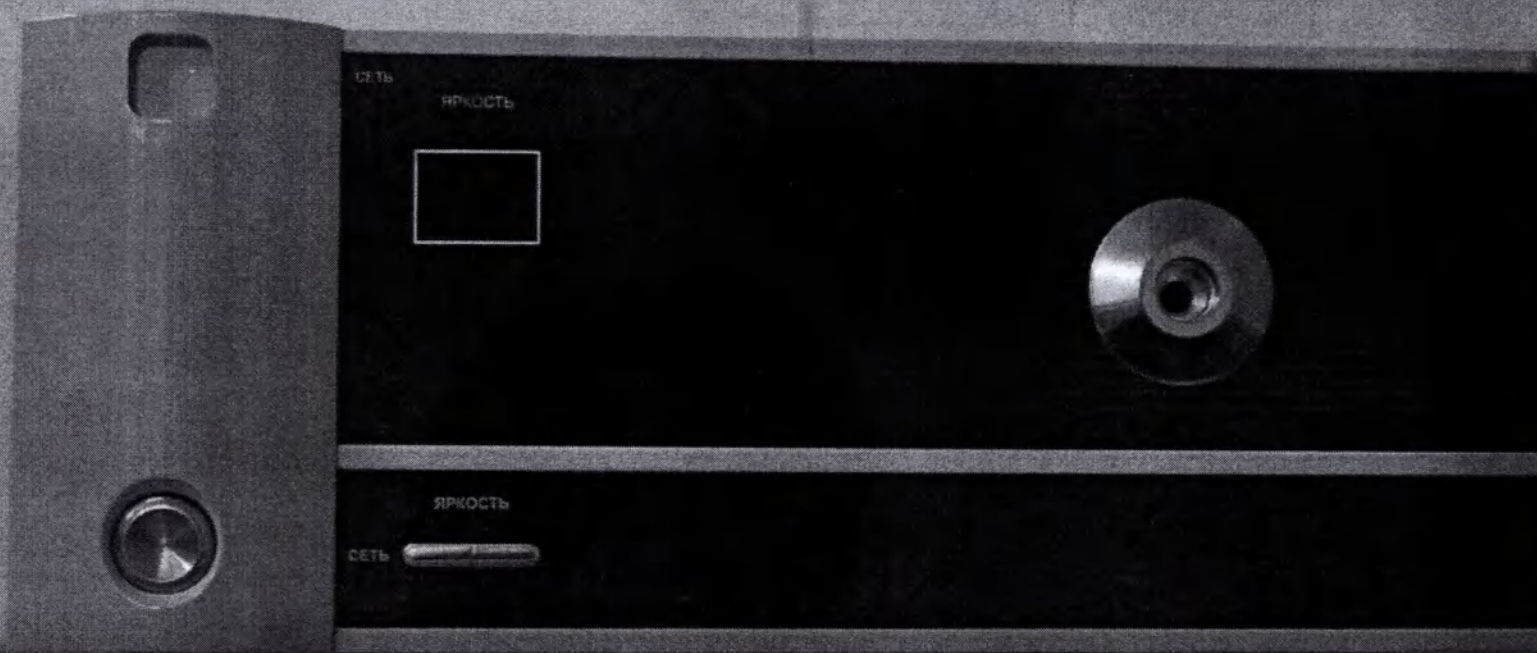

Устройство эндоскопический ОЭ-01-«ПРИМА»: вид сзади с подключенным кабелем питания

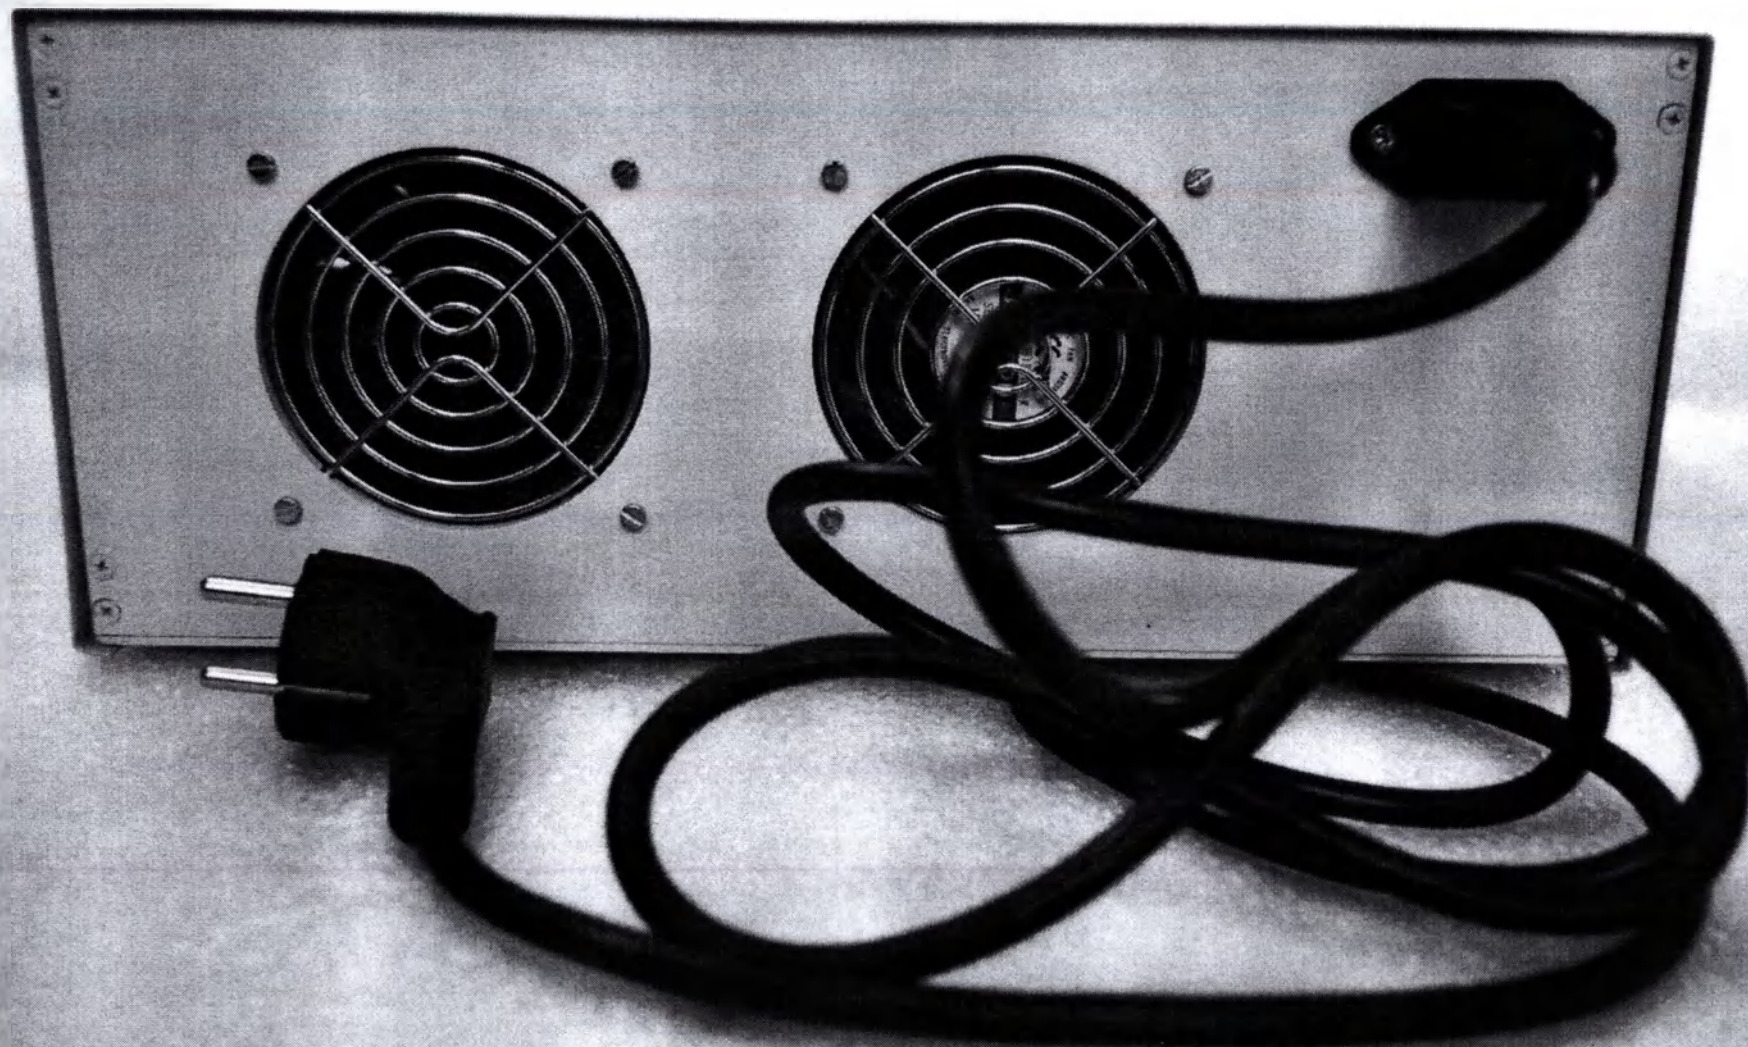


метитель эндоскопический ОЭ-01-«ПРИМА»: вид сзади

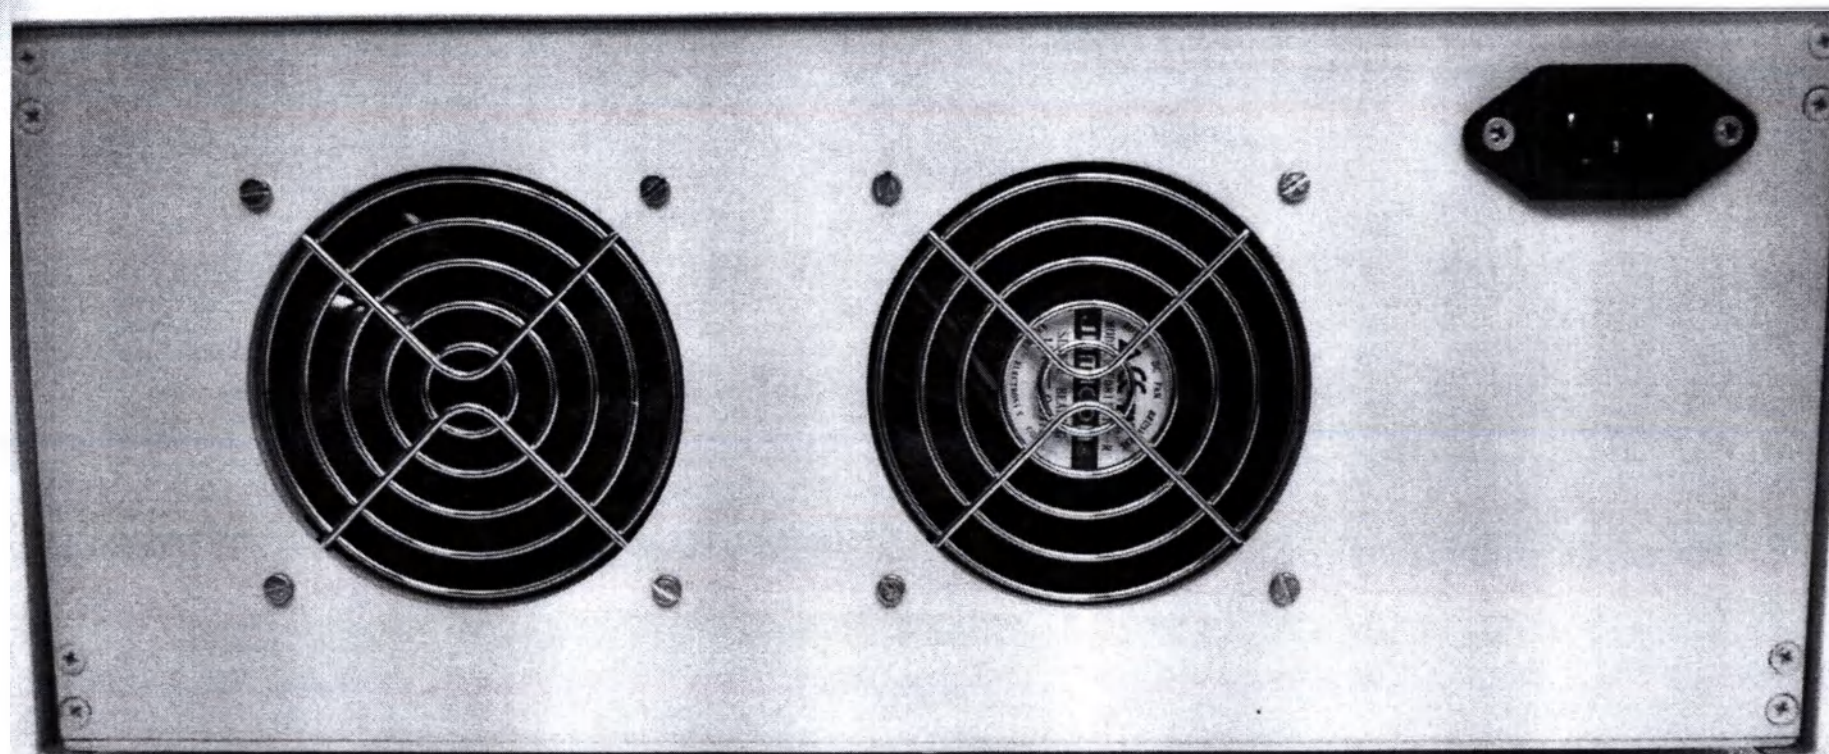

УСТРОЙСТВО ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОЭ-01-«ПРИМА»



ель осветительный КО-01-«ПРИМА» с Трубкой оптической ТО-01-«ПРИМА»

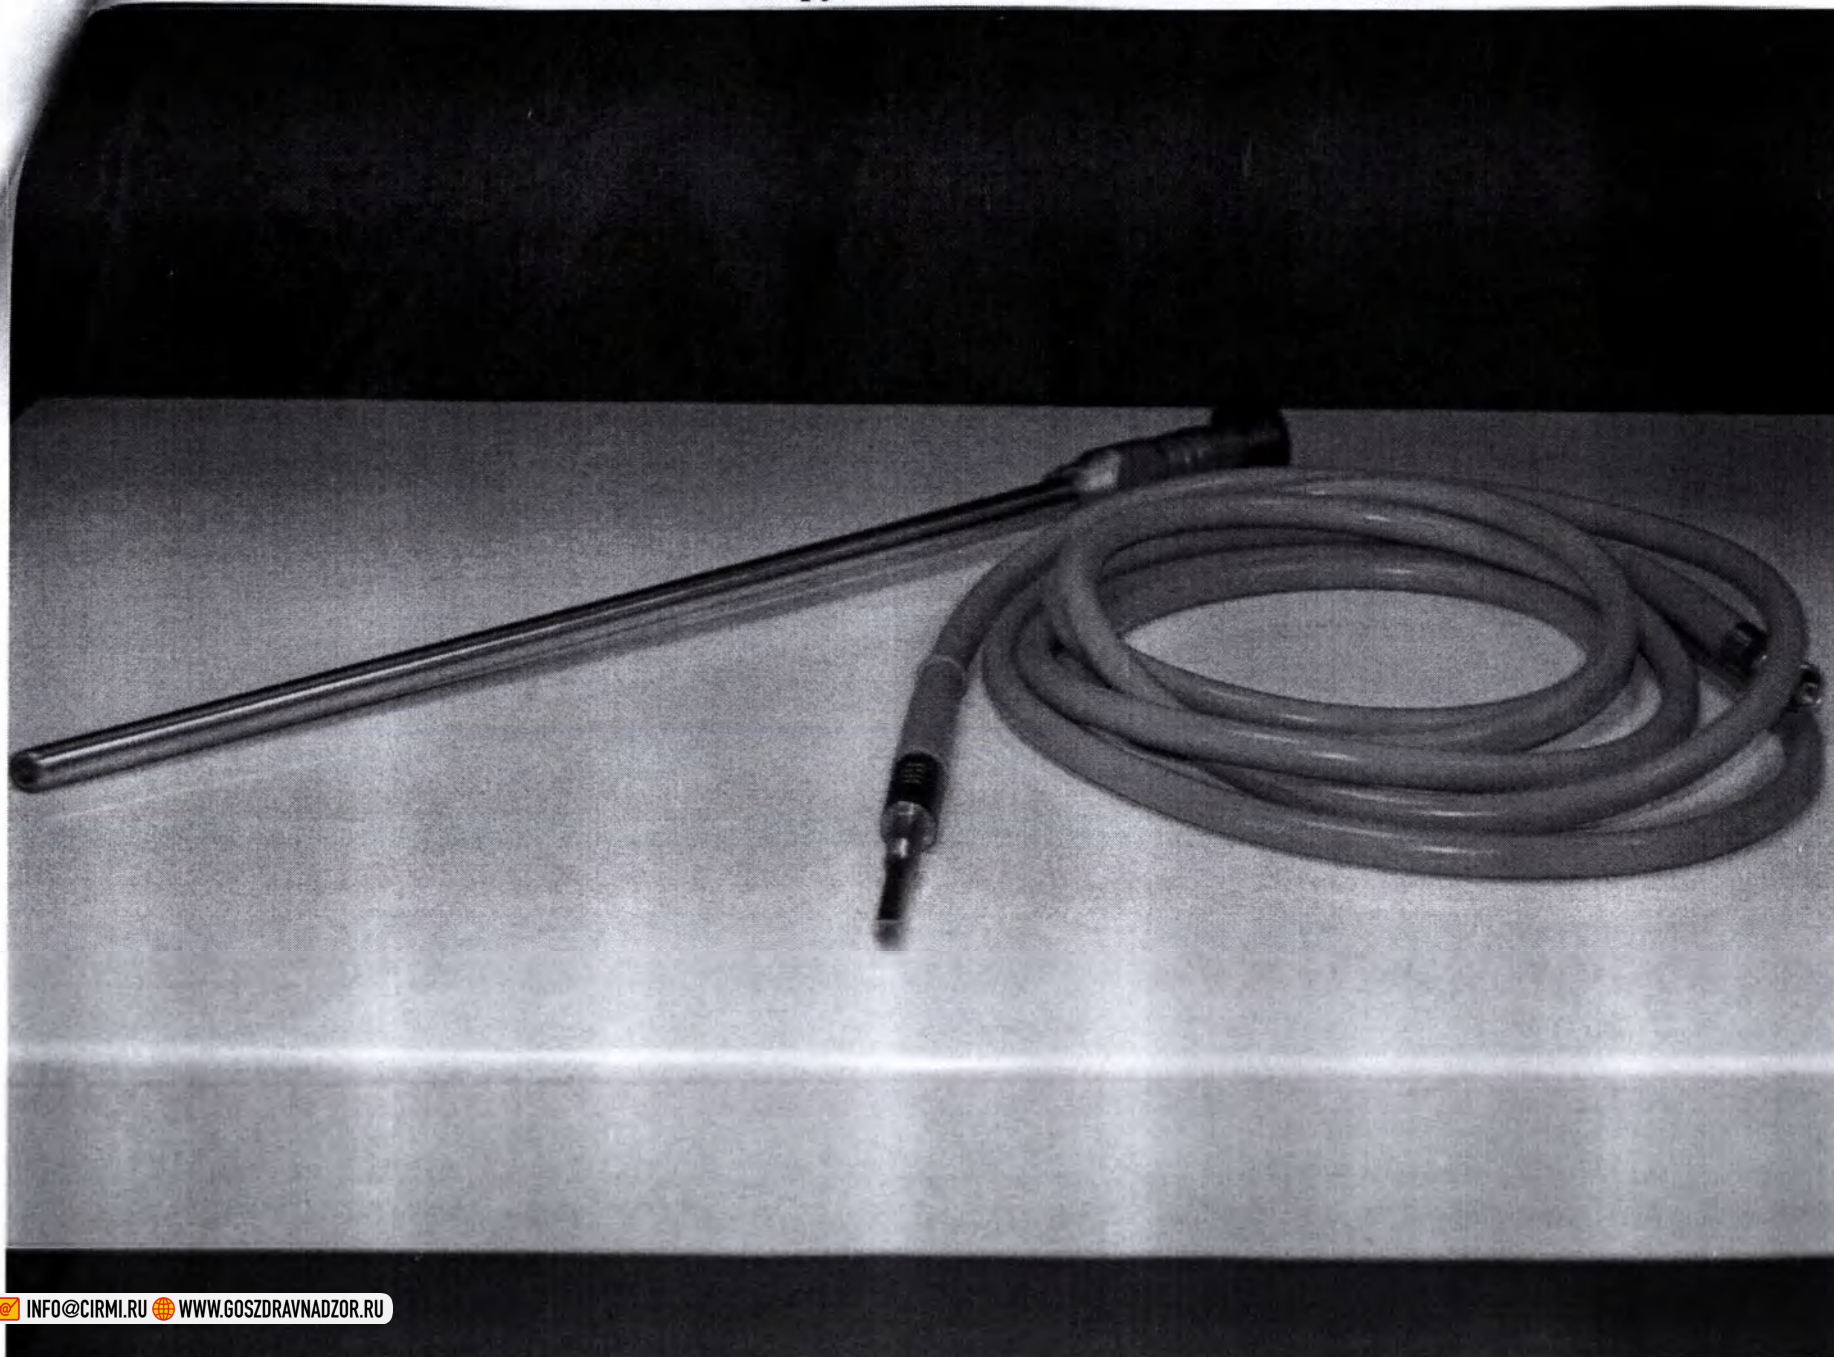

метитель эндоскопический ОЭ-01-«ПРИМА»

