



Фотографическое изображение
устройства

MICROVENTION®
TERUMO

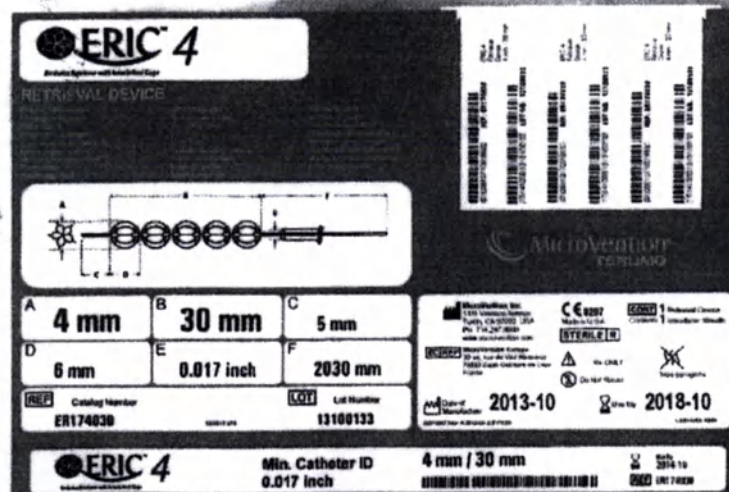


На маркировке указаны

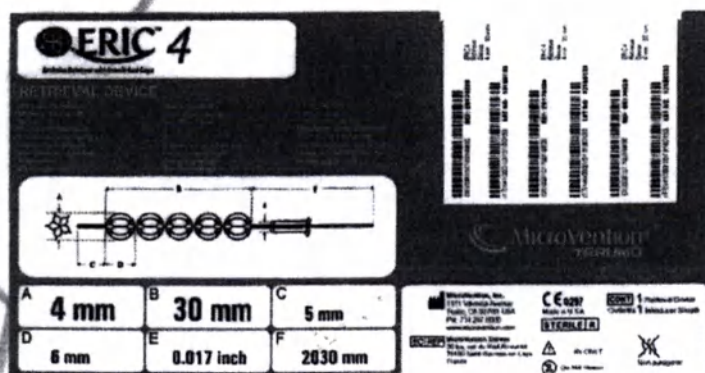

Embolus Retriever with Interlinked Cages

Внедрить в работу :

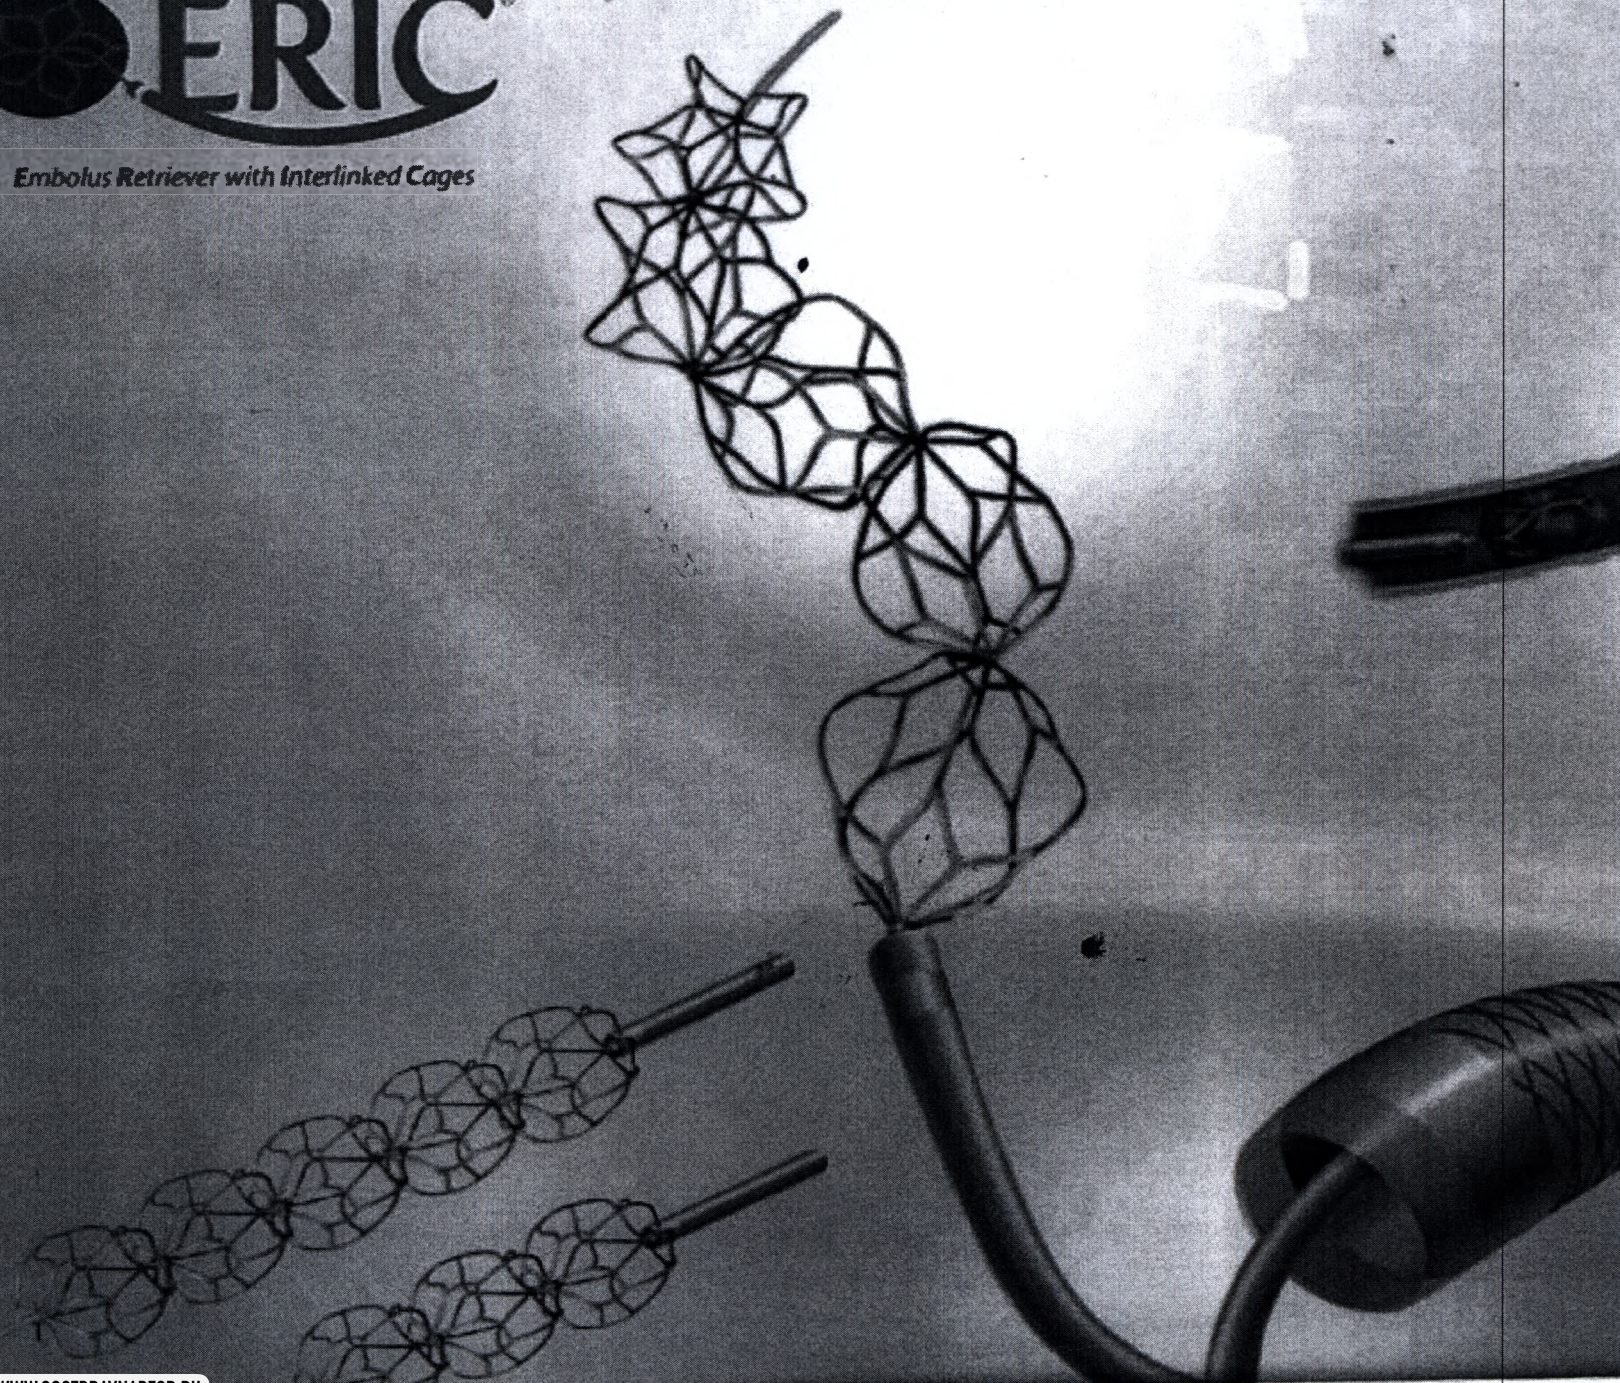

-2-



используемая часть

используемая часть



3-

копировка
судебного
эксперта

Результаты, полученные в
экспертном исследовании и
испытании.

Дуপুর
ООО - Инвест

/ Page 6 of