

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Парадигма»
Ю.В. Гольдберг



**Фотографические изображения
медицинского изделия
«НАБОР ДЛЯ ЭМБОЛИЗАЦИИ СОСУДОВ «КАП»
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ»**

ООО «Парадигма»


1) Набор для эмболизации сосудов «КАП» 11518, в составе:

Набор для эмболизации сосудов «КАП» 11518

№	Состав	Кол-во	Способ стерилизации
1	Эмболизирющий материал (объем 1,5 мл, вязкость 18 сСт)	1 флакон	STERILE
2	Диметилсульфоксид (объем 1,5 мл)	1 флакон	STERILE
3	Шприц 1 мл для доставки эмболизирющего материала	2 шт	STERILEEO
4	Шприц 1 мл для доставки диметилсульфоксида	1 шт	STERILEEO
5	Инструкция по применению	1 шт	-

REF 11518 LOT K011217 2020-01 STERILE

НЕТОКСИЧНО



ООО «Цирми», 620100, Российская Федерация, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Ретина, д. 22, помещение 1,
49/04 (область применения: система мед. В.Р. Гистологическое отделение Ротондальной
выдающей кассы ВООЗ, 620100, г. Екатеринбург, ул. С. Колосовский, 7/пр. Академическая, д. 22/39,
ООО «ЦирмиСистемы», 620001, г. Екатеринбург, ул. Мотеевская, дом 3, этаж 40/1.

Крепость 1, вязкость 18 сСт при температуре от -20 до +40 °C и относительной влажности не более 75%.
Хранить в герметичной упаковке при температуре от +2 до +25 °C и относительной влажности не более 75%.

ТУ 325050-001 67729874-2017 Сделано в России Рег.№: ИР7391 ОК Е

НАБОР ДЛЯ ЭМБОЛИЗАЦИИ СОСУДОВ «КАП»
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ
по ТУ 32.50.50-001-67729874-2017
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ООО «Цирми», 620100, Российская Федерация, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Ретина, д. 22, помещение 1.

Шприц 1 мл для доставки эмболизирющего материала - 2 шт
Шприц для доставки диметилсульфоксида - 1 шт


REF 11000 LOT S010817 2022-08 STERILEEO

НЕТОКСИЧНО



ТУ 325050-001 67729874-2017

ООО «Парадигма», 620100, Российская Федерация, Свердловская область,
 г. Екатеринбург, ул. Регина д. 22, помещение 1.
 Шприц 1 мл для доставки эмболизирующего материала - 2шт
 Шприц для доставки диметилсульфоксида - 1 шт
 REF 11000 LOT S010817 2022-08 STERILEEO
 НЕТОКСИЧНО
 Набор для выполнения операции «А/В»

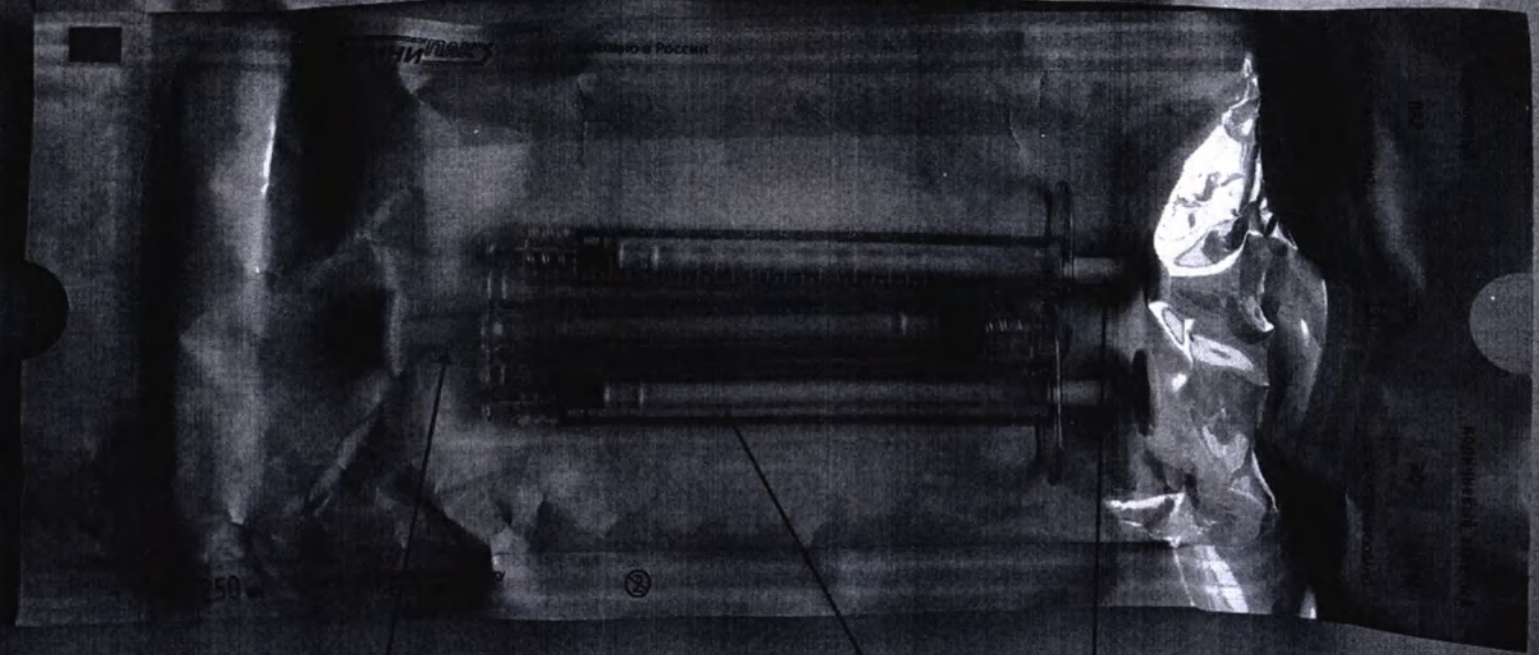

Шприц 1 мл для доставки диметилсульфоксида

Шприц 1 мл для доставки эмболизирующего материала

2) Набор для эмболизации сосудов «КАП» 11534, в составе:

Инструкция по применению

НАБОР ДЛЯ ЭМБОЛИЗАЦИИ СОСУДОВ «КАП»
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ
по ТУ 32.50.50-001-67729674-2017
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор для эмболизации сосудов «КАП» 11534

№	Состав	Кол-во	Способ стерилизации
1	Эмболизирующий материал (объем 1,5 мл, вязкость 34 сСт)	1 флакон	STERILE
2	Диметилсульфоксид (объем 1,5 мл)	1 флакон	STERILE
3	Шприц 1 мл для доставки эмболизирующего материала	2 шт	STERILEEO
4	Шприц 1 мл для доставки диметилсульфоксида	1 шт	STERILEEO
5	Инструкция по применению	1 шт	

REF 11534 LOT K021217 2020-01 STERILE

НЕТОКСИЧНО

ООО «Пардигма», 620100, Российская Федерация, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Ретина д. 22, помещение 1.
ВНП Населенный пункт: 620100, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалева, д. 22, 20.
ООО «Пардигма», 620100, г. Екатеринбург, ул. Мухоморова, д. 1, офис 001.

Хранить в герметичной упаковке при температуре от -30 до +40°C и относительной влажности не более 75%.
Выпускать и применять при температуре от -30 до +30°C и относительной влажности не более 75%.
ТУ 32.50.50-001-67729674-2017 Сделано в России Рег. №: ИР 020

ООО «Пардигма», 620100, Российская Федерация, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Ретина д. 22, помещение 1.

Шприц 1 мл для доставки эмболизирующего материала - 2шт
Шприц для доставки диметилсульфоксида - 1 шт

REF 11000 LOT S010817 2022-08 STERILEEO

НЕТОКСИЧНО

ТУ 32.50.50-001-67729674-2017

Эмболизирующий материал (объем 1,5 мл, вязкость 34 сСт)

Диметилсульфоксид (объем 1,5 мл)


ООО «Парадигма», 620100, Российская Федерация, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Регина д. 22, помещение 1.

Шприц 1 мл для доставки эмболизирующего материала - 2 шт
Шприц для доставки диметилсульфоксида - 1 шт

REF 11000 LOT S010817 2022-08 STERILEEO

НЕТОКСИЧНО

ТУ 339850-001-67720674-2017 Набор для эмболизации сосудов «АМГ»

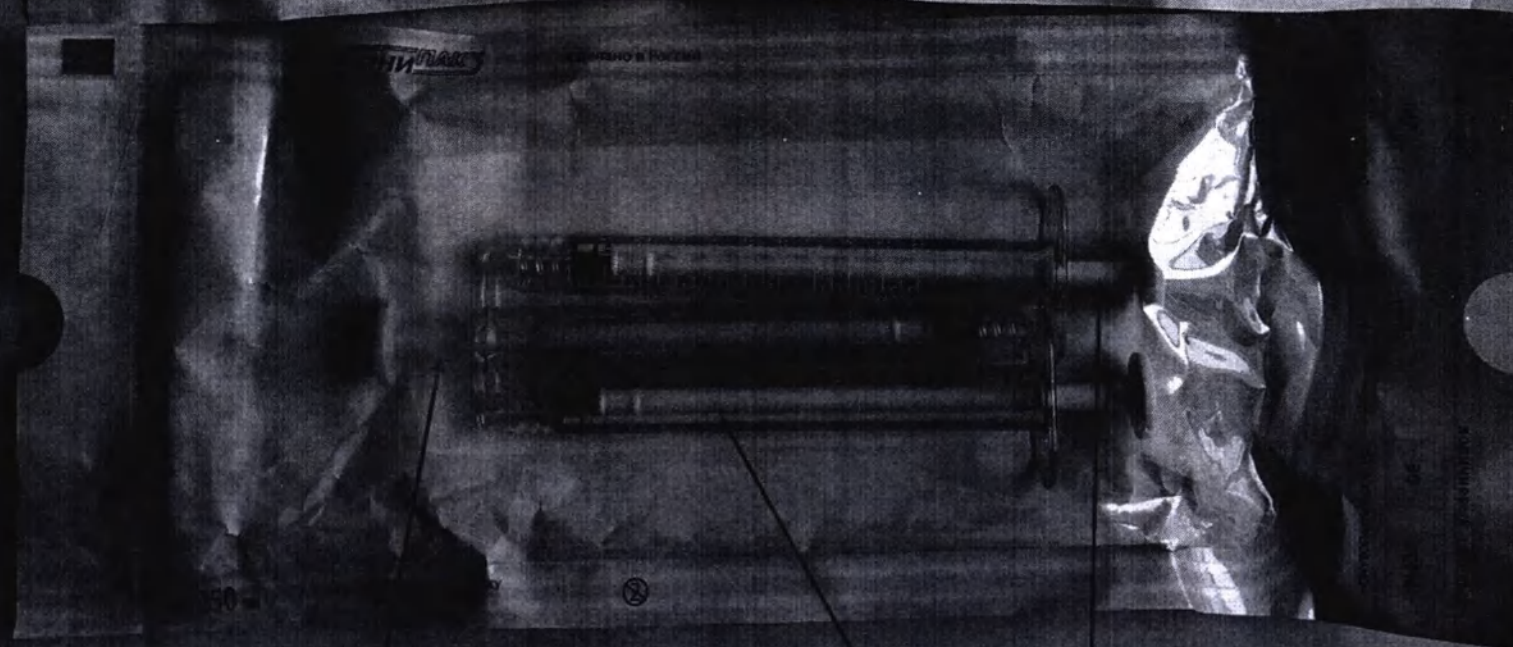

Шприц 1 мл для доставки диметилсульфоксида

Шприц 1 мл для доставки эмболизирующего материала

3) Набор для эмболизации сосудов «КАП» 16018, в составе:

Инструкция по применению

Набор для эмболизации сосудов «КАП» 16018

№	Состав	Кол-во	Способ стерилизации
1	Эмболизирующий материал (объем 6 мл, вязкость 18 сСт)	1 флакон	STERILE
2	Диметилсульфоксид (объем 6 мл)	1 флакон	STERILE
3	Шприц 1 мл для доставки эмболизирующего материала	4 шт	STERILE
4	Шприц 1 мл для доставки диметилсульфоксида	2 шт	STERILE
5	Инструкция по применению	1 шт	

REF 16018 LOT K031217 2020-01 STERILE

НЕТОКСИЧНО

ООО «Цирми», 620100, Российская Федерация, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Раткина, д. 22, помещение 1.
ФГУП Институт прикладных сплавов им. И.А. Пастухова Уральского отделения Российской
академии наук (ИОС УО РАН), 620137, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалева, д. 1/ ул. Академическая, д. 23/2б.
ООО «ЦирмиСистемы», 620085, г. Екатеринбург, ул. Моторная, дом 3, офис 88/1.

Хранить в герметичной упаковке при температуре от -30 до +40 °C и относительной влажности не более 75%.
Температура в ампулах при температуре от -30 до +50 °C и относительной влажности не более 75%.

ТУ 325050-001-67729874-2017. Екатеринбург, Россия. Разреш. № РИМ.

НАБОР ДЛЯ ЭМБОЛИЗАЦИИ СОСУДОВ «КАП»
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ
по ТУ 32.50.50-001-67729874-2017
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ООО «Цирми», 620100, Российская Федерация, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Раткина, д. 22, помещение 1.

Шприц 1 мл для доставки эмболизирующего материала - 2 шт.
Шприц для доставки диметилсульфоксида - 1 шт.

REF 11000 LOT SD10d17 2022-08 STERILE

НЕТОКСИЧНО

ООО «Цирми», 620100, Российская Федерация,
г. Екатеринбург, ул. Раткина, д. 22, помещение 1.

Шприц 1 мл для доставки эмболизирующего материала - 2 шт.

Шприц для доставки диметилсульфоксида - 1 шт.

Диметилсульфоксид (объем 6 мл)

ООО «Парадигма», 620100, Российская Федерация, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Регина д. 22, помещение 1.


Шприц 1 мл для доставки эмболизирующего материала - 2шт
Шприц для доставки диметилсульфоксида - 1 шт

REF 11000 LOT S010817 2022-08 STERILEEO

НЕТОКСИЧНО

ИЗДАНИЕ 01-2022

Набор для эмболизации сосудов «А/Ъ»

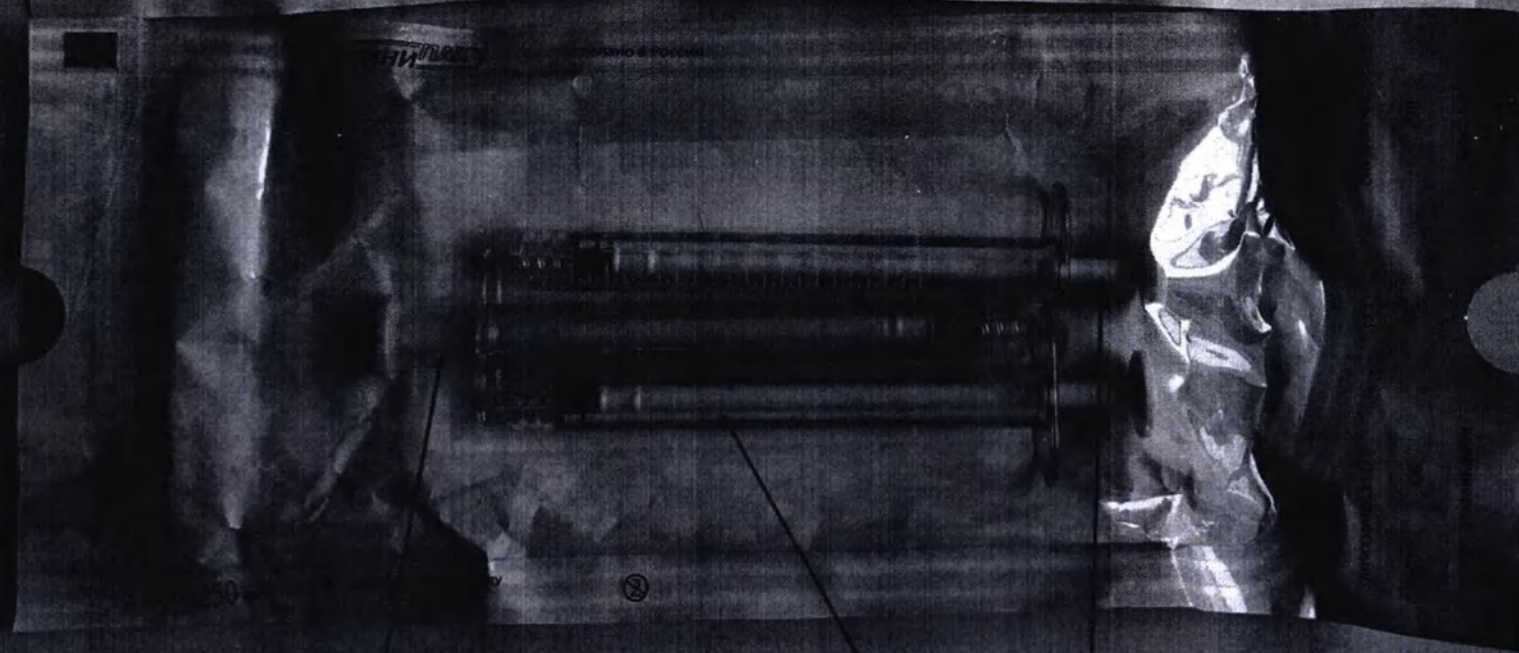

Шприц 1 мл для доставки диметилсульфоксида

Шприц 1 мл для доставки эмболизирующего материала

4) Набор для эмболизации сосудов «КАП» 16034, в составе

Инструкция по применению

НАБОР ДЛЯ ЭМБОЛИЗАЦИИ СОСУДОВ «КАП»
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ
по ТУ 32.50.50-001-67729874-2017
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор для эмболизации сосудов «КАП» 16034

№	Состав	Кол-во	Способ стерилизации
1	Эмболизирующий материал (объем 6 мл, вязкость 34 сСу)	1 флакон	STERILE ↓
2	Диметилсульфоксид (объем 6 мл)	1 флакон	STERILE ↓
3	Шприц 1 мл для доставки эмболизирующего материала	4 шт.	STERILEEO
4	Шприц 1 мл для доставки диметилсульфоксида	2 шт.	STERILEEO
5	Инструкция по применению	1 шт.	

REF 16034 LOT K041217 2020-01 STERILE

НЕТОКСИЧНО

ООО «Цирми», 620106, Российская Федерация, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Ретина, д. 22, помещение 1.
ФГБУН Институт органического синтеза им. И.В. Петровского Уральского отделения Российской
академии наук ВОО РАН, 620137, г. Екатеринбург, ул. С. Бажовского, д. 22/06
ООО «ЦирмиСистемы», 620061, г. Екатеринбург, ул. Мухоморова, дом 3, офис 601.

Хранить в закрытой упаковке при температуре от -20 до +40 °C и относительной влажности не более 75%.
Применять в течение 5 лет с даты изготовления при температуре от -20 до +40 °C и относительной влажности
не более 75%.


ТУ 32.50.50-001-67729874-2017 Сделано в России Рег.Уд.: № РЭН от

ООО «Цирми», 620106, Российская Федерация, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Ретина, д. 22, помещение 1.

Шприц 1 мл для доставки эмболизирующего материала - 2шт
Шприц для доставки диметилсульфоксида - 1 шт

REF 11000 LOT S010817 2022-08 STERILEEO

НЕТОКСИЧНО



Диметилсульфоксид (объем 6 мл)

ООО «Парадигма», 620100, Российская Федерация, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Репина д. 22, помещение 1.

Шприц 1 мл для доставки эмболизирующего материала - 2 шт
Шприц для доставки диметилсульфоксида - 1 шт


REF 11000 LOT S010817 2022-08 STERILE EO

НЕТОКСИЧНО



ТУ 321552-001-6772874-2017

Набор для эмболизации сосудов «АУ»

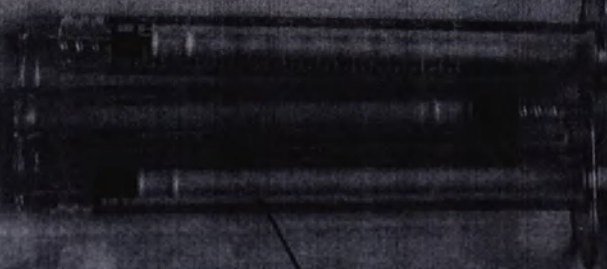

Шприц 1 мл для доставки диметилсульфоксида

Шприц 1 мл для доставки эмболизирующего материала

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девят)

листов(а)

Директор

Гольдберг Ю.В.

