

**Кресло-туалет  
модель АМСВ6803**



**Изготовитель:** Амрус Энтерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprises, Ltd.  
**Импортер:** ЗАО фирма «Москва-Амрос»,  
РФ, Москва, 107926, в/л 11  
**Сертификат соответствия:**  
РОСС US. IM25.  
**Регистрационное удостоверение**

**Гигиеническое заключение**

**Соответствует** ГОСТ Р 50444-92 (р.р.3,4).  
ГОСТ Р 51632-2000  
**Срок службы** не менее 10 лет

Печать  
торговой организации

Печать  
ЗАО фирмы «Москва-Амрос»

Дата выдачи  
Торговой организацией

Дата поставки в  
Торговую организацию

Претензий к внешнему виду не имею.  
С условиями действия гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

**Кресло-туалет  
АМСВ6803**



**Руководство пользователя**



**Амрус Энтерпрайзис, Лтд**

**Кресло-туалет  
модель АМСВ6803**



**Изготовитель:** Амрус Энтерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprises, Ltd.  
**Импортер:** ЗАО фирма «Москва-Амрос»,  
РФ, Москва, 107926, в/л 11  
**Сертификат соответствия:**  
РОСС US. IM25.  
**Регистрационное удостоверение**

**Гигиеническое заключение**

**Соответствует** ГОСТ Р 50444-92 (р.р.3,4).  
ГОСТ Р 51632-2000  
**Срок службы** не менее 10 лет

Печать  
торговой организации

Печать  
ЗАО фирмы «Москва-Амрос»

Дата выдачи  
Торговой организацией

Дата поставки в  
Торговую организацию

Претензий к внешнему виду не имею.  
С условиями действия гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

**Кресло-туалет  
АМСВ6803**



**Руководство пользователя**



**Амрус Энтерпрайзис, Лтд**

## ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Соберите кресло-туалет, как показано на рисунке на обложке. Отрегулируйте выдвижные опоры, чтобы получить желаемую высоту кресла-туалета. Убедитесь, что все резьбовые соединения надежно закреплены, а кнопки фиксаторов на нижних частях опор закреплены и зафиксированы (см. рисунок на обложке).

## ПЕРЕХОД ОТ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ К КРЕСЛУ-ТУАЛЕТУ

Убедитесь, что колеса инвалидного кресла-коляски заторможены. Поднимитесь, опираясь на поручни коляски. Перенесите руку на поручень кресла-туалета. Если у Вас поранена левая конечность, то сначала перенесите руку, противоположную пораженной стороне. Повернитесь и сядьте на сиденье кресла-туалета.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохраните кресло-туалет от ударов и повреждений. Не допускайте присоединения кресла-туалета к электрическим проводам. Вовремя заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки кресла – туалета пользуйтесь водой и нейтральным моющим средством, затем вытрите его сухой тканью. Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства. Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

## ХРАНЕНИЕ

Храните кресло-туалет после использования в сухом и чистом месте. Не подвергайте кресло-туалет воздействию высокой температуры, влажности и пыли. Оберегайте кресло-туалет от воздействия прямых солнечных лучей. Храните кресло-туалет при температуре от -20°C до +60 °C.

## ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Соберите кресло-туалет, как показано на рисунке на обложке. Отрегулируйте выдвижные опоры, чтобы получить желаемую высоту кресла-туалета. Убедитесь, что все резьбовые соединения надежно закреплены, а кнопки фиксаторов на нижних частях опор закреплены и зафиксированы (см. рисунок на обложке).

## ПЕРЕХОД ОТ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ К КРЕСЛУ-ТУАЛЕТУ

Убедитесь, что колеса инвалидного кресла-коляски заторможены. Поднимитесь, опираясь на поручни коляски. Перенесите руку на поручень кресла-туалета. Если у Вас поранена левая конечность, то сначала перенесите руку, противоположную пораженной стороне. Повернитесь и сядьте на сиденье кресла-туалета.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохраните кресло-туалет от ударов и повреждений. Не допускайте присоединения кресла-туалета к электрическим проводам. Вовремя заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки кресла – туалета пользуйтесь водой и нейтральным моющим средством, затем вытрите его сухой тканью. Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства. Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

## ХРАНЕНИЕ

Храните кресло-туалет после использования в сухом и чистом месте. Не подвергайте кресло-туалет воздействию высокой температуры, влажности и пыли. Оберегайте кресло-туалет от воздействия прямых солнечных лучей. Храните кресло-туалет при температуре от -20°C до +60 °C.

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
2. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
3. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты поставки кресла-туалета в торгующую организацию плюс 1 месяц.
4. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона.
5. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
6. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:
  - удара;
  - механического воздействия;
  - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
  - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

## ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:

- отметку о дате поставки торгующей организацией фирмой "Москва-Амрос"
- отметку о дате продажи кресла-туалета

Сохраните гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока. При возникновении неисправности обращайтесь в гарантийную мастерскую, указанную торгующей организацией.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для региона Москвы и Московской области:  
ул. Митрофановская, д. 23, стр. 2,  
во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.  
Проезд: метро "Сокольники",  
далее трамвай 7, автобус 265, 716, троллейбус 14, 32, 41.  
До остановки "Дело им. Русакова, Академия приборостроения".  
При отсутствии Вашего города гарантийной мастерской обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107966, а/я 11.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:  
[www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru) E-mail: [mos\\_amros@mtu-net.ru](mailto:mos_amros@mtu-net.ru)

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

7. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
8. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
9. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты поставки кресла-туалета в торгующую организацию плюс 1 месяц.
10. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона.
11. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
12. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:
  - удара;
  - механического воздействия;
  - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
  - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

## ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:

- отметку о дате поставки торгующей организацией фирмой "Москва-Амрос"
- отметку о дате продажи кресла-туалета

Сохраните гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока. При возникновении неисправности обращайтесь в гарантийную мастерскую, указанную торгующей организацией.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для региона Москвы и Московской области:  
ул. Митрофановская, д. 23, стр. 2,  
во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.  
Проезд: метро "Сокольники",  
далее трамвай 7, автобус 265, 716, троллейбус 14, 32, 41.  
До остановки "Дело им. Русакова, Академия приборостроения".  
При отсутствии Вашего города гарантийной мастерской обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107966, а/я 11.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:  
[www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru) E-mail: [mos\\_amros@mtu-net.ru](mailto:mos_amros@mtu-net.ru)

# Кресло-туалет модель АМСВ6804



Изготовитель: Амрус Энтерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprise, Ltd.  
Импортер: ЗАО фирма «Москва-Амрос»,  
РФ, Москва, 107996, а/я 11  
Сертификат соответствия:  
РОСС US. IMZS.  
Регистрационное удостоверение

Гигиеническое заключение

Соответствует ГОСТ Р 50444-02 (р.р.3,4).  
ГОСТ Р 51832-2000  
Срок службы не менее 10 лет

Печать  
торговой организации

Печать  
ЗАО фирмы "Москва-Амрос"

Дата продажи  
Торговой организацией

Дата поставки в  
Торговую организацию

Претензий к внешнему виду не имеет.  
С условиями действия гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

# Кресло-туалет АМСВ6804



## Руководство пользователя



Амрус Энтерпрайзис, Лтд

# Кресло-туалет модель АМСВ6804



Изготовитель: Амрус Энтерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprise, Ltd.  
Импортер: ЗАО фирма «Москва-Амрос»,  
РФ, Москва, 107996, а/я 11  
Сертификат соответствия:  
РОСС US. IMZS.  
Регистрационное удостоверение

Гигиеническое заключение

Соответствует ГОСТ Р 50444-02 (р.р.3,4).  
ГОСТ Р 51832-2000  
Срок службы не менее 10 лет

Печать  
торговой организации

Печать  
ЗАО фирмы "Москва-Амрос"

Дата продажи  
Торговой организацией

Дата поставки в  
Торговую организацию

Претензий к внешнему виду не имеет.  
С условиями действия гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

# Кресло-туалет АМСВ6804



## Руководство пользователя



Амрус Энтерпрайзис, Лтд

## ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Соберите кресло-туалет, как показано на рисунке на обложке. Отрегулируйте выдвигающиеся опоры, чтобы получить желаемую высоту кресла-туалета. Убедитесь, что все резьбовые соединения надежно закреплены, а ювелирные фиксаторы на нижних частях опор зафиксированы (см. рисунок на обложке).

## ПЕРЕХОД ОТ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ К КРЕСЛУ-ТУАЛЕТУ

Убедитесь, что колеса инвалидного кресла-коляски заторможены.

Поднимитесь, опираясь на поручни коляски.

Перенесите руку на поручень кресла-туалета.

Если у Вас повреждена нижняя конечность, то сначала перенесите руку, противоположную поврежденной стороне.

Повернитесь и сядьте на сиденье кресла-туалета

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохраните кресло-туалет от ударов и повреждений.

Не допускайте присоединения кресла-туалета к электрическим проводам.

Вовремя заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки кресла – туалета пользуйтесь водой и нейтральным моющим средством, затем вытрите его сухой тканью.

Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства

Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

## ХРАНЕНИЕ

Храните кресло-туалет после использования в сухом и чистом месте.

Не подвержайте кресло-туалет воздействию высокой температуры, влажности и пыли. Оберегайте кресло-туалет от воздействия прямых солнечных лучей.

Храните кресло-туалет при температуре от -20°C до +60 °C.

## ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Соберите кресло-туалет, как показано на рисунке на обложке. Отрегулируйте выдвигающиеся опоры, чтобы получить желаемую высоту кресла-туалета.

Убедитесь, что все резьбовые соединения надежно закреплены, а ювелирные фиксаторы на нижних частях опор зафиксированы (см. рисунок на обложке).

## ПЕРЕХОД ОТ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ К КРЕСЛУ-ТУАЛЕТУ

Убедитесь, что колеса инвалидного кресла-коляски заторможены.

Поднимитесь, опираясь на поручни коляски.

Перенесите руку на поручень кресла-туалета.

Если у Вас повреждена нижняя конечность, то сначала перенесите руку, противоположную поврежденной стороне.

Повернитесь и сядьте на сиденье кресла-туалета

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохраните кресло-туалет от ударов и повреждений.

Не допускайте присоединения кресла-туалета к электрическим проводам.

Вовремя заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки кресла – туалета пользуйтесь водой и нейтральным моющим средством, затем вытрите его сухой тканью.

Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства

Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

## ХРАНЕНИЕ

Храните кресло-туалет после использования в сухом и чистом месте.

Не подвержайте кресло-туалет воздействию высокой температуры, влажности и пыли. Оберегайте кресло-туалет от воздействия прямых солнечных лучей.

Условия хранения: температура от -20°C до +60 °C.

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
2. Дата продажи указывается продавцом в гарантийном талоне.
3. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты поставки кресла-туалета в торгующую организацию плюс 1 месяц.
4. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона.
5. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
6. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:
  - удара;
  - механического воздействия;
  - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
  - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

## ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:

- отметку о дате поставки в торгующую организацию фирмой "Москва-Амрос"
  - отметку о дате продажи кресла-туалета
- Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока. При возникновении неисправности обращайтесь в гарантийную мастерскую, указанную торгующей организацией.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для региона Москвы и Московской области:

ул. Матросская тишина, д. 23, стр.2,  
во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.

Проезд: метро "Сокольники",

длина трамвай 7, автобус 265, 716, троллейбус 14, 32, 41.

До остановки "Депо им. Русанова, Академия приборостроения". При отсутствии в Вашем городе гарантийной мастерской обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107986, а/я 11.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:

[www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru)

E-mail: [mos\\_amros@mtu-net.ru](mailto:mos_amros@mtu-net.ru)

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

7. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
8. Дата продажи указывается продавцом в гарантийном талоне.
9. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты поставки кресла-туалета в торгующую организацию плюс 1 месяц.
10. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона.
11. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
12. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:
  - удара;
  - механического воздействия;
  - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
  - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

## ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:

- отметку о дате поставки в торгующую организацию фирмой "Москва-Амрос"
  - отметку о дате продажи кресла-туалета
- Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока. При возникновении неисправности обращайтесь в гарантийную мастерскую, указанную торгующей организацией.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для региона Москвы и Московской области:

ул. Матросская тишина, д. 23, стр.2,  
во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.

Проезд: метро "Сокольники",

длина трамвай 7, автобус 265, 716, троллейбус 14, 32, 41.

До остановки "Депо им. Русанова, Академия приборостроения". При отсутствии в Вашем городе гарантийной мастерской обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107986, а/я 11.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:

[www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru)

E-mail: [mos\\_amros@mtu-net.ru](mailto:mos_amros@mtu-net.ru)

## Кресло-туалет модель АМСВ6806



Изготовитель: Амрус Эntерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprises, Ltd.  
Импортёр: ЗАО фирма «Москва-Амрус»,  
РФ, Москва, 107906, в/л 11  
Сертификат соответствия:  
РОСС УБ. IM25.  
Регистрационное удостоверение

Гигиеническое заключение

Соответствует ГОСТ Р 50444-02 (р.р.3,4).  
ГОСТ Р 51632-2000  
Срок службы не менее 10 лет

Печать  
торговой организации

Печать  
ЗАО фирма «Москва-Амрус»

Дата продажи  
Торговой организацией

Дата поставки в  
Торговую организацию

Претензий к внешнему виду не имею.  
С условиями действия гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

## Кресло-туалет АМСВ6806



### Руководство пользователя



Амрус Эntерпрайзис, Лтд

## Кресло-туалет модель АМСВ6806



Изготовитель: Амрус Эntерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprises, Ltd.  
Импортёр: ЗАО фирма «Москва-Амрус»,  
РФ, Москва, 107906, в/л 11  
Сертификат соответствия:  
РОСС УБ. IM25.  
Регистрационное удостоверение

Гигиеническое заключение

Соответствует ГОСТ Р 50444-02 (р.р.3,4).  
ГОСТ Р 51632-2000  
Срок службы не менее 10 лет

Печать  
торговой организации

Печать  
ЗАО фирма «Москва-Амрус»

Дата продажи  
Торговой организацией

Дата поставки в  
Торговую организацию

Претензий к внешнему виду не имею.  
С условиями действия гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

## Кресло-туалет АМСВ6806



### Руководство пользователя



Амрус Эntерпрайзис, Лтд

## ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Соберите кресло-туалет, как показано на рисунке на обложке. Отрегулируйте выдвижные опоры, чтобы получить желаемую высоту кресла-туалета. Убедитесь, что все резьбовые соединения надежно закреплены, а кнопки фиксаторов на ножках частей опор закреплены и зафиксированы (см. рисунок на обложке).

## ПЕРЕХОД ОТ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ К КРЕСЛУ-ТУАЛЕТУ

Убедитесь, что колеса инвалидного кресла-коляски заторможены. Поднимитесь, опираясь на поручни коляски. Перенесите руку на поручень кресла-туалета. Если у Вас порвана нижняя конечность, то сначала перенесите руку, противоположную пораженной стороне. Повернитесь и сядьте на сиденье кресла-туалета.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохраняйте кресло-туалет от ударов и повреждений. Не допускайте присоединения кресла-туалета к электрическим проводам. Всегда заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки кресла – туалета пользуйтесь водой и нейтральным моющим средством, затем вытрите его сухой тканью. Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства. Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

## ХРАНЕНИЕ

Храните кресло-туалет после использования в сухом и чистом месте. Не подвержайте кресло-туалет воздействию высокой температуры, влажности и пыли. Оберегайте кресло-туалет от воздействия прямых солнечных лучей. Храните кресло-туалет при температуре от -20°C до +60°C.

## ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Соберите кресло-туалет, как показано на рисунке на обложке. Отрегулируйте выдвижные опоры, чтобы получить желаемую высоту кресла-туалета. Убедитесь, что все резьбовые соединения надежно закреплены, а кнопки фиксаторов на ножках частей опор закреплены и зафиксированы (см. рисунок на обложке).

## ПЕРЕХОД ОТ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ К КРЕСЛУ-ТУАЛЕТУ

Убедитесь, что колеса инвалидного кресла-коляски заторможены. Поднимитесь, опираясь на поручни коляски. Перенесите руку на поручень кресла-туалета. Если у Вас порвана нижняя конечность, то сначала перенесите руку, противоположную пораженной стороне. Повернитесь и сядьте на сиденье кресла-туалета.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохраняйте кресло-туалет от ударов и повреждений. Не допускайте присоединения кресла-туалета к электрическим проводам. Всегда заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки кресла – туалета пользуйтесь водой и нейтральным моющим средством, затем вытрите его сухой тканью. Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства. Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

## ХРАНЕНИЕ

Храните кресло-туалет после использования в сухом и чистом месте. Не подвержайте кресло-туалет воздействию высокой температуры, влажности и пыли. Оберегайте кресло-туалет от воздействия прямых солнечных лучей. Храните кресло-туалет при температуре от -20°C до +60°C.

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
2. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
3. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты поставки кресла-туалета в торговую организацию плюс 1 месяц.
4. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона.
5. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
6. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:
  - удара;
  - механического воздействия;
  - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
  - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

## ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:

- отмену о дате поставки в торговую организацию фирмой "Москва-Амрос"
- отмену о дате продажи кресла-туалета

Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока. При возникновении неисправности обращайтесь в гарантийную мастерскую, указанную торговой организацией.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для региона Москвы и Московской области:  
ул. Матросская тишина, д. 23, стр.2,  
во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.  
Проезд: метро "Сокольники",  
далее трамвай 7, автобус 285, 716, троллейбус 14, 32, 41.  
До остановки "Дело им. Русакова, Академия приборостроения".  
При отсутствии в Вашем городе гарантийной мастерской обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107986, а/я 11.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:  
[www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru) E-mail: [mos\\_amros@mtk-net.ru](mailto:mos_amros@mtk-net.ru)

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

7. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
8. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
9. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты поставки кресла-туалета в торговую организацию плюс 1 месяц.
10. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона.
11. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
12. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:
  - удара;
  - механического воздействия;
  - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
  - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

## ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:

- отмену о дате поставки в торговую организацию фирмой "Москва-Амрос"
- отмену о дате продажи кресла-туалета

Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока. При возникновении неисправности обращайтесь в гарантийную мастерскую, указанную торговой организацией.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для региона Москвы и Московской области:  
ул. Матросская тишина, д. 23, стр.2,  
во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.  
Проезд: метро "Сокольники",  
далее трамвай 7, автобус 285, 716, троллейбус 14, 32, 41.  
До остановки "Дело им. Русакова, Академия приборостроения".  
При отсутствии в Вашем городе гарантийной мастерской обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107986, а/я 11.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:  
[www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru) E-mail: [mos\\_amros@mtk-net.ru](mailto:mos_amros@mtk-net.ru)

**Кресло-туалет  
модель АМСВ6807**



Изготовитель: Амрус Энтерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprise, Ltd.  
Импортер: ЗАО фирма «Москва-Амрус»,  
РФ, Москва, 107998, а/я 11

Сертификат соответствия:  
РОСС US. ИМ25.  
Регистрационное удостоверение

Гигиеническое заключение

Соответствует ГОСТ Р 50444-92 (р.3,4).  
ГОСТ Р 51632-2000  
Срок службы не менее 10 лет

Печать  
торговой организации

Печать  
ЗАО фирма «Москва-Амрус»

Дата продажи  
Торговой организацией

Дата поставки в  
Торговую организацию

Претензий к внешнему виду не имею.  
С условиями действия гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

**Кресло-туалет  
модель АМСВ6807**



Изготовитель: Амрус Энтерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprise, Ltd.  
Импортер: ЗАО фирма «Москва-Амрус»,  
РФ, Москва, 107998, а/я 11

Сертификат соответствия:  
РОСС US. ИМ25.  
Регистрационное удостоверение

Гигиеническое заключение

Соответствует ГОСТ Р 50444-92 (р.3,4).  
ГОСТ Р 51632-2000  
Срок службы не менее 10 лет

Печать  
торговой организации

Печать  
ЗАО фирма «Москва-Амрус»

Дата продажи  
Торговой организацией

Дата поставки в  
Торговую организацию

Претензий к внешнему виду не имею.  
С условиями действия гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

**Кресло-туалет  
АМСВ6807**



**Руководство пользователя**



**Амрус Энтерпрайзис, Лтд**

**Кресло-туалет  
АМСВ6807**



**Руководство пользователя**



**Амрус Энтерпрайзис, Лтд**

## ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Соберите кресло-туалет, как показано на рисунке на обложке. Отрегулируйте выдвижающиеся опоры, чтобы получить желаемую высоту кресла-туалета. Убедитесь, что все резьбовые соединения надежно закреплены, а ювелирные фиксаторы на нижних частях опор закреплены и зафиксированы (см. рисунок на обложке).

## ПЕРЕХОД ОТ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ К КРЕСЛУ-ТУАЛЕТУ

Убедитесь, что колеса инвалидного кресла-коляски заторможены.

Поднимитесь, опираясь на поручни коляски.

Перенесите руку на поручень кресла-туалета.

Если у Вас поразившая нижняя конечность, то сначала перенесите руку, противоположную пораженной стороне.

Повернитесь и сядьте на сиденье кресла-туалета

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохраняйте кресло-туалет от ударов и повреждений.

Не допускайте прикосновения кресла-туалета к электрическим проводам.

Вовремя заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки кресла – туалета пользуйтесь водой и нейтральным моющим средством, затем вытрите его сухой тканью.

Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства

Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

## ХРАНИЕНИЕ

Храните кресло-туалет после использования в сухом и чистом месте.

Не подвержайте кресло-туалет воздействию высокой температуры, влажности и пыли. Оберегайте кресло-туалет от воздействия прямых солнечных лучей.

Храните кресло-туалет при температуре от -20°C до +60 °C.

## ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Соберите кресло-туалет, как показано на рисунке на обложке. Отрегулируйте выдвижающиеся опоры, чтобы получить желаемую высоту кресла-туалета.

Убедитесь, что все резьбовые соединения надежно закреплены, а ювелирные фиксаторы на нижних частях опор закреплены и зафиксированы (см. рисунок на обложке).

## ПЕРЕХОД ОТ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ К КРЕСЛУ-ТУАЛЕТУ

Убедитесь, что колеса инвалидного кресла-коляски заторможены.

Поднимитесь, опираясь на поручни коляски.

Перенесите руку на поручень кресла-туалета.

Если у Вас поразившая нижняя конечность, то сначала перенесите руку, противоположную пораженной стороне.

Повернитесь и сядьте на сиденье кресла-туалета

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохраняйте кресло-туалет от ударов и повреждений.

Не допускайте прикосновения кресла-туалета к электрическим проводам.

Вовремя заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки кресла – туалета пользуйтесь водой и нейтральным моющим средством, затем вытрите его сухой тканью.

Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства

Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

## ХРАНИЕНИЕ

Храните кресло-туалет после использования в сухом и чистом месте.

Не подвержайте кресло-туалет воздействию высокой температуры, влажности и пыли. Оберегайте кресло-туалет от воздействия прямых солнечных лучей.

Условия хранения: кресло-туалет при температуре от -20°C до +60 °C.

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
2. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
3. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты поставки кресла-туалета в торгующую организацию плюс 1 месяц.
4. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона.
5. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
6. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:
  - удара;
  - механического воздействия;
  - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
  - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

## ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:

- отметку о дате поставки в торгующую организацию фирмой "Моск-Аэрос"
  - отметку о дате продажи кресла-туалета
- Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока. При возникновении неисправности обращайтесь в гарантийную мастерскую, указанную торгующей организацией.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для региона Москвы и Московской области:

ул. Матросская тишина, д. 23, стр.2,  
во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.

Проезд: метро "Сокольники",

длина трамвай 7, автобус 266, 716, троллейбус 14, 32, 41.

До остановки "Дело им. Русакова, Академия приборостроения". При отсутствии в Вашем городе гарантийной мастерской обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107986, вл 11.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:

[www.mos-aeros.ru](http://www.mos-aeros.ru)

E-mail: [mos\\_aeros@mail.ru](mailto:mos_aeros@mail.ru)

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

7. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
8. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
9. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты поставки кресла-туалета в торгующую организацию плюс 1 месяц.
10. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона.
11. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
12. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:
  - удара;
  - механического воздействия;
  - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
  - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

## ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:

- отметку о дате поставки в торгующую организацию фирмой "Моск-Аэрос"
  - отметку о дате продажи кресла-туалета
- Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока. При возникновении неисправности обращайтесь в гарантийную мастерскую, указанную торгующей организацией.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для региона Москвы и Московской области:

ул. Матросская тишина, д. 23, стр.2,  
во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.

Проезд: метро "Сокольники",

длина трамвай 7, автобус 266, 716, троллейбус 14, 32, 41.

До остановки "Дело им. Русакова, Академия приборостроения". При отсутствии в Вашем городе гарантийной мастерской обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107986, вл 11.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:

[www.mos-aeros.ru](http://www.mos-aeros.ru)

E-mail: [mos\\_aeros@mail.ru](mailto:mos_aeros@mail.ru)

**Кресло-туалет  
модель АМСВ6808**



Изготовитель: Амрус Энтерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprises, Ltd.  
Импортер: ЗАО фирма «Москва-Амрус»,  
РФ, Москва, 107996, а/я 11  
Сертификат соответствия:  
РОСС US. IM25.  
Регистрационное удостоверение

Гигиеническое заключение

Соответствует ГОСТ Р 50444-92 (р.3,4).  
ГОСТ Р 51632-2000  
Срок службы не менее 10 лет

Печать  
торгующей организации

Печать  
ЗАО фирмы «Москва-Амрус»

Дата продажи  
Торгующей организацией

Дата поставки в  
Торговую организацию


Претензий к внешнему виду не имею.  
С условиями действия гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

**Кресло-туалет  
АМСВ6808**



**Руководство пользователя**

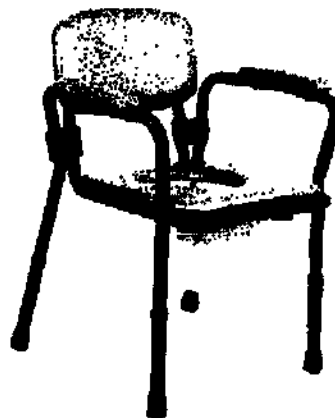

**Амрус Энтерпрайзис, Лтд**

**Кресло-туалет  
модель АМСВ6808**



Изготовитель: Амрус Энтерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprises, Ltd.  
Импортер: ЗАО фирма «Москва-Амрус»,  
РФ, Москва, 107996, а/я 11  
Сертификат соответствия:  
РОСС US. IM25.  
Регистрационное удостоверение

Гигиеническое заключение

Соответствует ГОСТ Р 50444-92 (р.3,4).  
ГОСТ Р 51632-2000  
Срок службы не менее 10 лет

Печать  
торгующей организации

Печать  
ЗАО фирмы «Москва-Амрус»

Дата продажи  
Торгующей организацией

Дата поставки в  
Торговую организацию


Претензий к внешнему виду не имею.  
С условиями действия гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

**Кресло-туалет  
АМСВ6808**



**Руководство пользователя**

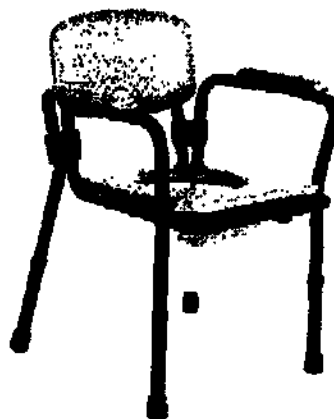

**Амрус Энтерпрайзис, Лтд**

## ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Соберите кресло-туалет, как показано на рисунке на обложке. Отрегулируйте выдвижающиеся опоры, чтобы получить желаемую высоту кресла-туалета. Убедитесь, что все резьбовые соединения надежно закреплены, а кнопки фиксаторов на нижних частях опор закреплены и зафиксированы (см. рисунок на обложке).

## ПЕРЕХОД ОТ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ К КРЕСЛУ-ТУАЛЕТУ

Убедитесь, что колеса инвалидного кресла-коляски заторможены. Поднимитесь, опираясь на поручни коляски. Перенесите руку на поручень кресла-туалета. Если у Вас порожена нижняя конечность, то сначала перенесите руку, противоположную пораженной стороне. Повернитесь и сядьте на сиденье кресла-туалета.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохраняйте кресло-туалет от ударов и повреждений. Не допускайте прикосновения кресла-туалета к электрическим проводам. Всегда заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки кресла – туалета пользуйтесь водой и нейтральным моющим средством, затем вытрите его сухой тканью. Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства. Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

## ХРАНЕНИЕ

Храните кресло-туалет после использования в сухом и чистом месте. Не подвергайте кресло-туалет воздействию высокой температуры, влажности и пыли. Оберегайте кресло-туалет от воздействия прямых солнечных лучей. Храните кресло-туалет при температуре от -20°C до +60°C.

## ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Соберите кресло-туалет, как показано на рисунке на обложке. Отрегулируйте выдвижающиеся опоры, чтобы получить желаемую высоту кресла-туалета. Убедитесь, что все резьбовые соединения надежно закреплены, а кнопки фиксаторов на нижних частях опор закреплены и зафиксированы (см. рисунок на обложке).

## ПЕРЕХОД ОТ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ К КРЕСЛУ-ТУАЛЕТУ

Убедитесь, что колеса инвалидного кресла-коляски заторможены. Поднимитесь, опираясь на поручни коляски. Перенесите руку на поручень кресла-туалета. Если у Вас порожена нижняя конечность, то сначала перенесите руку, противоположную пораженной стороне. Повернитесь и сядьте на сиденье кресла-туалета.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохраняйте кресло-туалет от ударов и повреждений. Не допускайте прикосновения кресла-туалета к электрическим проводам. Всегда заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки кресла – туалета пользуйтесь водой и нейтральным моющим средством, затем вытрите его сухой тканью. Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства. Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

## ХРАНЕНИЕ

Храните кресло-туалет после использования в сухом и чистом месте. Не подвергайте кресло-туалет воздействию высокой температуры, влажности и пыли. Оберегайте кресло-туалет от воздействия прямых солнечных лучей. Храните кресло-туалет при температуре от -20°C до +60°C.

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
2. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
3. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты поставки кресла-туалета в торгующую организацию плюс 1 месяц.
4. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона.
5. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
6. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:
  - удара;
  - механического воздействия;
  - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
  - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

## ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:

- отметку о дате поставки в торгующую организацию фирмой "Москва-Амрос"
- отметку о дате продажи кресла-туалета

Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока. При возникновении неисправности обращайтесь в гарантийную мастерскую, указанную торгующей организацией.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для региона Москвы и Московской области:  
ул. Матросская тишина, д. 23, стр.2,  
во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.  
Проезд: метро "Сокольники",  
далее трамвай 7, автобус 266, 718, троллейбус 14, 32, 41.  
До остановки "Дело им. Русакова, Академия приборостроения".  
При отсутствии в Вашем городе гарантийной мастерской обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107996, а/я 11.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:  
[www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru) E-mail: [mos\\_amros@mtu-net.ru](mailto:mos_amros@mtu-net.ru)

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

7. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
8. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
9. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты поставки кресла-туалета в торгующую организацию плюс 1 месяц.
10. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона.
11. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
12. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:
  - удара;
  - механического воздействия;
  - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
  - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

## ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:

- отметку о дате поставки в торгующую организацию фирмой "Москва-Амрос"
- отметку о дате продажи кресла-туалета

Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока. При возникновении неисправности обращайтесь в гарантийную мастерскую, указанную торгующей организацией.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для региона Москвы и Московской области:  
ул. Матросская тишина, д. 23, стр.2,  
во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.  
Проезд: метро "Сокольники",  
далее трамвай 7, автобус 266, 718, троллейбус 14, 32, 41.  
До остановки "Дело им. Русакова, Академия приборостроения".  
При отсутствии в Вашем городе гарантийной мастерской обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107996, а/я 11.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:  
[www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru) E-mail: [mos\\_amros@mtu-net.ru](mailto:mos_amros@mtu-net.ru)

**Кресло-туалет  
модель АМСВ6809**



Изготовитель: Амрус Энтерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprises, Ltd.  
Импортер: ЗАО фирма «Москва-Амрус»,  
РФ, Москва, 107986, в/я 11  
Сертификат соответствия:  
РОСС US. IM25.  
Регистрационное удостоверение

Гигиеническое заключение

Соответствует ГОСТ Р 50444-02 (р.3,4).  
ГОСТ Р 51632-2000  
Срок службы не менее 10 лет

Печать  
торговой организации

Печать  
ЗАО фирма «Москва-Амрус»

Дата продажи  
Торговой организацией

Дата поставки в  
Торговую организацию

Претензий к внешнему виду не имею.  
С условиями действия гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

**Кресло-туалет  
модель АМСВ6809**



Изготовитель: Амрус Энтерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprises, Ltd.  
Импортер: ЗАО фирма «Москва-Амрус»,  
РФ, Москва, 107986, в/я 11  
Сертификат соответствия:  
РОСС US. IM25.  
Регистрационное удостоверение

Гигиеническое заключение

Соответствует ГОСТ Р 50444-02 (р.3,4).  
ГОСТ Р 51632-2000  
Срок службы не менее 10 лет

Печать  
торговой организации

Печать  
ЗАО фирма «Москва-Амрус»

Дата продажи  
Торговой организацией

Дата поставки в  
Торговую организацию

Претензий к внешнему виду не имею.  
С условиями действия гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

**Кресло-туалет  
АМСВ6809**



**Руководство пользователя**




**Амрус Энтерпрайзис, Лтд**

**Кресло-туалет  
АМСВ6809**



**Руководство пользователя**

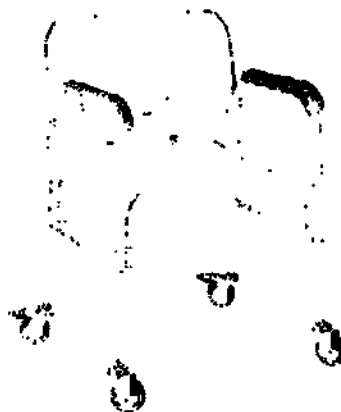

**Амрус Энтерпрайзис, Лтд**

## ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Соберите кресло-туалет, как показано на рисунке на обложке. Отрегулируйте выдвижающиеся опоры, чтобы получить желаемую высоту кресла-туалета. Убедитесь, что все резьбовые соединения надежно закреплены, а кнопки фиксаторов на нижних частях опор зафиксированы и зафиксированы (см. рисунок на обложке).

## ПЕРЕХОД ОТ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ К КРЕСЛУ-ТУАЛЕТУ

Убедитесь, что колеса инвалидного кресла-коляски заторможены. Поднимитесь, опираясь на поручни коляски. Перенесите руку на поручень кресла-туалета. Если у Вас поранена левая конечность, то сначала перенесите руку, противоположную пораненной стороне. Повернитесь и сядьте на сиденье кресла-туалета.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохраните кресло-туалет от ударов и повреждений. Не допускайте присоединения кресла-туалета к электрическим проводам. Всегда заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки кресла – туалета пользуйтесь водой и нейтральным моющим средством, затем вытрите его сухой тканью. Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства. Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

## ХРАНЕНИЕ

Храните кресло-туалет после использования в сухом и чистом месте. Не подвержайте кресло-туалет воздействию высокой температуры, влажности и пыли. Оберегайте кресло-туалет от воздействия прямых солнечных лучей. Храните кресло-туалет при температуре от -20°C до +60 °C.

## ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Соберите кресло-туалет, как показано на рисунке на обложке. Отрегулируйте выдвижающиеся опоры, чтобы получить желаемую высоту кресла-туалета. Убедитесь, что все резьбовые соединения надежно закреплены, а кнопки фиксаторов на нижних частях опор зафиксированы и зафиксированы (см. рисунок на обложке).

## ПЕРЕХОД ОТ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ К КРЕСЛУ-ТУАЛЕТУ

Убедитесь, что колеса инвалидного кресла-коляски заторможены. Поднимитесь, опираясь на поручни коляски. Перенесите руку на поручень кресла-туалета. Если у Вас поранена левая конечность, то сначала перенесите руку, противоположную пораненной стороне. Повернитесь и сядьте на сиденье кресла-туалета.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохраните кресло-туалет от ударов и повреждений. Не допускайте присоединения кресла-туалета к электрическим проводам. Всегда заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки кресла – туалета пользуйтесь водой и нейтральным моющим средством, затем вытрите его сухой тканью. Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства. Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

## ХРАНЕНИЕ

Храните кресло-туалет после использования в сухом и чистом месте. Не подвержайте кресло-туалет воздействию высокой температуры, влажности и пыли. Оберегайте кресло-туалет от воздействия прямых солнечных лучей. Храните кресло-туалет при температуре от -20°C до +60 °C.

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
2. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
3. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты поставки кресла-туалета в торговую организацию плюс 1 месяц.
4. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона.
5. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
6. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:
  - удара;
  - механического воздействия;
  - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
  - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

## ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:

- отметку о дате поставки в торговую организацию фирмой "Москва-Аэрос"
- отметку о дате продажи кресла-туалета

Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока. При возникновении неисправности обращайтесь в гарантийную мастерскую, указанную торговой организацией.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для региона Москвы и Московской области:  
ул. Матросская тишина, д. 23, стр.2,  
во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.  
Проезд: метро "Сокольники",  
далее трамвай 7, автобус 285, 716, троллейбус 14, 32, 41.  
До остановки "Дело им. Русанова, Академия приборостроения".  
При отсутствии в Вашем городе гарантийной мастерской обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107996, а/я 11.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:  
[www.mos-atmos.ru](http://www.mos-atmos.ru) E-mail: [mos\\_atmos@mtu-net.ru](mailto:mos_atmos@mtu-net.ru)

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

7. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
8. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
9. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты поставки кресла-туалета в торговую организацию плюс 1 месяц.
10. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона.
11. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
12. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:
  - удара;
  - механического воздействия;
  - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
  - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

## ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:

- отметку о дате поставки в торговую организацию фирмой "Москва-Аэрос"
- отметку о дате продажи кресла-туалета

Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока. При возникновении неисправности обращайтесь в гарантийную мастерскую, указанную торговой организацией.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для региона Москвы и Московской области:  
ул. Матросская тишина, д. 23, стр.2,  
во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.  
Проезд: метро "Сокольники",  
далее трамвай 7, автобус 285, 716, троллейбус 14, 32, 41.  
До остановки "Дело им. Русанова, Академия приборостроения".  
При отсутствии в Вашем городе гарантийной мастерской обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107996, а/я 11.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:  
[www.mos-atmos.ru](http://www.mos-atmos.ru) E-mail: [mos\\_atmos@mtu-net.ru](mailto:mos_atmos@mtu-net.ru)

**Приспособление для туалета  
модель AMSR6701**



Изготовитель: Амрус Энтерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprise, Ltd.  
Импортёр: ЗАО фирма «Москва-Амрос»,  
РФ, Москва, 107996, а/я 11

Сертификат соответствия:  
РОСС U.S. IM25.

Регистрационное удостоверение

Гигиеническое заключение

Соответствует ГОСТ Р 50444-92 (р.р.3,4).


Срок службы ГОСТ Р 51632-2000

не менее 5 лет

**Приспособление для туалета  
модель AMSR6701**



**Руководство пользователя**

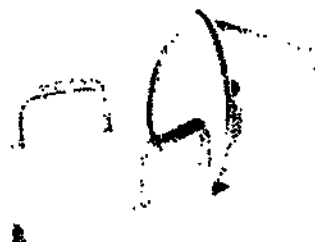

Печать  
торговой организации

Печать  
ЗАО фирмы «Москва-Амрос»

Дата продажи  
Торговой организацией

Дата поставки в  
Торговую организацию

Претензий к внешнему виду не имею.  
С условиями действия гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

**Амрус Энтерпрайзис, Лтд**

**Приспособление для туалета  
модель AMSR6701**



Изготовитель: Амрус Энтерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprise, Ltd.  
Импортёр: ЗАО фирма «Москва-Амрос»,  
РФ, Москва, 107996, а/я 11

Сертификат соответствия:  
РОСС U.S. IM25.

Регистрационное удостоверение

Гигиеническое заключение

Соответствует ГОСТ Р 50444-92 (р.р.3,4).


Срок службы ГОСТ Р 51632-2000

не менее 5 лет

**Приспособление для туалета  
модель AMSR6701**



**Руководство пользователя**

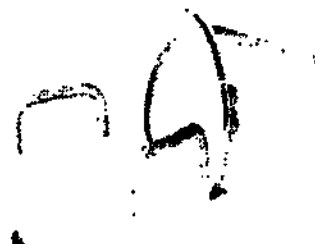

Печать  
торговой организации

Печать  
ЗАО фирмы «Москва-Амрос»

Дата продажи  
Торговой организацией

Дата поставки в  
Торговую организацию

Претензий к внешнему виду не имею.  
С условиями действия гарантии ознакомлен.

**Амрус Энтерпрайзис, Лтд**

## НАСАДКИ ДЛЯ УНИТАЗОВ

Насадки, увеличивающие высоту унитаза, обеспечивают безопасное и комфортное положение пациента. Поручни служат дополнительной опорой для ослабленных пациентов.

Для изготовления применяется прочная, легко моющаяся пластмасса.

Насадка на унитаз с поручнями AMSR6701 обеспечивает комфорт и безопасность при использовании туалета пациентом. Поручни обеспечивают боковую поддержку ослабленным пациентам. Регулируемые крепления обеспечивают фиксацию насадки на унитазе любой формы. Высота насадки – 17,8 см.

Характеризуется малым весом, простотой крепления и перевода в рабочее положение.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки насадки пользуйтесь водой и нейтральным моющим средством, затем вытрите их сухой тканью. Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства. Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

### ХРАНЕНИЕ

Храните насадки после использования в сухом и чистом месте. Не подвержайте насадки воздействию высокой температуры, влажности и пыли. Оберегайте насадки от воздействия прямых солнечных лучей. Храните насадки при температуре от -20°C до +60 °C.

## НАСАДКИ ДЛЯ УНИТАЗОВ

Насадки, увеличивающие высоту унитаза, обеспечивают безопасное и комфортное положение пациента. Поручни служат дополнительной опорой для ослабленных пациентов.

Для изготовления применяется прочная, легко моющаяся пластмасса.

Насадка на унитаз с поручнями AMSR6701 обеспечивает комфорт и безопасность при использовании туалета пациентом. Поручни обеспечивают боковую поддержку ослабленным пациентам. Регулируемые крепления обеспечивают фиксацию насадки на унитазе любой формы. Высота насадки – 17,8 см.

Характеризуется малым весом, простотой крепления и перевода в рабочее положение.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки насадки пользуйтесь водой и нейтральным моющим средством, затем вытрите их сухой тканью. Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства. Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

### ХРАНЕНИЕ

Храните насадки после использования в сухом и чистом месте. Не подвержайте насадки воздействию высокой температуры, влажности и пыли. Оберегайте насадки от воздействия прямых солнечных лучей. Храните насадки при температуре от -20°C до +60 °C.

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
2. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
3. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты поставки кресла-туалета в торговую организацию плюс 1 месяц.
4. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона.
5. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
6. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:
  - удара;
  - механического воздействия;
  - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
  - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

## ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:

- отметку для поставки в торговую организацию фирмой "Москва-Амрос"
  - отметку о дате продажи кресла-туалета
- Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока. При возникновении неисправности обращайтесь в гарантийную мастерскую, указанную торговой организацией.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для региона Москвы и Московской области:

ул. Матросская тишина, д. 23, стр.2,  
во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.

Проезд: метро "Сокольники",  
далее трамвай 7, автобус 266, 716, троллейбус 14, 32, 41.

До остановки "Дело им. Русакова, Академия приборостроения".  
При отсутствии в Вашем городе гарантийной мастерской обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107996, а/л 11.  
Дополнительную информацию можно получить по адресу:  
[www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru) E-mail: [mos\\_amros@mtu-net.ru](mailto:mos_amros@mtu-net.ru)

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

7. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
8. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
9. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты поставки кресла-туалета в торговую организацию плюс 1 месяц.
10. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона.
11. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
12. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:
  - удара;
  - механического воздействия;
  - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
  - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

## ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:

- отметку для поставки в торговую организацию фирмой "Москва-Амрос"
  - отметку о дате продажи кресла-туалета
- Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока. При возникновении неисправности обращайтесь в гарантийную мастерскую, указанную торговой организацией.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для региона Москвы и Московской области:

ул. Матросская тишина, д. 23, стр.2,  
во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.

Проезд: метро "Сокольники",  
далее трамвай 7, автобус 266, 716, троллейбус 14, 32, 41.

До остановки "Дело им. Русакова, Академия приборостроения".  
При отсутствии в Вашем городе гарантийной мастерской обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107996, а/л 11.  
Дополнительную информацию можно получить по адресу:  
[www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru) E-mail: [mos\\_amros@mtu-net.ru](mailto:mos_amros@mtu-net.ru)

**Приспособление для туалета  
модель AMSR6702**



**Изготовитель:** Амрус Энтерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprises, Ltd.  
**Импортёр:** ЗАО фирма «Москва-Амрос»,  
РФ, Москва, 107996, а/я 11

**Сертификат соответствия:**  
РОСС US. IM25.

**Регистрационное удостоверение**

**Гигиеническое заключение**

**Соответствует** ГОСТ Р 50444-92 (п.р.3,4).

ГОСТ Р 51632-2000

**Срок службы** не менее 5 лет

Печать  
торговой организации

Печать  
ЗАО фирмы "Москва-Амрос"

Дата продажи  
Торговой организацией

Дата поставки в  
Торговую организацию


**Претензий к внешнему виду не имею.**  
**С условиями действия гарантии ознакомлен.**

Подпись покупателя

**Приспособление для туалета  
модель AMSR6702**



**Руководство пользователя**



**Амрус Энтерпрайзис, Лтд**

**Приспособление для туалета  
модель AMSR6702**



**Изготовитель:** Амрус Энтерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprises, Ltd.  
**Импортёр:** ЗАО фирма «Москва-Амрос»,  
РФ, Москва, 107996, а/я 11

**Сертификат соответствия:**  
РОСС US. IM25.

**Регистрационное удостоверение**

**Гигиеническое заключение**

**Соответствует** ГОСТ Р 50444-92 (п.р.3,4).

ГОСТ Р 51632-2000

**Срок службы** не менее 5 лет

Печать  
торговой организации

Печать  
ЗАО фирмы "Москва-Амрос"

Дата продажи  
Торговой организацией

Дата поставки в  
Торговую организацию

**Претензий к внешнему виду не имею.**  
**С условиями действия гарантии ознакомлен.**

**Приспособление для туалета  
модель AMSR6702**



**Руководство пользователя**



**Амрус Энтерпрайзис, Лтд**

## НАСАДКИ ДЛЯ УНИТАЗОВ

Насадки, увеличивающие высоту унитаза, обеспечивают безопасное и комфортное положение пациента. Поручни служат дополнительной опорой для ослабленных пациентов.

Для изготовления применяется прочная, легко моющаяся пластика.

Насадка на унитаз AMSR5702 обеспечивает комфорт и безопасность при использовании туалета пациента. Регулируемые крепления обеспечивают фиксацию насадки на унитазе любой формы. Высота насадки – 17,8 см.

Характеризуется малым весом, простотой крепления и перевода в рабочее положение.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки насадки пользуйтесь водой и нейтральным моющим средством, затем вытрите их сухой тканью. Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства. Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

### ХРАНЕНИЕ

Храните насадки после использования в сухом и чистом месте. Не подвержайте насадки воздействию высокой температуры, влажности и пыли. Оберегайте насадки от воздействия прямых солнечных лучей. Храните насадки при температуре от -20°C до +60 °C.

## НАСАДКИ ДЛЯ УНИТАЗОВ

Насадки, увеличивающие высоту унитаза, обеспечивают безопасное и комфортное положение пациента. Поручни служат дополнительной опорой для ослабленных пациентов.

Для изготовления применяется прочная, легко моющаяся пластика.

Насадка на унитаз AMSR5702 обеспечивает комфорт и безопасность при использовании туалета пациента. Регулируемые крепления обеспечивают фиксацию насадки на унитазе любой формы. Высота насадки – 17,8 см.

Характеризуется малым весом, простотой крепления и перевода в рабочее положение.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки насадки пользуйтесь водой и нейтральным моющим средством, затем вытрите их сухой тканью. Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства. Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

### ХРАНЕНИЕ

Храните насадки после использования в сухом и чистом месте. Не подвержайте насадки воздействию высокой температуры, влажности и пыли. Оберегайте насадки от воздействия прямых солнечных лучей. Храните насадки при температуре от -20°C до +60 °C.

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
2. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
3. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты поставки кресла-туалета в торгующую организацию плюс 1 месяц.
4. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона.
5. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
6. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:
  - удара;
  - механического воздействия;
  - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
  - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

### ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:

- отпечаток дна поставки в торгующую организацию фирмой "Москва-Амрос"
  - отметку о дате продажи кресла-туалета
- Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока. При возникновении неисправности обращайтесь в гарантийную мастерскую, указанную торгующей организацией.

### АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для региона Москвы и Московской области:

ул. Матросская тишина, д. 23, стр.2,  
во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.

Проезд: метро "Сокольники",

далее трамвай 7, автобус 265, 716, троллейбус 14, 32, 41.

До остановки "Дело им. Русакова, Академия приборостроения".

При отсутствии в Вашем городе гарантийной мастерской

обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107996, а/я 11.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:

[www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru)

E-mail: [mos\\_amros@mtu-net.ru](mailto:mos_amros@mtu-net.ru)

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

7. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
8. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
9. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты поставки кресла-туалета в торгующую организацию плюс 1 месяц.
10. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона.
11. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
12. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:
  - удара;
  - механического воздействия;
  - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
  - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

### ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:

- отпечаток дна поставки в торгующую организацию фирмой "Москва-Амрос"
  - отметку о дате продажи кресла-туалета
- Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока. При возникновении неисправности обращайтесь в гарантийную мастерскую, указанную торгующей организацией.

### АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для региона Москвы и Московской области:

ул. Матросская тишина, д. 23, стр.2,  
во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.

Проезд: метро "Сокольники",

далее трамвай 7, автобус 265, 716, троллейбус 14, 32, 41.

До остановки "Дело им. Русакова, Академия приборостроения".

При отсутствии в Вашем городе гарантийной мастерской

обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107996, а/я 11.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:

[www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru)

E-mail: [mos\\_amros@mtu-net.ru](mailto:mos_amros@mtu-net.ru)

**Приспособление для туалета  
модель AMSR6703**



**Изготовитель:** Амрус Энтерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprises, Ltd.  
**Импортёр:** ЗАО фирма «Москва-Амрус»,  
РФ, Москва, 107996, в/л 11  
**Сертификат соответствия:**  
РОСС УС. ИМ25.  
**Регистрационное удостоверение**

**Гигиеническое заключение**

**Соответствует** ГОСТ Р 50444-92 (р.р.3,4).  
ГОСТ Р 51632-2000  
**Срок службы** не менее 5 лет

Печать  
торгующей организации

Печать  
ЗАО фирма «Москва-Амрус»

Дата продажи  
Торгующей организацией

Дата поставки в  
Торгующую организацию


Претензий к внешнему виду не имею.  
С условиями действия гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

**Приспособление для туалета  
модель AMSR6703**



**Руководство пользователя**



**Амрус Энтерпрайзис, Лтд**

**Приспособление для туалета  
модель AMSR6703**



**Изготовитель:** Амрус Энтерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprises, Ltd.  
**Импортёр:** ЗАО фирма «Москва-Амрус»,  
РФ, Москва, 107996, в/л 11  
**Сертификат соответствия:**  
РОСС УС. ИМ25.  
**Регистрационное удостоверение**

**Гигиеническое заключение**

**Соответствует** ГОСТ Р 50444-92 (р.р.3,4).  
ГОСТ Р 51632-2000  
**Срок службы** не менее 5 лет

Печать  
торгующей организации

Печать  
ЗАО фирма «Москва-Амрус»

Дата продажи  
Торгующей организацией

Дата поставки в  
Торгующую организацию


Претензий к внешнему виду не имею.  
С условиями действия гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

**Приспособление для туалета  
модель AMSR6703**



**Руководство пользователя**

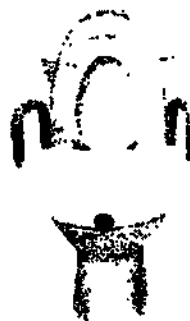

**Амрус Энтерпрайзис, Лтд**

## НАСАДКИ ДЛЯ УНИТАЗОВ

Насадки, увеличивающие высоту унитаза, обеспечивают безопасное и комфортное положение пациента. Поручни служат дополнительной опорой для ослабленных пациентов.

Для изготовления применяется прочная, легко моющаяся пластика.

Насадка на унитаз со съёмными поручнями AMSR6703 обеспечивает комфорт и безопасность при использовании туалета пациентом. Поручни обеспечивают боковую поддержку ослабленным пациентам. Регулируемые крепления обеспечивают фиксацию насадки на унитазе любой формы. Высота насадки – 17,8 см.

Характеризуется малым весом, простотой крепления и перевода в рабочее положение.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки насадки пользуйтесь водой и нейтральными моющими средствами, затем вытрите их сухой тканью.

Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства.

Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

## ХРАНЕНИЕ

Храните насадку после использования в сухом и чистом месте.

Не подвержайте насадку воздействию высокой температуры, влажности и пыли. Оберегайте насадку от воздействия прямых солнечных лучей.

Храните насадку при температуре от -20°C до +60°C.

## НАСАДКИ ДЛЯ УНИТАЗОВ

Насадки, увеличивающие высоту унитаза, обеспечивают безопасное и комфортное положение пациента.

Поручни служат дополнительной опорой для ослабленных пациентов.

Для изготовления применяется прочная, легко моющаяся пластика.

Насадка на унитаз со съёмными поручнями AMSR6703 обеспечивает комфорт и безопасность при использовании туалета пациентом. Поручни обеспечивают боковую поддержку ослабленным пациентам. Регулируемые крепления обеспечивают фиксацию насадки на унитазе любой формы. Высота насадки – 17,8 см.

Характеризуется малым весом, простотой крепления и перевода в рабочее положение.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки насадки пользуйтесь водой и нейтральными моющими средствами, затем вытрите их сухой тканью.

Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства.

Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

## ХРАНЕНИЕ

Храните насадку после использования в сухом и чистом месте.

Не подвержайте насадку воздействию высокой температуры, влажности и пыли. Оберегайте насадку от воздействия прямых солнечных лучей.

Храните насадку при температуре от -20°C до +60°C.

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
2. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
3. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты поставки кресла-туалета в торгующую организацию плюс 1 месяц.
4. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона.
5. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
6. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:
  - удара;
  - механического воздействия;
  - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
  - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

## ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:

- отметку о дате поставки в торгующую организацию фирмой "Москов-Аэрос"

- отметку о дате продажи кресла-туалета

Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока.

При возникновении неисправности обращайтесь в гарантийную мастерскую, указанную торгующей организацией.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для региона Москвы и Московской области:

ул. Матросская тишина, д. 23, стр.2,

во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.

Проезд: метро "Сокольники",

далее трамвай 7, автобус 265, 716, троллейбус 14, 32, 41.

До остановки "Дело им. Русакова, Академия приборостроения".

При отсутствии в Вашем городе гарантийной мастерской обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107906, а/я 11.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:

[www.mos-atmos.ru](http://www.mos-atmos.ru)

E-mail: [mos\\_atmos@mtu-net.ru](mailto:mos_atmos@mtu-net.ru)

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

7. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
8. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
9. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты поставки кресла-туалета в торгующую организацию плюс 1 месяц.
10. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона.
11. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
12. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:
  - удара;
  - механического воздействия;
  - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
  - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

## ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:

- отметку о дате поставки в торгующую организацию фирмой "Москов-Аэрос"

- отметку о дате продажи кресла-туалета

Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока.

При возникновении неисправности обращайтесь в гарантийную мастерскую, указанную торгующей организацией.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для региона Москвы и Московской области:

ул. Матросская тишина, д. 23, стр.2,

во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.

Проезд: метро "Сокольники",

далее трамвай 7, автобус 265, 716, троллейбус 14, 32, 41.

До остановки "Дело им. Русакова, Академия приборостроения".

При отсутствии в Вашем городе гарантийной мастерской обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107906, а/я 11.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:

[www.mos-atmos.ru](http://www.mos-atmos.ru)

E-mail: [mos\\_atmos@mtu-net.ru](mailto:mos_atmos@mtu-net.ru)

**Приспособление для туалета  
модель AMSR6720**



Изготовитель: Амрус Энтерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprises, Ltd.  
Импортёр: ЗАО фирма «Москва-Амрос»,  
РФ, Москва, 107996, в/я 11  
Сертификат соответствия:  
РОСС U.S. IM25.  
Регистрационное удостоверение

Гигиеническое заключение

Соответствует ГОСТ Р 50444-92 (р.3,4).  
ГОСТ Р 51632-2000  
Срок службы не менее 5 лет

Печать  
торгующей организации

Печать  
ЗАО фирмы "Москва-Амрос"

Дата продажи  
Торгующей организацией

Дата поставки в  
Торговую организацию

Претензий к внешнему виду не имеет.  
С условиями действия гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

**Приспособление для туалета  
модель AMSR6720**



**Руководство пользователя**



**Амрус Энтерпрайзис, Лтд**

**Приспособление для туалета  
модель AMSR6720**



Изготовитель: Амрус Энтерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprises, Ltd.  
Импортёр: ЗАО фирма «Москва-Амрос»,  
РФ, Москва, 107996, в/я 11  
Сертификат соответствия:  
РОСС U.S. IM25.  
Регистрационное удостоверение

Гигиеническое заключение

Соответствует ГОСТ Р 50444-92 (р.3,4).  
ГОСТ Р 51632-2000  
Срок службы не менее 5 лет

Печать  
торгующей организации

Печать  
ЗАО фирмы "Москва-Амрос"

Дата продажи  
Торгующей организацией

Дата поставки в  
Торговую организацию

Претензий к внешнему виду не имеет.  
С условиями действия гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

**Приспособление для туалета  
модель AMSR6720**



**Руководство пользователя**



**Амрус Энтерпрайзис, Лтд**

## НАСАДКИ ДЛЯ УНИТАЗОВ

Насадки, увеличивающие высоту унитаза, обеспечивают безопасное и комфортное положение пациента. Поручни служат дополнительной опорой для ослабленных пациентов.

Для изготовления применяется прочная, легкая моющаяся пластмасса.

Насадка на унитаз с удлиняющим цилиндром AMSR6720 предотвращает загрязнение стенок унитаза, обеспечивает комфорт и безопасность при использовании туалета пациентом.

Регулируемые крепления обеспечивают изменение высоты и угла установки насадки при фиксации на унитазе любой формы, что способствует снижению усилий и утомляемости пациента.

Крепления имеют защитное покрытие, исключющее повреждение хромированного унитаза.

Регулировка высоты насадки – 17,8 см.

Используемые материалы обеспечивают прочность и долговечность в использовании.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки насадки пользуйтесь водой и нейтральным моющим средством, затем вытрите их сухой тканью.

Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства.

Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

### ХРАНЕНИЕ

Храните насадку после использования в сухом и чистом месте.

Не подвергайте насадку воздействию высокой температуры, влажности и пыли. Оберегайте насадку от воздействия прямых солнечных лучей.

Храните насадку при температуре от -20°C до +60 °C.

## НАСАДКИ ДЛЯ УНИТАЗОВ

Насадки, увеличивающие высоту унитаза, обеспечивают безопасное и комфортное положение пациента.

Поручни служат дополнительной опорой для ослабленных пациентов.

Для изготовления применяется прочная, легкая моющаяся пластмасса.

Насадка на унитаз с удлиняющим цилиндром AMSR6720 предотвращает загрязнение стенок унитаза, обеспечивает комфорт и безопасность при использовании туалета пациентом.

Регулируемые крепления обеспечивают изменение высоты и угла установки насадки при фиксации на унитазе любой формы, что способствует снижению усилий и утомляемости пациента.

Крепления имеют защитное покрытие, исключющее повреждение хромированного унитаза.

Регулировка высоты насадки – 17,8 см.

Используемые материалы обеспечивают прочность и долговечность в использовании.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки насадки пользуйтесь водой и нейтральным моющим средством, затем вытрите их сухой тканью.

Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства.

Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

### ХРАНЕНИЕ

Храните насадку после использования в сухом и чистом месте.

Не подвергайте насадку воздействию высокой температуры, влажности и пыли. Оберегайте насадку от воздействия прямых солнечных лучей.

Храните насадку при температуре от -20°C до +60 °C.

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
2. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
3. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты поставки кресла-туалета в торговую организацию плюс 1 месяц.
4. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона.
5. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
6. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:

- удара;
- механического воздействия;
- несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
- пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

## ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:

- отметку о дате поставки в торговую организацию фирмой "Москва-Амрос"
  - отметку о дате продажи кресла-туалета
- Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока. При возникновении неисправности обращайтесь в гарантийную мастерскую, указанную торговой организацией.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для регионов Москвы и Московской области:

ул. Мятроская ташкина, д. 23, стр.2,  
во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.

Проезд: метро "Сокольники",

длина трамвая 7, автобус 285, 718, троллейбус 14, 32, 41.

До остановки "Дело им. Русакова, Академия приборостроения".

При отсутствии в Вашем городе гарантийной мастерской обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107996, а/я 11.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:

[www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru)

E-mail: [mos\\_amros@yandex.net](mailto:mos_amros@yandex.net)

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

7. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
8. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
9. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты поставки кресла-туалета в торговую организацию плюс 1 месяц.
10. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона.
11. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
12. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:

- удара;
- механического воздействия;
- несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
- пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

## ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:

- отметку о дате поставки в торговую организацию фирмой "Москва-Амрос"
  - отметку о дате продажи кресла-туалета
- Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока. При возникновении неисправности обращайтесь в гарантийную мастерскую, указанную торговой организацией.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для регионов Москвы и Московской области:

ул. Мятроская ташкина, д. 23, стр.2,  
во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.

Проезд: метро "Сокольники",

длина трамвая 7, автобус 285, 718, троллейбус 14, 32, 41.

До остановки "Дело им. Русакова, Академия приборостроения".

При отсутствии в Вашем городе гарантийной мастерской обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107996, а/я 11.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:

[www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru)

E-mail: [mos\\_amros@yandex.net](mailto:mos_amros@yandex.net)

Приспособления для туалета  
модели AMSR6702 AMSR6702 AMSR6702



Изготовитель: Амрус Энтерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprises, Ltd.  
Импортёр: ЗАО фирма «Москва-Амрос»,  
РФ, Москва, 107998, в/л 11  
Сертификат соответствия:  
РОСС U.S. ИМ25.  
Регистрационное удостоверение

Гигиеническое заключение

Соответствует ГОСТ Р 50444-92 (р.р.3,4).  
ГОСТ Р 51632-2000  
Срок службы не менее 5 лет

Печать  
торговой организации

Печать  
ЗАО фирмы "Москва-Амрос"

Дата продажи  
Торговой организацией

Дата поставки в  
Торговую организацию

Претензий к внешнему виду не имею.  
С условиями действия гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

Приспособления для туалета  
модели AMSR6721 AMSR6722 AMSR6729



Руководство пользователя

Приспособления для туалета  
модели AMSR6721 AMSR6722 AMSR6729



Руководство пользователя

Приспособления для туалета  
модели AMSR6702 AMSR6702 AMSR6702



Изготовитель: Амрус Энтерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprises, Ltd.  
Импортёр: ЗАО фирма «Москва-Амрос»,  
РФ, Москва, 107998, в/л 11  
Сертификат соответствия:  
РОСС U.S. ИМ25.  
Регистрационное удостоверение

Гигиеническое заключение

Соответствует ГОСТ Р 50444-92 (р.р.3,4).  
ГОСТ Р 51632-2000  
Срок службы не менее 5 лет

Печать  
торговой организации

Печать  
ЗАО фирмы "Москва-Амрос"

Дата продажи  
Торговой организацией

Дата поставки в  
Торговую организацию

Претензий к внешнему виду не имею.  
С условиями действия гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

Амрус Энтерпрайзис, Лтд

## НАСАДКИ ДЛЯ УНИТАЗОВ

Насадки, увеличивающие высоту унитаза, обеспечивают безопасное и комфортное положение пациента. Поручни служат дополнительной опорой для ослабленных пациентов.

Для изготовления применяется прочная, легкая моющаяся пластмасса.

Насадки на унитаз AMSR5721, AMSR5722, AMSR5729 обеспечивают удобство при использовании туалета пациентами. Крышка позволяет использовать насадку как независимое изделие. Регулируемые крепления обеспечивают фиксацию насадок на унитазах любой формы. Форма насадок позволяет применять вкладыш-биде AMSR2520. Высота насадок AMSR5721 – 10 см, AMSR5722 – 15 см, AMSR5729 – 7,5 см.

Характеризуются малым весом, простотой крепления и перевода в рабочее положение.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки насадок пользуйтесь водой и нейтральным моющим средством, затем вытрите их сухой тканью. Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства. Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

### ХРАНЕНИЕ

Храните насадки после использования в сухом и чистом месте. Не подвержайте насадки воздействию высокой температуры, влажности и пыли. Оберегайте насадки от воздействия прямых солнечных лучей. Храните насадки при температуре от -20°C до +60°C.

## НАСАДКИ ДЛЯ УНИТАЗОВ

Насадки, увеличивающие высоту унитаза, обеспечивают безопасное и комфортное положение пациента. Поручни служат дополнительной опорой для ослабленных пациентов.

Для изготовления применяется прочная, легкая моющаяся пластмасса.

Насадка на унитаз AMSR5702 обеспечивает комфорт и безопасность при использовании туалета пациентами. Регулируемые крепления обеспечивают фиксацию насадок на унитазах любой формы. Высота насадки – 17,8 см.

Характеризуется малым весом, простотой крепления и перевода в рабочее положение.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки насадок пользуйтесь водой и нейтральным моющим средством, затем вытрите их сухой тканью. Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства. Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

### ХРАНЕНИЕ

Храните насадки после использования в сухом и чистом месте. Не подвержайте насадки воздействию высокой температуры, влажности и пыли. Оберегайте насадки от воздействия прямых солнечных лучей. Храните насадки при температуре от -20°C до +60°C.

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
2. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
3. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты поставки кресла-туалета в торговую организацию плюс 1 месяц.
4. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона.
5. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
6. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:
  - удара;
  - механического воздействия;
  - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
  - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

## ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:

- отметку о дате поставки в торговую организацию фирмой "Москва-Амрос"
  - отметку о дате продажи кресла-туалета
- Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока. При возникновении неисправности обращайтесь в гарантийную мастерскую, указанную торговой организацией.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для региона Москвы и Московской области:

ул. Матросская тишина, д. 23, стр.2,  
во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.

Проезд: метро "Сокольники",

далее трамвай 7, автобус 265, 716, троллейбус 14, 32, 41.

До остановки "Дело им. Русакова, Академия приборостроения". При отсутствии в Вашем городе гарантийной мастерской обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107996, а/я 11. Дополнительную информацию можно получить по адресу: [www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru) E-mail: [mos\\_amros@mtu-net.ru](mailto:mos_amros@mtu-net.ru)

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

7. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
8. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
9. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты поставки кресла-туалета в торговую организацию плюс 1 месяц.
10. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона.
11. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
12. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:
  - удара;
  - механического воздействия;
  - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
  - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

## ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:

- отметку о дате поставки в торговую организацию фирмой "Москва-Амрос"
  - отметку о дате продажи кресла-туалета
- Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока. При возникновении неисправности обращайтесь в гарантийную мастерскую, указанную торговой организацией.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для региона Москвы и Московской области:

ул. Матросская тишина, д. 23, стр.2,  
во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.

Проезд: метро "Сокольники",

далее трамвай 7, автобус 265, 716, троллейбус 14, 32, 41.

До остановки "Дело им. Русакова, Академия приборостроения". При отсутствии в Вашем городе гарантийной мастерской обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107996, а/я 11. Дополнительную информацию можно получить по адресу: [www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru) E-mail: [mos\\_amros@mtu-net.ru](mailto:mos_amros@mtu-net.ru)

**Приспособление для туалета  
модель AMSR6733**



Изготовитель: Амрус Энтерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprise, Ltd.  
Импортёр: ЗАО фирма «Москва-Амрус»,  
РФ, Москва, 107996, а/я 11  
Сертификат соответствия:  
РОСС US. IMZS.  
Регистрационное удостоверение

Гигиеническое заключение

Соответствует ГОСТ Р 50444-92 (р.р.3,4).  
ГОСТ Р 51632-2000  
Срок службы не менее 5 лет

Печать  
торговой организации

Печать  
ЗАО фирмы «Москва-Амрус»

Дата продажи  
Торговой организацией

Дата поставки в  
Торговую организацию

Претензий к внешнему виду не имею.  
С условиями действия гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

**Приспособление для туалета  
модель AMSR6733**



**Руководство пользователя**

**Приспособление для туалета  
модель AMSR6733**



Изготовитель: Амрус Энтерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprise, Ltd.  
Импортёр: ЗАО фирма «Москва-Амрус»,  
РФ, Москва, 107996, а/я 11  
Сертификат соответствия:  
РОСС US. IMZS.  
Регистрационное удостоверение

Гигиеническое заключение

Соответствует ГОСТ Р 50444-92 (р.р.3,4).  
ГОСТ Р 51632-2000  
Срок службы не менее 5 лет

Печать  
торговой организации

Печать  
ЗАО фирмы «Москва-Амрус»

Дата продажи  
Торговой организацией

Дата поставки в  
Торговую организацию

Претензий к внешнему виду не имею.  
С условиями действия гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

**Приспособление для туалета  
модель AMSR6733**



**Руководство пользователя**

## НАСАДКИ ДЛЯ УНИТАЗОВ

Насадки, увеличивающие высоту унитаза, обеспечивают безопасное и комфортное положение пациента. Поручни служат дополнительной опорой для ослабленных пациентов.

Для изготовления применяется прочная, легко моющаяся пластика.

Насадка на унитаз AMSR5733 обеспечивает комфорт и безопасность при использовании туалета пациентом. Регулируемые крепления обеспечивают фиксацию насадки на унитазе любой формы. Высота насадки – 17,8 см.

Характеризуется малым весом, простотой крепления и перевода в рабочее положение.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки насадки пользуйтесь водой и нейтральным моющим средством, затем вытрите их сухой тканью.

Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства.

Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

## ХРАНЕНИЕ

Храните насадки после использования в сухом и чистом месте. Не подвержайте насадки воздействию высокой температуры, влажности и пыли. Оберегайте насадки от воздействия прямых солнечных лучей.

Храните насадки при температуре от -20°C до +60 °C.

## НАСАДКИ ДЛЯ УНИТАЗОВ

Насадки, увеличивающие высоту унитаза, обеспечивают безопасное и комфортное положение пациента. Поручни служат дополнительной опорой для ослабленных пациентов.

Для изготовления применяется прочная, легко моющаяся пластика.

Насадка на унитаз AMSR5733 обеспечивает комфорт и безопасность при использовании туалета пациентом. Регулируемые крепления обеспечивают фиксацию насадки на унитазе любой формы. Высота насадки – 17,8 см.

Характеризуется малым весом, простотой крепления и перевода в рабочее положение.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки насадки пользуйтесь водой и нейтральным моющим средством, затем вытрите их сухой тканью.

Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства.

Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

## ХРАНЕНИЕ

Храните насадки после использования в сухом и чистом месте. Не подвержайте насадки воздействию высокой температуры, влажности и пыли. Оберегайте насадки от воздействия прямых солнечных лучей.

Храните насадки при температуре от -20°C до +60 °C.

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
2. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
3. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты поставки кресла-туалета в торгующую организацию плюс 1 месяц.
4. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона.
5. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
6. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:

- удара;
- механического воздействия;
- несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
- пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

## ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:

- отметку о дате поставки в торгующую организацию фирмой "Москва-Амрос"

- отметку о дате продажи кресла-туалета

Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока.

При возникновении неисправности обращайтесь в гарантийную мастерскую, указанную торгующей организацией.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для региона Москвы и Московской области:

ул. Матросская тишина, д. 23, стр.2,  
во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.

Проезд: метро "Сокольники",

далее трамвай 7, автобус 265, 716, троллейбус 14, 32, 41.

До остановки "Дело им. Русакова, Академия приборостроения". При отсутствии в Вашем городе гарантийной мастерской обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107996, в/п 11.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:

[www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru)

E-mail: [mos\\_amros@mtu-net.ru](mailto:mos_amros@mtu-net.ru)

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

7. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
8. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
9. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты поставки кресла-туалета в торгующую организацию плюс 1 месяц.
10. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона.
11. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
12. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:

- удара;
- механического воздействия;
- несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
- пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

## ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:

- отметку о дате поставки в торгующую организацию фирмой "Москва-Амрос"

- отметку о дате продажи кресла-туалета

Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока.

При возникновении неисправности обращайтесь в гарантийную мастерскую, указанную торгующей организацией.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для региона Москвы и Московской области:

ул. Матросская тишина, д. 23, стр.2,  
во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.

Проезд: метро "Сокольники",

далее трамвай 7, автобус 265, 716, троллейбус 14, 32, 41.

До остановки "Дело им. Русакова, Академия приборостроения". При отсутствии в Вашем городе гарантийной мастерской обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107996, в/п 11.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:

[www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru)

E-mail: [mos\\_amros@mtu-net.ru](mailto:mos_amros@mtu-net.ru)

**Приспособление для туалета  
модель AMSR2820**



Изготовитель: Амрус Энтерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprises, Ltd.  
Импортер: ЗАО фирма «Москва-Амрус»,  
РФ, Москва, 107996, а/я 11  
Сертификат соответствия:  
РОСС US. IM25.  
Регистрационное удостоверение

Гигиеническое заключение

Соответствует ГОСТ Р 50444-92 (р.р.3,4).  
ГОСТ Р 51632-2000  
Срок службы не менее 5 лет

Печать  
торговой организации

Печать  
ЗАО фирмы "Москва-Амрус"

Дата продажи  
Торговой организацией

Дата поставки в  
Торговую организацию

Претензий к внешнему виду не имею.  
С условиями действия гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

**Приспособление для туалета  
модель AMSR2820**



**Руководство пользователя**

**Приспособление для туалета  
модель AMSR2820**



Изготовитель: Амрус Энтерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprises, Ltd.  
Импортер: ЗАО фирма «Москва-Амрус»,  
РФ, Москва, 107996, а/я 11  
Сертификат соответствия:  
РОСС US. IM25.  
Регистрационное удостоверение

Гигиеническое заключение

Соответствует ГОСТ Р 50444-92 (р.р.3,4).  
ГОСТ Р 51632-2000  
Срок службы не менее 5 лет

Печать  
торговой организации

Печать  
ЗАО фирмы "Москва-Амрус"

Дата продажи  
Торговой организацией

Дата поставки в  
Торговую организацию

Претензий к внешнему виду не имею.  
С условиями действия гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

**Приспособление для туалета  
модель AMSR2820**



**Руководство пользователя**

## НАСАДКИ ДЛЯ УНИТАЗОВ

Для изготовления применяется прочная, легко моющаяся пластмасса.

Пластмассовый вкладыш-биде AMSR2820, совместимый с насадками моделей AMSR6701, AMSR6702, AMSR6703, AMSR6721, AMSR6722, AMSR6729.

Перед использованием промыть теплой водой, после применения опорожнить и промыть.

Не допускайте появления осадка.

Характеризуется малым весом, простотой крепления и перевода в рабочее положение.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки насадки пользуйтесь водой и нейтральным моющим средством, затем вытрите их сухой тканью. Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства. Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

## ХРАНЕНИЕ

Храните насадки после использования в сухом и чистом месте. Не подвержайте насадки воздействию высокой температуры, влажности и пыли. Оберегайте насадки от воздействия прямых солнечных лучей. Храните насадки при температуре от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ .

## НАСАДКИ ДЛЯ УНИТАЗОВ

Для изготовления применяется прочная, легко моющаяся пластмасса.

Пластмассовый вкладыш-биде AMSR2820, совместимый с насадками моделей AMSR6701, AMSR6702, AMSR6703, AMSR6721, AMSR6722, AMSR6729.

Перед использованием промыть теплой водой, после применения опорожнить и промыть.

Не допускайте появления осадка.

Характеризуется малым весом, простотой крепления и перевода в рабочее положение.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки насадки пользуйтесь водой и нейтральным моющим средством, затем вытрите их сухой тканью. Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства. Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

## ХРАНЕНИЕ

Храните насадки после использования в сухом и чистом месте. Не подвержайте насадки воздействию высокой температуры, влажности и пыли. Оберегайте насадки от воздействия прямых солнечных лучей. Храните насадки при температуре от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ .

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
2. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
3. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты поставки кресла-туалета в торгующую организацию плюс 1 месяц.
4. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона.
5. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
6. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:
  - удара;
  - механического воздействия;
  - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
  - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

## ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:

- отметку о дате поставки в торгующую организацию фирмой "Москва-Апос"
  - отметку о дате продажи кресла-туалета
- Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока. При возникновении неисправности обращайтесь в гарантийную мастерскую, указанную торгующей организацией.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для региона Москвы и Московской области:

ул. Матросская тишина, д. 23, стр.2,  
во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.

Проезд: метро "Сокольники",

далее трамвай 7, автобус 285, 716, троллейбус 14, 32, 41.

До остановки "Дело им. Русакова, Академия приборостроения". При отсутствии в Вашем городе гарантийной мастерской обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107986, в/п 11. Дополнительную информацию можно получить по адресу: [www.mos-apos.ru](http://www.mos-apos.ru) E-mail: [mos\\_apos@mtu-net.ru](mailto:mos_apos@mtu-net.ru)

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

7. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
8. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
9. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты поставки кресла-туалета в торгующую организацию плюс 1 месяц.
10. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона.
11. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
12. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:
  - удара;
  - механического воздействия;
  - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
  - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

## ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:

- отметку о дате поставки в торгующую организацию фирмой "Москва-Апос"
  - отметку о дате продажи кресла-туалета
- Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока. При возникновении неисправности обращайтесь в гарантийную мастерскую, указанную торгующей организацией.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для региона Москвы и Московской области:

ул. Матросская тишина, д. 23, стр.2,  
во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.

Проезд: метро "Сокольники",

далее трамвай 7, автобус 285, 716, троллейбус 14, 32, 41.

До остановки "Дело им. Русакова, Академия приборостроения". При отсутствии в Вашем городе гарантийной мастерской обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107986, в/п 11. Дополнительную информацию можно получить по адресу: [www.mos-apos.ru](http://www.mos-apos.ru) E-mail: [mos\\_apos@mtu-net.ru](mailto:mos_apos@mtu-net.ru)

**Приспособление для туалета  
модель AMSR2822**



**Изготовитель:** Амрус Энтерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprises, Ltd.  
**Импортер:** ЗАО фирма «Москва-Амрос»,  
РФ, Москва, 107995, а/я 11  
**Сертификат соответствия:**  
РОСС US. IM25.  
**Регистрационное удостоверение**

**Гигиеническое заключение**

**Соответствует** ГОСТ Р 50444-92 (р.р.3,4).  
ГОСТ Р 51632-2000  
**Срок службы** не менее 5 лет

Печать  
торгующей организации

Печать  
ЗАО фирма «Москва-Амрос»

Дата продажи  
Торгующей организацией

Дата поставки в  
Торгующую организацию

Претензий к внешнему виду не имеет.  
С условиями действия гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

**Приспособление для туалета  
модель AMSR2822**



**Руководство пользователя**



**Амрус Энтерпрайзис, Лтд**

**Приспособление для туалета  
модель AMSR2822**



**Изготовитель:** Амрус Энтерпрайзис Лтд., США  
Amrus Enterprises, Ltd.  
**Импортер:** ЗАО фирма «Москва-Амрос»,  
РФ, Москва, 107995, а/я 11  
**Сертификат соответствия:**  
РОСС US. IM25.  
**Регистрационное удостоверение**

**Гигиеническое заключение**

**Соответствует** ГОСТ Р 50444-92 (р.р.3,4).  
ГОСТ Р 51632-2000  
**Срок службы** не менее 5 лет

Печать  
торгующей организации

Печать  
ЗАО фирма «Москва-Амрос»

Дата продажи  
Торгующей организацией

Дата поставки в  
Торгующую организацию

Претензий к внешнему виду не имеет.  
С условиями действия гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

**Приспособление для туалета  
модель AMSR2822**



**Руководство пользователя**



**Амрус Энтерпрайзис, Лтд**

## НАСАДКИ ДЛЯ УНИТАЗОВ

Для изготовления применяется прочная, легкая  
моющаяся пластмасса.

Пластмассовый кроватный вкладыш AMSR2822-  
женский мочесборник.  
Материал корпуса — полипропилен.

Перед использованием промыть теплой водой, после  
применения опорожнить и промыть.

Не допускайте появления осадка.

Характеризуется малым весом, простотой крепления и  
перевода в рабочее положение.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки насадки пользуйтесь водой и нейтральным моющим  
средством, затем вытрите их сухой тканью.  
Не применяйте растворители (ацет, ацетон и пр.) или любые  
сильные моющие средства.  
Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

## ХРАНЕНИЕ

Храните насадки после использования в сухом и чистом месте.  
Не подвергайте насадки воздействию высокой температуры,  
влажности и пыли. Оберегайте насадки от воздействия прямых  
солнечных лучей.  
Храните насадки при температуре от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ .

## НАСАДКИ ДЛЯ УНИТАЗОВ

Для изготовления применяется прочная, легкая  
моющаяся пластмасса.

Пластмассовый кроватный вкладыш AMSR2822-  
женский мочесборник.  
Материал корпуса — полипропилен.

Перед использованием промыть теплой водой, после  
применения опорожнить и промыть.

Не допускайте появления осадка.

Характеризуется малым весом, простотой крепления и  
перевода в рабочее положение.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки насадки пользуйтесь водой и нейтральным моющим  
средством, затем вытрите их сухой тканью.  
Не применяйте растворители (ацет, ацетон и пр.) или любые  
сильные моющие средства.  
Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

## ХРАНЕНИЕ

Храните насадки после использования в сухом и чистом месте.  
Не подвергайте насадки воздействию высокой температуры,  
влажности и пыли. Оберегайте насадки от воздействия прямых  
солнечных лучей.  
Храните насадки при температуре от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ .

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Срок действия гарантии — 12 месяцев с даты продажи.
2. Дата продажи отмечается продажей в гарантийном талоне.
3. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии  
исчисляется с даты поставки кресла-туалета в  
торгующую организацию плюс 1 месяц.
4. Гарантийное обслуживание производится только при  
наличии настоящего гарантийного талона.
5. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
6. Гарантия не распространяется на кресло-туалет,  
поврежденное вследствие:
  - удара;
  - механического воздействия;
  - несанкционированного ремонта или внесения изменений в  
конструкцию;
  - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

## ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:  
- отметку о дате поставки в торговую организацию фирмой "Москва-Апос"  
- отметку о дате продажи кресла-туалета  
Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение  
всего действия гарантийного срока.  
При возникновении неисправности обращайтесь в  
гарантийную мастерскую, указанную торгующей  
организацией.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для региона Москвы и Московской области:  
ул. Мятроская тishина, д. 23, стр.2,  
во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.  
Проезд: метро "Сокольники",  
далее трамвай 7, автобус 285, 716, троллейбус 14, 32, 41.  
До остановки "Дело им. Русакова, Академия приборостроения".  
При отсутствии в Вашем городе гарантийной мастерской  
обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107985, вл 11.  
Дополнительную информацию можно получить по адресу:  
[www.mos-apos.ru](http://www.mos-apos.ru) E-mail: [mos\\_apos@ram.ru](mailto:mos_apos@ram.ru)

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

7. Срок действия гарантии — 12 месяцев с даты продажи.
8. Дата продажи отмечается продажей в гарантийном талоне.
9. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии  
исчисляется с даты поставки кресла-туалета в  
торгующую организацию плюс 1 месяц.
10. Гарантийное обслуживание производится только при  
наличии настоящего гарантийного талона.
11. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
12. Гарантия не распространяется на кресло-туалет,  
поврежденное вследствие:
  - удара;
  - механического воздействия;
  - несанкционированного ремонта или внесения изменений в  
конструкцию;
  - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

## ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон должен иметь:  
- отметку о дате поставки в торговую организацию фирмой "Москва-Апос"  
- отметку о дате продажи кресла-туалета  
Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение  
всего действия гарантийного срока.  
При возникновении неисправности обращайтесь в  
гарантийную мастерскую, указанную торгующей  
организацией.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для региона Москвы и Московской области:  
ул. Мятроская тishина, д. 23, стр.2,  
во вторник и пятницу, с 13 до 17 часов.  
Проезд: метро "Сокольники",  
далее трамвай 7, автобус 285, 716, троллейбус 14, 32, 41.  
До остановки "Дело им. Русакова, Академия приборостроения".  
При отсутствии в Вашем городе гарантийной мастерской  
обращайтесь по адресу: РФ, г. Москва, 107985, вл 11.  
Дополнительную информацию можно получить по адресу:  
[www.mos-apos.ru](http://www.mos-apos.ru) E-mail: [mos\\_apos@ram.ru](mailto:mos_apos@ram.ru)