




УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ИММУНОСКРИН»



Фотографические изображения медицинского изделия
Индикатор фотолюминесценции импульсный ИФИ-05
для лабораторной диагностики in vitro,
в вариантах исполнения с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-048-49941990-2018

Ведущий специалист




 А.С. Соколов
от «30» июля 2021 г.

Москва 2021

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению

Таблица – Перечень фотографических изображений

Общий вид медицинского изделия	
Рисунок 1 –	Общий вид медицинского изделия в рабочем состоянии
Рисунок 2 –	ИФИ-05 вид спереди
Рисунок 3 –	ИФИ-05 вид сзади
Рисунок 4 –	ИФИ-05А вид спереди
Рисунок 5 –	ИФИ-05А вид сзади
Рисунок 6 –	Все исполнения вид сбоку
Рисунок 7 –	Кабель питания CEE 7/7 - IEC 320 C13, Кабель USB тип А-В
Рисунок 8 –	Программное обеспечение (ПО) «ИФИ» RU.СДАЕ.00001-01 12 01 на носителе информации: компакт-диск
Принадлежности	
Рисунок 9 –	Комплект запасных частей и принадлежностей одиночный (ЗИП 0)
Маркировка	
Рисунок 10 –	ИФИ-05 задняя панель с маркировкой
Рисунок 11 –	ИФИ-05А задняя панель с маркировкой
Транспортная упаковка	
Рисунок 12 –	Транспортная упаковка
Рисунок 13 –	Маркировка на транспортной упаковке
Рисунок 14 –	Проект шильдика ИФИ-05 после смены организационно-правовой формы производителя.
Рисунок 15 –	Проект шильдика ИФИ-05А после смены организационно-правовой формы производителя.

	Разработал	Согласовал	Утвердил
Должность ФИО	Инженер Аслиян С.К.	Ведущий специалист Соколов А.С.	Ведущий специалист Соколов А.С.
Дата			
Подпись			

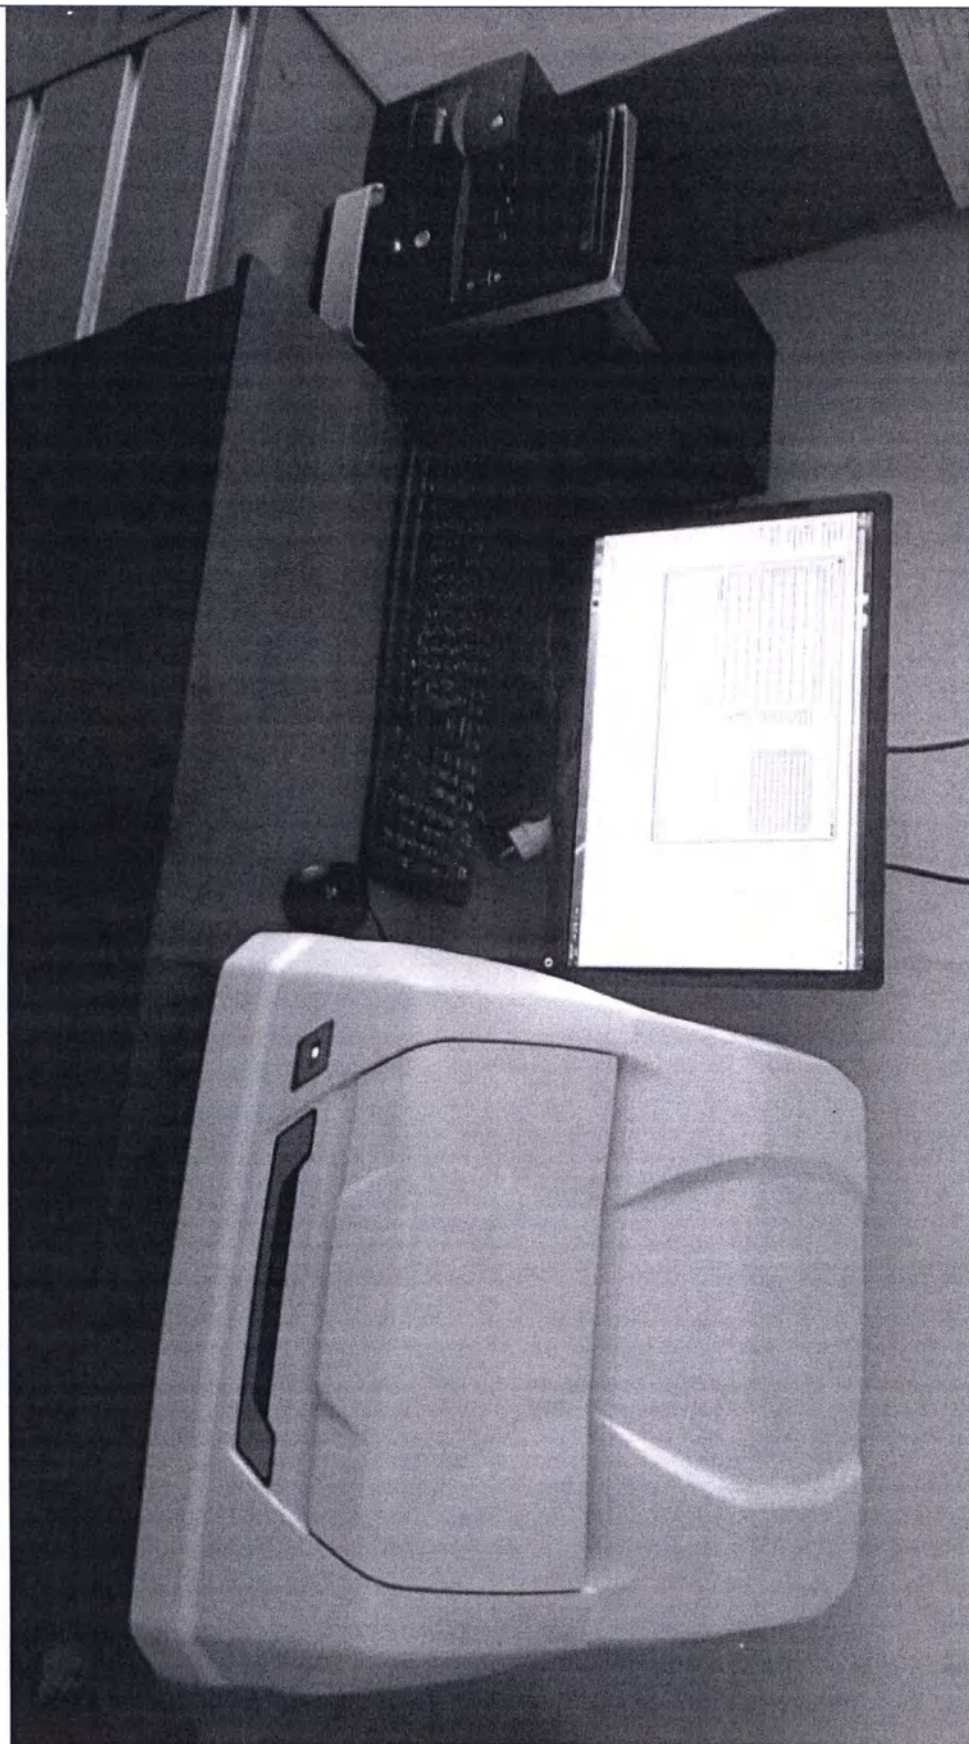


Рисунок 1 – Общий вид МИ в рабочем состоянии



Рисунок 2 – ИФИ-05 вид спереди

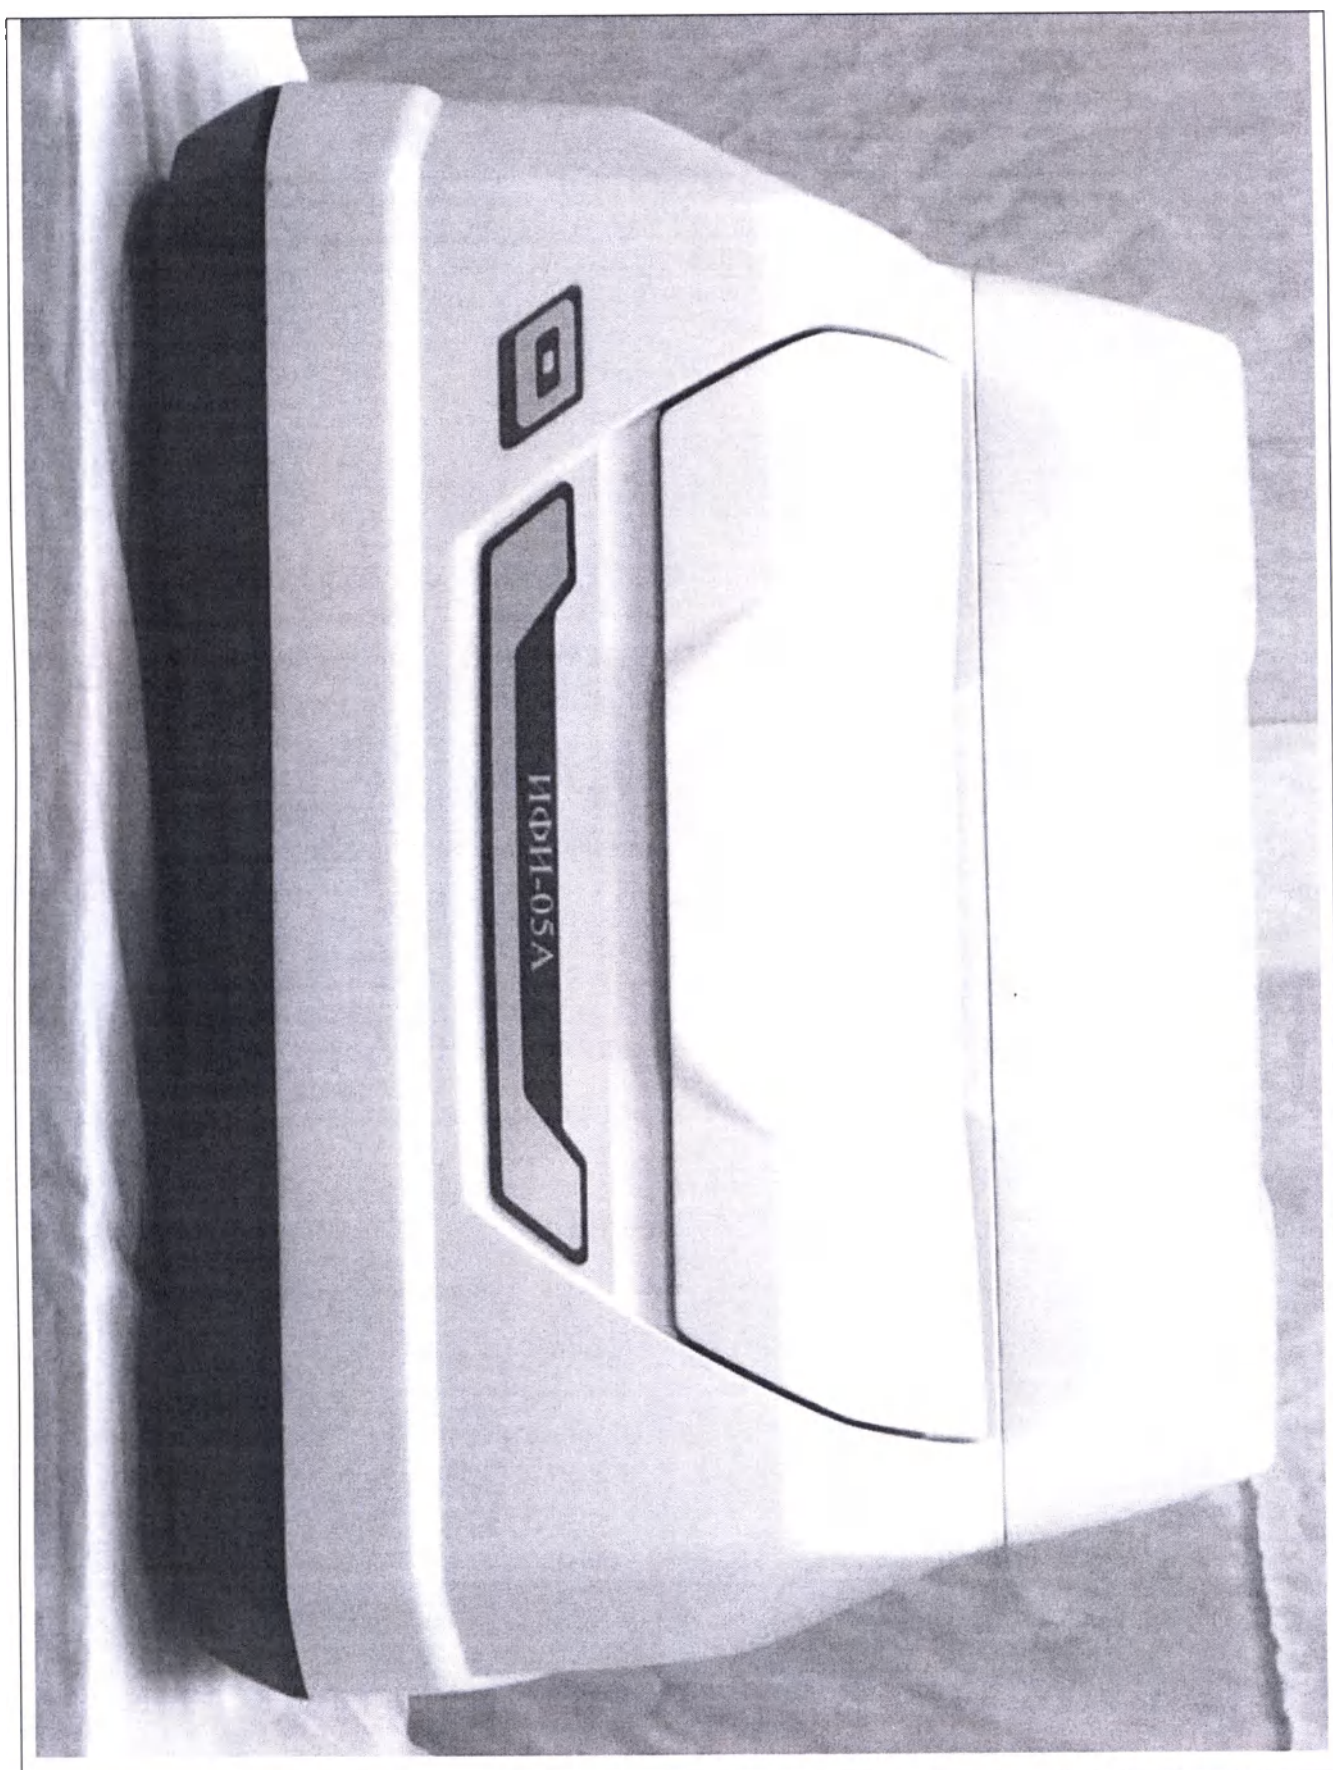


Рисунок 4 – ИФИ-05А вид спереди

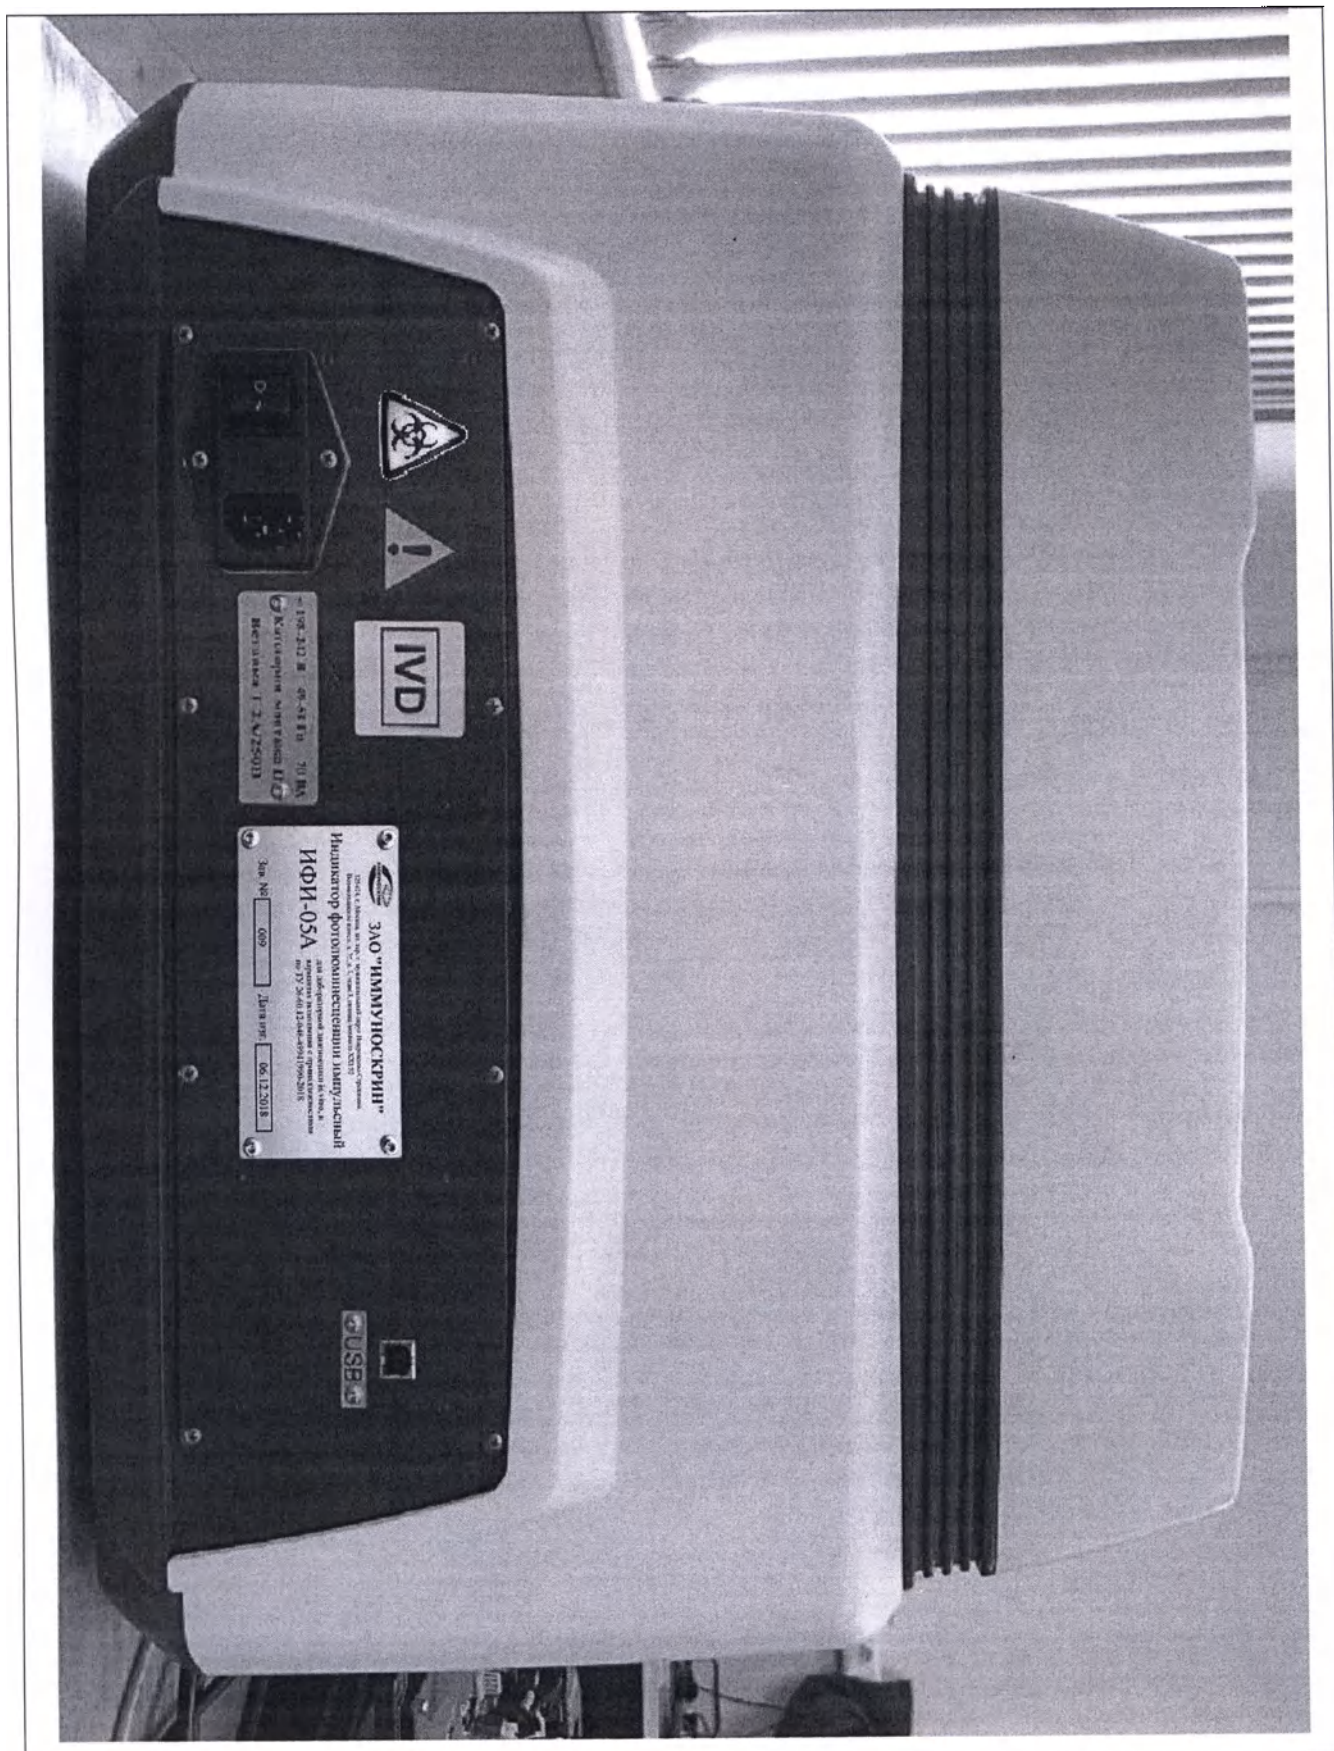


Рисунок 5 – ИФИ-05А вид сзади

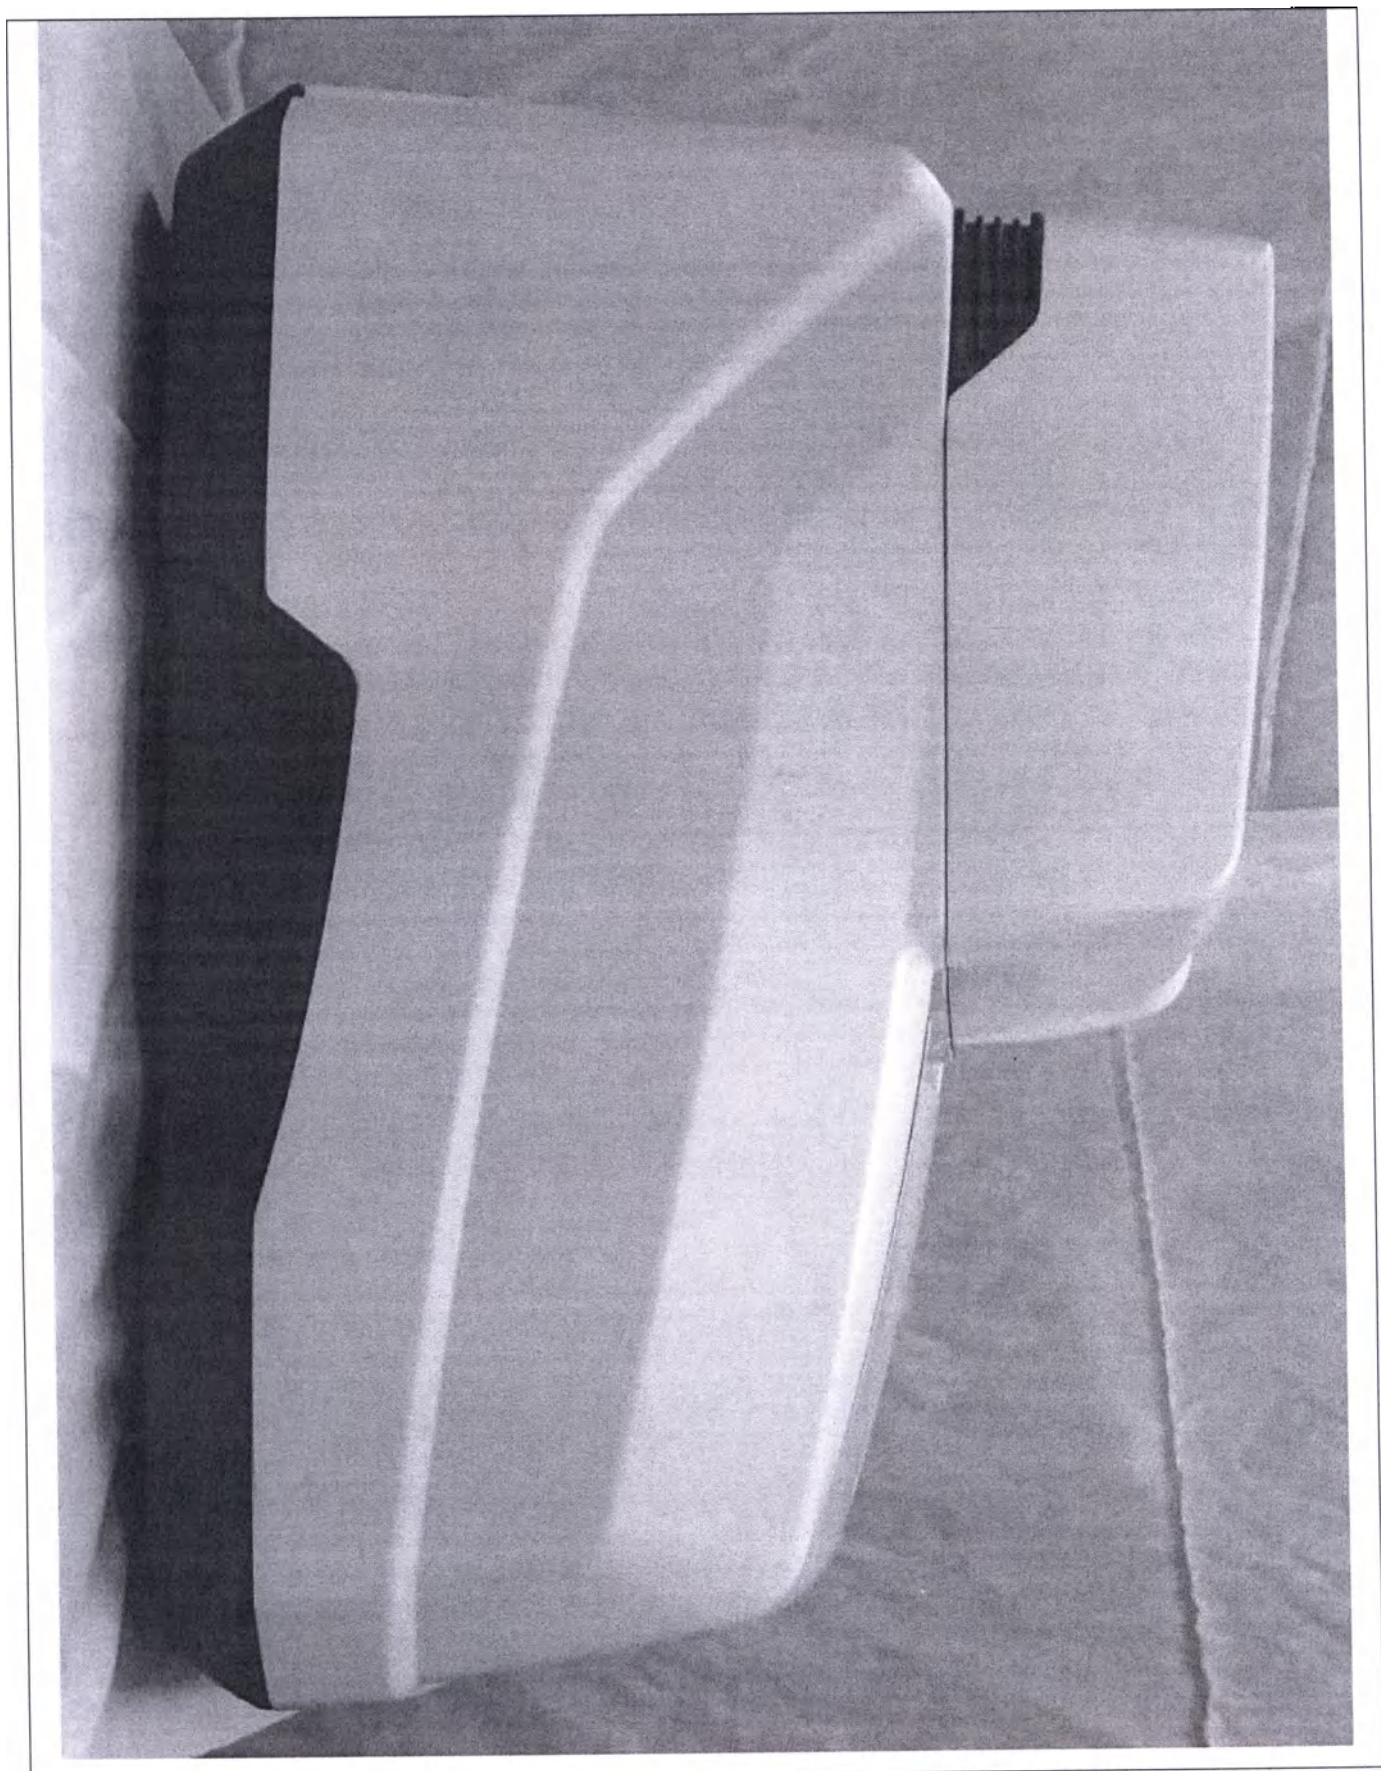


Рисунок 6 – Все исполнения вид сбоку



**Рисунок 7 – Кабель питания СЕЕ 7/7 - IEC 320 C13 (слева),
Кабель USB тип А-В (справа)**

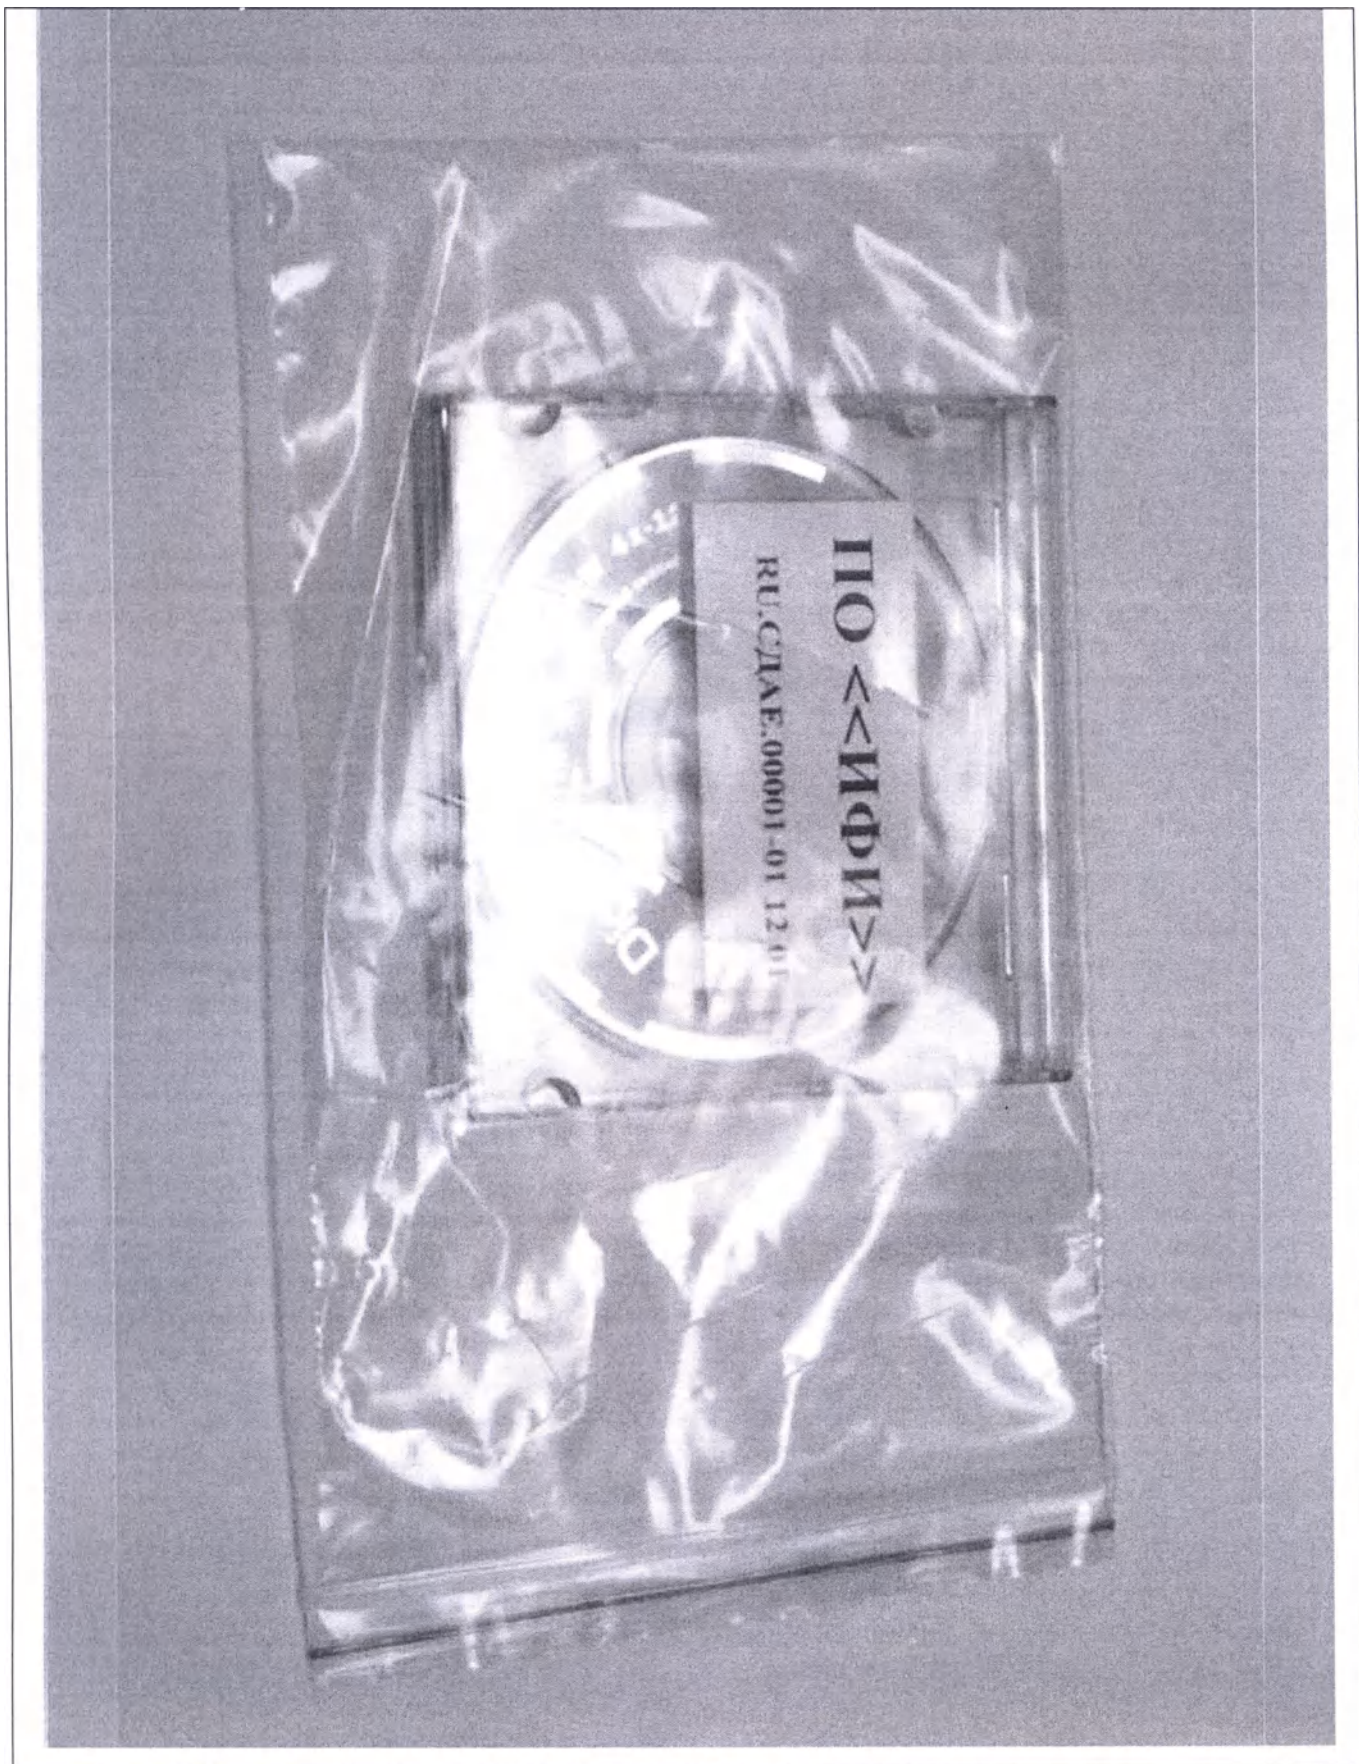


Рисунок 8 – ПО «ИФИ» RU.CDAE.00001-01 12 01 на компакт-диске



Рисунок 9 – Комплект запасных частей и принадлежностей одиночный (ЗИП 0)

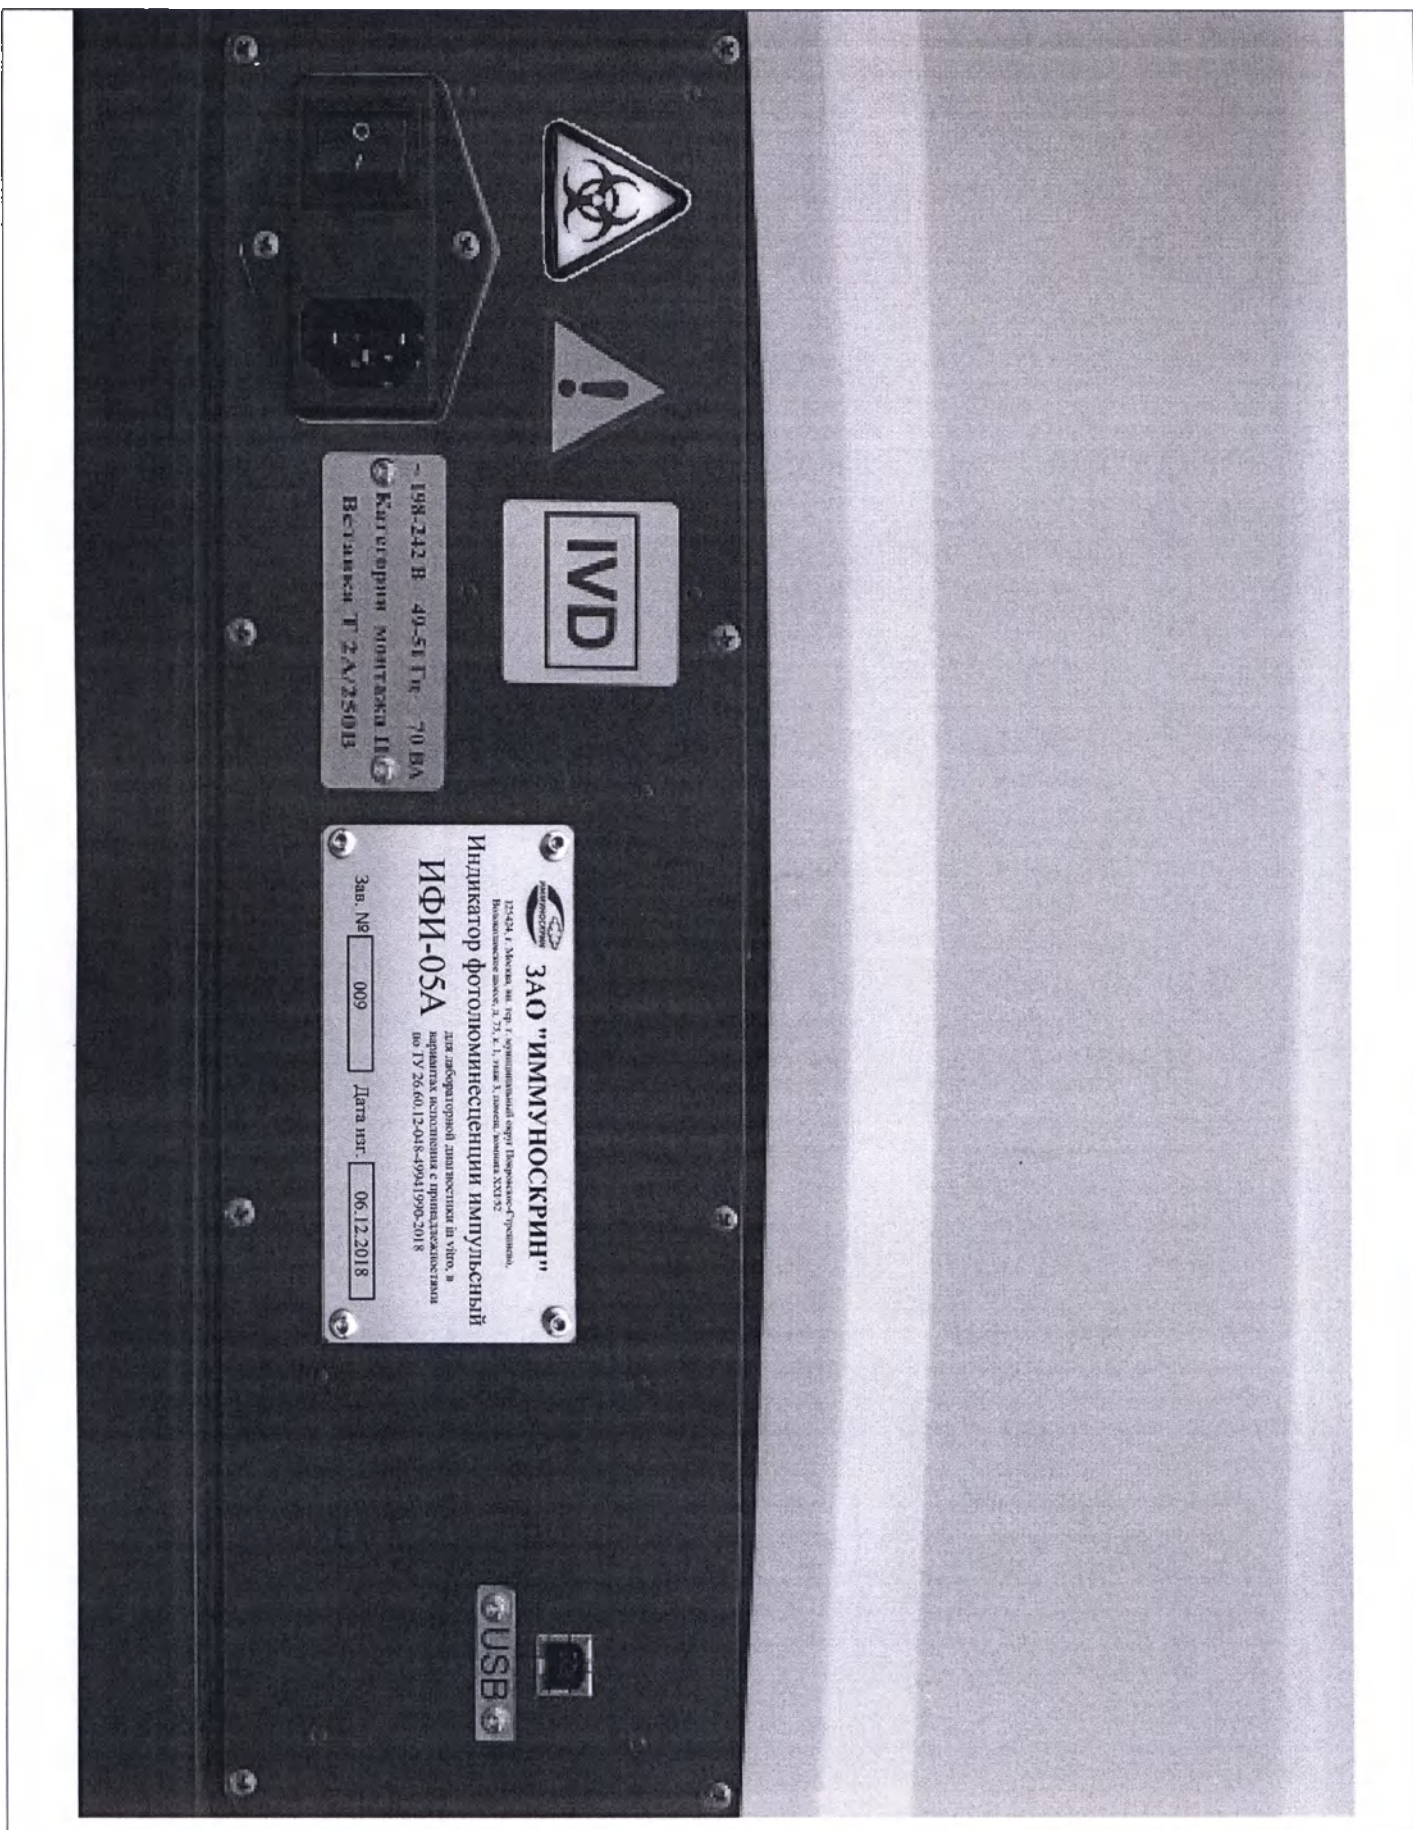


Рисунок 10 – ИФИ-05А задняя панель с маркировкой

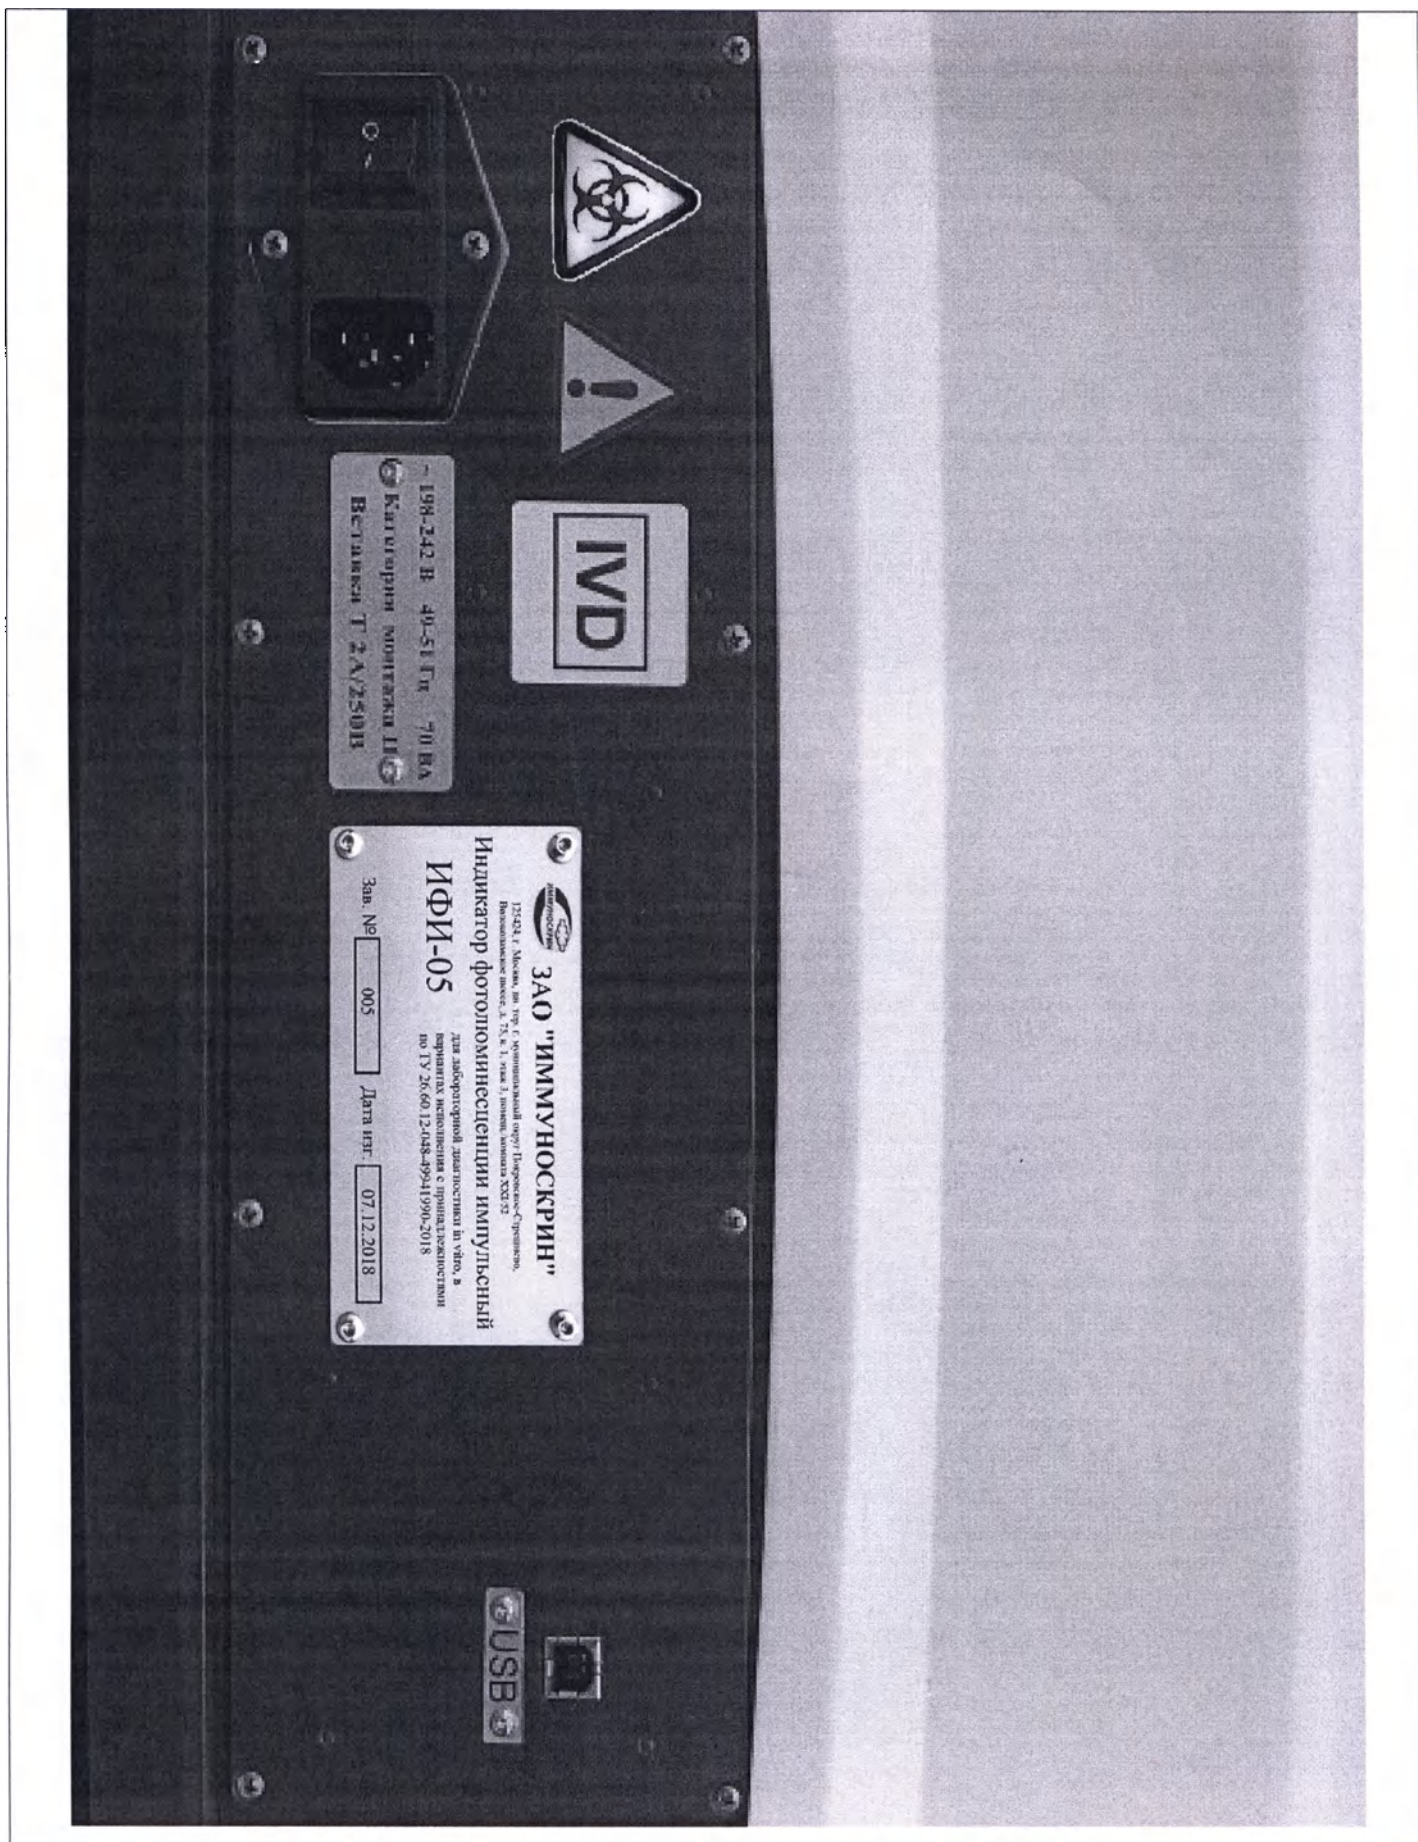


Рисунок 11 – ИФИ-05 задняя панель с маркировкой



Рисунок 12 – Транспортная упаковка

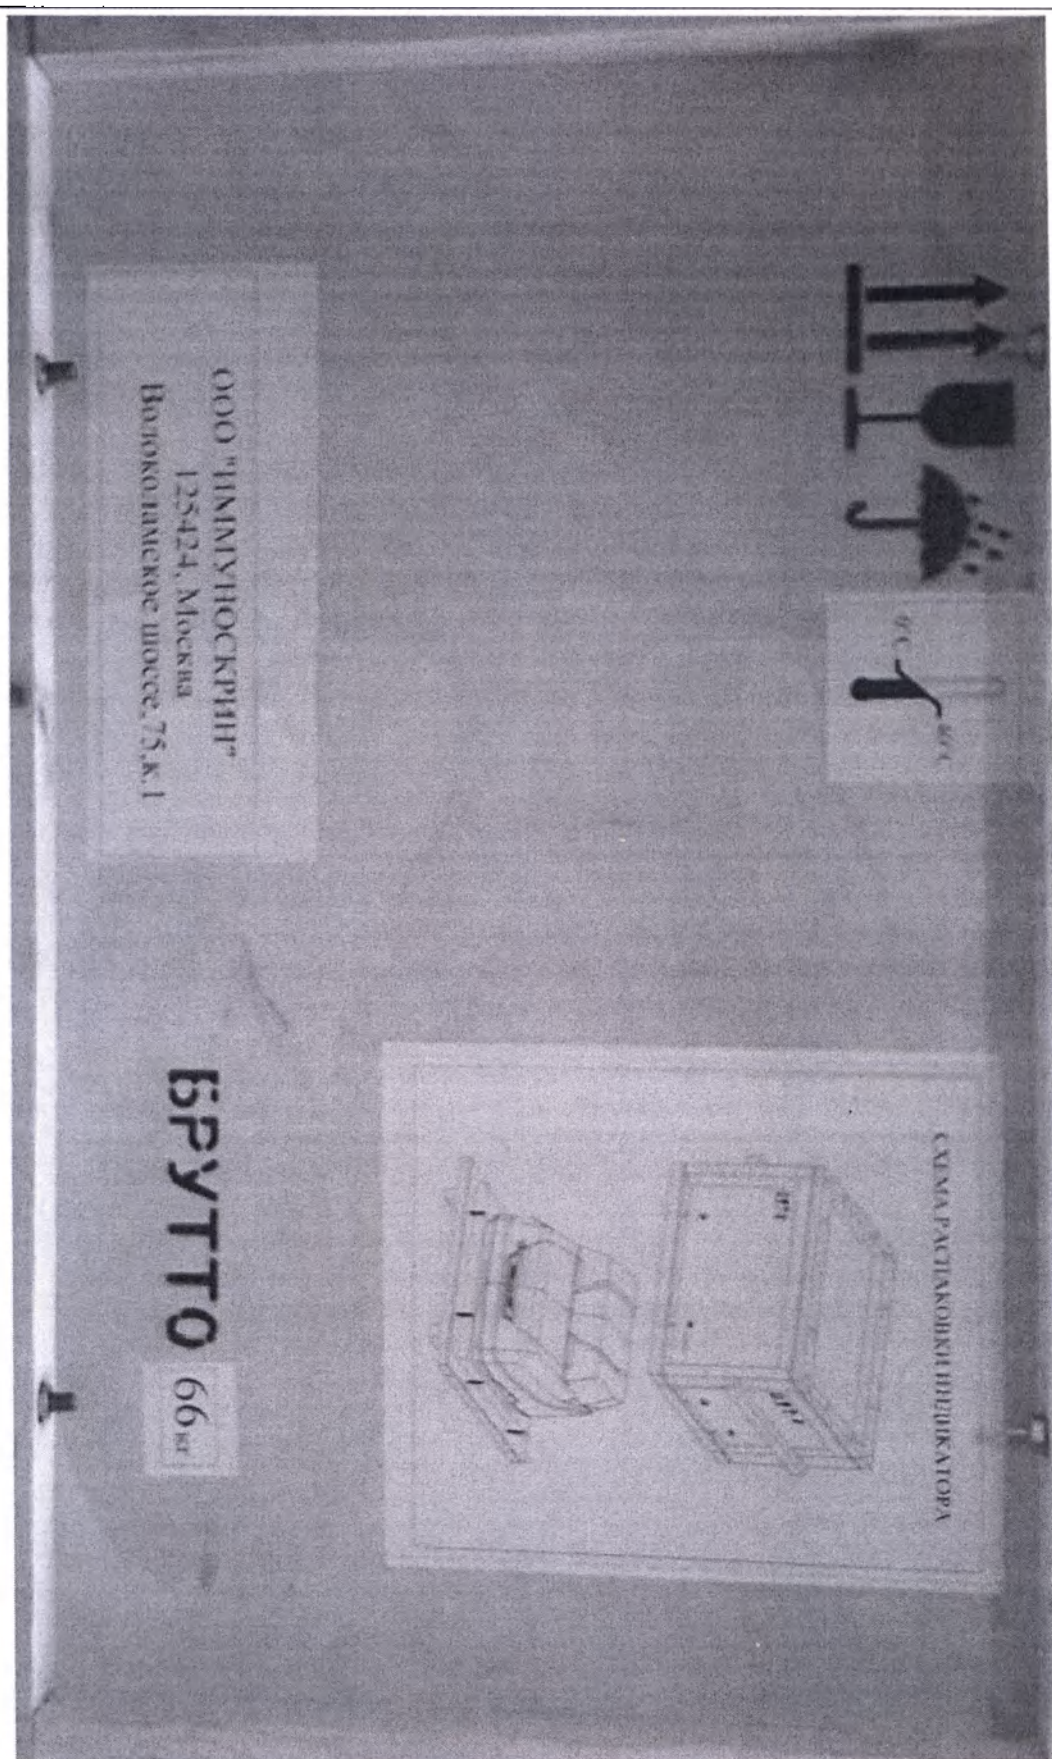


Рисунок 13 – Маркировка на транспортной упаковке

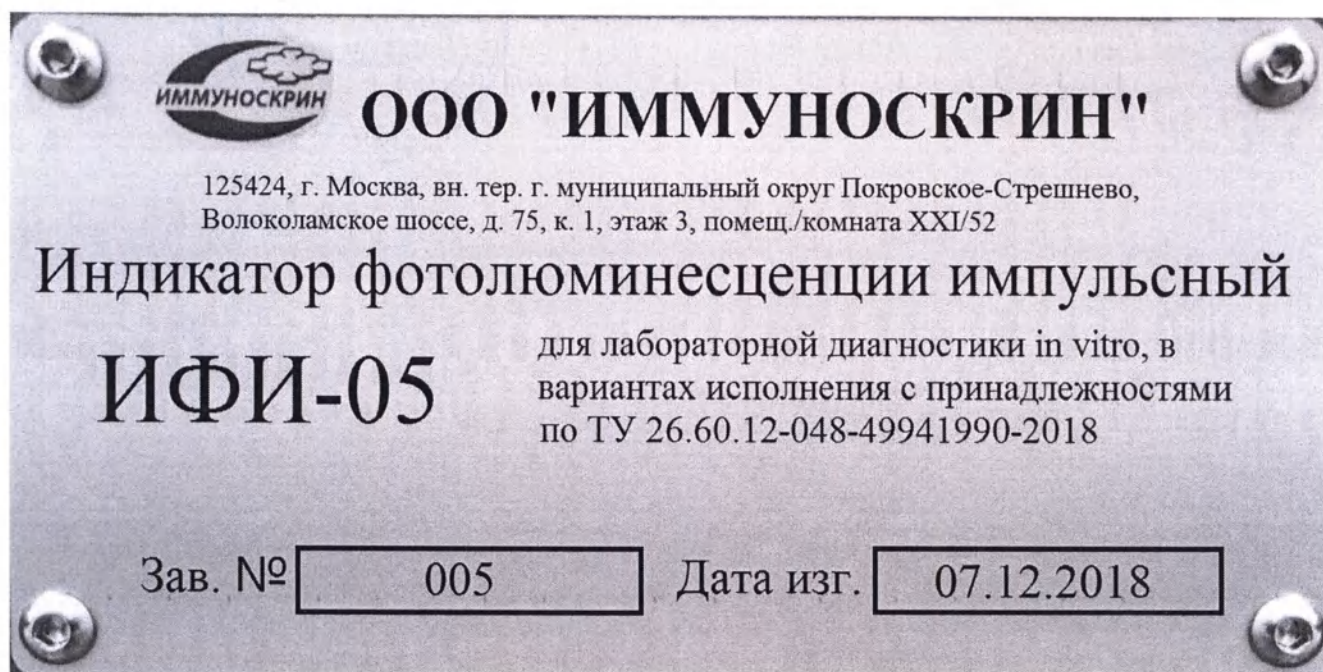


Рисунок 14 – Проект шильдика ИФИ-05 после смены организационно-правовой формы производителя.

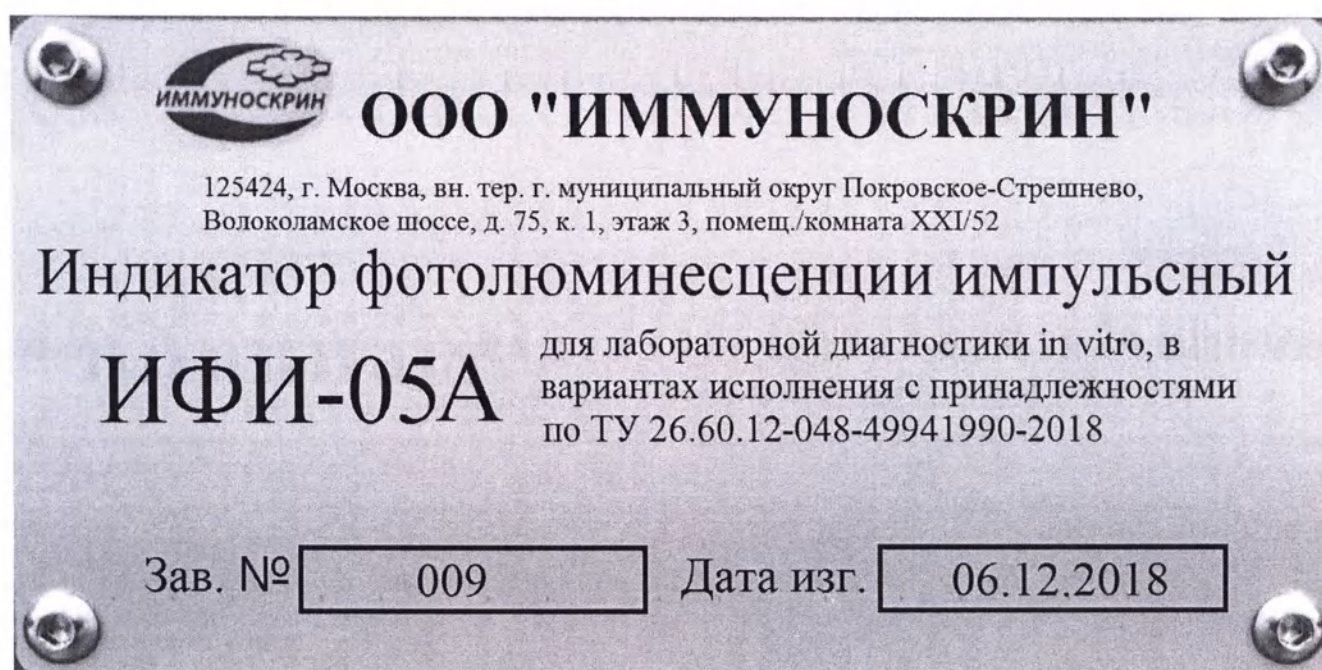


Рисунок 15 – Проект шильдика ИФИ-05А после смены организационно-правовой формы производителя.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
на 16 (шестнадцать) (а/ов)

Генеральный директор
ООО «ИММУНОСКРИН» _____ Н.С. Осин

