

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО ИТО «ИРЭ-Полус»
Евтихий Н.Н.
« 09 » сентября 2021 г.




Фотографические изображения

Медицинского изделия:

Аппарат лазерный хирургический повышенной мощности «FiberLase U» по


ТУ 32.50.50–052-18003536-2017



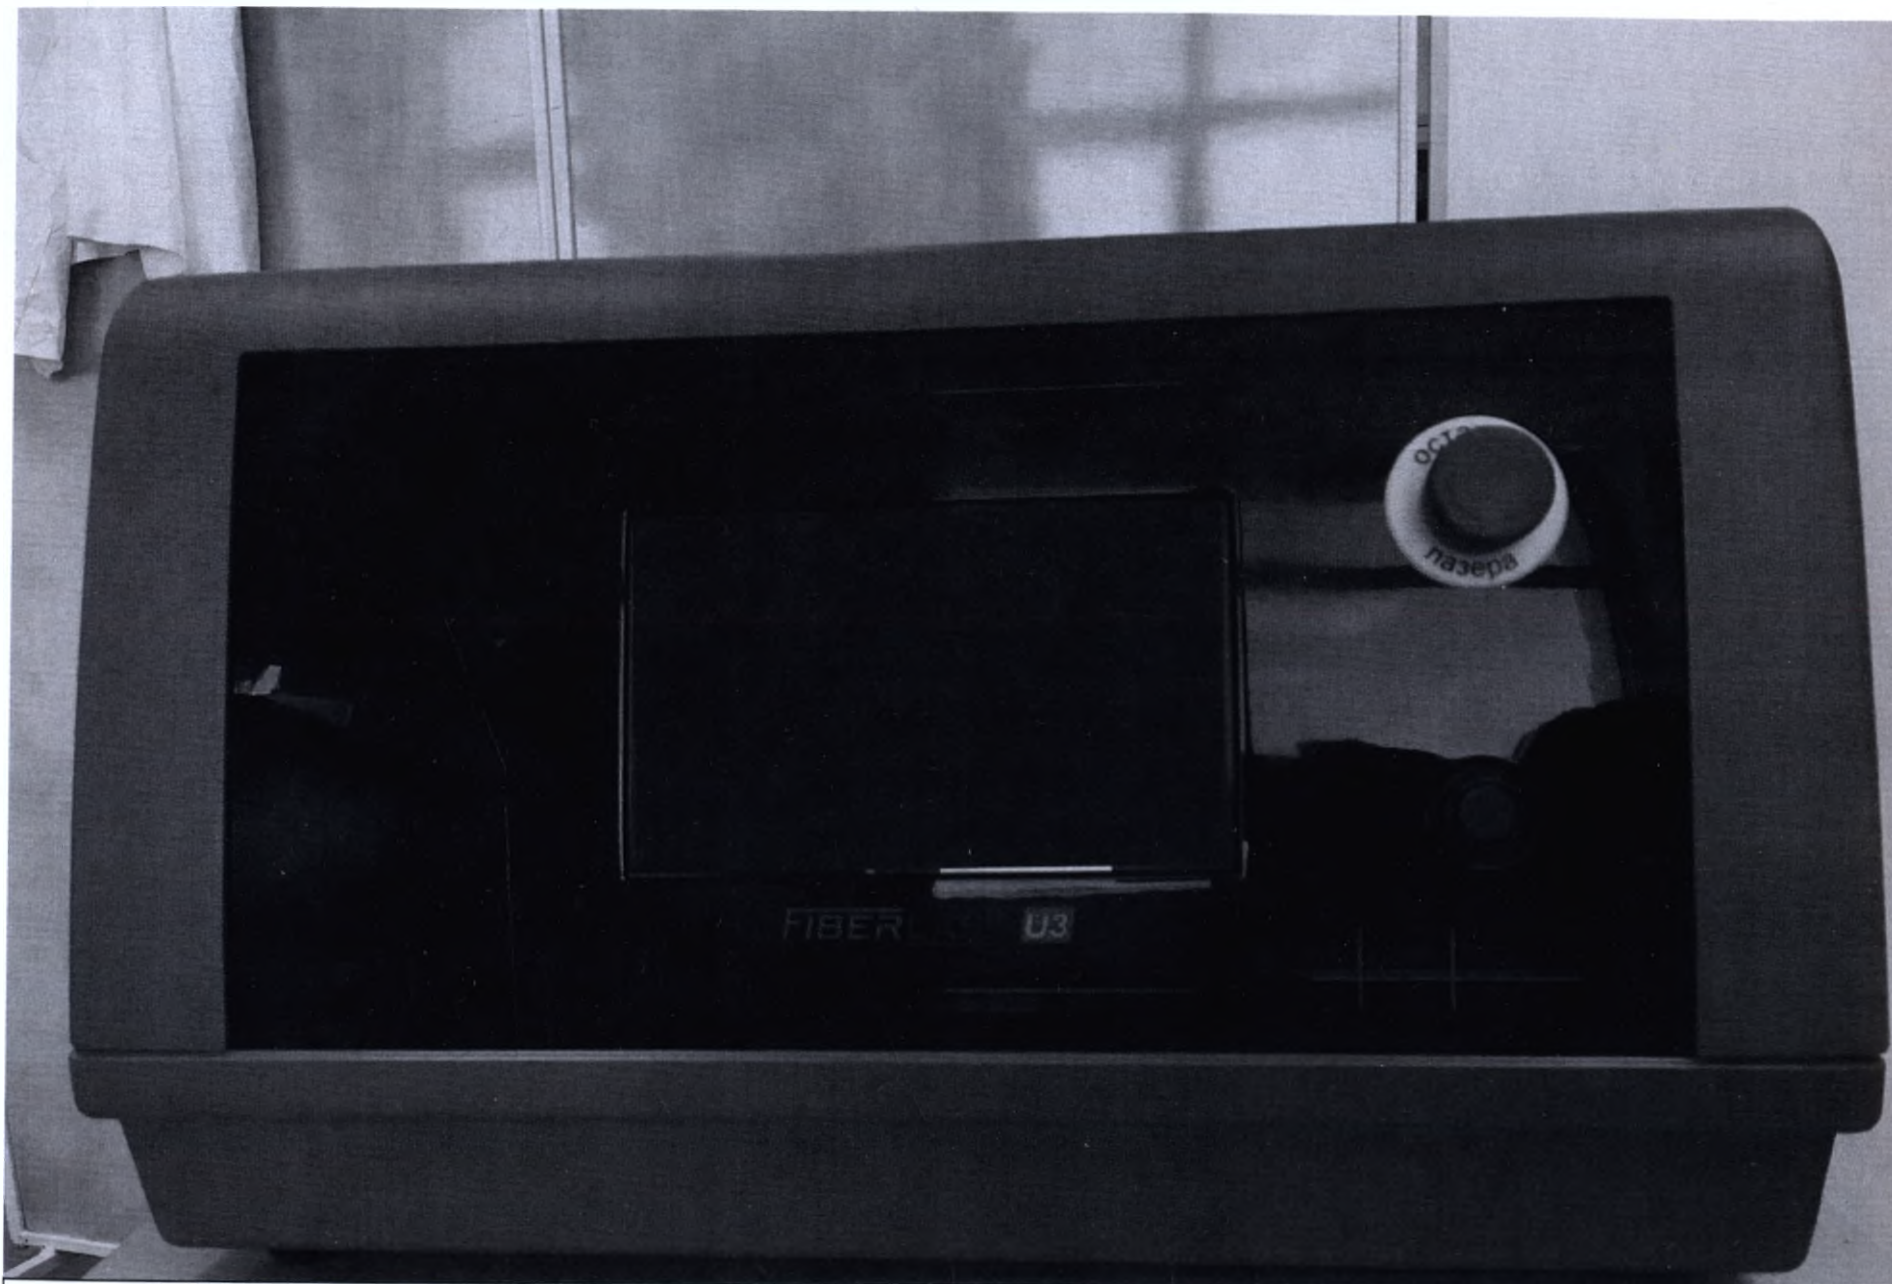


Аппарат лазерный хирургический повышенной мощности «FiberLase U» по ТУ 32.50.50-052-18003536-2017,

в исполнении «FiberLase U3», вид спереди

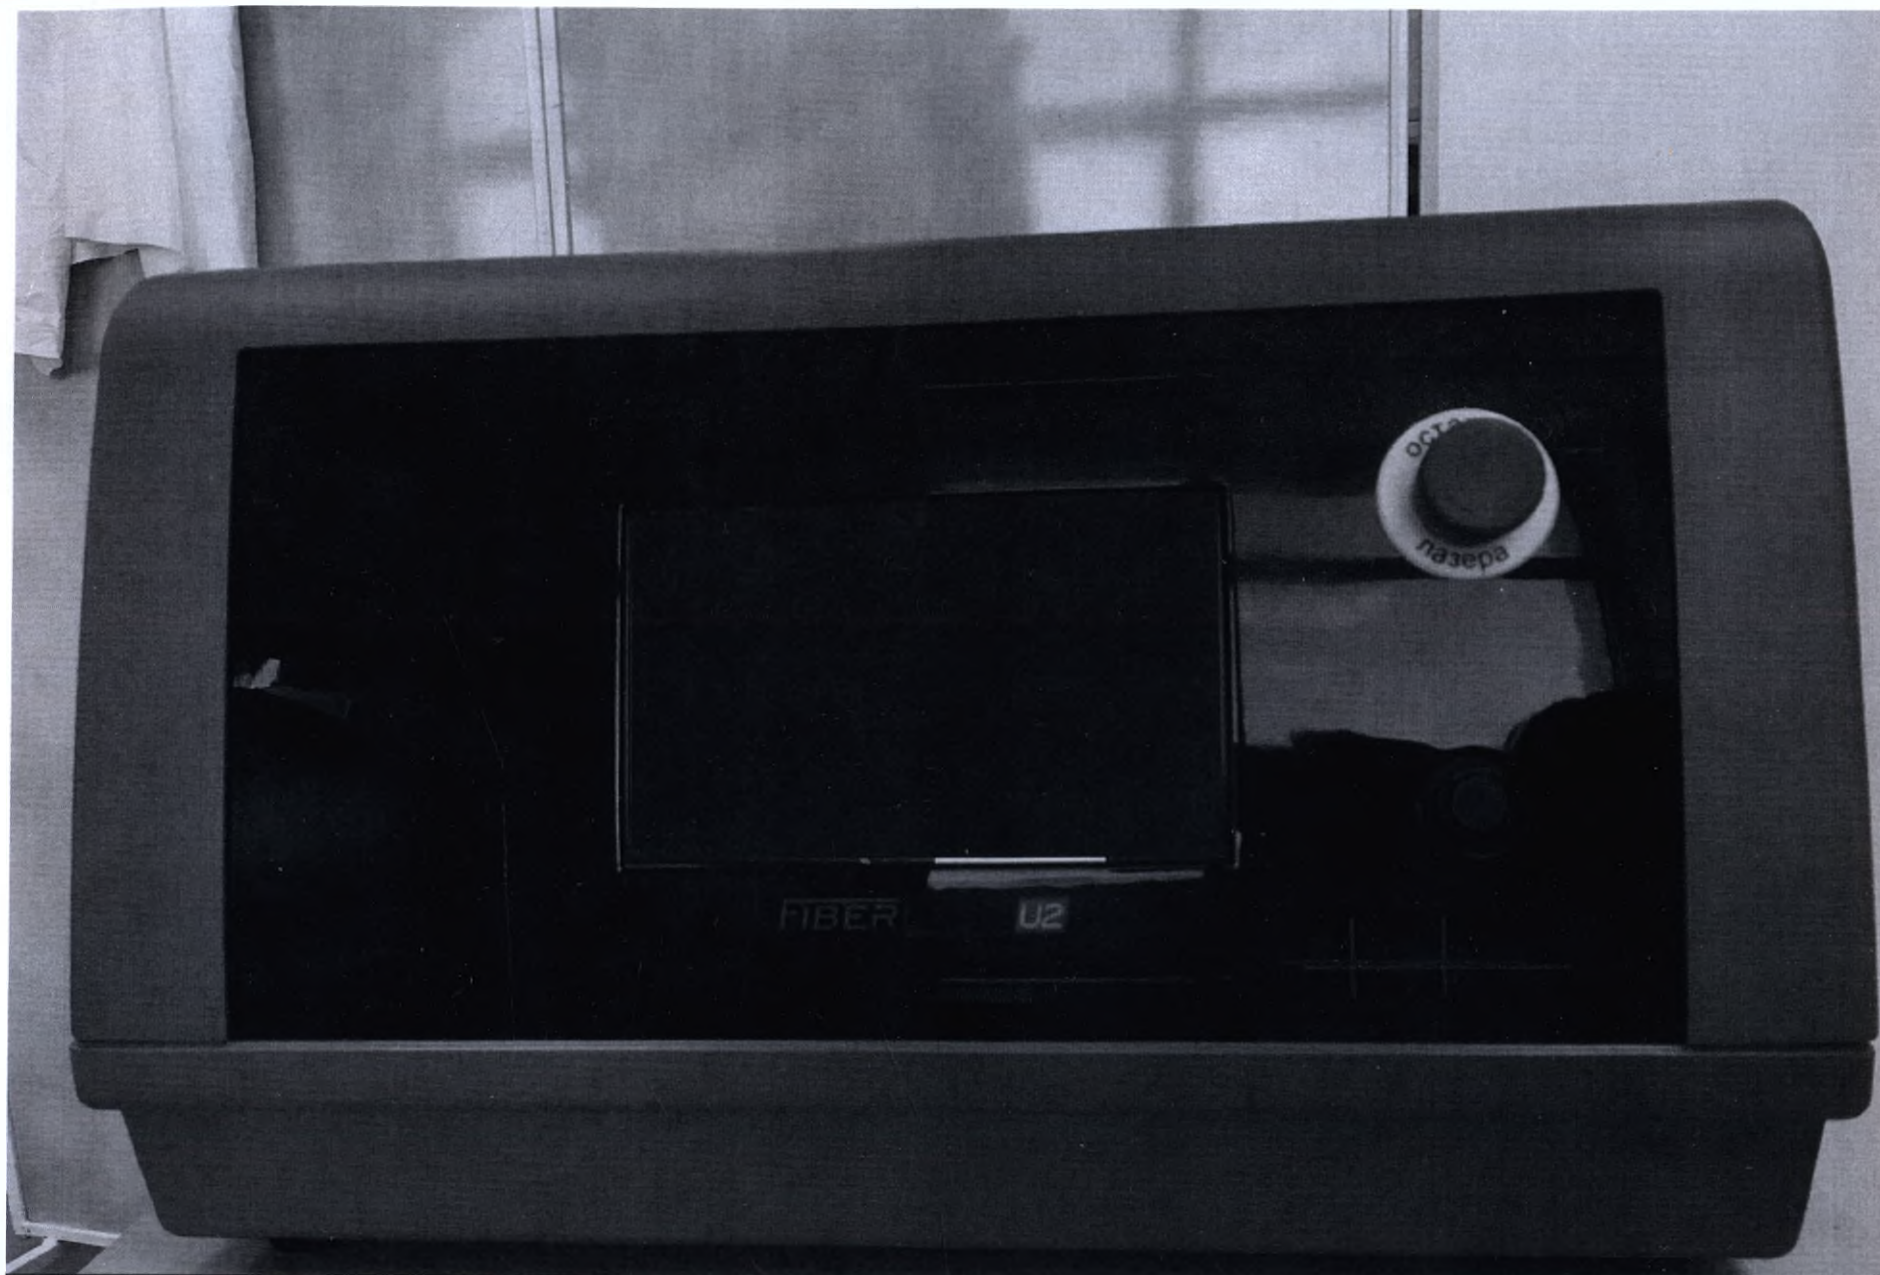


Аппарат лазерный хирургический повышенной мощности «FiberLase U» по ТУ 32.50.50-052-18003536-2017,

в исполнении «FiberLase U2», вид спереди

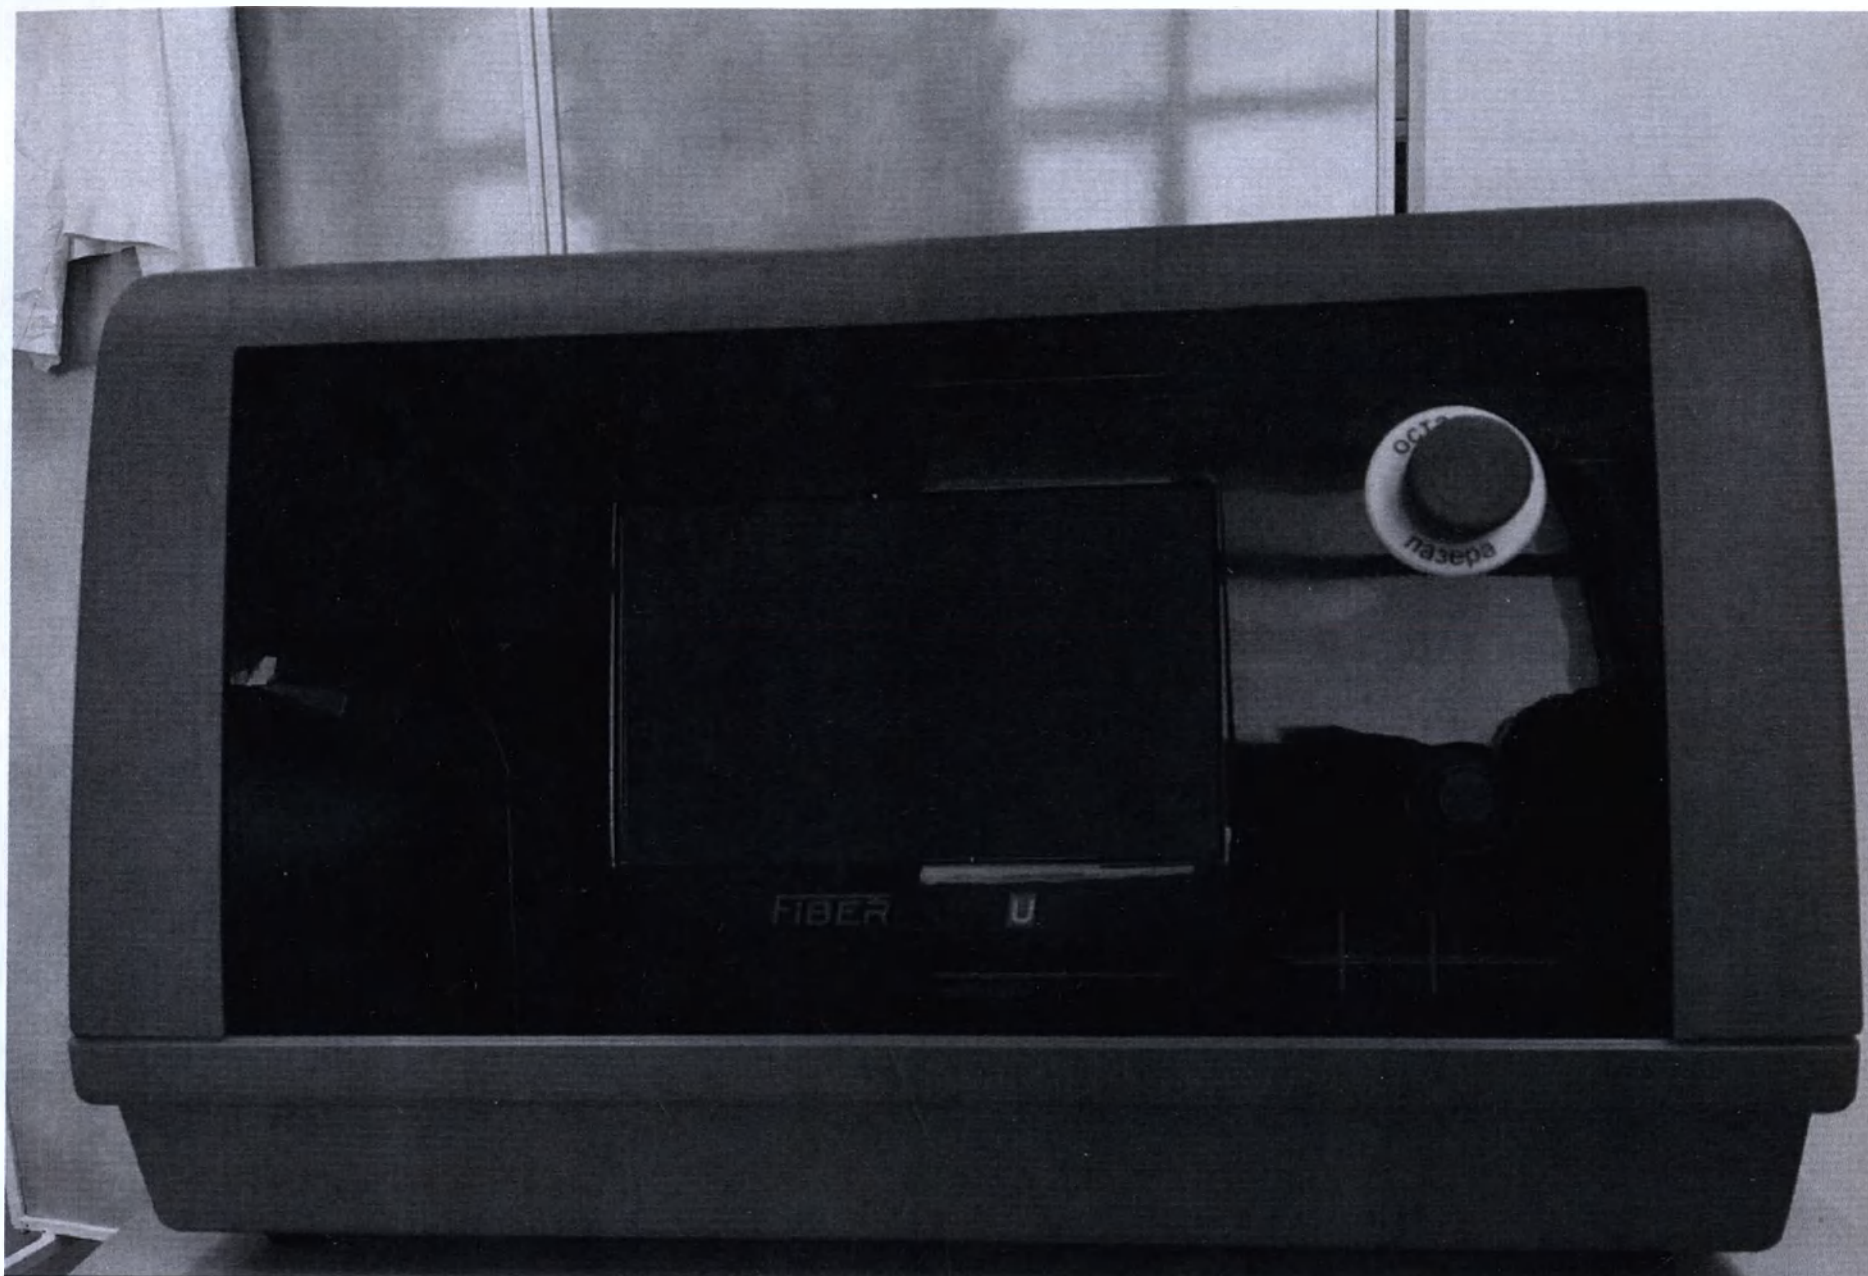


Аппарат лазерный хирургический повышенной мощности «FiberLase U» по ТУ 32.50.50-052-18003536-2017,

в исполнении «FiberLase U», вид спереди

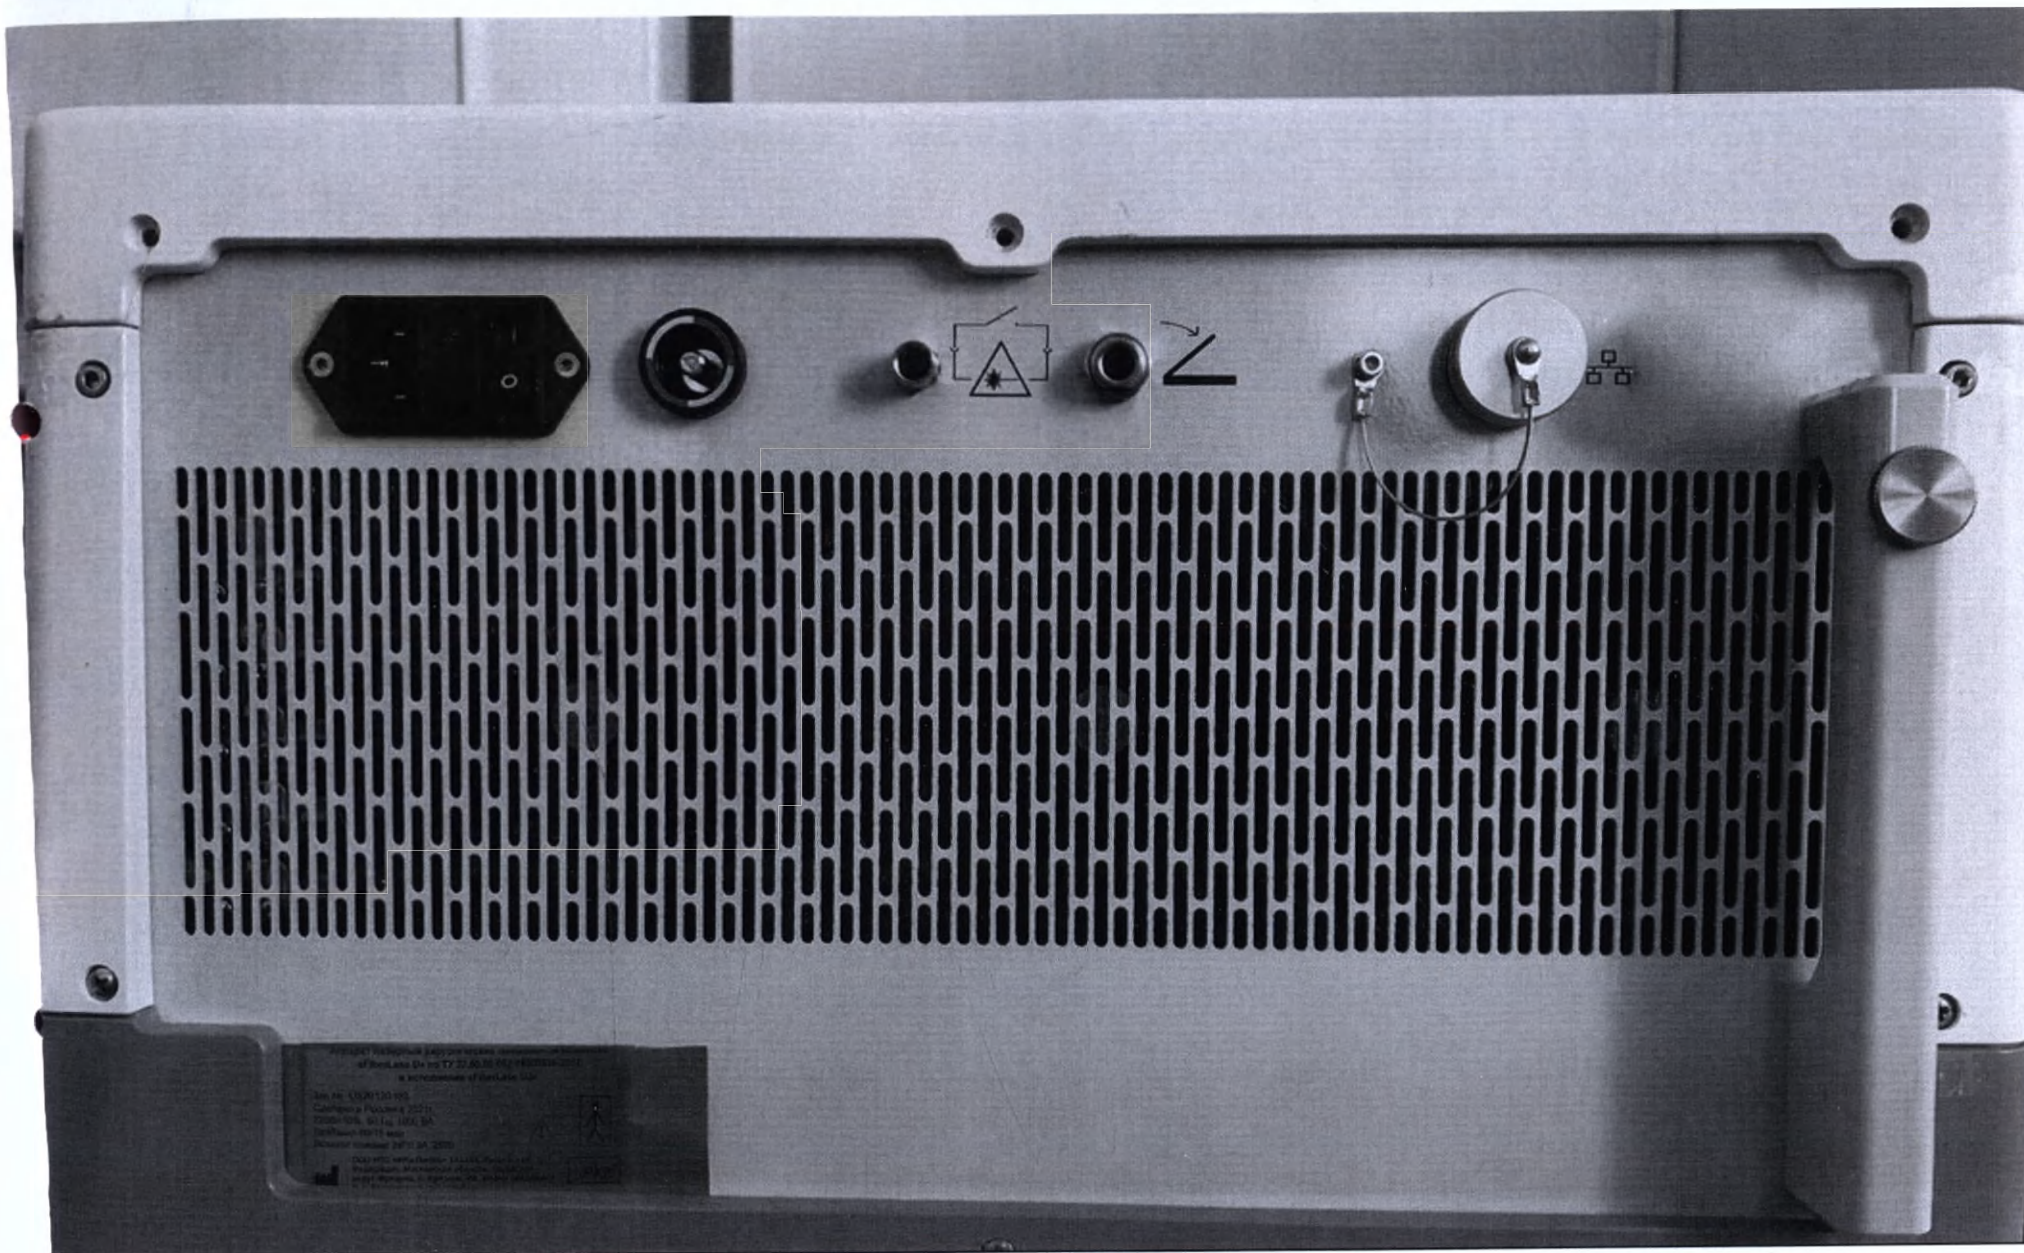

Аппарат лазерный хирургический повышенной мощности «FiberLase U» по ТУ 32.50.50–052-18003536-2017,
в исполнении «FiberLase U3», вид сзади (аналогичен вариантам исполнения «FiberLase U», «FiberLase U2»)

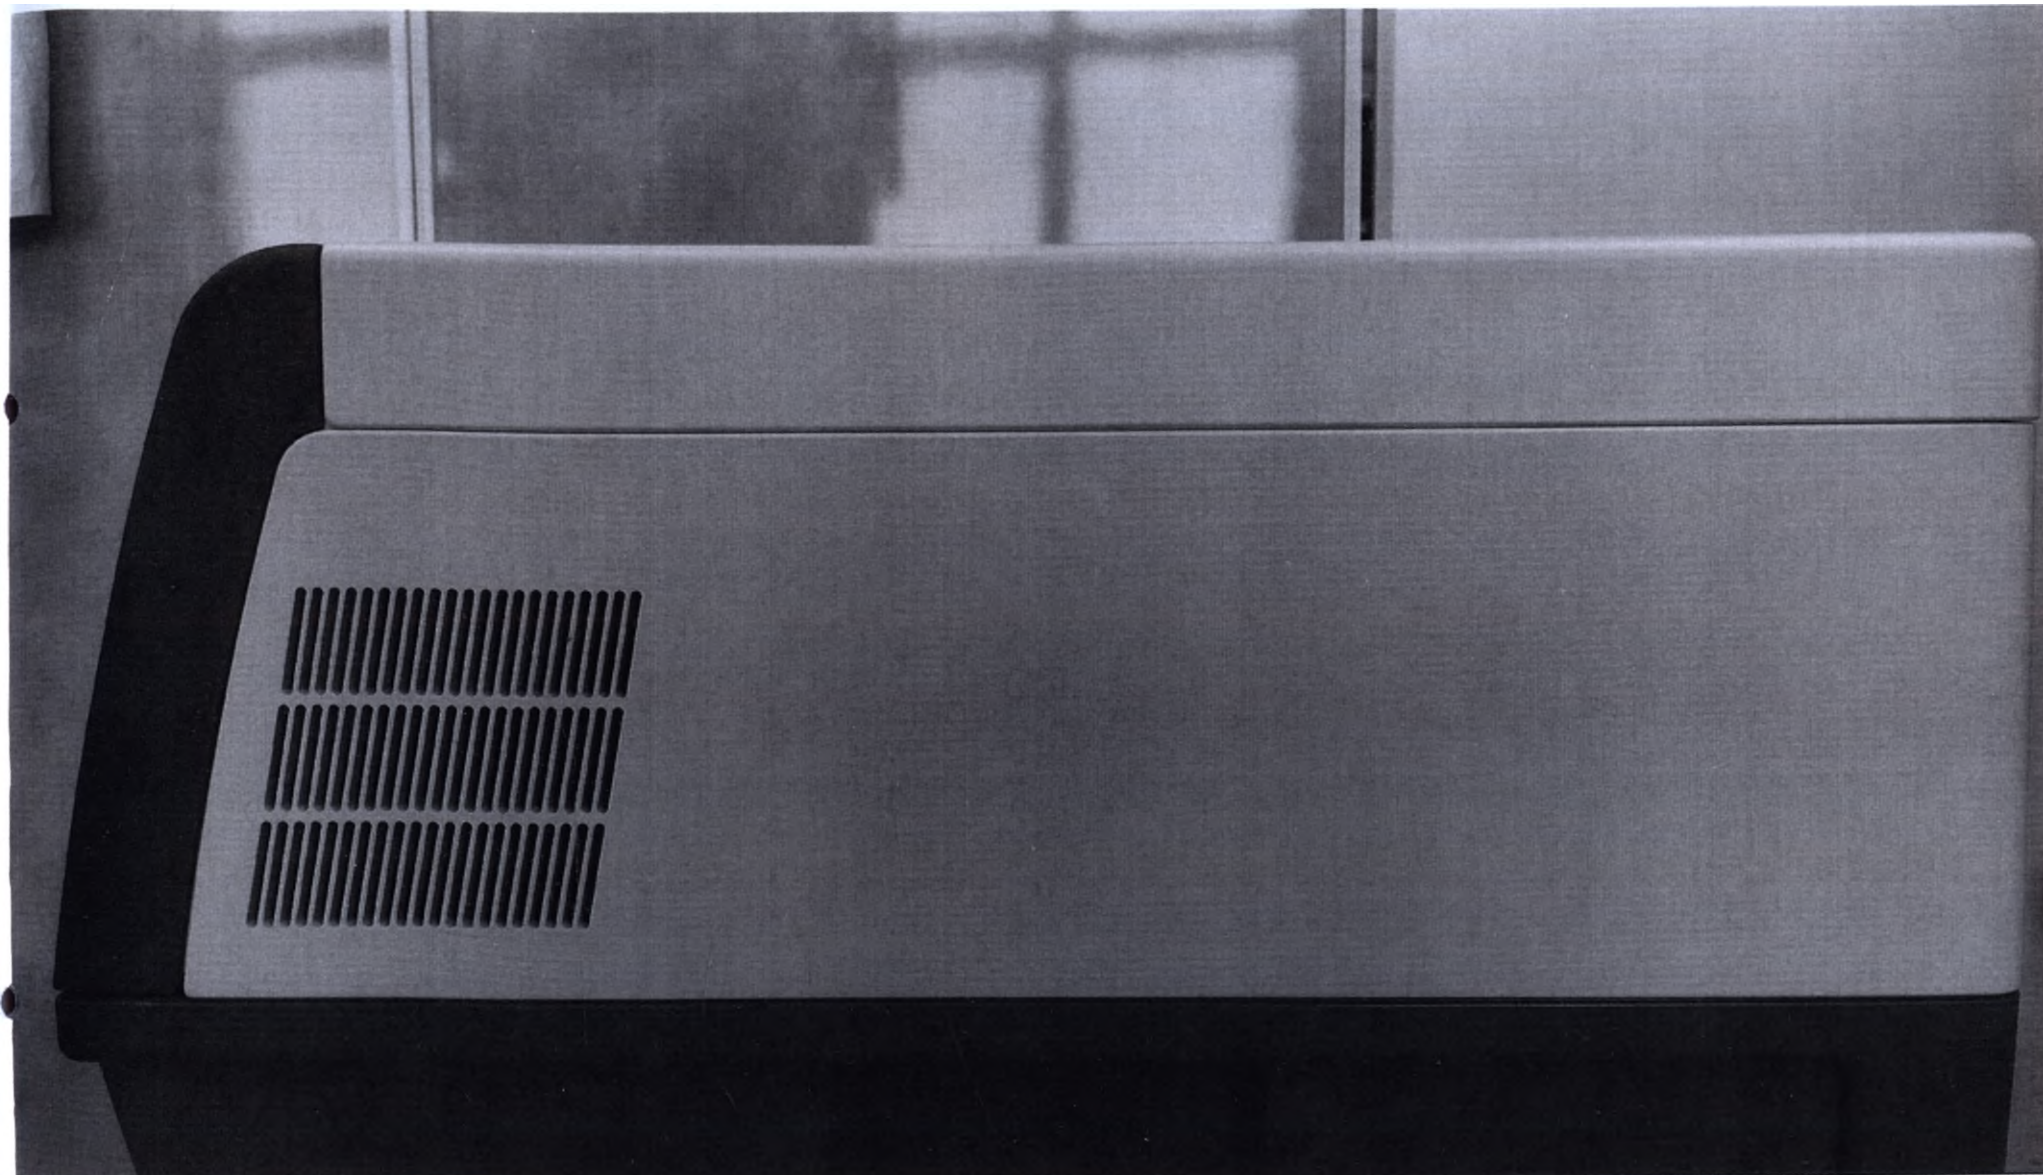

**Аппарат лазерный хирургический повышенной мощности «FiberLase U» по ТУ 32.50.50–052-18003536-2017,
в исполнении «FiberLase U3», вид сбоку (аналогичен вариантам исполнения «FiberLase U», «FiberLase U2»)**

**Аппарат лазерный хирургический повышенной мощности
«FiberLase U» по ТУ 32.50.50-052-18003536-2017,
в исполнении «FiberLase U3»**

Зав.№ U320120103

Сделано в России в 2021г.


220В±10%, 50 Гц, 1000 ВА

Вкл/Выкл 60/15 мин


Вставки плавкие 2xF6.3A, 250В




ООО НТО «ИРЭ-Полюс» 141195, Российская
Федерация, Московская область, городской
округ Фрязино, г. Фрязино, пл. имени академика
Б.А. Введенского, д.3, стр.5.




Образец маркировки (задняя стенка аппарата)

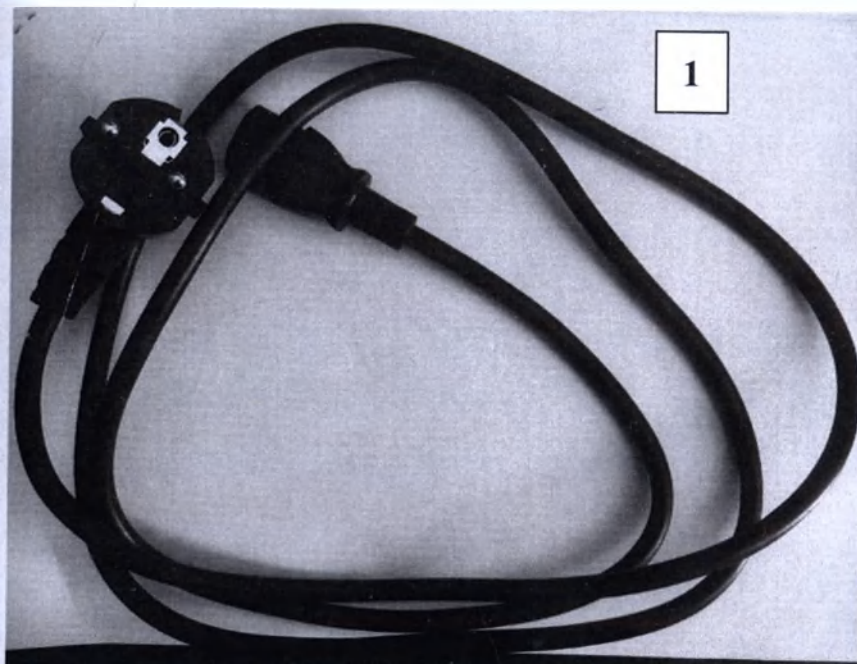


1

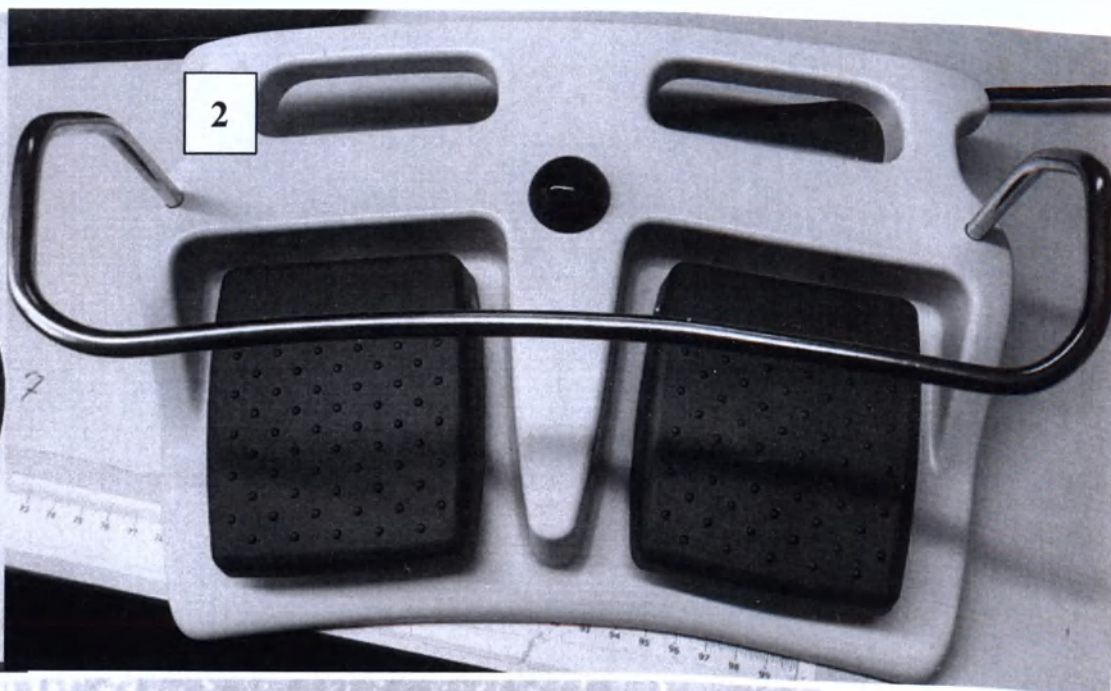

2



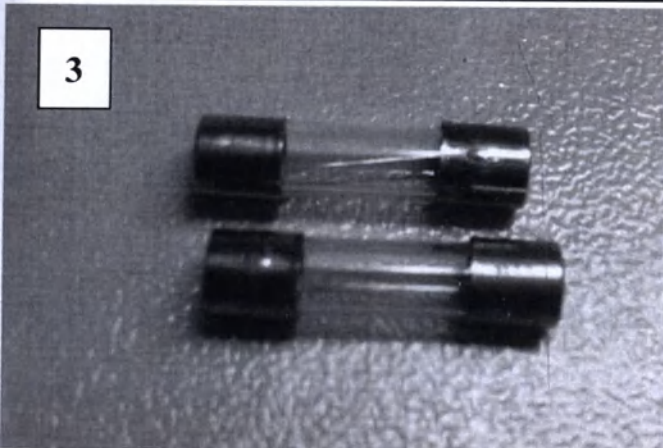


3

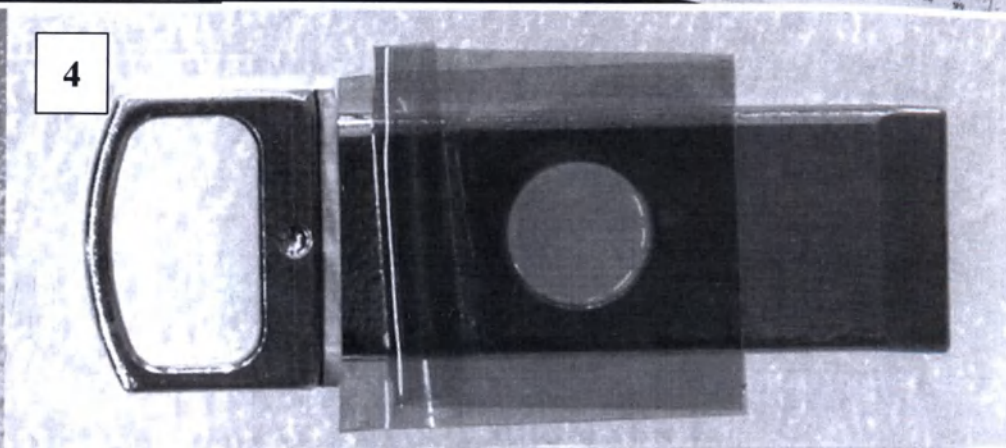


4

1. Шнур питания
2. Педаль включения излучения
3. Вставки плавкие
4. Защитное окно

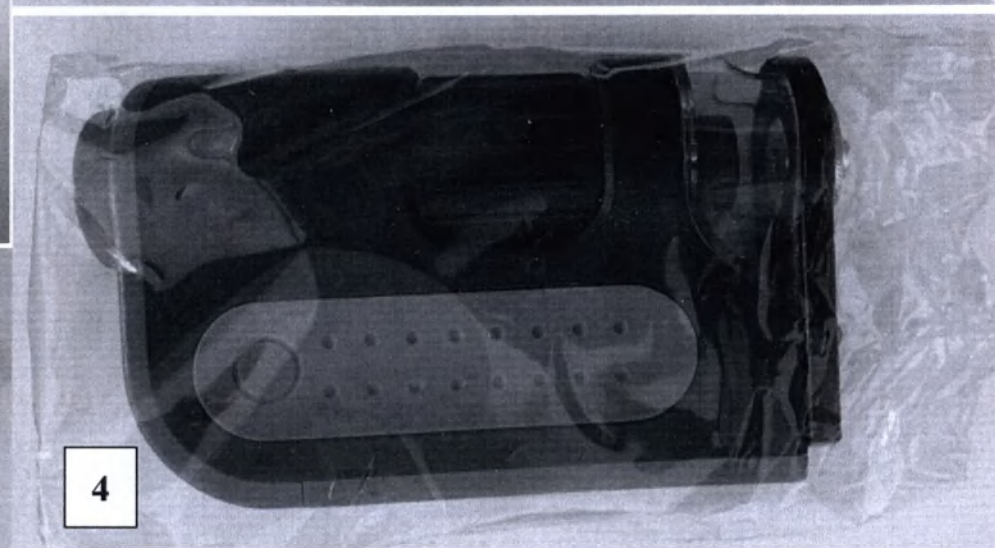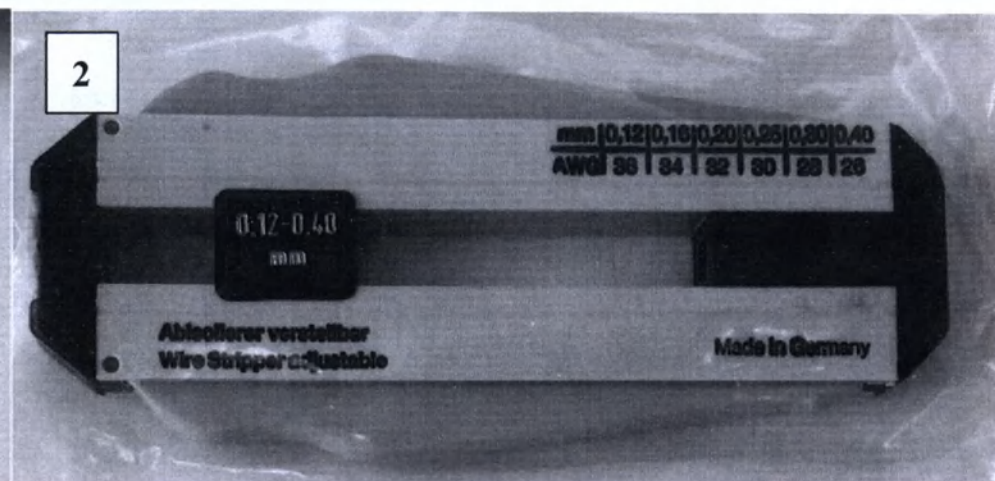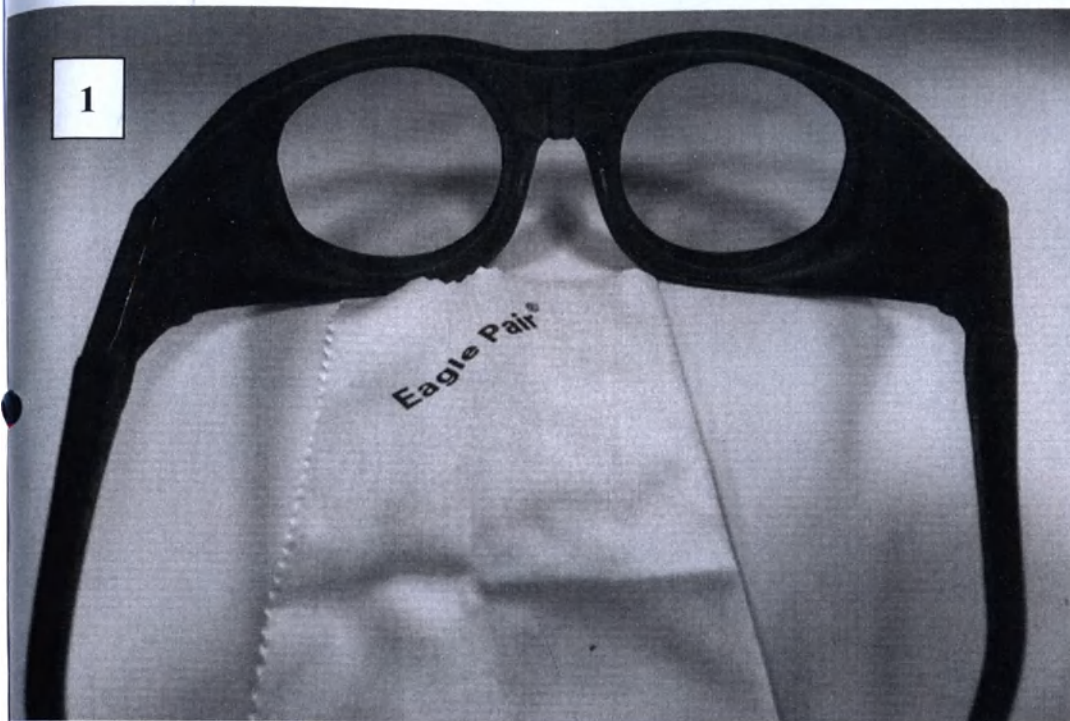


1. Очки защитные от воздействия лазерного излучения, модель «Eagle Pair» EP-10-4 с салфеткой для очищения линз, в чехле
2. Стриппер волоконного инструмента
3. Скалыватель волокна
4. Микроскоп для проверки торца волоконного инструмента в разъеме

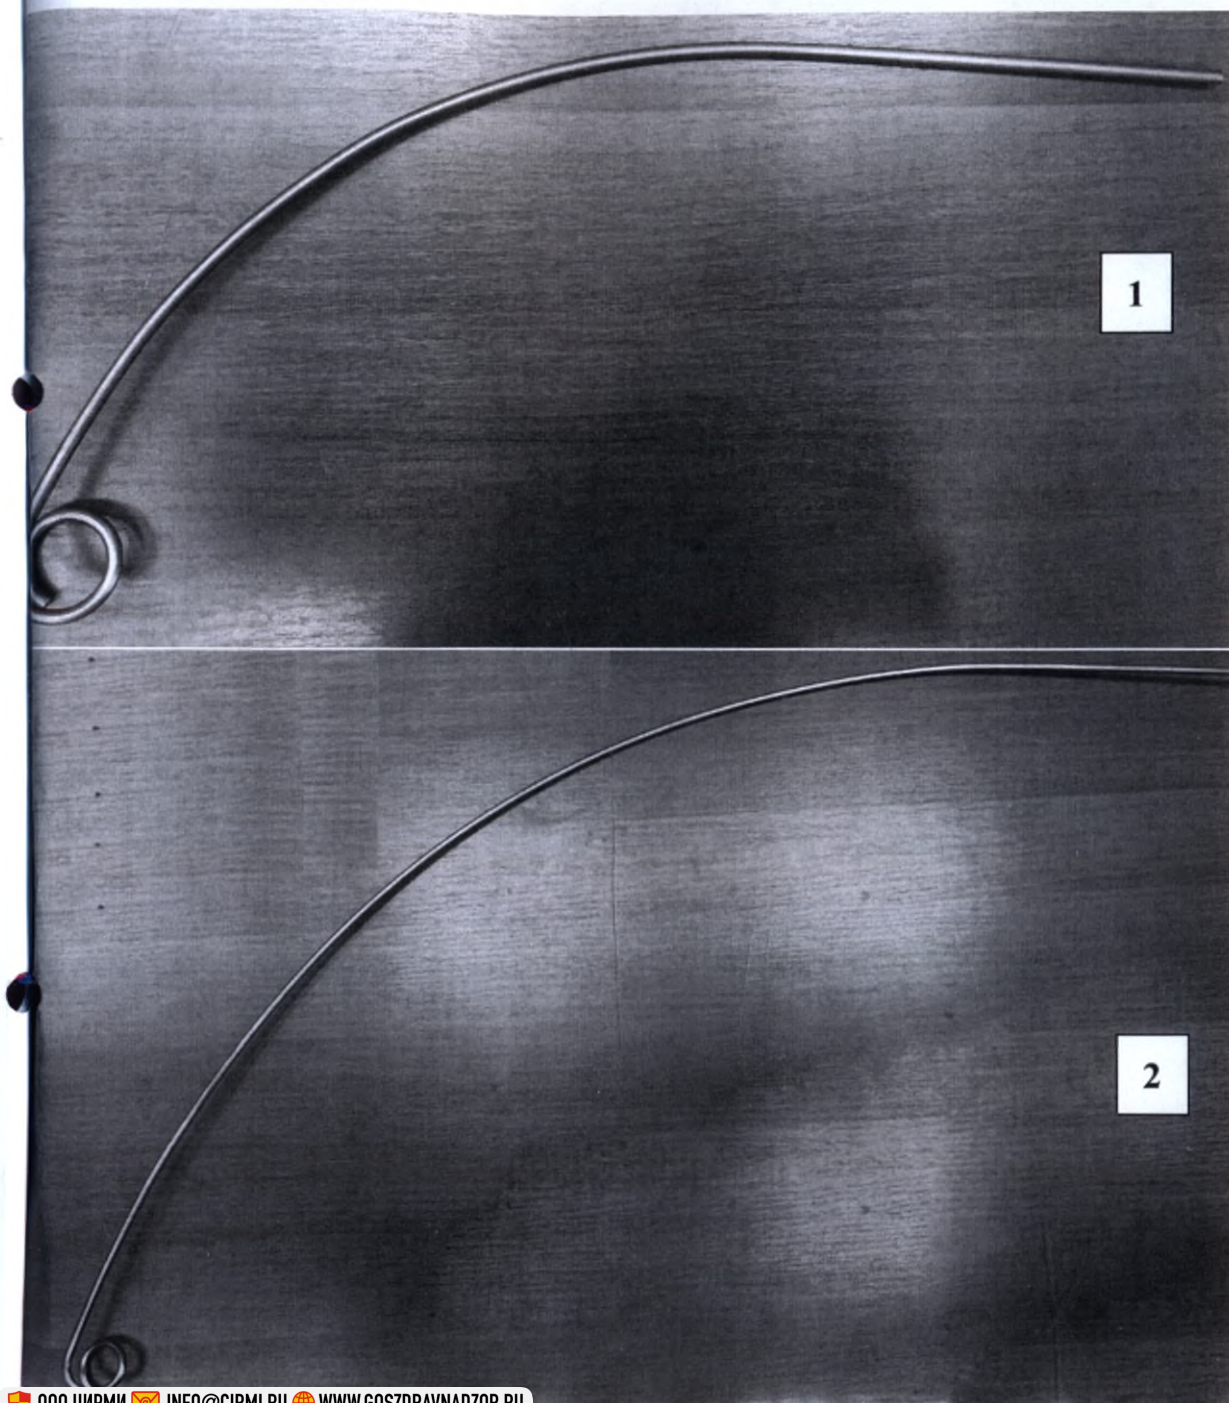

**1. Держатель инструмента
короткий**

**2. Держатель инструмента
длинный**

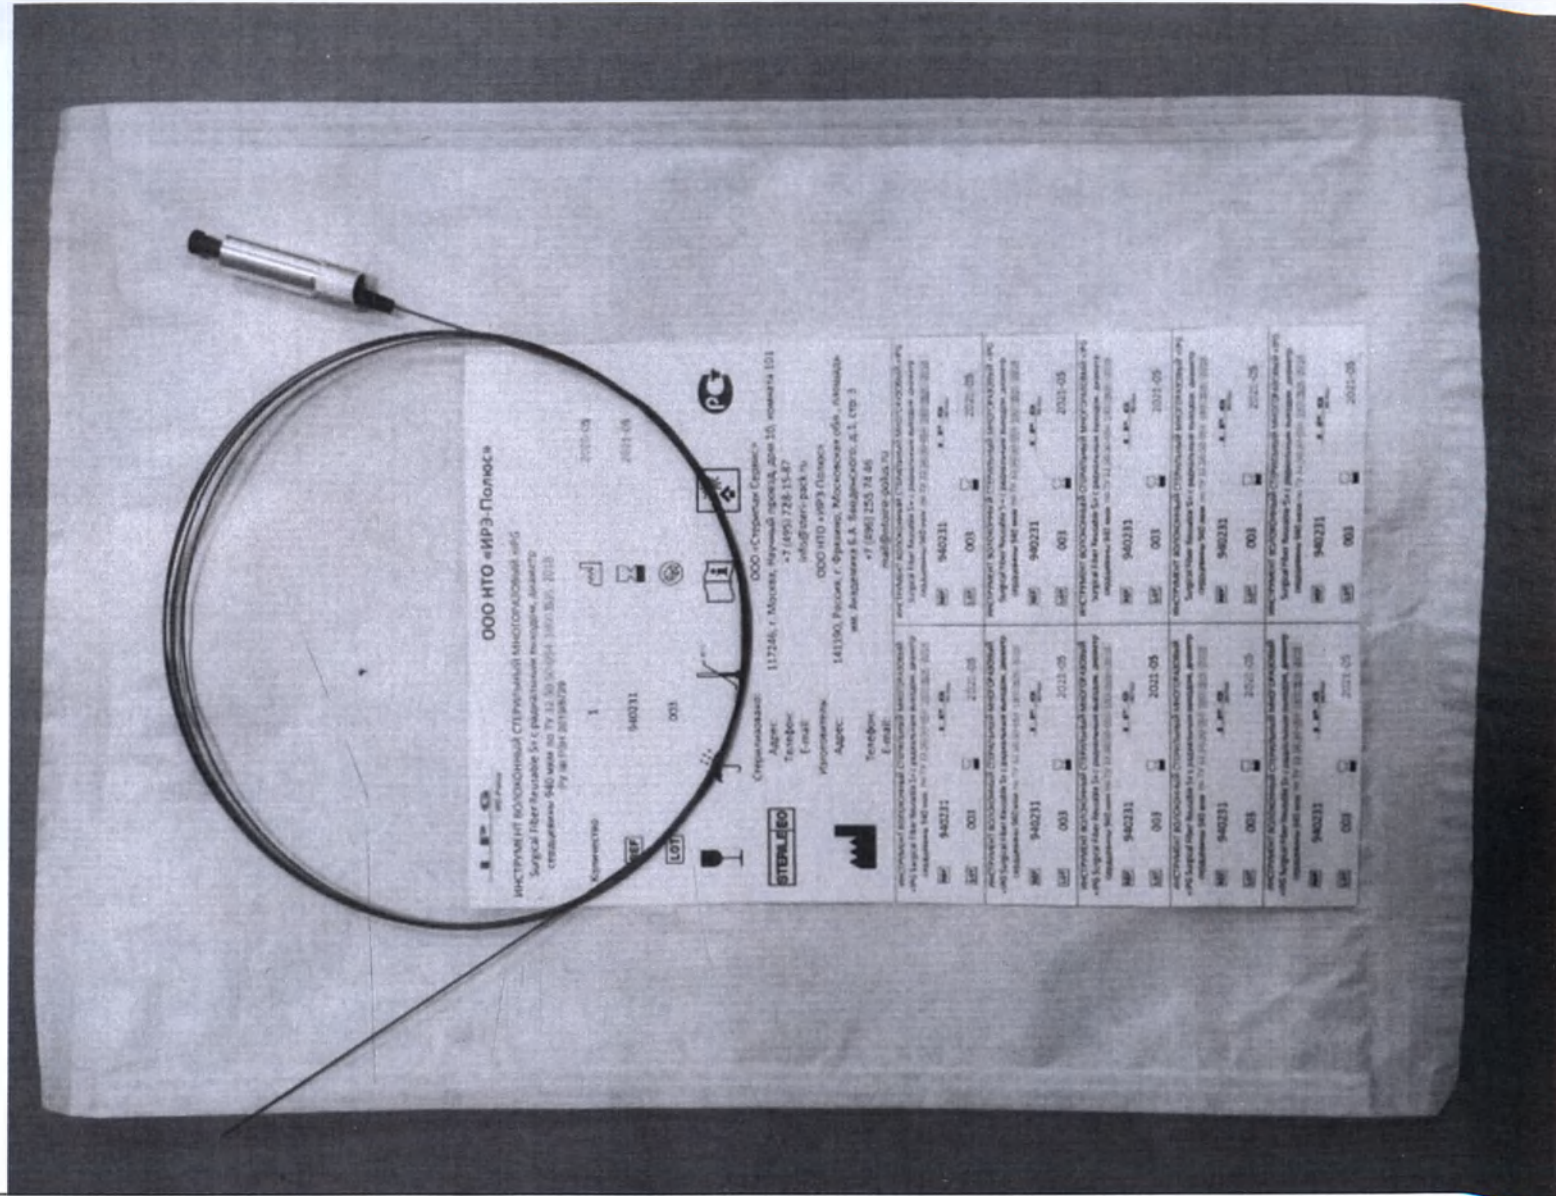

Инструмент волоконный стерильный многоцветный "IPG Surgical Fiber Reusable S" (ПУ №ПЗН 2019/8729)



Внешний вид упаковки

Печать, подпись



Э Полюс»