

15	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ		
15.1	В общих стандартах, и/или стандартах на изделия конкретных видов, и/или технических условиях должны быть установлены гарантийные сроки		С
15.2	Гарантийный срок эксплуатации изделий должен быть не менее 12 месяцев		С
15.3	Гарантийный срок хранения изделий должен быть не менее 3 месяцев		НП

3.1 Дополнить АКТ оценки результатов технических испытаний медицинского изделия № 2019-67.02 от 27.09.2019г. следующими фотографическими изображениями:




АКТу оценки результатов технических испытаний медицинского изделия № 2019-67.02 от 27.09.2019г.

Протоколу технических испытаний № 2019.TR-67.02MN от 27.09.2019г.

Протоколу оценки технической документации медицинского изделия № 2019.O-67.02MN от 27.09.2019г.

Протоколу испытаний на электромагнитную совместимость № 2019.R-67.02MN от 27.09.2019г.

Программе и методике технических испытаний № 2019-67.02 от 27.08.2019г.

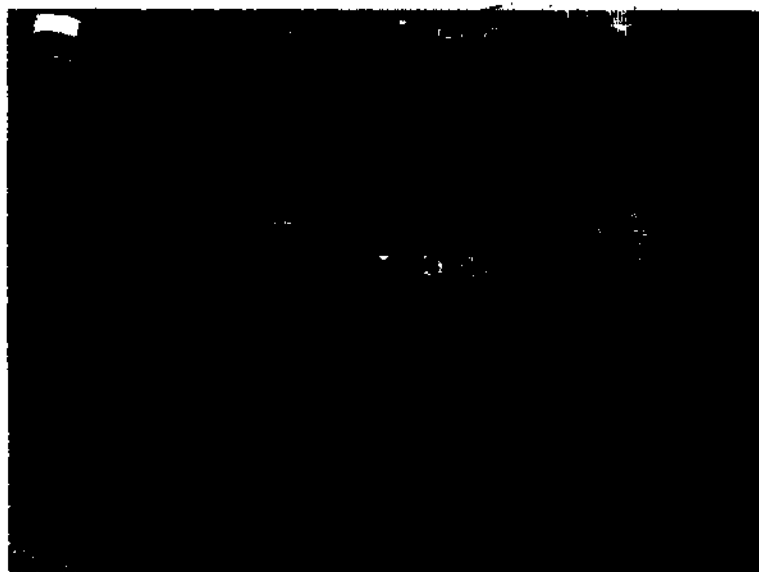


АКТу оценки результатов технических испытаний медицинского изделия № 2019-67.02 от 27.09.2019г.

Протоколу технических испытаний № 2019.TR-67.02MN от 27.09.2019г.

Протоколу оценки технической документации медицинского изделия № 2019.O-67.02MN от 27.09.2019г.

Протоколу испытаний на электромагнитную совместимость № 2019.R-67.02MN от 27.09.2019г.

Программе и методике технических испытаний № 2019-67.02 от 27.08.2019г.

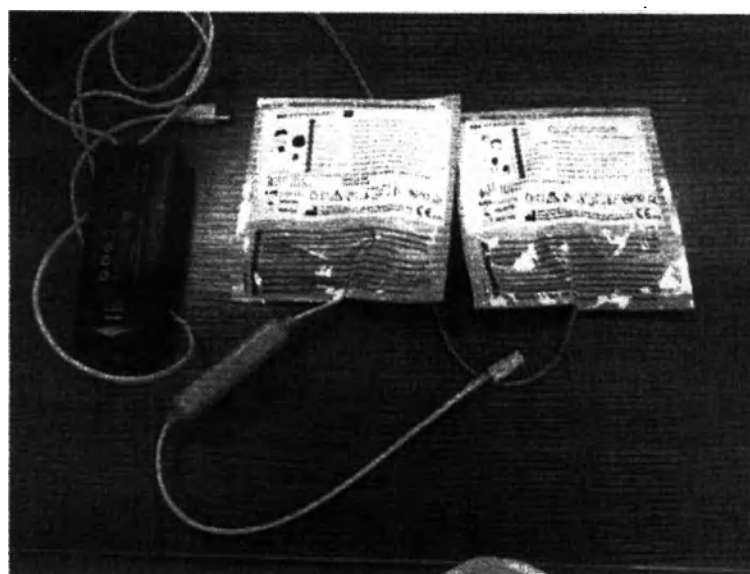

АКТу оценки результатов технических испытаний медицинского изделия № 2019-67.02 от 27.09.2019г.

Протоколу технических испытаний № 2019.TR-67.02MN от 27.09.2019г.


Протоколу оценки технической документации медицинского изделия № 2019.O-67.02MN от 27.09.2019г.

Протоколу испытаний на электромагнитную совместимость № 2019.R-67.02MN от 27.09.2019г.


Программе и методике технических испытаний № 2019-67.02 от 27.08.2019г.



АКТу оценки результатов технических испытаний медицинского изделия № 2019-67.02 от 27.09.2019г.
Протоколу технических испытаний № 2019.TR-67.02MN от 27.09.2019г.
Протоколу оценки технической документации медицинского изделия № 2019.O-67.02MN от 27.09.2019г.
Протоколу испытаний на электромагнитную совместимость № 2019.R-67.02MN от 27.09.2019г.
Программе и методике технических испытаний № 2019-67.02 от 27.08.2019г.

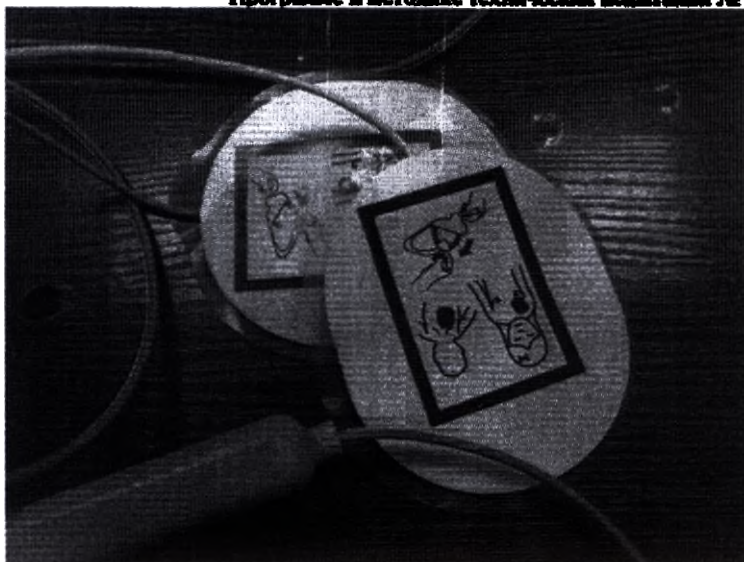

Испытания провел





Р.А. Ширшов

С.В. Кочеров