



Генеральный директор
ООО «МЕДИПЛАСТ»
Комягин С.Е.

(подпись)

М.П.

«06» июня 2021 г.

**Инструкция по применению
(для специалистов)**

Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019, в вариантах исполнения

Оглавление

1	Наименование медицинского изделия	3
2	Сведения о производителе медицинского изделия	54
3	Назначение медицинского изделия, установленное производителем	54
4	Условия применения	54
5	Принцип действия	54
6	Перечень показаний к применению, противопоказаний, возможных побочных действий	54
6.1	Показания к применению	54
6.2	Противопоказания к применению	55
6.3	Возможные побочные действия	55
6.4	Меры предосторожности и требования безопасности	55
7	Описание, параметры и характеристики медицинского изделия	56
7.1	Описание изделия	56
7.2	Методы и условия стерилизации и дезинфекции	61
8	Указания по применению	61
8.1	Общие положения	61
9	Установка и способ применения	61
9.1	Подготовка к использованию	61
9.2	Выбор размера	62
9.3	Рекомендуемый метод установки	62
9.4	Возможные риски при использовании	63
9.5	Обслуживание и ремонт	63
10	Комплектность	63
10.1	Минимальная комплектность	66
10.2	Максимальная комплектность	138
11	Упаковка	138
12	Маркировка	139
13	Условия эксплуатации	139
14	Транспортирование	139
15	Хранение	140
16	Гарантийные обязательства	140
17	Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия	140
18	Контактная информация	141
Приложение А: Манипуляционные символы, указанные на упаковке		142
Приложение Б: Внешний вид изделия		211
Приложение В: Покупные изделия		

1 Наименование медицинского изделия – Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019:

Варианты исполнения:

I. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: анестезиологические, в составе:

1. Трубка гофрированная, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубка соединительная, трубка дыхательная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или трубки дыхательного контура однократного использования (этилвинилацетат), трубки дыхательного контура однократного использования гофрированные (этиленвинилацетат) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или дыхательные шланги (длиной 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 180 см, 300 см, 400 см) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или дыхательные шланги производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или трубки дыхательные производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или дыхательные шланги в комплекте с соединителями или без: шланги для дыхательных контуров; шланги для эвакуации отработанных газов производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или трубка дыхательная производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или трубки дыхательные производства "Интаир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 6 шт.

2. Коннектор прямой, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992 - не более 15 шт.

3. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия, или угловые адаптеры производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - переходник прямой; - переходник Т-образный; - угловой производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или переходники производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или воздуховоды производства "Смите Медикал Интернэшнл Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/05401,

или коннектор (адаптор), варианты исполнения: G-311000; G-311000-1; G-311001; G-311001-1; G-311002; G-311003; G-311003-2; G-311003-3; G-311004; G-311004-2; G-311005; G-311006; G-311008-1; G-311017; G-311019; G-311019-2; G-311024; G-311031; V-1022-02; 9014-

D; G-311008; G-311008-2; G-311039; G-311003-2; G-311003-2-1; G-311004-3; G-311031-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или угловой адаптер (22 mm F - 22 mm M/15 mm F) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12372,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094, RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 5 шт.

4. Адаптер кислорода, соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 - не более 100 шт. (при необходимости).

5. Держатель контура дыхательного, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или держатель шлангов RT028 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 5 шт. (при необходимости).

6. Держатель масок, держатели для масок (длиной 440 мм и 700 мм) и фиксаторы для шлангов и трубок производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или ремни на голову BC325-10, BC328-10, BC331-10, ремни на подбородок BC351-10, BC353-10, BC355-10, BC357-10 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

7. Канюли назальные, канюли назальные для взрослых, детей и младенцев производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или канюли носовые для недоношенных детей: RT091, BC2425-20, канюли носовые для новорожденных детей: RT092, BC2435-20, канюли носовые для младенцев: RT093, BC2745-20, канюли носовые для детей: RT094, BC3780-20, канюли носовые для взрослых RT095, канюли носовые для крупных младенцев BC2755-20 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или канюли назальные кислородные MEDEREN в следующих вариантах исполнения производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2018/7623

или канюля назальная кислородная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

8. Кислородная трубка, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубки кислородные постоянного и переменного сечения производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или шланги кислородные производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или трубка кислородная (вид 156030) производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или кислородная трубка BC400-10, BC402-5, 500RD103, 500RD107, 500RD113, 900RD008, 900RD009, 900RT003 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или трубки кислородные: 900RT003, 900RD008, 900RD009 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или трубки кислородные производства "Интаир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

9. Клапаны положительного давления, клапан давления, клапан РЕЕР производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, клапаны РЕЕР производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или клапаны дыхательные производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых, для детей; предохранительные клапаны сброса; управляемые клапаны выдоха; клапаны РЕЕР; клапаны Вентури регулируемые и нерегулируемые; клапаны реверсивные и нереверсивные; клапаны с линиями мониторинга (или без) и управления производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

10. Клапан нереверсивный, одноразового использования, клапан контроля производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, управляемые клапаны выдоха, клапаны РЕЕР, клапаны Вентури, регулируемые и нерегулируемые, клапаны реверсивные и нереверсивные производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или клапаны дыхательные производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых, для детей; предохранительные клапаны сброса; клапаны нереверсивные; клапаны с линиями мониторинга (или без) производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

11. Линии контроля давления, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубка соединительная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга давления. производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или трубка измерения давления в контуре 900MR075, 900MR076, 900MR077 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

12. Линия мониторинга газов, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или трубка проксимального давления и CO₂ производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга содержания углекислого газа производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

13. Маски анестезиологические, маски анестезиологические для взрослых, детей, младенцев и новорожденных: стандартные и применяемые при МРТ, анатомические и с

воздушной подушкой, с клапаном и без, с крепежным хомутом и без, размеры № 0, №1, №2, №3, №4, №5, №6 производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маски производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или маски наркозные производства "Смите Медикал Интернэшнл Лимитед», Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/05401,

или Маска дыхательная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286

или Маски анестезиологические MEDEREN в вариантах исполнения производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/8818 - не более 100 шт. (при необходимости).

14. Маски кислородные, маски кислородные, для взрослых и детей, одиночные и в комплекте: с трубкой кислородной; с трубкой кислородной и мешком дыхательным производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маски производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или кислородная маска HC407NIV, HC431NIV, HC452NIV, RD806-10, RD807-10, 900RT004, 900RT005, 900RT006 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или маски кислородные неонатальные: RD803-10, RD804-10, RD805-10, RD806-10, RD807-10, маски кислородные для взрослых: 900RT004, 900RT005, маски кислородные для детей 900RT006 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или маска кислородная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

15. Маски аэрозольные, маски аэрозольные для взрослых и детей, одиночные и в комплекте: с нерегулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с регулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с небулайзером и без производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маска аэрозольная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

16. Маски лицевые, маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные и лицевые) различных размеров (малый, средний и большой), маски для СРАР производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или набор масок RD800-EN (5 шт.) производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или маска дыхательная однократного применения в индивидуальной упаковке с этикеткой, в следующих размерах: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6, принадлежности: маскодержатель производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7995- не более 100 шт. (при необходимости).

17. Мешок для дыхательного контура, одноразового использования, мешок резервный, производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или резервные мешки производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные мешки объёмом: 0.5л, 1.0л, 1.3л, 2.0л, 2.3л, 3.0л, 5.0л: для анестезиологических или реанимационных дыхательных контуров с петлёй или без, с открытым или закрытым концом; для аппаратуры; для оксигенации с дыхательным клапаном с трубкой или без производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или мешок дыхательный (латекс) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или мешки (дыхательные и резервные, объемом 0.5 л, 1.0 л, 2.0 л, 3.0 л) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или мешок дыхательный реанимационный для ИВЛ производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или мешки производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или мешок одноразовый, варианты исполнения: G-118000; G-118001; G-118002 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или мешки резервные дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742

или мешок дыхательный однократного применения, объем 500 мл, мешок дыхательный однократного применения, объем 1000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объем 2000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объем 3000 мл производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/6773 - не более 100 шт. (при необходимости).

18. Монитор давления, линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 - не более 100 шт. (при необходимости).

19. Мундштук, мундштуки производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или мундштуки (загубники) производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

20. Распылитель аэрозоля (небулайзер), небулайзеры (распылители трахеобронхиального и альвеолярного осаждения) и резервуары небулайзеров, одиночные и в наборах (с маской аэрозольной, с коннектором или без, с фильтром или без, с кислородной трубкой) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или распылители (небулайзеры) производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или небулайзеры дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

21. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или коннектор угловой производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286, или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: жесткие; эластомерные; гибкие; шарнирные; прямые; угловые; Т-образные; Y-образные; адаптеры производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или гибкие соединители дыхательного контура производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннектор (угольник), варианты исполнения: G-311011; G-311012; G-311015; G-311015-0; G-311015-1; G-311015-R; G-311015-R2; G-311022; G-311025; G-311025-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094, RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или переходники для дыхательных контуров производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

22. Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, фильтры тепловлагообменные: фильтры тепловлагообменные угловой конфигурации: взрослые, педиатрические, взрослые/педиатрические, фильтры тепловлагообменные прямые: взрослые, педиатрические, взрослые/педиатрические производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или фильтры производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или фильтры производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или фильтры производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020 производства АО "НПП "ИНТЕРОКО", Россия, РУ № ФСР 2011/11397,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции легких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8405,

или фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции легких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8705,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником НЕРА, фильтр дыхательный бактериально-вирусный педиатрический с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный педиатрический с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный неонатальный с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор. , фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана и кислородной трубкой, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги и кислородной трубкой, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, Т-образный, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги и кислородной трубкой, Т-образный, для трахеостомы производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/9010,

или фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, НЕРА, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, угловой, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, НЕРА, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, Ø 15F, с

кислородным портом Ø 6 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 6 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 5 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 3 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 2 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Small, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, угловой Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Small, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2020/9671 - не более 100 шт. (при необходимости).

23. Термометр, термометр 900MR033 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

24. Тест-колпачок защитный по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

25. Тестовое легкое, тестовые легкие: RD020-01, 500RD106 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 2 шт. (при необходимости).

26. Фильтры дыхательные, Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020 производства АО "НПП "ИНТЕРОКО", Россия, РУ № ФСР 2011/11397,

или фильтр вирусный производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или фильтры производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или фильтры производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные вирусно-бактериальные фильтры в комплекте с соединителями или без: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или фильтры производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или фильтр дыхательный производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или фильтр, варианты исполнения: 800-51700-0; 800-51700; 800-61600; 800-51900; 800-51900-0; 800-51900-11; 800-51800; 800-52000; 800-51500; 800-51600; 800-54011; 800-52300 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или фильтр RT019, RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или фильтр выдоха RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или фильтры дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7282,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8405,

или фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8705,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный НЕРА производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/9010,

или фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22M/15F, 22F, фильтр дыхательный линии давления 0,2 µm производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2020/9671 - не более 100 шт. (при необходимости).

II. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: анестезиологические, циркуляционные, в составе:

1. Трубка гофрированная, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубка соединительная, трубка дыхательная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или трубки дыхательного контура однократного использования (этилвинилацетат), трубки дыхательного контура однократного использования гофрированные (этиленвинилацетат) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или дыхательные шланги (длиной 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 180 см, 300 см, 400 см) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или дыхательные шланги производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или трубки дыхательные производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или дыхательные шланги в комплекте с соединителями или без: шланги для дыхательных контуров; шланги для эвакуации отработанных газов производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или трубка дыхательная производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или трубки дыхательные производства "Интаир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 20 шт.

2. Y-образный коннектор, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или коннектор Y-образный производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или Y-образный адаптер (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннекторы (Y-образные) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: Y-образные производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - тройник пациента производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или коннектор (тройник пациента), варианты исполнения: E-1030-01-2; G-311010; E-1031-04; G-313005; G-313005-00; G-313005-00-1; G-313005-11; G-313005-11-1; G-311010-1;

G-311030; G-311032 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или тройник пациента RT029, 900MR125, 900MR126, 900MR126C, 900MR126L, 900MR127, 900MR128, 900MR128L, 900MR136, 900MR138, 900MR145, 900MR145C производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или тройник пациента неонатальный RT029 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 3 шт.

3. Адаптер кислорода, соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 - не более 100 шт. (при необходимости).

4. Влагосборник, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или влагосборник производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или влагосборники: - влагосборник однократного использования (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол) производства Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или влагосборники для дыхательных контуров для взрослых и детей производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или влагосборники производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или влагосборники для дыхательных контуров для взрослых, для детей и для новорождённых. производства "Интересджикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или влагосборники производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или влагосборник одноразовый, варианты исполнения: G-313001; G-313001-0; G-313001-00; G-313001-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или влагосборник 900MR139, 900MR139C производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или влагосборники дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

5. Держатель контура дыхательного, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или держатель шлангов RT028 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 5 шт.

6. Держатель масок, держатели для масок (длиной 440 мм и 700 мм) и фиксаторы для шлангов и трубок производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или ремни на голову BC325-10, BC328-10, BC331-10, ремни на подбородок BC351-10, BC353-10, BC355-10, BC357-10 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

7. Канюли назальные, канюли назальные для взрослых, детей и младенцев производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или канюли носовые для недоношенных детей: RT091, BC2425-20, канюли носовые для новорожденных детей: RT092, BC2435-20, канюли носовые для младенцев: RT093, BC2745-20, канюли носовые для детей: RT094, BC3780-20, канюли носовые для взрослых RT095, канюли носовые для крупных младенцев BC2755-20 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или канюли назальные кислородные MEDEREN в следующих вариантах исполнения производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2018/7623

или канюля назальная кислородная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

8. Канюли назальные (типа RAM), канюли назальные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229,
- не более 100 шт. (при необходимости).

9. Кислородная трубка, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубки кислородные постоянного и переменного сечения производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или шланги кислородные производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или трубка кислородная (вид 156030) производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или кислородная трубка BC400-10, BC402-5, 500RD103, 500RD107, 500RD113, 900RD008, 900RD009, 900RT003 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или трубки кислородные: 900RT003, 900RD008, 900RD009 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или трубки кислородные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

10. Клапаны положительного давления, клапан давления, клапан РЕЕР производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, клапаны РЕЕР производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или клапаны дыхательные производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых, для детей; предохранительные клапаны сброса; управляемые клапаны выдоха; клапаны РЕЕР; клапаны Вентури регулируемые и нерегулируемые; клапаны реверсивные и нереверсивные; клапаны с линиями мониторинга (или без) и управления производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

11. Клапан нереверсивный, клапан контроля производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, управляемые клапаны выдоха, клапаны РЕЕР, клапаны Вентури, регулируемые и нерегулируемые, клапаны реверсивные и нереверсивные производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или клапаны дыхательные производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых, для детей; предохранительные клапаны сброса; клапаны нереверсивные; клапаны с линиями мониторинга (или без) производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

12. Линии контроля давления, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубка соединительная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга давления. производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или трубка измерения давления в контуре 900MR075, 900MR076, 900MR077 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

13. Линия мониторинга газов, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или трубка проксимального давления и CO2 производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга содержания углекислого газа производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

14. Маски анестезиологические, маски анестезиологические для взрослых, детей, младенцев и новорожденных: стандартные и применяемые при МРТ, анатомические и с воздушной подушкой, с клапаном и без, с крепежным хомутом и без, размеры № 0, №1, №2, №3, №4, №5, №6 производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маски производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или маски наркозные производства "Смите Медикал Интернэшнл Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/05401,

или Маска дыхательная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286

или Маски анестезиологические MEDEREN в вариантах исполнения производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/8818 - не более 100 шт. (при необходимости).

15. Маски кислородные, маски кислородные, для взрослых и детей, одиночные и в комплекте: с трубкой кислородной; с трубкой кислородной и мешком дыхательным производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маски производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или кислородная маска HC407NIV, HC431NIV, HC452NIV, RD806-10, RD807-10, 900RT004, 900RT005, 900RT006 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или маски кислородные неонатальные: RD803-10, RD804-10, RD805-10, RD806-10, RD807-10, маски кислородные для взрослых: 900RT004, 900RT005, маски кислородные для детей 900RT006 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или маска кислородная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

16. Маски аэрозольные, маски аэрозольные для взрослых и детей, одиночные и в комплекте: с нерегулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с регулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с небулайзером и без производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маска аэрозольная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

17. Маски лицевые, маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные и лицевые) различных размеров (малый, средний и большой), маски для СРАР производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или набор масок RD800-EN (5 шт.) производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или маска дыхательная однократного применения в индивидуальной упаковке с этикеткой, в следующих размерах: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6, принадлежности: маскодержатель производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7995 - не более 100 шт. (при необходимости).

18. Мешок для дыхательного контура, одноразового использования, мешок резервный, производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или резервные мешки производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные мешки объёмом: 0.5л, 1.0л, 1.3л, 2.0л, 2.3л, 3.0л, 5.0л: для анестезиологических или реанимационных дыхательных контуров с петлёй или без, с открытым или закрытым концом; для аппаратуры; для оксигенации с дыхательным клапаном с трубкой или без производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или мешок дыхательный (латекс) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или мешки (дыхательные и резервные, объемом 0.5 л, 1.0 л, 2.0 л, 3.0 л) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или мешок дыхательный реанимационный для ИВЛ производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или мешки производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или мешок одноразовый, варианты исполнения: G-118000; G-118001; G-118002 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или мешки резервные дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742

или мешок дыхательный однократного применения, объём 500 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 1000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 2000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 3000 мл производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/6773 - не более 100 шт. (при необходимости).

19. Монитор давления, линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 - не более 100 шт. (при необходимости).

20. Мундштук, мундштуки производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или мундштуки (загубники) производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

21. Распылитель аэрозоля (небулайзер), небулайзеры (распылители трахеобронхиального и альвеолярного осаждения) и резервуары небулайзеров, одиночные и в наборах (с маской аэрозольной, с коннектором или без, с фильтром или без, с кислородной трубкой) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или распылители (небулайзеры) производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или небулайзеры дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

22. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или коннектор угловой производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286, или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: жесткие; эластомерные; гибкие; шарнирные; прямые; угловые; Т-образные; Y-образные; адаптеры производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или гибкие соединители дыхательного контура производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннектор (угольник), варианты исполнения: G-311011; G-311012; G-311015; G-311015-0; G-311015-1; G-311015-R; G-311015-R2; G-311022; G-311025; G-311025-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094, RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или переходники для дыхательных контуров производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

23. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или угловые адаптеры производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - переходник прямой; - переходник Т-образный; - угловой производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или переходники производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или воздуховоды производства "Смите Медикал Интернэшнл Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/05401,

или коннектор (адаптор), варианты исполнения: G-311000; G-311000-1; G-311001; G-311001-1; G-311002; G-311003; G-311003-2; G-311003-3; G-311004; G-311004-2; G-311005; G-311006; G-311008-1; G-311017; G-311019; G-311019-2; G-311024; G-311031; V-1022-02; 9014-D; G-311008; G-311008-2; G-311039; G-311003-2; G-311003-2-1; G-311004-3; G-311031-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или угловой адаптер (22 mm F - 22 mm M/15 mm F) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12372,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094,

RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 100 шт.

24. Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, фильтры тепловлагообменные: фильтры тепловлагообменные угловой конфигурации: взрослые, педиатрические, взрослые/педиатрические, фильтры тепловлагообменные прямые: взрослые, педиатрические, взрослые/педиатрические производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или фильтры производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или фильтры производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или фильтры производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020 производства АО "НПП "ИНТЕРОКО", Россия, РУ № ФСР 2011/11397,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции легких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8405,

или фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции легких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8705,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником НЕРА, фильтр дыхательный бактериально-вирусный педиатрический с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный педиатрический с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный неонатальный с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор, , фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана и кислородной трубкой, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги и кислородной трубкой, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, Т-образный, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги и кислородной трубкой, Т-образный, для трахеостомы производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/9010,

или фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, НЕРА, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, угловой, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, НЕРА, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, Ø 15F, с

кислородным портом Ø 6 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 6 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 5 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 3 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 2 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, угловой Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2020/9671 - не более 100 шт. (при необходимости).

25. Термометр, термометр 900MR033 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

26. Тест-колпачок защитный по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

27. Тестовое легкое, тестовые легкие: RD020-01, 500RD106 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 2 шт. (при необходимости).

28. Фильтры дыхательные, Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020 производства АО "НПП "ИНТЕРОКО", Россия, РУ № ФСР 2011/11397,

или фильтр вирусный производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или фильтры производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или фильтры производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные вирусно-бактериальные фильтры в комплекте с соединителями или без: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или фильтры производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или фильтр дыхательный производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или фильтр, варианты исполнения: 800-51700-0; 800-51700; 800-61600; 800-51900; 800-51900-0; 800-51900-11; 800-51800; 800-52000; 800-51500; 800-51600; 800-54011; 800-52300 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или фильтр RT019, RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или фильтр выдоха RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или фильтры дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7282,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8405,

или фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8705,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный НЕРА производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/9010,

или фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22M/15F, 22F, фильтр дыхательный линии давления 0,2 µm производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2020/9671 - не более 100 шт. (при необходимости).

III. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения; реанимационные, в составе:

1. Трубка гофрированная, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубка соединительная, трубка дыхательная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или трубки дыхательного контура однократного использования (этилвинилацетат), трубки дыхательного контура однократного использования гофрированные (этиленвинилацетат) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или дыхательные шланги (длиной 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 180 см, 300 см, 400 см) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или дыхательные шланги производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или трубки дыхательные производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или дыхательные шланги в комплекте с соединителями или без: шланги для дыхательных контуров; шланги для эвакуации отработанных газов производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или трубка дыхательная производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или трубки дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 6 шт.

2. Коннектор прямой, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992 - не более 15 шт.

3. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или угловые адаптеры производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - переходник прямой; - переходник Т-образный; - угловой производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или переходники производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или воздуховоды производства "Смите Медикал Интернэшнл Лимитед», Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/05401,

или коннектор (адаптор), варианты исполнения: G-311000; G-311000-1; G-311001; G-311001-1; G-311002; G-311003; G-311003-2; G-311003-3; G-311004; G-311004-2; G-311005; G-311006; G-311008-1; G-311017; G-311019; G-311019-2; G-311024; G-311031; V-1022-02; 9014-D; G-311008; G-311008-2; G-311039; G-311003-2; G-311003-2-1; G-311004-3; G-311031-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или угловой адаптер (22 mm F - 22 mm M/15 mm F) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12372,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094, RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 5 шт.

4. Адаптер кислорода, соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 - не более 100 шт. (при необходимости).

5. Влагосборник, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или влагосборник производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или влагосборники: - влагосборник однократного использования (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол) производства Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или влагосборники для дыхательных контуров для взрослых и детей производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или влагосборники производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или влагосборники для дыхательных контуров для взрослых, для детей и для новорождённых. производства "Интересджикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или влагосборники производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или влагосборник одноразовый, варианты исполнения: G-313001; G-313001-0; G-313001-00; G-313001-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или влагосборник 900MR139, 900MR139C производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или влагосборники дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

6. Генератор дыхания, производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229 - не более 100 шт. (при необходимости).

7. Держатель контура дыхательного, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или держатель шлангов RT028 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 5 шт. (при необходимости).

8. Держатель масок, держатели для масок (длиной 440 мм и 700 мм) и фиксаторы для шлангов и трубок производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566, или ремни на голову ВС325-10, ВС328-10, ВС331-10, ремни на подбородок ВС351-10, ВС353-10, ВС355-10, ВС357-10 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

9. Канюли для СРАР-терапии, канюли назальные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229

Или канюли назальные СРАР производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286

- не более 100 шт. (при необходимости).

10. Канюли назальные, канюли назальные для взрослых, детей и младенцев производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или канюли носовые для недоношенных детей: RT091, BC2425-20, канюли носовые для новорожденных детей: RT092, BC2435-20, канюли носовые для младенцев: RT093, BC2745-20, канюли носовые для детей: RT094, BC3780-20, канюли носовые для взрослых RT095, канюли носовые для крупных младенцев BC2755-20 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или канюли назальные кислородные MEDEREN в следующих вариантах исполнения производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2018/7623

или канюля назальная кислородная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

11. Канюли назальные (типа RAM), канюли назальные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229,

- не более 100 шт. (при необходимости).

12. Кислородная трубка, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубки кислородные постоянного и переменного сечения производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или шланги кислородные производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или трубка кислородная (вид 156030) производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или кислородная трубка BC400-10, BC402-5, 500RD103, 500RD107, 500RD113, 900RD008, 900RD009, 900RT003 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или трубки кислородные: 900RT003, 900RD008, 900RD009 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или трубки кислородные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

13. Камера для увлажнителей дыхательных смесей, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или увлажнители (камеры увлажнителя) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или камера увлажнителя MR225, MR225X, MR250, MR250X, MR290, MR290X, MR340, MR370 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или камеры увлажнителя взрослые: MR210, MR210X, MR250, MR250X, камеры увлажнителя детские: MR225, MR225X, камеры увлажнителя универсальные: MR290, MR290X, MR290U, MR290UX, MR290V, MR290VX, MR290HFV, производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или увлажнители дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742,

или увлажнители производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или Камера увлажнителя (вид 185610) производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053 – не более 100 шт. (при необходимости).

14. Клапан выдоха, клапан вдоха/выдоха производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или дыхательные клапаны: управляемые клапаны выдоха; клапаны с линиями мониторинга (или без) и управления производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, управляемые клапаны выдоха, клапаны РЕЕР, клапаны Вентури, регулируемые и нерегулируемые, клапаны реверсивные и неререверсивные производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или клапаны дыхательные производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992 - не более 100 шт. (при необходимости).

15. Клапаны положительного давления, клапан давления, клапан РЕЕР производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, клапаны РЕЕР производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или клапаны дыхательные производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых, для детей; предохранительные клапаны сброса; управляемые клапаны выдоха; клапаны РЕЕР; клапаны Вентури регулируемые и нерегулируемые; клапаны реверсивные и неререверсивные; клапаны с линиями мониторинга (или без) и управления производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

16. Клапан неререверсивный, одноразового использования, клапан контроля производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, управляемые клапаны выдоха, клапаны РЕЕР, клапаны Вентури, регулируемые и нерегулируемые, клапаны реверсивные и неререверсивные производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или клапаны дыхательные производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых, для детей; предохранительные клапаны сброса; клапаны неререверсивные; клапаны с линиями мониторинга (или без) производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

17. Линии контроля давления, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубка соединительная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга давления. производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или трубка измерения давления в контуре 900MR075, 900MR076, 900MR077 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

18. Линия мониторинга газов, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или трубка проксимального давления и CO2 производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга содержания углекислого газа производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

19. Линия подачи воды по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

20. Маски анестезиологические, маски анестезиологические для взрослых, детей, младенцев и новорожденных: стандартные и применяемые при МРТ, анатомические и с воздушной подушкой, с клапаном и без, с крепежным хомутом и без, размеры № 0, №1, №2, №3, №4, №5, №6 производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маски производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или маски наркозные производства "Смите Медикал Интернэшнл Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/05401,

или Маска дыхательная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286

или Маски анестезиологические MEDEREN в вариантах исполнения производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/8818 - не более 100 шт. (при необходимости).

21. Маски кислородные, маски кислородные, для взрослых и детей, одиночные и в комплекте: с трубкой кислородной; с трубкой кислородной и мешком дыхательным производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маски производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или кислородная маска HC407NIV, HC431NIV, HC452NIV, RD806-10, RD807-10, 900RT004, 900RT005, 900RT006 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или маски кислородные неонатальные: RD803-10, RD804-10, RD805-10, RD806-10, RD807-10, маски кислородные для взрослых: 900RT004, 900RT005, маски кислородные для детей 900RT006 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или маска кислородная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

22. Маски аэрозольные, маски аэрозольные для взрослых и детей, одиночные и в комплекте: с нерегулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с регулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с небулайзером и без производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маска аэрозольная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

23. Маска носовая аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях, маски лицевые дыхательные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229,

или маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные) различных размеров (малый, средний и большой) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маски носовые: RT033, RT034, RT042, RT050, RT051, RT052 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 100 шт. (при необходимости).

24. Маска лицевая аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях, одноразового использования, маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: маски для СРАР производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маска СРАР/NIPPV производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

25. Маски лицевые, маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные и лицевые) различных размеров (малый, средний и большой), маски для СРАР производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или набор масок RD800-EN (5 шт.) производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или маска дыхательная однократного применения в индивидуальной упаковке с этикеткой, в следующих размерах: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6, принадлежности: маскодержатель производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7995 - не более 100 шт. (при необходимости).

26. Мешок для дыхательного контура, одноразового использования, мешок резервный, производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или резервные мешки производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные мешки объёмом: 0.5л, 1.0л, 1.3л, 2.0л, 2.3л, 3.0л, 5.0л: для анестезиологических или реанимационных дыхательных контуров с петлёй или без, с открытым или закрытым концом; для аппаратуры; для оксигенации с дыхательным клапаном с трубкой или без производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или мешок дыхательный (латекс) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или мешки (дыхательные и резервные, объемом 0.5 л, 1.0 л, 2.0 л, 3.0 л) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или мешок дыхательный реанимационный для ИВЛ производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или мешки производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или мешок одноразовый, варианты исполнения: G-118000; G-118001; G-118002 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или мешки резервные дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742

или мешок дыхательный однократного применения, объём 500 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 1000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 2000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 3000 мл производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/6773 - не более 100 шт. (при необходимости).

27. Монитор давления, линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления) производства

"ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 - не более 100 шт. (при необходимости).

28. Мундштук, мундштуки производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или мундштуки (загубники) производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

29. Отражатели тепла, отражатели тепла: 900MR208, NC040-10, NC041-10 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 100 шт. (при необходимости).

30. Распылитель аэрозоля (небулайзер), небулайзеры (распылители трахеобронхиального и альвеолярного осаждения) и резервуары небулайзеров, одиночные и в наборах (с маской аэрозольной, с коннектором или без, с фильтром или без, с кислородной трубкой) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или распылители (небулайзеры) производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или небулайзеры дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

31. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или коннектор угловой производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286, или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: жесткие; эластомерные; гибкие; шарнирные; прямые; угловые; Т-образные; Y-образные; адаптеры производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или гибкие соединители дыхательного контура производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннектор (угольник), варианты исполнения: G-311011; G-311012; G-311015; G-311015-0; G-311015-1; G-311015-R; G-311015-R2; G-311022; G-311025; G-311025-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094, RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или переходники для дыхательных контуров производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

32. Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, фильтры тепловлагообменные: фильтры тепловлагообменные угловой конфигурации: взрослые, педиатрические, взрослые/педиатрические, фильтры тепловлагообменные прямые: взрослые, педиатрические, взрослые/педиатрические производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или фильтры производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или фильтры производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или фильтры производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020 производства АО "НПП "ИНТЕРОКО", Россия, РУ № ФСР 2011/11397,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции легких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8405,

или фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции легких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8705,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником НЕРА, фильтр дыхательный бактериально-вирусный педиатрический с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный педиатрический с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный неонатальный с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор, , фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана и кислородной трубкой, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги и кислородной трубкой, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, Т-образный, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги и кислородной трубкой, Т-образный, для трахеостомы производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/9010,

или фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, НЕРА, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, угловой, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, НЕРА, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, Ø 15F, с кислородным портом Ø 6 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 6 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 5 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 3 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 2 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, угловой Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2020/9671 - не более 100 шт. (при необходимости).

33. Термометр, термометр 900MR033 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

34. Тест-колпачок защитный по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

35. Фильтры дыхательные, Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020 производства АО "НПП "ИНТЕРОКО", Россия, РУ № ФСР 2011/11397,

или фильтр вирусный производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или фильтры производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или фильтры производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные вирусно-бактериальные фильтры в комплекте с соединителями или без: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или фильтры производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или фильтр дыхательный производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или фильтр, варианты исполнения: 800-51700-0; 800-51700; 800-61600; 800-51900; 800-51900-0; 800-51900-11; 800-51800; 800-52000; 800-51500; 800-51600; 800-54011; 800-52300 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или фильтр RT019, RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или фильтр выдоха RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или фильтры дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7282,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8405,

или фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8705,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный НЕРА производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/9010,

или фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22M/15F, 22F, фильтр дыхательный линии давления 0,2 µm производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2020/9671 - не более 100 шт. (при необходимости).

36. Шапочки-фиксаторы дыхательные, шапочки-фиксаторы дыхательные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229,

или колпак BC300-05, BC303-05, BC306-05, BC309-05, BC360-SK производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

37. Y-образный коннектор, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или коннектор Y-образный производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или Y-образный адаптер (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,
или коннекторы (Y-образные) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: Y-образные производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - тройник пациента производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или коннектор (тройник пациента), варианты исполнения: E-1030-01-2; G-311010; E-1031-04; G-313005; G-313005-00; G-313005-00-1; G-313005-11; G-313005-11-1; G-311010-1; G-311030; G-311032 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или тройник пациента RT029, 900MR125, 900MR126, 900MR126C, 900MR126L, 900MR127, 900MR128, 900MR128L, 900MR136, 900MR138, 900MR145, 900MR145C производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или тройник пациента неонатальный RT029 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 100 шт. (при необходимости).

IV. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: реанимационные, циркуляционные, в составе:

1. Трубка гофрированная, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 6 шт.

2. Коннектор прямой, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992 - не более 20 шт.

3. Y-образный коннектор, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или коннектор Y-образный производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или Y-образный адаптер (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннекторы (Y-образные) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: Y-образные производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - тройник пациента производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или коннектор (тройник пациента), варианты исполнения: E-1030-01-2; G-311010; E-1031-04; G-313005; G-313005-00; G-313005-00-1; G-313005-11; G-313005-11-1; G-311010-1; G-311030; G-311032 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или тройник пациента RT029, 900MR125, 900MR126, 900MR126C, 900MR126L, 900MR127, 900MR128, 900MR128L, 900MR136, 900MR138, 900MR145, 900MR145C производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или тройник пациента неонатальный RT029 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 3 шт.

4. Адаптер кислорода, соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 - не более 100 шт. (при необходимости).

5. Влагосборник, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или влагосборник производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или влагосборники: - влагосборник однократного использования (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол) производства Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или влагосборники для дыхательных контуров для взрослых и детей производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или влагосборники производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или влагосборники для дыхательных контуров для взрослых, для детей и для новорождённых. производства "Интересджикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или влагосборники производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или влагосборник одноразовый, варианты исполнения: G-313001; G-313001-0; G-313001-00; G-313001-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или влагосборник 900MR139, 900MR139C производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или влагосборники дыхательные производства "Интаир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

6. Держатель контура дыхательного, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или держатель шлангов RT028 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 5 шт. (при необходимости).

7. Держатель масок, держатели для масок (длиной 440 мм и 700 мм) и фиксаторы для шлангов и трубок производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или ремни на голову BC325-10, BC328-10, BC331-10, ремни на подбородок BC351-10, BC353-10, BC355-10, BC357-10 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

8. Канюли для СРАР-терапии, канюли назальные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229

Или канюли назальные СРАР производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286

- не более 100 шт. (при необходимости).

9. Канюли назальные, канюли назальные для взрослых, детей и младенцев производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или канюли носовые для недоношенных детей: RT091, BC2425-20, канюли носовые для новорожденных детей: RT092, BC2435-20, канюли носовые для младенцев: RT093, BC2745-20, канюли носовые для детей: RT094, BC3780-20, канюли носовые для взрослых RT095, канюли носовые для крупных младенцев BC2755-20 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или канюли назальные кислородные MEDEREN в следующих вариантах исполнения производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2018/7623

или канюля назальная кислородная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

10. Канюли назальные (типа RAM), канюли назальные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229,

- не более 100 шт. (при необходимости).

11. Кислородная трубка, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубки кислородные постоянного и переменного сечения производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или шланги кислородные производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или трубка кислородная (вид 156030) производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или кислородная трубка BC400-10, BC402-5, 500RD103, 500RD107, 500RD113, 900RD008, 900RD009, 900RT003 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или трубки кислородные: 900RT003, 900RD008, 900RD009 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или трубки кислородные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

12. Камера для увлажнителей дыхательных смесей, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или увлажнители (камеры увлажнителя) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или камера увлажнителя MR225, MR225X, MR250, MR250X, MR290, MR290X, MR340, MR370 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или камеры увлажнителя взрослые: MR210, MR210X, MR250, MR250X, камеры увлажнителя детские: MR225, MR225X, камеры увлажнителя универсальные: MR290, MR290X, MR290U, MR290UX, MR290V, MR290VX, MR290HFV, производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или увлажнители дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742,

или увлажнители производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или Камера увлажнителя (вид 185610) производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053 – не более 100 шт. (при необходимости).

13. Клапан выдоха, клапан вдоха/выдоха производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или дыхательные клапаны: управляемые клапаны выдоха; клапаны с линиями мониторинга (или без) и управления производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, управляемые клапаны выдоха, клапаны РЕЕР, клапаны Вентури, регулируемые и нерегулируемые, клапаны реверсивные и нереверсивные производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или клапаны дыхательные производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992 - не более 100 шт. (при необходимости).

14. Клапаны положительного давления, клапан давления, клапан РЕЕР производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, клапаны РЕЕР производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или клапаны дыхательные производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых, для детей; предохранительные клапаны сброса; управляемые клапаны выдоха; клапаны РЕЕР; клапаны Вентури регулируемые и нерегулируемые; клапаны реверсивные и нереверсивные; клапаны с линиями мониторинга (или без) и управления производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

15. Клапан нереверсивный, одноразового использования, клапан контроля производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, управляемые клапаны выдоха, клапаны РЕЕР, клапаны Вентури, регулируемые и нерегулируемые, клапаны реверсивные и нереверсивные производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или клапаны дыхательные производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых, для детей; предохранительные клапаны сброса; клапаны нереверсивные; клапаны с линиями мониторинга (или без) производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

16. Линии контроля давления, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубка соединительная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга давления. производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или трубка измерения давления в контуре 900MR075, 900MR076, 900MR077 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

17. Линия мониторинга газов, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или трубка проксимального давления и CO₂ производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга содержания углекислого газа производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

18. Линия подачи воды по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

19. Маски анестезиологические, маски анестезиологические для взрослых, детей, младенцев и новорожденных: стандартные и применяемые при МРТ, анатомические и с воздушной подушкой, с клапаном и без, с крепежным хомутом и без, размеры № 0, №1, №2, №3, №4, №5, №6 производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маски производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или маски наркозные производства "Смите Медикал Интернэшнл Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/05401,

или Маска дыхательная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286

или Маски анестезиологические MEDEREN в вариантах исполнения производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/8818 - не более 100 шт. (при необходимости).

20. Маски кислородные, маски кислородные, для взрослых и детей, одиночные и в комплекте: с трубкой кислородной; с трубкой кислородной и мешком дыхательным производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маски производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или кислородная маска HC407NIV, HC431NIV, HC452NIV, RD806-10, RD807-10, 900RT004, 900RT005, 900RT006 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или маски кислородные неонатальные: RD803-10, RD804-10, RD805-10, RD806-10, RD807-10, маски кислородные для взрослых: 900RT004, 900RT005, маски кислородные для детей 900RT006 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или маска кислородная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

21. Маски аэрозольные, маски аэрозольные для взрослых и детей, одиночные и в комплекте: с нерегулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с регулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с небулайзером и без производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маска аэрозольная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

22. Маска носовая аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях, маски лицевые дыхательные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229,

или маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные) различных размеров (малый, средний и большой) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маски носовые: RT033, RT034, RT042, RT050, RT051, RT052 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 100 шт. (при необходимости).

23. Маска лицевая аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях, одноразового использования, маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: маски для СРАР производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маска СРАР/NIPPV производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

24. Маски лицевые, маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные и лицевые) различных размеров (малый, средний и большой), маски для СРАР производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или набор масок RD800-EN (5 шт.) производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или маска дыхательная однократного применения в индивидуальной упаковке с этикеткой, в следующих размерах: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6, принадлежности: маскодержатель производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7995 - не более 100 шт. (при необходимости).

25. Мешок для дыхательного контура, одноразового использования, мешок резервный, производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или резервные мешки производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные мешки объёмом: 0.5л, 1.0л, 1.3л, 2.0л, 2.3л, 3.0л, 5.0л: для анестезиологических или реанимационных дыхательных контуров с петлёй или без, с открытым или закрытым концом; для аппаратуры; для оксигенации с дыхательным клапаном с трубкой или без производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или мешок дыхательный (латекс) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или мешки (дыхательные и резервные, объемом 0.5 л, 1.0 л, 2.0 л, 3.0 л) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или мешок дыхательный реанимационный для ИВЛ производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или мешки производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или мешок одноразовый, варианты исполнения: G-118000; G-118001; G-118002 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или мешки резервные дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742

или мешок дыхательный однократного применения, объём 500 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 1000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 2000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 3000 мл производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/6773 - не более 100 шт. (при необходимости).

26. Монитор давления, линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления) "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 - не более 100 шт. (при необходимости).

27. Отражатели тепла, отражатели тепла: 900MR208, NC040-10, NC041-10 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 100 шт. (при необходимости).

28. Распылитель аэрозоля (небулайзер), небулайзеры (распылители трахеобронхиального и альвеолярного осаждения) и резервуары небулайзеров, одиночные и в наборах (с маской аэрозольной, с коннектором или без, с фильтром или без, с кислородной трубкой) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или распылители (небулайзеры) производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или небулайзеры дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

29. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или коннектор угловой производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286, или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: жесткие; эластомерные; гибкие; шарнирные; прямые; угловые; Т-образные; Y-образные; адаптеры производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или гибкие соединители дыхательного контура производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннектор (угольник), варианты исполнения: G-311011; G-311012; G-311015; G-311015-0; G-311015-1; G-311015-R; G-311015-R2; G-311022; G-311025; G-311025-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094, RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или переходники для дыхательных контуров производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

30. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или угловые адаптеры производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - переходник прямой; - переходник Т-образный; - угловой производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или переходники производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или воздуховоды производства "Смите Медикал Интернэшнл Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/05401,

или коннектор (адаптор), варианты исполнения: G-311000; G-311000-1; G-311001; G-311001-1; G-311002; G-311003; G-311003-2; G-311003-3; G-311004; G-311004-2; G-311005; G-311006; G-311008-1; G-311017; G-311019; G-311019-2; G-311024; G-311031; V-1022-02; 9014-D; G-311008; G-311008-2; G-311039; G-311003-2; G-311003-2-1; G-311004-3; G-311031-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или угловой адаптер (22 mm F - 22 mm M/15 mm F) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12372,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094,

RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 100 шт.

31. Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, фильтры тепловлагообменные: фильтры тепловлагообменные угловой конфигурации: взрослые, педиатрические, взрослые/педиатрические, фильтры тепловлагообменные прямые: взрослые, педиатрические, взрослые/педиатрические производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или фильтры производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или фильтры производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или фильтры производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020 производства АО "НПП "ИНТЕРОКО", Россия, РУ № ФСР 2011/11397,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции легких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8405,

или фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции легких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8705,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником НЕРА, фильтр дыхательный бактериально-вирусный педиатрический с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный педиатрический с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный неонатальный с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор, , фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана и кислородной трубкой, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги и кислородной трубкой, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, Т-образный, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги и кислородной трубкой, Т-образный, для трахеостомы производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/9010,

или фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, НЕРА, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, угловой, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, НЕРА, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, Ø 15F, с

кислородным портом Ø 6 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 6 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 5 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 3 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 2 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Small, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, угловой Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Small, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2020/9671 - не более 100 шт. (при необходимости).

32. Термометр, термометр 900MR033 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

33. Тест-колпачок защитный по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

34. Тестовое легкое, тестовые легкие: RD020-01, 500RD106 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 2 шт. (при необходимости).

35. Фильтры дыхательные, Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020 производства АО "НПП "ИНТЕРОКО", Россия, РУ № ФСР 2011/11397,

или фильтр вирусный производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или фильтры производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или фильтры производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные вирусно-бактериальные фильтры в комплекте с соединителями или без: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или фильтры производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или фильтр дыхательный производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или фильтр, варианты исполнения: 800-51700-0; 800-51700; 800-61600; 800-51900; 800-51900-0; 800-51900-11; 800-51800; 800-52000; 800-51500; 800-51600; 800-54011; 800-52300 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или фильтр RT019, RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или фильтр выдоха RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или фильтры дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7282,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8405,

или фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8705,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный НЕРА производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/9010,

или фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22M/15F, 22F, фильтр дыхательный линии давления 0,2 µm производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2020/9671 - не более 100 шт. (при необходимости).

V. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: реанимационные, с встроенным нагревательным элементом, в составе:

1. Трубка гофрированная обогреваемая по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия, не более 2 шт.

2. Трубка гофрированная, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубка соединительная, трубка дыхательная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или трубки дыхательного контура однократного использования (этилвинилацетат), трубки дыхательного контура однократного использования гофрированные (этиленвинилацетат) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или дыхательные шланги (длиной 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 180 см, 300 см, 400 см) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или дыхательные шланги производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или трубки дыхательные производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или дыхательные шланги в комплекте с соединителями или без: шланги для дыхательных контуров; шланги для эвакуации отработанных газов производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или трубка дыхательная производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или трубки дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 5 шт.

3. Коннектор прямой, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992 - не более 15 шт.

4. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или угловые адаптеры производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - переходник прямой; - переходник Т-образный; - угловой производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или переходники производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или воздуховоды производства "Смите Медикал Интернэшнл Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/05401,

или коннектор (адаптор), варианты исполнения: G-311000; G-311000-1; G-311001; G-311001-1; G-311002; G-311003; G-311003-2; G-311003-3; G-311004; G-311004-2; G-311005; G-311006; G-311008-1; G-311017; G-311019; G-311019-2; G-311024; G-311031; V-1022-02; 9014-D; G-311008; G-311008-2; G-311039; G-311003-2; G-311003-2-1; G-311004-3; G-311031-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или угловой адаптер (22 mm F - 22 mm M/15 mm F) производства "Грейт Групп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12372,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094, RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 5 шт.

5. Влагосборник, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или влагосборник производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или влагосборники: - влагосборник однократного использования (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол) производства Грейт Групп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или влагосборники для дыхательных контуров для взрослых и детей производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или влагосборники производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или влагосборники для дыхательных контуров для взрослых, для детей и для новорождённых. производства "Интересджикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или влагосборники производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или влагосборник одноразовый, варианты исполнения: G-313001; G-313001-0; G-313001-00; G-313001-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или влагосборник 900MR139, 900MR139C производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или влагосборники дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

6. Генератор дыхания, производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229 - не более 100 шт. (при необходимости).

7. Держатель контура дыхательного, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или держатель шлангов RT028 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 5 шт. (при необходимости).

8. Держатель масок, держатели для масок (длиной 440 мм и 700 мм) и фиксаторы для шлангов и трубок производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или ремни на голову BC325-10, BC328-10, BC331-10, ремни на подбородок BC351-10, BC353-10, BC355-10, BC357-10 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

9. Канюли для СРАР-терапии, канюли назальные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229

Или канюли назальные СРАР производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286

- не более 100 шт. (при необходимости).

10. Канюли назальные, канюли назальные для взрослых, детей и младенцев производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или канюли носовые для недоношенных детей: RT091, BC2425-20, канюли носовые для новорожденных детей: RT092, BC2435-20, канюли носовые для младенцев: RT093, BC2745-20, канюли носовые для детей: RT094, BC3780-20, канюли носовые для взрослых RT095, канюли носовые для крупных младенцев BC2755-20 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или канюли назальные кислородные MEDEREN в следующих вариантах исполнения производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2018/7623

или канюля назальная кислородная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

11. Канюли назальные (типа RAM), канюли назальные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229,

- не более 100 шт. (при необходимости).

12. Кабель соединительный электрический к проводу для подогрева дыхательных газов, кабель гибкого нагревателя, варианты исполнения: 900MR860, 900MR861, 900MR863, 900MR868, 900MR869 производства "Фишер энд Пэйкел Хелскэр Лимитед", Новая Зеландия, РУ № РЗН 2014/1416 - не более 100 шт. (при необходимости).

13. Камера для увлажнителей дыхательных смесей, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или увлажнители (камеры увлажнителя) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или камера увлажнителя MR225, MR225X, MR250, MR250X, MR290, MR290X, MR340, MR370 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или камеры увлажнителя взрослые: MR210, MR210X, MR250, MR250X, камеры увлажнителя детские: MR225, MR225X, камеры увлажнителя универсальные: MR290, MR290X, MR290U, MR290UX, MR290V, MR290VX, MR290HFV, производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или увлажнители дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742,

или увлажнители производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или Камера увлажнителя (вид 185610) производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053 – не более 100 шт. (при необходимости).

14. Линии контроля давления, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубка соединительная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга давления. производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или трубка измерения давления в контуре 900MR075, 900MR076, 900MR077 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

15. Линия мониторинга газов, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или трубка проксимального давления и CO2 производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга содержания углекислого газа производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

16. Линия подачи воды по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

17. Маски анестезиологические, маски анестезиологические для взрослых, детей, младенцев и новорожденных: стандартные и применяемые при МРТ, анатомические и с воздушной подушкой, с клапаном и без, с крепежным хомутом и без, размеры № 0, №1, №2, №3, №4, №5, №6 производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маски производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или маски наркозные производства "Смите Медикал Интернэшнл Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/05401,

или Маска дыхательная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286

или Маски анестезиологические MEDEREN в вариантах исполнения производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/8818 - не более 100 шт. (при необходимости).

18. Маски лицевые, маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные и лицевые) различных размеров (малый, средний и большой), маски для СРАР производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или набор масок RD800-EN (5 шт.) производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или маска дыхательная однократного применения в индивидуальной упаковке с этикеткой, в следующих размерах: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6, принадлежности: маскодержатель производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7995 - не более 100 шт. (при необходимости).

19. Мешок для дыхательного контура, одноразового использования, мешок резервный, производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или резервные мешки производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные мешки объёмом: 0.5л, 1.0л, 1.3л, 2.0л, 2.3л, 3.0л, 5.0л: для анестезиологических или реанимационных дыхательных контуров с петлёй или без, с открытым или закрытым концом; для аппаратуры; для оксигенации с дыхательным клапаном с трубкой или без производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или мешок дыхательный (латекс) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или мешки (дыхательные и резервные, объемом 0.5 л, 1.0 л, 2.0 л, 3.0 л) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или мешок дыхательный реанимационный для ИВЛ производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или мешки производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или мешок одноразовый, варианты исполнения: G-118000; G-118001; G-118002 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или мешки резервные дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742

или мешок дыхательный однократного применения, объем 500 мл, мешок дыхательный однократного применения, объем 1000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объем 2000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объем 3000 мл производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/6773 - не более 100 шт. (при необходимости).

20. Монитор давления, линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 - не более 100 шт. (при необходимости).

21. Отражатели тепла, отражатели тепла: 900MR208, NC040-10, NC041-10 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 100 шт. (при необходимости).

22. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или коннектор угловой производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: жесткие; эластомерные; гибкие; шарнирные; прямые; угловые; Т-образные; Y-образные; адаптеры производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или гибкие соединители дыхательного контура производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннектор (угольник), варианты исполнения: G-311011; G-311012; G-311015; G-311015-0; G-311015-1; G-311015-R; G-311015-R2; G-311022; G-311025; G-311025-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094, RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или переходники для дыхательных контуров производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

23. Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, фильтры тепловлагообменные: фильтры тепловлагообменные угловой конфигурации: взрослые, педиатрические, взрослые/педиатрические, фильтры тепловлагообменные прямые: взрослые, педиатрические, взрослые/педиатрические производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или фильтры производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или фильтры производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или фильтры производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020 производства АО "НПП "ИНТЕРОКО", Россия, РУ № ФСР 2011/11397,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции легких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8405,

или фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции легких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8705,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником НЕРА, фильтр дыхательный бактериально-вирусный педиатрический с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный педиатрический с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный неонатальный с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор. , фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана и кислородной трубкой, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги и кислородной трубкой, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, Т-образный, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги и кислородной трубкой, Т-образный, для трахеостомы производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/9010,

или фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, НЕРА, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, угловой, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, НЕРА, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, Ø 15F, с кислородным портом Ø 6 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 6 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 5 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 3 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 2 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, угловой Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный,

бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Small, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2020/9671 - не более 100 шт. (при необходимости).

24. Термометр, термометр 900MR033 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

25. Тест-колпачок защитный по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

26. Тестовое легкое, тестовые легкие: RD020-01, 500RD106 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 2 шт. (при необходимости).

27. Фильтры дыхательные, Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020 производства АО "НПП "ИНТЕРОКО", Россия, РУ № ФСР 2011/11397,

или фильтр вирусный производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или фильтры производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или фильтры производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные вирусно-бактериальные фильтры в комплекте с соединителями или без: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или фильтры производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или фильтр дыхательный производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или фильтр, варианты исполнения: 800-51700-0; 800-51700; 800-61600; 800-51900; 800-51900-0; 800-51900-11; 800-51800; 800-52000; 800-51500; 800-51600; 800-54011; 800-52300 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или фильтр RT019, RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или фильтр выдоха RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или фильтры дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7282,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8405,

или фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8705,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный НЕРА производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/9010,

или фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22M/15F, 22F, фильтр дыхательный линии давления 0,2 µm производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2020/9671 - не более 100 шт. (при необходимости).

28. Шапочки-фиксаторы дыхательные, шапочки-фиксаторы дыхательные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229,

или колпак BC300-05, BC303-05, BC306-05, BC309-05, BC360-SK производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

VI. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: реанимационные, циркуляционные, с встроенным нагревательным элементом, в составе:

1. Трубка гофрированная, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,
или трубка соединительная, трубка дыхательная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или трубки дыхательного контура однократного использования (этилвинилацетат), трубки дыхательного контура однократного использования гофрированные (этиленвинилацетат) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или дыхательные шланги (длиной 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 180 см, 300 см, 400 см) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или дыхательные шланги производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или трубки дыхательные производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или дыхательные шланги в комплекте с соединителями или без: шланги для дыхательных контуров; шланги для эвакуации отработанных газов производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или трубка дыхательная производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или трубки дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 5 шт.

2. Трубка гофрированная обогреваемая по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 3 шт.

3. Влагосборник, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или влагосборник производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или влагосборники: - влагосборник однократного использования (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол) производства Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или влагосборники для дыхательных контуров для взрослых и детей производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или влагосборники производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или влагосборники для дыхательных контуров для взрослых, для детей и для новорождённых. производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или влагосборники производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или влагосборник одноразовый, варианты исполнения: G-313001; G-313001-0; G-313001-00; G-313001-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или влагосборник 900MR139, 900MR139C производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или влагосборники дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 3 шт. (при необходимости).

4. Коннектор прямой, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,
или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992 - не более 15 шт.

5. Y-образный коннектор, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,
или коннектор Y-образный производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или Y-образный адаптер (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннекторы (Y-образные) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: Y-образные производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - тройник пациента производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или коннектор (тройник пациента), варианты исполнения: E-1030-01-2; G-311010; E-1031-04; G-313005; G-313005-00; G-313005-00-1; G-313005-11; G-313005-11-1; G-311010-1; G-311030; G-311032 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или тройник пациента RT029, 900MR125, 900MR126, 900MR126C, 900MR126L, 900MR127, 900MR128, 900MR128L, 900MR136, 900MR138, 900MR145, 900MR145C производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или тройник пациента неонатальный RT029 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 3 шт.

6. Держатель контура дыхательного, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или держатель шлангов RT028 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 5 шт. (при необходимости).

7. Держатель масок, держатели для масок (длиной 440 мм и 700 мм) и фиксаторы для шлангов и трубок производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или ремни на голову BC325-10, BC328-10, BC331-10, ремни на подбородок BC351-10, BC353-10, BC355-10, BC357-10 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

8. Канюли для СРАР-терапии, канюли назальные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229

Или канюли назальные СРАР производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286

- не более 100 шт. (при необходимости).

9. Кабель соединительный электрический к проводу для подогрева дыхательных газов, кабель гибкого нагревателя, варианты исполнения: 900MR860, 900MR861, 900MR863, 900MR868, 900MR869 производства "Фишер энд Пэйкел Хелскэр Лимитед", Новая Зеландия, РУ № РЗН 2014/1416 - не более 100 шт. (при необходимости).

10. Камера для увлажнителей дыхательных смесей, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или увлажнители (камеры увлажнителя) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или камера увлажнителя MR225, MR225X, MR250, MR250X, MR290, MR290X, MR340, MR370 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или камеры увлажнителя взрослые: MR210, MR210X, MR250, MR250X, камеры увлажнителя детские: MR225, MR225X, камеры увлажнителя универсальные: MR290, MR290X, MR290U, MR290UX, MR290V, MR290VX, MR290HFV, производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или увлажнители дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742,

или увлажнители производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или Камера увлажнителя (вид 185610) производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053 – не более 100 шт. (при необходимости).

11. Линии контроля давления, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубка соединительная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга давления. производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или трубка измерения давления в контуре 900MR075, 900MR076, 900MR077 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

12. Линия мониторинга газов, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или трубка проксимального давления и CO₂ производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга содержания углекислого газа производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

13. Линия подачи воды по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

14. Маски лицевые, маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные и лицевые) различных размеров (малый, средний и большой), маски для СРАР производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или набор масок RD800-EN (5 шт.) производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или маска дыхательная однократного применения в индивидуальной упаковке с этикеткой, в следующих размерах: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6, принадлежности: маскодержатель производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7995 - не более 100 шт. (при необходимости).

15. Мешок для дыхательного контура, одноразового использования, мешок резервный, производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или резервные мешки производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные мешки объёмом: 0.5л, 1.0л, 1.3л, 2.0л, 2.3л, 3.0л, 5.0л: для анестезиологических или реанимационных дыхательных контуров с петлёй или без, с

открытым или закрытым концом; для аппаратуры; для оксигенации с дыхательным клапаном с трубкой или без производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или мешок дыхательный (латекс)производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или мешки (дыхательные и резервные, объемом 0.5 л, 1.0 л, 2.0 л, 3.0 л) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или мешок дыхательный реанимационный для ИВЛ производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или мешки производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или мешок одноразовый, варианты исполнения: G-118000; G-118001; G-118002 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или мешки резервные дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742

или мешок дыхательный однократного применения, объём 500 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 1000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 2000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 3000 мл производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/6773 - не более 100 шт. (при необходимости).

16. Ограничители потока по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

17. Отражатели тепла, отражатели тепла: 900MR208, NC040-10, NC041-10 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 100 шт. (при необходимости).

18. Распылитель аэрозоля (небулайзер), небулайзеры (распылители трахеобронхиального и альвеолярного осаждения) и резервуары небулайзеров, одиночные и в наборах (с маской аэрозольной, с коннектором или без, с фильтром или без, с кислородной трубкой) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или распылители (небулайзеры) производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или небулайзеры дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

19. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или угловые адаптеры производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - переходник прямой; - переходник Т-образный; - угловой производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или переходники производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или воздуховоды производства "Смите Медикал Интернэшнл Лимитед», Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/05401,

или коннектор (адаптор), варианты исполнения: G-311000; G-311000-1; G-311001; G-311001-1; G-311002; G-311003; G-311003-2; G-311003-3; G-311004; G-311004-2; G-311005; G-

311006; G-311008-1; G-311017; G-311019; G-311019-2; G-311024; G-311031; V-1022-02; 9014-D; G-311008; G-311008-2; G-311039; G-311003-2; G-311003-2-1; G-311004-3; G-311031-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или угловой адаптер (22 mm F - 22 mm M/15 mm F) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12372,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094, RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 100 шт. (при необходимости).

20. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или коннектор угловой производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: жесткие; эластомерные; гибкие; шарнирные; прямые; угловые; Т-образные; Y-образные; адаптеры производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или гибкие соединители дыхательного контура производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннектор (угольник), варианты исполнения: G-311011; G-311012; G-311015; G-311015-0; G-311015-1; G-311015-R; G-311015-R2; G-311022; G-311025; G-311025-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094, RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или переходники для дыхательных контуров производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

21. Термометр, термометр 900MR033 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

22. Тест-колпачок защитный по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

23. Тестовое легкое, тестовые легкие: RD020-01, 500RD106 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 2 шт. (при необходимости).

24. Фильтры дыхательные, Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020 производства АО "НПП "ИНТЕРОКО", Россия, РУ № ФСР 2011/11397,

или фильтр вирусный производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или фильтры производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или фильтры производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные вирусно-бактериальные фильтры в комплекте с соединителями или без: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или фильтры производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или фильтр дыхательный производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или фильтр, варианты исполнения: 800-51700-0; 800-51700; 800-61600; 800-51900; 800-51900-0; 800-51900-11; 800-51800; 800-52000; 800-51500; 800-51600; 800-54011; 800-52300 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или фильтр RT019, RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или фильтр выдоха RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или фильтры дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7282,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8405,

или фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8705,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный НЕРА производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/9010,

или фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22M/15F, 22F, фильтр дыхательный линии давления 0,2 мПа производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2020/9671 - не более 100 шт. (при необходимости).

25. Шапочки-фиксаторы дыхательные, шапочки-фиксаторы дыхательные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229,

или колпак ВС300-05, ВС303-05, ВС306-05, ВС309-05, ВС360-SK производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

VII. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: реанимационные, циркуляционные, с встроенными нагревательными элементами, в составе:

1. Трубка гофрированная обогреваемая по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 4 шт.

2. Трубка гофрированная, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубка соединительная, трубка дыхательная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или трубки дыхательного контура однократного использования (этилвинилацетат), трубки дыхательного контура однократного использования гофрированные (этиленвинилацетат) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или дыхательные шланги (длиной 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 180 см, 300 см, 400 см) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или дыхательные шланги производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или трубки дыхательные производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или дыхательные шланги в комплекте с соединителями или без: шланги для дыхательных контуров; шланги для эвакуации отработанных газов производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или трубка дыхательная производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или трубки дыхательные производства "Интаир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 5 шт.

3. Y-образный коннектор, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или коннектор Y-образный производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или Y-образный адаптер (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннекторы (Y-образные) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: Y-образные производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - тройник пациента производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или коннектор (тройник пациента), варианты исполнения: E-1030-01-2; G-311010; E-1031-04; G-313005; G-313005-00; G-313005-00-1; G-313005-11; G-313005-11-1; G-311010-1; G-311030; G-311032 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или тройник пациента RT029, 900MR125, 900MR126, 900MR126C, 900MR126L, 900MR127, 900MR128, 900MR128L, 900MR136, 900MR138, 900MR145, 900MR145C производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или тройник пациента неонатальный RT029 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 3 шт.

4. Влагосборник, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или влагосборник производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или влагосборники: - влагосборник однократного использования (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол) производства Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или влагосборники для дыхательных контуров для взрослых и детей производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или влагосборники производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или влагосборники для дыхательных контуров для взрослых, для детей и для новорождённых. производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или влагосборники производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или влагосборник одноразовый, варианты исполнения: G-313001; G-313001-0; G-313001-00; G-313001-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или влагосборник 900MR139, 900MR139C производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или влагосборники дыхательные производства "Интаир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

5. Держатель контура дыхательного, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или держатель шлангов RT028 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 5 шт. (при необходимости).

6. Держатель масок, держатели для масок (длиной 440 мм и 700 мм) и фиксаторы для шлангов и трубок производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или ремни на голову BC325-10, BC328-10, BC331-10, ремни на подбородок BC351-10, BC353-10, BC355-10, BC357-10 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

7. Канюли для СРАР-терапии, канюли назальные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229

Или канюли назальные СРАР производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286

- не более 100 шт. (при необходимости).

8. Кабель соединительный электрический к проводу для подогрева дыхательных газов, кабель гибкого нагревателя, варианты исполнения: 900MR860, 900MR861, 900MR863, 900MR868, 900MR869 производства "Фишер энд Пэйкел Хелскэр Лимитед", Новая Зеландия, РУ № РЗН 2014/1416 - не более 100 шт. (при необходимости).

9. Камера для увлажнителей дыхательных смесей, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или увлажнители (камеры увлажнителя) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или камера увлажнителя MR225, MR225X, MR250, MR250X, MR290, MR290X, MR340, MR370 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или камеры увлажнителя взрослые: MR210, MR210X, MR250, MR250X, камеры увлажнителя детские: MR225, MR225X, камеры увлажнителя универсальные: MR290, MR290X, MR290U, MR290UX, MR290V, MR290VX, MR290HFV, производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или увлажнители дыхательные производства "Интаир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742,

или увлажнители производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или Камера увлажнителя (вид 185610) производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053 – не более 100 шт. (при необходимости).

10. Коннектор прямой, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992 - не более 100 шт.

11. Линии контроля давления, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубка соединительная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга давления. производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или трубка измерения давления в контуре 900MR075, 900MR076, 900MR077 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

12. Линия мониторинга газов, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или трубка проксимального давления и CO2 производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга содержания углекислого газа производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

13. Линия подачи воды по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

14. Маски лицевые, маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные и лицевые) различных размеров (малый, средний и большой), маски для СРАР производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или набор масок RD800-EN (5 шт.) производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или маска дыхательная однократного применения в индивидуальной упаковке с этикеткой, в следующих размерах: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6, принадлежности: маскодержатель производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7995 - не более 100 шт. (при необходимости).

15. Мешок для дыхательного контура, одноразового использования, мешок резервный, производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или резервные мешки производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные мешки объёмом: 0.5л, 1.0л, 1.3л, 2.0л, 2.3л, 3.0л, 5.0л: для анестезиологических или реанимационных дыхательных контуров с петлёй или без, с открытым или закрытым концом; для аппаратуры; для оксигенации с дыхательным клапаном с трубкой или без производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или мешок дыхательный (латекс) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или мешки (дыхательные и резервные, объёмом 0.5 л, 1.0 л, 2.0 л, 3.0 л) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или мешок дыхательный реанимационный для ИВЛ производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или мешки производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или мешок одноразовый, варианты исполнения: G-118000; G-118001; G-118002 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или мешки резервные дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742

или мешок дыхательный однократного применения, объём 500 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 1000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 2000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 3000 мл

производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/6773 - не более 100 шт. (при необходимости).

16. Монитор давления, линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 - не более 100 шт. (при необходимости).

17. Ограничители потока по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

18. Отражатели тепла, отражатели тепла: 900MR208, NC040-10, NC041-10 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 100 шт. (при необходимости).

19. Распылитель аэрозоля (небулайзер), небулайзеры (распылители трахеобронхиального и альвеолярного осаждения) и резервуары небулайзеров, одиночные и в наборах (с маской аэрозольной, с коннектором или без, с фильтром или без, с кислородной трубкой) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или распылители (небулайзеры) производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или небулайзеры дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

20. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или угловые адаптеры производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - переходник прямой; - переходник Т-образный; - угловой производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или переходники производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или воздуховоды производства "Смите Медикал Интернэшнл Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/05401,

или коннектор (адаптор), варианты исполнения: G-311000; G-311000-1; G-311001; G-311001-1; G-311002; G-311003; G-311003-2; G-311003-3; G-311004; G-311004-2; G-311005; G-311006; G-311008-1; G-311017; G-311019; G-311019-2; G-311024; G-311031; V-1022-02; 9014-D; G-311008; G-311008-2; G-311039; G-311003-2; G-311003-2-1; G-311004-3; G-311031-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или угловой адаптер (22 mm F - 22 mm M/15 mm F) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12372,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094, RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 100 шт. (при необходимости).

21. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или коннектор угловой производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,
или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: жесткие; эластомерные; гибкие; шарнирные; прямые; угловые; Т-образные; Y-образные; адаптеры производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или гибкие соединители дыхательного контура производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннектор (угольник), варианты исполнения: G-311011; G-311012; G-311015; G-311015-0; G-311015-1; G-311015-R; G-311015-R2; G-311022; G-311025; G-311025-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094, RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или переходники для дыхательных контуров производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

22. Термометр, термометр 900MR033 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

23. Тест-колпачок защитный по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

24. Тестовое легкое, тестовые легкие: RD020-01, 500RD106 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 2 шт. (при необходимости).

25. Фильтры дыхательные, Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020 производства АО "НПП "ИНТЕРОКО", Россия, РУ № ФСЗ 2011/11397,

или фильтр вирусный производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или фильтры производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или фильтры производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные вирусно-бактериальные фильтры в комплекте с соединителями или без: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или фильтры производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или фильтр дыхательный производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или фильтр, варианты исполнения: 800-51700-0; 800-51700; 800-61600; 800-51900; 800-51900-0; 800-51900-11; 800-51800; 800-52000; 800-51500; 800-51600; 800-54011; 800-52300 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или фильтр RT019, RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или фильтр выдоха RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или фильтры дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7282,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8405,

или фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8705,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный НЕРА производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/9010,

или фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22M/15F, 22F, фильтр дыхательный линии давления 0,2 µm производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2020/9671 - не более 100 шт. (при необходимости).

26. Шапочки-фиксаторы дыхательные, шапочки-фиксаторы дыхательные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229,

или колпак ВС300-05, ВС303-05, ВС306-05, ВС309-05, ВС360-SK производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

2 Сведения о производителе медицинского изделия

ООО «МЕДИПЛАСТ»,

196641, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Дорога на Металлострой, дом 5, литера А, помещение 7-Н, оф.6.

Тел: +79533551330, e-mail: mediplast.st.petersburg@gmail.com.

3 Назначение медицинского изделия, установленное производителем

Устройства предназначены для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, в вариантах исполнения (далее по тексту - устройства), предназначены для использования при подаче воздушно-кислородной и анестезиологической смеси, а также при проведении искусственной вентиляции легких и ингаляционной анестезии: для подачи и отвода управляемой газовой смеси, с целью профилактики осложнений, лечения, медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма человека.

Изделие предназначено для использования квалифицированным (обученным) медицинским персоналом, на дому (по рекомендации врача).

Область применения – искусственная вентиляция легких, ингаляционная анестезия, ингаляционная терапия, физиотерапия.

Потенциальные потребители: пациенты, нуждающиеся в подаче воздушно-кислородной и анестезиологической смеси, а также для проведения искусственной вентиляции легких и ингаляционной анестезии: для подачи и отвода управляемой газовой смеси, с целью профилактики осложнений, лечения, медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма человека.

4 Условия применения

Операционные отделения, реанимационные отделения, физиотерапевтические отделения, палаты интенсивной терапии, на дому (по рекомендации врача), в транспортных средствах скорой медицинской помощи.

5 Принцип действия

Устройства являются частью респираторного оборудования, замещающего функцию легких, аппаратов искусственной вентиляции лёгких или анестезиологической/реанимационной «рабочей станции», которая обеспечивает подачу кислорода и вдыхаемых газов пациенту, выводит двуокись углерода (CO_2) и увлажняет вдыхаемую смесь и предотвращает аккумуляцию нежелательных или токсичных продуктов обмена, сохраняя постоянным газовый состав альвеол.

6 Перечень показаний к применению, противопоказаний, возможных побочных действий

6.1 Показания к применению

Необходимость подачи дыхательной смеси под давлением, с переменным давлением или газа с повышенным содержанием кислорода, или проведения искусственной вентиляции легких или, ввода ингаляционных анестезирующих смесей.

6.2 Противопоказания к применению:

- Аллергия или непереносимость химических веществ, входящие в состав изделия;
- Хирургически недренированный пневмоторакс (риск чрезмерного повышения давления в устройстве и как следствие, в дыхательных путях и плевральных полостях).

6.3 Возможные побочные действия:

- Асфиксия вследствие обтурации трубки дыхательного контура мокротой, инородным телом или конденсатом при длительном использовании;
- Асфиксия при разгерметизации Устройства (отсоединения Устройства от соответствующего коннектора аппарата ИВЛ/НДА);
- Аллергические реакции на химические вещества, входящие в состав изделия.

6.4 Меры предосторожности и требования безопасности

- Устройства являются одноразовыми медицинскими изделиями;
- Изделия для многократного использования (Держатель) подлежат дезинфекции путем протирания салфеткой 3% го раствора перекиси водорода или 70%го этилового спирта;
- Изделия должны применяться только квалифицированным (обученным) персоналом;
- Перед устройствами убедиться в целостности индивидуальной упаковки;
- Не применять медицинское изделие при нарушении целостности упаковки. Качество изделия гарантируется только при отсутствии следов повреждения упаковки;
- Не применять медицинское изделие при наличии визуальных дефектов;
- Не применять медицинское изделие после истечения срока годности;
- Медицинское изделие не подлежит повторной стерилизации и дезинфекции для повторного применения;
- Использовать при применении изделий исправную следящую аппаратуру, в соответствии с принятыми стандартами и рекомендациями;
- Соблюдать рекомендации, инструкции и требования безопасности по использованию медицинского оборудования (анестезиологические аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких, капнографы, небулайзеры, аппараты ручной вентиляции легких и прочее) и других медицинских изделий (дыхательные контуры и фильтры, соединители, линии, анестезиологические маски, эндотрахеальные и трахеостомические трубки, ларингеальные маски, другие надгортанные устройства и прочее), с которым используются Устройства;

- Не использовать медицинское изделие повторно или у других пациентов во избежание развития перекрестного инфицирования;
- Соединять Устройства с соответствующими коническими коннекторами притирая их надежно;
- Контролировать образование конденсата и вовремя его эвакуировать.
- Не следует без особых показаний производить замену Устройства, исходя только из продолжительности его применения у пациента;
- При использовании Устройства для замещения функции легких иметь резервный экземпляр изделия;
- Использование Устройств с встроенными нагревательными элементами совместно с увлажнителями дыхательных смесей, не указанными в п. 8.1.2, или не имеющих датчика потока дыхательной смеси, потенциально может привести к перегреву нагревательных элементов Устройств, особенно в условиях низких потоков газа (менее 4 литров в 1 минуту);
- При использовании с анестезиологической станцией следить за количеством абсорбента диоксида углерода и избегать его истощения;
- Перед использованием Устройств всегда проводить тестирование оборудования для того, чтобы убедиться в герметичности изделия;
- Избегать состояний, которые могут сопровождаться накоплением в устройстве примесей посторонних газов.

7 Описание, параметры и характеристики медицинского изделия

7.1 Описание изделия

Трубка гофрированная.

Трубка предназначена для использования при проведении дыхательных газов во время дыхательного цикла, как правило, в процессе проведения анестезии или искусственной вентиляции легких. Изделие функционирует как часть дыхательного контура или другого устройства для подачи газов (например, респираторной маски) или в сочетании с ними и/или подсоединяется к дыхательному мешку или аппарату искусственной вентиляции легких. Также используется совместно с кислородной маской, эндотрахеальной трубкой, трахеостомической трубкой, ларингеальной маской и другими надгортанными устройствами, увлажнителем или ингалятором для аэрозольного увлажнения, как правило, обогащенного кислородом.

Трубка гофрированная устройств должна иметь следующие варианты исполнения и соответствовать конструкторской документации:

- Трубка гофрированная 22;
- Трубка гофрированная 22 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F;
- Трубка гофрированная 22 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F и 22M;
- Трубка гофрированная 22 с антимикробными компонентами с коннекторами 22M;
- Трубка гофрированная 22 с коннекторами 22F;
- Трубка гофрированная 22 с коннекторами 22F и 22M;
- Трубка гофрированная 22 с коннекторами 22M;
- Трубка гофрированная растяжимая 22;
- Трубка гофрированная растяжимая 22 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F;
- Трубка гофрированная растяжимая 22 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F и 22M;
- Трубка гофрированная растяжимая 22 с антимикробными компонентами с коннекторами 22M;

- Трубка гофрированная растяжимая 22 с коннекторами 22F;
- Трубка гофрированная растяжимая 22 с коннекторами 22F и 22M;
- Трубка гофрированная растяжимая 22 с коннекторами 22M;
- Трубка гофрированная 15;
- Трубка гофрированная 15 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F;
- Трубка гофрированная 15 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F и 22M;
- Трубка гофрированная 15 с антимикробными компонентами с коннекторами 22M;
- Трубка гофрированная 15 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F и 15M;
- Трубка гофрированная 15 с коннекторами 22F;
- Трубка гофрированная 15 с коннекторами 22F и 22M;
- Трубка гофрированная 15 с коннекторами 22M;
- Трубка гофрированная 15 с коннекторами 22F и 15M;
- Трубка гофрированная растяжимая 15;
- Трубка гофрированная растяжимая 15 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F;
- Трубка гофрированная растяжимая 15 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F и 22M;
- Трубка гофрированная растяжимая 15 с антимикробными компонентами с коннекторами 22M;
- Трубка гофрированная растяжимая 15 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F и 15M;
- Трубка гофрированная растяжимая 15 с коннекторами 22F;
- Трубка гофрированная растяжимая 15 с коннекторами 22F и 22M;
- Трубка гофрированная растяжимая 15 с коннекторами 22M;
- Трубка гофрированная растяжимая 15 с коннекторами 22F и 15M;
- Трубка гофрированная 10;
- Трубка гофрированная 10 с коннекторами 15M и 22F;
- Трубка гофрированная 10 с коннекторами 15M;
- Трубка гофрированная 10 с коннекторами 10M и 15M;
- Трубка гофрированная 10 с коннекторами 10M и 22F;
- Трубка гофрированная 10 с коннектором 15M;
- Трубка гофрированная 10 с коннектором 12,5M;
- Трубка гофрированная 10 с коннекторами 12,5M и 15M;
- Трубка гофрированная 10 с коннектором 22F;
- Трубка гофрированная 10 с коннектором 15M;
- Трубка гофрированная 22 обогреваемая, длиной трубки 150 см, с коннекторами 22F с портом;
- Трубка гофрированная 22 обогреваемая, длиной трубки 150 см, с коннекторами 22F;
- Трубка гофрированная 10 обогреваемая, длиной трубки 110 см, с коннекторами 22F с портом;
- Трубка гофрированная 10 обогреваемая, длиной трубки 110 см, с коннекторами 22F.

Y-образный коннектор.

Обеспечивает создание дыхательного контура с совместимыми комплектующими (например, дыхательными трубками и лицевой маской или эндотрахеальной трубкой, трахеостомической трубкой, ларингеальной маской и другими надгортанными устройствами), может функционировать только в составе дыхательного контура, должен обеспечивать распределение и движение газов по соединяемым трубкам.

Y-образный коннектор должен иметь следующие варианты исполнения:

- Y-образный коннектор 22М/15F-22М-22М без портов;
- Y-образный коннектор 22М/15F-22М-22М с портами 7,6 мм;
- Y-образный коннектор 22М/15F-15М-15М без портов;
- Y-образный коннектор 22М/15F-15М-15М с портами 7,6 мм.

Соединитель угловой.

Соединитель для совместимых комплектующих (например, трубок и лицевой маски или эндотрахеальной трубки, трахеостомической трубкой, ларингеальной маской и другими надгортанными устройствами), обеспечивающий создание Устройства. Изделие может функционировать только в составе Устройства и обычно подключается непосредственно к точке контроля вдоха/выдоха пациента. Изделие для одноразового использования.

Соединитель угловой устройств должен иметь следующие варианты исполнения и соответствовать конструкторской документации:

- Соединитель угловой 22М/15F-15М без портов;
- Соединитель угловой 22М/15F-15М с портом Луер;
- Соединитель угловой 22М/15F-15М с портом 7,6 мм;
- Соединитель угловой 22М/15F-15М с портом 7,6/9,5 мм;
- Соединитель угловой шарнирный 22М/15F-15М с портом 7,6/9,5 мм.

Соединитель.

Соединитель – гибкое изделие, разработанное для подключения к дыхательному контуру эндотрахеальной трубки, трахеостомической трубкой, ларингеальной маской и другими надгортанными устройствами, лицевой маски для анестезии или другого компонента дыхательного контура, предназначен для обеспечения мобильности пациента относительно Устройства. Используется для подключения дыхательного контура (например, анестезиологического дыхательного контура или дыхательного контура аппарата искусственной вентиляции легких) или аппарата для реанимации к эндотрахеальной трубке для повышения мобильности края контура на стороне пациента.

Соединитель должен иметь следующие варианты исполнения:

- Соединитель гофрированный длинной трубки с коннектором угловым 22М/15F-15М без портов;
- Соединитель гофрированный длинной трубки с коннектором угловым 22М/15F-15М с портом Луер;
- Соединитель гофрированный длинной трубки с коннектором угловым 22М/15F-15М с портом 7,6 мм;
- Соединитель гофрированный длинной трубки с коннектором угловым 22М/15F-15М с портом 7,6/9,5 мм;
- Соединитель гофрированный длинной трубки с коннектором угловым шарнирным 22М/15F-15М с портом 7,6/9,5 мм;
- Соединитель гофрированный длинной трубки с коннектором 22М/15F;
- Соединитель растяжимый длинной с коннектором угловым 22М/15F-15М без портов;
- Соединитель растяжимый длинной трубки с коннектором угловым 22М/15F-15М с портом Луер;
- Соединитель растяжимый длинной трубки с коннектором угловым 22М/15F-15М с портом 7,6;
- Соединитель растяжимый длинной трубки с коннектором угловым 22М/15F-15М с портом 7,6/9,5;

- Соединитель растяжимый длинной трубки с шарнирным коннектором угловым 22M/15F-15M с портом 7,6/9,5 мм;
- Соединитель растяжимый длинной трубки с коннектором 22M/15F;
- Соединитель гофрированный длинной трубки в сборе с коннектором угловым 22M/15F-15M без портов;
- Соединитель гофрированный длинной трубки в сборе с коннектором угловым 22M/15F-15M с портом Луер;
- Соединитель растяжимый длинной трубки в сборе с коннектором угловым 22M/15F-15M с портом 7,6 мм;
- Соединитель гофрированный длинной трубки в сборе с коннектором угловым 22M/15F-15M с портом 7,6/9,5 мм;
- Соединитель растяжимый длинной трубки в сборе с коннектором угловым 22M/15F-15M без портов;
- Соединитель растяжимый длинной трубки в сборе с коннектором угловым 22M/15F-15M с портом Луер;
- Соединитель растяжимый длинной трубки в сборе с коннектором угловым 22M/15F-15M с портом 7,6 мм;
- Соединитель растяжимый длинной трубки в сборе с коннектором угловым 22M/15F-15M с портом 7,6/9,5 мм;
- Соединитель гофрированный длинной трубки с коннектором угловым 22M/15F-15M без портов и коннектором 15M;
- Соединитель гофрированный длинной трубки с коннектором угловым 22M/15F-15M с портом Луер и коннектором 15M;
- Соединитель растяжимый длинной трубки с коннектором угловым 22M/15F-15M без портов и коннектором 15M;
- Соединитель растяжимый длинной трубки с коннектором угловым 22M/15F-15M с портом Луер и коннектором 15M.

Влагосборник.

Влагосборник предназначен для сбора и дальнейшего удаления конденсированной воды из Устройства. Влагосборник может устанавливаться как на трубке выдоха, так и на трубке вдоха. Влагосборник устанавливается таким образом, чтобы обеспечить сбор конденсата в самой нижней точке. При этом расположение трубок должно быть таким, что бы стакан (накопитель) влагосборника не касался поверхности пола.

Влагосборник должен иметь следующие варианты исполнения:

- Влагосборник 22M, 22M;
- Влагосборник 22M/15F, 22M/15F.

Кислородная трубка.

Доставка дополнительного кислорода или обогащенной кислородом воздушной смеси пациенту. Может использоваться в качестве трубки для создания давления газа в пневматическом небулайзере для создания аэрозоля для подачи его в Устройство.

Коннектор прямой.

Предназначен для обеспечения надежного соединения трубки дыхательного контура с соответствующим патрубком аппарата искусственной вентиляции легких или аппарата для реанимации. При наличии соответствующего порта обеспечивают подсоединение соответствующих устройств (температурного датчика, линии мониторинга).

Варианты исполнения:

- Коннектор прямой 15M-15F с портом 7,6 мм;

- Коннектор прямой 15М-15F с портом 6.0 мм;
- Коннектор прямой 15F-15F;
- Коннектор прямой 15М-22F;
- Коннектор прямой 15F-22F;
- Коннектор прямой 22М-22М;
- Коннектор прямой 22М-22М/15F;
- Коннектор прямой 22М/15F-22М/15F;
- Коннектор прямой 22М-22F;
- Коннектор прямой 22М-19М.

Линия мониторинга газов.

Предназначена для использования в качестве переходника между коннектором трубки/маски дыхательного контура и инструментом для измерения респираторных газов, (например, анализатором диоксида углерода (CO₂) или нескольких газов, манометром/монитором давления). Может предназначаться для мониторинга давления и/или забора проб газа, но не содержит компонентов, предназначенных для подачи медицинского воздуха пациенту.

Линия мониторинга газов должна иметь следующие варианты исполнения:

- Линия мониторинга газов с коннекторами Луер – Лок male и female;
- Линия мониторинга газов с коннекторами Луер – Лок male.

Линия контроля давления.

Предназначена для использования в качестве переходника между коннектором трубки/маски дыхательного контура и инструментом для измерения респираторных газов, (например, анализатором диоксида углерода (CO₂) или нескольких газов, манометром/монитором давления). Не содержит компонентов, предназначенных для подачи медицинского воздуха пациенту.

Линия контроля давления должна иметь следующие варианты исполнения:

- Линия контроля давления;
- Линия контроля давления с коннектором Луер;
- Линия контроля давления с прямым коннектором;
- Линия контроля давления с коннектором Луер – Лок.

Линия подачи воды.

Применяется в Устройствах в случаях необходимости подачи дистиллированной воды в ингаляционно-терапевтических устройствах различного типа в целях профилактики пересыхания слизистой дыхательных путей вследствие пересушенности окружающего воздуха или ингаляционных газов. Увлажнение достигается путём испарения или распыления воды в помещении или газовом потоке дыхательного контура. Может иметь различные размеры, подключаться с помощью или без помощи переходника.

Линия подачи воды должна иметь следующие варианты исполнения:

- Линия подачи воды;
- Линия подачи воды с коннектором Луер – Лок male.

Держатель контура дыхательного.

Держатель контура дыхательного, может использоваться многократно. Предназначен для удержания трубок Устройства, а также других элементов Устройства, по которым проходят газы от аппарата искусственной вентиляции легких и/или анестезиологических систем к пациенту и от пациента. Держатель должен обеспечивать фиксацию трубок дыхательного контура в заданном пользователем положении. Наружные поверхности при необходимости

обрабатываются 3 % раствором хлорамина Б или 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего синтетического средства по ГОСТ 25644.

Держатель контура дыхательного должен иметь следующие варианты исполнения:

- Держатель контура дыхательного исполнение 1;
- Держатель контура дыхательного исполнение 2;
- Держатель контура дыхательного исполнение 3.

Ограничитель потока.

Предназначен для использования в Устройствах (в патрубке вдоха) исключительно для соответствующих моделей аппаратов искусственной вентиляции легких: SLE 2000, и SLE 5000 (4000). Функция ограничителя – создавать соответствующее обратное давление в патрубке вдоха. Ограничитель потока должен создавать соответствующее обратное давление в патрубке вдоха, что приводит в действие сигнализаторы утечки и блокировки при падении давления. Ограничитель изготавливается в двух вариантах:

- Ограничитель потока для аппаратов SLE2000 откалиброван для потока 5 л/мин. свежего газа;
- Ограничитель потока для аппаратов SLE5000 (4000) откалиброван для потока 8 л/мин. свежего газа.

Принцип действия ограничителя потока: создание соответствующего обратного давления в патрубке вдоха, что приводит в действие сигнализаторы утечки и блокировки при падении давления. При применении Устройств с ограничителями потока необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации соответствующего оборудования.

- Ограничитель потока для аппаратов SLE2000;
- Ограничитель потока для аппаратов SLE5000 (4000).

Тест-колпачок защитный.

Предназначен для установления в проксимальный конец Устройств. Основное его назначение – осуществление тестирования респираторного оборудования. Тест Устройства, запускаемый пользователем при начале работы с соответствующим оборудованием, позволяет удостовериться в отсутствии утечек в системе дыхательного контура аппарата ИВЛ, измерить комплайнс и сопротивление контура, выполнить калибровку датчика потока выдоха и т. п. А также предназначен для защиты от попадания инородных тел в полость дыхательного контура с проксимального конца устройства. При подключении Устройства к пациенту, колпачок отсоединяется от Устройства.

Тест-колпачок защитный должен иметь следующие варианты исполнения:

- Тест-колпачок защитный;
- Тест-колпачок защитный 15М.

7.2 Методы и условия стерилизации и дезинфекции

Устройства являются нестерильными медицинскими изделиями, предназначены для однократного применения, за исключением Держателя (Держатель дыхательного контура) и тестового легкого, которые могут использоваться многократно после соответствующей дезинфекции и обработки.

8 Указания по применению

8.1 Общие положения

Перед работой с Устройством ознакомьтесь с данным руководством, а также с инструкцией по применению соответствующего респираторного оборудования. Устройства должны применяться только лицами, получившими необходимую подготовку. Подготовка должна включать тренировку на реалистичном тренировочном манекене. Неправильное применение устройств может нанести непоправимый вред пациенту.

Внимание! Устройства в вариантах исполнения: реанимационные, с встроенным нагревательным элементом, циркуляционные, с встроенным нагревательным элементом протестированы и испытаны с увлажнителями дыхательных смесей производства «Фишер энд Пэйкел Хелскэр Лимитед» (Новая Зеландия) моделей MR850 (регистрационное удостоверение №РЗН 2014/1416) и модели MR810 (регистрационное удостоверение №ФСЗ 2007/00742); в варианте исполнения реанимационные, циркуляционные с встроенными нагревательными элементами – только с увлажнителем дыхательных смесей модели MR850. При использовании Устройств в указанных вариантах исполнения с иными моделями увлажнителей производитель Устройств не может гарантировать их корректную работу и безопасное использование.

9 Установка и способ применения

9.1 Подготовка к использованию

Произведите антисептику кожи рук или наденьте перчатки.

9.2 Выбор размера

Выбор диаметра дыхательных трубок обуславливается возрастными и/или анатомическими характеристиками пациентов, такими как: масса тела, рост, дыхательный объем; режим вентиляции; возраст. Выбор Устройства в зависимости от размера (диаметра) дыхательной трубки обусловлен также респираторным оборудованием. Размерный ряд дыхательных трубок и их соединений стандартизирован (табл.).

Таблица

Диаметр трубки	Описание размера
10 мм	Для применения у пациентов массой тела до 12 кг
15 мм	Для применения у пациентов с массой тела до 40 кг
22 мм	Для применения в дыхательных системах для взрослых пациентов и детей старшего возраста

Выбор длины устройств характеризуется конструктивными особенностями дыхательной системы в целом, расстоянием от пациента до источника газа.

Выбор длины и диаметра устройств делает квалифицированный специалист, основываясь на профессиональном опыте и вышеперечисленных условиях.

9.3 Рекомендуемый метод установки

- Осмотреть упаковку, убедиться в отсутствии её повреждений или инородных тел, загрязнений. Проверить наличие индивидуальной маркировки и убедиться в том, что срок годности устройства не истек. Вскрыть упаковку, осмотреть каждый компонент устройства и провести визуальную проверку целостности шлангов, соединителей и отсутствия посторонних предметов.
- Подсоединить устройство к аппарату. При соединении разъёмов продольное движение должно сопровождаться поворотом – для достижения требуемой надежности соединения и герметичности.
- После подсоединения к аппаратуре, при необходимости и наличии технической возможности провести соответствующие тесты оборудования на герметичность, комплайнс, компенсацию утечек и прочее. При этой проверке используется тест-колпачок, входящий в комплект устройства.
- Перед присоединением устройства к схеме на пациента (эндотрахеальной трубке, трахеостомической трубке, ларингеальной или лицевой маске), необходимо снять защитный колпачок.
- Если в устройстве имеется регулируемый клапан предельного давления РПК (APL), установите и регулируйте его согласно клиническим требованиям на протяжении всего времени применения. Давление в устройстве максимальное, когда крышка клапана РПК повернута по часовой стрелке до конца. Сброс давления до 60 см H₂O не может быть перерегулирован. Максимальное давление сброса не должно превышать 60 см H₂O.
- Замену устройства необходимо производить в соответствии с установленным в медицинском учреждении порядком очистки и дезинфекции или на основании его непригодности к дальнейшему использованию по назначению.
- Рекомендуются использование устройства однократного применения в течение не более 168 часов.
- Не следует без особых показаний (явное загрязнение, нарушение функционирования и т.п.) производить замену устройства исходя только из продолжительности его применения при использовании устройства у того же самого пациента.
- Следует своевременно удалять любой конденсат в устройстве.
- Устройства при **использовании вне пределов ЛПУ (например, при использовании респираторного оборудования в домашних условиях)** применяются на одном пациенте. При применении Устройств на дому, на них распространяются условия, указанные в п. 9.3.9. При перерыве в работе устройства со стороны пациента должен быть защищён защитным колпачком, входящим в комплект, для предотвращения контаминации или повреждения.

9.4 Возможные риски при использовании

Самый большой риск при использовании устройства связан с контролем загрязнения/инфекции и биохимической совместимости. Повторное использование одного устройства может привести к инфицированию пациента.

При использовании устройств в обязательном порядке необходимо использовать следящую аппаратуру в соответствии с принятыми стандартами. Необходимо периодически контролировать надежность соединения патрубков (коннекторов трубок) Устройств с респираторным оборудованием.

9.5 Обслуживание и ремонт

Устройства техническому обслуживанию и ремонту не подлежат.

10 Комплектность

10.1 Минимальная комплектация в соответствии с таблицей

Наименование	№	Комплектация
1. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: анестезиологические, в составе:		
	1	Трубка гофрированная – 1 шт.
	2	Коннектор прямой – 1 шт.
	3	Соединитель – 1 шт.
	4	Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
2. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием вариант исполнения: анестезиологические, циркуляционные, в составе:		
	1	Трубка гофрированная – 2 шт.
	2	Коннектор прямой – 2 шт.
	3	Y-образный коннектор - 1 шт.
	4	Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
3. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: реанимационные, в составе:		
	1	Трубка гофрированная - 1 шт.
	2	Коннектор прямой- 1 шт.
	3	Соединитель - 1 шт.
	4	Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
4. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения:		

реанимационные, циркуляционные, в составе:		
	1	Трубка гофрированная - 2 шт.
	2	Коннектор прямой – 2 шт
	3	У-образный коннектор - 1 шт.
	4	Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт на транспортную упаковку.
5. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: реанимационные, с встроенным нагревательным элементом, в составе:		
	1	Трубка гофрированная обогреваемая- 1 шт.
	2	Трубка гофрированная - 1 шт.
	3	Коннектор прямой - 1 шт.
	4	Соединитель - 1 шт.
	5	Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
6. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: реанимационные, циркуляционные, с встроенным нагревательным элементом в составе:		
	1	Трубка гофрированная - 2 шт.
	2	Трубка гофрированная обогреваемая- 1 шт.
	3	Влагосборник - 1 шт.
	4	Коннектор прямой - 1 шт.
	5	У-образный коннектор - 1 шт.
	6	Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.

7. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: реанимационные, циркуляционные, с встроенными нагревательными элементами, в составе:		
	1	Трубка гофрированная обогреваемая - 2 шт.
	2	Трубка гофрированная - 1 шт.
	3	У-образный коннектор - 1 шт.
	4	Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.

10.2 Максимальная комплектация

№	Наименование	Комплектность	Нормативный документ	Количество	Примечание	22мм	15мм	10мм
	1. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: анестезиологические, в составе:		ТУ 32.50.21-003-40945934-2019					
		В составе:						
1		Трубка гофрированная (вид 354450).	ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/12928	до 6 шт.		1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2009/03742					
2		Коннект ор прямой	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 15 шт.		1	1	1
3		Соедини- тель (вид 165140)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/05401 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2012/12372	до 5 шт.		1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111					
4		Адаптер кислоро- да	ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2012/11566	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
5		Держате- ль контура дыхател- ьного (вид 185520)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 5 шт.	при необходим- ости	1	1	1
6		Держате- ль масок (вид 322590)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	
7		Канюли назальн- ые (вид 136410)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ РЗН 2018/7623 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
8		Кислоро- дная трубка (вид 156030).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
9		Клапаны положит- ельного давлени- я (вид 108960 и 321960)	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
10		Клапан нереверс- ивный, однораз- ового использ- ования (вид 321960)	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
11		Линии контрол я давлени я (вид 271240)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
12		Линия монитор инга газов (вид 271240).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
13		Маски анестези ологиче ские (вид 275780)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/05401 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ РЗН 2019/8818 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
14		Маски кислоро дные (вид 167560)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2012/13286					
15		Маски аэрозоль- ные (вид 274020)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
16		Маски лицевые (вид 271390)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ РЗН 2018/7995	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	
17		Мешок для дыхател- ьного контура, однораз- ового использ- ования (вид 283370).	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ РЗН 2018/6773	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
18		Монитор давления (вид 132370)	ФСЗ 2012/11566	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
19		Мундштук (вид 283330)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/03551	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	
20		Распыли- тель аэрозоля (небулай- зер) (вид 324660)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	
21		Соедини- тель (вид 327610)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			2009/03742					
22		Тепло/в- лагообм- енник/ба- ктериаль- ный фильтр (вид 218750)	ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСР 2011/11397 ИЛИ РЗН 2019/8405 ИЛИ РЗН 2019/9010 ИЛИ РЗН 2019/8705 ИЛИ РЗН 2020/9671	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
23		Термоме- тр (вид 320750).	ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
24		Тест- колпачо- к защитны й	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
25		Тестово- е легкое (вид 107580)	ФСЗ 2011/09111	до 2 шт.	при необходим ости	1	1	1
26		Фильтр ы дыхател- ьные (вид 318730)	ФСР 2011/11397 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ РЗН 2018/7282 ИЛИ РЗН 2019/8405 ИЛИ РЗН 2019/8705 ИЛИ РЗН 2019/9010	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ИЛИ РЗН 2020/9761					
	1. Устрой- ства дыхательные для совместного использования с анестезиологи- ческим и реанимационн- ым оборудование- м, вариант исполнения: анестезиологи- ческие, циркуляционн- ые, в составе:		ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019					
		В						

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
		составе:						
1		Трубка гофриро- ванная (вид 354450).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 6 шт.		1	1	1
2		Коннект- ор прямой	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 20 шт.	при необходим- ости	1	1	1
3		У- образный коннект- ор (вид 151450).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ	до 3 шт.		1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2011/09111					
4		Адаптер кислоро- да	ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2012/11566	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
5		Влагосб- орник (вид 260670)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
6		Держате- ль контура дыхател- ьного (вид 185520).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 5 шт.	при необходим- ости	1	1	1
7		Держате- ль масок (вид 322590)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
8		Канюли назальн- ые (вид 136410)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ РЗН	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			2018/7623 ИЛИ ФСЗ 2012/13286					
9		Канюли назальн ые (типа RAM)	ФСЗ 2011/10229	до 100 шт.	при необходим ости			1
10		Кислоро- дная трубка (вид 156030).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
11		Клапаны положит ельного давлени я (вид 108960 и 321960)	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
12		Клапан нереверс- ивный, однораз- ового использ- ования (вид 321960)	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
13		Линии контрол- я давлени- я (вид 271240)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
14		Линия монитор- инга газов (вид 271240).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
15		Маски анестези- ологиче- ские (вид 275780)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/05401 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ РЗН 2019/8818 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
16		Маски кислоро- дные (вид 337070, 167560)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
17		Маски аэрозоль- ные (вид 274020)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
18		Маски лицевые (вид 271390)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ РЗН 2018/7995	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
19		Мешок для дыхател- ьного контура, однораз- ового использ- ования (вид 283370).	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ РЗН 2018/6773					
20		Монитор давления (вид 132370)	ФСЗ 2012/11566	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
21		Мундштук (вид 283330)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/03551	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	
22		Распылитель аэрозоля (небулайзер) (вид 324660)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
23		Соедини- тель (вид 327610)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03702	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
24		Соедини- тель (вид 165140)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/05401 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2012/12372 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
25		Тепло/в- лагообм- енник/ба- ктериаль- ный фильтр (вид 218750)	ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСР 2011/11397 ИЛИ РЗН 2019/8405 ИЛИ РЗН 2019/9010	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ИЛИ РЗН 2019/8705 ИЛИ РЗН 2020/9671					
26		Термоме- тр (вид 320750)	ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
27		Тест- колпачо- к защитны- й	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
28		Тестово- е легкое (вид 107580)	ФСЗ 2011/09111	до 2 шт.	при необходим- ости	1	1	1
29		Фильтр- ы дыхател- ьные (вид 318730)	ФСР 2011/11397 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			РЗН 2018/7282 ИЛИ РЗН 2019/8405 ИЛИ 2019/8705 ИЛИ РЗН 2019/9010 ИЛИ РЗН 2020/9761					
	3. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологи- ческим и реанимационн- ым оборудование- м, вариант исполнения: реанимационн- ые, в составе:		ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019					
		В составе:						
1		Трубка гофриро- ванная (вид 354450).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053	до 6 шт.		1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ИЛИ ФСЗ 2009/03742					
2		Коннект ор прямой	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 15 шт.		1	1	1
3		Соедини- тель (вид 165140).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/05401 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2012/12372 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 5 шт.		1	1	1
4		Адаптер кислоро- да	ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2012/11566	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
5		Влагосб- орник (вид 260670).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим- ости			1
6		Генерат- ор дыхания	ФСЗ 2011/10229	до 100 шт.	при необходим- ости			
7		Держате- ль контура дыхател- ьного (вид 185520).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 5 шт.	при необходим- ости	1	1	1
8		Держате- ль масок (вид 322590)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
9		Канюли для СРАР-	ФСЗ 2011/10229	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
		терапии (вид 105850)						
10		Канюли назальн ые (вид 136410)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ РЗН 2018/7623 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
11		Канюли назальн ые (типа RAM)	ФСЗ 2011/10229	до 100 шт.	при необходим ости			1
12		Кислоро- дная трубка (вид 156030).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
13		Камера для увлажни- телей дыхател- ьных смесей (вид 321970)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ ФСЗ 2011/09053					
14		Клапан выдоха (вид 124510)	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
15		Клапаны положит ельного давлени я (вид 108960 и 321960)	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
16		Клапан нереверс ивный, однораз ового использ ования (вид 321960)	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
17		Линии контрол я давлени я (вид 271240)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
18		Линия монитор инга газов (вид 271240).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
19		Линия подачи воды	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
20		Маска анестези ологиче ская (вид 275780)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/05401 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ РЗН 2019/8818 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
21		Маски кислоро- дные (вид 167560)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
22		Маски аэрозоль- ные (вид 274020)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
23		Маска носовая аппарата постоян- ного/дву- хфазног- о положит- ельного давлени- я в дыхател- ьных путях (вид 109700)	ФСЗ 2011/10229 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
24		Маска лицевая аппарата постоян- ного/дву- хфазног- о положит- ельного давлени- я в дыхател- ьных путях, однораз	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
		ового использ ования (вид 109710)						
25		Маски лицевые (вид 271390)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ РЗН 2018/7995	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
26		Мешок для дыхател ьного контура, однораз ового использ ования (вид 283370).	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ РЗН 2018/6773	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
27		Монито р давлени я (вид 132370)	ФСЗ 2012/11566	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
28		Мундшт ук (вид 283330)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/03551	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	
29		Отражат ели тепла (вид 330090)	ФСЗ 2011/09111	до 100 шт.	при необходим ости			1
30		Распыли- тель аэрозоля (небулай- зер) (вид 324660)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
31		Соедини- тель (вид 327610)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
32		Тепло/в- лагообм- енник/ба- ктериаль- ный фильтр (вид 218750)	ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСР 2011/11397 ИЛИ РЗН 2019/8405 ИЛИ РЗН 2019/9010 ИЛИ РЗН 2019/8705 ИЛИ РЗН 2020/9671	до 100 шт	при необходим- ости	1	1	1
33		Термоме- тр (вид 320750).	ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
34		Тест- колпачо- к защитны- й	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
35		Фильтр- ы дыхател- ьные (вид 318730)	ФСР 2011/11397 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ РЗН 2018/7282 ИЛИ РЗН 2019/8405 ИЛИ 2019/8705 ИЛИ РЗН 2019/9010 ИЛИ РЗН 2020/9761					
36		Шапочк и- фиксато ры дыхател ьные (вид 275620)	ФСЗ 2011/10229 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим ости			1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
37		У- образны й коннект ор (вид 151450)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
	4. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологи- ческим и реанимационн- ым оборудование м, вариант исполнения: реанимационн- ые, циркуляционн- ые, в составе:		ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019					
		В составе:						

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
1		Трубка гофриро- ванная (вид 354450)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ РЗН 2013/1311 ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 6 шт.		1	1	1
2		Коннект- ор прямой	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 20 шт.		1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
3		У- образны й коннект ор (вид 151450).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 3 шт.		1	1	1
4		Адаптер кислоро- да	ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2012/11566	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
5		Влагосборник (вид 260670).	ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
6		Держатель контура дыхательного (вид 185520).	ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 5 шт.	при необходим ости	1	1	1
7		Держатель масок (вид 322590)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
8		Канюли для СРАР-терапии	ФСЗ 2011/10229	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
		(вид 105850)						
9		Канюли назальн ые (вид 136410)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ РЗН 2018/7623 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
10		Канюли назальн ые (типа RAM)	ФСЗ 2011/10229 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим ости			1
11		Кислоро- дная трубка (вид 156030).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
12		Камера для увлажни- телей дыхател- ьных смесей (вид 321970)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ ФСЗ 2011/09053					
13		Клапан выдоха (вид 124510)	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551	До 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
14		Клапаны положит ельного давлени я (вид 108960 и 321960)	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
15		Клапан нереве- рс ивный, одно- раз ового исполь- зова- ния (вид 321960)	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
16		Линии контрол я давлени я (вид 271240)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
17		Линия монитор инга газов (вид 271240).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
18		Линия подачи воды	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
19		Маски анестези ологиче ские (вид 275780)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/05401 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ РЗН 2019/8818 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
20		Маски кислоро- дные (вид 167560)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
21		Маски аэрозоль- ные (вид 274020)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
22		Маска носовая аппарата постоян- ного/дву- хфазног- о положит- ельного давлени- я в дыхател- ьных путях (вид 109700)	ФСЗ 2011/10229 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	
23		Маска лицевая аппарата постоян- ного/дву- хфазног- о положит- ельного давлени- я в	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
		дыхател- ьных путях, однораз- ового использ- ования (вид 109710)						
24		Маски лицевые (вид 271390)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ РЗН 2018/7995	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
25		Мешок для дыхател- ьного контура, однораз- ового использ- ования (вид 283370)	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ РЗН 2018/6773	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
26		Монито- р давлени- я (вид 132370)	ФСЗ 2012/11566	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
27		Отражат ели тепла (вид 330090)	ФСЗ 2011/09111	до 100 шт.	при необходим ости			1
28		Распыли- тель аэрозоля (небулай- зер) (вид 324660)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
29		Соедини- тель (вид 327610)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
30		Соедини- тель (вид 165140)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/05401 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2012/12372 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
31		Тепло/в лагообм енник/ба ктериаль ный фильтр (вид 218750)	ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСР 2011/11397 ИЛИ РЗН 2019/8405 ИЛИ РЗН 2019/9010	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ИЛИ РЗН 2019/8705 ИЛИ РЗН 2020/9671					
32		Термоме- тр (вид 320750).	ФСЗ 2007/00742	до 100шт.	при необходим ости	1	1	1
33		Тест- колпачо- к защитны- й	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
34		Тестово- е легкое (вид 107580)	ФСЗ 2011/09111	до 2 шт.	при необходим ости	1	1	1
35		Фильтр- ы дыхател- ьные (вид 318730)	ФСР 2011/11397 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ИЛИ РЗН 2018/7282 ИЛИ РЗН 2019/8405 ИЛИ 2019/8705 ИЛИ РЗН 2019/9010 ИЛИ РЗН 2020/9761					
	5. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологи- ческим и реанимационн- ым оборудование- м, вариант исполнения: реанимационн- ые, с встроенным нагревательны- м элементом, в составе:		ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019					
		В составе:						
1		Трубка гофриро- ванная обогрева- емая	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	До 2 шт.		1		1
2		Трубка гофриро- ванная (вид 354450)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ	до 5 шт.		1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ФСЗ 2009/04992 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2009/03742					
3		Коннект ор прямой	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	До 15 шт.		1		1
4		Соедини- тель (вид 165140)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/05401 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2012/12372 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ	до 5 шт.		1		1

№	Наименование	Комплек тность	Нормативный документ	Количе ство	Примечани е	22мм	15мм	10мм
			ФСЗ 2011/09111					

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
5		Влагосб- орник (вид 260670).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1
6		Генерат- ор дыхания	ФСЗ 2011/10229	до 100 шт.	при необходим- ости			1
7		Держате- ль дыхател- ьного контура (вид 185520).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 5 шт.	при необходим- ости	1		1
8		Держате- ль масок (вид 322590)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1
9		Канюли для	ФСЗ 2011/10229	до 100 шт.	при необходим	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
		СРАР- терапии (вид 105850)			ости			
10		Канюли назаль- ные (вид 136410)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ РЗН 2018/7623 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
11		Канюли назаль- ные (типа RAM)	ФСЗ 2011/10229	до 100 шт.	при необходим ости			1
12		Кабель соедини- тельный электри- ческий к проводу для подогре- ва дыхател- ьных газов (вид 324410).	РЗН 2014/1416	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
13		Камера для увлажни- телей дыхател- ьных смесей (вид 321970)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ИЛИ ФСЗ 2011/09053					
14		Линии контрол- я давлени- я (вид 271240).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1
15		Линия монитор- инга газов (вид 271240).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1
16		Линия подачи воды	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
17		Маски анестези- ологиче- ские (вид 275780)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/05401 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ РЗН 2019/8818 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1
18		Маски лицевые (вид 271390)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ РЗН 2018/7995	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1
19		Мешок для дыхател- ьного контура, однораз- ового использ- ования (вид 283370).	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ФСЗ 2009/03742 ИЛИ РЗН 2018/6773	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
20		Монитор давления (вид 132370)	ФСЗ 2012/11566	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
21		Отражатели тепла (вид 330090)	ФСЗ 2011/09111	до 100 шт.	при необходим ости			1
22		Соединитель (вид 327610)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
23		Тепло/в- лагообм- енник/ба- ктериаль- ный фильтр (вид 218750)	ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСР 2011/11397 ИЛИ РЗН 2019/8405 ИЛИ РЗН 2019/9010 ИЛИ РЗН 2019/8705 ИЛИ РЗН 2020/9671	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1
24		Термоме- тр (вид 320750).	ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1
25		Тест- колпачо- к защитны- й	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1
26		Тестово- е легкое (вид 107580)	ФСЗ 2011/09111	до 2 шт.	при необходим- ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
27		Фильтр ы дыхател ьные (вид 318730)	ФСП 2011/11397 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ РЗН 2018/7282 ИЛИ РЗН 2019/8405 ИЛИ 2019/8705 ИЛИ РЗН 2019/9010 ИЛИ РЗН 2020/9761	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
38		Шапочк и- фиксато ры дыхател ьные (вид 275620)	ФСЗ 2011/10229 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим ости			1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
	6. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологи- ческим и реанимационн- ым оборудование- м, вариант исполнения: реанимационн- ые, циркуляционн- ые, с встроенным нагревательны- м элементом, в составе:		ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019					
		В составе:						
2		Трубка гофриро- ванная (вид 354450)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до шт. 5	при необходим- ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
2		Трубка гофриро- ванная обогрева- емая	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 3 шт.		1		1
3		Влагосб- орник (вид 260670).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1
4		Коннект- ор прямой	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 15 шт.		1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
5		У- образны й коннект ор (вид 151450)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 3 шт.		1		1
6		Держате- ль контура дыхател- ьного (вид 185520).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 5 шт.	при необходим ости	1		1
7		Держате- ль масок (вид 322590)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
8		Канюли для СРАР- терапии	ФСЗ 2011/10229	до 100 шт.	при необходим ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
		(вид 105850)						
9		Кабель соедини- тельный электри- ческий к проводу для подогре- ва дыхател- ьных газов (вид 324410).	РЗН 2014/1416	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1
10		Камера для увлажни- телей дыхател- ьных смесей (вид 321970)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ ФСЗ 2011/09053	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1
11		Линии контрол- я давлени- я (вид 271240)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ФСЗ 2007/00742					
12		Линия монитор- инга газов (вид 271240).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
13		Линия подачи воды	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
14		Маски лицевые (вид 271390)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ РЗН 2018/7995	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
15		Мешок для дыхател- ьного контур,	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928	до 100 шт.	при необходим ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
		однораз- ового использ- ования, (вид 283370).	ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ РЗН 2018/6773					
16		Огранич- ители потока	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим- ости			1
17		Отражат- ели тепла (вид 330090)	ФСЗ 2011/09111	до 100 шт.	при необходим- ости			1
18		Распыли- тель аэрозоля (небулай- зер) (вид 324660)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1
19		Соедини- тель (вид 165140)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/05401 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2012/12372 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111					
20		Соедини- тель (вид 327610)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
21		Термоме- тр (вид 320750)	ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
22		Тест- колпачо- к защитны- й	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
23		Тестово- е легкое (вид 107580)	ФСЗ 2011/09111	до 2 шт.	при необходим ости	1		1
24		Фильтр- ы дыхател- ьные (вид 318730)	ФСР 2011/11397 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ РЗН 2018/7282 ИЛИ	до 100 шт.	при необходим ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			РЗН 2019/8405 ИЛИ 2019/8705 ИЛИ РЗН 2019/9010 ИЛИ РЗН 2020/9761					
25		Шапочк и- фиксато ры дыхател ьные (вид 275620)	ФСЗ 2011/10229 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
	7. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологи- ческим и реанимационн ым оборудование м, вариант исполнения: реанимационн ые, циркуляционн ые, с встроенными нагревательны ми элементами, в составе:		ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019					
		В составе:						
1		Трубка гофриро- ванная обогрева- емая	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 4 шт.		1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
2		Трубка гофриро- ванная (вид 354450)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 5 шт.		1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
3		У- образны й коннект ор (вид 151450)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 3 шт.		1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
4		Влагосб орник (вид 260670).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
5		Держате ль контура дыхател ьного (вид 185520).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 5 шт.	при необходим ости	1		1
6		Держате ль масок (вид 322590)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
7		Канюли для СРАР- терапии (вид 105850)	ФСЗ 2011/10229	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
8		Кабель соедини- тельный электри- ческий к проводу для подогре- ва дыхател- ьных газов (вид 324410).	РЗН 2014/1416	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
9		Камера для увлажни- телей дыхател- ьных смесей (вид 321970)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ ФСЗ 2011/09053	до 100 шт.	при необходим ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
10		Коннект ор прямой	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
11		Линии контрол я давлени я (вид 271240)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
12		Линия монитор инга газов (вид 271240).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
13		Линия подачи воды	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
14		Маски лицевые (вид 271390)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ 2018/7995	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
15		Мешок для дыхател ьного контура, однораз ового использ ования, (вид 283370).	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ РЗН 2018/6773	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
16		Монито р давлени я (вид 132370)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
17		Огранич ители потока	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим ости			1
18		Отражат ели тепла (вид 330090)	ФСЗ 2011/09111	до 100 шт.	при необходим ости			1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
19		Распыли- тель аэрозоля (небулай- зер) (вид 324660)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1
20		Соедини- тель (вид 165140)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/05401 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2012/12372 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1
21		Соедини- тель (вид 327610)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742					
22		Термоме- тр (вид 320750)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
23		Тест- колпачо- к защитны- й	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
24		Тестово- е легкое (вид 107580)	ФСЗ 2011/09111	до 2 шт.	при необходим ости	1		1
25		Фильтр- ы дыхател- ьные (вид 318730)	ФСР 2011/11397 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ	до 100 шт.	при необходим ости			1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ РЗН 2018/7282 ИЛИ РЗН 2019/8405 ИЛИ 2019/8705 ИЛИ РЗН 2019/9010 ИЛИ РЗН 2020/9761					
26		Шапочк и- фиксато ры дыхател ьные (вид 275620)	ФСЗ 2011/10229 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
Эксплуатационная документация								
Инструкция по применению (для потребителя) – 1 шт. на транспортную упаковку.								

11 Упаковка

Покупные изделия должны поставляться в индивидуальной и/или потребительской упаковке производителя, при необходимости упаковываются в групповую упаковку совместно с устройством. Устройство должно быть упаковано в индивидуальную (групповую) упаковку. Составные части устройства при необходимости должны упаковываться в индивидуальную упаковку. Потребительская (транспортная) упаковка – ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142. В каждую транспортную упаковку должен быть вложен упаковочный лист. Масса транспортной упаковки брутто - не более 150 кг.

12 Маркировка

Маркировка устройства должна соответствовать требованиям ТУ 32.50.21-003-40945934-2019, быть четкой и разборчивой при нормальном или скорректированном до нормального зрения. Маркировка на индивидуальной упаковке должна быть постоянной и несмываемой. В маркировке устройства могут быть применены символы в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1.

На индивидуальную упаковку наносится следующая маркировка:

- наименование изделия (надпись);
- наименование и адрес места производства (символ, надпись: наименование, адрес);
- наименование и адрес изготовителя, принимающего претензии потребителей (надпись: наименование, адрес);
- логотип предприятия-изготовителя (символ);
- штрих-код (символ);
- код партии (символ, надпись);
- номер по каталогу (символ, надпись);
- состав изделия (надпись);
- тип изделия;
- дата изготовления (символ, надпись);
- использовать до (символ, надпись);
- предупреждение о запрете на повторное применение (символ);
- предупреждение о запрете использования при повреждении упаковки (символ);
- предупреждение о необходимости обратиться к инструкции по применению (символ);
- сведения о пределах температурного диапазона хранения (символ);
- сведения о диапазоне влажности (символ);
- не допускать воздействия солнечного света (символ);
- беречь от влаги (символ);
- апиrogenно (символ);
- нетоксично, нестерильно (надпись: «нетоксично», «нестерильно»);
- сведения об утилизации (надпись);
- количество изделий, шт. (надпись);
- номер и дата регистрационного удостоверения (надпись);
- QR-код (Инструкция по применению размещается на официальном сайте производителя в сети "Интернет", а также отправляется по запросу направленному в адрес производителя).

Маркировка покупных изделий маркируется производителем и дополнительно содержит:

- наименование и адрес изготовителя, принимающего претензии потребителей;
- наименование изделия.

Транспортная маркировка изделий содержит:

- наименование изделия;
- тип изделия;
- код партии;
- номер по каталогу;
- наименование и адрес изготовителя, принимающего претензии потребителей;
- наименование и адрес места производства;
- количество изделий;
- дата изготовления;
- дата истечения срока годности;
- условия хранения (сведения о температурном диапазоне хранения, сведения о диапазоне влажности);
- штрих-код;

- масса брутто, кг;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- ограничена возможность штабелирования груза;
- контроль ОТК (Отдел технического контроля);
- QR – код (Инструкция по применению размещается на официальном сайте производителя в сети "Интернет", а также отправляется по запросу направленному в адрес производителя).

На транспортную упаковку могут быть нанесены манипуляционные знаки «Беречь от влаги», «Предел по количеству ярусов в штабеле» (не более 8 ярусов), «Беречь от солнечных лучей», «Верх», «Предел штабелирования по массе» (25 кг) по ГОСТ 14192. Обозначение условий хранения и другие дополнительные надписи должны быть нанесены на тару или ярлык в местах, свободных от транспортной маркировки. Возможно нанесение дополнительной маркировки на индивидуальную и потребительскую упаковки, содержащую информацию в соответствии с требованиями заказчика (например, наименование заказчика, адрес заказчика, рекламные слоганы и т.д.). Дополнительная маркировка не должна вводить в заблуждение потребителя.

13 Условия эксплуатации

Устройство применяется в помещениях и на улице в следующих климатических условиях:

- температура воздуха: от + 10 °С до + 35 °С;
- относительная влажность воздуха: 35-80%;
- атмосферное давление: 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.).

14 Транспортирование

Упакованное устройство транспортируют всеми видами транспортных средств, в крытых средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортируются в следующих климатических условиях:

- температура воздуха: от - 50 °С до + 50 °С;
- относительная влажность воздуха: 0-95%;
- атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

15 Хранение

Хранение устройств осуществляется в закрытых отапливаемых помещениях в следующих климатических условиях:

- температура воздуха: от + 5 °С до + 40 °С;
- относительная влажность воздуха: 0-80%;
- атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.),

Хранение изделия должно осуществляться вдали от нагревательных приборов, в защищенном от солнца месте.

Срок годности устройств составляет 5 лет с даты производства. При использовании в составе Устройств покупных изделий, зарегистрированных в установленном порядке в Росздравнадзоре, срок годности Устройства определяется остаточным сроком годности покупного изделия, имеющего наименьший срок годности.

16 Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие устройств, заявленных в документации показателями качества и характеристиками при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течение всего срока годности. Производитель не несет ответственности за случайные или косвенные убытки, ущерб или расходы, прямо или косвенно связанные с использованием данного изделия; не несет ответственности в

отношении изделий, подвергаемых повторной обработке, используемых повторно, подвергаемых воздействию климатических и механических факторов при транспортировании и хранении, отличных от указанных в документации производителя, и не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо всего прочего, гарантии коммерческого качества и пригодность для использования по назначению в отношении таких изделий.

Срок годности изделия с даты производства – 5 лет. Срок годности изделия, в составе которого применяются покупные изделия, определяется остаточным сроком годности покупного изделия, имеющего наименьший срок годности.

17 Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия

17.1 Устройства, не использованные по назначению, с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А.

17.2 Устройства, использованные по назначению, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса Б.

17.3 Устройства, использованные по назначению во фтизиатрии, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса В.

18 Контактная информация


18.1 В случае возникновения вопросов, связанных с применением изделий, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться по указанному адресу: ООО «МЕДИПЛАСТ», 196641, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Дорога на Металлострой, дом 5, литера А, помещение 7-Н, оф.6.

18.2 В случае утери данной инструкции и/или возникновении необходимости ознакомления с инструкцией по применению (для специалистов) потребитель может обратиться по e-mail: mediplast.st.petersburg@gmail.com.

Приложение А: Манипуляционные символы, указанные на упаковке:


Символ	Обозначение
	Использовать до ...
	Дата изготовления
	Код партии
	Номер по каталогу
	Сведения о производителе
	Обратитесь к инструкции по применению
	Температурный диапазон
	Не допускать воздействия солнечного света
	Беречь от влаги
	Запрет на повторное применение
	Не использовать при повреждении упаковки
	Диапазон влажности

Приложение Б
(обязательное)
Внешний вид изделия

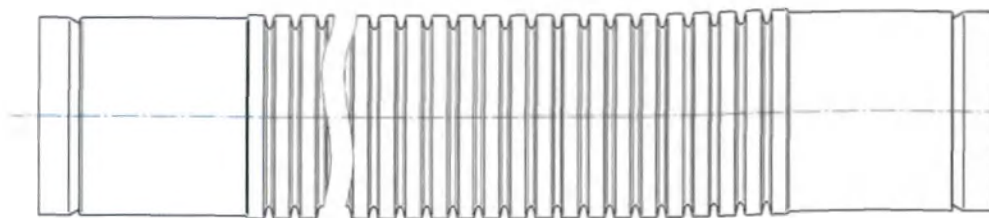


Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
Трубка гофрированная 22	Диаметр наружный (24±3) мм. Длина (от 20см до 5500 см с шагом 1 см), допуск составляет ±10% от номинальной величины.	3000

Рисунок В1. Трубка гофрированная 22.

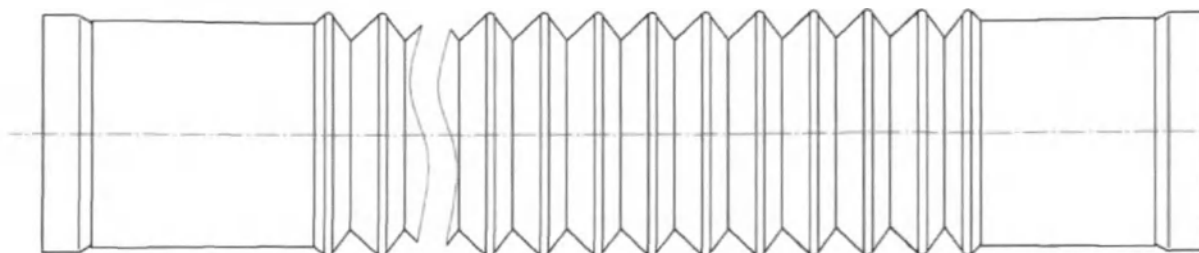


Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
Трубка гофрированная растяжимая 22	Диаметр наружный (24±3) мм. Длина (от 20см до 5500 см с шагом 1 см), допуск составляет ±10% от номинальной величины.	2000

Рисунок В2. Трубка гофрированная растяжимая 22.

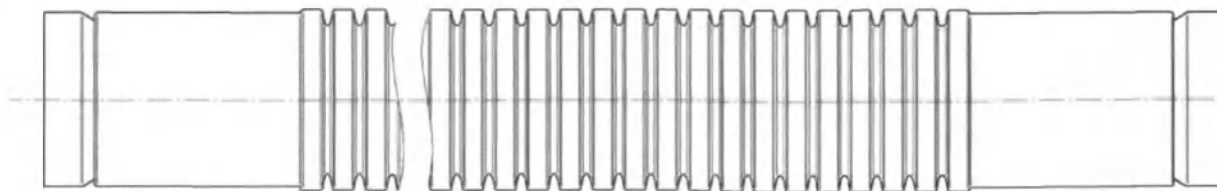


Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
Трубка гофрированная 15	Диаметр наружный (17±3) мм. Длина (от 20см до 5500 см с шагом 1 см), допуск составляет ±10% от номинальной величины.	1900

Рисунок В3. Трубка гофрированная 15.

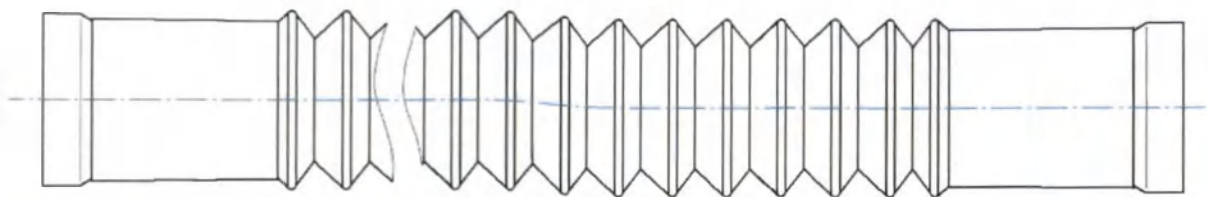


Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
Трубка гофрированная растяжимая 15	Диаметр наружный (21 ± 3) мм. Длина (от 20 см до 5500 см с шагом 1 см), допуск составляет $\pm 10\%$ от номинальной величины.	1900

Рисунок В4. Трубка гофрированная растяжимая 15.

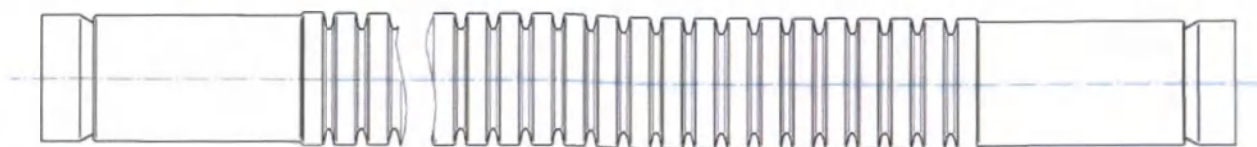

Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
Трубка гофрированная 10	Диаметр наружный (12 ± 3) мм. Длина (от 20 см до 300 см с шагом 1 см), допуск составляет $\pm 10\%$ от номинальной величины	60


Рисунок В5. Трубка гофрированная 10.

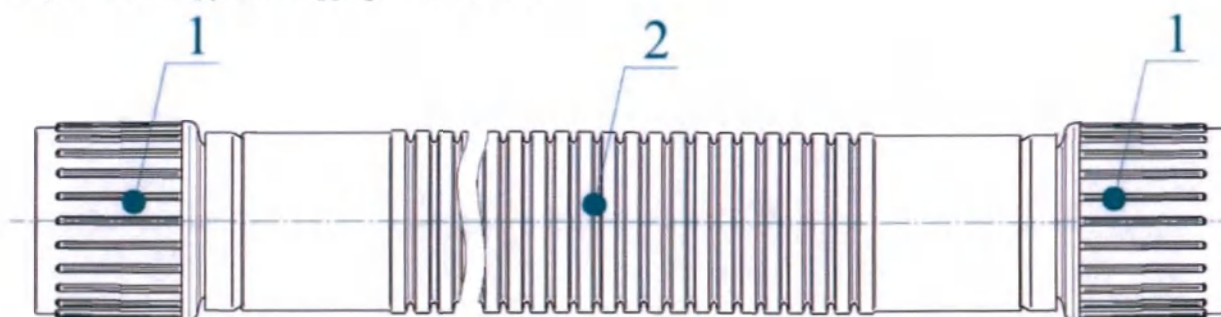

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 22 22F	Длина (48 ± 2) мм. Диаметр присоединительный 22F $(\varnothing 22,2 \pm 0,5)$ мм	6
2	Трубка гофрированная 22	Диаметр наружный (24 ± 3) мм. Длина (от 20 см до 300 см с шагом 1 см), допуск составляет $\pm 10\%$ от номинальной величины	180
	Устройства в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 25 см до 305 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$ от номинальной величины.	192


	Внешний диаметр - (27 ± 2) мм.	
--	------------------------------------	--

Рисунок В 7. Трубка гофрированная 22, длиной трубки от 20см до 300см с шагом 1 см, с коннекторами 22F: 1 – коннектор-22 22F; 2 – трубка гофрированная 22.

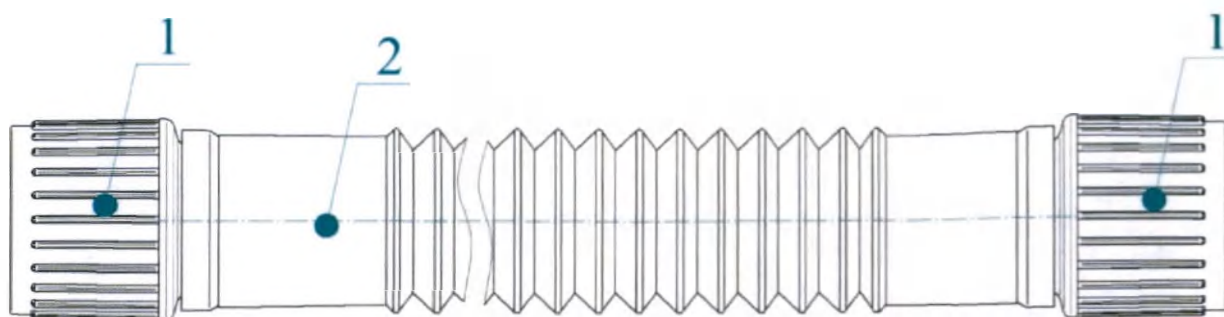

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 22 22F	Длина (48 ± 2) мм. Диаметр присоединительный 22F $(\varnothing 22,2 \pm 0,5)$ мм	6
2	Трубка гофрированная растяжимая 22	Диаметр наружный (25 ± 2) мм. Длина (от 20см до 300 см с шагом 1 см), допуск составляет $\pm 10\%$ от номинальной величины	120
	Устройства в сборе	Габаритные размеры: Длина в растянутом состоянии – варианты исполнения от 25 см до 305 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$ от номинальной величины. Внешний диаметр - (27 ± 2) мм.	132


Рисунок 8. Трубка гофрированная растяжимая 22, длиной трубки от 20 см до 300 см с шагом 1 см, с коннекторами 22F: 1 – коннектор-22 22F; 2 – трубка растяжимая 22.

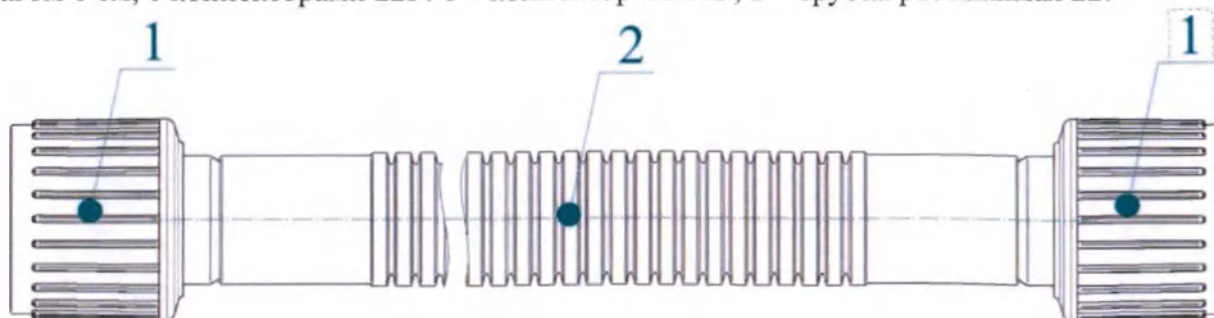

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 15 22F	Длина (48 ± 2) мм. Диаметр присоединительный 22F $(\varnothing 22,2 \pm 0,5)$ мм	5
2	Трубка гофрированная 15	Диаметр наружный (17 ± 3) мм. Длина (от 20см до 300 см с шагом 1 см),	110


		допуск составляет $\pm 10\%$ от номинальной величины	
	Устройства в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 25 см до 305 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$ от номинальной величины. Внешний диаметр - (27 ± 2) мм.	120

Рисунок В9. Трубка гофрированная 15, длинна трубки от 20см до 300см с шагом 1 см, с коннекторами 22F: 1 – коннектор-15 22F; 2 – трубка гофрированная 15.

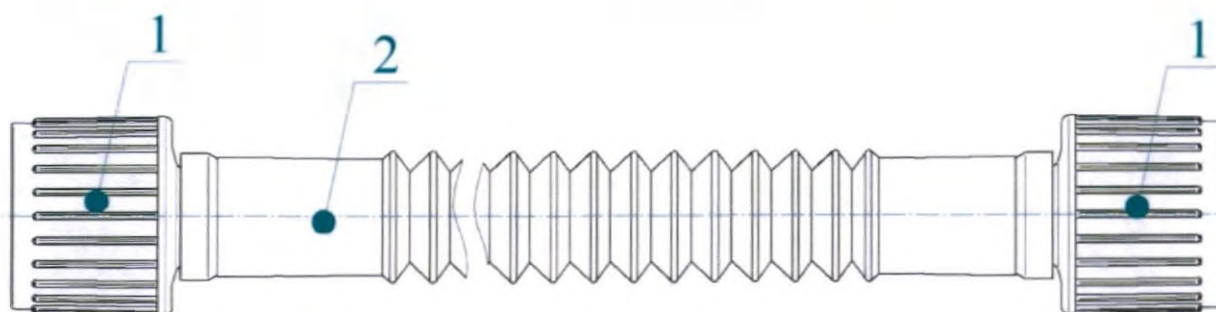

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 15 22F	Длина (48 ± 2) мм. Диаметр присоединительный 22F ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм	5
2	Трубка растяжимая 15	Диаметр наружный (21 ± 2) мм. Длина (от 20см до 300 см с шагом 1 см), допуск составляет $\pm 10\%$ от номинальной величины	110
	Устройства в сборе	Габаритные размеры: Длина в растянутом состоянии– варианты исполнения от 25 см до 305 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$ от номинальной величины. Внешний диаметр - (27 ± 2) мм.	120


Рисунок В10. Трубка гофрированная растяжимая 15, длинной трубки от 20см до 300см с шагом 1 см, с коннекторами 22F: 1 – коннектор-15 22F; 2 – трубка гофрированная растяжимая 15.

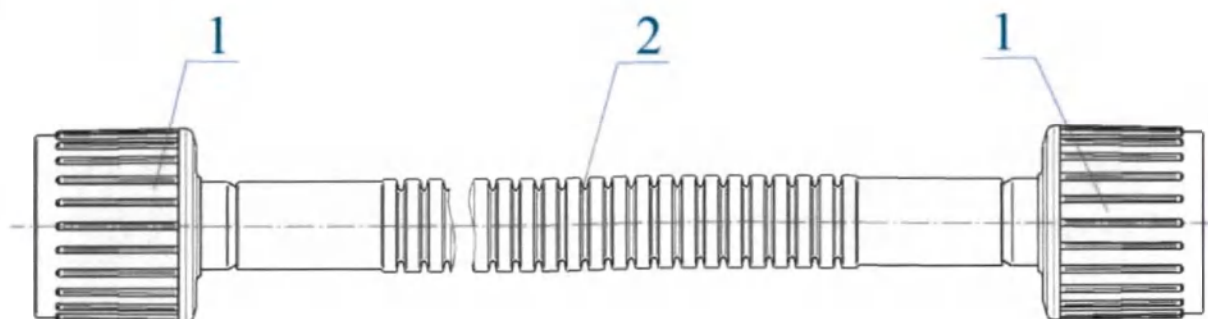

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 10 22F	Длина (48 ± 2) мм.	6


		Диаметр присоединительный 22F ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм	
2	Трубка гофрированная 10	Диаметр наружный (13 ± 3) мм. Длина (от 20 см до 300 см с шагом 1 см), допуск составляет $\pm 10\%$ от номинальной величины.	60
	Устройства в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 25 см до 305 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$ от номинальной величины. Внешний диаметр - (27 ± 2) мм.	72

Рисунок В11. Трубка гофрированная 10, длиной трубки от 20 см до 300 см с шагом 1 см, с коннекторами 22F: 1 – коннектор-15 22F; 2 – трубка гофрированная 10.

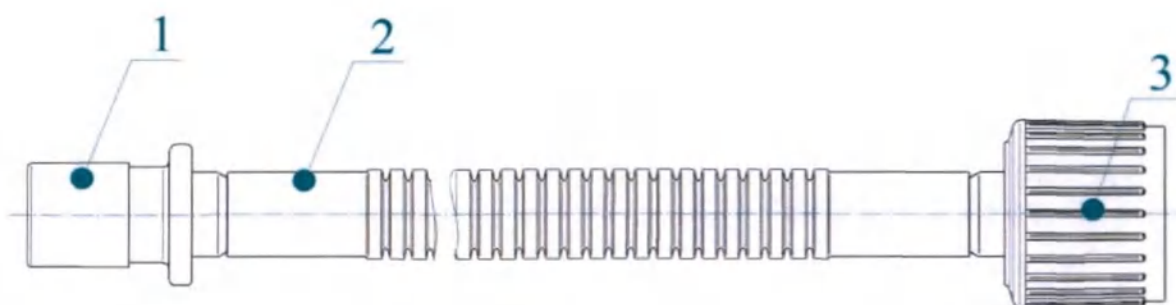


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 10 15M	Длина (48 ± 5) мм. Диаметр присоединительный 15M ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм	5
2	Трубка гофрированная 10	Диаметр наружный (13 ± 3) мм. Длина (от 20 см до 300 см с шагом 1 см), допуск составляет $\pm 10\%$ от номинальной величины	60
3	Коннектор – 15 22F	Длина (48 ± 5) мм. Диаметр присоединительный 22F ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм	6
	Устройства в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 25 см до 305 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$ от номинальной величины. Внешний диаметр - (27 ± 2) мм.	71

Рисунок В12. Трубка гофрированная 10, длиной трубки от 20 см до 300 см с шагом 1 см, с коннекторами 15M и 22F: 1 – коннектор-15 15M; 2 – трубка гофрированная 10; 3 – коннектор-15 22F.

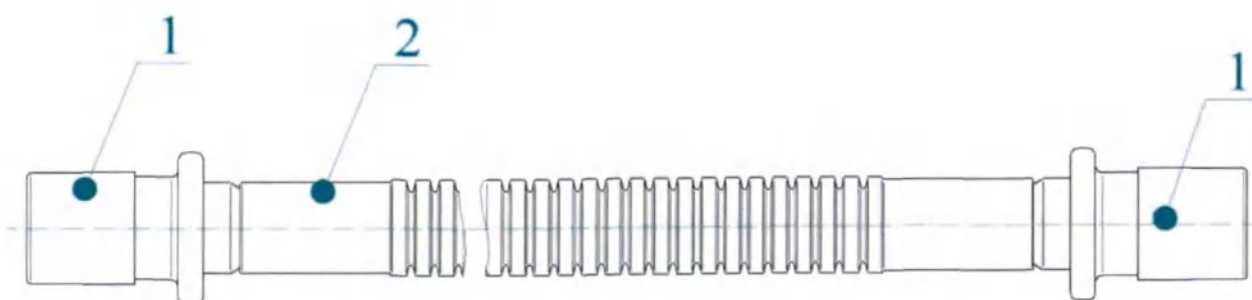

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 10 15M	Длина (48±5) мм. Диаметр присоединительный 15M (Ø15,3±0,5) мм	5
2	Трубка гофрированная 10	Диаметр наружный (13±3) мм. Длина (от 20см до 300 см с шагом 1 см), допуск составляет ±10% от номинальной величины.	60
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 25 см до 305 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет ±10% от номинальной величины. Внешний диаметр - (18±2) мм.	70


Рисунок В13. Трубка гофрированная 10, длиной трубки от 20см до 300см с шагом 1 см, с коннекторами 15M: 1 – коннектор-15 15M; 2 – трубка гофрированная 10.

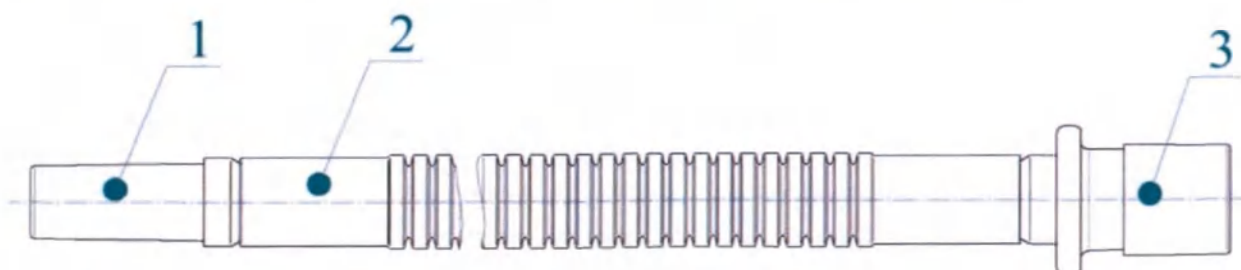

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 10 10M	Длина (48±5) мм. Диаметр присоединительный 10M (Ø10,3±1) мм	5
2	Трубка гофрированная 10	Диаметр наружный (13±3) мм. Длина (от 20см до 300 см с шагом 1 см), допуск составляет ±10% от номинальной величины	60
3	Коннектор – 10 15M	Длина (48±5) мм. Диаметр присоединительный 15M (Ø15,3±0,5) мм	5
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 25 см до 305 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет ±10% от номинальной	70


	величины. Внешний диаметр - (18 ± 2) мм.	
--	---	--

Рисунок В 14. Трубка гофрированная 10, длиной трубки от 5 см до 300 см с шагом 1 см, с коннекторами 10М и 15М: 1 – коннектор-15 10М; 2 – трубка гофрированная 10; 3 – коннектор-15 15М.

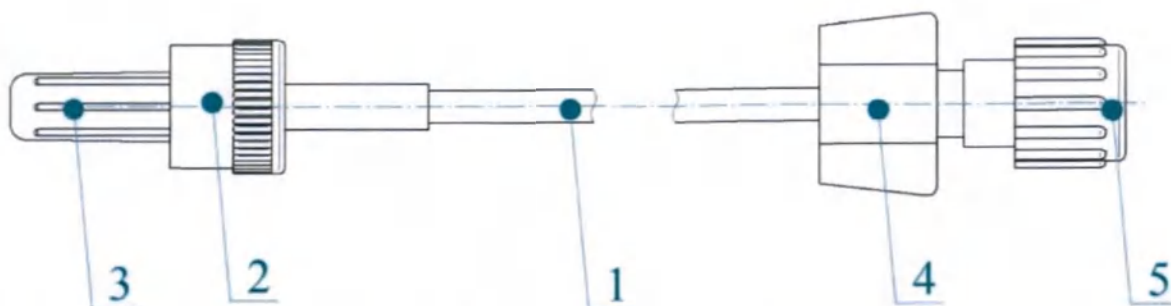


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Трубка мониторинга газов	Диаметр наружный $(2,5 \pm 0,4)$ мм. Длина (от 70см до 300 см с шагом 1) см.	20
2	Коннектор Luer Lock male 2,5	Диаметр присоединительный $(\varnothing 3,9 \pm 0,3)$ мм Конус 6% «Luer»	1
3	Колпачок коннектора Luer Lock male	Длина (19 ± 5) мм.	0,7
4	Коннектор Luer Lock female 2,5	Диаметр присоединительный $(\varnothing 3,9 \pm 0,3)$ мм Конус 6% «Luer»	0,8
5	Колпачок коннектора Luer Lock female	Длина (10 ± 2) мм.	0,7
Общая масса			23,2

Рисунок 15. Линия мониторинга газов, с коннекторами Luer Lock male и female: 1 – трубка мониторинга газов; 2 – коннектор Luer Lock male; 3 – колпачок коннектора Luer Lock male; 4 – коннектор Luer Lock female; 5 – колпачок коннектора Luer Lock female.

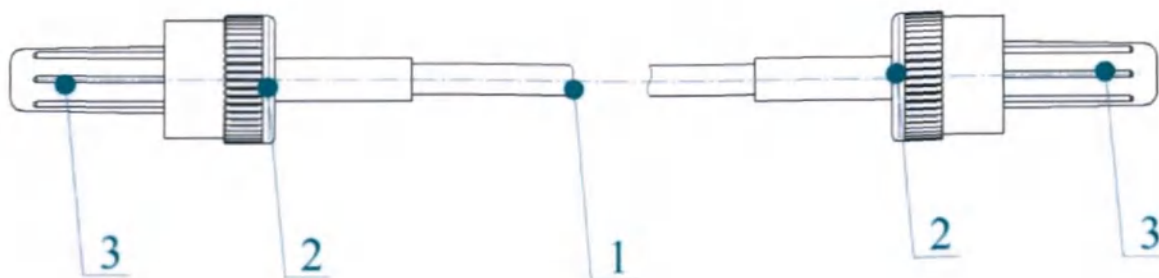


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Трубка мониторинга газов	Диаметр наружный ($2,5 \pm 0,4$) мм. Длина (от 70 см до 300 см с шагом 1) см.	20
2	Коннектор Luer Lock male 2,5	Диаметр присоединительный ($\varnothing 3,9 \pm 0,3$) мм Конус 6% «Luer»	1
3	Колпачок коннектора Luer Lock male	Длина (19 ± 5) мм.	0,7
Общая масса			23,4

Рисунок В 16. Линия мониторинга газов, с коннекторами Luer Lock male: 1 – трубка мониторинга газов; 2 – коннектор Luer Lock male; 3 – колпачок коннектора Luer Lock male

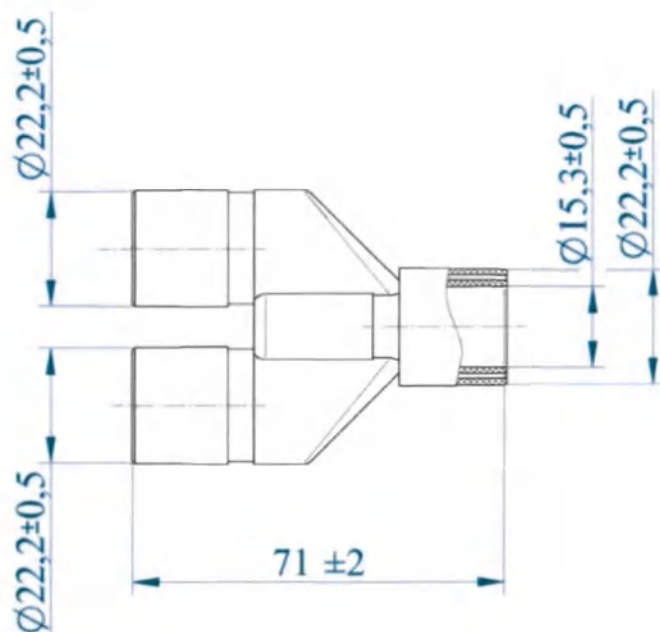


Масса не более - 14г.

Рисунок В17. Y-образный коннектор 22M/15F-22M-22M без портов

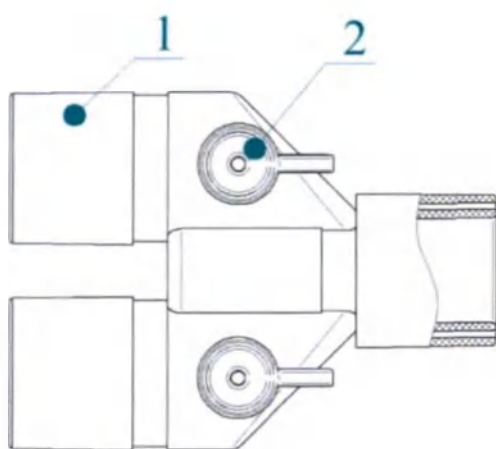


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Y-образный коннектор 22M/15F-22M-22M с портами 7,6	Длина (71 ± 2) мм. Диаметр присоединительный 15F $(\varnothing 15,3 \pm 0,5)$ мм. Диаметр присоединительный 22M $(\varnothing 22,2 \pm 0,5)$ мм.	15
2	Пробка 7,6	Диаметр $(7,6 \pm 0,5)$ мм.	0,7
Общая масса			15,7

Рисунок 18. Y-образный коннектор 22M/15F-22M-22M с портами 7,6: 1 – Y-образный коннектор 22M/15F-22M-22M с портом 7,6; 2- пробка 7,6.

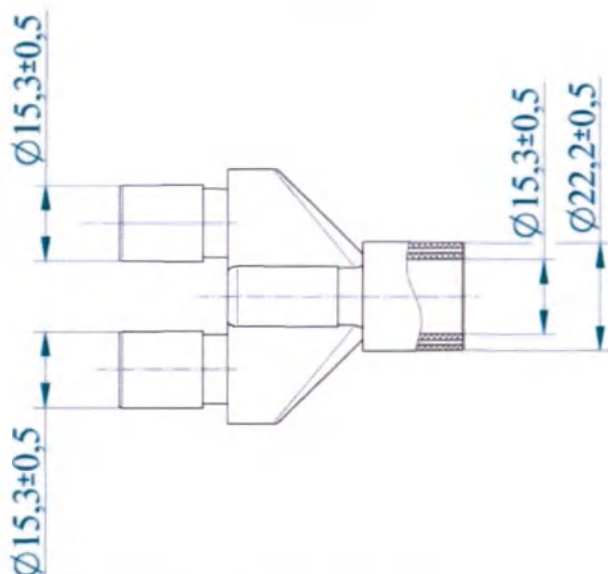


Масса не более – 13г.

Рисунок В19. Y-образный коннектор 22M/15F-15M-15M без портов

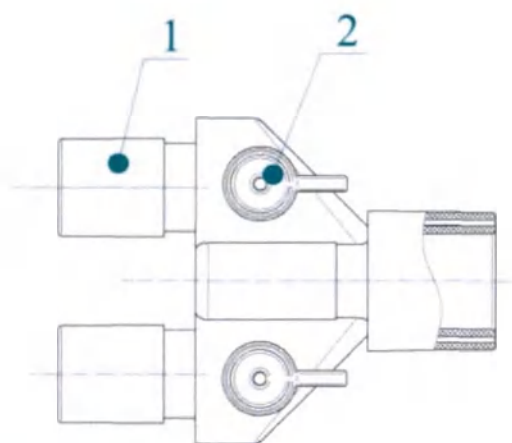

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Y-образный коннектор 22M/15F-15M-15M с портами 7,6	Длина (71 ± 2) мм. Диаметр присоединительный 15F $(\varnothing 15,3 \pm 0,5)$ мм. Диаметр присоединительный 15M $(\varnothing 15,3 \pm 0,5)$ мм. Диаметр присоединительный 22M $(\varnothing 22,2 \pm 0,5)$ мм.	14
2	Пробка 7,6	Диаметр $(7,6 \pm 0,5)$ мм.	0,7
Общая масса			15,4


Рисунок В20. Y-образный коннектор 22M/15F-15M-15M с портами 7,6: 1 – Y-образный коннектор 22M/15F-15M-15M с портами 7,6; 2 – пробка 7,6

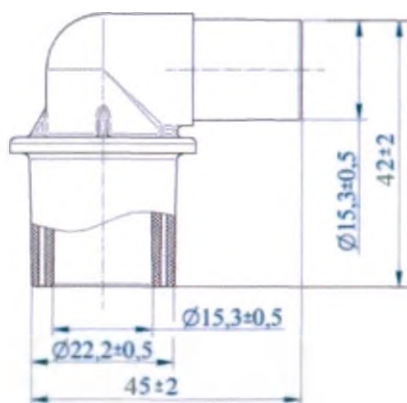

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Соединитель угловой 22M/15F-15M без портов	Диаметр присоединительный 15M, 15F $(\varnothing 15,3 \pm 0,5)$ мм. Диаметр присоединительный 22M	8


		($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм. Длина (45 ± 2) мм. Высота (42 ± 2) мм.	
	Устройство в сборе	Габаритные размеры – (45 ± 2) x (28 ± 2) x (42 ± 2) мм	8

Рисунок В21. Соединитель угловой 22М/15F-15М без портов

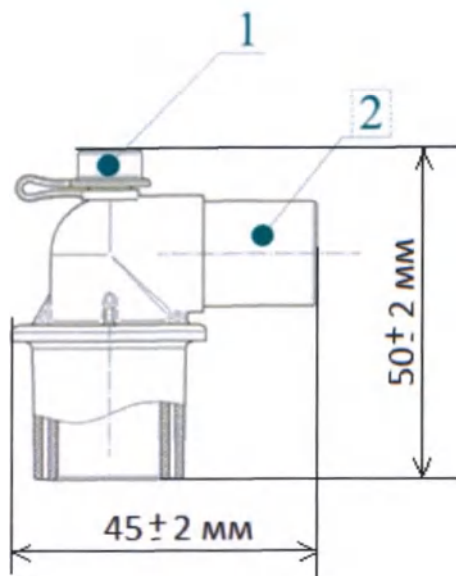


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Пробка Луэр	Диаметр (внутренней заглушки) ($4,3 \pm 0,3$) мм.	0,5
2	Соединитель угловой 22М/15F-15М с портом Луэр	Диаметр присоединительный 15М, 15F ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22М ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм. Длина (45 ± 2) мм. Высота (50 ± 2) мм.	8
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: 45x28x50мм (± 2 мм).	8

Рисунок В22. Соединитель угловой 22М/15F-15М с портом Луэр: 1 – пробка Луэр; 2 – коннектор угловой 22М/15F-15М с портом Луэр.

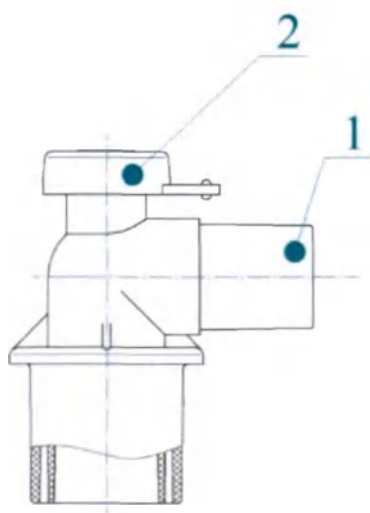


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Соединитель угловой 22М/15F-15М с портом 7,6	Диаметр присоединительный 15М, 15F ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22М ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм. Длина (45 ± 2) мм. Высота (53 ± 2) мм.	9
2	Пробка 7,6	Диаметр ($\varnothing 7,6 \pm 0,3$) мм.	0,7
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: 45x28x53мм (± 2 мм).	9,7

Рисунок В23. Соединитель угловой 22М/15F-15М с портом 7,6: 1 – коннектор угловой 22М/15F-15М с портом 7,6; 2 – пробка 7,6.

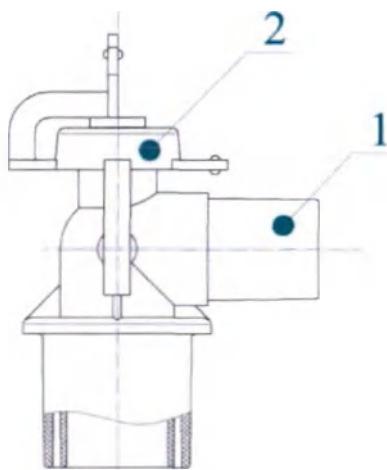

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Соединитель угловой 22M/15F-15M с портом 7,6/9,5	Диаметр присоединительный 15M, 15F ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22M ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм. Длина (45 ± 2) мм. Высота (57 ± 2) мм.	9
2	Пробка 7,6/9,5	Диаметр ($\varnothing 7,6 \pm 0,5$) мм. Диаметр ($\varnothing 9,6 \pm 0,5$) мм.	0,8
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: 48x29x68мм (± 2 мм).	9,8

Рисунок В24. Соединитель угловой 22M/15F-15M с портом 7,6/9,5: 1 – коннектор угловой 22M/15F-15M с портом 7,6/9,5; 2 – пробка 7,6/9,5.

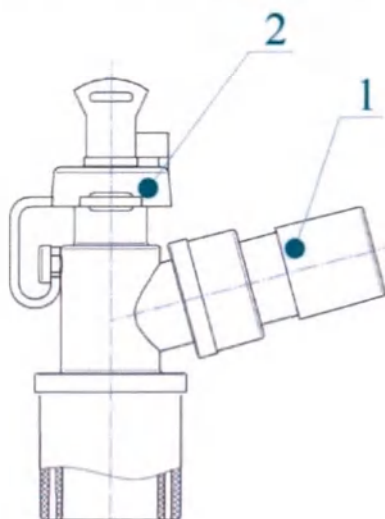


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Соединитель угловой шарнирный коннектор 22M/15F-15M с портом 7,6/9,5	Диаметр присоединительный 15M, 15F ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22M ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм. Длина (47 ± 2) мм. Высота (57 ± 2) мм.	11
2	Пробка 7,6/9,5	Диаметр ($\varnothing 7,6 \pm 0,5$) мм. Диаметр ($\varnothing 9,6 \pm 0,5$) мм.	0,8
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: 48x29x68мм (± 2 мм).	11,8

Рисунок В25. Соединитель угловой шарнирный 22M/15F-15M с портом 7,6/9: 1 – шарнирный угловой коннектор 22M/15F-15M с портом 7,6/9,5; 2 – пробка 7,6/9,5.




Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
Линия контроля давления	Диаметр наружный (5,5±0,5) мм. Длина (от 50 до 300 с шагом 5) см.	60

Рисунок В26. Линия контроля давления.

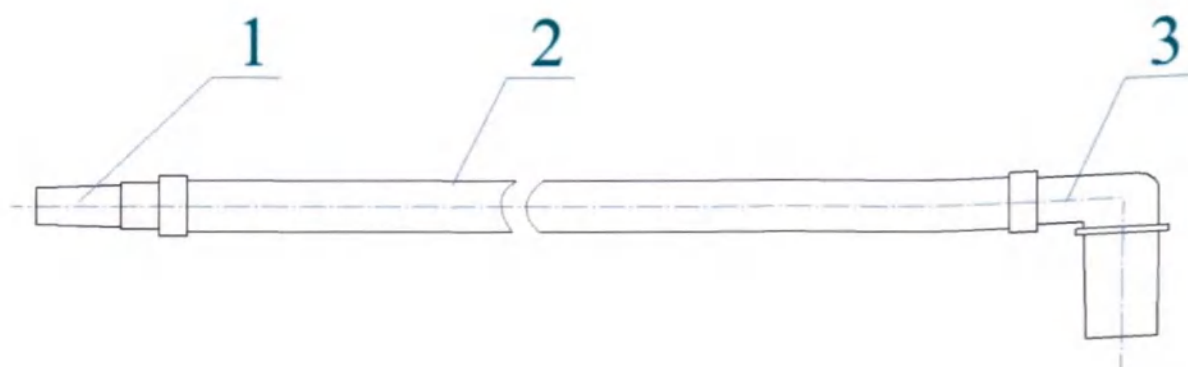


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Втулка Luer 5,5	Диаметр присоединительный (Ø3,9±0,3) мм Конус 6% «Luer»	1
2	Линия контроля давления	Диаметр наружный (5,5±0,5) мм. Длина (от 50 до 300 с шагом 5) см.	45
3	Угольник 7,6	Диаметр присоединительный (8±1) мм.	1,5
Общая масса			47,5

Рисунок В27. Линия контроля давления, с коннектором Luer: 1 – втулка Luer; 2-трубка контроля давления; 3-угольник 7,6

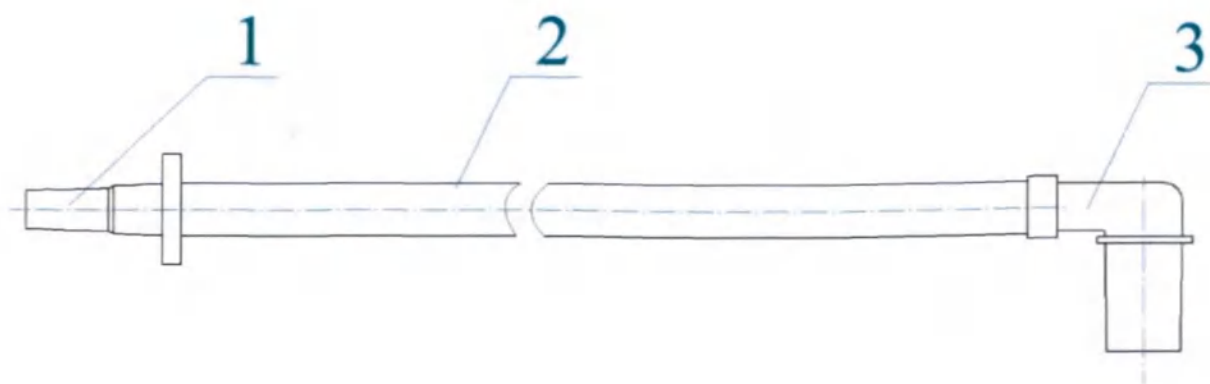

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор прямой	Диаметр присоединительный ($\varnothing 4,3 \pm 0,5$) мм	1
2	Трубка контроля давления	Диаметр наружный ($5,5 \pm 0,5$) мм. Длина (от 50 до 300 с шагом 5) см.	45
3	Угольник 7,6	Диаметр присоединительный (8 ± 1) мм.	1,5
Общая масса			47,5


Рисунок В28. Линия контроля давления, с прямым коннектором: 1 –коннектор прямой; 2- трубка контроля давления; 3-угольник 7,6

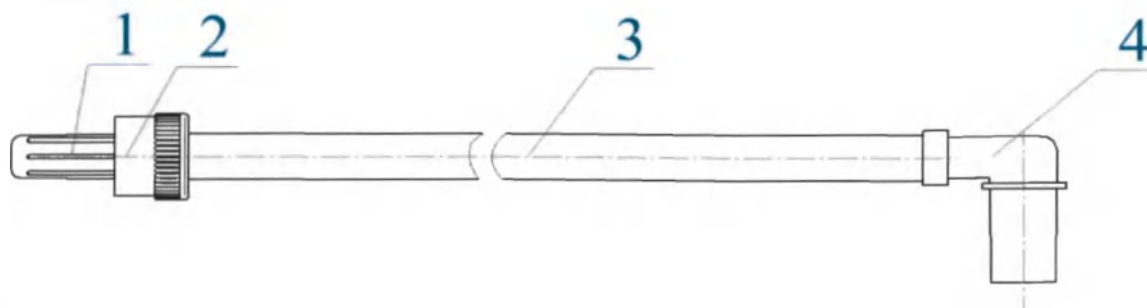

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Колпачок коннектора Luer Lock male	Длина (19 ± 5) мм.	0,7
2	Коннектор Luer Lock male 5,5	Диаметр присоединительный ($\varnothing 3,9 \pm 0,3$) мм Конус 6% «Luer»	1
3	Трубка контроля давления	Диаметр наружный ($5,5 \pm 0,5$) мм. Длина (от 50 до 300 с шагом 5) см.	45


4	Угольник 7,6	Диаметр присоединительный (8±1) мм.	1,5
		Общая масса	48,2

Рисунок В 29. Линия контроля давления, с коннектором Luer Lock: 1 – колпачок коннектора Luer Lock male; 2 – коннектор Luer Lock male; 3-трубка контроля давления; 4- угольник 7,6

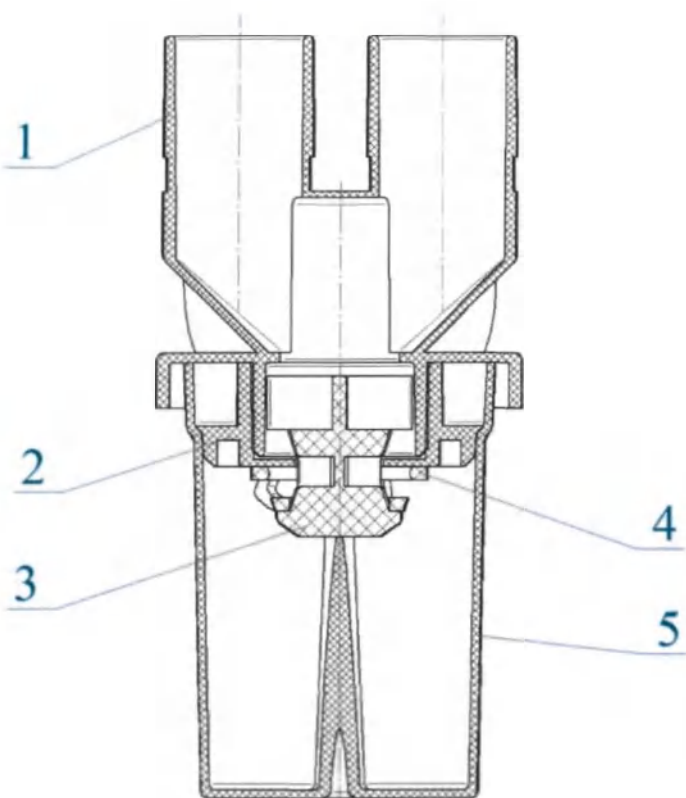


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Крышка влагоборника 22М, 22М	Диаметр присоединительный 22М (Ø22,2±0,5) мм.	18
2	Манжета влагоборника	Диаметр наружный (Ø47±5) мм. Диаметр внутренний (Ø14±2) мм.	6
3	Клапан влагоборника	Длина (19±2) мм. Диаметр наружный (Ø24±2) мм.	3
4	Пружина влагоборника	Диаметр наружный (Ø26±2) мм.	1
5	Корпус влагоборника	Длина (65±5) мм. Диаметр наружный (Ø50±4) мм.	16
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Высота – (114±3) мм; Внешний диаметр – (54±2) мм.	44

Рисунок В30. Влагоборник 22М, 22М: 1- крышка влагоборника 22М, 22М; 2-манжета влагоборника; 3-клапан влагоборника; 4-пружина влагоборника; 5-корпус влагоборника

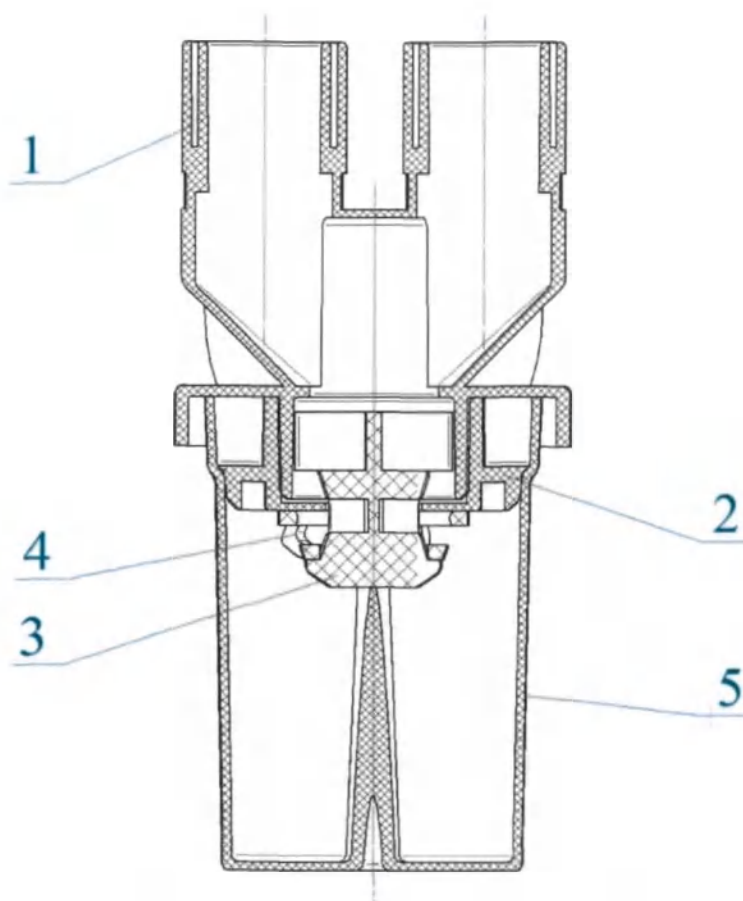


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Крышка влагосборника 22M/15F, 22M/15F	Диаметр присоединительный 22M ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм. Диаметр присоединительный 15F ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм.	23
2	Манжета влагосборника	Диаметр наружный ($\varnothing 47 \pm 5$) мм. Диаметр внутренний ($\varnothing 14 \pm 2$) мм.	6
3	Клапан влагосборника	Длина (19 ± 2) мм. Диаметр наружный ($\varnothing 24 \pm 2$) мм.	3
4	Пружина влагосборника	Диаметр наружный ($\varnothing 26 \pm 2$) мм.	1
5	Корпус влагосборника	Длина (65 ± 5) мм. Диаметр наружный ($\varnothing 50 \pm 4$) мм.	16
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Высота – (114 ± 3) мм; Внешний диаметр – (54 ± 2) мм.	49

Рисунок 31. Влагосборник 22M/15F, 22M/15F: 1- крышка влагосборника 22M/15F, 22M/15F; 2-манжета влагосборника; 3-клапан влагосборника; 4-пружина влагосборника; 5-корпус влагосборника

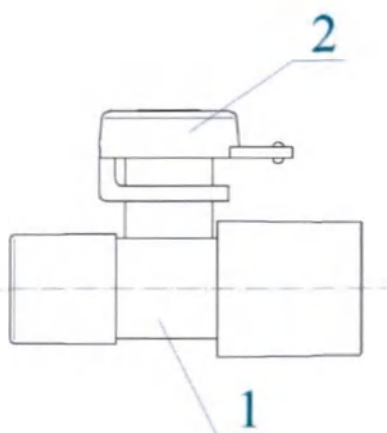


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор 15М-15F с портом 7,6	Диаметр присоединительный 15М, 15F ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм.	8
2	Пробка 7,6	Диаметр ($\varnothing 7,6 \pm 0,5$) мм.	0,7
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: 49x16x30мм.	8,7

Рисунок В32. Коннектор прямой 15М-15F с портом 7,6: 1 –коннектор 15М-15F с портом 7,6; 2 – пробка 7,6

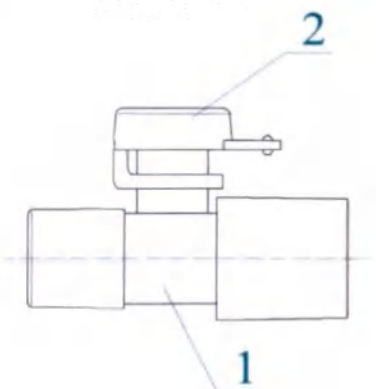


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор 15М-15F с портом 6	Диаметр присоединительный 15М, 15F ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм.	8
2	Пробка 6.0	Диаметр ($\varnothing 6 \pm 0,6$) мм.	0,7
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: 49x16x30мм.	8,7


Рисунок В33. Коннектор прямой 15М-15F с портом 6.0: 1 –коннектор 15М-15F с портом 6.0; 2 – пробка 6.0.

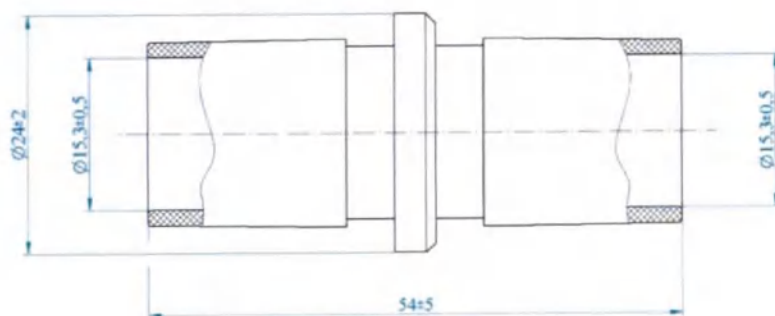

Длина – (54 ± 5) мм;
 Внешний диаметр – (24 ± 2) мм.
 Масса не более – 7г
 Рисунок В34. Коннектор прямой 15F-15F

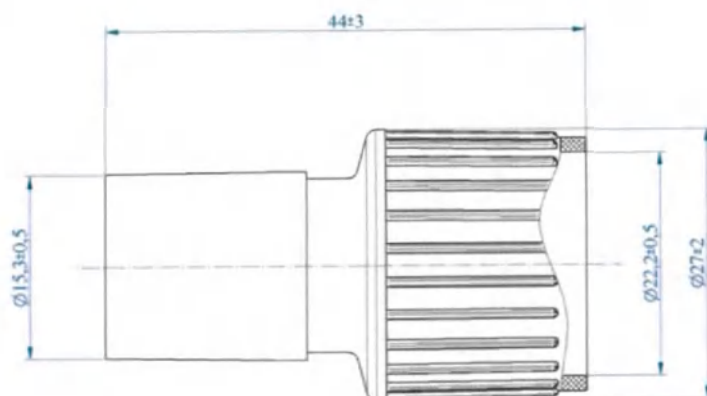

Масса не более – 6г.
 Габаритные размеры:
 Длина – (44 ± 3) мм;
 Внешний диаметр – (27 ± 2) мм.
 Рисунок В35. Коннектор прямой 15M-22F

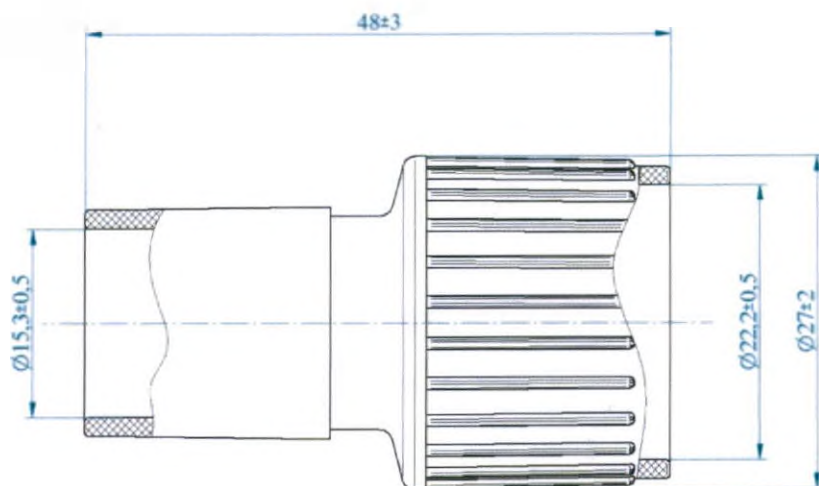


Масса не более – 6г.;

Габаритные размеры:

Длина – (48 ± 3) мм;

Внешний диаметр – (27 ± 2) мм.

Рисунок В36. Коннектор прямой 15F-22F

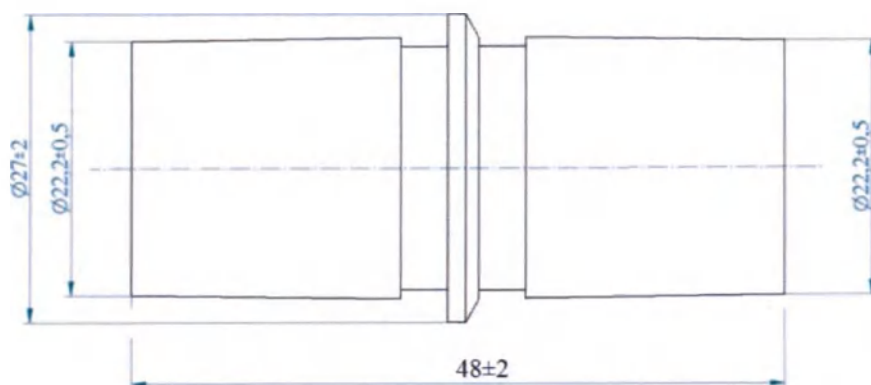


Масса не более – 7г.;

Габаритные размеры:

Длина – (48 ± 2) мм;

Внешний диаметр – (27 ± 2) мм.

Рисунок В37. Коннектор прямой 22М-22М

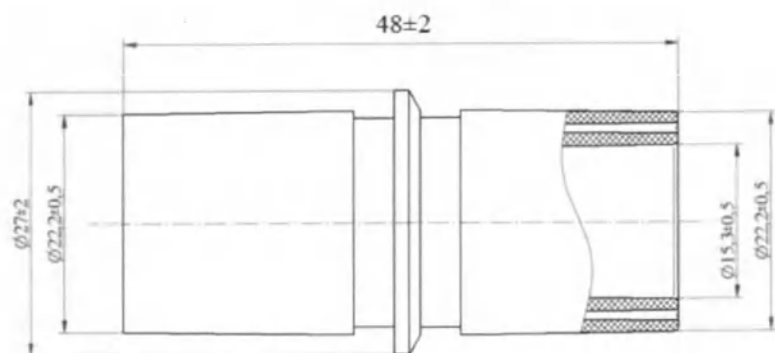


Масса не более – 7г.;

Габаритные размеры:

Длина – (48 ± 2) мм;

Внешний диаметр – (27 ± 2) мм.

Рисунок В38. Коннектор прямой 22М-22М/15F

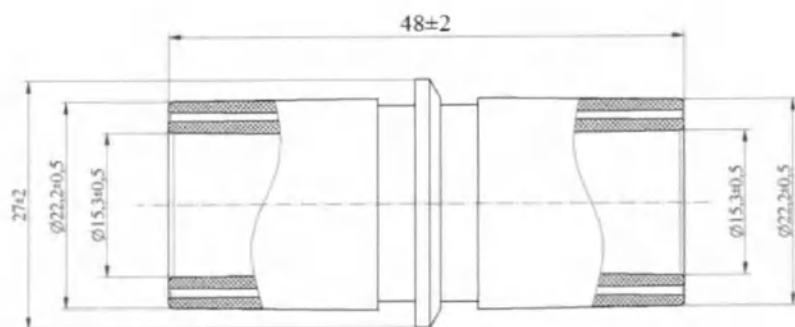


Масса не более – 9г.;

Габаритные размеры:

Длина – (48 ± 2) мм;

Внешний диаметр – (27 ± 2) мм.

Рисунок В39. Коннектор прямой 22М/15F-22М/15F

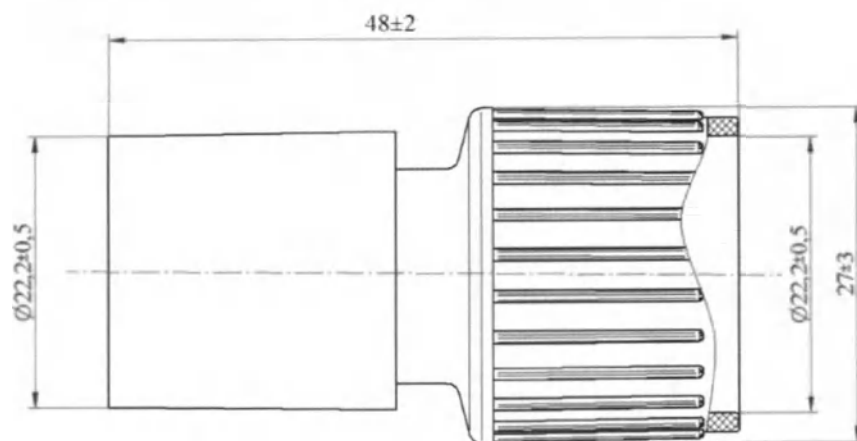


Масса не более – 6г.;

Габаритные размеры:


Длина – (48 ± 2) мм;

Внешний диаметр – (27 ± 3) мм.

Рисунок В40. Коннектор прямой 22М-22F

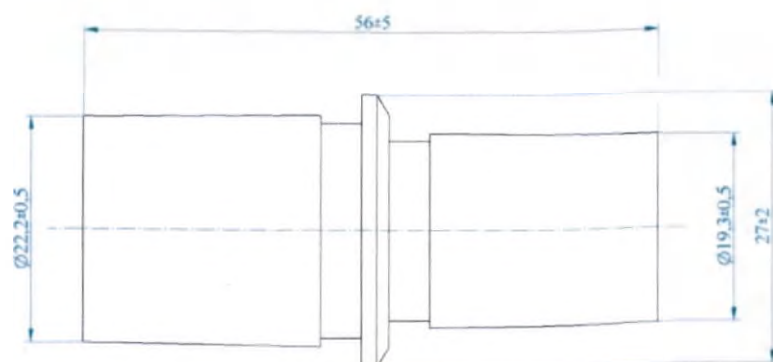


Масса не более – 7 г.;
 Габаритные размеры:
 Длина – (56 ± 5) мм;
 Внешний диаметр – (27 ± 2) мм.
 Рисунок В41. Коннектор прямой 22М – 19М

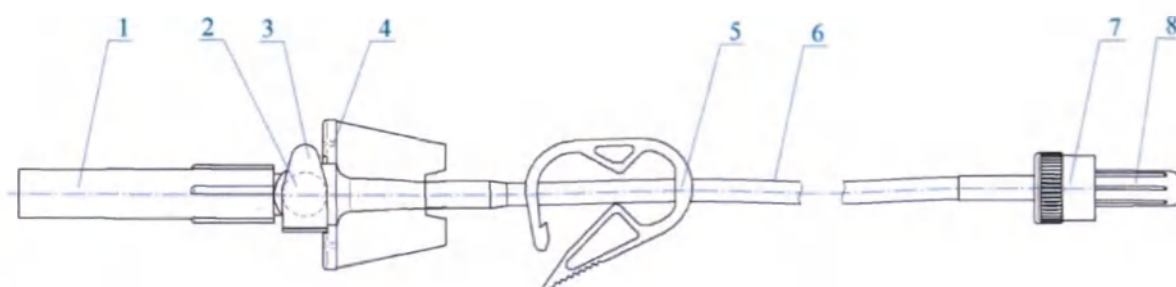

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Колпачок	Длина (40 ± 3) мм. Диаметр внутренний, внешний $(5,7/8,2) \pm 0,5$ мм.	0,9
2	Фильтр воздушный	Диаметр наружный $(6,3 \pm 0,5)$ мм. Толщина $(1 \pm 0,2)$ мм.	0,3
3	Пробка	Длина (21 ± 3) мм. Диаметр отверстия клапана $(4 \pm 0,4)$ мм	1,5
4	Игла полимерная	Диаметр основания иглы (22 ± 2) мм. Длина (51 ± 3) мм. Длина колющей части иглы (28 ± 2) мм.	2,5
5	Зажим 3,3	Длина (25 ± 2) мм. Ширина образца (21 ± 2) мм. Высота образцы (9 ± 1) мм.	2
6	Трубка	Длина (от 100 до 200 с шагом 10) см. Наружный диаметр $(4,2 \pm 0,5)$ мм.	25
7	Коннектор Luer Lock male 3,3	Диаметр присоединительный $(\varnothing 3,9 \pm 0,3)$ мм Конус 6% «Luer»	1
8	Колпачок коннектора Luer Lock male	Длина (19 ± 5) мм.	0,7


Устройство в сборе	Длина – варианты исполнения от 102 см до 210 см с шагом 10 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$ от номинальной величины.	
	Общая масса	33,9

Рисунок В42. Линия подачи воды, с коннектор Luer Lock male: 1 – колпачок; 2 – фильтр воздушный; 3 – пробка; 4 – игла полимерная; 5 – зажим 3,3; 6 – трубка 3,3; 7 – коннектор Luer Lock male; 8 – колпачок Luer Lock male

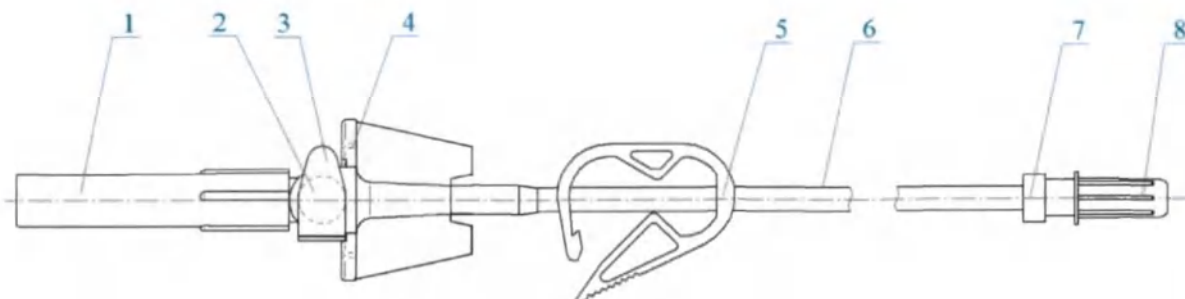


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Колпачок	Длина (40 $\pm$ 3) мм. Диаметр внутренний, внешний (5,7/8,2) $\pm$ 0,5мм.	0,9
2	Фильтр воздушный	Диаметр наружный (6,3 $\pm$ 0,5) мм. Толщина (1 $\pm$ 0,2) мм.	0,3
3	Пробка	Длина (21 $\pm$ 3) мм. Диаметр отверстия клапана (4 $\pm$ 0,4) мм	1,5
4	Игла полимерная	Диаметр основания иглы (22 $\pm$ 2) мм. Длина (51 $\pm$ 3) мм. Длина колющей части иглы (28 $\pm$ 2) мм.	2,5
5	Зажим 3,3	Длина (25 $\pm$ 2) мм. Ширина образца (21 $\pm$ 2) мм. Высота образцы (9 $\pm$ 1) мм.	2
6	Трубка	Длина (от 100 до 200 с шагом 10) см. Наружный диаметр (4,2 $\pm$ 0,5) мм.	25
7	Втулка Luer 3,3	Диаметр присоединительный (Ø3,9 $\pm$ 0,3) мм Конус 6% «Luer»	1,4
8	Колпачок втулки Luer	Длина (19 $\pm$ 5) мм.	0,7
	Устройство в сборе	Длина – варианты исполнения от 102 см до 210 см с шагом 10 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$ от номинальной величины.	
	Общая масса		34,3

Рисунок В43. Линия подачи воды: 1 – колпачок; 2 – фильтр воздушный; 3 – пробка; 4 – игла полимерная; 5 – зажим 3,3; 6 – трубка 3,3; 7 – втулка Luer; 8 – колпачок втулки Luer

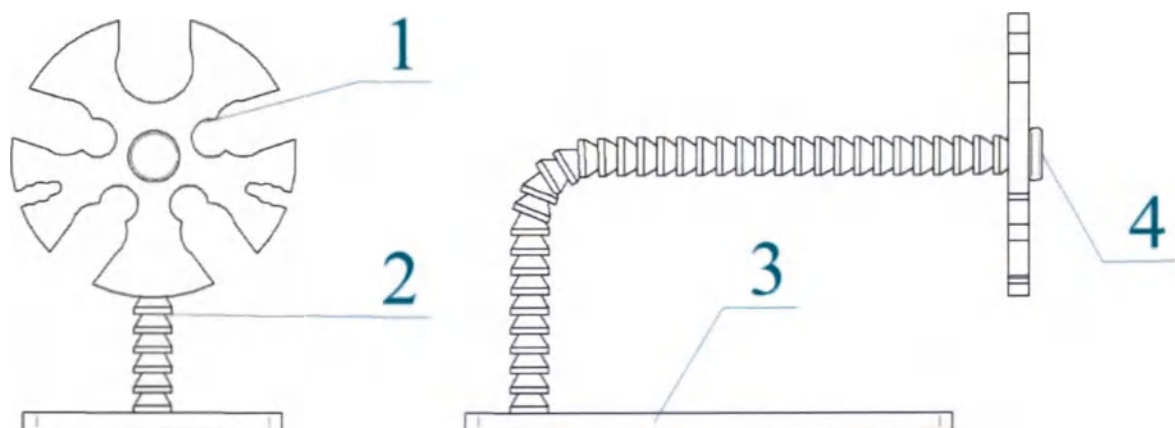


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Держатель	Диаметр наружный (110±20) мм. Диаметр внутренний присоединительный (Ø17±5) мм.	60
2	Стержень	Диаметр звеньев 1/4''; 3/8''; 1/2''.	150
3	Основание держателя (исполнение 1)	Ширина (130±15) мм. Длина (380±30) мм.	280
4	Гайка М12	Габаритные размеры 10х20,9 мм (±10%)	2
	Габаритные размеры (в сложенном состоянии)	130х400х165 мм (±10%)	
Общая масса			492

Рисунок В 44. Держатель контура дыхательного, исполнение 1: 1 – держатель; 2 – основание держателя (исполнение 1); 3 – стержень; 4 – фиксатор

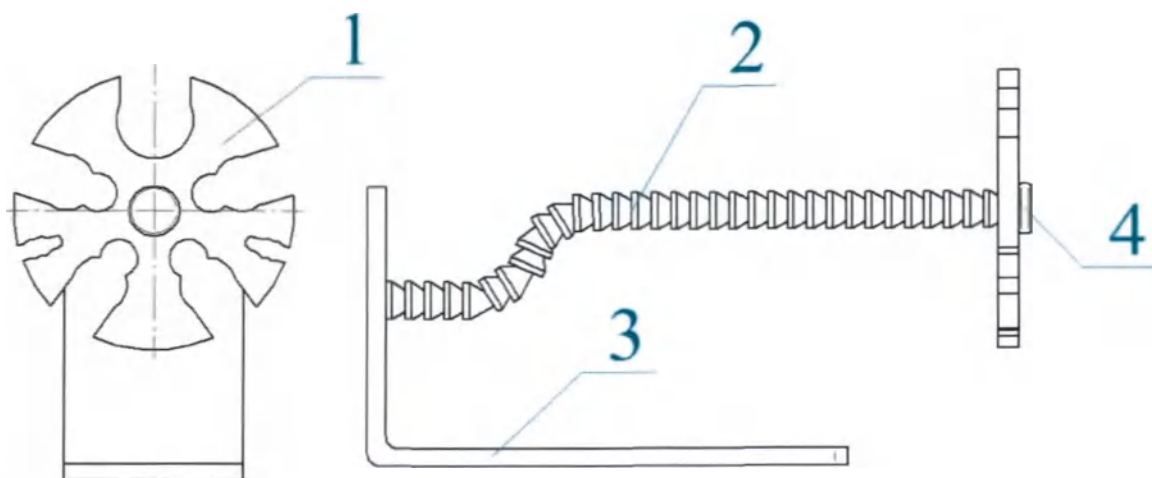

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Держатель	Диаметр наружный (110±20) мм. Диаметр внутренний соединительный (Ø17±5) мм.	60
2	Стержень	Диаметр звеньев 1/4''; 3/8''; 1/2''.	150
3	Основание держателя (исполнение 2)	Ширина (70±15) мм. Длина (250±30) мм.	200
4	Гайка M12	Габаритные размеры 10x20,9 мм (±10%)	2
	Габаритные размеры (в сложенном состоянии)	110x2800x160 мм (±10%)	
Общая масса			412


Рисунок В 45. Держатель контура дыхательного, исполнение 2: 1 – держатель; 2 – основание держателя (исполнение 2); 3 – стержень; 4 – фиксатор

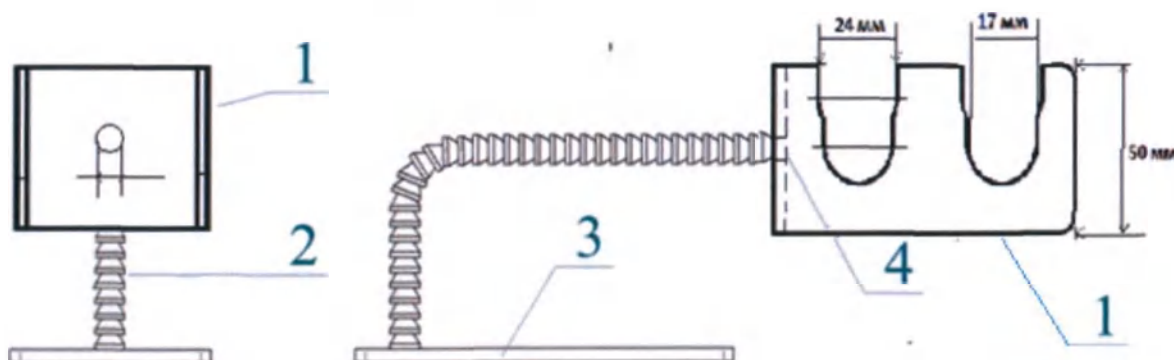

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Держатель	Ширина Высота Диаметр внутреннего отверстия	110


		($\varnothing 17 \pm 5$) мм.	
2	Стержень	Диаметр звеньев 1/4''; 3/8''; 1/2''.	150
3	Основание держателя (исполнение 2)	Ширина (70 ± 15) мм. Длина (250 ± 30) мм.	200
4	Гайка М12	Габаритные размеры 10x20,9 мм ($\pm 10\%$)	2
	Габаритные размеры (в сложенном состоянии)	130x450x165 мм ($\pm 10\%$)	
Общая масса			462

Рисунок В46. Держатель контура дыхательного, исполнение 3: 1 – держатель; 3 – основание держателя (исполнение 3); 2 – стержень; 4 – фиксатор.

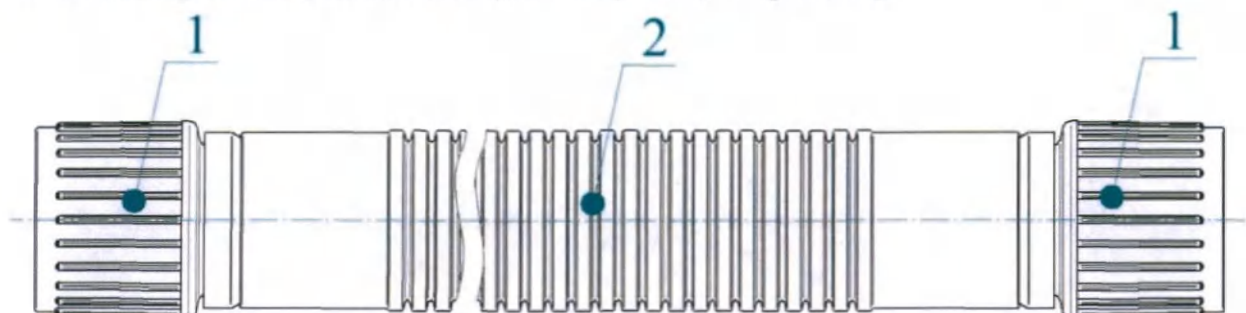


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 22 22F	Длина (48 ± 3) мм. Диаметр присоединительный 22F ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм	6
2	Трубка гофрированная 22 с антимикробными компонентами	Диаметр наружный (24 ± 3) мм. Длина (от 20 см до 300 см с шагом 1) см.	180
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 205 см до 305 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$ от номинальной величины, диаметр 27 ± 3) мм.	
Общая масса			186

Рисунок В 47. Трубка гофрированная 22 с антимикробными компонентами, длиной трубки от 20см до 300см с шагом 1 см, с коннекторами 22F: 1 – коннектор-22 22F; 2 – трубка гофрированная 22.

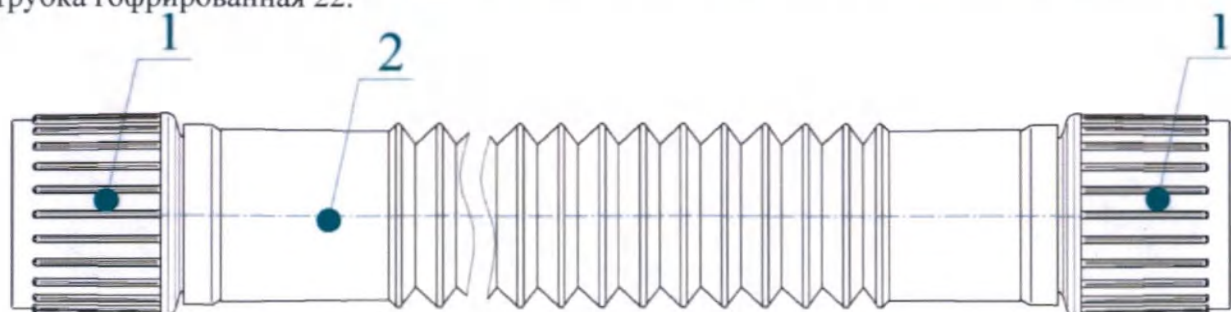


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 22 22F	Длина (48 ±3) мм. Диаметр присоединительный 22F (Ø22,2±0,5) мм	6
2	Трубка гофрированная растяжимая 22 с антимикробными компонентами	Диаметр наружный (25±2) мм. Длина (от 20см до 300 см с шагом 1) см.	120
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 25 см до 305 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет ±10% от номинальной величины, диаметр 27±3) мм.	
Общая масса			132

Рисунок В 48. Трубка гофрированная растяжимая, длиной трубки от 20см до 300см с шагом 1 см, с коннекторами 22F: 1 – коннектор-22 22F; 2 – трубка растяжимая 22.

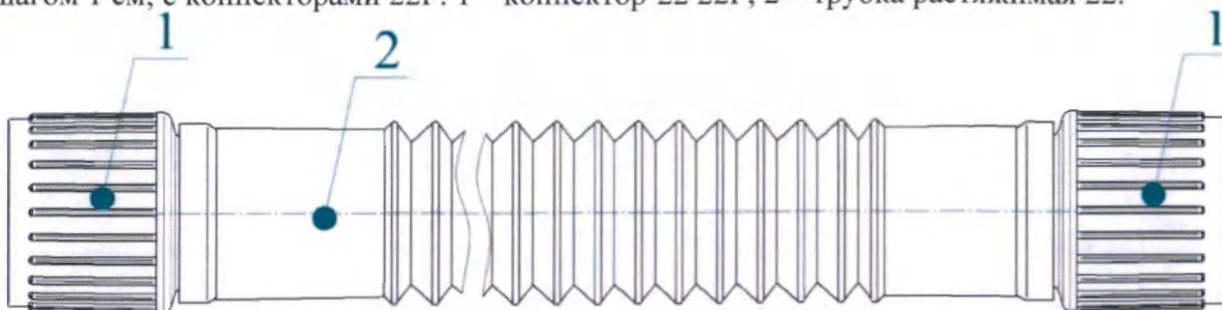


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 22 22F	Длина (48 ±3) мм. Диаметр присоединительный 22F (Ø22,2±0,5) мм	6
2	Трубка гофрированная растяжимая 22 с антимикробными компонентами	Диаметр наружный (25±2) мм. Длина (от 20см до 300 см с шагом 1) см.	120
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 25 см до 305 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет ±10% от номинальной величины, диаметр 27±3) мм.	
Общая масса устройства			132

Рисунок В 49. Трубка гофрированная растяжимая 22 с антимикробными компонентами, длиной трубки от 20см до 300см с шагом 1 см, с коннекторами 22F: 1 – коннектор-22 22F; 2 – трубка растяжимая 22.

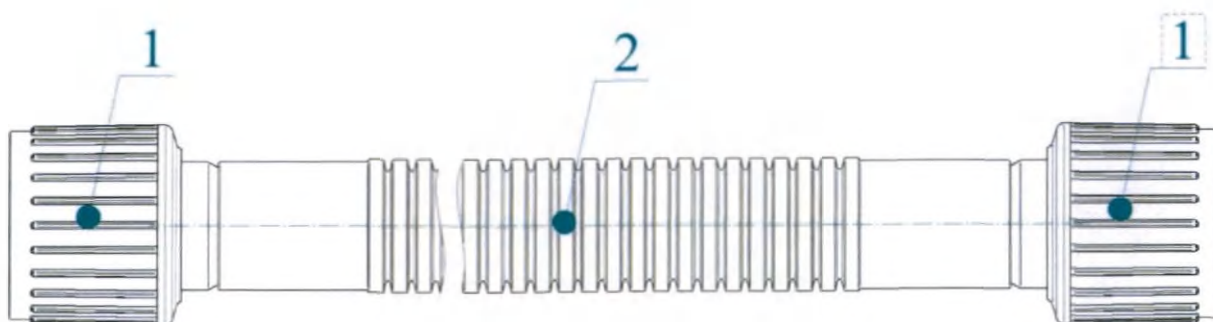

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 15 22F	Длина (48±3) мм. Диаметр присоединительный 22F (Ø22,2±0,5) мм	5
2	Трубка гофрированная 15 с антимикробными компонентами	Диаметр наружный (18±2) мм. Длина (от 20см до 300 см с шагом 1) см.	110
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 25 см до 305 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет ±10% от номинальной величины, диаметр 27±3) мм.	
Общая масса			120


Рисунок В 50. Трубка гофрированная 15 с антимикробными компонентами, длиной трубки от 20 см до 300 см с шагом 1 см, с коннекторами 22F: 1 – коннектор-15 22F; 2 – трубка гофрированная 15.

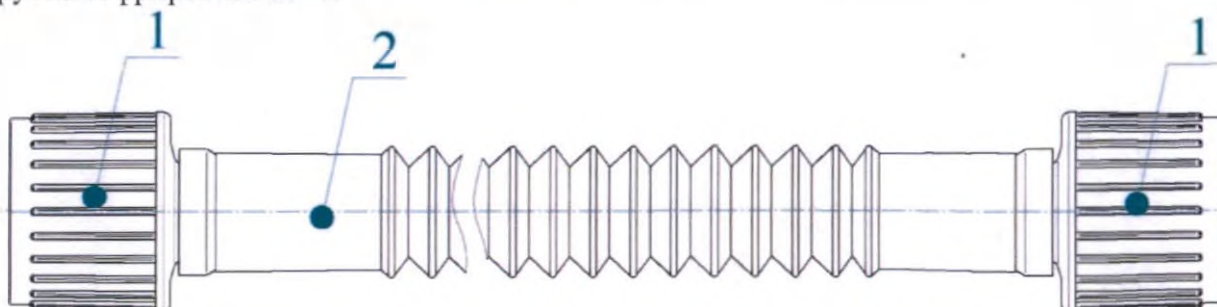

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 15 22F	Длина (48 ±3) мм. Диаметр присоединительный 22F (Ø22,2±0,5) мм	5
2	Трубка растяжимая 15 с антимикробными компонентами	Диаметр наружный (21±2) мм. Длина (от 20см до 300 см с шагом 1) см.	110
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 25 см до 305 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет ±10% от номинальной величины, диаметр 27±3) мм.	


Общая устройства	масса	120
---------------------	-------	-----

Рисунок В 51. Трубка гофрированная растяжимая 15 с антимикробными компонентами, длиной трубки от 20см до 300 см с шагом 1 см, с коннекторами 22F: 1 – коннектор-15 22F; 2 – трубка растяжимая 15.

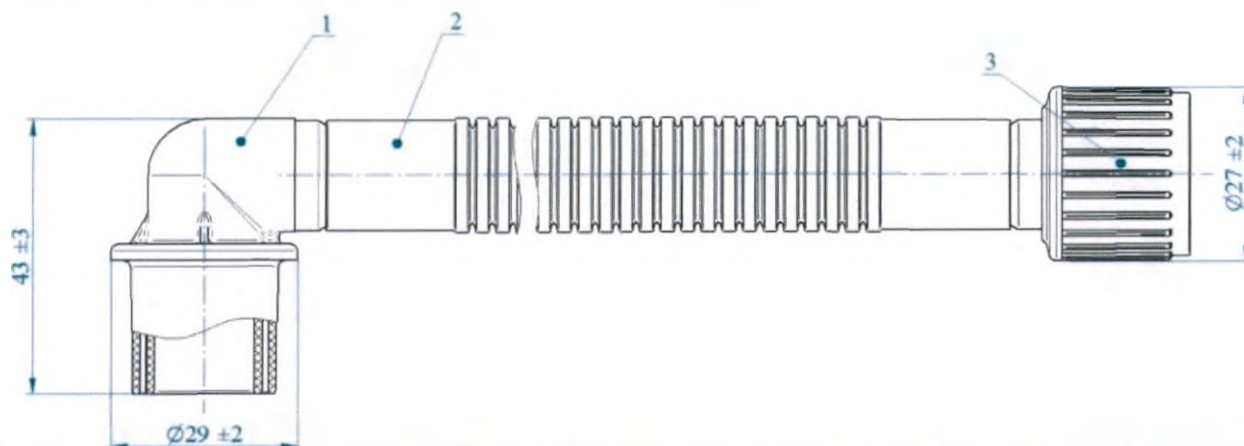


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор угловой 22М/15F-15М без портов	Диаметр присоединительный 15F (Ø15,3±0,5) мм. Диаметр присоединительный 22М (Ø22,2±0,5) мм.	7
2	Трубка гофрированная 15	Диаметр наружный (18±2) мм. Длина (от 15 до 30 с шагом 1) см.	12
3	Коннектор –15 22F	Длина (48±3) мм. Диаметр присоединительный 22F (Ø22,2±0,5) мм.	5
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 21 см до 36 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет ±10% от номинальной величины.	24

Рисунок В 52. Соединитель, гофрированный длиной трубки от 15 до 30 см с шагом 1 см с коннектором угловым 22М/15F-15М без портов: 1 – коннектор угловой 22М/15F-15М без портов; 2 – трубка гофрированная 15; 3 – коннектор -15 22F.

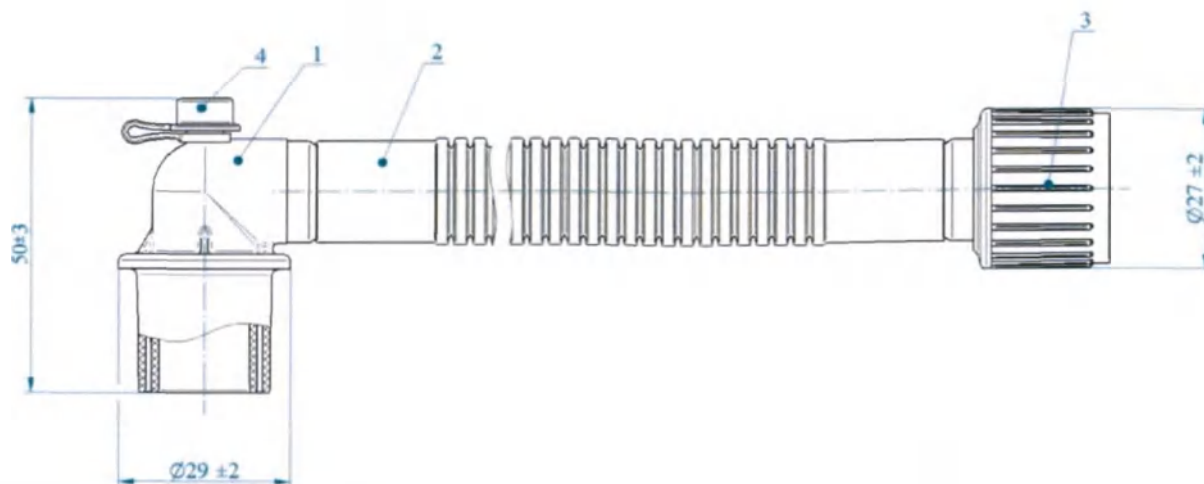


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор угловой 22M/15F-15M с портом Луер	Диаметр присоединительный 15F ($\text{Ø}15,3\pm0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22M ($\text{Ø}22,2\pm0,5$) мм.	8
2	Трубка гофрированная 15	Диаметр наружный (18 ± 2) мм. Длина (от 15 до 30 с шагом 1) см.	12
3	Коннектор -15 22F	Длина (48 ± 3) мм. Диаметр присоединительный 22F ($\text{Ø}22,2\pm0,5$) мм.	5
4	Пробка Луер	Диаметр (внутренней заглушки) ($4,3\pm0,3$) мм.	0,5
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 21 см до 36 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$ от номинальной величины.	25,5

Рисунок В 53. Соединитель гофрированный длинной трубки от 15 до 30 см с шагом 1 см с коннектором угловым 22M/15F-15M с портом Луер: 1 – коннектор угловой 22M/15F-15M с портом Луэр; 2 – трубка гофрированная 15; 3 – коннектор -15 22F; 4 – пробка Луер.

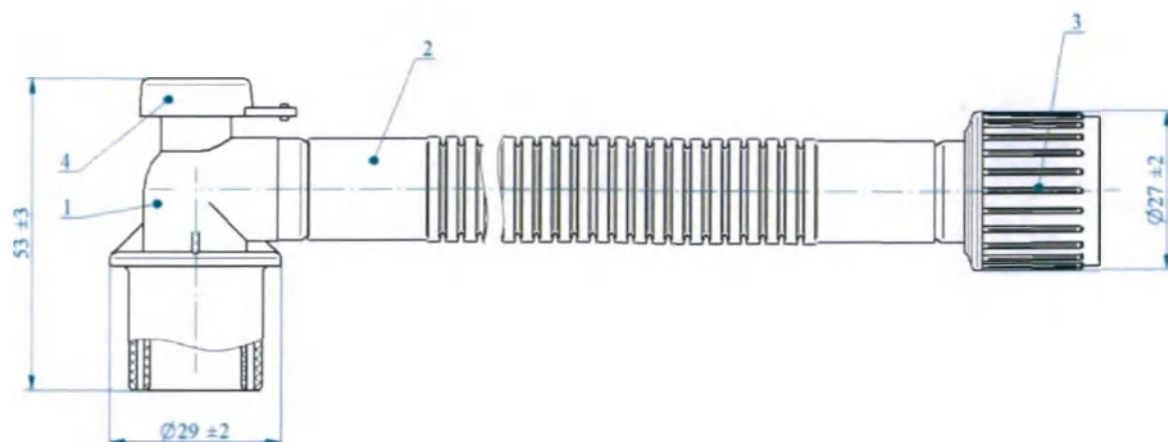


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор угловой 22М/15F-15М с портом 7,6	Диаметр присоединительный 15F ($\text{Ø}15,3 \pm 0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22М ($\text{Ø}22,2 \pm 0,5$) мм.	9
2	Трубка гофрированная 15	Диаметр наружный (18 ± 2) мм. Длина (от 15 до 30 с шагом 1) см.	12
3	Коннектор – 15 22F	Длина (48 ± 3) мм. Диаметр присоединительный 22F ($\text{Ø}22,2 \pm 0,5$) мм.	5
4	Пробка 7,6	Диаметр ($7,6 \pm 0,3$) мм.	0,7
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 21 см до 36 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$ от номинальной величины.	26,7

Рисунок В54. Соединитель гофрированный длинной трубки от 15 до 30 см с шагом 1 см с коннектором угловым 22М/15F-15М с портом 7,6: 1 – коннектор угловой 22М/15F-15М с портом 7,6; 2 – трубка гофрированная 15; 3 – коннектор -15 22F; 4 – пробка 7,6.

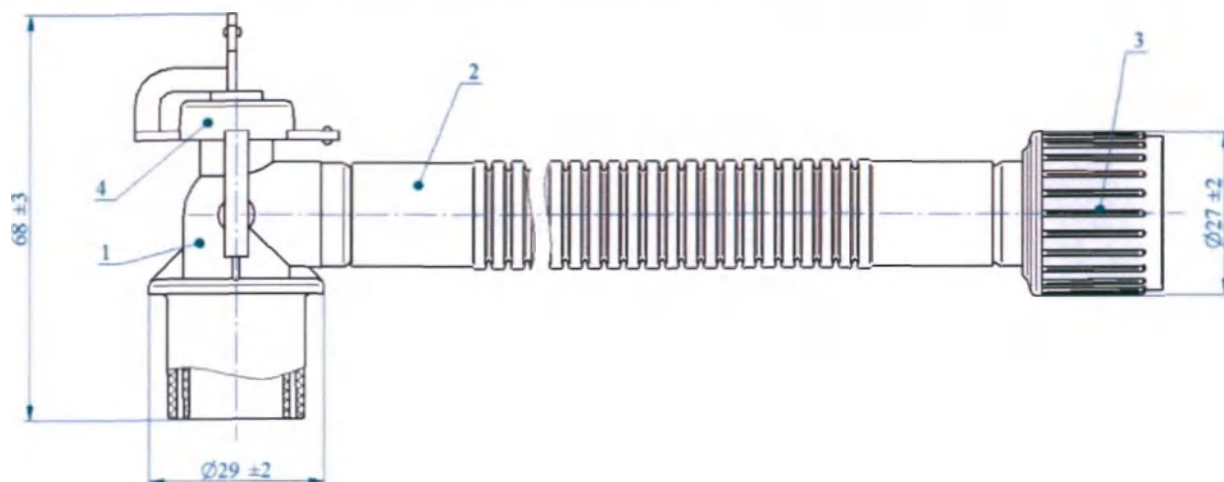

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор угловой 22М/15F-15М с портом 7,6/9,5	Диаметр присоединительный 15F ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22М ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	9
2	Трубка гофрированная 15	Диаметр наружный (18 ± 2) мм. Длина (от 15 до 30 с шагом 1) см.	12
3	Коннектор-15 22F	Длина (48 ± 3) мм. Диаметр присоединительный 22F ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	5
4	Пробка 7,6/9,5	Диаметр ($7,6 \pm 0,3$) мм. Диаметр ($9,5 \pm 0,3$) мм.	0,8
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина (от 21 до 36 с шагом 1) см. Ширина – 29 ± 2 мм. Высота – 68 ± 3 мм.	26,8


Рисунок В 55 Соединитель гофрированный длинной трубки от 15 до 30 см с шагом 1 см с коннектором угловым 22М/15F-15М с портом 7,6/9,5: 1 – коннектор угловой 22М/15F-15М с портом 7,6/9,5; 2 – трубка гофрированная 15; 3 – коннектор -15 22F; 4 – пробка 7,6/9,5.

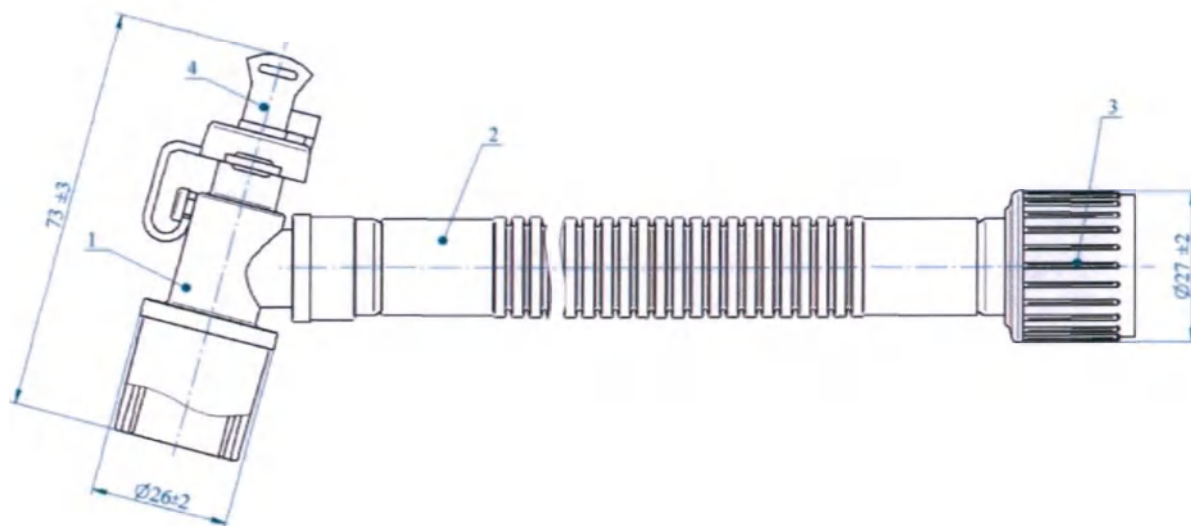

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор шарнирный угловой 22М/15F-15М с портом 7,6/9,5	Диаметр присоединительный 15F ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22М ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	11
2	Трубка гофрированная 15	Диаметр наружный (18 ± 2) мм. Длина (от 15 до 30 с шагом 1) см.	12
3	Коннектор -15 22F	Длина (48 ± 3) мм.	5


		Диаметр присоединительный 22F ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	
4	Пробка 7,6/9,5	Диаметр ($7,6 \pm 0,3$) мм. Диаметр ($9,5 \pm 0,3$) мм.	0,8
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 25 см до 40 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$ от номинальной величины.	28,8

Рисунок В 56. Соединитель гофрированный длиной трубки от 15 до 30 см с шагом 1 см с шарнирным угловым коннектором 22М/15F-15М с портом 7,6/9,5: 1 – шарнирный угловой коннектор 22М/15F-15М с портом 7,6/9,5; 2 – трубка гофрированная 15; 3 – коннектор -15 22F; 4 – пробка 7,6/9,5.

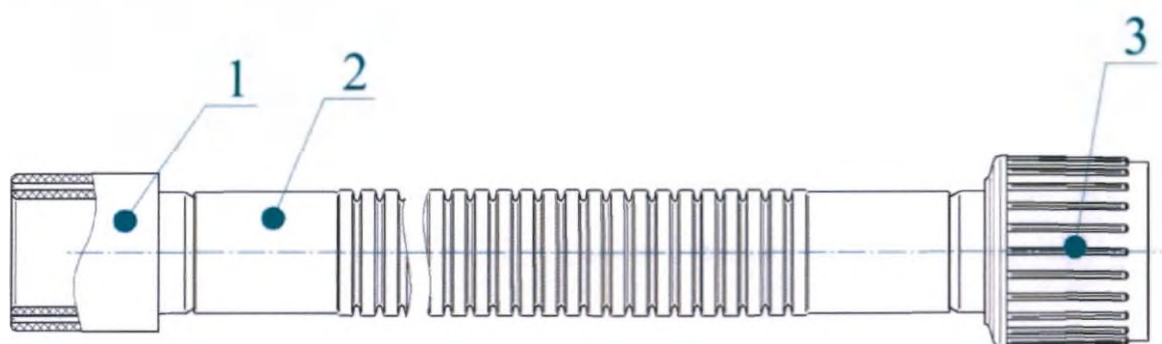


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор 22М/15F	Диаметр присоединительный 15F ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22М ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	6
2	Трубка гофрированная 15	Диаметр наружный (18 ± 2) мм. Длина (от 15 до 30 с шагом 1) см.	12
3	Коннектор -15 22F	Длина (48 ± 3) мм. Диаметр присоединительный 22F ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	5
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 20 см до 35 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$ от номинальной величины. Внешний диаметр - (27 ± 2) мм.	23

Рисунок В 57. Соединитель гофрированный длиной трубки от 15 до 30 см с шагом 1 см с коннектором 22М/15F: 1 – коннектор 22М/15F; 2 – трубка гофрированная 15; 3 – коннектор -15 22F;

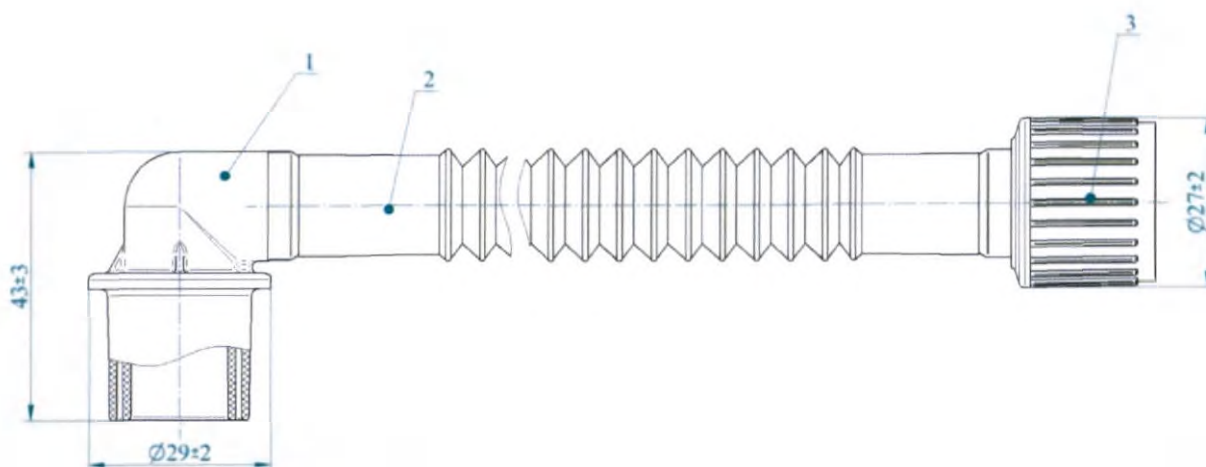

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор угловой 22М/15F-15М без портов	Диаметр присоединительный 15F ($\text{Ø}15,3\pm0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22М ($\text{Ø}22,2\pm0,5$) мм.	7
2	Трубка гофрированная растяжимая 15	Диаметр наружный (21 ± 2) мм. Длина (в растянутом состоянии, от 7 до 30 с шагом 1) см.	11
3	Коннектор -15 22F	Длина (48 ± 3) мм. Диаметр присоединительный 22F ($\text{Ø}22,2\pm0,5$) мм.	5
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 13 см до 36 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$.	23


Рисунок В 58. Соединитель гофрированный растяжимый длиной трубки от 7 до 30 см с шагом 1 см с коннектором угловым 22М/15F-15М без портов: 1 – коннектор угловой 22М/15F-15М без портов; 2 – трубка растяжимая 15; 3 – коннектор -15 22F.

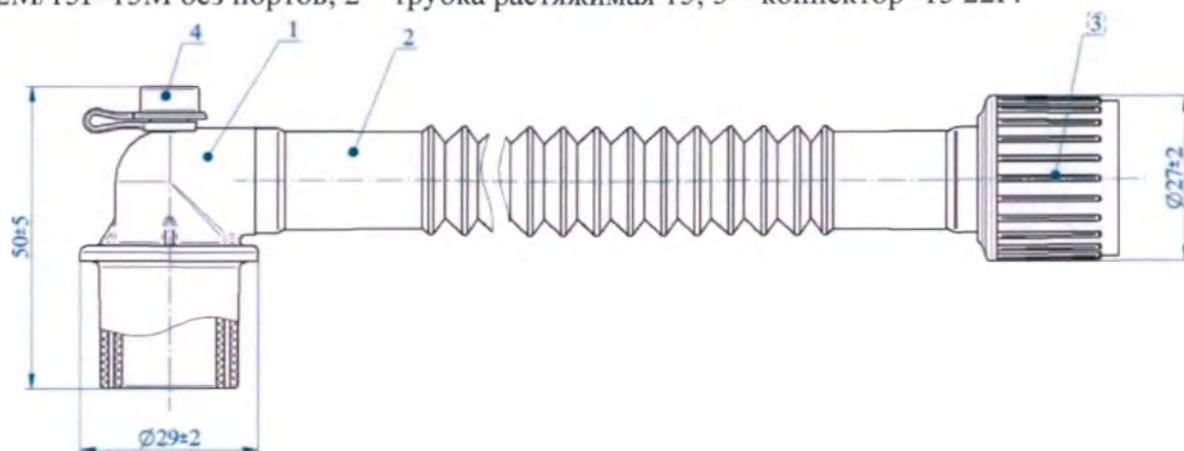

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор угловой 22М/15F-15М с портом Луер	Диаметр присоединительный 15F ($\text{Ø}15,3\pm0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22М	8

		($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	
2	Трубка гофрированная растяжимая 15	Диаметр наружный (21 ± 2) мм. Длина (в растянутом состоянии, от 7 до 30 с шагом 1) см.	11
3	Коннектор –15 22F	Длина (48 ± 3) мм. Диаметр присоединительный 22F ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	5
4	Пробка Луер	Диаметр (внутренней заглушки) ($4,3 \pm 0,3$) мм.	0,5
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 13 см до 36 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет ± 10 %.	24,5


Рисунок В 59. Соединитель гофрированный растяжимый длинной трубки от 7 до 30 см с шагом 1 см с коннектором угловым 22М/15F-15М с портом Луер: 1 – коннектор угловой 22М/15F-15М с портом Луэр; 2 – трубка растяжимая 15; 3 – коннектор -15 22F; 4 – пробка Луер.

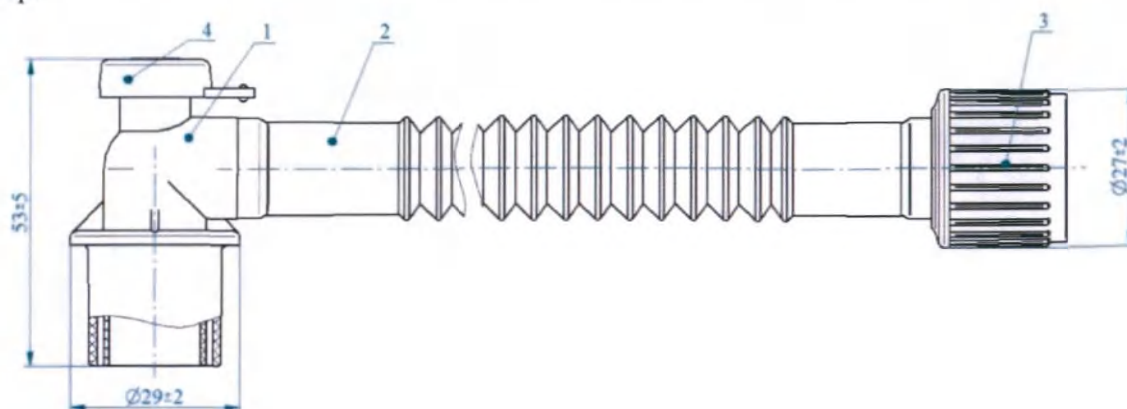

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор угловой 22М/15F-15М с портом 7,6	Диаметр присоединительный 15F ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22М ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	9
2	Трубка гофрированная растяжимая 15	Диаметр наружный (21 ± 2) мм. Длина (в растянутом состоянии, от 7 до 30 с шагом 1) см.	11
3	Коннектор –15 22F	Длина (48 ± 3) мм. Диаметр присоединительный 22F ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	5
4	Пробка 7,6	Диаметр ($7,6 \pm 0,3$) мм.	0,7
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 13	25,7


	см до 36 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$.	
--	---	--

Рисунок В 60. Соединитель гофрированный растяжимый длиной трубки от 7 до 30 см с шагом 1 см с коннектором угловым 22М/15F-15М с портом 7,6; 1 – коннектор угловой 22М/15F-15М с портом 7,6; 2 – трубка растяжимая 15; 3 – коннектор -15 22F; 4 – пробка 7,6.

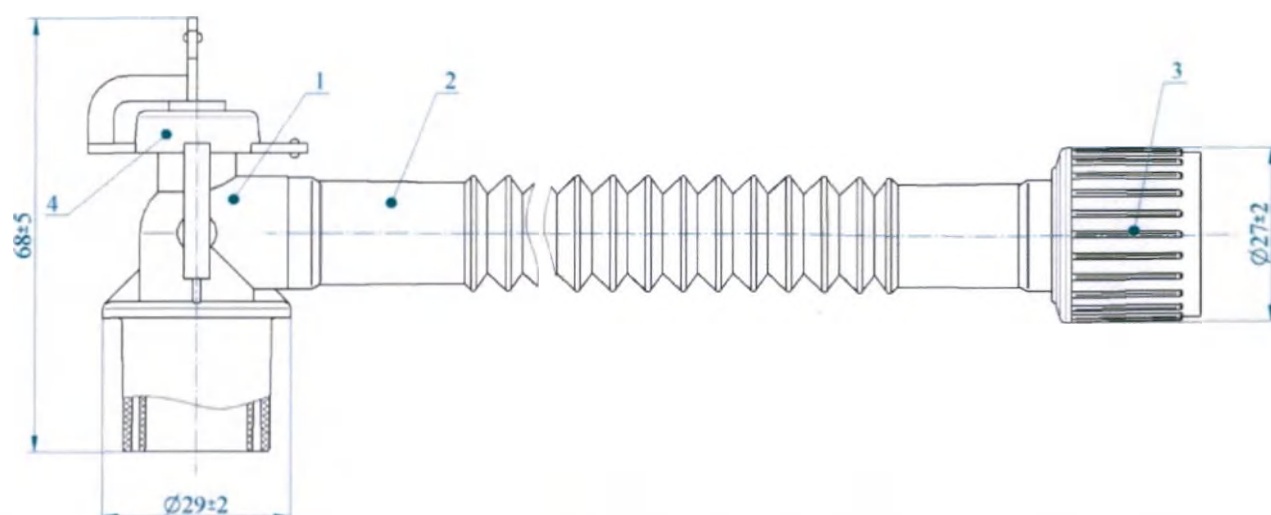


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор угловой 22М/15F-15М с портом 7,6/9,5	Диаметр присоединительный 15F (Ø15,3±0,5) мм. Диаметр присоединительный 22М (Ø22,2±0,5) мм.	9
2	Трубка гофрированная растяжимая 15	Диаметр наружный (21±2) мм. Длина (в растянутом состоянии, от 7 до 30 с шагом 1) см.	11
3	Коннектор -15 22F	Длина (48±3) мм. Диаметр присоединительный 22F (Ø22,2±0,5) мм.	5
4	Пробка 7,6/9,5	Диаметр (7,6±0,3) мм. Диаметр (9,5±0,3) мм.	0,8
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 13 см до 36 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$.	25,8

Рисунок В 61. Соединитель гофрированный растяжимый длиной трубки от 7 до 30 см с шагом 1 см с коннектором угловым 22М/15F-15М с портом 7,6/9,5; 1 – коннектор угловой 22М/15F-15М с портом 7,6/9,5; 2 – трубка растяжимая 15; 3 – коннектор -15 22F; 4 – пробка 7,6/9,5.

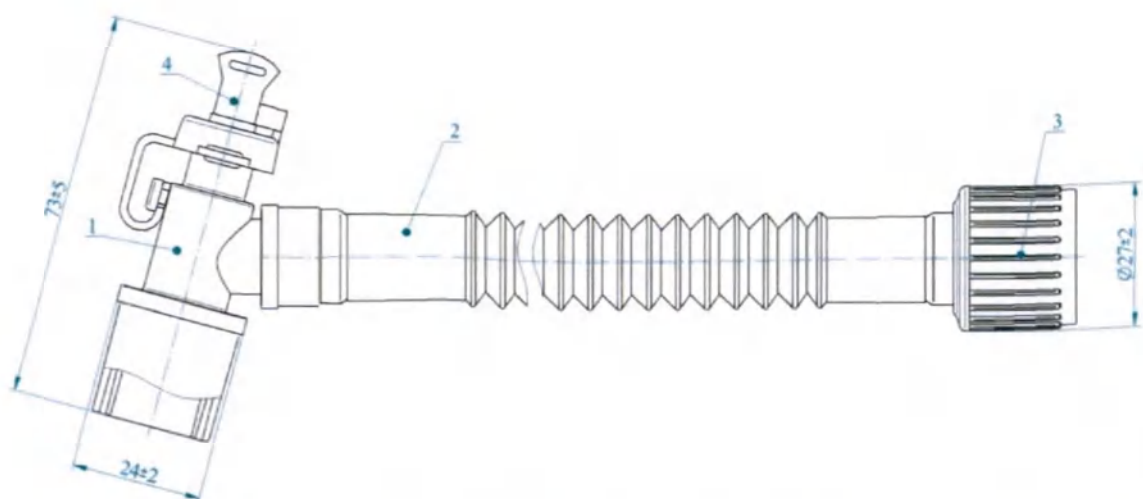

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Шарнирный угловой коннектор 22M/15F-15M с портом 7,6/9,5	Диаметр присоединительный 15F ($\text{Ø}15,3\pm0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22M ($\text{Ø}22,2\pm0,5$) мм.	11
2	Трубка гофрированная растяжимая 15	Диаметр наружный (21 ± 2) мм. Длина (в растянутом состоянии, от 7 до 30 с шагом 1) см.	11
3	Коннектор – 15 22F	Длина (48 ± 3) мм. Диаметр присоединительный 22F ($\text{Ø}22,2\pm0,5$) мм.	5
4	Пробка 7,6/9,5	Диаметр ($7,6\pm0,3$) мм. Диаметр ($9,5\pm0,3$) мм.	0,8
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 13 см до 36 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$.	27,8


Рисунок В 62. Соединитель гофрированная растяжимый длинной трубки от 7 до 30 см с шагом 1 см с шарнирным коннектором угловым 22M/15F-15M с портом 7,6/9,5: 1 – шарнирный угловой коннектор 22M/15F-15M с портом 7,6/9,5; 2 – трубка растяжимая 15; 3 – коннектор -15 22F; 4 – пробка 7,6/9,5.

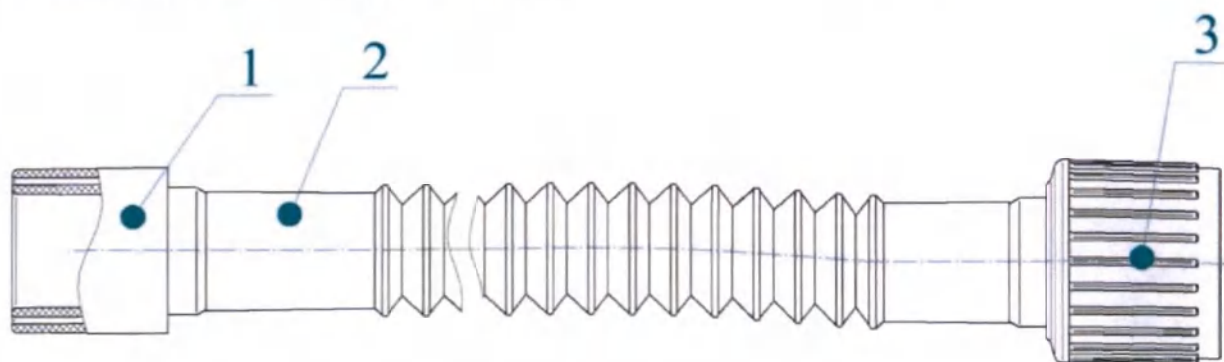

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор 22M/15F	Диаметр присоединительный 15F	6


		($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22М ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	
2	Трубка гофрированная растяжимая 15	Диаметр наружный (21 ± 2) мм. Длина (в растянутом состоянии, от 7 до 30 с шагом 1) см.	11
3	Коннектор – 15 22F	Длина (48 ± 3) мм. Диаметр присоединительный 22F ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	5
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 13 см до 36 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$	22

Рисунок В 63. Соединитель гофрированный растяжимый длинной трубки от 7 до 30 см с шагом 1 см с коннектором 22М/15F: 1 – коннектор 22М/15F; 2 – трубка растяжимая 15; 3 – коннектор -15 22F.

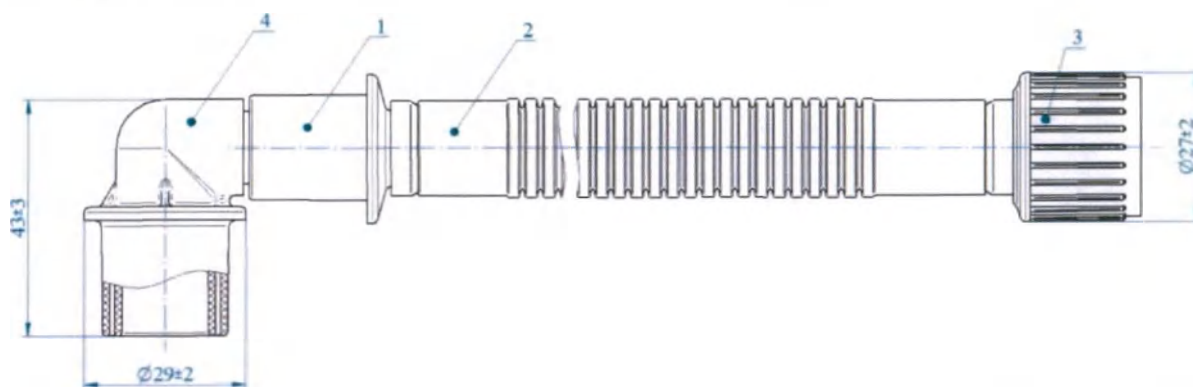


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор - 22М/15F	Диаметр присоединительный 15F ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22М ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	6
2	Трубка гофрированная 15	Диаметр наружный (18 ± 2) мм. Длина (от 15 до 30 с шагом 1) см.	12
3	Коннектор –15 22F	Длина (48 ± 3) мм. Диаметр присоединительный 22F ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	5
4	Коннектор угловой 22М/15F-15М без портов	Диаметр присоединительный 15F ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22М ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	7
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 23 см до 38 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$.	30

Рисунок В 64. Соединитель гофрированный длинной трубки от 15 до 30 см с шагом 1 см в сборе с коннектором угловым 22М/15F-15М без портов: 1 – коннектор 22М/15F; 2 – трубка гофрированная 15; 3 – коннектор -15 22F; 4 – коннектор угловой 22М/15F-15М без портов.

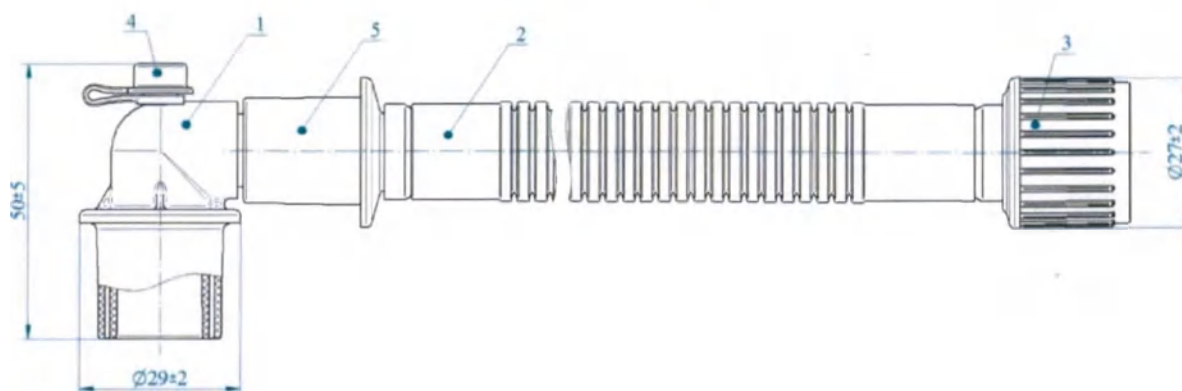


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор угловой 22М/15F-15М с портом Луер	Диаметр присоединительный 15F ($\text{Ø}15,3\pm0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22М ($\text{Ø}22,2\pm0,5$) мм.	8
2	Трубка гофрированная 15	Диаметр наружный (18 ± 2) мм. Длина (от 15 до 30 с шагом 1) см.	12
3	Коннектор -15 22F	Длина (48 ± 3) мм. Диаметр присоединительный 22F ($\text{Ø}22,2\pm0,5$) мм.	5
4	Пробка Луер	Диаметр (внутренней заглушки) ($4,3\pm0,3$) мм.	0,5
5	Коннектор - 22М/15F	Диаметр присоединительный 15F ($\text{Ø}15,3\pm0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22М ($\text{Ø}22,2\pm0,5$) мм.	6
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 23 см до 38 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$.	31,5

Рисунок В 65. Соединитель гофрированный длинной трубки от 15 до 30 см с шагом 1 см в сборе с коннектором угловым 22М/15F-15М с портом Луер: 1 – коннектор угловой 22М/15F-15М с портом Луер; 2 – трубка гофрированная 15; 3 – коннектор -15 22F; 4 – пробка Луер; 5 – коннектор 22М/15F.

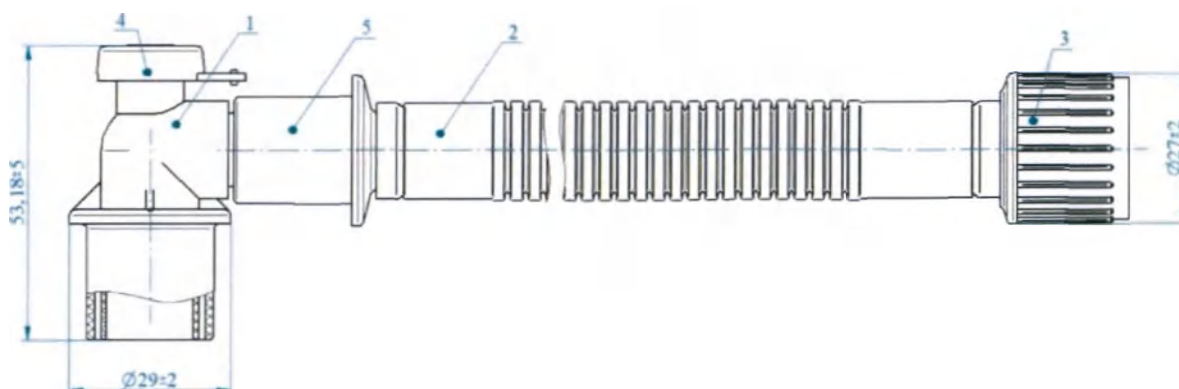


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор - 22M/15F	Диаметр присоединительный 15F ($\text{Ø}15,3\pm0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22M ($\text{Ø}22,2\pm0,5$) мм.	6
2	Трубка гофрированная 15	Диаметр наружный (21 ± 2) мм. Длина (от 15 до 30 с шагом 1) см.	12
3	Коннектор -15 22F	Длина (48 ± 3) мм. Диаметр присоединительный 22F ($\text{Ø}22,2\pm0,5$) мм.	5
4	Коннектор угловой 22M/15F-15M с портом 7,6	Диаметр присоединительный 15F ($\text{Ø}15,3\pm0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22M ($\text{Ø}22,2\pm0,5$) мм.	9
5	Пробка 7,6	Диаметр ($7,6\pm0,3$) мм.	0,7
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 23 см до 38 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$.	32,7

Рисунок В 66. Соединитель гофрированный длинной трубки от 7 до 30 см с шагом 1 см в сборе с коннектором угловым 22M/15F-15M с портом 7,6: 1 – коннектор 22M/15F; 2 – трубка растяжимая 15; 3 – коннектор -15 22F; 4 – коннектор угловой 22M/15F-15M с портом 7,6; 5 – пробка 7,6.

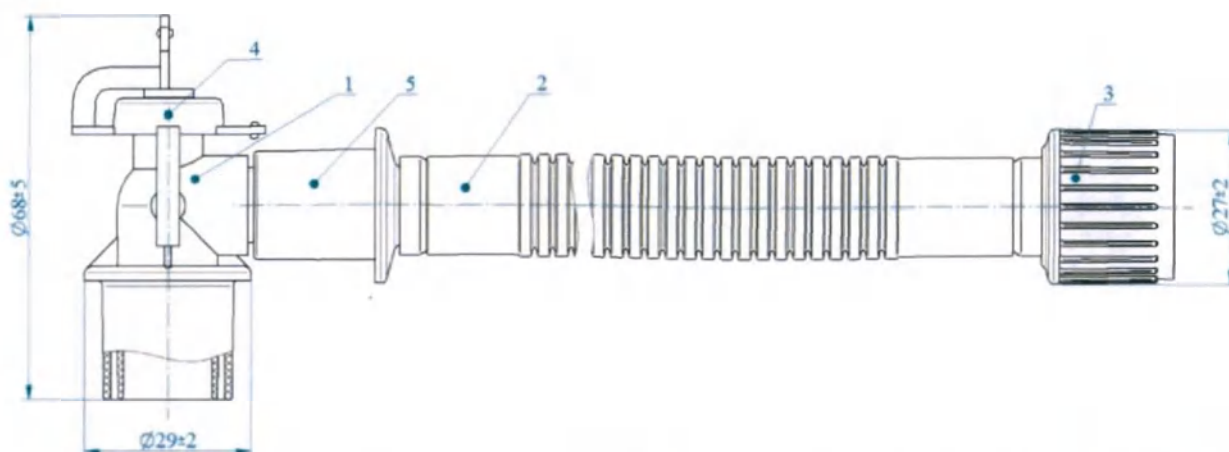

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор угловой 22М/15F-15М с портом 7,6/9,5	Диаметр присоединительный 15F ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22М ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	9
2	Трубка гофрированная 15	Диаметр наружный (18 ± 2) мм. Длина (от 15 до 30 с шагом 1) см.	12
3	Коннектор-15 22F	Длина (48 ± 3) мм. Диаметр присоединительный 22F ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	5
4	Пробка 7,6/9,5	Диаметр ($7,6 \pm 0,3$) мм. Диаметр ($9,5 \pm 0,3$) мм.	0,8
5	Коннектор - 22М/15F	Диаметр присоединительный 15F ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22М ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	6
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 23 см до 38 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$.	32,8


Рисунок В 67. Соединитель гофрированный длинной трубки от 15 до 30 см с шагом 1 см в сборе с коннектором угловым 22М/15F-15М с портом 7,6/9,5; 1 – коннектор угловой 22М/15F-15М с портом 7,6/9,5; 2 – трубка гофрированная 15; 3 – коннектор -15 22F; 4 – пробка 7,6/9,5; 5 – коннектор 22М/15F.

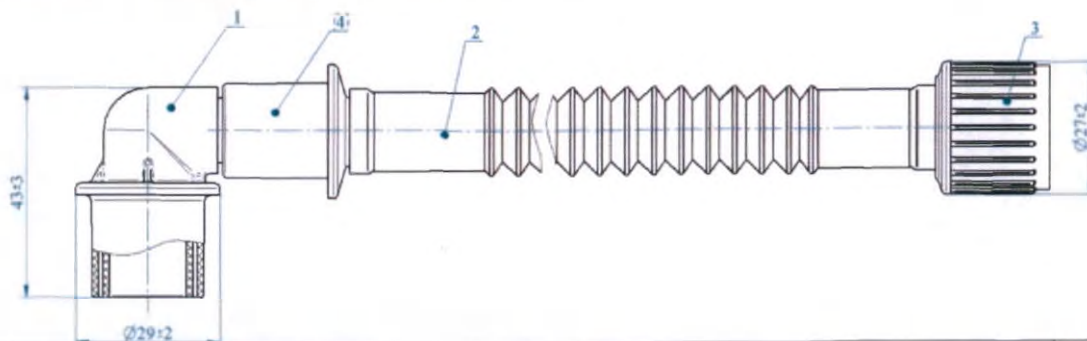

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
---	---------------------	--------	------------------------

1	Коннектор угловой 22M/15F-15M без портов	Диаметр присоединительный 15F ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22M ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	7
2	Трубка гофрированная растяжимая 15	Диаметр наружный (21 ± 2) мм. Длина (в растянутом состоянии, от 7 до 30 с шагом 1) см.	11
3	Коннектор – 15 22F	Длина (48 ± 3) мм. Диаметр присоединительный 22F ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	5
4	Коннектор -22M/15F	Диаметр присоединительный 15F ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22M ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	6
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина в растянутом состоянии – варианты исполнения от 15 см до 38 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$.	29


Рисунок В 68. Соединитель гофрированный растяжимый длинной трубки от 7 до 30 см с шагом 1 см в сборе с коннектором угловым 22M/15F-15M без портов: 1 – коннектор угловой 22M/15F-15M без портов; 2 – трубка растяжимая 15; 3 – коннектор -15 22F; 4 – коннектор 22M/15F.

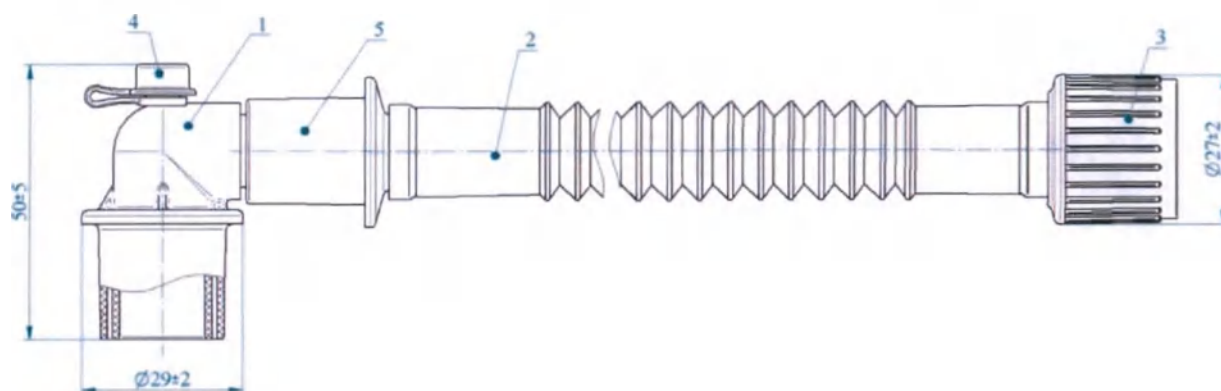

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор угловой 22M/15F-15M с портом Луер	Диаметр присоединительный 15F ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22M ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	8
2	Трубка гофрированная растяжимая 15	Диаметр наружный (21 ± 2) мм. Длина (в растянутом положении, от 7 до 30 с шагом 1) см.	11
3	Коннектор –15 22F	Длина (48 ± 3) мм. Диаметр присоединительный	5

		22F ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	
4	Пробка Луер	Диаметр (внутренней заглушки) ($4,3 \pm 0,3$) мм.	0,5
5	Коннектор -22М/15F	Диаметр присоединительный 15F ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22М ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	6
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 15 см до 38 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$.	30,5


Рисунок В 69. Соединитель гофрированный растяжимый длинной трубки от 7 до 30 см с шагом 1 см в сборе с коннектором угловым 22М/15F-15М с портом Луер: 1 – коннектор угловой 22М/15F-15М с портом Луер; 2 – трубка растяжимая 15; 3 – коннектор -15 22F; 4 – пробка Луер; 5 – коннектор 22М/15F.

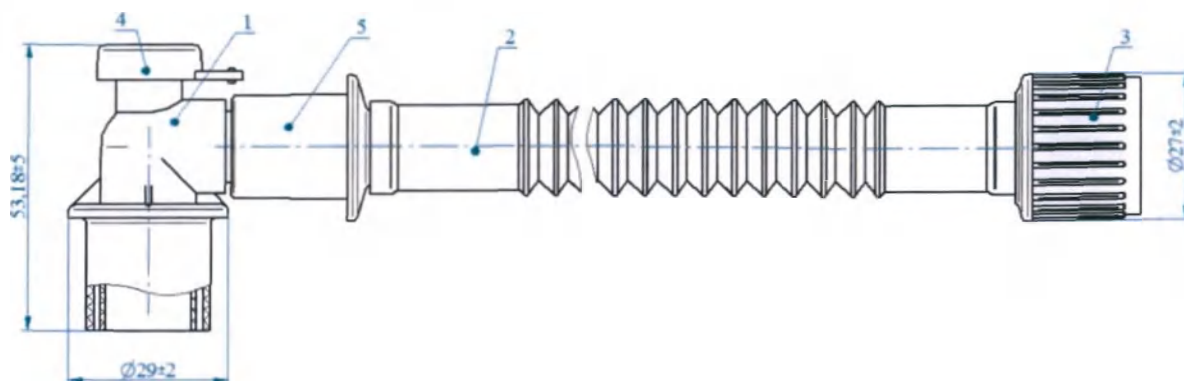

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор угловой 22М/15F-15М с портом 7,6	Диаметр присоединительный 15F ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22М ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	9
2	Трубка гофрированная растяжимая 15	Диаметр наружный (21 ± 2) мм. Длина (в растянутом состоянии, от 7 до 30 с шагом 1) см.	11
3	Коннектор -15 22F	Длина (48 ± 3) мм. Диаметр присоединительный 22F ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	5
4	Пробка 7,6	Диаметр ($7,6 \pm 0,3$) мм.	0,7
5	Коннектор -22М/15F	Диаметр присоединительный 15F ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22М ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	6
	Устройство в сборе	Габаритные размеры:	31,7


		Длина в растянутом состоянии – варианты исполнения от 15 см до 38 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$.	
--	--	--	--

Рисунок В 70. Соединитель гофрированная растяжимый длинной трубки от 7 до 30 см с шагом 1 см в сборе с коннектором угловым 22М/15F-15М с портом 7,6: 1 – коннектор угловой 22М/15F-15М с портом 7,6; 2 – трубка растяжимая 15; 3 – коннектор -15 22F; 4 – пробка 7,6; 5 – коннектор 22М/15F.

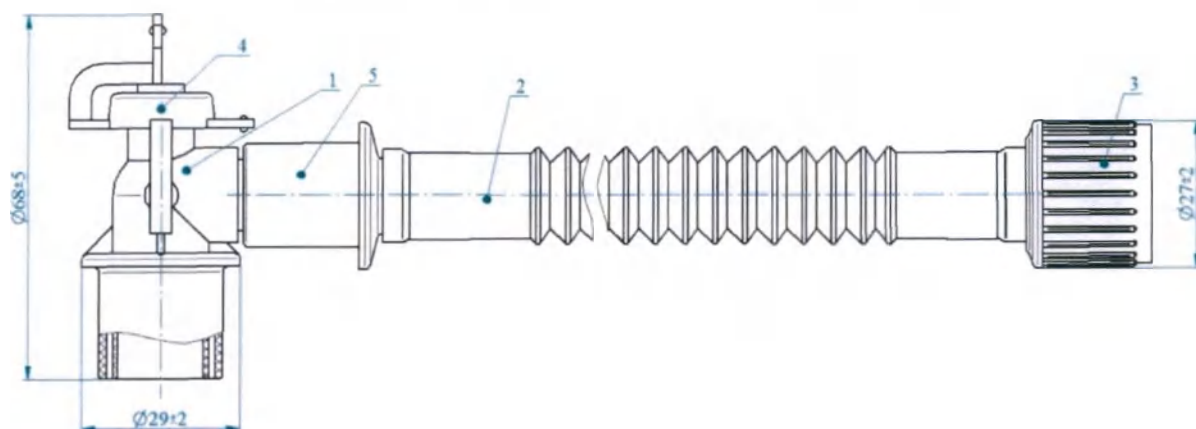


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор угловой 22М/15F-15М с портом 7,6/9,5	Диаметр присоединительный 15F ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22М ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	9
2	Трубка гофрированная растяжимая 15	Диаметр наружный (21 ± 2) мм. Длина (в растянутом состоянии, от 7 до 30 с шагом 1) см.	11
3	Коннектор -15 22F	Длина (48 ± 3) мм. Диаметр присоединительный 22F ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	5
4	Пробка 7,6/9,5	Диаметр ($7,6 \pm 0,3$) мм. Диаметр ($9,5 \pm 0,3$) мм.	0,8
5	Коннектор -22М/15F	Диаметр присоединительный 15F ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22М ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	6
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина в растянутом состоянии – варианты исполнения от 15 см до 38 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$.	31,8

Рисунок В 71 Соединитель гофрированный растяжимый длинной трубки от 7 до 30 см с шагом 1 см в сборе с коннектором угловым 22М/15F-15М с портом 7,6/9,5: 1 – коннектор угловой 22М/15F-15М с портом 7,6/9,5; 2 – трубка растяжимая 15; 3 – коннектор -15 22F; 4 – пробка 7,6/9,5; 5 – коннектор 22М/15F.

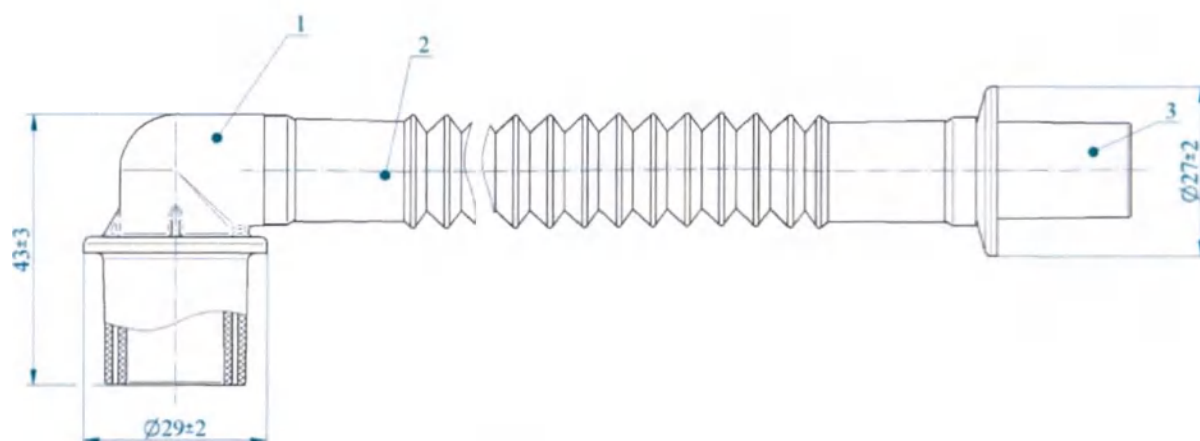


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор угловой 22М/15F-15М без портов	Диаметр присоединительный 15F ($\text{Ø}15,3\pm0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22М ($\text{Ø}22,2\pm0,5$) мм.	7
2	Трубка гофрированная 15	Диаметр наружный (18 ± 2) мм. Длина (от 15 до 30 с шагом 1) см.	12
3	Коннектор –15 15М	Длина (48 ± 3) мм. Диаметр присоединительный 15М ($\text{Ø}15,3\pm0,5$) мм.	5
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина– варианты исполнения от 21 см до 36 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$.	24

Рисунок В 72. Соединитель, гофрированный длинной трубки от 15 до 30 см с шагом 1 см с коннектором угловым 22М/15F-15М без портов и коннектором 15М: 1 – коннектор угловой 22М/15F-15М без портов; 2 – трубка гофрированная 15; 3 – коннектор -15 15М.

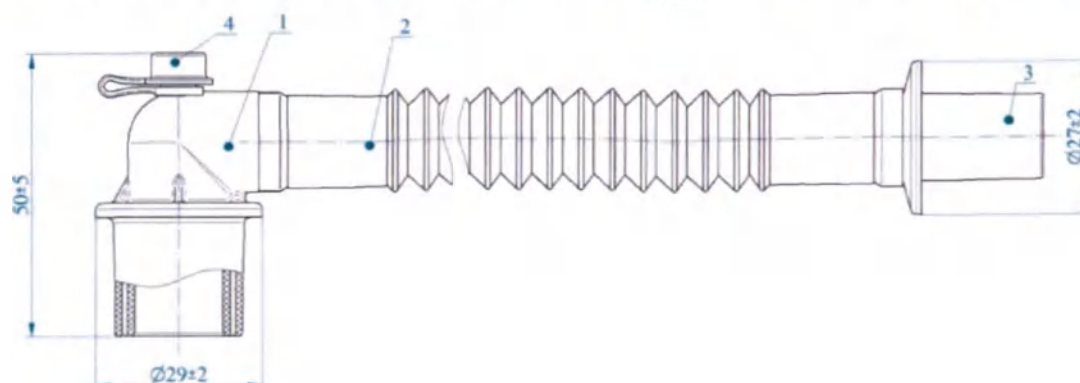

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор угловой 22М/15F-15М с портом Луер	Диаметр присоединительный 15F ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22М ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	8
2	Трубка гофрированная 15	Диаметр наружный (18 ± 2) мм. Длина (от 15 до 30 с шагом 1) см.	12
3	Коннектор -15 15М	Длина (48 ± 3) мм. Диаметр присоединительный 15М ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм.	5
4	Пробка Луер	Диаметр (внутренней заглушки) ($4,3 \pm 0,3$) мм.	0,5
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 21 см до 36 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$.	25,5


Рисунок В 73. Соединитель гофрированный длиной трубки от 15 до 30 см с шагом 1 см с коннектором угловым 22М/15F-15М с портом Луер и коннектором 15М: 1 – коннектор угловой 22М/15F-15М с портом Луер; 2 – трубка гофрированная 15; 3 – коннектор -15 15М; 4 – пробка Луер.

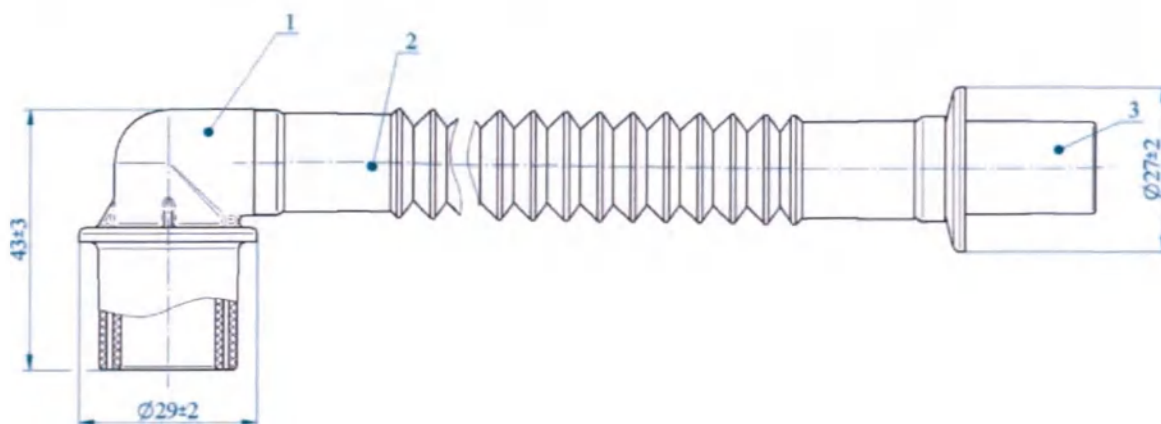

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор угловой 22М/15F-15М без портов	Диаметр присоединительный 15F ($\varnothing 15,3 \pm 0,5$) мм. Диаметр присоединительный 22М ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	7
2	Трубка гофрированная растяжимая 15	Диаметр наружный (21 ± 2) мм. Длина (в растянутом состоянии, от 7 до 30 с шагом 1) см.	11


3	Коннектор –15 15М	Длина (48±3) мм. Диаметр присоединительный 15М (Ø15,3±0,5) мм.	5
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина в растянутом состоянии – варианты исполнения от 13 см до 36 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет ±10%.	23

Рисунок В 74. Соединитель гофрированный растяжимый длинной трубки от 7 до 30 см с шагом 1 см с коннектором угловым 22М/15F-15М без портов и коннектором 15М: 1 – коннектор угловой 22М/15F-15М без портов; 2 – трубка растяжимая 15; 3 – коннектор -15 15М.

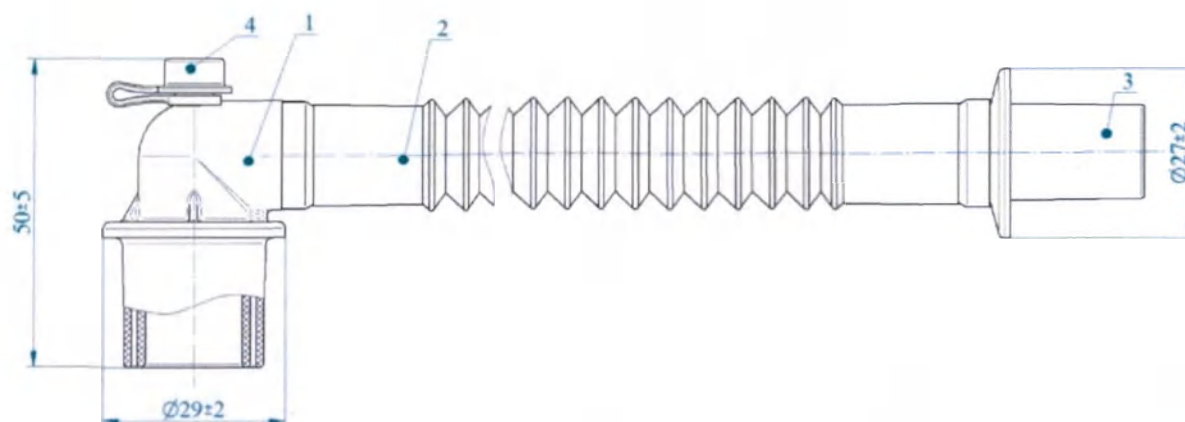


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор угловой 22М/15F-15М с портом Луер	Диаметр присоединительный 15F (Ø15,3±0,5) мм. Диаметр присоединительный 22М (Ø22,2±0,5) мм.	8
2	Трубка гофрированная растяжимая 15	Диаметр наружный (21±2) мм. Длина (в растянутом состоянии, от 7 до 30 с шагом 1) см.	11
3	Коннектор –15 15М	Длина (48±3) мм. Диаметр присоединительный 15М (Ø15,3±0,5) мм.	5
4	Пробка Луер	Диаметр (внутренней заглушки) (4,3±0,3) мм.	0,5
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина в растянутом состоянии – варианты исполнения от 13 см до 36 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет ±10%.	24,5

Рисунок В 75. Соединитель гофрированный растяжимый длинной трубки от 7 до 30 см с шагом 1 см с коннектором угловым 22М/15F-15М с портом Луер и коннектором 15М: 1 – коннектор угловой 22М/15F-15М с портом Луер; 2 – трубка растяжимая 15; 3 – коннектор -15 15М; 4 – пробка Луер.

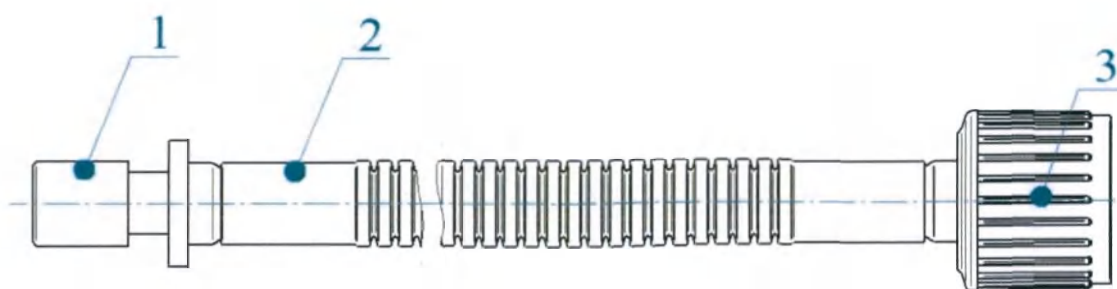

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор датчика потока	Длина (48±5) мм. Диаметр присоединительный наружный (Ø13±12) мм. Диаметр внутренний (Ø11±2) мм.	5
2	Трубка гофрированная 10	Диаметр наружный (13±3) мм. Длина (от 20см до 300 см с шагом 1) см.	60
3	Коннектор – 10 22F	Длина (48±5) мм. Диаметр присоединительный 22F (Ø22,2±0,5) мм	6
	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 25 см до 305 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет ±10% от номинальной величины. Внешний диаметр - (28±2) мм.	71


Рисунок В 78. Трубка гофрированная 10, длиной трубки от 5см до 100см с шагом 1 см, с коннекторами 22F и коннектором датчика потока: 1 – коннектор датчика потока; 2 – трубка гофрированная 10; 1 – коннектор-10 22F.

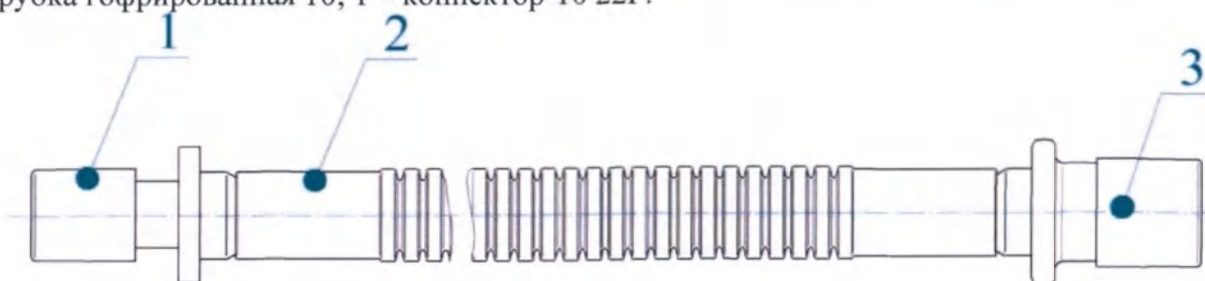

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор датчика потока	Длина (48±5) мм. Диаметр присоединительный наружный (Ø13±2) мм. Диаметр внутренний (Ø11±2) мм.	5
2	Трубка гофрированная 10	Диаметр наружный (13±3) мм. Длина (от 20см до 300 см с шагом 1) см.	60
3	Коннектор – 10 15M	Длина (48±5) мм. Диаметр присоединительный 15M (Ø15,3±0,5) мм	5

	Устройство в сборе	Габаритные размеры: Длина – варианты исполнения от 25 см до 305 см с шагом 1 см, допуск на длину составляет $\pm 10\%$ от номинальной величины. Внешний диаметр - (17 ± 2) мм.	70
--	--------------------	--	----

Рисунок В 79. Трубка гофрированная 10, длиной трубки от 5см до 100см с шагом 1 см, с коннекторами 15М и коннектором датчика потока. 1 – коннектор датчика потока; 2 – трубка гофрированная 10; 1 – коннектор-10 15М.

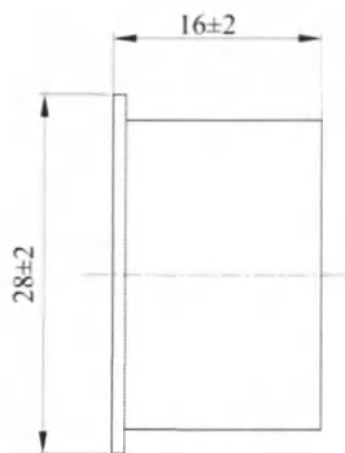


Масса не более – 3г.

Рисунок В 80. Тест-колпачок защитный




Масса не более – 3г.

Рисунок В 81. Тест-колпачок защитный 15М

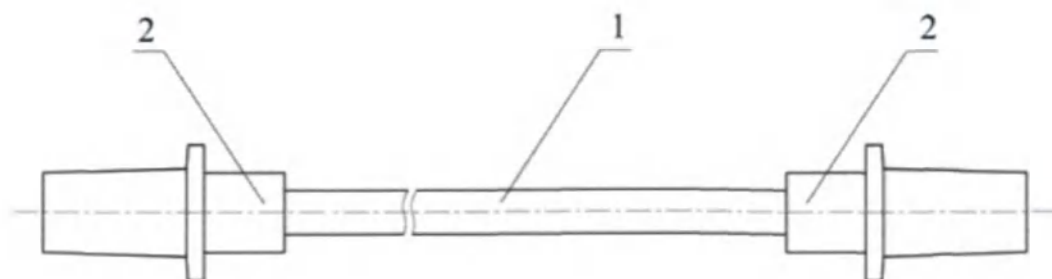


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Трубка кислородная	Диаметр наружный $(5,5 \pm 0,5)$ мм. Длина (от 12 см до 300 см с шагом 1) см.	60
2	Коннектор кислородной трубки	Длина (30 ± 3) мм. Диаметр наружный $(\varnothing 17 \pm 2)$ мм	10
Общая масса			80

Рисунок В 82. Трубка кислородная: 1 – трубка кислородная; 2 – коннектор трубки кислородной 10

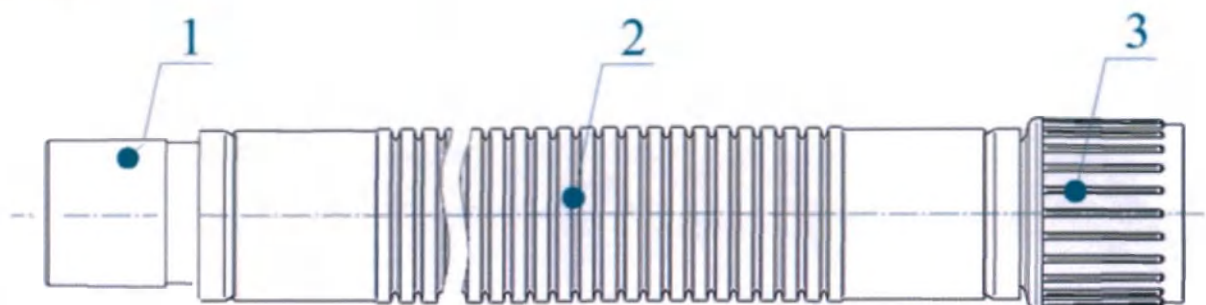


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор 22M	Длина (48 ± 2) мм. Диаметр присоединительный 22M $(\varnothing 22,2 \pm 0,5)$ мм.	6
2	Трубка гофрированная 22 с антимикробными компонентами	Диаметр наружный (22 ± 2) мм. Длина (от 20 см до 300 см с шагом 1) см.	180
3	Коннектор – 22F	Длина (48 ± 2) мм. Диаметр присоединительный 22F $(\varnothing 22,2 \pm 0,5)$ мм	6
Общая масса			192

Рисунок В 83. Трубка гофрированная 22 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F и 22M.

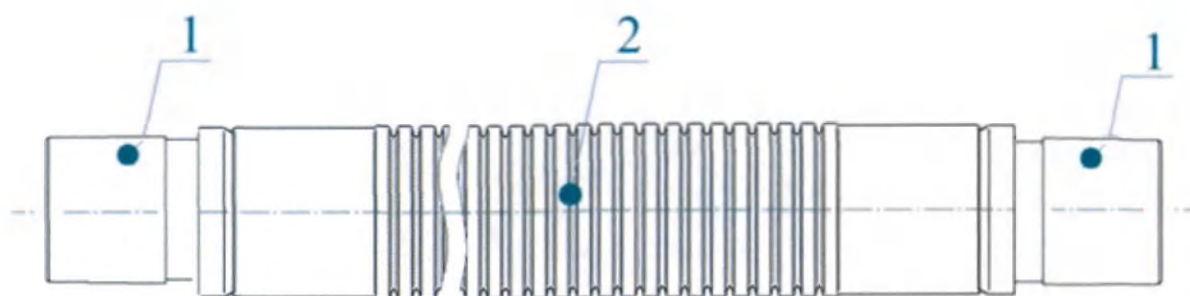


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор 22М	Длина (48±2) мм. Диаметр присоединительный 22М (Ø22,2±0,5) мм.	6
2	Трубка гофрированная 22 с антимикробными компонентами	Диаметр наружный (22±2) мм. Длина (от 20см до 300 см с шагом 1) см.	180
Общая масса			192

Рисунок В 84. Трубка гофрированная 22 с антимикробными компонентами с коннекторами 22М.

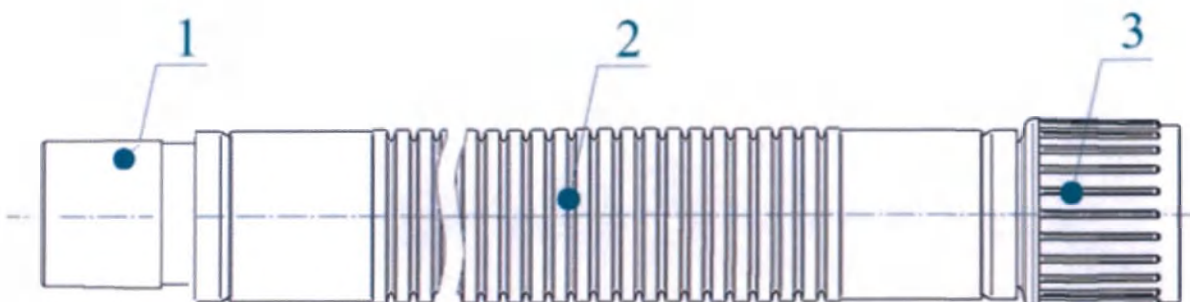


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор 22М	Длина (48±2) мм. Диаметр присоединительный 22М (Ø22,2±0,5) мм.	6
2	Трубка гофрированная 22	Диаметр наружный (22±2) мм. Длина (от 20см до 300 см с шагом 1) см.	180
3	Коннектор – 22F	Длина (48±2) мм. Диаметр присоединительный 22F (Ø22,2±0,5) мм	6
Общая масса			192

Рисунок В 85. Трубка гофрированная 22 с коннекторами 22F и 22М.

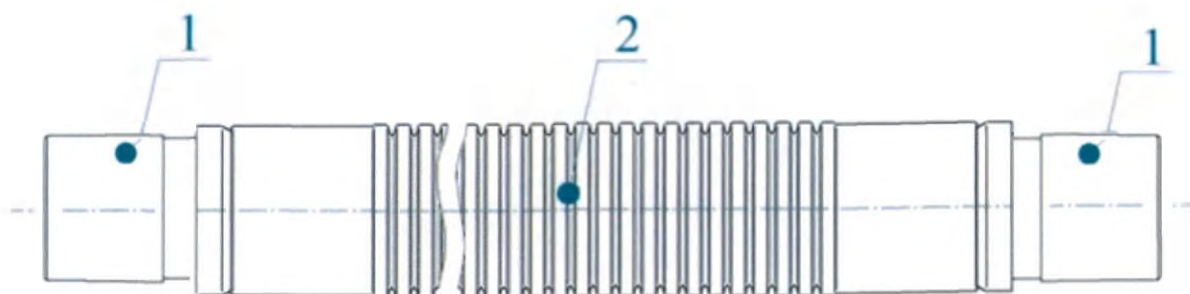


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор 22М	Длина (48±2) мм. Диаметр присоединительный 22М (Ø22,2±0,5) мм.	6
2	Трубка гофрированная 22	Диаметр наружный (22±2) мм. Длина (от 20см до 300 см с шагом 1) см.	180
Общая масса			192

Рисунок В 86. Трубка гофрированная 22 с коннекторами 22М.

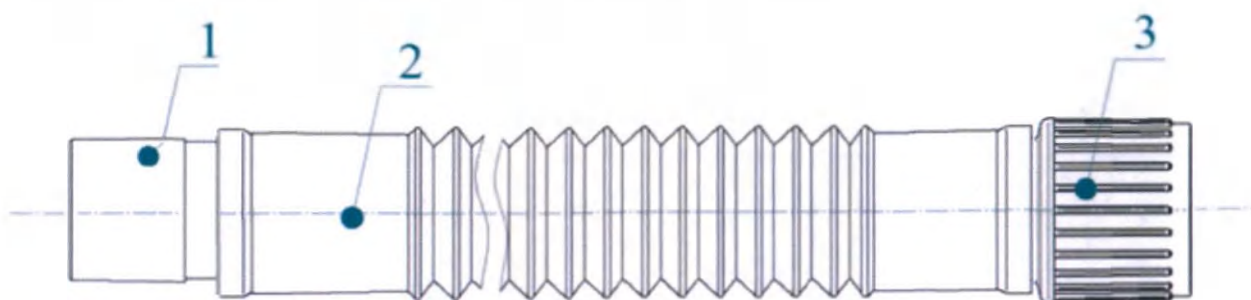


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор 22М	Длина (48±2) мм. Диаметр присоединительный 22М (Ø22,2±0,5) мм.	6
2	Трубка гофрированная растяжимая 22 с антимикробными компонентами	Диаметр наружный (25±2) мм. Длина (от 20см до 300 см с шагом 1) см.	120
3	Коннектор – 22F	Длина (48±2) мм. Диаметр присоединительный 22F (Ø22,2±0,5) мм	6
Общая масса			132

Рисунок В 87. Трубка гофрированная растяжимая 22 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F и 22М.

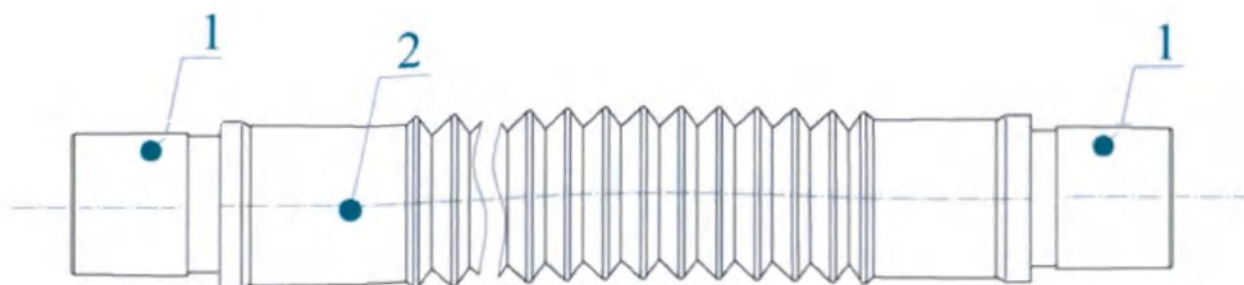


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор 22М	Длина (48 ± 2) мм. Диаметр присоединительный 22М ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	6
2	Трубка гофрированная растяжимая 22 с антимикробными компонентами	Диаметр наружный (25 ± 2) мм. Длина (от 20 см до 300 см с шагом 1) см.	120
Общая масса			132

Рисунок В 88. Трубка гофрированная растяжимая 22 с антимикробными компонентами с коннекторами 22М.

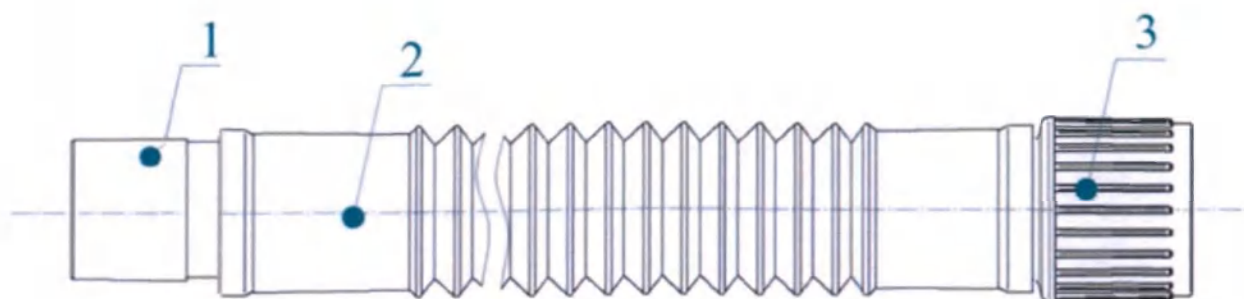


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор 22М	Длина (48 ± 2) мм. Диаметр присоединительный 22М ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм.	6
2	Трубка гофрированная растяжимая 22	Диаметр наружный (25 ± 2) мм. Длина (от 20 см до 300 см с шагом 1) см.	120
3	Коннектор – 22F	Длина (48 ± 2) мм. Диаметр присоединительный 22F ($\varnothing 22,2 \pm 0,5$) мм	6
Общая масса			132

Рисунок В 89. Трубка гофрированная растяжимая 22 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F и 22М.

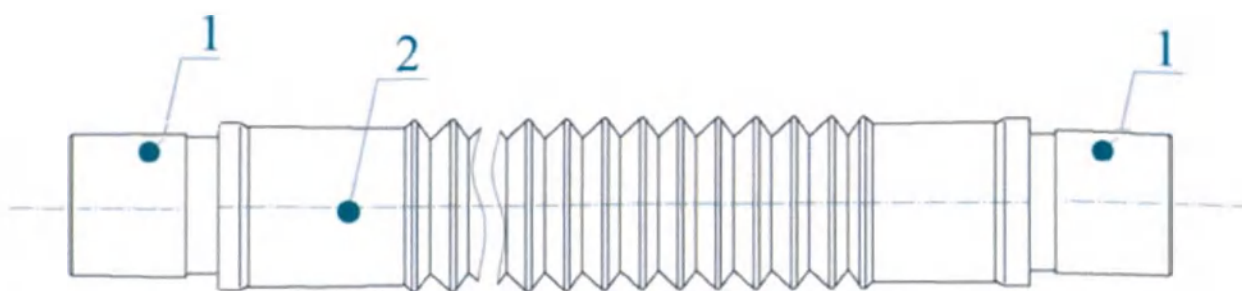


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор 22М	Длина (48±2) мм. Диаметр присоединительный 22М (Ø22,2±0,5) мм.	6
2	Трубка гофрированная растяжимая 22	Диаметр наружный (25±2) мм. Длина (от 20см до 300 см с шагом 1) см.	120
Общая масса			132

Рисунок В 90. Трубка гофрированная растяжимая 22 с антимикробными компонентами с коннекторами 22М.

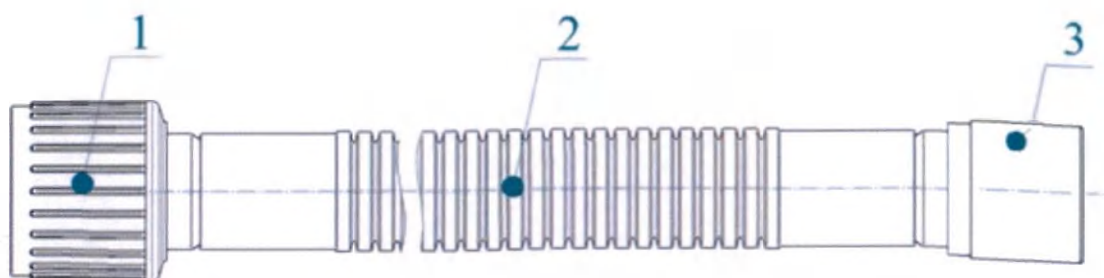


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 15 22F	Длина (48±2) мм. Диаметр присоединительный 22F (Ø22,2±0,5) мм	5
2	Трубка гофрированная 15 с антимикробными компонентами	Диаметр наружный (18±2) мм. Длина (от 20 см до 300 см с шагом 1) см.	110
3	Коннектор – 15 22М	Длина (48±2) мм. Диаметр присоединительный 22М (Ø22,2±0,5) мм	5
Общая масса			120

Рисунок В 91. Трубка гофрированная 15 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F и 22М.

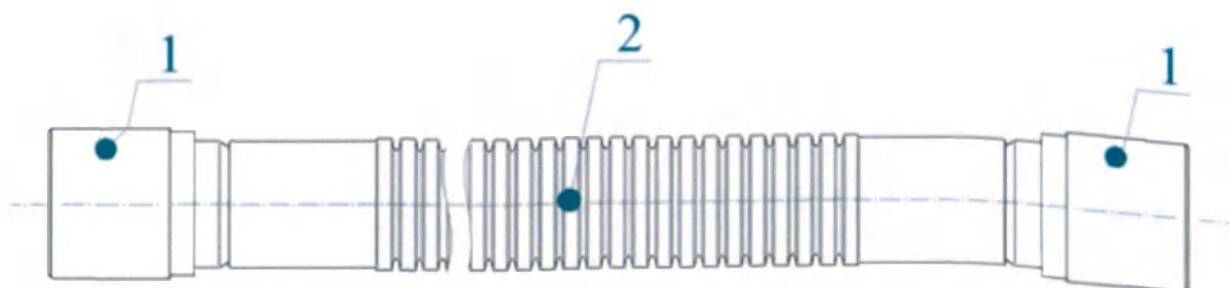


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 15 22М	Длина (48±2) мм. Диаметр присоединительный 22М (Ø22,2±0,5) мм	5
2	Трубка гофрированная 15 с антимикробными компонентами	Диаметр наружный (18±2) мм. Длина (от 20 см до 300 см с шагом 1) см.	110
Общая масса			120

Рисунок В 92. Трубка гофрированная 15 с антимикробными компонентами с коннекторами 22М.

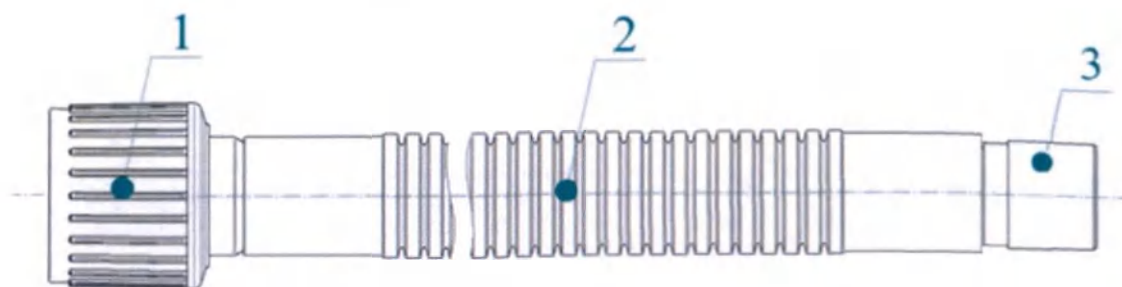


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 15 22F	Длина (48±2) мм. Диаметр присоединительный 22F (Ø22,2±0,5) мм	5
2	Трубка гофрированная 15 с антимикробными компонентами	Диаметр наружный (18±2) мм. Длина (от 20 см до 300 см с шагом 1) см.	110
3	Коннектор – 15 15М	Длина (48±2) мм. Диаметр присоединительный 15М (Ø15,3±0,5) мм	5
Общая масса			120

Рисунок В 93. Трубка гофрированная 15 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F и 15М.

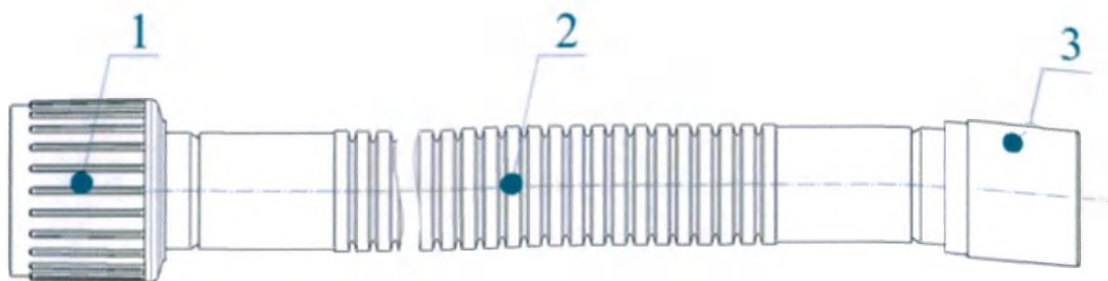


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 15 22F	Длина (48 ± 2) мм. Диаметр присоединительный 22F $(\varnothing 22,2 \pm 0,5)$ мм	5
2	Трубка гофрированная 15	Диаметр наружный (18 ± 2) мм. Длина (от 20 см до 300 см с шагом 1) см.	110
3	Коннектор – 15 22M	Длина (48 ± 2) мм. Диаметр присоединительный 22M $(\varnothing 22,2 \pm 0,5)$ мм	5
Общая масса			120

Рисунок В 94. Трубка гофрированная 15 с коннекторами 22F и 22M.

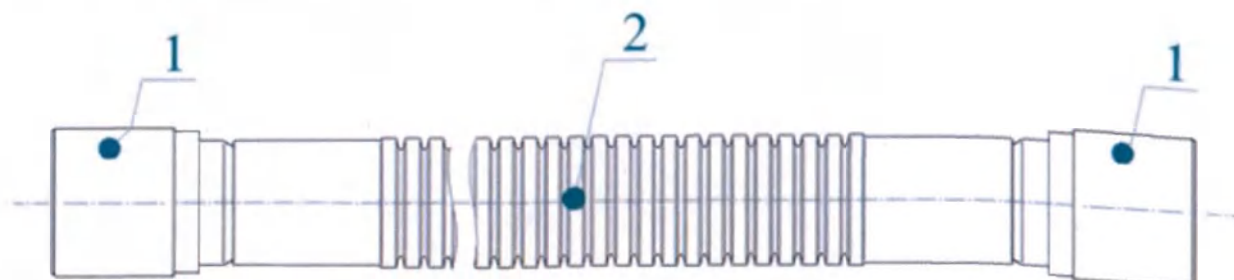


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 15 22M	Длина (48 ± 2) мм. Диаметр присоединительный 22M $(\varnothing 22,2 \pm 0,5)$ мм	5
2	Трубка гофрированная 15	Диаметр наружный (18 ± 2) мм. Длина (от 20 см до 300 см с шагом 1) см.	110
Общая масса			120

Рисунок В 95. Трубка гофрированная 15 с коннекторами 22M.

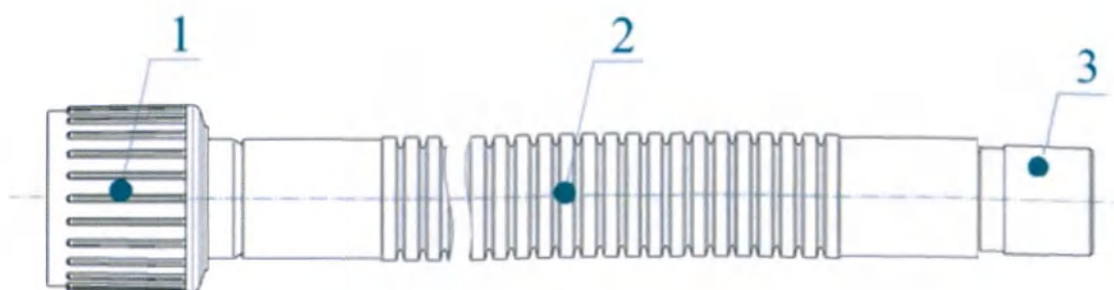


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 15 22F	Длина (48±2) мм. Диаметр присоединительный 22F (Ø22,2±0,5) мм	5
2	Трубка гофрированная 15	Диаметр наружный (18±2) мм. Длина (от 20 см до 300 см с шагом 1) см.	110
3	Коннектор – 15 15M	Длина (48±2) мм. Диаметр присоединительный 15M (Ø15,3±0,5) мм	5
Общая масса			120

Рисунок В 96. Трубка гофрированная 15 с коннекторами 22F и 15M.

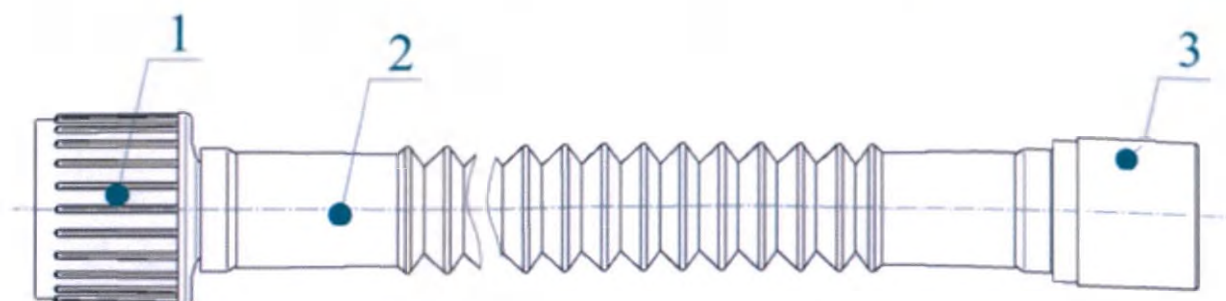


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 15 22F	Длина (48±2) мм. Диаметр присоединительный 22F (Ø22,2±0,5) мм	5
2	Трубка гофрированная растяжимая 15 с антимикробными компонентами	Диаметр наружный (21±3) мм. Длина (в растянутом состоянии, от 20 см до 300 см с шагом 1) см.	110
3	Коннектор – 15 22M	Длина (48±2) мм. Диаметр присоединительный 22M (Ø22,2±0,5) мм	5
Общая масса			120

Рисунок В 97. Трубка гофрированная растяжимая 15 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F и 22M.

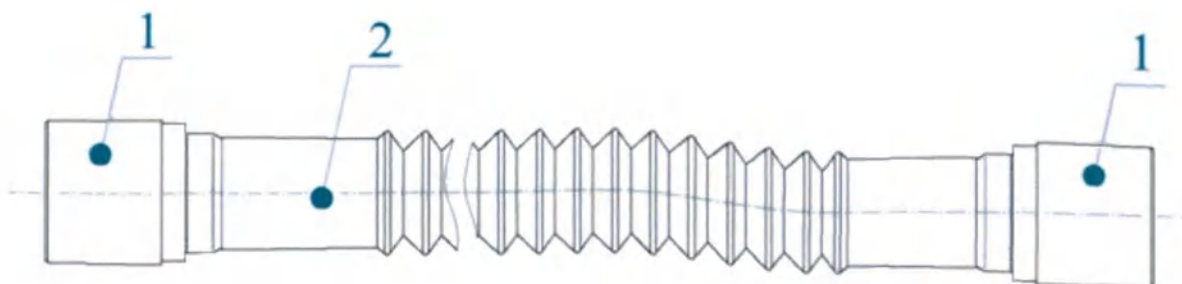


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 15 22М (2 шт)	Длина (48 ± 2) мм. Диаметр присоединительный 22М $(\varnothing 22,2 \pm 0,5)$ мм	5
2	Трубка гофрированная растяжимая 15 с антимикробными компонентами	Диаметр наружный (21 ± 3) мм. Длина (в растянутом состоянии, от 20 см до 300 см с шагом 1) см.	110
Общая масса			120

Рисунок В 98. Трубка гофрированная растяжимая 15 с антимикробными компонентами с коннекторами 22М.

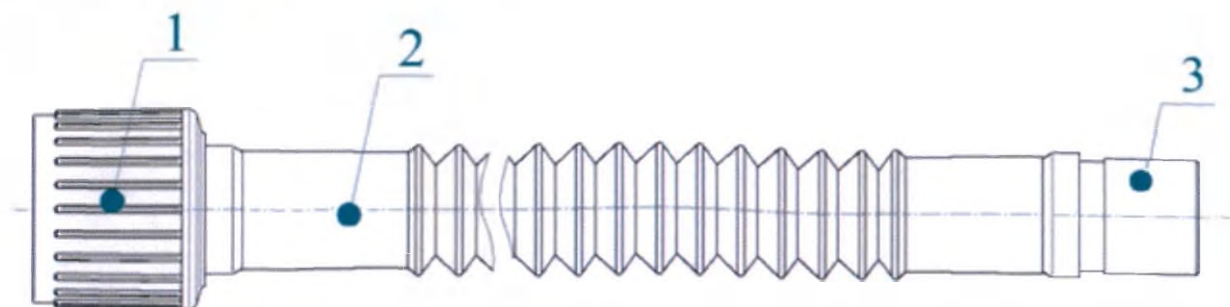


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 15 22F	Длина (48 ± 2) мм. Диаметр присоединительный 22F $(\varnothing 22,2 \pm 0,5)$ мм	5
2	Трубка гофрированная растяжимая 15 с антимикробными компонентами	Диаметр наружный (21 ± 3) мм. Длина (в растянутом состоянии, от 20 см до 300 см с шагом 1) см.	110
3	Коннектор – 15 15М	Длина (48 ± 2) мм. Диаметр присоединительный 15М $(\varnothing 15,3 \pm 0,5)$ мм	5
Общая масса			120

Рисунок В 99. Трубка гофрированная растяжимая 15 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F и 15М.

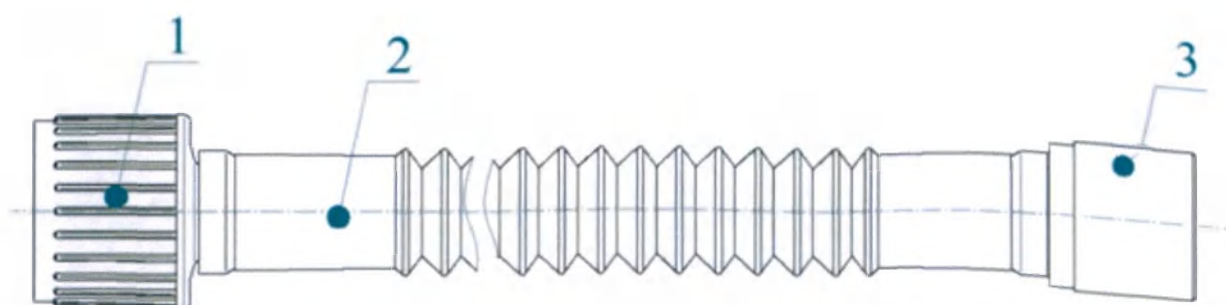


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 15 22F	Длина (48±2) мм. Диаметр присоединительный 22F (Ø22,2±0,5) мм	5
2	Трубка растяжимая 15	Диаметр наружный (21±3) мм. Длина (в растянутом состоянии, от 20 см до 300 см с шагом 1) см.	110
3	Коннектор – 15 22M	Длина (48±2) мм. Диаметр присоединительный 22M (Ø22,2±0,5) мм	5
Общая масса			120

Рисунок В 100. Трубка гофрированная растяжимая 15 с коннекторами 22F и 22M.

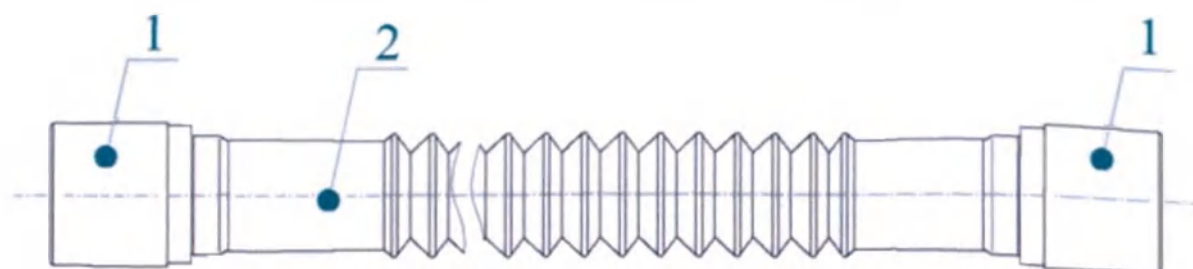


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 15 22M (2 шт.)	Длина (48±2) мм. Диаметр присоединительный 22M (Ø22,2±0,5) мм	5
2	Трубка гофрированная растяжимая 15	Диаметр наружный (21±3) мм. Длина (в растянутом состоянии, от 20 см до 300 см с шагом 1) см.	110
Общая масса			120

Рисунок В 101. Трубка гофрированная растяжимая 15 с коннекторами 22M.

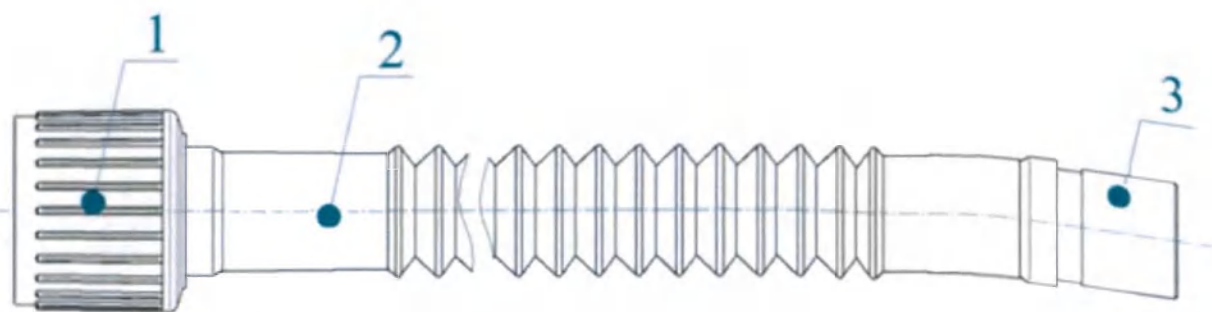


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 15 22F	Длина (48 ± 2) мм. Диаметр присоединительный 22F $(\varnothing 22,2 \pm 0,5)$ мм	5
2	Трубка растяжимая 15	Диаметр наружный (21 ± 3) мм. Длина (в растянутом состоянии, от 20 см до 300 см с шагом 1) см.	110
3	Коннектор – 15 15M	Длина (48 ± 2) мм. Диаметр присоединительный 15M $(\varnothing 15,3 \pm 0,5)$ мм	5
Общая масса			120

Рисунок В 102. Трубка гофрированная растяжимая 15 с коннекторами 22F и 15M.

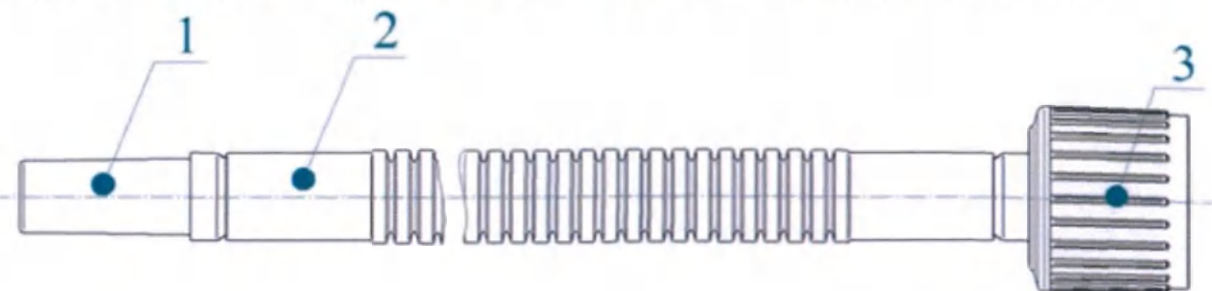

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 10 10M	Длина (48 ± 5) мм. Диаметр присоединительный 10M $(\varnothing 10,3 \pm 1)$ мм	5
2	Трубка гофрированная 10	Диаметр наружный (13 ± 3) мм. Длина (от 20 см до 300 см с шагом 1) см.	60
3	Коннектор – 10 22F	Длина (48 ± 2) мм. Диаметр присоединительный 22F $(\varnothing 22,2 \pm 0,5)$ мм	5
Общая масса			70

Рисунок В 103. Трубка гофрированная 10 с коннекторами 10M и 22F.

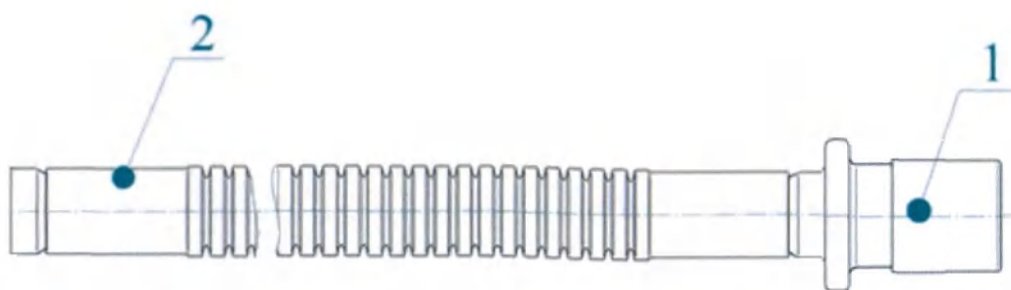


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 10 15M	Длина (48±5) мм. Диаметр присоединительный 15M (Ø15,3±0,5) мм	5
2	Трубка гофрированная 10	Диаметр наружный (13±3) мм. Длина (от 20см до 300 см с шагом 1) см.	60
Общая масса			65

Рисунок В 104. Трубка гофрированная 10 с коннектором 15M.



№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 10 12,5M	Длина (48±5) мм. Диаметр присоединительный 12,5M (Ø12,5±0,5) мм	5
2	Трубка гофрированная 10	Диаметр наружный (13±3) мм. Длина (от 20 см до 300 см с шагом 1) см.	60
Общая масса			65


Рисунок В 105. Трубка гофрированная 10 с коннектором 12,5M.

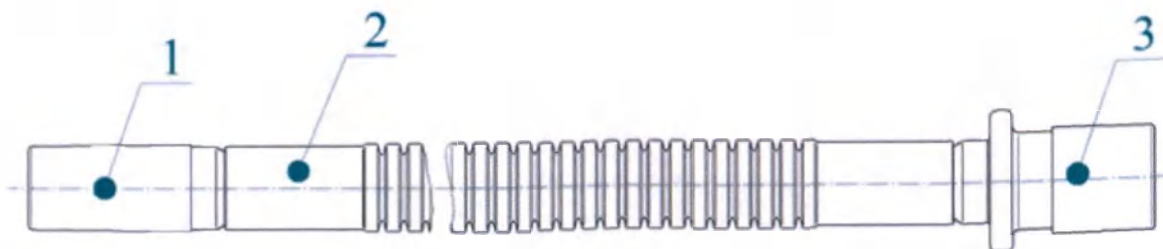

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
---	---------------------	--------	---------------------


1	Коннектор – 10 12,5М	Длина (48±5) мм. Диаметр присоединительный 12,5М (Ø12,5±0,5) мм	5
2	Трубка гофрированная 10	Диаметр наружный (13±3) мм. Длина (от 20 см до 300 см с шагом 1) см.	60
3	Коннектор – 10 15М	Длина (48±5) мм. Диаметр присоединительный 15М (Ø15,3±0,5) мм	5
Общая масса			70

Рисунок В 106. Трубка гофрированная 10 с коннекторами 12,5М и 15М.

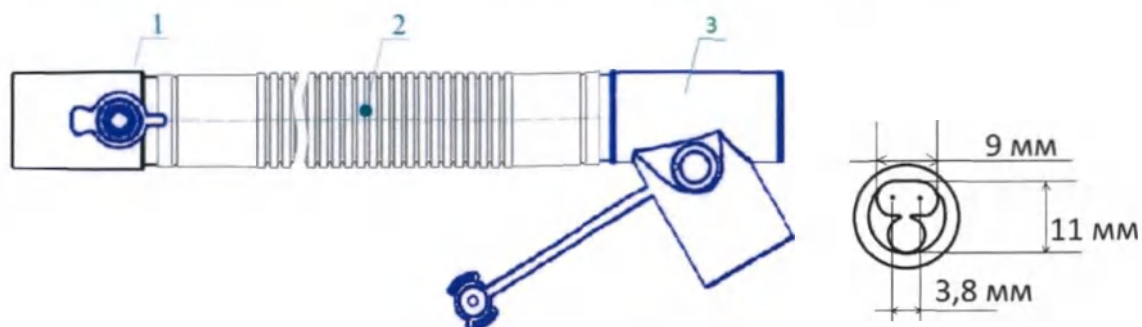


№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 22 22F с портом	Длина (48±2) мм. Диаметр присоединительный 22F (Ø22,2±0,5) мм	8
2	Трубка гофрированная 22	Диаметр наружный (22±2) мм. Длина 150 см.	180
3	Коннектор – 22 22F с портом 7,6 мм, угловой	Длина (48±5) мм. Диаметр присоединительный 22F (Ø22,2±0,5) мм	50
Общая масса устройства			238

Рисунок В 107. Трубка гофрированная 22 обогреваемая, длиной трубки 150 см, с коннекторами 22F с портом. (справа расположена схема и размеры подключения электрического адаптера увлажнителя дыхательных смесей)

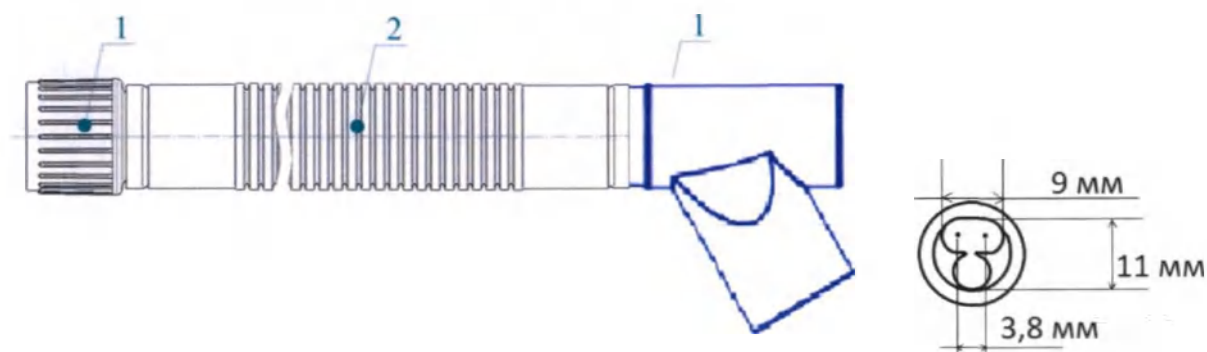

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 22 22F	Длина (48±2) мм. Диаметр присоединительный 22F (Ø22,2±0,5) мм	6
2	Трубка гофрированная 22	Диаметр наружный (22±2) мм. Длина 150 см.	180
3	Коннектор – 22 22F угловой	Длина (48±5) мм. Диаметр присоединительный 22F (Ø22,2±0,5) мм	48
Общая масса устройства			234


Рисунок В 108. Трубка гофрированная 22 обогреваемая, длиной трубки 150 см, с коннекторами 22F. (справа расположена схема и размеры подключения электрического адаптера увлажнителя дыхательных смесей)

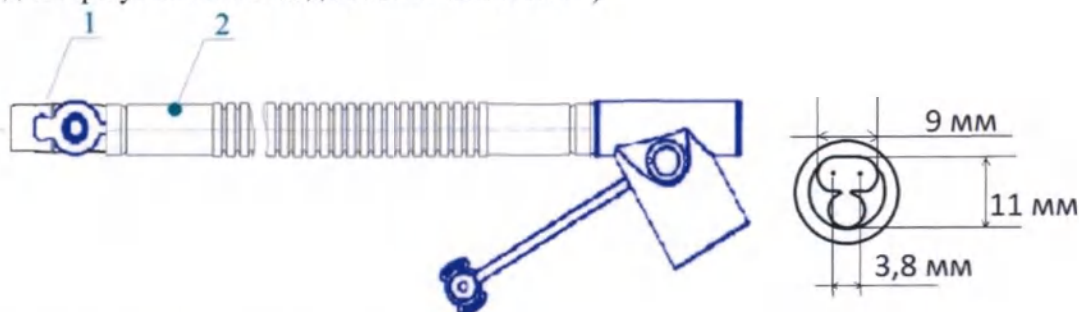

1 – коннектор-12,5 15M; 2 – трубка гофрированная 10; 3 – коннектор-10 22F.

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 10 12,5M с портом	Длина (48±5) мм. Диаметр присоединительный 12,5M (Ø12,3±0,5) мм	6
2	Трубка гофрированная 10	Диаметр наружный (13±3) мм. Длина 110 см.	60
3	Коннектор – 10 22F с 7,6 портом	Длина (48±5) мм. Диаметр присоединительный 22F (Ø22,2±0,5) мм	6
Общая масса устройства			72

Рисунок В 109. Трубка гофрированная 10 обогреваемая, длиной трубки 110 см, с коннекторами 22F с портом. (справа расположена схема и размеры подключения электрического адаптера увлажнителя дыхательных смесей)

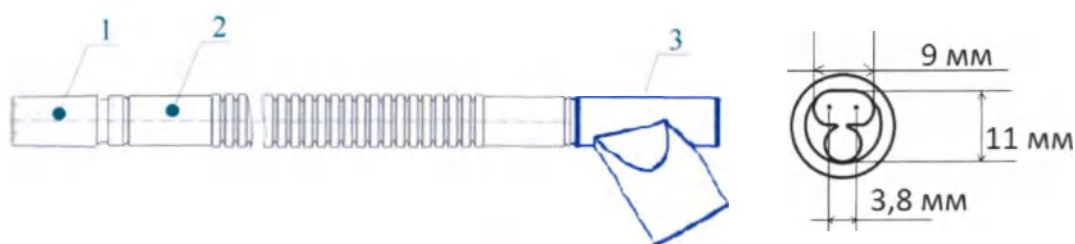


1 – коннектор-12,5 15M; 2 – трубка гофрированная 10; 3 – коннектор-10 22F.

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Коннектор – 10 12,5М с портом	Длина (48±5) мм. Диаметр присоединительный 12,5М (Ø12,3±0,5) мм	6
2	Трубка гофрированная 10	Диаметр наружный (13±3) мм. Длина 110 см.	60
3	Коннектор – 10 22F	Длина (48±5) мм. Диаметр присоединительный 22F (Ø22,2±0,5) мм	6
Общая масса устройства			72

Рисунок В 110. Трубка гофрированная 10 обогреваемая, длиной трубки 110 см, с коннекторами 22F. (справа расположена схема и размеры подключения электрического адаптера увлажнителя дыхательных смесей)

Схема расположения провода обогрева в трубке обогреваемой:

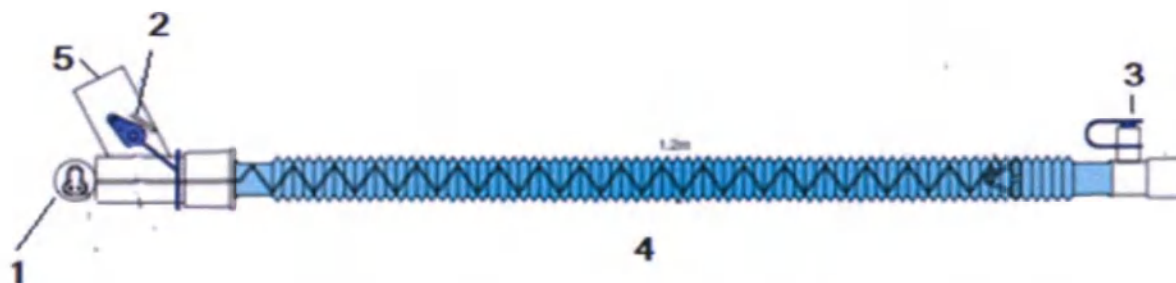

1. Соединитель для адаптера провода нагрева увлажнителя (он развернут на схеме на 90 градусов для наглядности).
2. Температурный порт 1.
3. Температурный порт 2.
4. Гофрированная трубка с проводом обогрева внутри.
5. Коннектор 22 мм.


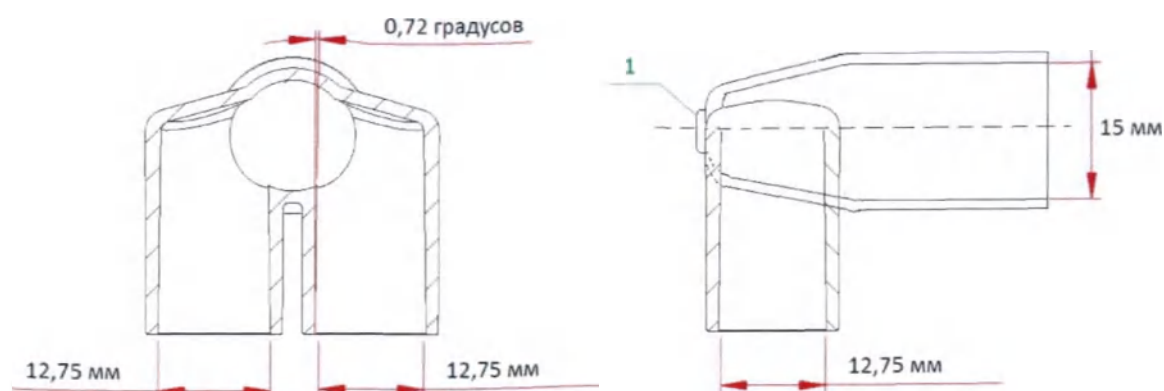



Рисунок В 111. Y-образный коннектор, с портом.

№	Наименование детали	Размер	Масса, г (не более)
1	Y-образный коннектор – 10 12,5М с портом	Длина (48±5) мм. Диаметр присоединительный 12,5М (Ø12,3±0,5) мм	6

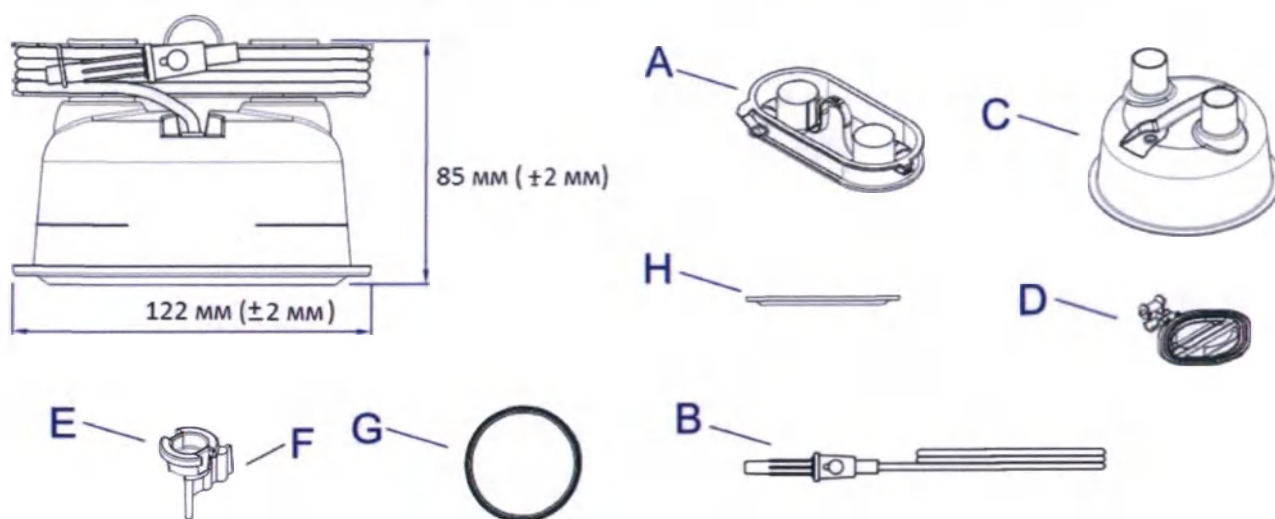


№	Обозначение на схеме	Наименование детали	Масса, г (не более)
1	A	Защитная крышка	110
2	B	Линия подачи воды (интегрированная)	
3	C	Корпус	
4	D	Поплавок	
5	E	Клапан	
6	F	Стойка	
7	G	Уплотнитель	
8	H	Нагревательная пластина	
Общая масса устройства			110

Рисунок В 112. Камера для увлажнителей дыхательных смесей (с автоматическим заполнением, для взрослых пациентов).

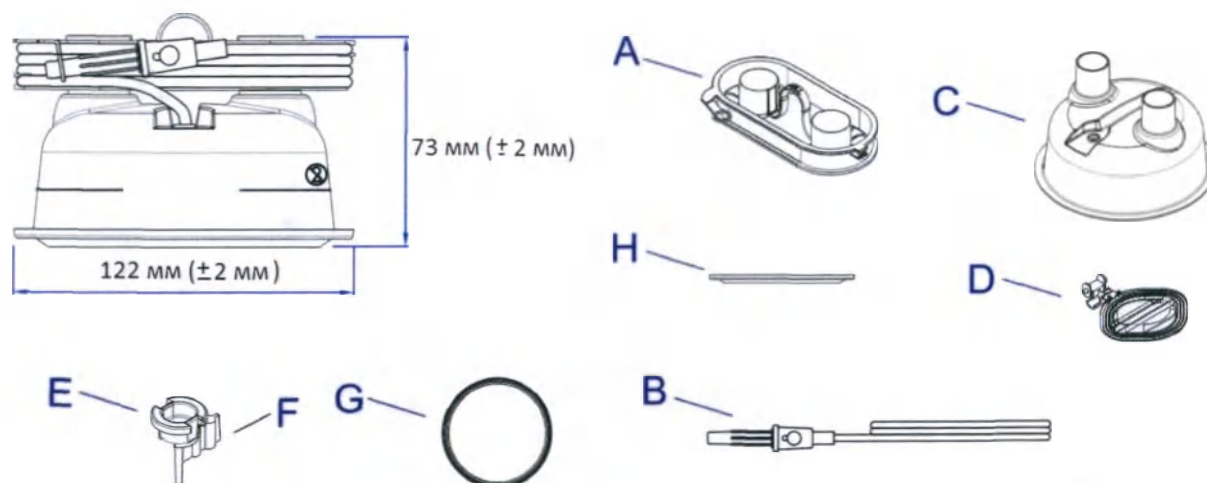

№	Обозначение на схеме	Наименование детали	Масса, г (не более)
1	A	Защитная крышка	105
2	B	Линия подачи воды (интегрированная)	
3	C	Корпус	
4	D	Поплавок	
5	E	Клапан	
6	F	Стойка	
7	G	Уплотнитель	
8	H	Нагревательная пластина	
Общая масса устройства			105


Рисунок В 113. Камера для увлажнителей дыхательных смесей (с автоматическим заполнением, для детей).

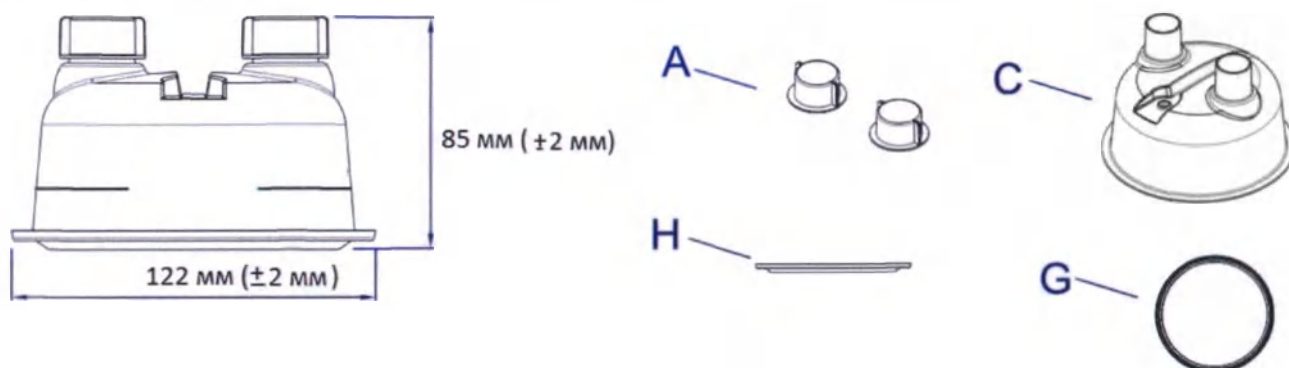

№	Обозначение на схеме	Наименование детали	Масса, г (не более)
1	A	Защитные колпачки	


2	C	Корпус	Общая масса устройства 85
3	G	Уплотнитель	
4	H	Нагревательная пластина	

Рисунок В 114. Камера для увлажнителей дыхательных смесей (большая).

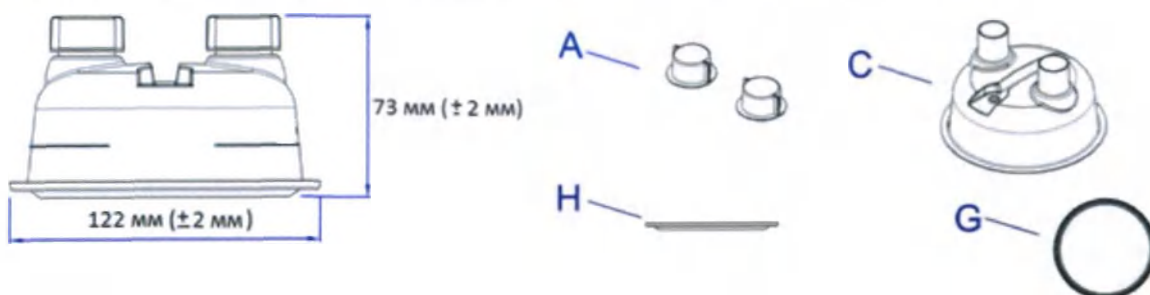

№	Обозначение на схеме	Наименование детали	Масса, г (не более)
1	A	Защитные колпачки	82
2	C	Корпус	
3	G	Уплотнитель	
4	H	Нагревательная пластина	
Общая масса устройства			82

Рисунок В 115. Камера для увлажнителей дыхательных смесей (малая).

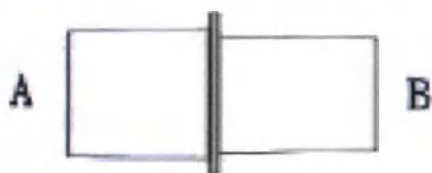


№	Наименование детали	Размеры	Масса, г (не более)
1	Коннектор прямой.	A - наружный диаметр 15 мм B - наружный диаметр 7,6 мм	3

Рисунок В 116. Коннектор прямой.



№	Наименование детали	Размеры	Масса, г (не более)
1	Коннектор прямой.	A - наружный диаметр 15 мм B - наружный диаметр 13 мм	3

Рисунок В 117. Коннектор прямой.

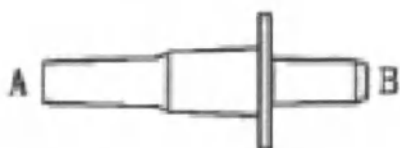


№	Наименование детали	Размеры	Масса, г (не более)
1	Коннектор прямой.	А - наружный диаметр 4,3 мм В - наружный диаметр 4,5 мм	2

Рисунок В 118. Коннектор прямой.




№	Наименование детали	Размеры	Масса, г (не более)
1	Коннектор прямой.	А - наружный диаметр 22 мм В - наружный диаметр 22 мм	3

Рисунок В 119. Коннектор прямой.

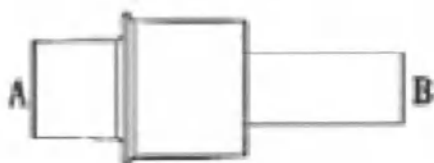

№	Наименование детали	Размеры	Масса, г (не более)
1	Коннектор прямой.	А - внутренний диаметр 15 мм	3
2	Трубка эластомерная	В - внутренний диаметр 9,4 мм	1
Общая масса устройства			4

Рисунок В 120. Коннектор прямой.

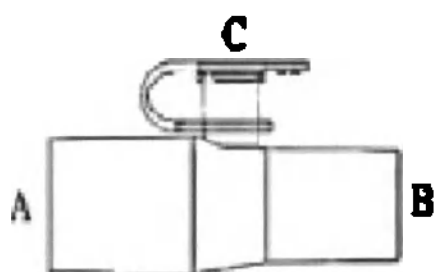

№	Наименование детали	Размеры	Масса, г (не более)
1	Т-коннектор.	А - наружный диаметр 15 мм В - внутренний диаметр 10 мм С - внутренний диаметр 4,3 мм	5
2	Колпачок	С - наружный диаметр 4,3 мм	1
Общая масса устройства			6

Рисунок В 121. Коннектор прямой

Приложение В: Покупные изделия:

Наименование изделия	Производитель, страна производства	Нормативный документ
Контуры пациента для аппаратов наркозно-дыхательных и искусственной вентиляции легких, с принадлежностями (см. Приложение на 2 листах): Принадлежности: 1. Трубки разных размеров: 1.1. Трубка дыхательная; 1.2. Трубка проксимального давления и CO₂; 1.3. Трубка кислородная. 1.4. Трубка соединительная; 3.1. Мешок дыхательный. 3.2. Мешок резервный; 4. Маски лицевые разных размеров: 4.1. Маска кислородная. 4.2. Маска аэрозольная. 4.3. Маска дыхательная. 4.4. Маска CPAP/NIPPV 5.1. Фильтр вирусный; 5.2. Фильтр бактериально-вирусный с увлажнителем. 7. Клапаны: 7.1. Клапан вдоха/выдоха. 7.2. Клапан РЕЕР. 7.3. Клапан контроля. 7.4. Клапан давления; 8.2. Коннектор угловой; 8.3. Коннектор Т-образный 8.4. Коннектор У-образный; 9. Влагосборник. 10. Канюли назальные: 10.1. Канюля назальная CPAP. 10.2. Канюля назальная кислородная. 11. Фиксатор масок. 12. Зажим.	"ХЭРОЛ С.р.л.", Италия	ФСЗ 2012/13286
Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких, с принадлежностями: 2 Трубки дыхательного контура: - трубки дыхательного контура многоразового использования силиконовые	"Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань	ФСЗ 2012/12928

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
(гладкоствольные, армированные); - трубки дыхательного контура многоразового использования (Hytrel) (гладкоствольные, армированные); - трубки дыхательного контура однократного использования гофрированные (этиленвинилацетат); - трубки дыхательного контура однократного использования (этиленвинилацетат); - трубки дыхательного контура однократного использования (гладкоствольные, армированные), (этиленвинилацетат); 3. Гибкие соединители дыхательного контура: - гибкие соединители дыхательного контура с эндотрахеальной трубкой многоразового использования (силикон, Hytrel, этиленвинилацетат); 4. Влагосборники: - влагосборник однократного использования (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол); - влагосборник многоразового использования (полисульфон, поликарбонат); 6. Угловые адаптеры: - угловой адаптер (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен); 7. Y-образные адаптеры: -Y-образный адаптер (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен); 9. Мешок дыхательный (латекс); 10. Фильтры тепловлагообменные: - фильтры тепловлагообменные угловой конфигурации:			

Наименование изделия	Производитель, страна производства	Нормативный документ
взрослые, педиатрические, взрослые/педиатрические; - фильтры тепловлагообменные прямые: взрослые, взрослые/педиатрические, педиатрические.		
Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии торговой марки «Eximed» (см. Приложение на 2 листах): 11. Дыхательные шланги (длиной 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 180 см, 300 см, 400 см); 12. Линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления); 16. Фильтры (бактериальновирусные и тепловлагообменные, с дополнительным Луер-портом и без него) для пациентов, дыхательных контуров и аппаратов; 17. Мешки (дыхательные и резервные, объемом 0.5 л, 1.0 л, 2.0 л, 3.0 л); 19. Дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, управляемые клапаны выдоха, клапаны РЕЕР, клапаны Вентури, регулируемые и нерегулируемые, клапаны реверсивные и нереверсивные; 20. Коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, Y-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них), мундштуки, держатели для	"ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань	ФСЗ 2012/11566

Наименование изделия	Производитель, страна производства	Нормативный документ
масок (длиной 440 мм и 700 мм) и фиксаторы для шлангов и трубок; 21. Влагосборники для дыхательных контуров для взрослых и детей.		
Изделия расходные к аппаратам искусственной вентиляции лёгких для лечения новорожденных Изделия расходные к аппаратам искусственной вентиляции лёгких для лечения новорожденных 1. Генератор дыхания. 3. Маски лицевые дыхательные. 4. Канюли назальные. 5. Шапочки-фиксаторы дыхательные.	"Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания	ФСЗ 2011/10229
Изделия медицинские полимерные для анестезиологии и реаниматологии: Мешок для дыхательного контура, одноразового использования (вид 283370); 3. Влагосборники; 5. Резервные мешки; 7. Клапаны дыхательные; 10. Дыхательные шланги; 11. Тонкие трубки для мониторинга; 15. Соединительные устройства; 17. Фильтры.	"Алба Хелскеа ЛЛС", США,	ФСЗ 2009/04992
Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: 10. Дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых, для детей; предохранительные клапаны сброса; управляемые клапаны выдоха; клапаны РЕЕР; клапаны Вентури	"Интерседжикал Лтд.", Великобритания	ФСЗ 2009/03551

Наименование изделия	Производитель, страна производства	Нормативный документ
регулируемые и нерегулируемые; клапаны реверсивные и нереверсивные; клапаны с линиями мониторинга (или без) и управления; 17. Дыхательные шланги в комплекте с соединителями или без: шланги для дыхательных контуров; шланги для эвакуации отработанных газов; 18. Соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: жесткие; эластомерные; гибкие; шарнирные; прямые; угловые; Т-образные; Y-образные; адаптеры; мундштуки (загубники); 19. Влагосборники для дыхательных контуров для взрослых, для детей и для новорождённых; 20. Дыхательные вирусобактериальные фильтры в комплекте с соединителями или без: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов; 26. Линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга содержания углекислого газа; линии мониторинга давления; 27. Дыхательные мешки объёмом: 0.5л, 1.0л, 1.3л, 2.0л, 2.3л, 3.0л, 5.0л: для анестезиологических или реанимационных дыхательных контуров с петлёй или без, с открытым или закрытым концом; для аппаратуры; для оксигенации с дыхательным клапаном с трубкой или без;		
Изделия медицинские для дыхательной терапии: 4. Маска наркозная (вид	"Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С. ", Турция	ФСЗ 2011/09053

Наименование изделия	Производитель, страна производства	Нормативный документ
156640); 5. Мешок дыхательный реанимационный для ИВЛ (вид 283370); 7. Камера увлажнителя (вид 185610). 8. Фильтр дыхательный (вид 324930); 9. Переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - тройник пациента; - переходник прямой; - переходник Т-образный; - угловой; 11. Трубка дыхательная (вид 156030); 12. Влагосборник дыхательный (вид 331220) 14. Трубка кислородная (вид 156030).		
Устройство ручное для искусственной вентиляции легких Resuscitator Bags с принадлежностями: 1. Мешки; 2. Маски; 3. Фильтры; 5. Влагосборники; 6. Переходники; 8. Трубки дыхательные; 9. Увлажнители; 10. Шланги кислородные; 12. Распылители (небулайзеры);	"Флексикэр Медикал Лимитед" Flexicare Medical Limited, Соединенное Королевство	РЗН 2013/1311
Изделия для респираторной терапии в анестезиологии и реанимации. 4. Маски наркозные 6. Воздуховоды	«Смитс Интернэшнл Медикал Лимитед», Великобритания	ФСЗ 2009/05401
Увлажнитель дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, с принадлежностями: 14. Влагосборник одноразовый, варианты исполнения: G-313001; G-313001-0; G-313001-00; G-	«ВАДИ Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань	ФСЗ 2010/08292

Наименование изделия	Производитель, страна производства	Нормативный документ
313001-1; 15. Коннектор (адаптор), варианты исполнения: G-311000; G-311000-1; G-311001; G-311001-1; G-311002; G-311003; G-311003-2; G-311003-3; G-311004; G-311004-2; G-311005; G-311006; G-311008-1; G-311017; G-311019; G-311019-2; G-311024; G-311031; V-1022-02; 9014-D; G-311008; G-311008-2; G-311039; G-311003-2; G-311003-2-1; G-311004-3; G-311031-1; 17. Коннектор (угольник), варианты исполнения: G-311011; G-311012; G-311015; G-311015-0; G-311015-1; G-311015-R; G-311015-R2; G-311022; G-311025; G-311025-1; 18. Коннектор (тройник пациента), варианты исполнения: E-1030-01-2; G-311010; E-1031-04; G-313005; G-313005-00; G-313005-00-1; G-313005-11; G-313005-11-1; G-311010-1; G-311030; G-311032; 26. Фильтр, варианты исполнения: 800-51700-0; 800-51700; 800-61600; 800-51900; 800-51900-0; 800-51900-11; 800-51800; 800-52000; 800-51500; 800-51600; 800-54011; 800-52300; 30. Мешок одноразовый, варианты исполнения: G-118000; G-118001; G-118002;		
Увлажнитель дыхательных смесей MG с принадлежностями Принадлежности: 27. Угловой адаптер (22 mm F - 22 mm M/15 mm F) - не более 5 шт.;	«Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.», Тайвань	ФСЗ 2012/12372
Вода дистиллированная стерильная в полимерных контейнерах по ТУ 9398-003-	ООО «Завод Медсинтез», Россия	ТУ 9398-003-52317999-2010

Наименование изделия	Производитель, страна производства	Нормативный документ
52317999-2010		
Увлажнитель дыхательных смесей MR810 с принадлежностями Принадлежности к увлажнителю дыхательных смесей MR810: 1. Камера увлажнителя MR225, MR225X, MR250, MR250X, MR290, MR290X, MR340, MR370 - 100 шт. 3. Крепление BC510-01, RT028, 900MR030, 900MR083, 900MR086, 900MR087, 900MR088, 900MR167, 900MR170, 900MR301, 900MR302, 900MR303, 900MR304, 900MR081, 900MR082, 900MR305, 900MR306, 900MR307, 900MR308, 900RD301, 900RD302 - 100 шт. 13. Тройник пациента RT029, 900MR125, 900MR126, 900MR126C, 900MR126L, 900MR127, 900MR128, 900MR128L, 900MR136, 900MR138, 900MR145, 900MR145C - 100 шт. 14. Угольник 900MR052, 900MR052C, 900MR053, 900MR053C, 900MR130, 900MR130C, 900MR130L, 900MR131, 900MR131L, 900MR132, 900MR147, 500RD104 - 100 шт. 15. Заглушка 900MR124, 900MR164, 900MR164C - 100 шт. 16. Влагосборник 900MR139, 900MR139C - 100 шт. 17. Адаптер для температурного датчика 900MR132, 900MR143, 900MR144, 900MR146, 900MR146C, 900MR531, 900MR531C, 900MR531L, 900MR532, 900MR532C, 900MR532L, 900MR534 - 100	"Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд", (Fisher & Paykel Healthcare Ltd.) Новая Зеландия.	ФСЗ 2007/00742

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
шт. 18. Адаптер BC420-10, BC450-01, RT010, RT030, 900MR148, 900MR156, 900MR157, 900MR158, 900MR159, 900MR177, 900MR178, 900MR405, 900MR406, 900MR530, 900MR530L, 900MR533, 900MR533C, 900MR533L, 900MR534C, 900MR534L, 900MR535 - 100 шт. 19. Воздушный адаптер RT001, RT008 - 100 шт. 20. Коллектор давления BC110-05 - 100 шт. 21. Фильтр RT019, RT020 - 100 шт. 22. Кислородная маска HC407NIV, HC431NIV, HC452NIV, RD806-10, RD807-10, 900RT004, 900RT005, 900RT006 - 100 шт. 23. Кислородная трубка BC400-10, BC402-5, 500RD103, 500RD107, 500RD113, 900RD008, 900RD009, 900RT003 - 100 шт. 25. Трубка измерения давления в контуре 900MR075, 900MR076, 900MR077 - 100 шт. 26. Система для измерения давления в контуре 900MR753 - 100 шт. 27. Система для кислородной терапии BW150-10, BC151-10, BC160-SK, BC161-10, BC162-10, BC163-10, BC164-10, BC171-10, BC461-SK, BC471-SK, RD900, RT307, RT308, RT407, RT408, RT333, 500RD002, 500RD050, 500RD052, 500RD106, 900RD010, 900RT002, 900RT009, 900RT010 - 100 шт. 28. Коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05,			

Наименование изделия	Производитель, страна производства	Нормативный документ
BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094, RT095 - 100 шт. 29. Колпак BC300-05, BC303-05, BC306-05, BC309-05, BC360-SK - 100 шт. 30. Ремни на голову BC325-10, BC328-10, BC331-10 - 100 шт. 31. Ремни на подбородок BC351-10, BC353-10, BC355-10, BC357-10 - 100 шт. 33. Термометр 900MR033 - 100 шт.		
Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких в наборах и отдельных упаковках V. Набор адаптеров RT010 для установки распылителя (20 шт./уп). VI. Набор масок RD800-EN (5 шт.). VII. Отдельные упаковки: 1. Камеры увлажнителя взрослые: MR210, 40 шт./уп., MR210X, 10 шт./уп., MR250, 40 шт./уп., MR250X, 10 шт./уп. 2. Камеры увлажнителя детские: MR225, 50 шт./уп., MR225X, 10 шт./уп. 3. Камеры увлажнителя универсальные: MR290, 40 шт./уп., MR290X, 10 шт./уп., MR290U, 40 шт./уп., MR290UX, 10 шт./уп., MR290V, 40 шт./уп., MR290VX, 10 шт./уп., MR290HFV, 40 шт./уп. 4. Адаптер для катетеров 3222-504G, 50 шт./уп.	"Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд", Новая Зеландия,	ФСЗ 2011/09111

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
5. Адаптеры для камеры увлажнителя: 900MR161, 1 шт./уп., 900MR161L, 50 шт./уп., 900MR162, 1 шт./уп., 900MR162L, 50 шт./уп. 6. Адаптер соединителя 900MR835, 50 шт./уп. 7. Адаптер 900MR961 для камеры увлажнителя, два газа, 20 шт./уп. 8. Адаптер RT021 гибкого соединения с тройником, 20 шт./уп. 9. Адаптер RT022 гибкого соединения, 20 шт./уп. 10. Адаптер RT030 для тройника распылителя, 20 шт./уп. 11. Адаптеры для подсоса воздуха: RT001, 20 шт./уп., RT008, 20 шт./уп. 12. Тройник пациента неонатальный RT029, 20 шт./уп. 13. Трубки кислородные: 900RT003, 50 шт./уп., 900RD008, 10 шт./уп., 900RD009, 10 шт./уп. 14. Держатель шлангов RT028, 20 шт./уп. 15. Отражатели тепла: 900MR208, 20 шт./уп., NC040-10, 10 шт./уп., NC041-10, 10 шт./уп. 16. Обтурирующие обертки: NC100-10, 10 шт./уп. NC100-25, 25 шт./уп., NC100-SK, 1 шт./уп. 17. Тестовые легкие: RD020-01, 1 шт./уп. 500RD106, 1 шт./уп. 18. Фильтр вдоха и выдоха RT019, 20 шт./уп. 19. Фильтр выдоха RT020, 20 шт./уп. 20. Канюли носовые для недоношенных детей: RT091, 20 шт./уп. BC2425-20, 20 шт./уп. 21. Канюли носовые для			

Наименование изделия	Производитель, страна	Нормативный документ
новорожденных детей: RT092, 20 шт./уп. BC2435-20, 20 шт./уп. 22. Канюли носовые для младенцев: RT093, 20 шт./уп. BC2745-20, 20 шт./уп. 23. Канюли носовые для детей: RT094, 20 шт./уп. BC3780-20, 20 шт./уп. 24. Канюли носовые для взрослых RT095, 20 шт./уп. 25. Канюли носовые для крупных младенцев BC2755-20, 20 шт./уп. 26. Маски кислородные неонатальные: RD803-10, 10 шт./уп. RD804-10, 10 шт./уп., RD805-10, 10 шт./уп., RD806-10, 10 шт./уп., RD807-10, 10 шт./уп. 27. Маски кислородные для взрослых: 900RT004, 50 шт./уп. 900RT005, 50 шт./уп. 28. Маски кислородные для детей 900RT006, 50 шт./уп. 29. Маски носовые: RT033, 20 шт./уп. RT034, 20 шт./уп., RT042, 10 шт./уп., RT050, 20 шт./уп., RT051, 20 шт./уп., RT052, 20 шт./уп. 30. Маски лицевые: RT040S, 10 шт./уп. RT040M, 10 шт./уп., RT040L, 10 шт./уп., RT041L, 10 шт./уп., RT041M, 10 шт./уп., RT041S, 10 шт./уп. 31. Маска трахеостомические RT035, 20 шт./уп. 32. Удлинитель трубки (22 мм.) RT024, 20 шт./уп.		
Увлажнитель дыхательных смесей MR850: 2. Кабель гибкого нагревателя, варианты исполнения: 900MR860, 900MR861, 900MR863, 900MR868, 900MR869 – не более 20 шт.	"Фишер & Пэйкер Хелткер Лимитед", Новая Зеландия,	P3H 2014/1416
Изделия медицинские для дыхательной терапии 2. Переходники для дыхательных	«ИнтАир Франция	Медикал» ФСЗ 2009/03742

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
контуров. 3.Трубки дыхательные. 4.Фильтры дыхательные. 5.Трубки кислородные. 6.Небулайзеры дыхательные. 7.Влагосборники дыхательные. 8.Увлажнители дыхательные. 9.Мешки резервные дыхательные.			
Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения I. Варианты исполнения: 1. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22М/15F- 15М/22F, 22М/15F-22F или 8М/15М-15F, без тепловлагообмена. 2. Фильтр дыхательный бактериально- вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22М/15F- 15М/22F, 22М/15F-22F или 8М/15М-15F, без тепловлагообмена, с портом luer-lock. 3. Фильтр дыхательный бактериально- вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22М/15F- 15М/22F, 22М/15F-22F или 8М/15М-15F, с тепловлагообменом. 4. Фильтр дыхательный бактериально- вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22М/15F- 15М/22F, 22М/15F-22F или 8М/15М-15F, с тепловлагообменом, с портом luer-lock. 5. Фильтр дыхательный бактериально- вирусный однократного	ООО Республика Беларусь	"Ассомедика",	РЗН 2018/7282

Наименование изделия	Производитель, страна производства	Нормативный документ
применения механический с размерами выходов 22M/15F-15M/22F, 22M/15F-22F или 8M/15M-15F, с тепловлагообменом. 6. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения механический с размерами выходов 22M/15F-15M/22, 22M/15F-22F или 8M/15M-15F, с тепловлагообменом, с портом luer-lock.		
Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии варианты исполнения: I. Фильтры электростатические взрослые в следующих вариантах исполнения: 1. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4222/701. 2. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4222/700. 3. Фильтр электростатический взрослый без отверстия для отбора проб газа модель 4222/703. 4. Фильтр электростатический взрослый без отверстия для отбора проб газа модель 4222/702. 5. Фильтр электростатический взрослый дыхательный модель FR004. 6. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4333/01. 7. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4333/711. 8. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4333/761. 9. Фильтр	"Джи Ви Эс С.П.А.", Италия	РЗН 2019/8405

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4333/750. 10. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4333/751. 11. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 9064/711. 12. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для сбора проб газа модель 9064/751. 13. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 9065/710. 14. Фильтр электростатический взрослый, с отверстием для сбора проб газа модель 9065/750. 15. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4333/710. 16. Фильтр электростатический взрослый модель 4333/712. 17. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4333/721. 18. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4222/01. 19. Фильтр электростатический взрослый модель 4222/02. 20. Фильтр электростатический взрослый модель 4222/03. 21. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 9070/01. 22. Фильтр электростатический взрослый модель 9071/01. 23. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 8866/100. 24. Фильтр электростатический взрослый модель 5200/01. 25. Фильтр электростатический			

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
взрослый с отверстием для отбора проб газа модель FR003. 26. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 9040/01. 27. Фильтр электростатический взрослый модель 9041/01. II. Фильтры механические взрослые в следующих вариантах исполнения: 1. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4244/701. 2. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4244/700. 3. Фильтр механический взрослый модель 4244/702. 4. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4244/711. 5. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4244/761. 6. Фильтр механический взрослый модель 4333/752. 7. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 9040/50. 8. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4220/01. 9. Фильтр механический взрослый модель 4220/04. 10. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4244/01. 11. Фильтр механический взрослый модель 4244/02. 12. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4244/04. 13. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб			

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
газа модель 8222/01. III. Фильтры электростатические детские в следующих вариантах исполнения: 1. Фильтр электростатический детский с отверстием для отбора проб газа модель 9066/701. 2. Фильтр электростатический детский, с отверстием для сбора проб газа модель 9066/751. 3. Фильтр электростатический детский, с отверстием для сбора проб газа модель 9066/771. 4. Фильтр электростатический детский с отверстием для отбора проб газа модель 9067/700. 5. Фильтр электростатический детский с отверстием для отбора проб газа модель 9066/711. 6. Фильтр электростатический детский с отверстием для отбора проб газа модель 9067/710. 7. Фильтр электростатический детский с отверстием для отбора проб газа модель 9067/750. 8. Фильтр электростатический детский с отверстием для отбора проб газа модель 9066/01. IV. Фильтры механические детские в следующих вариантах исполнения: 1. Фильтр механический детский с отверстием для отбора проб газа модель 9898/01. 2. Фильтр механический детский с отверстием для отбора проб газа модель 9800/01. V. Фильтры механические спирометрические взрослые в следующих вариантах исполнения: 1. Фильтр механический спирометрический взрослый модель 2800/R1. 2. Фильтр механический			

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
спирометрический взрослый модель 2800/R10. 3. Фильтр механический спирометрический взрослый модель 2800/R2. 4. Фильтр механический спирометрический взрослый модель 2800/R3. VI. Фильтры электростатические для небулайзерного аппарата в следующих вариантах исполнения: 1. Фильтр электростатический для небулайзерного аппарата модель 1420/01. 2. Фильтр электростатический для небулайзерного аппарата модель 1420/03. 3. Фильтр электростатический для небулайзерного аппарата модель 4444/01. 4. Фильтр электростатический для небулайзерного аппарата модель 4444/64. 5. Фильтр электростатический для небулайзерного аппарата модель 4444/66.			
Фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии в следующих вариантах исполнения: I. Фильтры электростатические взрослые: 1. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4222/701. 2. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4222/700. 3. Фильтр электростатический взрослый без отверстия для отбора проб газа 4222/703. 4. Фильтр электростатический взрослый без отверстия для отбора проб газа 4222/705. 5. Фильтр электростатический взрослый без отверстия для	"Джи Ви Эс С.П.А.", Италия		РЗН 2019/8705

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
отбора проб газа 4222/702. 6. Фильтр электростатический взрослый дыхательный FR004. 7. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4333/01. 8. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4333/711. 9. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4333/761. 10. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4333/750. 11. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4333/751. 12. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 9064/711. 13. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для сбора проб газа 9064/751. 14. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 9065/710. 15. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для сбора проб газа 9065/750. 16. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4333/710. 17. Фильтр электростатический взрослый 4333/712. 18. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4333/721. 19. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 8866/50. 20. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4222/01. 21. Фильтр электростатический взрослый 4222/02. 22. Фильтр электростатический взрослый 4222/03. 23. Фильтр электростатический взрослый			

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
с отверстием для отбора проб газа 8866/01. 24. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 9070/01. 25. Фильтр электростатический взрослый 9071/01. 26. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 8866/100. 27. Фильтр электростатический взрослый 5200/01. 28. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа FR003. 29. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 9040/01. 30. Фильтр электростатический взрослый 9041/01. II. Фильтры механические взрослые: 1. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4244/701. 2. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4244/700. 3. Фильтр механический взрослый 4244/702. 4. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4244/711. 5. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4244/761. 6. Фильтр механический взрослый 4333/752. 7. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа 9040/50. 8. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4220/01. 9. Фильтр механический взрослый 4220/04. 10. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4244/01. 11. Фильтр механический взрослый			

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
4244/02. 12. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4244/04. 13. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа 8222/01. III. Фильтры электростатические детские: 1. Фильтр электростатический детский с отверстием для отбора проб газа 9066/701. 2. Фильтр электростатический детский с отверстием для сбора проб газа 9066/751. 3. Фильтр электростатический детский с отверстием для сбора проб газа 9066/771. 4. Фильтр электростатический детский с отверстием для отбора проб газа 9067/700. 5. Фильтр электростатический детский с отверстием для отбора проб газа 9066/711. 6. Фильтр электростатический детский с отверстием для отбора проб газа 9067/710. 7. Фильтр электростатический детский с отверстием для отбора проб газа 9067/750. 8. Фильтр электростатический детский с отверстием для отбора проб газа 9064/100. 9. Фильтр электростатический детский с отверстием для отбора проб газа 9066/01. IV. Фильтры механические детские: 1. Фильтр механический детский с отверстием для отбора проб газа 9898/01. 2. Фильтр механический детский с отверстием для отбора проб газа 9800/01. V. Фильтры механические для аппарата вентиляции лёгких: 1. Фильтр механический для аппарата вентиляции лёгких 3000/01. 2. Фильтр механический для аппарата вентиляции лёгких			

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
3000/03. 3. Фильтр механический для аппарата вентиляции лёгких 3000/04. 4. Фильтр механический для аппарата вентиляции лёгких 3000/740. 5. Фильтр механический для аппарата вентиляции лёгких 3200/06. 6. Фильтр механический для концентратора кислорода 3200/03. 7. Фильтр механический для концентратора кислорода 3200/06. 8. Фильтр механический для концентратора кислорода 3200/08. 9. Фильтр механический для аппарата вентиляции лёгких 3100/01. 10. Фильтр механический для концентратора кислорода 4100/20. 11. Фильтр механический для концентратора кислорода 4100/30. 12. Фильтр механический для концентратора кислорода 4100/92. 13. Фильтр механический для концентратора кислорода 4100/725. 14. Фильтр механический для концентратора кислорода 4100/735. 15. Фильтр механический для аппарата вентиляции лёгких 4020/01. 16. Фильтр механический для аппарата вентиляции лёгких 4020/02. 17. Фильтр механический для аппарата вентиляции лёгких 4020/03. 18. Фильтр механический для аппарата вентиляции лёгких 4020/06. 19. Фильтр механический для аппарата вентиляции лёгких с угольным наполнителем 1898/01. 20. Фильтр механический для аппарата вентиляции лёгких с			

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
угольным наполнителем 1898/03. VI. Фильтры электростатические спирометрические взрослые: 1. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/01. 2. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/02. 3. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/03. 4. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/10. 5. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/11. 6. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/15. 7. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/17. 8. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/21. 9. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/22. 10. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/23. 11. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/24. 12. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/25. 13. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/26. 14. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/30. Принадлежности: 1. Адаптер разъема 2802/01. 2. Адаптер разъема 2802/02. 3. Адаптер			

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
разъема 2802/03. 4. Адаптер			
разъема 2802/04. 5. Адаптер			
разъема 2802/05. 6. Адаптер			
разъема 2802/06. 7. Адаптер			
разъема 2802/07. 8. Адаптер			
разъема 2802/08. 9. Адаптер			
разъема 2802/09. 10. Адаптер			
разъема 2802/10. 11. Адаптер			
разъема 2802/11. 12. Адаптер			
разъема 2802/12. 13. Адаптер			
разъема 2802/13. 14. Адаптер			
разъема 2802/14. 15. Адаптер			
разъема 2802/15. 16. Адаптер			
разъема 2802/16. 17. Адаптер			
разъема 2802/17. 18. Адаптер			
разъема 2802/18. 19. Адаптер			
разъема 2802/19. 20. Адаптер			
разъема 2802/20. 21. Адаптер			
разъема 2802/21. 22. Адаптер			
разъема 2802/22. 23. Адаптер			
разъема 2802/23. 24. Адаптер			
разъема 2802/24. 25. Адаптер			
разъема 2802/25. 26. Адаптер			
разъема 2802/26. 27. Адаптер			
разъема 2802/27. 28. Адаптер			
разъема 2802/28. 29. Адаптер			
разъема 2802/29. 30. Адаптер			
разъема 2802/30. VII. Фильтры механические			
спирометрические взрослые: 1.			
Фильтр механический			
спирометрический взрослый			
модель 2800/R1. 2. Фильтр			
механический			
спирометрический взрослый			
модель 2800/R10. 3. Фильтр			
механический			
спирометрический взрослый			
модель 2800/R2. 4. Фильтр			
механический			
спирометрический взрослый			
модель 2800/R3. VIII. Фильтры			
электростатические			
неонатальные: 1. Фильтр			
электростатический			
неонатальный с отверстием			
для отбора проб газа 9080/700.			
2. Фильтр электростатический			
неонатальный с отверстием			

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
для отбора проб газа 9080/01. 3. Фильтр электростатический неонатальный с отверстием для отбора проб газа 9080/710. 4. Фильтр электростатический неонатальный с отверстием для сбора проб газа 9080/100. 5. Фильтр электростатический неонатальный с отверстием для сбора проб газа 9080/750. IX. Фильтры электростатические для небулайзерного аппарата: 1. Фильтр электростатический для небулайзерного аппарата 1420/01. 2. Фильтр электростатический для небулайзерного аппарата 1420/03. 3. Фильтр электростатический для небулайзерного аппарата 4444/01. 4. Фильтр электростатический для небулайзерного аппарата 4444/64. 5. Фильтр электростатический для небулайзерного аппарата 4444/66. X. Фильтры тепловлагообменные трахеостомические неонатальные: 1. Фильтр тепловлагообменный трахеостомический неонатальный 9085/01. 2. Фильтр тепловлагообменный трахеостомический неонатальный 9085/771. 3. Фильтр тепловлагообменный трахеостомический неонатальный 9085/751. XI. Фильтры тепловлагообменные трахеостомические: 1. Фильтр тепловлагообменный трахеостомический взрослый с кислородным коннектором и всасывающим портом 9500/01. 2. Фильтр тепловлагообменный трахеостомический взрослый с			

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
бумажным наполнением 9500/710. 3. Фильтр тепловлагообменный трахеостомический взрослый 9500/750. 4. Фильтр тепловлагообменный трахеостомический взрослый 9500/02. 5. Фильтр тепловлагообменный трахеостомический взрослый с клапаном 9500/03. 6. Фильтр тепловлагообменный трахеостомический взрослый с отверстием для сбора проб газа 9066/50. 7. Фильтр тепловлагообменный трахеостомический 9085/09.			
Канюли назальные кислородные MEDEREN в следующих вариантах исполнения: 1. Канюля назальная кислородная со стандартным наконечником, S; REF - 0112-M101-01: - канюля назальная кислородная со стандартным наконечником, в зависимости от выбранного размера - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - индивидуальная упаковка. 2. Канюля назальная кислородная со стандартным наконечником, M; REF - 0112- M101-02: - канюля назальная кислородная со стандартным наконечником, в зависимости от выбранного размера - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - индивидуальная упаковка. 3. Канюля назальная кислородная со стандартным наконечником, L; REF - 0112- M101-03: - канюля назальная кислородная со стандартным наконечником, в зависимости от выбранного размера - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - индивидуальная упаковка. 4. Канюля назальная	"Медерен Неотех Израиль	Лтд.",	РЗН 2018/7623

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
кислородная с мягким наконечником, XS; REF - 0112-M102-01: - канюля назальная кислородная с мягким наконечником, в зависимости от выбранного размера - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - индивидуальная упаковка. 5. Канюля назальная кислородная с мягким наконечником, S; REF - 0112-M102-02: - канюля назальная кислородная с мягким наконечником, в зависимости от выбранного размера - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - индивидуальная упаковка. 6. Канюля назальная кислородная с мягким наконечником, M; REF - 0112-M102-03: - канюля назальная кислородная с мягким наконечником, в зависимости от выбранного размера - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - индивидуальная упаковка. 7. Канюля назальная кислородная с мягким наконечником, L; REF - 0112-M102-04: - канюля назальная кислородная с мягким наконечником, в зависимости от выбранного размера - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - индивидуальная упаковка.			
Фильтр дыхательный MEDEREN варианты исполнения: 1. Фильтр дыхательный, теплооблагодобменный, с портом Луер-Лок, Ø 15М, 22М/15Ф. 2. Фильтр дыхательный, теплооблагодобменный, с портом Луер-Лок, Small, Ø 22Ф/15М, 22М/15Ф. 3. Фильтр дыхательный, теплооблагодобменный, с портом Луер-Лок, Ø 22Ф/15М,	"Медерен Неотех Лтд.", Израиль		РЗН 2020/9671

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
22М/15F. 4. Фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, НЕРА. 5. Фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, угловой, Ø 22F/15М, 22М/15F. 6. Фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F. 7. Фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F. 8. Фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, НЕРА, Ø 22F/15М, 22М/15F. 9. Фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, Ø 15F, с кислородным портом Ø 6 мм. 10. Фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 6 мм. 11. Фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 5 мм. 12. Фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 3 мм. 13. Фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 2 мм. 14. Фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F. 15. Фильтр			

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
дыхательный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22M/15F, 22F. 16. Фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 15M, 22M/15F. 17. Фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Small, Ø 22F/15M, 22M/15F. 18. Фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F. 19. Фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, угловой Ø 22F/15M, 22M/15F. 20. Фильтр дыхательный линии давления 0,2 м. 21. Фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Small, Ø 22F/15M, 22M/15F. 22. Фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F.			
Маски анестезиологические MEDEREN в вариантах исполнения: 1. Маска анестезиологическая с манжетой, размер 0, REF-0115-M 130-00, в составе: - маска анестезиологическая, размер 0 - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - индивидуальная упаковка. 2. Маска анестезиологическая с манжетой, размер 1, REF-0115-M130-01, в составе: - маска анестезиологическая, размер 1	"Медерен Неотех Израиль	Лтд.",	РЗН 2019/8818

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
- 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - индивидуальная упаковка. 3. Маска анестезиологическая с манжетой, размер 2, REF-0115-M130-02, в составе: - маска анестезиологическая, размер 2 - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - индивидуальная упаковка. 4. Маска анестезиологическая с манжетой, размер S, REF-0115-M130-03, в составе: - маска анестезиологическая, размер S - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - индивидуальная упаковка. 5. Маска анестезиологическая с манжетой, размер M, REF-0115-M130-04, в составе: - маска анестезиологическая, размер M - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - индивидуальная упаковка. 6. Маска анестезиологическая с манжетой, размер L, REF-0115-M130-05, в составе: - маска анестезиологическая, размер L - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - индивидуальная упаковка. 7. Маска анестезиологическая с манжетой, размер XL, REF-0115-M130-06, в составе: - маска анестезиологическая, размер XL - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - индивидуальная упаковка. 8. Маска анестезиологическая термоэластопласт, размер 0, REF-0115-M140-00, в составе: - маска анестезиологическая термоэластопласт, размер 0 - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - индивидуальная упаковка. 9. Маска анестезиологическая термоэластопласт, размер 1,			

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
REF-0115-M140-01, в составе: - маска анестезиологическая термоэластопласт, размер 1 - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - индивидуальная упаковка. 10. Маска анестезиологическая термоэластопласт, размер 2, REF-0115-M 140-02, в составе: - маска анестезиологическая термоэластопласт, размер 2 - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - индивидуальная упаковка. 11. Маска анестезиологическая термоэластопласт, размер S, REF-0115-M140-03, в составе: - маска анестезиологическая термоэластопласт, размер S - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - индивидуальная упаковка. 12. Маска анестезиологическая термоэластопласт, размер M, REF-0115-M 140-04, в составе: - маска анестезиологическая термоэластопласт, размер M - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - индивидуальная упаковка. 13. Маска анестезиологическая термоэластопласт, размер L, REF-0115-M 140-05, в составе: - маска анестезиологическая термоэластопласт, размер L - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.; - индивидуальная упаковка.			
Фильтр дыхательный бактериально-вирусный MEDEREN в вариантах исполнения: 1. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный, прямой коннектор. 2. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный, угловой коннектор. 3. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с	"Медерен Неотех Израиль	Лтд.",	РЗН 2019/9010

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор. 4. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор. 5. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, прямой коннектор. 6. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, угловой коннектор. 7. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный НЕРА. 8. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником НЕРА. 9. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный педиатрический с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор. 10. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный педиатрический с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор. 11. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный неонатальный с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор. 12. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор. 13. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, для трахеостомы. 14. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана и			

Наименование изделия	Производитель, страна производства	Нормативный документ
кислородной трубкой, для трахеостомы. 15. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, для трахеостомы. 16. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги и кислородной трубкой, для трахеостомы. 17. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, Т-образный, для трахеостомы. 18. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги и кислородной трубкой, Т-образный, для трахеостомы.		
Соединители для дыхательного контура MEDEREN варианты исполнения: 1. Соединители для дыхательного контура конфигурируемые, в вариантах исполнения: 1.1. Соединитель для дыхательного контура конфигурируемый, прямой коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 22F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MR930-01. 1.2. Соединитель для дыхательного контура конфигурируемый, двойной вертлужный коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 22F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MR930-02. 1.3. Соединитель для дыхательного контура конфигурируемый, двойной вертлужный коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор	"Медерен Неотех Лтд.", Израиль	РЗН 2020/9918

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
22F/15M, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB930-01. 1.4. Соединитель для дыхательного контура конфигурируемый, двойной вертлужный коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 22F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB930-02. 1.5. Соединитель для дыхательного контура конфигурируемый, двойной вертлужный коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 15M, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB930-03. 1.6. Соединитель для дыхательного контура конфигурируемый, угловой коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 22M/15F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB930-04. 1.7. Соединитель для дыхательного контура конфигурируемый, угловой коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 22F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB930-05. 1.8. Соединитель для дыхательного контура конфигурируемый, угловой коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 15M, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB930-06. 1.9. Соединитель для дыхательного контура конфигурируемый, прямой коннектор 15F, аппаратный коннектор 22M/15F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB930-07. 1.10. Соединитель для дыхательного контура конфигурируемый, прямой коннектор 15F, аппаратный коннектор 22F,			

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB930-08. 1.11. Соединитель для дыхательного контура конфигурируемый, прямой коннектор 15F, аппаратный коннектор 15M, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB930-09. 2. Соединители для дыхательного контура конфигурируемые, порт для бронхоскопии и санации, в вариантах исполнения: 2.1. Соединитель для дыхательного контура конфигурируемый, порт для бронхоскопии и санации, двойной вертлужный коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 15M, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MR931-01. 2.2. Соединитель для дыхательного контура конфигурируемый, порт для бронхоскопии и санации, двойной вертлужный коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 22F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MR931-02. 2.3. Соединитель для дыхательного контура конфигурируемый, порт для бронхоскопии и санации, фильтр с функцией тепло-влажностного обмена с портом для капнографии, двойной вертлужный коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 22F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MR931-03. 2.4. Соединитель для дыхательного контура конфигурируемый, порт для бронхоскопии и санации, двойной вертлужный коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор			

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
22M/15F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB931-01. 2.5. Соединитель для дыхательного контура конфигурируемый, порт для бронхоскопии и санации, двойной вертлужный коннектор ,22M/15F, аппаратный коннектор 22F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB931-02. 2.6. Соединитель для дыхательного контура конфигурируемый, порт для бронхоскопии и санации, двойной вертлужный коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 15M, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB931-03. 3. Соединители для дыхательного контура конфигурируемые, с портом для капнографии, в вариантах исполнения: 3.1. Соединитель для дыхательного контура конфигурируемый, порт для капнографии, угловой коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 15M, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MR932-01. 3.2. Соединитель для дыхательного контура конфигурируемый, порт для капнографии, угловой коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 22F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MR932-02. 3.3. Соединитель для дыхательного контура конфигурируемый, фильтр бактериально-вирусный с функцией тепло-влагообмена с портом для капнографии, прямой коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 22F, длина без учета коннекторов			

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
15 см, REF - 0125-MR932-03. 3.4. Соединитель для дыхательного контура конфигурируемый, порт для капнографии, фильтр бактериально-вирусный с функцией тепло-влагообмена с портом для капнографии, угловой коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 22F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MR932-04. 3.5. Соединитель для дыхательного контура конфигурируемый, порт для капнографии, угловой коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 22M/15F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB932-01. 3.6. Соединитель для дыхательного контура конфигурируемый, порт для капнографии, угловой коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 22F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB932-02. 3.7. Соединитель для дыхательного контура конфигурируемый, порт для капнографии, угловой коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 15M, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB932-03. 4. Соединители для дыхательного контура гладкоствольные, в вариантах исполнения: 4.1. Соединитель для дыхательного контура гладкоствольный, прямой коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 22F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MR940-01. 4.2. Соединитель для дыхательного контура гладкоствольный, двойной			

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
вертлужный коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 22F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MR940-02. 4.3. Соединитель для дыхательного контура гладкоствольный, двойной вертлужный коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 22M/15F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB940-01. 4.4. Соединитель для дыхательного контура гладкоствольный, двойной вертлужный коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 22F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB940-02. 4.5. Соединитель для дыхательного контура гладкоствольный, двойной вертлужный коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 15M, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB940-03. 4.6. Соединитель для дыхательного контура гладкоствольный, угловой коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 22M/15F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB940-04. 4.7. Соединитель для дыхательного контура гладкоствольный, угловой коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 22F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB940-05. 4.8. Соединитель для дыхательного контура гладкоствольный, угловой коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 15M, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB940-06. 4.9. Соединитель для			

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
дыхательного контура гладкоствольный, прямой коннектор 15F, аппаратный коннектор 22M/15F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB940-07. 4.10. Соединитель для дыхательного контура гладкоствольный, прямой коннектор 15F, аппаратный коннектор 22F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB940-08. 4.11. Соединитель для дыхательного контура гладкоствольный, прямой коннектор 15F, аппаратный коннектор 15M, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB940-09. 5. Соединители для дыхательного контура гладкоствольные, порт для бронхоскопии и санации, в вариантах исполнения: 5.1. Соединитель для дыхательного контура гладкоствольный, порт для бронхоскопии и санации, двойной вертлужный коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 22F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MR940-01. 5.2. Соединитель для дыхательного контура гладкоствольный, порт для бронхоскопии и санации, двойной вертлужный коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 22F, длина без учета коннекторов 5 см, REF - 0125-MR941-02. 5.3. Соединитель для дыхательного контура гладкоствольный, порт для бронхоскопии и санации, двойной вертлужный коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 22F, длина без учета коннекторов 20 см, REF - 0125-MR941-03.			

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
5.4. Соединитель для дыхательного контура гладкоствольный, порт для бронхоскопии и санации, двойной вертлужный 22M/15F, аппаратный коннектор 15M, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MR941-04. 5.5. Соединитель для дыхательного контура гладкоствольный, порт для бронхоскопии и санации, двойной вертлужный 22M/15F, аппаратный коннектор 22M/15F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB941-01. 5.6. Соединитель дыхательного контура гладкоствольный, порт для бронхоскопии и санации, двойной вертлужный f аппаратный коннектор 22M/15F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB941-02. 5.7. Соединитель для дыхательного контура гладкоствольный, порт для бронхоскопии и санации, двойной вертлужный 22M/15F, аппаратный коннектор 15M, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB941-03. 6. Соединители для дыхательного контура гладкоствольные, с портом для капнографии, в вариантах исполнения: 6.1. Соединитель для дыхательного контура гладкоствольный, порт для капнографии, угловой коннектор 22M/15F, аппаратный коннектор 15M, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MR942-01. 6.2. Соединитель для дыхательного контура гладкоствольный, порт для капнографии, угловой			

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
коннектор 22М/15F, аппаратный коннектор 22F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MR942-02. 6.3. Соединитель для дыхательного контура гладкоствольный, порт для капнографии, угловой коннектор 22М/15F, аппаратный коннектор 22М/15F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB942-01. 6.4. Соединитель для дыхательного контура гладкоствольный, порт для капнографии, угловой коннектор 22М/15F, аппаратный коннектор 22F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB942-02. 6.5. Соединитель для дыхательного контура гладкоствольный, порт для капнографии, угловой коннектор 22М/15F, аппаратный коннектор 15М, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB942-03. 7. Соединители для дыхательного контура гофрированные, в вариантах исполнения: 7.1. Соединитель для дыхательного контура гофрированный, двойной вертлужный коннектор 22М/15F, аппаратный коннектор 22М/15F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB920-01. 7.2. Соединитель для дыхательного контура гофрированный, двойной вертлужный коннектор 22М/15F, аппаратный коннектор 22F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB920-02. 7.3. Соединитель для дыхательного контура гофрированный, двойной			

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
вертлужный коннектор 22М/15F, аппаратный коннектор 15М, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB920-03. 7.4. Соединитель для дыхательного контура гофрированный, угловой коннектор 22М/15F, аппаратный коннектор 22М/15F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB920-04. 7.5. Соединитель для дыхательного контура гофрированный, угловой коннектор 22М/15F, аппаратный коннектор 22F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB920-05. 7.6. Соединитель для дыхательного контура гофрированный, угловой коннектор 22М/15F, аппаратный коннектор 15М, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB920-06. 8. Соединители для дыхательного контура гофрированные, порт для бронхоскопии и санации, в вариантах исполнения: 8.1. Соединитель для дыхательного контура гофрированный, порт для бронхоскопии и санации, двойной вертлужный коннектор 22М/15F, аппаратный коннектор 22М/15F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB921-01. 8.2. Соединитель для дыхательного контура гофрированный, порт для бронхоскопии и санации, двойной вертлужный коннектор 22М/15F, аппаратный коннектор 22F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB921-02. 8.3. Соединитель для дыхательного контура			

Наименование изделия	Производитель, производства	страна	Нормативный документ
гофрированный, порт для бронхоскопии и санации, двойной вертлужный коннектор 22М/15F, аппаратный коннектор 15М, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB921-03. 9. Соединители для дыхательного контура гофрированные, с портом для капнографии, в вариантах исполнения: 9.1. Соединитель для дыхательного контура гофрированный, порт для капнографии, угловой коннектор 22М/15F, аппаратный коннектор 22М/15F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB922-01. 9.2. Соединитель для дыхательного контура гофрированный, порт для капнографии, угловой коннектор 22М/15F, аппаратный коннектор 22F, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB922-02. 9.3. Соединитель для дыхательного контура гофрированный, порт для капнографии, угловой коннектор 22М/15F, аппаратный коннектор 15М, длина без учета коннекторов 15 см, REF - 0125-MB922-03.			
Мешок дыхательный однократного применения в следующих исполнениях: 1. Мешок дыхательный однократного применения, объём 500 мл. 2. Мешок дыхательный однократного применения, объём 1000 мл. 3. Мешок дыхательный однократного применения, объём 2000 мл. 4. Мешок дыхательный однократного применения, объём 3000 мл.	ООО "Ассомедика", Республика Беларусь		РЗН 2018/6773
Маски дыхательные	ООО "Ассомедика",		РЗН 2018/7995

Наименование изделия	Производитель, страна производства	Нормативный документ
однократного применения Маска дыхательная однократного применения в индивидуальной упаковке с этикеткой, в следующих размерах: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. Принадлежности: Маскодержатель.	Республика Беларусь	
Изделия медицинские полимерные для анестезиологии и реаниматологии 1. Маски Aerobag. 2. Мешки Aerobag. 3. Клапаны дыхательные Aerobag. 5. Трубки кислородные Aeropart. 6. Маски с трубками Aeropart. 7. Коннекторы и адаптеры Aeropart. 8. Увлажнители Aeropart. 10. Коннекторы и адаптеры Aerotube. 12. Трубки дыхательные Aerotube. 13. Лимб-соединители Aerotube. 16. Распылители и комплекты с распылителями Aerotube. 17. Влагосборники Aerotube. 22. Фильтры Aerovent. 23. Тепловлагообменники Aerovent.	"ГЮЭм Гезелльшафт фюр Хаумкейр унд Медикентехник мбХ", Германия	ФСЗ 2011/10317
Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020	АО "НПП "ИНТЕРОКО"	ФСР 2011/11397

Приложение Г: Перечень минимальных технических требований к покупным изделиям

№ п/п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрационное удостоверение	Технические требования
1	Адаптер кислорода	15. Соединительные устройства	ФСЗ 2009/04992	Присоединительный размер коннектора: 22F
		20. Коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные,	ФСЗ 2012/11566	Присоединительный размер коннектора: 22F/15M- 6 мм

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		адаптеры, с дополнительными портами и без них)		
2	Влагосборник (вид 260670)	9. Влагосборник	ФСЗ 2012/13286	Присоединитель ный размер коннектора:22М- 22М; Объем: 70 мл
		4. Влагосборники: - влагосборник однократного использования (полисульфон, акрилонитрилбутадиенст ирол)	ФСЗ 2012/12928	Присоединитель ный размер коннектора:22М- 22М; Объем: 70 мл
		21. Влагосборники для дыхательных контуров для взрослых и детей	ФСЗ 2012/11566	Присоединитель ный размер коннектора:22М- 22М; Объем: 70 мл
		3. Влагосборники	ФСЗ 2009/04992	Присоединитель ный размер коннектора:22М- 22М; Объем: 70 мл
		19. Влагосборники для дыхательных контуров для взрослых, для детей и для новорождённых.	ФСЗ 2009/03551	Присоединитель ный размер коннектора:22М- 22М; Объем: 70 мл. ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора:15М - 15М; Объем: 60 мл ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора:10М - 10М; Объем: 50 мл
		5. Влагосборники	РЗН 2013/1311	Присоединитель ный размер коннектора:22М - 22М;

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
				Объем: 55 мл
		14. Влагосборник одноразовый, варианты исполнения: G-313001; G-313001-0; G-313001-00; G-313001-1;	ФСЗ 2010/08292	В соответствии с заявленными в РУ моделями
		16. Влагосборник 900MR139, 900MR139C - 100 шт.	ФСЗ 2007/00742	В соответствии с заявленными в РУ моделями
		7. Влагосборники дыхательные.	ФСЗ 2009/03742	Присоединитель ный размер коннектора: 22М - 22М; Объем: 70 мл
3	Вода стерильная	Вода дистиллированная стерильная в полимерных контейнерах по ТУ 9398- 003-52317999-2010	-	Объем: 250 мл ИЛИ Объем: 500 мл ИЛИ Объем: 1000 мл
4	Генератор дыхания	1. Генератор дыхания	ФСЗ 2011/10229	Габаритные размеры (мм): 15x10x13 Присоединитель ный размер коннектора: 10М - Люэр
5	Держатель масок (вид 322590)	Держатели для масок (длиной 440 мм и 700 мм) и фиксаторы для шлангов и трубок	ФСЗ 2012/11566	Габаритные размеры (мм): 120x440 ИЛИ 138x700
		30. Ремни на голову BC325-10, BC328-10, BC331-10 - 100 шт. 31. Ремни на подбородок BC351-10, BC353-10, BC355-10, BC357-10 - 100 шт.	ФСЗ 2007/00742	В соответствии с заявленными в РУ моделями
6	Канюли для СРАР-терапии (вид 105850)	4. Канюли назальные	ФСЗ 2011/10229	Габаритные размеры (мм): 12x25x11 ИЛИ 12x25x10 ИЛИ 12x25x8 ИЛИ 12x25x7

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		10.1. Канюли назальные CPAP	ФСЗ 2012/13286	Габаритные размеры (мм): 12x25x11 ИЛИ 12x25x10 ИЛИ 12x25x8 ИЛИ 12x25x7
7	Канюли назальные (вид 136410)	13. Канюли назальные для взрослых, детей и младенцев.	ФСЗ 2012/11566	Габаритные размеры (мм): 1800x5,5 ИЛИ 2100x5,6 ИЛИ 2100x4,0
		20. Канюли носовые для недоношенных детей: RT091, 20 шт./уп. BC2425-20, 20 шт./уп. 21. Канюли носовые для новорожденных детей: RT092, 20 шт./уп. BC2435-20, 20 шт./уп. 22. Канюли носовые для младенцев: RT093, 20 шт./уп. BC2745-20, 20 шт./уп. 23. Канюли носовые для детей: RT094, 20 шт./уп. BC3780-20, 20 шт./уп. 24. Канюли носовые для взрослых RT095, 20 шт./уп. 25. Канюли носовые для крупных младенцев BC2755-20, 20 шт./уп.	ФСЗ 2011/09111	В соответствии с заявленными в РУ моделями
		Канюли назальные кислородные MEDEREN в следующих вариантах исполнения	РЗН 2018/7623	В соответствии с заявленными в РУ каталожными номераами
		10.2. Канюля назальная кислородная.	ФСЗ 2012/13286	Габаритные размеры (мм): 1800x5,5 ИЛИ 2100x5,6 ИЛИ

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
				2100х4,0
8	Канюли назальные (типа RAM)	4. Канюли назальные	ФСЗ 2011/10229	Габаритные размеры (мм): 13х10х40
9	Кабель соединительный электрический к проводу для подогрева дыхательных газов (вид 324410)	2. Кабель гибкого нагревателя, варианты исполнения: 900MR860, 900MR861, 900MR863, 900MR868, 900MR869 – не более 20 шт.	РЗН 2014/1416	В соответствии с заявленными в РУ моделями
10	Кислородная трубка (вид 156030)	10. Трубки кислородные постоянного и переменного сечения.	ФСЗ 2012/11566	Габаритные размеры (мм): 1800х5,5х5,5 ИЛИ 2100х5,5х5,5 ИЛИ 3000х5,5х5,5 ИЛИ 2500х5,5х5,5
		1. Шланги кислородные	РЗН 2013/1311	Габаритные размеры (мм): 1800х5х5 ИЛИ 2100х5х5 ИЛИ 2500х5,5х5,5 ИЛИ 3000х5,5х5,5
		14. Трубка кислородная (вид 156030)	ФСЗ 2011/09053	Габаритные размеры (мм): 2100х6х6 ИЛИ 1800х6х6
		23. Кислородная трубка BC400-10, BC402-5, 500RD103, 500RD107, 500RD113, 900RD008, 900RD009, 900RT003 - 100 шт.	ФСЗ 2007/00742	В соответствии с заявленными в РУ моделями
		13. Трубки кислородные: 900RT003, 50 шт./уп., 900RD008, 10 шт./уп., 900RD009, 10 шт./уп.	ФСЗ 2011/09111	В соответствии с заявленными в РУ моделями
		5. Трубки кислородные.	ФСЗ 2009/03742	Габаритные размеры (мм): 1800х7х7 ИЛИ

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
				2100х7х7
		1.3. Трубка кислородная.	ФСЗ 2012/13286	Габаритные размеры (мм): 1800х7х7 ИЛИ 2100х7х7 (±10%)
11	Камера для увлажнителей дыхательных смесей (вид 321970)	15. Увлажнители (камеры увлажнителя)	ФСЗ 2012/11566,	Габаритные размеры (мм): 125х108х125
		9. Увлажнители	РЗН 2013/1311	Габаритные размеры (мм): 125х98х125 ИЛИ 125х80х125
		1. Камера увлажнителя MR225, MR225X, MR250, MR250X, MR290, MR290X, MR340, MR370 - 100 шт.	ФСЗ 2007/00742	В соответствии с заявленными в РУ моделями
		1. Камеры увлажнителя взрослые: MR210, 40 шт./уп., MR210X, 10 шт./уп., MR250, 40 шт./уп., MR250X, 10 шт./уп. 2. Камеры увлажнителя детские: MR225, 50 шт./уп., MR225X, 10 шт./уп. 3. Камеры увлажнителя универсальные: MR290, 40 шт./уп., MR290X, 10 шт./уп., MR290U, 40 шт./уп., MR290UX, 10 шт./уп., MR290V, 40 шт./уп., MR290VX, 10 шт./уп., MR290HFV, 40 шт./уп.	ФСЗ 2011/09111	В соответствии с заявленными в РУ моделями
		8. Увлажнители дыхательные.	ФСЗ 2009/03742	Габаритные размеры (мм): 121х80х121
		7. Камера увлажнителя (вид 185610).	ФСЗ 2011/09053	Габаритные размеры (мм): 122х82х122 (±5%)
12	Клапан выдоха (вид 124510)	7.1. Клапан вдоха/выдоха	ФСЗ 2012/13286	Габаритные размеры (мм): 75х68х65

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
				Присоединитель ный размер коннектора: 22М
		10. Дыхательные клапаны: управляемые клапаны выдоха; клапаны с линиями мониторинга (или без) и управления.	ФСЗ 2009/03551	Габаритные размеры (мм): 75x68x65 Присоединитель ный размер коннектора: 22М
		Дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, управляемые клапаны выдоха, клапаны РЕЕР, клапаны Вентури, регулируемые и нерегулируемые, клапаны реверсивные и нереверсивные;	ФСЗ 2012/11566	Габаритные размеры (мм): 75x68x65
		7. Клапаны дыхательные	ФСЗ 2009/04992	Габаритные размеры (мм): 35x35x40 Присоединитель ный размер коннектора: 22М ИЛИ Габаритные размеры (мм): 35x35x48 Присоединитель ный размер коннектора: 22М ИЛИ Габаритные размеры (мм): 37x37x25 Присоединитель ный размер коннектора: 22М
13	Клапаны положительного давления (вид 108960 и 321960)	7.4. Клапан давления	ФСЗ 2012/13286	Габаритные размеры (мм): 37x37x28 Присоединитель ный размер

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
				коннектора: 22М
		7.2. Клапан РЕЕР	ФСЗ 2012/13286	Габаритные размеры (мм): 45х78х45 Присоединитель ный размер коннектора: 22М
		Дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, клапаны РЕЕР.	ФСЗ 2012/11566	Габаритные размеры (мм): 35х35х40 Присоединитель ный размер коннектора: 22М
		7. Клапаны дыхательные	ФСЗ 2009/04992	Габаритные размеры (мм): 44х44х75 Присоединитель ный размер коннектора: 22М
		10. Дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых, для детей; предохранительные клапаны сброса; управляемые клапаны выдоха; клапаны РЕЕР; клапаны Вентури регулируемые и нерегулируемые; клапаны реверсивные и нереверсивные; клапаны с линиями мониторинга (или без) и управления.	ФСЗ 2009/03551	Габаритные размеры (мм): 45х45х78 Присоединитель ный размер коннектора: 22М
14	Клапан нереверсивный, одноразового использования (вид 321960)	7.3. Клапан контроля	ФСЗ 2012/13286	Габаритные размеры (мм): 44х44х75 Присоединитель ный размер коннектора: 22М
		Дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК)	ФСЗ 2012/11566	Габаритные размеры (мм): 50х87х68 Присоединитель

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		ограничения давления для взрослых и для детей, управляемые клапаны выдоха, клапаны РЕЕР, клапаны Вентури, регулируемые и нерегулируемые, клапаны реверсивные и нереверсивные;		ный размер коннектора: 22М ИЛИ Габаритные размеры (мм): 45х45х78 Присоединитель ный размер коннектора: 22М
		7. Клапаны дыхательные	ФСЗ 2009/04992	Габаритные размеры (мм): 44х44х75 Присоединитель ный размер коннектора: 22М
		10. Дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых, для детей; предохранительные клапаны сброса; клапаны нереверсивные; клапаны с линиями мониторинга (или без).	ФСЗ 2009/03551	Габаритные размеры (мм): 46х46х75 Присоединитель ный размер коннектора: 22М
15	Коннектор прямой	15. Соединительные устройства	ФСЗ 2009/04992	Присоединитель ный размер коннектора: 22М, 19F ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора: 22М ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора: 22М, 15F ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора: 15М, 15F
16	Линии контроля давления (вид 271240)	1.4. Трубка соединительная	ФСЗ 2012/13286	Габаритные размеры (мм): 6х1800х6

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
				ИЛИ Габаритные размеры (мм): 6х2100х6
		11. Тонкие трубки для мониторинга	ФСЗ 2009/04992	Габаритные размеры (мм): 6х2100х6
		26. Линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга давления.	ФСЗ 2009/03551	Габаритные размеры (мм): 6х1800х6 Присоединитель ный размер коннектора: Люэр-Лок ИЛИ Габаритные размеры (мм): 6х2100х6 ИЛИ Габаритные размеры (мм): 6х2100х6 Присоединитель ный размер коннектора: Люэр-Лок ИЛИ Габаритные размеры (мм): 18х220х18 Присоединитель ный размер коннектора: Люэр-Лок
		25. Трубка измерения давления в контуре 900MR075, 900MR076, 900MR077 - 100 шт.	ФСЗ 2007/00742	В соответствии с заявленными в РУ моделями
17	Линия мониторинга газов (вид 271240)	1.2. Трубка проксимального давления и CO2	ФСЗ 2012/13286	Габаритные размеры (мм): 6х2100х6
		12. Линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик	ФСЗ 2012/11566	Габаритные размеры (мм): 6х2100х6 Присоединитель ный размер коннектора:

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		давления);		Люэр-Лок
		26. Линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга содержания углекислого газа.	ФСЗ 2009/03551	Габаритные размеры (мм): 6x2100x6 Присоединительный размер коннектора: Люэр-Лок
		11. Тонкие трубки для мониторинга	ФСЗ 2009/04992	Габаритные размеры (мм): 7x180x6
18	Маски анестезиологические (вид 275780)	3. Маски анестезиологические для взрослых, детей, младенцев и новорожденных: стандартные и применяемые при МРТ, анатомические и с воздушной подушкой, с клапаном и без, с крепежным хомутом и без, размеры № 0, №1, №2, №3, №4, №5, №6.	ФСЗ 2012/11566	Размер маски: размер 2; Присоединительный размер коннектора: 15M ИЛИ Размер маски: размер 4; Присоединительный размер коннектора: 22F ИЛИ Размер маски: размер L; Присоединительный размер коннектора: 22F ИЛИ Размер маски: размер 4; Присоединительный размер коннектора: 22F
		4. Маски наркозные	ФСЗ 2009/05401	Присоединительный размер коннектора: 22F ИЛИ Присоединительный размер коннектора: 15M
		2. Маски	РЗН 2013/1311	Присоединительный размер коннектора: 22F
		Маски анестезиологические MEDEREN	РЗН 2019/8818	В соответствии с заявленными в РУ каталожными

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		в вариантах исполнения		номера
		4. Маска наркозная (вид 156640);	ФСЗ 2011/09053	Присоединитель ный размер коннектора: 22F ИЛИ Размер маски: размер 4, 5; Присоединитель ный размер коннектора: 22F
		4.3. Маска дыхательная	ФСЗ 2012/13286	Присоединитель ный размер коннектора: 22F ИЛИ Размер маски: размер 4, 5; Присоединитель ный размер коннектора: 22F
19	Маски кислородные (вид 167560)	1. Маски кислородные, для взрослых и детей, одиночные и в комплекте: с трубкой кислородной; с трубкой кислородной и мешком дыхательным.	ФСЗ 2012/11566	Габаритные размеры (мм): 84x178x61 Присоединитель ный размер коннектора (мм): 6
		2. Маски	РЗН 2013/1311	Габаритные размеры (мм): 85x178x62 Присоединитель ный размер коннектора (мм): 6
		22. Кислородная маска HC407NIV, HC431NIV, HC452NIV, RD806-10, RD807-10, 900RT004, 900RT005, 900RT006 - 100 шт.	ФСЗ 2007/00742	В соответствии с заявленными в РУ моделями
		26. Маски кислородные неонатальные: RD803-10, 10 шт./уп. RD804-10, 10 шт./уп., RD805-10, 10 шт./уп., RD806-10, 10 шт./уп., RD807-10, 10 шт./уп. 27. Маски кислородные	ФСЗ 2011/09111	В соответствии с заявленными в РУ моделями

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		для взрослых: 900RT004, 50 шт./уп. 900RT005, 50 шт./уп. 28. Маски кислородные для детей 900RT006, 50 шт./уп		
		4.1. Маска кислородная	ФСЗ 2012/13286	Габаритные размеры (мм): 86x177x66 Присоединительный размер коннектора (мм): 6
20	Маски аэрозольные (вид 274020)	4. Маски аэрозольные для взрослых и детей, одиночные и в комплекте: с нерегулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с регулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с небулайзером и без.	ФСЗ 2012/11566	Габаритные размеры (мм): 84x178x61 Присоединительный размер коннектора: 22М
		4.2. Маска аэрозольная	ФСЗ 2012/13286	Габаритные размеры (мм): 85x177x66 Присоединительный размер коннектора: 22М
21	Маска носовая аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях (вид 109700)	3. Маски лицевые дыхательные	ФСЗ 2011/10229	Габаритные размеры (мм): 96x205x70 Присоединительный размер коннектора: 22F
		2. Маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные) различных размеров (малый, средний и большой).	ФСЗ 2012/11566	Габаритные размеры (мм): 90x200x71 Присоединительный размер коннектора: 22F
		29. Маски носовые: RT033, 20 шт./уп. RT034, 20 шт./уп., RT042, 10	ФСЗ 2011/09111	В соответствии с заявленными в РУ моделями

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		шт./уп., RT050, 20 шт./уп., RT051, 20 шт./уп., RT052, 20 шт./уп.		
22	Маска лицевая аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях, одноразового использования (вид 109710)	2. Маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: маски для CPAP.	ФСЗ 2012/11566	Присоединитель ный размер коннектора: 22М ИЛИ 30F
		4.4. Маска CPAP/NIPPV	ФСЗ 2012/13286	Присоединитель ный размер коннектора: 22М или 22F
23	Маски лицевые (вид 271390)	2. Маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные и лицевые) различных размеров (малый, средний и большой).	ФСЗ 2012/11566	Присоединитель ный размер коннектора: 22F
		Набор масок RD800-EN (5 шт.).	ФСЗ 2011/09111	Присоединитель ный размер коннектора: 22F
		30. Маски лицевые: RT040S, 10 шт./уп., RT040M, 10 шт./уп., RT040L, 10 шт./уп., RT041L, 10 шт./уп., RT041M, 10 шт./уп., RT041S, 10 шт./уп.	ФСЗ 2011/09111	В соответствии с заявленными в РУ моделями
		Маски дыхательные однократного применения Маска дыхательная однократного применения в индивидуальной упаковке с этикеткой, в следующих размерах: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. Принадлежности: Маскодержатель.	РЗН 2018/7995	В соответствии с заявленными в РУ моделями
24	Мешок для дыхательного контура, одноразового использования (вид 283370)	3.2. Мешок резервный	ФСЗ 2012/13286	Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 1, 2, 3
		3.1. Мешок дыхательный	ФСЗ	Присоединитель

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
			2012/13286	ный размер коннектора: 15F; Объем (л): 0,5; 1
		9. Мешок дыхательный (латекс)	ФСЗ 2012/12928	Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 3 ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 1
		17. Мешки (дыхательные и резервные, объемом 0.5 л, 1.0 л, 2.0 л, 3.0 л);	ФСЗ 2012/11566	Присоединитель ный размер коннектора: 15F; Объем (л): 0,5 ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 1 ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 2 ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 3
		5. Резервные мешки	ФСЗ 2009/04992	Присоединитель ный размер коннектора: 15F; Объем (л): 0,5 ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 1 ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 2 ИЛИ Присоединитель

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
				ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 2,4 ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 3
		27. Дыхательные мешки объемом: 0.5л, 1.0л, 1.3л, 2.0л, 2.3л, 3.0л, 5.0л: для анестезиологических или реанимационных дыхательных контуров с петлём или без, с открытым или закрытым концом; для аппаратуры; для оксигенации с дыхательным клапаном с трубкой или без.	ФСЗ 2009/03551	Присоединитель ный размер коннектора: 15F; Объем (л): 0,5 ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 1 ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 1,3 ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 2 ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 2,3 ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 3 ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 5
		5. Мешок дыхательный реанимационный для ИВЛ	ФСЗ 2011/09053	Присоединитель ный размер коннектора: 15F; Объем (л): 0,5 ИЛИ

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
				Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 1 ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 2 ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 3
		1. Мешки	РЗН 2013/1311	Присоединитель ный размер коннектора: 15F; Объем (л): 0,5 ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 1 ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 2 ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 3
		30. Мешок одноразовый, варианты исполнения: G- 118000; G-118001; G- 118002;	ФСЗ 2010/08292	В соответствии с заявленными в РУ моделями
		9.Мешки резервные дыхательные.	ФСЗ 2009/03742	Присоединитель ный размер коннектора: 15F; Объем (л): 0,5 ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 1 ИЛИ

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
				Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 2 ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 3
		1. Мешок дыхательный однократного применения, объем 500 мл. 2. Мешок дыхательный однократного применения, объем 1000 мл. 3. Мешок дыхательный однократного применения, объем 2000 мл. 4. Мешок дыхательный однократного применения, объем 3000 мл.	РЗН 2018/6773	Присоединитель ный размер коннектора: 15F; Объем (л): 0,5 ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 1 ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 2 ИЛИ Присоединитель ный размер коннектора: 22F; Объем (л): 3
25	Монитор давления (вид 132370)	12. Линии мониторинга (включая датчик давления)	ФСЗ 2012/11566	Габаритные размеры (мм): 11х60х24 Присоединитель ный размер коннектора: 7,6М
26	Мундштук (вид 283330)	мундштуки	ФСЗ 2012/11566	Габаритные размеры (мм): 24х80х26 ИЛИ Габаритные размеры (мм): 24х85х24
		мундштуки (загубники)	ФСЗ 2009/03551	Габаритные размеры (мм): 23х85х23 ИЛИ Габаритные

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
				размеры (мм): 23x83x20
27	Отражатели тепла (вид 330090)	15. Отражатели тепла: 900MR208, 20 шт./уп., NC040-10, 10 шт./уп., NC041-10, 10 шт./уп.	ФСЗ 2011/09111	В соответствии с заявленными в РУ моделями
28	Распылитель аэрозоля (небулайзер) (вид 324660)	14. Небулайзеры (распылители трахеобронхиального и альвеолярного осаждения) и резервуары небулайзеров, одиночные и в наборах (с маской аэрозольной, с коннектором или без, с фильтром или без, с кислородной трубкой).	ФСЗ 2012/11566	Присоединитель ный размер коннектора: 22F/18M, Присоединитель ный размер коннектора: 18M
		12. Распылители (небулайзеры)	РЗН 2013/1311	Присоединитель ный размер коннектора: 18M
		6. Небулайзеры дыхательные.	ФСЗ 2009/03742	Присоединитель ный размер коннектора: 18M
29	Соединитель (вид 327610)	8.2. Коннектор угловой	ФСЗ 2012/13286	Присоединитель ный размер коннектора: 22M/15F - 15M
		3. Гибкие соединители дыхательного контура	ФСЗ 2012/12928	Присоединитель ный размер коннектора: 22F - 22M/15F, 15M- 22M/15F
		15. Соединительные устройства	ФСЗ 2009/04992	Присоединитель ный размер коннектора: 22F- 22M, 22M-22M, 22M-22M/15F- 22M, 15M-22M/15F- 15M
		18. Соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: жесткие; эластомерные; гибкие; шарнирные; прямые; угловые; Т-	ФСЗ 2009/03551	Присоединитель ный размер коннектора: 15F- 15M, 15M-22F, 22M-18F-22F, 22M-22M/15F- 22M

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		образные; Y-образные; адаптеры;		
		17. Коннектор (угольник), варианты исполнения: G-311011; G-311012; G-311015; G- 311015-0; G-311015-1; G- 311015-R; G-311015-R2; G-311022; G-311025; G- 311025-1;	ФСЗ 2010/08292	В соответствии с заявленными в РУ моделями
		28. Коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094, RT095 - 100 шт.	ФСЗ 2007/00742	В соответствии с заявленными в РУ моделями
		32. Удлинитель трубки (22 мм.) RT024, 20 шт./уп	ФСЗ 2011/09111	В соответствии с заявленной в РУ моделью
		2.Переходники для дыхательных контуров.	ФСЗ 2009/03742	Присоединитель ный размер коннектора: 22F- 22M, 22M-22M, 22M-22M/15F- 22M
30	Соединитель (вид 165140)	6. Угловые адаптеры	ФСЗ 2012/12928	Присоединитель ный размер коннектора: 22F- 22M, 15M- 22M/15F
		20. Коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них)	ФСЗ 2012/11566	Присоединитель ный размер коннектора: 22F- 22M, 15M- 22M/15F

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		15. Соединительные устройства	ФСЗ 2009/04992	Присоединитель ный размер коннектора: 22F- 22М, 22М-22М, 22М-22М/15F- 22М, 15F-15М, 22М-2М, 15М- 15М.
		9. Переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - переходник прямой; - переходник Т-образный; - угловой.	ФСЗ 2011/09053	Присоединитель ный размер коннектора: 22F- 22М, 22М-22М, 22М-22М/15F- 22М, 15М- 22М/15F-15М
		6. Переходники	РЗН 2013/1311	Присоединитель ный размер коннектора: 22F- 22М, 22М-22М, 22М- 22М/15F-22М, 15М-22М/15F- 15М
		6. Воздуховоды	ФСЗ 2009/05401	Присоединитель ный размер коннектора: 22F- 22М, 22М-22М, 22М-22М/15F- 22М, 15М- 22М/15F-15М
		15. Коннектор (адаптор), варианты исполнения: G- 311000; G-311000-1; G- 311001; G-311001-1; G- 311002; G-311003; G- 311003-2; G-311003-3; G- 311004; G-311004-2; G- 311005; G-311006; G- 311008-1; G-311017; G- 311019; G-311019-2; G- 311024; G-311031; V- 1022-02; 9014-D; G- 311008; G-311008-2; G- 311039; G-311003-2; G- 311003-2-1; G-311004-3; G-311031-1;	ФСЗ 2010/08292	В соответствии с заявленными в РУ моделями
		27. Угловой адаптер (22	ФСЗ	В соответствии с

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		mm F - 22 mm M/15 mm F) - не более 5 шт.;	2012/12372	заявленными в РУ
		17. Адаптер для температурного датчика 900MR132, 900MR143, 900MR144, 900MR146, 900MR146C, 900MR531, 900MR531C, 900MR531L, 900MR532, 900MR532C, 900MR532L, 900MR534 - 100 шт. 18. Адаптер BC420-10, BC450-01, RT010, RT030, 900MR148, 900MR156, 900MR157, 900MR158, 900MR159, 900MR177, 900MR178, 900MR405, 900MR406, 900MR530, 900MR530L, 900MR533, 900MR533C, 900MR533L, 900MR534C, 900MR534L, 900MR535 - 100 шт. 19. Воздушный адаптер RT001, RT008 - 100 шт.	ФСЗ 2007/00742	В соответствии с заявленными в РУ моделями
		14. Угольник 900MR052, 900MR052C, 900MR053, 900MR053C, 900MR130, 900MR130C, 900MR130L, 900MR131, 900MR131L, 900MR132, 900MR147, 500RD104 - 100 шт.	ФСЗ 2007/00742	В соответствии с заявленными в РУ моделями
		5. Адаптеры для камеры увлажнителя: 900MR161, 1 шт./уп., 900MR161L, 50 шт./уп., 900MR162, 1 шт./уп., 900MR162L, 50 шт./уп. 6. Адаптер соединителя 900MR835, 50 шт./уп. 7. Адаптер 900MR961 для камеры увлажнителя, два газа, 20 шт./уп.	ФСЗ 2011/09111	В соответствии с заявленными в РУ моделями
		8. Адаптер RT021 гибкого соединения с тройником, 20 шт./уп. 9. Адаптер RT022 гибкого соединения, 20 шт./уп.	ФСЗ 2007/00742	В соответствии с заявленными в РУ моделями

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		10. Адаптер RT030 для тройника распылителя, 20 шт./уп. 11. Адаптеры для подсоса воздуха: RT001, 20 шт./уп., RT008, 20 шт./уп.		
		8.3. Коннектор Т- образный	ФСЗ 2012/13286	Присоединитель ный размер коннектора: 22F- 22M, 22M-22M, 22M- 22M/15F-22M, 15M-22M/15F- 15M
31	Тепло/влагообменник/бактериа льный фильтр (вид 218750)	10. Фильтры тепловлагообменные	ФСЗ 2012/12928	Присоединитель ный размер коннектора: 22F/15M- 22M/15F
		16. Фильтры	ФСЗ 2012/11566	Присоединитель ный размер коннектора: 22F/15M- 22M/15F
		17. Фильтры	ФСЗ 2009/04992	Присоединитель ный размер коннектора: 22F/15M- 22M/15F
		3. Фильтры	РЗН 2013/1311	Присоединитель ный размер коннектора: 22F/15M- 22M/15F
		Фильтр дыхательный для аппаратов ИВЛ	ФСР 2011/11397	Присоединитель ный размер коннектора: 22F/15M- 22M/15F
		Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции легких, аэрозольной и кислородной терапии	РЗН 2019/8405	В соответствии с заявленными в РУ каталожными номераами
		3. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с	РЗН 2019/9010	Присоединитель ный размер

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор. 4. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор. 5. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, прямой коннектор. 6. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, угловой коннектор. 8. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником НЕРА. 9. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный педиатрический с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор. 10. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный педиатрический с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор. 11. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный неонатальный с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор. 12. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор. 13. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с		коннектора: 22F/15M- 22M/15F

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		тепловлагообменником из пенополиуретана, для трахеостомы. 14. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана и кислородной трубкой, для трахеостомы. 15. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, для трахеостомы. 16. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги и кислородной трубкой, для трахеостомы. 17. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, Т-образный, для трахеостомы. 18. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги и кислородной трубкой, Т-образный, для трахеостомы.		
		5.1. Фильтр бактериально-вирусный с увлажнителем	ФСЗ 2012/13286	Присоединительный размер коннектора: 22F/15M-22M/15F
		Фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции легких, аэрозольной и кислородной терапии	РЗН 2019/8705	В соответствии с заявленными в РУ каталожными номерами
		1. Фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 15M, 22M/15F. 2. Фильтр	РЗН 2020/9671	Присоединительный размер коннектора: 22F/15M-

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		дыхательный, теплооблагодобменный, с портом Луер-Лок, Small, Ø 22F/15M, 22M/15F. 3. Фильтр дыхательный, теплооблагодобменный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F. 4. Фильтр дыхательный, теплооблагодобменный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F, HEPA. 5. Фильтр дыхательный, теплооблагодобменный, с портом Луер-Лок, угловой, Ø 22F/15M, 22M/15F. 6. Фильтр дыхательный, теплооблагодобменный, без порта Луер-Лок, Small, Ø 22F/15M, 22M/15F. 7. Фильтр дыхательный, теплооблагодобменный, без порта Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F. 8. Фильтр дыхательный, теплооблагодобменный, без порта Луер-Лок, HEPA, Ø 22F/15M, 22M/15F. 9. Фильтр дыхательный, теплооблагодобменный, трахеостомический, Ø 15F, с кислородным портом Ø 6 мм. 10. Фильтр дыхательный, теплооблагодобменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 6 мм. 11. Фильтр дыхательный, теплооблагодобменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 5 мм. 12. Фильтр		22M/15F или 22F-22M/15F или 15F-15M/8,5F

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 3 мм. 13. Фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 2 мм. 16. Фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 15M, 22M/15F. 17. Фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Small, Ø 22F/15M, 22M/15F. 18. Фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F. 19. Фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, угловой Ø 22F/15M, 22M/15F. 21. Фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Small, Ø 22F/15M, 22M/15F. 22. Фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F.		
32	Термометр (вид 320750)	33. Термометр 900MR033 - 100 шт.	ФСЗ 2007/00742	В соответствии с заявленной в РУ

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
				моделью
34	Тестовое легкое (вид 107580)	17. Тестовые легкие: RD020-01, 1 шт./уп. 500RD106, 1 шт./уп.	ФСЗ 2011/09111	В соответствии с заявленными в РУ моделями
35	Трубка дыхательная (вид 354450)	1.4. Трубка соединительная	ФСЗ 2012/13286	Присоединитель ный размер коннектора: 22F- 22F,15F-15F Длина: 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 180 см, 300 см, 400 см
		1.1. Трубка дыхательная	ФСЗ 2012/13286	Присоединитель ный размер коннектора: 22F- 22F,15F-15F Длина: 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 180 см, 300 см, 400 см
		- трубки дыхательного контура однократного использования (этилвинилацетат);	ФСЗ 2012/12928	Присоединитель ный размер коннектора: 22F- 22F; Длина: 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 180 см, 300 см, 400 см
		трубки дыхательного контура однократного использования гофрированные (этиленвинилацетат);	ФСЗ 2012/12928	Присоединитель ный размер коннектора: 22F- 22F; Длина: 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 180 см, 300 см, 400 см
		Дыхательные шланги (длиной 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см,	ФСЗ 2012/11566	Присоединитель ный размер коннектора: 22F-

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		120 см, 150 см, 180 см, 300 см, 400 см);		22F; Длина: 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 180 см, 300 см, 400 см
		10. Дыхательные шланги	ФСЗ 2009/04992	Присоединитель ный размер коннектора: 22F- 22F; Длина: 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 180 см, 300 см, 400 см
		8. Трубки дыхательные	РЗН 2013/1311	Присоединитель ный размер коннектора: 22F- 22F; Длина: 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 180 см, 300 см, 400 см
		17. Дыхательные шланги в комплекте с соединителями или без: шланги для дыхательных контуров; шланги для эвакуации отработанных газов.	ФСЗ 2009/03551	Присоединитель ный размер коннектора: 22F- 22F; Длина: 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 180 см, 300 см, 400 см
		11. Трубка дыхательная.	ФСЗ 2011/09053	Присоединитель ный размер коннектора: 22F- 22F; Длина: 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 180 см, 300 см, 400 см

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		3.Трубки дыхательные.	ФСЗ 2009/03742	Присоединитель ный размер коннектора: 22F- 22F; Длина: 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 180 см, 300 см, 400 см
36	Фильтры дыхательные (вид 318730)	5.1. Фильтр вирусный	ФСЗ 2012/13286	Присоединитель ный размер коннектора: 22М/15F- 15М/22F 22М/15F-22F, 8,5М/15М-15F или 15F
		16. Фильтры	ФСЗ 2012/11566	Присоединитель ный размер коннектора: 22М/15F- 15М/22F, 22М/15F-22F, 8,5М/15М-15F или 15F
		17. Фильтры	ФСЗ 2009/04992	Присоединитель ный размер коннектора: 22М/15F- 15М/22F, 22М/15F-22F, 8,5М/15М-15F или 15F
		20. Дыхательные вирусо- бактериальные фильтры в комплекте с соединителями или без: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов.	ФСЗ 2009/03551	Присоединитель ный размер коннектора: 22М/15F- 15М/22F, 22М/15F-22F, 8М/15М-15F или 15F
		8. Фильтр дыхательный	ФСЗ 2011/09053	Присоединитель ный размер коннектора: 22М/15F- 15М/22F,

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
				22М/15F-22F, 8,5М/15М-15F или 15F
		3. Фильтры	РЗН 2013/1311	Присоединитель ный размер коннектора: 22М/15F- 15М/22F, 22М/15F-22F, 8,5М/15М-15F или 15F
		26. Фильтр, варианты исполнения: 800-51700-0; 800-51700; 800-61600; 800-51900; 800-51900-0; 800-51900-11; 800-51800; 800-52000; 800-51500; 800-51600; 800- 54011;800-52300;	ФСЗ 2010/08292	В соответствии с заявленными в РУ моделями
		21. Фильтр RT019, RT020 - 100 шт.	ФСЗ 2007/00742	В соответствии с заявленными в РУ моделями
		19. Фильтр выдоха RT020, 20 шт./уп.	ФСЗ 2011/09111	В соответствии с заявленными в РУ моделями
		4.Фильтры дыхательные	ФСЗ 2009/03742	Присоединитель ный размер коннектора: 22М/15F- 15М/22F, 22М/15F-22F, 8,5М/15М-15F или 15F
		Фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии в следующих вариантах исполнения: I. Фильтры электростатические взрослые: 1. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа	РЗН 2019/8705	В соответствии с заявленными в РУ моделями

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		4222/701. 2. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4222/700. 3. Фильтр электростатический взрослый без отверстия для отбора проб газа 4222/703. 4. Фильтр электростатический взрослый без отверстия для отбора проб газа 4222/705. 5. Фильтр электростатический взрослый без отверстия для отбора проб газа 4222/702. 6. Фильтр электростатический взрослый дыхательный FR004. 7. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4333/01. 8. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4333/711. 9. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4333/761. 10. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4333/750. 11. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4333/751. 12. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 9064/711. 13. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для сбора проб газа		

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		9064/751. 14. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 9065/710. 15. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для сбора проб газа 9065/750. 16. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4333/710. 17. Фильтр электростатический взрослый 4333/712. 18. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4333/721. 19. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 8866/50. 20. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4222/01. 21. Фильтр электростатический взрослый 4222/02. 22. Фильтр электростатический взрослый 4222/03. 23. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 8866/01. 24. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 9070/01. 25. Фильтр электростатический взрослый 9071/01. 26. Фильтр электростатический взрослый с отверстием		

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		для отбора проб газа 8866/100. 27. Фильтр электростатический взрослый 5200/01. 28. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа FR003. 29. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа 9040/01. 30. Фильтр электростатический взрослый 9041/01. II. Фильтры механические взрослые: 1. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4244/701. 2. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4244/700. 3. Фильтр механический взрослый 4244/702. 4. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4244/711. 5. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4244/761. 6. Фильтр механический взрослый 4333/752. 7. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа 9040/50. 8. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4220/01. 9. Фильтр механический взрослый 4220/04. 10. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4244/01. 11.		

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		Фильтр механический взрослый 4244/02. 12. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа 4244/04. 13. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа 8222/01. III. Фильтры электростатические детские: 1. Фильтр электростатический детский с отверстием для отбора проб газа 9066/701. 2. Фильтр электростатический детский с отверстием для сбора проб газа 9066/751. 3. Фильтр электростатический детский с отверстием для сбора проб газа 9066/771. 4. Фильтр электростатический детский с отверстием для отбора проб газа 9067/700. 5. Фильтр электростатический детский с отверстием для отбора проб газа 9066/711. 6. Фильтр электростатический детский с отверстием для отбора проб газа 9067/710. 7. Фильтр электростатический детский с отверстием для отбора проб газа 9067/750. 8. Фильтр электростатический детский с отверстием для отбора проб газа 9064/100. 9. Фильтр электростатический детский с отверстием для отбора проб газа 9066/01.		

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		IV. Фильтры механические детские: 1. Фильтр механический детский с отверстием для отбора проб газа 9898/01. 2. Фильтр механический детский с отверстием для отбора проб газа 9800/01. V. Фильтры механические для аппарата вентиляции лёгких: 1. Фильтр механический для аппарата вентиляции лёгких 3000/01. 2. Фильтр механический для аппарата вентиляции лёгких 3000/03. 3. Фильтр механический для аппарата вентиляции лёгких 3000/04. 4. Фильтр механический для аппарата вентиляции лёгких 3000/740. 5. Фильтр механический для аппарата вентиляции лёгких 3200/06. 6. Фильтр механический для концентратора кислорода 3200/03. 7. Фильтр механический для концентратора кислорода 3200/06. 8. Фильтр механический для концентратора кислорода 3200/08. 9. Фильтр механический для аппарата вентиляции лёгких 3100/01. 10. Фильтр механический для концентратора кислорода 4100/20. 11. Фильтр механический для концентратора кислорода 4100/30. 12. Фильтр механический для концентратора		

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		кислорода 4100/92. 13. Фильтр механический для концентратора кислорода 4100/725. 14. Фильтр механический для концентратора кислорода 4100/735. 15. Фильтр механический для аппарата вентиляции лёгких 4020/01. 16. Фильтр механический для аппарата вентиляции лёгких 4020/02. 17. Фильтр механический для аппарата вентиляции лёгких 4020/03. 18. Фильтр механический для аппарата вентиляции лёгких 4020/06. 19. Фильтр механический для аппарата вентиляции лёгких с угольным наполнителем 1898/01. 20. Фильтр механический для аппарата вентиляции лёгких с угольным наполнителем 1898/03. VI. Фильтры электростатические спирометрические взрослые: 1. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/01. 2. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/02. 3. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/03. 4. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/10. 5. Фильтр		

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		электростатический спирометрический взрослый 2800/11. 6. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/15. 7. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/17. 8. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/21. 9. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/22. 10. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/23. 11. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/24. 12. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/25. 13. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/26. 14. Фильтр электростатический спирометрический взрослый 2800/30. Принадлежности: 1. Адаптер разъема 2802/01. 2. Адаптер разъема 2802/02. 3. Адаптер разъема 2802/03. 4. Адаптер разъема 2802/04. 5. Адаптер разъема 2802/05. 6. Адаптер		

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		разъема 2802/06. 7. Адаптер разъема 2802/07. 8. Адаптер разъема 2802/08. 9. Адаптер разъема 2802/09. 10. Адаптер разъема 2802/10. 11. Адаптер разъема 2802/11. 12. Адаптер разъема 2802/12. 13. Адаптер разъема 2802/13. 14. Адаптер разъема 2802/14. 15. Адаптер разъема 2802/15. 16. Адаптер разъема 2802/16. 17. Адаптер разъема 2802/17. 18. Адаптер разъема 2802/18. 19. Адаптер разъема 2802/19. 20. Адаптер разъема 2802/20. 21. Адаптер разъема 2802/21. 22. Адаптер разъема 2802/22. 23. Адаптер разъема 2802/23. 24. Адаптер разъема 2802/24. 25. Адаптер разъема 2802/25. 26. Адаптер разъема 2802/26. 27. Адаптер разъема 2802/27. 28. Адаптер разъема 2802/28. 29. Адаптер разъема 2802/29. 30. Адаптер разъема 2802/30. VII. Фильтры механические спирометрические взрослые: 1. Фильтр механический спирометрический взрослый модель 2800/R1. 2. Фильтр механический спирометрический взрослый модель 2800/R10. 3. Фильтр механический спирометрический взрослый модель		

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		2800/R2. 4. Фильтр механический спирометрический взрослый модель 2800/R3. VIII. Фильтры электростатические неонатальные: 1. Фильтр электростатический неонатальный с отверстием для отбора проб газа 9080/700. 2. Фильтр электростатический неонатальный с отверстием для отбора проб газа 9080/01. 3. Фильтр электростатический неонатальный с отверстием для отбора проб газа 9080/710. 4. Фильтр электростатический неонатальный с отверстием для сбора проб газа 9080/100. 5. Фильтр электростатический неонатальный с отверстием для сбора проб газа 9080/750. IX. Фильтры электростатические для небулайзерного аппарата: 1. Фильтр электростатический для небулайзерного аппарата 1420/01. 2. Фильтр электростатический для небулайзерного аппарата 1420/03. 3. Фильтр электростатический для небулайзерного аппарата 4444/01. 4. Фильтр электростатический для небулайзерного аппарата 4444/64. 5. Фильтр		

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		электростатический для небулайзерного аппарата 4444/66. X. Фильтры тепловлагообменные трахеостомические неонатальные: 1. Фильтр тепловлагообменный трахеостомический неонатальный 9085/01. 2. Фильтр тепловлагообменный трахеостомический неонатальный 9085/771. 3. Фильтр тепловлагообменный трахеостомический неонатальный 9085/751. XI. Фильтры тепловлагообменные трахеостомические: 1. Фильтр тепловлагообменный трахеостомический взрослый с кислородным коннектором и всасывающим портом 9500/01. 2. Фильтр тепловлагообменный трахеостомический взрослый с бумажным наполнением 9500/710. 3. Фильтр тепловлагообменный трахеостомический взрослый 9500/750. 4. Фильтр тепловлагообменный трахеостомический взрослый 9500/02. 5. Фильтр тепловлагообменный трахеостомический взрослый с клапаном 9500/03. 6. Фильтр тепловлагообменный трахеостомический взрослый с отверстием		

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		для сбора проб газа 9066/50. 7. Фильтр тепловлагообменный трахеостомический 9085/09.		
		Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения. I. Варианты исполнения: 1. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22M/15F-15M/22F, 22M/15F-22F или 8M/15M-15F, без тепловлагообмена. 2. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22M/15F-15M/22F, 22M/15F-22F или 8M/15M-15F, без тепловлагообмена, с портом luer-lock. 3. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22M/15F-15M/22F, 22M/15F-22F или 8M/15M-15F, с тепловлагообменом. 4. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов	РЗН 2018/7282	Присоединитель ный размер коннектора: 22M/15F - 22F/15M или 22F-22M/15F или 8M/15M-15F

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		22М/15F-15М/22F, 22М/15F-22F или 8М/15М-15F, с тепловлагообменом, с портом luer-lock. 5. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения механический с размерами выходов 22М/15F-15М/22F, 22М/15F-22F или 8М/15М-15F, с тепловлагообменом. 6. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения механический с размерами выходов 22М/15F-15М/22, 22М/15F-22F или 8М/15М-15F, с тепловлагообменом, с портом luer-lock.		
		Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии, варианты исполнения: I. Фильтры электростатические взрослые в следующих вариантах исполнения: 1. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4222/701. 2. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4222/700. 3.	РЗН 2019/8405	В соответствии с заявленными в РУ моделями

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		Фильтр электростатический взрослый без отверстия для отбора проб газа модель 4222/703. 4. Фильтр электростатический взрослый без отверстия для отбора проб газа модель 4222/702. 5. Фильтр электростатический взрослый дыхательный модель FR004. 6. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4333/01. 7. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4333/711. 8. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4333/761. 9. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4333/750. 10. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4333/751. 11. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 9064/711. 12. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для сбора проб газа		

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		модель 9064/751. 13. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 9065/710. 14. Фильтр электростатический взрослый, с отверстием для сбора проб газа модель 9065/750. 15. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4333/710. 16. Фильтр электростатический взрослый модель 4333/712. 17. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4333/721. 18. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4222/01. 19. Фильтр электростатический взрослый модель 4222/02. 20. Фильтр электростатический взрослый модель 4222/03. 21. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 9070/01. 22. Фильтр электростатический взрослый модель 9071/01. 23. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа		

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		модель 8866/100. 24. Фильтр электростатический взрослый модель 5200/01. 25. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель FR003. 26. Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 9040/01. 27. Фильтр электростатический взрослый модель 9041/01. II. Фильтры механические взрослые в следующих вариантах исполнения: 1. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4244/701. 2. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4244/700. 3. Фильтр механический взрослый модель 4244/702. 4. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4244/711. 5. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4244/761. 6. Фильтр механический взрослый модель 4333/752. 7. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 9040/50. 8. Фильтр механический взрослый с отверстием		

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		для отбора проб газа модель 4220/01. 9. Фильтр механический взрослый модель 4220/04. 10. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4244/01. 11. Фильтр механический взрослый модель 4244/02. 12. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4244/04. 13. Фильтр механический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 8222/01. III. Фильтры электростатические детские в следующих вариантах исполнения: 1. Фильтр электростатический детский с отверстием для отбора проб газа модель 9066/701. 2. Фильтр электростатический детский, с отверстием для сбора проб газа модель 9066/751. 3. Фильтр электростатический детский, с отверстием для сбора проб газа модель 9066/771. 4. Фильтр электростатический детский с отверстием для отбора проб газа модель 9067/700. 5. Фильтр электростатический детский с отверстием для отбора проб газа модель 9066/711. 6. Фильтр электростатический детский с отверстием для		

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		отбора проб газа модель 9067/710. 7. Фильтр электростатический детский с отверстием для отбора проб газа модель 9067/750. 8. Фильтр электростатический детский с отверстием для отбора проб газа модель 9066/01. IV. Фильтры механические детские в следующих вариантах исполнения: 1. Фильтр механический детский с отверстием для отбора проб газа модель 9898/01. 2. Фильтр механический детский с отверстием для отбора проб газа модель 9800/01. V. Фильтры механические спирометрические взрослые в следующих вариантах исполнения: 1. Фильтр механический спирометрический взрослый модель 2800/R1. 2. Фильтр механический спирометрический взрослый модель 2800/R10. 3. Фильтр механический спирометрический взрослый модель 2800/R2. 4. Фильтр механический спирометрический взрослый модель 2800/R3. VI. Фильтры электростатические для небулайзерного аппарата в следующих вариантах исполнения: 1. Фильтр электростатический для небулайзерного аппарата модель 1420/01. 2.		

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		Фильтр электростатический для небулайзерного аппарата модель 1420/03. 3. Фильтр электростатический для небулайзерного аппарата модель 4444/01. 4. Фильтр электростатический для небулайзерного аппарата модель 4444/64. 5. Фильтр электростатический для небулайзерного аппарата модель 4444/66.		
		Фильтр дыхательный для аппаратов ИВЛ	ФСР 2011/11397	Присоединитель ный размер коннектора: 22F- 15M/22M- 15F
		1. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный, прямой коннектор. 2. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный, угловой коннектор. 7. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный НЕРА.	РЗН 2019/9010	Присоединитель ный размер коннектора: 22F/15M- 22M/15F
		14. Фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F. 15. Фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22M/15F, 22F. 20. Фильтр дыхательный линии давления 0,2 µm.	РЗН 2020/9671	Присоединитель ный размер коннектора: 22F/15M- 22M/15F или 22F-22M/15F или 15F-15M/8,5F
37	Шапочки-фиксаторы дыхательные (вид 275620)	5. Шапочки-фиксаторы дыхательные	ФСЗ 2011/10229	Габаритные размеры (мм): 180x120
		29. Колпак ВС300-05, ВС303-05, ВС306-05, ВС309-05, ВС360-SK - 100 шт.	ФСЗ 2007/00742	В соответствии с заявленными в РУ моделями
38	У-образный коннектор (вид	8.4. Коннектор У-	ФСЗ	Присоединитель

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
	151450)	образный	2012/13286	ный размер коннектора: 22М-22М/22F- 22М, 15М- 22М/22F-15М
		Y-образный адаптер (полисульфон, акрилонитрилбутадиенст ирол, полипропилен)	ФСЗ 2012/12928	Присоединитель ный размер коннектора: 22М-22М/22F- 22М, 15М- 22М/22F-15М
		20 Коннекторы (Y- образные)	ФСЗ 2012/11566	Присоединитель ный размер коннектора: 22М-22М/22F- 22М, 15М- 22М/22F-15М
		18. Соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: Y- образные;	ФСЗ 2009/03551	Присоединитель ный размер коннектора: 22М-22М/22F- 22М, 15М- 22М/22F-15М
		9. Переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - тройник пациента;	ФСЗ 2011/09053	Присоединитель ный размер коннектора: 22М-22М/22F- 22М, 15М- 22М/22F-15М
		18. Коннектор (тройник пациента), варианты исполнения: E-1030-01-2; G-311010; E-1031-04; G- 313005; G-313005-00; G- 313005-00-1; G-313005- 11; G-313005-11-1; G- 311010-1; G-311030; G- 311032;	ФСЗ 2010/08292	В соответствии с заявленными в РУ моделями
		13. Тройник пациента RT029, 900MR125, 900MR126, 900MR126C, 900MR126L, 900MR127, 900MR128, 900MR128L, 900MR136, 900MR138, 900MR145, 900MR145C - 100 шт.	ФСЗ 2007/00742	В соответствии с заявленными в РУ моделями
		15. Соединительные	ФСЗ	Присоединитель

№ п/ п	Наименование по ТУ*	Наименование по РУ покупных изделий	Регистрацион ное удостоверени е	Технические требования
		устройства	2009/04992	ный размер коннектора: 22М-22М/22F- 22М, 15М- 22М/22F-15М
		12. Тройник пациента неонатальный RT029, 20 шт./уп.	ФСЗ 2011/09111	В соответствии с заявленной в РУ моделью
39	Держатель контура дыхательного (вид 185520)	14. Держатель шлангов RT028, 20 шт./уп.	ФСЗ 2011/09111	В соответствии с заявленной РУ моделью
* наименования выбраны в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий				




Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
(лист(ов))

Генеральный директор

ООО «МЕДИПЛАСТ»

С.Е. Коминин

06.04.2022

Генеральный директор
ООО «МЕДИПЛАСТ»
Комягин С.Е.

(подпись)
М.П.
«06» июня 2022 г.



Инструкция по применению (для потребителей)

Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019, в вариантах исполнения

Оглавление

1	Наименование медицинского изделия	3
2	Сведения о производителе медицинского изделия	33
3	Назначение медицинского изделия, установленное производителем	33
4	Условия применения	34
5	Принцип действия	34
6	Перечень показаний к применению, противопоказаний, возможных побочных действий	34
6.1	Показания к применению	34
6.2	Противопоказания к применению	34
6.3	Возможные побочные действия	34
6.4	Меры предосторожности и требования безопасности	34
7	Описание, параметры и характеристики медицинского изделия	35
7.1	Описание изделия	35
7.2	Методы и условия стерилизации и дезинфекции	41
8	Указания по применению	41
8.1	Общие положения	41
9	Установка и способ применения	41
9.1	Подготовка к использованию	41
9.2	Выбор размера	41
9.3	Рекомендуемый метод установки	42
9.5	Возможные риски при использовании	43
9.6	Обслуживание и ремонт	43
10	Комплектность	43
10.1	Минимальная комплектность	43
10.2	Максимальная комплектность	45
11	Упаковка	117
12	Маркировка	117
13	Условия эксплуатации	118
14	Транспортирование	119
15	Хранение	119
16	Гарантийные обязательства	119
17	Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия	119
18	Контактная информация	119
	Приложение А: Манипуляционные символы, указанные на упаковке	121

1 Наименование медицинского изделия – Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019;

Варианты исполнения:

I. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: анестезиологические, в составе:

1. Трубка гофрированная, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,
или трубка соединительная, трубка дыхательная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или трубки дыхательного контура однократного использования (этилвинилацетат), трубки дыхательного контура однократного использования гофрированные (этиленвинилацетат) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или дыхательные шланги (длиной 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 180 см, 300 см, 400 см) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или дыхательные шланги производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или трубки дыхательные производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или дыхательные шланги в комплекте с соединителями или без: шланги для дыхательных контуров; шланги для эвакуации отработанных газов производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или трубка дыхательная производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или трубки дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 6 шт.

2. Коннектор прямой, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992 - не более 15 шт.

3. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия, или угловые адаптеры производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - переходник прямой; - переходник Т-образный; - угловой производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или переходники производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или воздуховоды производства "Смите Медикал Интернэшнл Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/05401,

или коннектор (адаптор), варианты исполнения: G-311000; G-311000-1; G-311001; G-311001-1; G-311002; G-311003; G-311003-2; G-311003-3; G-311004; G-311004-2; G-311005; G-311006; G-311008-1; G-311017; G-311019; G-311019-2; G-311024; G-311031; V-1022-02; 9014-

D; G-311008; G-311008-2; G-311039; G-311003-2; G-311003-2-1; G-311004-3; G-311031-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,
или угловой адаптер (22 mm F - 22 mm M/15 mm F) производства "Грейт Групп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12372,
или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094, RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,
или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 5 шт.
4. Адаптер кислорода, соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,
или коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 - не более 100 шт. (при необходимости).
5. Держатель контура дыхательного, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,
или держатель шлангов RT028 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 5 шт. (при необходимости).
6. Держатель масок, держатели для масок (длиной 440 мм и 700 мм) и фиксаторы для шлангов и трубок производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,
или ремни на голову BC325-10, BC328-10, BC331-10, ремни на подбородок BC351-10, BC353-10, BC355-10, BC357-10 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).
7. Канюли назальные, канюли назальные для взрослых, детей и младенцев производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,
или канюли носовые для недоношенных детей: RT091, BC2425-20, канюли носовые для новорожденных детей: RT092, BC2435-20, канюли носовые для младенцев: RT093, BC2745-20, канюли носовые для детей: RT094, BC3780-20, канюли носовые для взрослых RT095, канюли носовые для крупных младенцев BC2755-20 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,
или канюли назальные кислородные MEDEREN в следующих вариантах исполнения производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2018/7623
или канюля назальная кислородная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).
8. Кислородная трубка, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,
или трубки кислородные постоянного и переменного сечения производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,
или шланги кислородные производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,
или трубка кислородная (вид 156030) производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,
или кислородная трубка BC400-10, BC402-5, 500RD103, 500RD107, 500RD113, 900RD008, 900RD009, 900RT003 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,
или трубки кислородные: 900RT003, 900RD008, 900RD009 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,
или трубки кислородные производства "Интаир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

9. Клапаны положительного давления, клапан давления, клапан РЕЕР производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, клапаны РЕЕР производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или клапаны дыхательные производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых, для детей; предохранительные клапаны сброса; управляемые клапаны выдоха; клапаны РЕЕР; клапаны Вентури регулируемые и нерегулируемые; клапаны реверсивные и нереверсивные; клапаны с линиями мониторинга (или без) и управления производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

10. Клапан нереверсивный, одноразового использования, клапан контроля производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, управляемые клапаны выдоха, клапаны РЕЕР, клапаны Вентури, регулируемые и нерегулируемые, клапаны реверсивные и нереверсивные производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или клапаны дыхательные производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых, для детей; предохранительные клапаны сброса; клапаны нереверсивные; клапаны с линиями мониторинга (или без) производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

11. Линии контроля давления, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубка соединительная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга давления. производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или трубка измерения давления в контуре 900MR075, 900MR076, 900MR077 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

12. Линия мониторинга газов, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или трубка проксимального давления и СО2 производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга содержания углекислого газа производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

13. Маски анестезиологические, маски анестезиологические для взрослых, детей, младенцев и новорожденных: стандартные и применяемые при МРТ, анатомические и с

воздушной подушкой, с клапаном и без, с крепежным хомутом и без, размеры № 0, №1, №2, №3, №4, №5, №6 производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маски производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или маски наркозные производства "Смите Медикал Интернэшнл Лимитед», Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/05401,

или Маска дыхательная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286

или Маски анестезиологические MEDEREN в вариантах исполнения производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/8818 - не более 100 шт. (при необходимости).

14. Маски кислородные, маски кислородные, для взрослых и детей, одиночные и в комплекте: с трубкой кислородной; с трубкой кислородной и мешком дыхательным производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маски производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или кислородная маска HC407NIV, HC431NIV, HC452NIV, RD806-10, RD807-10, 900RT004, 900RT005, 900RT006 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или маски кислородные неонатальные: RD803-10, RD804-10, RD805-10, RD806-10, RD807-10, маски кислородные для взрослых: 900RT004, 900RT005, маски кислородные для детей 900RT006 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или маска кислородная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

15. Маски аэрозольные, маски аэрозольные для взрослых и детей, одиночные и в комплекте: с нерегулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с регулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с небулайзером и без производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маска аэрозольная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

16. Маски лицевые, маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные и лицевые) различных размеров (малый, средний и большой), маски для СРАР производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или набор масок RD800-EN (5 шт.) производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или маска дыхательная однократного применения в индивидуальной упаковке с этикеткой, в следующих размерах: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6, принадлежности: маскодержатель производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7995- не более 100 шт. (при необходимости).

17. Мешок для дыхательного контура, одноразового использования, мешок резервный, производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или резервные мешки производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные мешки объёмом: 0.5л, 1.0л, 1.3л, 2.0л, 2.3л, 3.0л, 5.0л: для анестезиологических или реанимационных дыхательных контуров с петлёй или без, с открытым или закрытым концом; для аппаратуры; для оксигенации с дыхательным клапаном с трубкой или без производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или мешок дыхательный (латекс) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или мешки (дыхательные и резервные, объемом 0.5 л, 1.0 л, 2.0 л, 3.0 л) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или мешок дыхательный реанимационный для ИВЛ производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или мешки производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или мешок одноразовый, варианты исполнения: G-118000; G-118001; G-118002 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или мешки резервные дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742

или мешок дыхательный однократного применения, объем 500 мл, мешок дыхательный однократного применения, объем 1000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объем 2000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объем 3000 мл производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/6773 - не более 100 шт. (при необходимости).

18. Монитор давления, линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 - не более 100 шт. (при необходимости).

19. Мундштук, мундштуки производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или мундштуки (загубники) производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

20. Распылитель аэрозоля (небулайзер), небулайзеры (распылители трахеобронхиального и альвеолярного осаждения) и резервуары небулайзеров, одиночные и в наборах (с маской аэрозольной, с коннектором или без, с фильтром или без, с кислородной трубкой) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или распылители (небулайзеры) производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или небулайзеры дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

21. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или коннектор угловой производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: жесткие; эластомерные; гибкие; шарнирные; прямые; угловые; Т-образные; Y-образные; адаптеры производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или гибкие соединители дыхательного контура производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннектор (угольник), варианты исполнения: G-311011; G-311012; G-311015; G-311015-0; G-311015-1; G-311015-R; G-311015-R2; G-311022; G-311025; G-311025-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094, RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или переходники для дыхательных контуров производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

22. Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, фильтры тепловлагообменные: фильтры тепловлагообменные угловой конфигурации: взрослые, педиатрические, взрослые/педиатрические, фильтры тепловлагообменные прямые: взрослые, педиатрические, взрослые/педиатрические производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или фильтры производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или фильтры производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или фильтры производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020 производства АО "НПП "ИНТЕРОКО", Россия, РУ № ФСР 2011/11397,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции легких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8405,

или фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции легких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8705,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником НЕРА, фильтр дыхательный бактериально-вирусный педиатрический с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный педиатрический с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный неонатальный с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор. , фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана и кислородной трубкой, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги и кислородной трубкой, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, Т-образный, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги и кислородной трубкой, Т-образный, для трахеостомы производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/9010,

или фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, НЕРА, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, угловой, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, НЕРА, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, Ø 15F, с

кислородным портом Ø 6 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 6 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 5 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 3 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 2 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Small, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, угловой Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Small, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2020/9671 - не более 100 шт. (при необходимости).

23. Термометр, термометр 900MR033 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

24. Тест-колпачок защитный по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

25. Тестовое легкое, тестовые легкие: RD020-01, 500RD106 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 2 шт. (при необходимости).

26. Фильтры дыхательные, Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020 производства АО "НПП "ИНТЕРОКО", Россия, РУ № ФСР 2011/11397,

или фильтр вирусный производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или фильтры производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или фильтры производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные вирусно-бактериальные фильтры в комплекте с соединителями или без: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или фильтры производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или фильтр дыхательный производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или фильтр, варианты исполнения: 800-51700-0; 800-51700; 800-61600; 800-51900; 800-51900-0; 800-51900-11; 800-51800; 800-52000; 800-51500; 800-51600; 800-54011; 800-52300 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или фильтр RT019, RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или фильтр выдоха RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или фильтры дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7282,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8405,

или фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8705,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный НЕРА производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/9010,

или фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22M/15F, 22F, фильтр дыхательный линии давления 0,2 µm производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2020/9671 - не более 100 шт. (при необходимости).

II. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: анестезиологические, циркуляционные, в составе:

1. Трубка гофрированная, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубка соединительная, трубка дыхательная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или трубки дыхательного контура однократного использования (этилвинилацетат), трубки дыхательного контура однократного использования гофрированные (этиленвинилацетат) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или дыхательные шланги (длиной 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 180 см, 300 см, 400 см) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или дыхательные шланги производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или трубки дыхательные производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или дыхательные шланги в комплекте с соединителями или без: шланги для дыхательных контуров; шланги для эвакуации отработанных газов производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или трубка дыхательная производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или трубки дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 20 шт.

2. Y-образный коннектор, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или коннектор Y-образный производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или Y-образный адаптер (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннекторы (Y-образные) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: Y-образные производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - тройник пациента производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или коннектор (тройник пациента), варианты исполнения: E-1030-01-2; G-311010; E-1031-04; G-313005; G-313005-00; G-313005-00-1; G-313005-11; G-313005-11-1; G-311010-1;

G-311030; G-311032 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или тройник пациента RT029, 900MR125, 900MR126, 900MR126C, 900MR126L, 900MR127, 900MR128, 900MR128L, 900MR136, 900MR138, 900MR145, 900MR145C производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или тройник пациента неонатальный RT029 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 3 шт.

3. Адаптер кислорода, соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 - не более 100 шт. (при необходимости).

4. Влагосборник, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или влагосборник производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или влагосборники: - влагосборник однократного использования (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол) производства Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или влагосборники для дыхательных контуров для взрослых и детей производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или влагосборники производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или влагосборники для дыхательных контуров для взрослых, для детей и для новорождённых. производства "Интересджикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или влагосборники производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или влагосборник одноразовый, варианты исполнения: G-313001; G-313001-0; G-313001-00; G-313001-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или влагосборник 900MR139, 900MR139C производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или влагосборники дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

5. Держатель контура дыхательного, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или держатель шлангов RT028 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 5 шт.

6. Держатель масок, держатели для масок (длиной 440 мм и 700 мм) и фиксаторы для шлангов и трубок производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или ремни на голову BC325-10, BC328-10, BC331-10, ремни на подбородок BC351-10, BC353-10, BC355-10, BC357-10 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

7. Канюли назальные, канюли назальные для взрослых, детей и младенцев производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или канюли носовые для недоношенных детей: RT091, BC2425-20, канюли носовые для новорожденных детей: RT092, BC2435-20, канюли носовые для младенцев: RT093, BC2745-20, канюли носовые для детей: RT094, BC3780-20, канюли носовые для взрослых RT095, канюли носовые для крупных младенцев BC2755-20 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или канюли назальные кислородные MEDEREN в следующих вариантах исполнения производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2018/7623

или канюля назальная кислородная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

8. Канюли назальные (типа RAM), канюли назальные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229,
- не более 100 шт. (при необходимости).

9. Кислородная трубка, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубки кислородные постоянного и переменного сечения производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или шланги кислородные производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или трубка кислородная (вид 156030) производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или кислородная трубка BC400-10, BC402-5, 500RD103, 500RD107, 500RD113, 900RD008, 900RD009, 900RT003 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или трубки кислородные: 900RT003, 900RD008, 900RD009 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или трубки кислородные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

10. Клапаны положительного давления, клапан давления, клапан РЕЕР производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, клапаны РЕЕР производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или клапаны дыхательные производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых, для детей; предохранительные клапаны сброса; управляемые клапаны выдоха; клапаны РЕЕР; клапаны Вентури регулируемые и нерегулируемые; клапаны реверсивные и нереверсивные; клапаны с линиями мониторинга (или без) и управления производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

11. Клапан нереверсивный, клапан контроля производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, управляемые клапаны выдоха, клапаны РЕЕР, клапаны Вентури, регулируемые и нерегулируемые, клапаны реверсивные и нереверсивные производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или клапаны дыхательные производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых, для детей; предохранительные клапаны сброса; клапаны нереверсивные; клапаны с линиями мониторинга (или без) производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

12. Линии контроля давления, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубка соединительная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга давления. производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или трубка измерения давления в контуре 900MR075, 900MR076, 900MR077 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

13. Линия мониторинга газов, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или трубка проксимального давления и CO₂ производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга содержания углекислого газа производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

14. Маски анестезиологические, маски анестезиологические для взрослых, детей, младенцев и новорожденных: стандартные и применяемые при МРТ, анатомические и с воздушной подушкой, с клапаном и без, с крепежным хомутом и без, размеры № 0, №1, №2, №3, №4, №5, №6 производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маски производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или маски наркозные производства "Смите Медикал Интернэшнл Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/05401,

или Маска дыхательная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286

или Маски анестезиологические MEDEREN в вариантах исполнения производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/8818 - не более 100 шт. (при необходимости).

15. Маски кислородные, маски кислородные, для взрослых и детей, одиночные и в комплекте: с трубкой кислородной; с трубкой кислородной и мешком дыхательным производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маски производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или кислородная маска HC407NIV, HC431NIV, HC452NIV, RD806-10, RD807-10, 900RT004, 900RT005, 900RT006 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или маски кислородные неонатальные: RD803-10, RD804-10, RD805-10, RD806-10, RD807-10, маски кислородные для взрослых: 900RT004, 900RT005, маски кислородные для детей 900RT006 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или маска кислородная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

16. Маски аэрозольные, маски аэрозольные для взрослых и детей, одиночные и в комплекте: с нерегулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с регулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с небулайзером и без производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маска аэрозольная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

17. Маски лицевые, маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные и лицевые) различных размеров (малый, средний и большой), маски для СРАР производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или набор масок RD800-EN (5 шт.) производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или маска дыхательная однократного применения в индивидуальной упаковке с этикеткой, в следующих размерах: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6, принадлежности: маскодержатель производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7995 - не более 100 шт. (при необходимости).

18. Мешок для дыхательного контура, одноразового использования, мешок резервный, производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или резервные мешки производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные мешки объёмом: 0.5л, 1.0л, 1.3л, 2.0л, 2.3л, 3.0л, 5.0л: для анестезиологических или реанимационных дыхательных контуров с петлёй или без, с открытым или закрытым концом; для аппаратуры; для оксигенации с дыхательным клапаном с трубкой или без производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или мешок дыхательный (латекс) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или мешки (дыхательные и резервные, объёмом 0.5 л, 1.0 л, 2.0 л, 3.0 л) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или мешок дыхательный реанимационный для ИВЛ производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или мешки производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или мешок одноразовый, варианты исполнения: G-118000; G-118001; G-118002 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или мешки резервные дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742

или мешок дыхательный однократного применения, объём 500 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 1000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 2000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 3000 мл производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/6773 - не более 100 шт. (при необходимости).

19. Монитор давления, линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 - не более 100 шт. (при необходимости).

20. Мундштук, мундштуки производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или мундштуки (загубники) производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

21. Распылитель аэрозоля (небулайзер), небулайзеры (распылители трахеобронхиального и альвеолярного осаждения) и резервуары небулайзеров, одиночные и в наборах (с маской аэрозольной, с коннектором или без, с фильтром или без, с кислородной трубкой) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или распылители (небулайзеры) производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или небулайзеры дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

22. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или коннектор угловой производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286, или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: жесткие; эластомерные; гибкие; шарнирные; прямые; угловые; Т-образные; Y-образные; адаптеры производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или гибкие соединители дыхательного контура производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннектор (угольник), варианты исполнения: G-311011; G-311012; G-311015; G-311015-0; G-311015-1; G-311015-R; G-311015-R2; G-311022; G-311025; G-311025-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094, RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или переходники для дыхательных контуров производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

23. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или угловые адаптеры производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - переходник прямой; - переходник Т-образный; - угловой производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или переходники производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или воздуховоды производства "Смите Медикал Интернэшнл Лимитед», Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/05401,

или коннектор (адаптор), варианты исполнения: G-311000; G-311000-1; G-311001; G-311001-1; G-311002; G-311003; G-311003-2; G-311003-3; G-311004; G-311004-2; G-311005; G-311006; G-311008-1; G-311017; G-311019; G-311019-2; G-311024; G-311031; V-1022-02; 9014-D; G-311008; G-311008-2; G-311039; G-311003-2; G-311003-2-1; G-311004-3; G-311031-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или угловой адаптер (22 mm F - 22 mm M/15 mm F) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12372,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094,

RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 100 шт.

24. Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, фильтры тепловлагообменные: фильтры тепловлагообменные угловой конфигурации: взрослые, педиатрические, взрослые/педиатрические, фильтры тепловлагообменные прямые: взрослые, педиатрические, взрослые/педиатрические производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или фильтры производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или фильтры производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или фильтры производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020 производства АО "НПП "ИНТЕРОКО", Россия, РУ № ФСР 2011/11397,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции легких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8405,

или фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции легких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8705,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником НЕРА, фильтр дыхательный бактериально-вирусный педиатрический с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный педиатрический с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный неонатальный с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор, , фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана и кислородной трубкой, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги и кислородной трубкой, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, Т-образный, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги и кислородной трубкой, Т-образный, для трахеостомы производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/9010,

или фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, НЕРА, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, угловой, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, НЕРА, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, Ø 15F, с

кислородным портом Ø 6 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 6 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 5 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 3 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 2 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, угловой Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2020/9671 - не более 100 шт. (при необходимости).

25. Термометр, термометр 900MR033 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

26. Тест-колпачок защитный по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

27. Тестовое легкое, тестовые легкие: RD020-01, 500RD106 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 2 шт. (при необходимости).

28. Фильтры дыхательные, Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020 производства АО "НПП "ИНТЕРОКО", Россия, РУ № ФСР 2011/11397,

или фильтр вирусный производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или фильтры производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или фильтры производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные вирусно-бактериальные фильтры в комплекте с соединителями или без: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или фильтры производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или фильтр дыхательный производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или фильтр, варианты исполнения: 800-51700-0; 800-51700; 800-61600; 800-51900; 800-51900-0; 800-51900-11; 800-51800; 800-52000; 800-51500; 800-51600; 800-54011; 800-52300 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или фильтр RT019, RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или фильтр выдоха RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или фильтры дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7282,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8405,

или фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8705,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный НЕРА производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/9010,

или фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22M/15F, 22F, фильтр дыхательный линии давления 0,2 µm производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2020/9671 - не более 100 шт. (при необходимости).

III. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения; реанимационные, в составе:

1. Трубка гофрированная, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубка соединительная, трубка дыхательная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или трубки дыхательного контура однократного использования (этилвинилацетат), трубки дыхательного контура однократного использования гофрированные (этиленвинилацетат) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или дыхательные шланги (длиной 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 180 см, 300 см, 400 см) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или дыхательные шланги производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или трубки дыхательные производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или дыхательные шланги в комплекте с соединителями или без: шланги для дыхательных контуров; шланги для эвакуации отработанных газов производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или трубка дыхательная производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или трубки дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 6 шт.

2. Коннектор прямой, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992 - не более 15 шт.

3. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или угловые адаптеры производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - переходник прямой; - переходник Т-образный; - угловой производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или переходники производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или воздуховоды производства "Смите Медикал Интернэшнл Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/05401,

или коннектор (адаптор), варианты исполнения: G-311000; G-311000-1; G-311001; G-311001-1; G-311002; G-311003; G-311003-2; G-311003-3; G-311004; G-311004-2; G-311005; G-311006; G-311008-1; G-311017; G-311019; G-311019-2; G-311024; G-311031; V-1022-02; 9014-D; G-311008; G-311008-2; G-311039; G-311003-2; G-311003-2-1; G-311004-3; G-311031-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или угловой адаптер (22 mm F - 22 mm M/15 mm F) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12372,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094, RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 5 шт.

4. Адаптер кислорода, соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 - не более 100 шт. (при необходимости).

5. Влагосборник, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или влагосборник производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или влагосборники: - влагосборник однократного использования (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол) производства Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или влагосборники для дыхательных контуров для взрослых и детей производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или влагосборники производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или влагосборники для дыхательных контуров для взрослых, для детей и для новорождённых. производства "Интересджикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или влагосборники производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или влагосборник одноразовый, варианты исполнения: G-313001; G-313001-0; G-313001-00; G-313001-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или влагосборник 900MR139, 900MR139C производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или влагосборники дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

6. Генератор дыхания, производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229 - не более 100 шт. (при необходимости).

7. Держатель контура дыхательного, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или держатель шлангов RT028 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 5 шт. (при необходимости).

8. Держатель масок, держатели для масок (длиной 440 мм и 700 мм) и фиксаторы для шлангов и трубок производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566, или ремни на голову BC325-10, BC328-10, BC331-10, ремни на подбородок BC351-10, BC353-10, BC355-10, BC357-10 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

9. Канюли для СРАР-терапии, канюли назальные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229

Или канюли назальные СРАР производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286

- не более 100 шт. (при необходимости).

10. Канюли назальные, канюли назальные для взрослых, детей и младенцев производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или канюли носовые для недоношенных детей: RT091, BC2425-20, канюли носовые для новорожденных детей: RT092, BC2435-20, канюли носовые для младенцев: RT093, BC2745-20, канюли носовые для детей: RT094, BC3780-20, канюли носовые для взрослых RT095, канюли носовые для крупных младенцев BC2755-20 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или канюли назальные кислородные MEDEREN в следующих вариантах исполнения производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2018/7623

или канюля назальная кислородная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

11. Канюли назальные (типа RAM), канюли назальные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229,

- не более 100 шт. (при необходимости).

12. Кислородная трубка, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубки кислородные постоянного и переменного сечения производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или шланги кислородные производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или трубка кислородная (вид 156030) производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или кислородная трубка BC400-10, BC402-5, 500RD103, 500RD107, 500RD113, 900RD008, 900RD009, 900RT003 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или трубки кислородные: 900RT003, 900RD008, 900RD009 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или трубки кислородные производства "Интаир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

13. Камера для увлажнителей дыхательных смесей, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или увлажнители (камеры увлажнителя) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или камера увлажнителя MR225, MR225X, MR250, MR250X, MR290, MR290X, MR340, MR370 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или камеры увлажнителя взрослые: MR210, MR210X, MR250, MR250X, камеры увлажнителя детские: MR225, MR225X, камеры увлажнителя универсальные: MR290, MR290X, MR290U, MR290UX, MR290V, MR290VX, MR290HFV, производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или увлажнители дыхательные производства "Интаир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742,

или увлажнители производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или Камера увлажнителя (вид 185610) производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С. ", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053 – не более 100 шт. (при необходимости).

14. Клапан выдоха, клапан вдоха/выдоха производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или дыхательные клапаны: управляемые клапаны выдоха; клапаны с линиями мониторинга (или без) и управления производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, управляемые клапаны выдоха, клапаны РЕЕР, клапаны Вентури, регулируемые и нерегулируемые, клапаны реверсивные и нереверсивные производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или клапаны дыхательные производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992 - не более 100 шт. (при необходимости).

15. Клапаны положительного давления, клапан давления, клапан РЕЕР производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, клапаны РЕЕР производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или клапаны дыхательные производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых, для детей; предохранительные клапаны сброса; управляемые клапаны выдоха; клапаны РЕЕР; клапаны Вентури регулируемые и нерегулируемые; клапаны реверсивные и нереверсивные; клапаны с линиями мониторинга (или без) и управления производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

16. Клапан нереверсивный, одноразового использования, клапан контроля производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, управляемые клапаны выдоха, клапаны РЕЕР, клапаны Вентури, регулируемые и нерегулируемые, клапаны реверсивные и нереверсивные производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или клапаны дыхательные производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых, для детей; предохранительные клапаны сброса; клапаны нереверсивные; клапаны с линиями мониторинга (или без) производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

17. Линии контроля давления, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубка соединительная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга давления. производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или трубка измерения давления в контуре 900MR075, 900MR076, 900MR077 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

18. Линия мониторинга газов, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или трубка проксимального давления и CO2 производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга содержания углекислого газа производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

19. Линия подачи воды по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

20. Маски анестезиологические, маски анестезиологические для взрослых, детей, младенцев и новорожденных: стандартные и применяемые при МРТ, анатомические и с воздушной подушкой, с клапаном и без, с крепежным хомутом и без, размеры № 0, №1, №2, №3, №4, №5, №6 производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маски производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или маски наркозные производства "Смите Медикал Интернэшнл Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/05401,

или Маска дыхательная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286

или Маски анестезиологические MEDEREN в вариантах исполнения производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/8818 - не более 100 шт. (при необходимости).

21. Маски кислородные, маски кислородные, для взрослых и детей, одиночные и в комплекте: с трубкой кислородной; с трубкой кислородной и мешком дыхательным производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маски производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или кислородная маска HC407NIV, HC431NIV, HC452NIV, RD806-10, RD807-10, 900RT004, 900RT005, 900RT006 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или маски кислородные неонатальные: RD803-10, RD804-10, RD805-10, RD806-10, RD807-10, маски кислородные для взрослых: 900RT004, 900RT005, маски кислородные для детей 900RT006 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или маска кислородная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

22. Маски аэрозольные, маски аэрозольные для взрослых и детей, одиночные и в комплекте: с нерегулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с регулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с небулайзером и без производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маска аэрозольная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

23. Маска носовая аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях, маски лицевые дыхательные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229,

или маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные) различных размеров (малый, средний и большой) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маски носовые: RT033, RT034, RT042, RT050, RT051, RT052 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 100 шт. (при необходимости).

24. Маска лицевая аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях, одноразового использования, маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: маски для СРАР производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маска СРАР/NIPPV производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

25. Маски лицевые, маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные и лицевые) различных размеров (малый, средний и большой), маски для СРАР производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или набор масок RD800-EN (5 шт.) производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или маска дыхательная однократного применения в индивидуальной упаковке с этикеткой, в следующих размерах: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6, принадлежности: маскодержатель производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7995 - не более 100 шт. (при необходимости).

26. Мешок для дыхательного контура, одноразового использования, мешок резервный, производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или резервные мешки производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные мешки объёмом: 0.5л, 1.0л, 1.3л, 2.0л, 2.3л, 3.0л, 5.0л: для анестезиологических или реанимационных дыхательных контуров с петлёй или без, с открытым или закрытым концом; для аппаратуры; для оксигенации с дыхательным клапаном с трубкой или без производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или мешок дыхательный (латекс) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или мешки (дыхательные и резервные, объёмом 0.5 л, 1.0 л, 2.0 л, 3.0 л) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или мешок дыхательный реанимационный для ИВЛ производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или мешки производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или мешок одноразовый, варианты исполнения: G-118000; G-118001; G-118002 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или мешки резервные дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742

или мешок дыхательный однократного применения, объём 500 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 1000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 2000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 3000 мл производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/6773 - не более 100 шт. (при необходимости).

27. Монитор давления, линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления) производства

"ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 - не более 100 шт. (при необходимости).

28. Мундштук, мундштуки производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или мундштуки (загубники) производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

29. Отражатели тепла, отражатели тепла: 900MR208, NC040-10, NC041-10 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 100 шт. (при необходимости).

30. Распылитель аэрозоля (небулайзер), небулайзеры (распылители трахеобронхиального и альвеолярного осаждения) и резервуары небулайзеров, одиночные и в наборах (с маской аэрозольной, с коннектором или без, с фильтром или без, с кислородной трубкой) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или распылители (небулайзеры) производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или небулайзеры дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

31. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или коннектор угловой производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: жесткие; эластомерные; гибкие; шарнирные; прямые; угловые; Т-образные; Y-образные; адаптеры производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или гибкие соединители дыхательного контура производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннектор (угольник), варианты исполнения: G-311011; G-311012; G-311015; G-311015-0; G-311015-1; G-311015-R; G-311015-R2; G-311022; G-311025; G-311025-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094, RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или переходники для дыхательных контуров производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

32. Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, фильтры тепловлагообменные: фильтры тепловлагообменные угловой конфигурации: взрослые, педиатрические, взрослые/педиатрические, фильтры тепловлагообменные прямые: взрослые, педиатрические, взрослые/педиатрические производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или фильтры производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или фильтры производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или фильтры производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020 производства АО "НПП "ИНТЕРОКО", Россия, РУ № ФСР 2011/11397,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции легких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8405,

или фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции легких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8705,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником НЕРА, фильтр дыхательный бактериально-вирусный педиатрический с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный педиатрический с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный неонатальный с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор. , фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана и кислородной трубкой, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги и кислородной трубкой, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, Т-образный, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги и кислородной трубкой, Т-образный, для трахеостомы производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/9010,

или фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, НЕРА, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, угловой, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, НЕРА, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, Ø 15F, с кислородным портом Ø 6 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 6 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 5 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 3 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 2 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, угловой Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2020/9671 - не более 100 шт. (при необходимости).

33. Термометр, термометр 900MR033 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

34. Тест-колпачок защитный по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

35. Фильтры дыхательные, Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020 производства АО "НПП "ИНТЕРОКО", Россия, РУ № ФСР 2011/11397,

или фильтр вирусный производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или фильтры производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или фильтры производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные вирусно-бактериальные фильтры в комплекте с соединителями или без: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или фильтры производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или фильтр дыхательный производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или фильтр, варианты исполнения: 800-51700-0; 800-51700; 800-61600; 800-51900; 800-51900-0; 800-51900-11; 800-51800; 800-52000; 800-51500; 800-51600; 800-54011; 800-52300 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или фильтр RT019, RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или фильтр выдоха RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или фильтры дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7282,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8405,

или фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8705,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный НЕРА производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/9010,

или фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22M/15F, 22F, фильтр дыхательный линии давления 0,2 µm производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2020/9671 - не более 100 шт. (при необходимости).

36. Шапочки-фиксаторы дыхательные, шапочки-фиксаторы дыхательные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229,

или колпак BC300-05, BC303-05, BC306-05, BC309-05, BC360-SK производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

37. Y-образный коннектор, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или коннектор Y-образный производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или Y-образный адаптер (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннекторы (Y-образные) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: Y-образные производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - тройник пациента производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или коннектор (тройник пациента), варианты исполнения: E-1030-01-2; G-311010; E-1031-04; G-313005; G-313005-00; G-313005-00-1; G-313005-11; G-313005-11-1; G-311010-1; G-311030; G-311032 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или тройник пациента RT029, 900MR125, 900MR126, 900MR126C, 900MR126L, 900MR127, 900MR128, 900MR128L, 900MR136, 900MR138, 900MR145, 900MR145C производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или тройник пациента неонатальный RT029 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 100 шт. (при необходимости).

IV. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: реанимационные, циркуляционные, в составе:

1. Трубка гофрированная, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 6 шт.

2. Коннектор прямой, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992 - не более 20 шт.

3. Y-образный коннектор, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или коннектор Y-образный производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или Y-образный адаптер (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннекторы (Y-образные) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: Y-образные производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - тройник пациента производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или коннектор (тройник пациента), варианты исполнения: E-1030-01-2; G-311010; E-1031-04; G-313005; G-313005-00; G-313005-00-1; G-313005-11; G-313005-11-1; G-311010-1; G-311030; G-311032 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или тройник пациента RT029, 900MR125, 900MR126, 900MR126C, 900MR126L, 900MR127, 900MR128, 900MR128L, 900MR136, 900MR138, 900MR145, 900MR145C производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или тройник пациента неонатальный RT029 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 3 шт.

4. Адаптер кислорода, соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 - не более 100 шт. (при необходимости).

5. Влагосборник, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или влагосборник производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или влагосборники: - влагосборник однократного использования (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол) производства Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или влагосборники для дыхательных контуров для взрослых и детей производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или влагосборники производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или влагосборники для дыхательных контуров для взрослых, для детей и для новорождённых. производства "Интересджикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или влагосборники производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или влагосборник одноразовый, варианты исполнения: G-313001; G-313001-0; G-313001-00; G-313001-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или влагосборник 900MR139, 900MR139C производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или влагосборники дыхательные производства "Интаир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

6. Держатель контура дыхательного, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или держатель шлангов RT028 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 5 шт. (при необходимости).

7. Держатель масок, держатели для масок (длиной 440 мм и 700 мм) и фиксаторы для шлангов и трубок производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или ремни на голову BC325-10, BC328-10, BC331-10, ремни на подбородок BC351-10, BC353-10, BC355-10, BC357-10 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

8. Канюли для СРАР-терапии, канюли назальные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229

Или канюли назальные СРАР производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286

- не более 100 шт. (при необходимости).

9. Канюли назальные, канюли назальные для взрослых, детей и младенцев производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,
или канюли носовые для недоношенных детей: RT091, BC2425-20, канюли носовые для новорожденных детей: RT092, BC2435-20, канюли носовые для младенцев: RT093, BC2745-20, канюли носовые для детей: RT094, BC3780-20, канюли носовые для взрослых RT095, канюли носовые для крупных младенцев BC2755-20 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,
или канюли назальные кислородные MEDEREN в следующих вариантах исполнения производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2018/7623
или канюля назальная кислородная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).
10. Канюли назальные (типа RAM), канюли назальные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229,
- не более 100 шт. (при необходимости).
11. Кислородная трубка, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,
или трубки кислородные постоянного и переменного сечения производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,
или шланги кислородные производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,
или трубка кислородная (вид 156030) производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,
или кислородная трубка BC400-10, BC402-5, 500RD103, 500RD107, 500RD113, 900RD008, 900RD009, 900RT003 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,
или трубки кислородные: 900RT003, 900RD008, 900RD009 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,
или трубки кислородные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).
12. Камера для увлажнителей дыхательных смесей, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,
или увлажнители (камеры увлажнителя) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,
или камера увлажнителя MR225, MR225X, MR250, MR250X, MR290, MR290X, MR340, MR370 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,
или камеры увлажнителя взрослые: MR210, MR210X, MR250, MR250X, камеры увлажнителя детские: MR225, MR225X, камеры увлажнителя универсальные: MR290, MR290X, MR290U, MR290UX, MR290V, MR290VX, MR290HFV, производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,
или увлажнители дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742,
или увлажнители производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,
или Камера увлажнителя (вид 185610) производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053 – не более 100 шт. (при необходимости).
13. Клапан выдоха, клапан вдоха/выдоха производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,
или дыхательные клапаны: управляемые клапаны выдоха; клапаны с линиями мониторинга (или без) и управления производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, управляемые клапаны выдоха, клапаны РЕЕР, клапаны Вентури, регулируемые и нерегулируемые, клапаны реверсивные и нереверсивные производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или клапаны дыхательные производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992 - не более 100 шт. (при необходимости).

14. Клапаны положительного давления, клапан давления, клапан РЕЕР производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, клапаны РЕЕР производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или клапаны дыхательные производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых, для детей; предохранительные клапаны сброса; управляемые клапаны выдоха; клапаны РЕЕР; клапаны Вентури регулируемые и нерегулируемые; клапаны реверсивные и нереверсивные; клапаны с линиями мониторинга (или без) и управления производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

15. Клапан нереверсивный, одноразового использования, клапан контроля производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, управляемые клапаны выдоха, клапаны РЕЕР, клапаны Вентури, регулируемые и нерегулируемые, клапаны реверсивные и нереверсивные производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или клапаны дыхательные производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых, для детей; предохранительные клапаны сброса; клапаны нереверсивные; клапаны с линиями мониторинга (или без) производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

16. Линии контроля давления, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубка соединительная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга давления. производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или трубка измерения давления в контуре 900MR075, 900MR076, 900MR077 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

17. Линия мониторинга газов, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или трубка проксимального давления и CO2 производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга содержания углекислого газа производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

18. Линия подачи воды по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

19. Маски анестезиологические, маски анестезиологические для взрослых, детей, младенцев и новорожденных: стандартные и применяемые при МРТ, анатомические и с воздушной подушкой, с клапаном и без, с крепежным хомутом и без, размеры № 0, №1, №2, №3, №4, №5, №6 производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маски производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или маски наркозные производства "Смите Медикал Интернэшнл Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/05401,

или Маска дыхательная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286

или Маски анестезиологические MEDEREN в вариантах исполнения производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/8818 - не более 100 шт. (при необходимости).

20. Маски кислородные, маски кислородные, для взрослых и детей, одиночные и в комплекте: с трубкой кислородной; с трубкой кислородной и мешком дыхательным производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маски производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или кислородная маска HC407NIV, HC431NIV, HC452NIV, RD806-10, RD807-10, 900RT004, 900RT005, 900RT006 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или маски кислородные неонатальные: RD803-10, RD804-10, RD805-10, RD806-10, RD807-10, маски кислородные для взрослых: 900RT004, 900RT005, маски кислородные для детей 900RT006 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или маска кислородная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

21. Маски аэрозольные, маски аэрозольные для взрослых и детей, одиночные и в комплекте: с нерегулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с регулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с небулайзером и без производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маска аэрозольная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

22. Маска носовая аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях, маски лицевые дыхательные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229,

или маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные) различных размеров (малый, средний и большой) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маски носовые: RT033, RT034, RT042, RT050, RT051, RT052 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 100 шт. (при необходимости).

23. Маска лицевая аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях, одноразового использования, маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: маски для СРАР производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маска СРАР/NIPPV производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

24. Маски лицевые, маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные и лицевые) различных размеров (малый, средний и большой), маски для СРАР производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или набор масок RD800-EN (5 шт.) производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или маска дыхательная однократного применения в индивидуальной упаковке с этикеткой, в следующих размерах: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6, принадлежности: маскодержатель производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7995 - не более 100 шт. (при необходимости).

25. Мешок для дыхательного контура, одноразового использования, мешок резервный, производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или резервные мешки производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные мешки объёмом: 0.5л, 1.0л, 1.3л, 2.0л, 2.3л, 3.0л, 5.0л: для анестезиологических или реанимационных дыхательных контуров с петлёй или без, с открытым или закрытым концом; для аппаратуры; для оксигенации с дыхательным клапаном с трубкой или без производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или мешок дыхательный (латекс) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или мешки (дыхательные и резервные, объемом 0.5 л, 1.0 л, 2.0 л, 3.0 л) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или мешок дыхательный реанимационный для ИВЛ производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или мешки производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или мешок одноразовый, варианты исполнения: G-118000; G-118001; G-118002 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или мешки резервные дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742

или мешок дыхательный однократного применения, объём 500 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 1000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 2000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 3000 мл производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/6773 - не более 100 шт. (при необходимости).

26. Монитор давления, линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления) "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 - не более 100 шт. (при необходимости).

27. Отражатели тепла, отражатели тепла: 900MR208, NC040-10, NC041-10 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 100 шт. (при необходимости).

28. Распылитель аэрозоля (небулайзер), небулайзеры (распылители трахеобронхиального и альвеолярного осаждения) и резервуары небулайзеров, одиночные и в наборах (с маской аэрозольной, с коннектором или без, с фильтром или без, с кислородной трубкой) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или распылители (небулайзеры) производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или небулайзеры дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

29. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или коннектор угловой производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286, или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: жесткие; эластомерные; гибкие; шарнирные; прямые; угловые; Т-образные; Y-образные; адаптеры производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или гибкие соединители дыхательного контура производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннектор (угольник), варианты исполнения: G-311011; G-311012; G-311015; G-311015-0; G-311015-1; G-311015-R; G-311015-R2; G-311022; G-311025; G-311025-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094, RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или переходники для дыхательных контуров производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

30. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или угловые адаптеры производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - переходник прямой; - переходник Т-образный; - угловой производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или переходники производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или воздуховоды производства "Смите Медикал Интернэшнл Лимитед», Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/05401,

или коннектор (адаптор), варианты исполнения: G-311000; G-311000-1; G-311001; G-311001-1; G-311002; G-311003; G-311003-2; G-311003-3; G-311004; G-311004-2; G-311005; G-311006; G-311008-1; G-311017; G-311019; G-311019-2; G-311024; G-311031; V-1022-02; 9014-D; G-311008; G-311008-2; G-311039; G-311003-2; G-311003-2-1; G-311004-3; G-311031-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или угловой адаптер (22 mm F - 22 mm M/15 mm F) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12372,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094,

RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 100 шт.

31. Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, фильтры тепловлагообменные: фильтры тепловлагообменные угловой конфигурации: взрослые, педиатрические, взрослые/педиатрические, фильтры тепловлагообменные прямые: взрослые, педиатрические, взрослые/педиатрические производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или фильтры производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или фильтры производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или фильтры производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020 производства АО "НПП "ИНТЕРОКО", Россия, РУ № ФСР 2011/11397,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции легких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8405,

или фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции легких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8705,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником НЕРА, фильтр дыхательный бактериально-вирусный педиатрический с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный педиатрический с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный неонатальный с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор, , фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана и кислородной трубкой, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги и кислородной трубкой, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, Т-образный, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги и кислородной трубкой, Т-образный, для трахеостомы производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/9010,

или фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, НЕРА, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, угловой, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, НЕРА, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, Ø 15F, с

кислородным портом Ø 6 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 6 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 5 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 3 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 2 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Small, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, угловой Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Small, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2020/9671 - не более 100 шт. (при необходимости).

32. Термометр, термометр 900MR033 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

33. Тест-колпачок защитный по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

34. Тестовое легкое, тестовые легкие: RD020-01, 500RD106 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 2 шт. (при необходимости).

35. Фильтры дыхательные, Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020 производства АО "НПП "ИНТЕРОКО", Россия, РУ № ФСР 2011/11397,

или фильтр вирусный производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или фильтры производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или фильтры производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные вирусно-бактериальные фильтры в комплекте с соединителями или без: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или фильтры производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или фильтр дыхательный производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или фильтр, варианты исполнения: 800-51700-0; 800-51700; 800-61600; 800-51900; 800-51900-0; 800-51900-11; 800-51800; 800-52000; 800-51500; 800-51600; 800-54011; 800-52300 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или фильтр RT019, RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или фильтр выдоха RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или фильтры дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7282,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8405,

или фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8705,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный НЕРА производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/9010,

или фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22M/15F, 22F, фильтр дыхательный линии давления 0,2 мПа производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2020/9671 - не более 100 шт. (при необходимости).

V. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: реанимационные, с встроенным нагревательным элементом, в составе:

1. Трубка гофрированная обогреваемая по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия, не более 2 шт.

2. Трубка гофрированная, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубка соединительная, трубка дыхательная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или трубки дыхательного контура однократного использования (этилвинилацетат), трубки дыхательного контура однократного использования гофрированные (этиленвинилацетат) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или дыхательные шланги (длиной 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 180 см, 300 см, 400 см) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или дыхательные шланги производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или трубки дыхательные производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или дыхательные шланги в комплекте с соединителями или без: шланги для дыхательных контуров; шланги для эвакуации отработанных газов производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или трубка дыхательная производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или трубки дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 5 шт.

3. Коннектор прямой, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992 - не более 15 шт.

4. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или угловые адаптеры производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - переходник прямой; - переходник Т-образный; - угловой производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или переходники производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или воздуховоды производства "Смите Медикал Интернэшнл Лимитед», Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/05401,

или коннектор (адаптор), варианты исполнения: G-311000; G-311000-1; G-311001; G-311001-1; G-311002; G-311003; G-311003-2; G-311003-3; G-311004; G-311004-2; G-311005; G-311006; G-311008-1; G-311017; G-311019; G-311019-2; G-311024; G-311031; V-1022-02; 9014-D; G-311008; G-311008-2; G-311039; G-311003-2; G-311003-2-1; G-311004-3; G-311031-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или угловой адаптер (22 mm F - 22 mm M/15 mm F) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12372,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094, RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 5 шт.

5. Влагосборник, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или влагосборник производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или влагосборники: - влагосборник однократного использования (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол) производства Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или влагосборники для дыхательных контуров для взрослых и детей производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или влагосборники производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или влагосборники для дыхательных контуров для взрослых, для детей и для новорождённых. производства "Интересджикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или влагосборники производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или влагосборник одноразовый, варианты исполнения: G-313001; G-313001-0; G-313001-00; G-313001-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или влагосборник 900MR139, 900MR139C производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или влагосборники дыхательные производства "Интаир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

6. Генератор дыхания, производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229 - не более 100 шт. (при необходимости).

7. Держатель контура дыхательного, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или держатель шлангов RT028 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 5 шт. (при необходимости).

8. Держатель масок, держатели для масок (длиной 440 мм и 700 мм) и фиксаторы для шлангов и трубок производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или ремни на голову BC325-10, BC328-10, BC331-10, ремни на подбородок BC351-10, BC353-10, BC355-10, BC357-10 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

9. Канюли для СРАР-терапии, канюли назальные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229

Или канюли назальные СРАР производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286

- не более 100 шт. (при необходимости).

10. Канюли назальные, канюли назальные для взрослых, детей и младенцев производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или канюли носовые для недоношенных детей: RT091, BC2425-20, канюли носовые для новорожденных детей: RT092, BC2435-20, канюли носовые для младенцев: RT093, BC2745-20, канюли носовые для детей: RT094, BC3780-20, канюли носовые для взрослых RT095, канюли носовые для крупных младенцев BC2755-20 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или канюли назальные кислородные MEDEREN в следующих вариантах исполнения производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2018/7623

или канюля назальная кислородная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286 - не более 100 шт. (при необходимости).

11. Канюли назальные (типа RAM), канюли назальные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229,

- не более 100 шт. (при необходимости).

12. Кабель соединительный электрический к проводу для подогрева дыхательных газов, кабель гибкого нагревателя, варианты исполнения: 900MR860, 900MR861, 900MR863, 900MR868, 900MR869 производства "Фишер энд Пэйкер Хелскэр Лимитед", Новая Зеландия, РУ № РЗН 2014/1416 - не более 100 шт. (при необходимости).

13. Камера для увлажнителей дыхательных смесей, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или увлажнители (камеры увлажнителя) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или камера увлажнителя MR225, MR225X, MR250, MR250X, MR290, MR290X, MR340, MR370 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или камеры увлажнителя взрослые: MR210, MR210X, MR250, MR250X, камеры увлажнителя детские: MR225, MR225X, камеры увлажнителя универсальные: MR290, MR290X, MR290U, MR290UX, MR290V, MR290VX, MR290HFV, производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или увлажнители дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742,

или увлажнители производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или Камера увлажнителя (вид 185610) производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053 – не более 100 шт. (при необходимости).

14. Линии контроля давления, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубка соединительная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга давления. производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или трубка измерения давления в контуре 900MR075, 900MR076, 900MR077 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

15. Линия мониторинга газов, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или трубка проксимального давления и CO2 производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга содержания углекислого газа производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

16. Линия подачи воды по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

17. Маски анестезиологические, маски анестезиологические для взрослых, детей, младенцев и новорожденных: стандартные и применяемые при МРТ, анатомические и с воздушной подушкой, с клапаном и без, с крепежным хомутом и без, размеры № 0, №1, №2, №3, №4, №5, №6 производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или маски производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или маски наркозные производства "Смите Медикал Интернэшнл Лимитед», Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/05401,

или Маска дыхательная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286

или Маски анестезиологические MEDEREN в вариантах исполнения производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/8818 - не более 100 шт. (при необходимости).

18. Маски лицевые, маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные и лицевые) различных размеров (малый, средний и большой), маски для СРАР производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или набор масок RD800-EN (5 шт.) производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или маска дыхательная однократного применения в индивидуальной упаковке с этикеткой, в следующих размерах: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6, принадлежности: маскодержатель производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7995 - не более 100 шт. (при необходимости).

19. Мешок для дыхательного контура, одноразового использования, мешок резервный, производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или резервные мешки производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные мешки объёмом: 0.5л, 1.0л, 1.3л, 2.0л, 2.3л, 3.0л, 5.0л: для анестезиологических или реанимационных дыхательных контуров с петлёй или без, с открытым или закрытым концом; для аппаратуры; для оксигенации с дыхательным клапаном с трубкой или без производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или мешок дыхательный (латекс) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или мешки (дыхательные и резервные, объемом 0.5 л, 1.0 л, 2.0 л, 3.0 л) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или мешок дыхательный реанимационный для ИВЛ производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или мешки производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или мешок одноразовый, варианты исполнения: G-118000; G-118001; G-118002 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или мешки резервные дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742

или мешок дыхательный однократного применения, объём 500 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 1000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 2000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 3000 мл производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/6773 - не более 100 шт. (при необходимости).

20. Монитор давления, линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 - не более 100 шт. (при необходимости).

21. Отражатели тепла, отражатели тепла: 900MR208, NC040-10, NC041-10 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 100 шт. (при необходимости).

22. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или коннектор угловой производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286, или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: жесткие; эластомерные; гибкие; шарнирные; прямые; угловые; Т-образные; Y-образные; адаптеры производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или гибкие соединители дыхательного контура производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннектор (угольник), варианты исполнения: G-311011; G-311012; G-311015; G-311015-0; G-311015-1; G-311015-R; G-311015-R2; G-311022; G-311025; G-311025-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094, RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или переходники для дыхательных контуров производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

23. Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, фильтры тепловлагообменные: фильтры тепловлагообменные угловой конфигурации: взрослые, педиатрические, взрослые/педиатрические, фильтры тепловлагообменные прямые: взрослые, педиатрические, взрослые/педиатрические производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или фильтры производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или фильтры производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или фильтры производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020 производства АО "НПП "ИНТЕРОКО", Россия, РУ № ФСР 2011/11397,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции легких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8405,

или фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции легких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8705,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником НЕРА, фильтр дыхательный бактериально-вирусный педиатрический с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный педиатрический с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный неонатальный с тепловлагообменником из бумаги, прямой коннектор. , фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана и кислородной трубкой, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги и кислородной трубкой, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из пенополиуретана, Т-образный, для трахеостомы, фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником из бумаги и кислородной трубкой, Т-образный, для трахеостомы производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/9010,

или фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, НЕРА, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, с портом Луер-Лок, угловой, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, без порта Луер-Лок, НЕРА, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, Ø 15F, с кислородным портом Ø 6 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 6 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 5 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 3 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, трахеостомический, с кислородным портом Ø 6 мм и портом для санации Ø 2 мм, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Small, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, угловой Ø 22F/15М, 22М/15F, фильтр дыхательный, тепловлагообменный,

бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Small, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, теплообменный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2020/9671 - не более 100 шт. (при необходимости).

24. Термометр, термометр 900MR033 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

25. Тест-колпачок защитный по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

26. Тестовое легкое, тестовые легкие: RD020-01, 500RD106 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 2 шт. (при необходимости).

27. Фильтры дыхательные, Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020 производства АО "НПП "ИНТЕРОКО", Россия, РУ № ФСР 2011/11397,

или фильтр вирусный производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или фильтры производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или фильтры производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные вирусно-бактериальные фильтры в комплекте с соединителями или без: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или фильтры производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или фильтр дыхательный производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или фильтр, варианты исполнения: 800-51700-0; 800-51700; 800-61600; 800-51900; 800-51900-0; 800-51900-11; 800-51800; 800-52000; 800-51500; 800-51600; 800-54011; 800-52300 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или фильтр RT019, RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или фильтр выдоха RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или фильтры дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7282,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8405,

или фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8705,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный НЕРА производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/9010,

или фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22M/15F, 22F, фильтр дыхательный линии давления 0,2 µm производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2020/9671 - не более 100 шт. (при необходимости).

28. Шапочки-фиксаторы дыхательные, шапочки-фиксаторы дыхательные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229,

или колпак ВС300-05, ВС303-05, ВС306-05, ВС309-05, ВС360-SK производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

VI. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: реанимационные, циркуляционные, с встроенным нагревательным элементом, в составе:

1. Трубка гофрированная, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубка соединительная, трубка дыхательная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или трубки дыхательного контура однократного использования (этилвинилацетат), трубки дыхательного контура однократного использования гофрированные (этиленвинилацетат) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или дыхательные шланги (длиной 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 180 см, 300 см, 400 см) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или дыхательные шланги производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или трубки дыхательные производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или дыхательные шланги в комплекте с соединителями или без: шланги для дыхательных контуров; шланги для эвакуации отработанных газов производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или трубка дыхательная производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или трубки дыхательные производства "Интаир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 5 шт.

2. Трубка гофрированная обогреваемая по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 3 шт.

3. Влагосборник, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или влагосборник производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или влагосборники: - влагосборник однократного использования (полисульфон, акрилонитрилбутадиестирол) производства Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или влагосборники для дыхательных контуров для взрослых и детей производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или влагосборники производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или влагосборники для дыхательных контуров для взрослых, для детей и для новорождённых. производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или влагосборники производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или влагосборник одноразовый, варианты исполнения: G-313001; G-313001-0; G-313001-00; G-313001-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или влагосборник 900MR139, 900MR139C производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или влагосборники дыхательные производства "Интаир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 3 шт. (при необходимости).

4. Коннектор прямой, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,
или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992 - не более 15 шт.
5. Y-образный коннектор, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,
или коннектор Y-образный производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,
или Y-образный адаптер (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,
или коннекторы (Y-образные) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,
или соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: Y-образные производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,
или переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - тройник пациента производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,
или коннектор (тройник пациента), варианты исполнения: E-1030-01-2; G-311010; E-1031-04; G-313005; G-313005-00; G-313005-00-1; G-313005-11; G-313005-11-1; G-311010-1; G-311030; G-311032 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,
или тройник пациента RT029, 900MR125, 900MR126, 900MR126C, 900MR126L, 900MR127, 900MR128, 900MR128L, 900MR136, 900MR138, 900MR145, 900MR145C производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,
или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,
или тройник пациента неонатальный RT029 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 3 шт.
6. Держатель контура дыхательного, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,
или держатель шлангов RT028 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 5 шт. (при необходимости).
7. Держатель масок, держатели для масок (длиной 440 мм и 700 мм) и фиксаторы для шлангов и трубок производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,
или ремни на голову BC325-10, BC328-10, BC331-10, ремни на подбородок BC351-10, BC353-10, BC355-10, BC357-10 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).
8. Канюли для СРАР-терапии, канюли назальные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229
Или канюли назальные СРАР производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286
- не более 100 шт. (при необходимости).
9. Кабель соединительный электрический к проводу для подогрева дыхательных газов, кабель гибкого нагревателя, варианты исполнения: 900MR860, 900MR861, 900MR863, 900MR868, 900MR869 производства "Фишер энд Пэйкел Хелскэр Лимитед", Новая Зеландия, РУ № РЗН 2014/1416 - не более 100 шт. (при необходимости).
10. Камера для увлажнителей дыхательных смесей, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,
или увлажнители (камеры увлажнителя) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,
или камера увлажнителя MR225, MR225X, MR250, MR250X, MR290, MR290X, MR340, MR370 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или камеры увлажнителя взрослые: MR210, MR210X, MR250, MR250X, камеры увлажнителя детские: MR225, MR225X, камеры увлажнителя универсальные: MR290, MR290X, MR290U, MR290UX, MR290V, MR290VX, MR290HFV, производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или увлажнители дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742,

или увлажнители производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или Камера увлажнителя (вид 185610) производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С. ", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053 – не более 100 шт. (при необходимости).

11. Линии контроля давления, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубка соединительная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга давления. производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или трубка измерения давления в контуре 900MR075, 900MR076, 900MR077 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

12. Линия мониторинга газов, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или трубка проксимального давления и CO2 производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга содержания углекислого газа производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

13. Линия подачи воды по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

14. Маски лицевые, маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные и лицевые) различных размеров (малый, средний и большой), маски для СРАР производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или набор масок RD800-EN (5 шт.) производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или маска дыхательная однократного применения в индивидуальной упаковке с этикеткой, в следующих размерах: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6, принадлежности: маскодержатель производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7995 - не более 100 шт. (при необходимости).

15. Мешок для дыхательного контура, одноразового использования, мешок резервный, производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или резервные мешки производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные мешки объёмом: 0.5л, 1.0л, 1.3л, 2.0л, 2.3л, 3.0л, 5.0л: для анестезиологических или реанимационных дыхательных контуров с петлёй или без, с

открытым или закрытым концом; для аппаратуры; для оксигенации с дыхательным клапаном с трубкой или без производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или мешок дыхательный (латекс)производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или мешки (дыхательные и резервные, объемом 0.5 л, 1.0 л, 2.0 л, 3.0 л) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или мешок дыхательный реанимационный для ИВЛ производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или мешки производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или мешок одноразовый, варианты исполнения: G-118000; G-118001; G-118002 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или мешки резервные дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742

или мешок дыхательный однократного применения, объём 500 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 1000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 2000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объём 3000 мл производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/6773 - не более 100 шт. (при необходимости).

16. Ограничители потока по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

17. Отражатели тепла, отражатели тепла: 900MR208, NC040-10, NC041-10 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 100 шт. (при необходимости).

18. Распылитель аэрозоля (небулайзер), небулайзеры (распылители трахеобронхиального и альвеолярного осаждения) и резервуары небулайзеров, одиночные и в наборах (с маской аэрозольной, с коннектором или без, с фильтром или без, с кислородной трубкой) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или распылители (небулайзеры) производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или небулайзеры дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

19. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или угловые адаптеры производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - переходник прямой; - переходник Т-образный; - угловой производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или переходники производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или воздуховоды производства "Смите Медикал Интернэшнл Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/05401,

или коннектор (адаптор), варианты исполнения: G-311000; G-311000-1; G-311001; G-311001-1; G-311002; G-311003; G-311003-2; G-311003-3; G-311004; G-311004-2; G-311005; G-

311006; G-311008-1; G-311017; G-311019; G-311019-2; G-311024; G-311031; V-1022-02; 9014-D; G-311008; G-311008-2; G-311039; G-311003-2; G-311003-2-1; G-311004-3; G-311031-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или угловой адаптер (22 mm F - 22 mm M/15 mm F) производства "Грейт Групп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12372,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094, RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 100 шт. (при необходимости).

20. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или коннектор угловой производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: жесткие; эластомерные; гибкие; шарнирные; прямые; угловые; Т-образные; Y-образные; адаптеры производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или гибкие соединители дыхательного контура производства "Грейт Групп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннектор (угольник), варианты исполнения: G-311011; G-311012; G-311015; G-311015-0; G-311015-1; G-311015-R; G-311015-R2; G-311022; G-311025; G-311025-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094, RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или переходники для дыхательных контуров производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

21. Термометр, термометр 900MR033 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

22. Тест-колпачок защитный по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

23. Тестовое легкое, тестовые легкие: RD020-01, 500RD106 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 2 шт. (при необходимости).

24. Фильтры дыхательные, Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020 производства АО "НПП "ИНТЕРОКО", Россия, РУ № ФСР 2011/11397,

или фильтр вирусный производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или фильтры производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или фильтры производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные вирусно-бактериальные фильтры в комплекте с соединителями или без: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или фильтры производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или фильтр дыхательный производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или фильтр, варианты исполнения: 800-51700-0; 800-51700; 800-61600; 800-51900; 800-51900-0; 800-51900-11; 800-51800; 800-52000; 800-51500; 800-51600; 800-54011; 800-52300 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или фильтр RT019, RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или фильтр выдоха RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или фильтры дыхательные производства "Интаир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7282,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8405,

или фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8705,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный НЕРА производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/9010,

или фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22M/15F, 22F, фильтр дыхательный линии давления 0,2 µm производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2020/9671 - не более 100 шт. (при необходимости).

25. Шапочки-фиксаторы дыхательные, шапочки-фиксаторы дыхательные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229,

или колпак ВС300-05, ВС303-05, ВС306-05, ВС309-05, ВС360-SK производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

VII. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: реанимационные, циркуляционные, с встроенными нагревательными элементами, в составе:

1. Трубка гофрированная обогреваемая по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 4 шт.

2. Трубка гофрированная, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубка соединительная, трубка дыхательная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или трубки дыхательного контура однократного использования (этилвинилацетат), трубки дыхательного контура однократного использования гофрированные (этиленвинилацетат) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или дыхательные шланги (длиной 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 180 см, 300 см, 400 см) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или дыхательные шланги производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или трубки дыхательные производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или дыхательные шланги в комплекте с соединителями или без: шланги для дыхательных контуров; шланги для эвакуации отработанных газов производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или трубка дыхательная производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или трубки дыхательные производства "Интаир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 5 шт.

3. Y-образный коннектор, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или коннектор Y-образный производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или Y-образный адаптер (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннекторы (Y-образные) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: Y-образные производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - тройник пациента производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или коннектор (тройник пациента), варианты исполнения: E-1030-01-2; G-311010; E-1031-04; G-313005; G-313005-00; G-313005-00-1; G-313005-11; G-313005-11-1; G-311010-1; G-311030; G-311032 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или тройник пациента RT029, 900MR125, 900MR126, 900MR126C, 900MR126L, 900MR127, 900MR128, 900MR128L, 900MR136, 900MR138, 900MR145, 900MR145C производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или тройник пациента неонатальный RT029 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 3 шт.

4. Влагосборник, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или влагосборник производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или влагосборники: - влагосборник однократного использования (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол) производства Грейт Груп Медикал Ко., Лтд., Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или влагосборники для дыхательных контуров для взрослых и детей производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или влагосборники производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или влагосборники для дыхательных контуров для взрослых, для детей и для новорождённых. производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или влагосборники производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или влагосборник одноразовый, варианты исполнения: G-313001; G-313001-0; G-313001-00; G-313001-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или влагосборник 900MR139, 900MR139C производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или влагосборники дыхательные производства "Интаир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

5. Держатель контура дыхательного, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или держатель шлангов RT028 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 5 шт. (при необходимости).

6. Держатель масок, держатели для масок (длиной 440 мм и 700 мм) и фиксаторы для шлангов и трубок производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или ремни на голову BC325-10, BC328-10, BC331-10, ремни на подбородок BC351-10, BC353-10, BC355-10, BC357-10 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

7. Канюли для СРАР-терапии, канюли назальные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229

Или канюли назальные СРАР производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286

- не более 100 шт. (при необходимости).

8. Кабель соединительный электрический к проводу для подогрева дыхательных газов, кабель гибкого нагревателя, варианты исполнения: 900MR860, 900MR861, 900MR863, 900MR868, 900MR869 производства "Фишер энд Пэйкел Хелскэр Лимитед", Новая Зеландия, РУ № РЗН 2014/1416 - не более 100 шт. (при необходимости).

9. Камера для увлажнителей дыхательных смесей, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или увлажнители (камеры увлажнителя) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или камера увлажнителя MR225, MR225X, MR250, MR250X, MR290, MR290X, MR340, MR370 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или камеры увлажнителя взрослые: MR210, MR210X, MR250, MR250X, камеры увлажнителя детские: MR225, MR225X, камеры увлажнителя универсальные: MR290, MR290X, MR290U, MR290UX, MR290V, MR290VX, MR290HFV, производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или увлажнители дыхательные производства "Интаир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742,

или увлажнители производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или Камера увлажнителя (вид 185610) производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053 – не более 100 шт. (при необходимости).

10. Коннектор прямой, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992 - не более 100 шт.

11. Линии контроля давления, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или трубка соединительная производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга давления. производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или трубка измерения давления в контуре 900MR075, 900MR076, 900MR077 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

12. Линия мониторинга газов, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или трубка проксимального давления и CO2 производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или тонкие трубки для мониторинга производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или линии мониторинга в комплекте с соединителями, фильтром или без: линии мониторинга содержания углекислого газа производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 - не более 100 шт. (при необходимости).

13. Линия подачи воды по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

14. Маски лицевые, маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные и лицевые) различных размеров (малый, средний и большой), маски для СРАР производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или набор масок RD800-EN (5 шт.) производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или маска дыхательная однократного применения в индивидуальной упаковке с этикеткой, в следующих размерах: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6, принадлежности: маскодержатель производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7995 - не более 100 шт. (при необходимости).

15. Мешок для дыхательного контура, одноразового использования, мешок резервный, производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или резервные мешки производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные мешки объемом: 0.5л, 1.0л, 1.3л, 2.0л, 2.3л, 3.0л, 5.0л: для анестезиологических или реанимационных дыхательных контуров с петлёй или без, с открытым или закрытым концом; для аппаратуры; для оксигенации с дыхательным клапаном с трубкой или без производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или мешок дыхательный (латекс) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или мешки (дыхательные и резервные, объемом 0.5 л, 1.0 л, 2.0 л, 3.0 л) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или мешок дыхательный реанимационный для ИВЛ производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или мешки производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или мешок одноразовый, варианты исполнения: G-118000; G-118001; G-118002 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или мешки резервные дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742

или мешок дыхательный однократного применения, объем 500 мл, мешок дыхательный однократного применения, объем 1000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объем 2000 мл, мешок дыхательный однократного применения, объем 3000 мл

производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/6773 - не более 100 шт. (при необходимости).

16. Монитор давления, линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 - не более 100 шт. (при необходимости).

17. Ограничители потока по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

18. Отражатели тепла, отражатели тепла: 900MR208, NC040-10, NC041-10 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 100 шт. (при необходимости).

19. Распылитель аэрозоля (небулайзер), небулайзеры (распылители трахеобронхиального и альвеолярного осаждения) и резервуары небулайзеров, одиночные и в наборах (с маской аэрозольной, с коннектором или без, с фильтром или без, с кислородной трубкой) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или распылители (небулайзеры) производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или небулайзеры дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

20. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или угловые адаптеры производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них) производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или переходники для дыхательных контуров (вид 185610): - переходник прямой; - переходник Т-образный; - угловой производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или переходники производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или воздуховоды производства "Смите Медикал Интернэшнл Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/05401,

или коннектор (адаптор), варианты исполнения: G-311000; G-311000-1; G-311001; G-311001-1; G-311002; G-311003; G-311003-2; G-311003-3; G-311004; G-311004-2; G-311005; G-311006; G-311008-1; G-311017; G-311019; G-311019-2; G-311024; G-311031; V-1022-02; 9014-D; G-311008; G-311008-2; G-311039; G-311003-2; G-311003-2-1; G-311004-3; G-311031-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или угловой адаптер (22 mm F - 22 mm M/15 mm F) производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12372,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094, RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 100 шт. (при необходимости).

21. Соединитель, по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия,

или коннектор угловой производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286, или соединительные устройства производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: жесткие; эластомерные; гибкие; шарнирные; прямые; угловые; Т-образные; Y-образные; адаптеры производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или гибкие соединители дыхательного контура производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/12928,

или коннектор (угольник), варианты исполнения: G-311011; G-311012; G-311015; G-311015-0; G-311015-1; G-311015-R; G-311015-R2; G-311022; G-311025; G-311025-1 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или коннектор BC180-05, BC181-05, BC182-05, BC190-05, BC191-05, BC192-05, BC260-SK, BC480-SK, BC481-SK, BC482-SK, BC490-SK, BC491-SK, BC492-SK, BC3020-10, BC3520-10, BC4030-10, BC4540-10, BC5040-10, BC5050-10, BC5550-10, BC5560-10, BC6060-10, BC6070-10, BC6570-10, RT021, RT022, RT023, RT024, RT091, RT092, RT093, RT094, RT095 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или удлинитель трубки (22 мм.) RT024 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или переходники для дыхательных контуров производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 - не более 100 шт. (при необходимости).

22. Термометр, термометр 900MR033 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

23. Тест-колпачок защитный по ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 производства ООО «МЕДИПЛАСТ», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

24. Тестовое легкое, тестовые легкие: RD020-01, 500RD106 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111 - не более 2 шт. (при необходимости).

25. Фильтры дыхательные, Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020 производства АО "НПП "ИНТЕРОКО", Россия, РУ № ФСЗ 2011/11397,

или фильтр вирусный производства "ХЭРОЛ С.р.л.", Италия, РУ № ФСЗ 2012/13286,

или фильтры производства "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566,

или фильтры производства "Алба Хелскеа ЛЛС", США, РУ № ФСЗ 2009/04992,

или дыхательные вирусно-бактериальные фильтры в комплекте с соединителями или без: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551,

или фильтры производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство, РУ № РЗН 2013/1311,

или фильтр дыхательный производства "Мортон Медикал Сан. ве. Тик. А.С.", Турция, РУ № ФСЗ 2011/09053,

или фильтр, варианты исполнения: 800-51700-0; 800-51700; 800-61600; 800-51900; 800-51900-0; 800-51900-11; 800-51800; 800-52000; 800-51500; 800-51600; 800-54011; 800-52300 производства "ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292,

или фильтр RT019, RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742,

или фильтр выдоха RT020 производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2011/09111,

или фильтры дыхательные производства "ИнтАир Медикал", Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь РУ № РЗН 2018/7282,

или фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8405,

или фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии производства "Джи Ви Эс С.П.А.", Италия, РУ № РЗН 2019/8705,

или фильтр дыхательный бактериально-вирусный, прямой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный, угловой коннектор, фильтр дыхательный бактериально-вирусный НЕРА производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2019/9010,

или фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, с портом Луер-Лок, Ø 22F/15M, 22M/15F, фильтр дыхательный, бактериально-вирусный, без порта Луер-Лок, Ø 22M/15F, 22F, фильтр дыхательный линии давления 0,2 µm производства "Медерен Неотех Лтд.", Израиль, РУ № РЗН 2020/9671 - не более 100 шт. (при необходимости).

26. Шапочки-фиксаторы дыхательные, шапочки-фиксаторы дыхательные производства "Инспирэйшн Хэлскеа Лимитед", Великобритания, РУ № ФСЗ 2011/10229,

или колпак ВС300-05, ВС303-05, ВС306-05, ВС309-05, ВС360-SK производства "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд.", Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 100 шт. (при необходимости).

2 Сведения о производителе медицинского изделия

ООО «МЕДИПЛАСТ»,

196641, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Дорога на Металлострой, дом 5, литера А, помещение 7-Н, оф.6.

Тел: +79533551330, e-mail: mediplast.st.petersburg@gmail.com.

3 Назначение медицинского изделия, установленное производителем

Устройства предназначены для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, в вариантах исполнения (далее по тексту - устройства), предназначены для использования при подаче воздушно-кислородной и анестезиологической смеси, а также при проведении искусственной вентиляции легких и ингаляционной анестезии: для подачи и отвода управляемой газовой смеси, с целью профилактики осложнений, лечения, медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма человека.

Изделие предназначено для использования квалифицированным (обученным) медицинским персоналом, на дому (по рекомендации врача).

Область применения – искусственная вентиляция легких, ингаляционная анестезия, ингаляционная терапия, физиотерапия.

Потенциальные потребители: пациенты, нуждающиеся в подаче воздушно-кислородной и анестезиологической смеси, а также для проведения искусственной вентиляции легких и ингаляционной анестезии: для подачи и отвода управляемой газовой смеси, с целью профилактики осложнений, лечения, медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма человека.

4 Условия применения

Операционные отделения, реанимационные отделения, физиотерапевтические отделения, палаты интенсивной терапии, на дому (по рекомендации врача), в транспортных средствах скорой медицинской помощи.

5 Принцип действия

Устройства являются частью респираторного оборудования, замещающего функцию легких, аппаратов искусственной вентиляции лёгких или анестезиологической/реанимационной «рабочей станции», которая обеспечивает подачу кислорода и вдыхаемых газов пациенту, выводит двуокись углерода (CO₂) и увлажняет вдыхаемую смесь и предотвращает аккумуляцию нежелательных или токсичных продуктов обмена, сохраняя постоянным газовый состав альвеол.

6 Перечень показаний к применению, противопоказаний, возможных побочных действий

6.1 Показания к применению

Необходимость подачи дыхательной смеси под давлением, с переменным давлением или газа с повышенным содержанием кислорода, или проведения искусственной вентиляции легких или, ввода ингаляционных анестезирующих смесей.

6.2 Противопоказания к применению:

- Аллергия или непереносимость химических веществ, входящие в состав изделия;
- Хирургически недренированный пневмоторакс (риск чрезмерного повышения давления в устройстве и как следствие, в дыхательных путях и плевральных полостях).

6.3 Возможные побочные действия:

- Асфиксия вследствие обтурации трубки дыхательного контура мокротой, инородным телом или конденсатом при длительном использовании;
- Асфиксия при разгерметизации Устройства (отсоединения Устройства от соответствующего коннектора аппарата ИВЛ/НДА);
- Аллергические реакции на химические вещества, входящие в состав изделия.

6.4 Меры предосторожности и требования безопасности

- Устройства являются одноразовыми медицинскими изделиями;
- Изделия для многократного использования (Держатель) подлежат дезинфекции путем протирания салфеткой 3% го раствора перекиси водорода или 70%го этилового спирта;
- Изделия должны применяться только квалифицированным (обученным) персоналом;
- Перед устройствами убедиться в целостности индивидуальной упаковки;
- Не применять медицинское изделие при нарушении целостности упаковки. Качество изделия гарантируется только при отсутствии следов повреждения упаковки;
- Не применять медицинское изделие при наличии визуальных дефектов;
- Не применять медицинское изделие после истечения срока годности;
- Медицинское изделие не подлежит повторной стерилизации и дезинфекции для повторного применения;
- Использовать при применении изделий исправную следящую аппаратуру, в соответствии с принятыми стандартами и рекомендациями;
- Соблюдать рекомендации, инструкции и требования безопасности по использованию медицинского оборудования (анестезиологические аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких, капнографы, небулайзеры, аппараты ручной вентиляции легких и прочее) и других медицинских изделий (дыхательные контуры и фильтры, соединители, линии, анестезиологические маски, эндотрахеальные и трахеостомические трубки, ларингеальные маски, другие надгортанные устройства и прочее), с которым используются Устройства;
- Не использовать медицинское изделие повторно или у других пациентов во избежание развития перекрестного инфицирования;

- Соединять Устройства с соответствующими коническими коннекторами притирая их надежно;
- Контролировать образование конденсата и вовремя его эвакуировать.
- Не следует без особых показаний производить замену Устройства, исходя только из продолжительности его применения у пациента;
- При использовании Устройства для замещения функции легких иметь резервный экземпляр изделия;
- Использование Устройств с встроенными нагревательными элементами совместно с увлажнителями дыхательных смесей, не указанными в п. 8.1.2, или не имеющих датчика потока дыхательной смеси, потенциально может привести к перегреву нагревательных элементов Устройств, особенно в условиях низких потоков газа (менее 4 литров в 1 минуту);
- При использовании с анестезиологической станцией следить за количеством абсорбента диоксида углерода и избегать его истощения;
- Перед использованием Устройств всегда проводить тестирование оборудования для того, чтобы убедиться в герметичности изделия;
- Избегать состояний, которые могут сопровождаться накоплением в устройстве примесей посторонних газов.

7 Описание, параметры и характеристики медицинского изделия

7.1 Описание изделия

Трубка гофрированная

Трубка предназначена для использования при проведении дыхательных газов во время дыхательного цикла, как правило, в процессе проведения анестезии или искусственной вентиляции легких. Изделие функционирует как часть дыхательного контура или другого устройства для подачи газов (например, респираторной маски) или в сочетании с ними и/или подсоединяется к дыхательному мешку или аппарату искусственной вентиляции легких. Также используется совместно с кислородной маской, эндотрахеальной трубкой, трахеостомической трубкой, ларингеальной маской и другими надгортанными устройствами, увлажнителем или ингалятором для аэрозольного увлажнения, как правило, обогащенного кислородом.

Трубка гофрированная устройств должна иметь следующие варианты исполнения и соответствовать конструкторской документации:

- Трубка гофрированная 22;
- Трубка гофрированная 22 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F;
- Трубка гофрированная 22 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F и 22M;
- Трубка гофрированная 22 с антимикробными компонентами с коннекторами 22M;
- Трубка гофрированная 22 с коннекторами 22F;
- Трубка гофрированная 22 с коннекторами 22F и 22M;
- Трубка гофрированная 22 с коннекторами 22M;
- Трубка гофрированная растяжимая 22;
- Трубка гофрированная растяжимая 22 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F;
- Трубка гофрированная растяжимая 22 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F и 22M;
- Трубка гофрированная растяжимая 22 с антимикробными компонентами с коннекторами 22M;
- Трубка гофрированная растяжимая 22 с коннекторами 22F;
- Трубка гофрированная растяжимая 22 с коннекторами 22F и 22M;
- Трубка гофрированная растяжимая 22 с коннекторами 22M;

- Трубка гофрированная 15;
- Трубка гофрированная 15 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F;
- Трубка гофрированная 15 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F и 22M;
- Трубка гофрированная 15 с антимикробными компонентами с коннекторами 22M;
- Трубка гофрированная 15 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F и 15M;
- Трубка гофрированная 15 с коннекторами 22F;
- Трубка гофрированная 15 с коннекторами 22F и 22M;
- Трубка гофрированная 15 с коннекторами 22M;
- Трубка гофрированная 15 с коннекторами 22F и 15M;
- Трубка гофрированная растяжимая 15;
- Трубка гофрированная растяжимая 15 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F;
- Трубка гофрированная растяжимая 15 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F и 22M;
- Трубка гофрированная растяжимая 15 с антимикробными компонентами с коннекторами 22M;
- Трубка гофрированная растяжимая 15 с антимикробными компонентами с коннекторами 22F и 15M;
- Трубка гофрированная растяжимая 15 с коннекторами 22F;
- Трубка гофрированная растяжимая 15 с коннекторами 22F и 22M;
- Трубка гофрированная растяжимая 15 с коннекторами 22M;
- Трубка гофрированная растяжимая 15 с коннекторами 22F и 15M;
- Трубка гофрированная 10;
- Трубка гофрированная 10 с коннекторами 15M и 22F;
- Трубка гофрированная 10 с коннекторами 15M;
- Трубка гофрированная 10 с коннекторами 10M и 15M;
- Трубка гофрированная 10 с коннекторами 10M и 22F;
- Трубка гофрированная 10 с коннектором 15M;
- Трубка гофрированная 10 с коннектором 12,5M;
- Трубка гофрированная 10 с коннекторами 12,5M и 15M;
- Трубка гофрированная 10 с коннектором 22F;
- Трубка гофрированная 10 с коннектором 15M;
- Трубка гофрированная 22 обогреваемая, длиной трубки 150 см, с коннекторами 22F с портом;
- Трубка гофрированная 22 обогреваемая, длиной трубки 150 см, с коннекторами 22F;
- Трубка гофрированная 10 обогреваемая, длиной трубки 110 см, с коннекторами 22F с портом;
- Трубка гофрированная 10 обогреваемая, длиной трубки 110 см, с коннекторами 22F.

Y-образный коннектор.

Обеспечивает создание дыхательного контура с совместимыми комплектующими (например, дыхательными трубками и лицевой маской или эндотрахеальной трубкой, трахеостомической трубкой, ларингеальной маской и другими надгортанными устройствами), может функционировать только в составе дыхательного контура, должен обеспечивать распределение и движение газов по соединяемым трубкам.

Y-образный коннектор должен иметь следующие варианты исполнения:

- Y-образный коннектор 22M/15F-22M-22M без портов;
- Y-образный коннектор 22M/15F-22M-22M с портами 7,6 мм;

- Y-образный коннектор 22M/15F-15M-15M без портов;
- Y-образный коннектор 22M/15F-15M-15M с портами 7,6 мм.

Соединитель угловой.

Соединитель для совместимых комплектующих (например, трубок и лицевой маски или эндотрахеальной трубки, трахеостомической трубкой, ларингеальной маской и другими надгортанными устройствами), обеспечивающий создание Устройства. Изделие может функционировать только в составе Устройства и обычно подключается непосредственно к точке контроля вдоха/выдоха пациента. Изделие для одноразового использования.

Соединитель угловой устройств должен иметь следующие варианты исполнения и соответствовать конструкторской документации:

- Соединитель угловой 22M/15F-15M без портов;
- Соединитель угловой 22M/15F-15M с портом Луер;
- Соединитель угловой 22M/15F-15M с портом 7,6 мм;
- Соединитель угловой 22M/15F-15M с портом 7,6/9,5 мм;
- Соединитель угловой шарнирный 22M/15F-15M с портом 7,6/9,5 мм.

Соединитель.

Соединитель – гибкое изделие, разработанное для подключения к дыхательному контуру эндотрахеальной трубки, трахеостомической трубкой, ларингеальной маской и другими надгортанными устройствами, лицевой маски для анестезии или другого компонента дыхательного контура, предназначен для обеспечения мобильности пациента относительно Устройства. Используется для подключения дыхательного контура (например, анестезиологического дыхательного контура или дыхательного контура аппарата искусственной вентиляции легких) или аппарата для реанимации к эндотрахеальной трубке для повышения мобильности края контура на стороне пациента.

Соединитель должен иметь следующие варианты исполнения:

- Соединитель гофрированный длинной трубки с коннектором угловым 22M/15F-15M без портов;
- Соединитель гофрированный длинной трубки с коннектором угловым 22M/15F-15M с портом Луер;
- Соединитель гофрированный длинной трубки с коннектором угловым 22M/15F-15M с портом 7,6 мм;
- Соединитель гофрированный длинной трубки с коннектором угловым 22M/15F-15M с портом 7,6/9,5 мм;
- Соединитель гофрированный длинной трубки с коннектором угловым шарнирным 22M/15F-15M с портом 7,6/9,5 мм;
- Соединитель гофрированный длинной трубки с коннектором 22M/15F;
- Соединитель растяжимый длинной с коннектором угловым 22M/15F-15M без портов;
- Соединитель растяжимый длинной трубки с коннектором угловым 22M/15F-15M с портом Луер;
- Соединитель растяжимый длинной трубки с коннектором угловым 22M/15F-15M с портом 7,6;
- Соединитель растяжимый длинной трубки с коннектором угловым 22M/15F-15M с портом 7,6/9,5;
- Соединитель растяжимый длинной трубки с шарнирным коннектором угловым 22M/15F-15M с портом 7,6/9,5 мм;
- Соединитель растяжимый длинной трубки с коннектором 22M/15F;
- Соединитель гофрированный длинной трубки в сборе с коннектором угловым 22M/15F-15M без портов;

- Соединитель гофрированный длинной трубки в сборе с коннектором угловым 22М/15F-15М с портом Луер;
- Соединитель растяжимый длинной трубки в сборе с коннектором угловым 22М/15F-15М с портом 7,6 мм;
- Соединитель гофрированный длинной трубки в сборе с коннектором угловым 22М/15F-15М с портом 7,6/9,5 мм;
- Соединитель растяжимый длинной трубки в сборе с коннектором угловым 22М/15F-15М без портов;
- Соединитель растяжимый длинной трубки в сборе с коннектором угловым 22М/15F-15М с портом Луер;
- Соединитель растяжимый длинной трубки в сборе с коннектором угловым 22М/15F-15М с портом 7,6 мм;
- Соединитель растяжимый длинной трубки в сборе с коннектором угловым 22М/15F-15М с портом 7,6/9,5 мм;
- Соединитель гофрированный длинной трубки с коннектором угловым 22М/15F-15М без портов и коннектором 15М;
- Соединитель гофрированный длинной трубки с коннектором угловым 22М/15F-15М с портом Луер и коннектором 15М;
- Соединитель растяжимый длинной трубки с коннектором угловым 22М/15F-15М без портов и коннектором 15М;
- Соединитель растяжимый длинной трубки с коннектором угловым 22М/15F-15М с портом Луер и коннектором 15М.

Влагосборник.

Влагосборник предназначен для сбора и дальнейшего удаления конденсированной воды из Устройства. Влагосборник может устанавливаться как на трубке выдоха, так и на трубке вдоха. Влагосборник устанавливается таким образом, чтобы обеспечить сбор конденсата в самой нижней точке. При этом расположение трубок должно быть таким, что бы стакан (накопитель) влагосборника не касался поверхности пола.

Влагосборник должен иметь следующие варианты исполнения:

- Влагосборник 22М, 22М;
- Влагосборник 22М/15F, 22М/15F.

Кислородная трубка.

Доставка дополнительного кислорода или обогащенной кислородом воздушной смеси пациенту. Может использоваться в качестве трубки для создания давления газа в пневматическом небулайзере для создания аэрозоля для подачи его в Устройство.

Коннектор прямой.

Предназначен для обеспечения надежного соединения трубки дыхательного контура с соответствующим патрубком аппарата искусственной вентиляции легких или аппарата для реанимации. При наличии соответствующего порта обеспечивают подсоединение соответствующих устройств (температурного датчика, линии мониторинга).

Варианты исполнения:

- Коннектор прямой 15М-15F с портом 7,6 мм;
- Коннектор прямой 15М-15F с портом 6.0 мм;
- Коннектор прямой 15F-15F;
- Коннектор прямой 15М-22F;
- Коннектор прямой 15F-22F;
- Коннектор прямой 22М-22М;

- Коннектор прямой 22М-22М/15F;
- Коннектор прямой 22М/15F-22М/15F;
- Коннектор прямой 22М-22F;
- Коннектор прямой 22М-19М.

Линия мониторинга газов.

Предназначена для использования в качестве переходника между коннектором трубки/маски дыхательного контура и инструментом для измерения респираторных газов, (например, анализатором диоксида углерода (CO₂) или нескольких газов, манометром/монитором давления). Может предназначаться для мониторинга давления и/или забора проб газа, но не содержит компонентов, предназначенных для подачи медицинского воздуха пациенту.

Линия мониторинга газов должна иметь следующие варианты исполнения:

- Линия мониторинга газов с коннекторами Луер – Лок male и female;
- Линия мониторинга газов с коннекторами Луер – Лок male.

Линия контроля давления.

Предназначена для использования в качестве переходника между коннектором трубки/маски дыхательного контура и инструментом для измерения респираторных газов, (например, анализатором диоксида углерода (CO₂) или нескольких газов, манометром/монитором давления). Не содержит компонентов, предназначенных для подачи медицинского воздуха пациенту.

Линия контроля давления должна иметь следующие варианты исполнения:

- Линия контроля давления;
- Линия контроля давления с коннектором Луер;
- Линия контроля давления с прямым коннектором;
- Линия контроля давления с коннектором Луер – Лок.

Линия подачи воды.

Применяется в Устройствах в случаях необходимости подачи дистиллированной воды в ингаляционно-терапевтических устройствах различного типа в целях профилактики пересыхания слизистой дыхательных путей вследствие пересушенности окружающего воздуха или ингаляционных газов. Увлажнение достигается путём испарения или распыления воды в помещении или газовом потоке дыхательного контура. Может иметь различные размеры, подключаться с помощью или без помощи переходника.

Линия подачи воды должна иметь следующие варианты исполнения:

- Линия подачи воды;
- Линия подачи воды с коннектор Луер – Лок male.

Держатель контура дыхательного.

Держатель контура дыхательного, может использоваться многократно. Предназначен для удержания трубок Устройства, а также других элементов Устройства, по которым проходят газы от аппарата искусственной вентиляции легких и/или анестезиологических систем к пациенту и от пациента. Держатель должен обеспечивать фиксацию трубок дыхательного контура в заданном пользователем положении. Наружные поверхности при необходимости обрабатываются 3 % раствором хлорамина Б или 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего синтетического средства по ГОСТ 25644.

Держатель контура дыхательного должен иметь следующие варианты исполнения:

- Держатель контура дыхательного исполнение 1;
- Держатель контура дыхательного исполнение 2;

- Держатель контура дыхательного исполнение 3.

Ограничитель потока.

Предназначен для использования в Устройствах (в патрубке вдоха) исключительно для соответствующих моделей аппаратов искусственной вентиляции легких: SLE 2000, и SLE 5000 (4000). Функция ограничителя – создавать соответствующее обратное давление в патрубке вдоха. Ограничитель потока должен создавать соответствующее обратное давление в патрубке вдоха, что приводит в действие сигнализаторы утечки и блокировки при падении давления. Ограничитель изготавливается в двух вариантах:

- Ограничитель потока для аппаратов SLE2000 откалиброван для потока 5 л/мин. свежего газа;
- Ограничитель потока для аппаратов SLE5000 (4000) откалиброван для потока 8 л/мин. свежего газа.

Принцип действия ограничителя потока: создание соответствующего обратного давления в патрубке вдоха, что приводит в действие сигнализаторы утечки и блокировки при падении давления. При применении Устройств с ограничителями потока необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации соответствующего оборудования.

- Ограничитель потока для аппаратов SLE2000;
- Ограничитель потока для аппаратов SLE5000 (4000).

Тест-колпачок защитный.

Предназначен для установления в проксимальный конец Устройств. Основное его назначение – осуществление тестирования респираторного оборудования. Тест Устройства, запускаемый пользователем при начале работы с соответствующим оборудованием, позволяет удостовериться в отсутствии утечек в системе дыхательного контура аппарата ИВЛ, измерить комплайнс и сопротивление контура, выполнить калибровку датчика потока выдоха и т. п. А также предназначен для защиты от попадания инородных тел в полость дыхательного контура с проксимального конца устройства. При подключении Устройства к пациенту, колпачок отсоединяется от Устройства.

Тест-колпачок защитный должен иметь следующие варианты исполнения:

- Тест-колпачок защитный;
- Тест-колпачок защитный 15М.

7.2 Методы и условия стерилизации и дезинфекции

Устройства являются нестерильными медицинскими изделиями, предназначены для однократного применения, за исключением Держателя (Держатель дыхательного контура) и тестового легкого, которые могут использоваться многократно после соответствующей дезинфекции и обработки.

8 Указания по применению

8.1 Общие положения

Перед работой с Устройством ознакомьтесь с данным руководством, а также с инструкцией по применению соответствующего респираторного оборудования. Устройства должны применяться только лицами, получившими необходимую подготовку. Подготовка должна включать тренировку на реалистичном тренировочном манекене. Неправильное применение устройств может нанести непоправимый вред пациенту.

Внимание! Устройства в вариантах исполнения: реанимационные, с встроенным нагревательным элементом, циркуляционные, с встроенным нагревательным элементом протестированы и испытаны с увлажнителями дыхательных смесей производства «Фишер энд Пэйкел Хелскэр Лимитед» (Новая Зеландия) моделей MR850 (регистрационное

удостоверение №РЗН 2014/1416) и модели MR810 (регистрационное удостоверение №ФСЗ 2007/00742); в варианте исполнения реанимационные, циркуляционные с встроенными нагревательными элементами – только с увлажнителем дыхательных смесей модели MR850. При использовании Устройств в указанных вариантах исполнения с иными моделями увлажнителей производитель Устройств не может гарантировать их корректную работу и безопасное использование.

9 Установка и способ применения

9.1 Подготовка к использованию

Произведите антисептику кожи рук или наденьте перчатки.

9.2 Выбор размера

Выбор диаметра дыхательных трубок обуславливается возрастными и/или анатомическими характеристиками пациентов, такими как: масса тела, рост, дыхательный объем; режим вентиляции; возраст. Выбор Устройства в зависимости от размера (диаметра) дыхательной трубки обусловлен также респираторным оборудованием. Размерный ряд дыхательных трубок и их соединений стандартизирован (табл.).

Таблица

Диаметр трубки	Описание размера
10 мм	Для применения у пациентов массой тела до 12 кг
15 мм	Для применения у пациентов с массой тела до 40 кг
22 мм	Для применения в дыхательных системах для взрослых пациентов и детей старшего возраста

Выбор длины устройств характеризуется конструктивными особенностями дыхательной системы в целом, расстоянием от пациента до источника газа.

Выбор длины и диаметра устройств делает квалифицированный специалист, основываясь на профессиональном опыте и вышеперечисленных условиях.

9.3 Рекомендуемый метод установки

- Осмотреть упаковку, убедиться в отсутствии её повреждений или инородных тел, загрязнений. Проверить наличие индивидуальной маркировки и убедиться в том, что срок годности устройства не истек. Вскрыть упаковку, осмотреть каждый компонент устройства и провести визуальную проверку целостности шлангов, соединителей и отсутствия посторонних предметов.
- Подсоединить устройство к аппарату. При соединении разъёмов продольное движение должно сопровождаться поворотом – для достижения требуемой надежности соединения и герметичности.
- После подсоединения к аппаратуре, при необходимости и наличии технической возможности провести соответствующие тесты оборудования на герметичность, комплайнс, компенсацию утечек и прочее. При этой проверке используется тест-колпачок, входящий в комплект устройства.
- Перед присоединением устройства к схеме на пациента (эндотрахеальной трубке, трахеостомической трубке, ларингеальной или лицевой маске), необходимо снять защитный колпачок.
- Если в устройстве имеется регулируемый клапан предельного давления РПК (APL), установите и регулируйте его согласно клиническим требованиям на протяжении всего времени применения. Давление в устройстве максимальное, когда крышка клапана РПК повернута по часовой стрелке до конца. Сброс давления до 60 см H₂O не может быть перерегулирован. Максимальное давление сброса не должно превышать 60 см H₂O.
- Замену устройства необходимо производить в соответствии с установленным в медицинском учреждении порядком очистки и дезинфекции или на основании его непригодности к дальнейшему использованию по назначению.
- Рекомендуются использование устройства однократного применения в течение не более 168 часов.
- Не следует без особых показаний (явное загрязнение, нарушение функционирования и т.п.) производить замену устройства исходя только из продолжительности его применения при использовании устройства у того же самого пациента.
- Следует своевременно удалять любой конденсат в устройстве.
- Устройства при **использовании вне пределов ЛПУ (например, при использовании респираторного оборудования в домашних условиях)** применяются на одном пациенте. При применении Устройств на дому, на них распространяются условия, указанные в п. 9.3.9. При перерыве в работе устройства со стороны пациента должен быть защищён защитным колпачком, входящим в комплект, для предотвращения контаминации или повреждения.

9.4 Возможные риски при использовании

Самый большой риск при использовании устройства связан с контролем загрязнения/инфекции и биохимической совместимости. Повторное использование одного устройства может привести к инфицированию пациента.

При использовании устройств в обязательном порядке необходимо использовать следящую аппаратуру в соответствии с принятыми стандартами. Необходимо периодически контролировать надежность соединения патрубков (коннекторов трубок) Устройств с респираторным оборудованием.

9.5 Обслуживание и ремонт

Устройства техническому обслуживанию и ремонту не подлежат.

10 Комплектность

10.1 Минимальная комплектация в соответствии с таблицей

Наименование	№	Комплектация
1. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: анестезиологические, в составе:		
	1	Трубка гофрированная – 1 шт.
	2	Коннектор прямой – 1 шт.
	3	Соединитель – 1 шт.
	4	Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
2. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием вариант исполнения: анестезиологические, циркуляционные, в составе:		
	1	Трубка гофрированная – 2 шт.
	2	Коннектор прямой – 2 шт.
	3	Y-образный коннектор - 1 шт.
	4	Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
3. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: реанимационные, в составе:		
	1	Трубка гофрированная - 1 шт.
	2	Коннектор прямой- 1 шт.
	3	Соединитель - 1 шт.
	4	Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
4. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения:		

реанимационные, циркуляционные, в составе:		
	1	Трубка гофрированная - 2 шт.
	2	Коннектор прямой – 2 шт
	3	У-образный коннектор - 1 шт.
	4	Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт на транспортную упаковку.
5. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: реанимационные, с встроенным нагревательным элементом, в составе:		
	1	Трубка гофрированная обогреваемая- 1 шт.
	2	Трубка гофрированная - 1 шт.
	3	Коннектор прямой - 1 шт.
	4	Соединитель - 1 шт.
	5	Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.
6. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: реанимационные, циркуляционные, с встроенным нагревательным элементом в составе:		
	1	Трубка гофрированная - 2 шт.
	2	Трубка гофрированная обогреваемая- 1 шт.
	3	Влагосборник - 1 шт.
	4	Коннектор прямой - 1 шт.
	5	У-образный коннектор - 1 шт.
	6	Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.

7. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: реанимационные, циркуляционные, с встроенными нагревательными элементами, в составе:		
	1	Трубка гофрированная обогреваемая - 2 шт.
	2	Трубка гофрированная - 1 шт.
	3	Y-образный коннектор - 1 шт.
	4	Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.

10.2 Максимальная комплектация

№	Наименование	Комплектность	Нормативный документ	Количество	Примечание	22мм	15мм	10мм
	1. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием, вариант исполнения: анестезиологические, в составе:		ТУ 32.50.21-003-40945934-2019					
		В составе:						
1		Трубка гофрированная (вид 354450).	ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ	до 6 шт.		1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2009/03742					
2		Коннект ор прямой	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 15 шт.		1	1	1
3		Соедини- тель (вид 165140)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/05401 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ	до 5 шт.		1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			2012/12372 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111					
4		Адаптер кислоро- да	ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2012/11566	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
5		Держате- ль контура дыхател- ьного (вид 185520)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 5 шт.	при необходим- ости	1	1	1
6		Держате- ль масок (вид 322590)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	
7		Канюли назальн- ые (вид 136410)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ РЗН 2018/7623 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
8		Кислоро- дная трубка (вид 156030).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
9		Клапаны положит- ельного давлени- я (вид 108960 и 321960)	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
10		Клапан нереверс- ивный, однораз- ового использ- ования (вид 321960)	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
11		Линии контрол я давлени я (вид 271240)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
12		Линия монитор инга газов (вид 271240).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
13		Маски анестези ологиче ские (вид 275780)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/05401 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ РЗН 2019/8818 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
14		Маски кислоро дные (вид 167560)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2012/13286					
15		Маски аэрозоль- ные (вид 274020)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
16		Маски лицевые (вид 271390)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ РЗН 2018/7995	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	
17		Мешок для дыхател- ьного контура, однораз- ового использ- ования (вид 283370).	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ РЗН 2018/6773	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
18		Монито- р давлени- я (вид 132370)	ФСЗ 2012/11566	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
19		Мундшт- ук (вид 283330)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/03551	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	
20		Распыли- тель аэрозоля (небулай- зер) (вид 324660)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	
21		Соедини- тель (вид 327610)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			2009/03742					
22		Тепло/в- лагообм- енник/ба- ктериаль- ный фильтр (вид 218750)	ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСР 2011/11397 ИЛИ РЗН 2019/8405 ИЛИ РЗН 2019/9010 ИЛИ РЗН 2019/8705 ИЛИ РЗН 2020/9671	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
23		Термоме- тр (вид 320750).	ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
24		Тест- колпачо- к защитны й	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
25		Тестово- е легкое (вид 107580)	ФСЗ 2011/09111	до 2 шт.	при необходим ости	1	1	1
26		Фильтр ы дыхател- ьные (вид 318730)	ФСР 2011/11397 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ РЗН 2018/7282 ИЛИ РЗН 2019/8405 ИЛИ РЗН 2019/8705 ИЛИ РЗН 2019/9010	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ИЛИ РЗН 2020/9761					
	1. Устрой- ства дыхательные для совместного использования с анестезиологи- ческим и реанимационн- ым оборудование- м, вариант исполнения: анестезиологи- ческие, циркуляционн- ые, в составе:		ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019					
		В						

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
		составе:						
1		Трубка гофриро- ванная (вид 354450).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до шт. 6		1	1	1
2		Коннект ор прямой	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до шт. 20	при необходим- ости	1	1	1
3		У- образный коннект ор (вид 151450).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ	до шт. 3		1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2011/09111					
4		Адаптер кислоро- да	ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2012/11566	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
5		Влагосб- орник (вид 260670)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
6		Держате- ль контура дыхател- ьного (вид 185520).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 5 шт.	при необходим- ости	1	1	1
7		Держате- ль масок (вид 322590)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
8		Канюли назальн- ые (вид 136410)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ РЗН	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			2018/7623 ИЛИ ФСЗ 2012/13286					
9		Канюли назальн ые (типа RAM)	ФСЗ 2011/10229	до 100 шт.	при необходим ости			1
10		Кислоро- дная трубка (вид 156030).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
11		Клапаны положит ельного давлени я (вид 108960 и 321960)	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
12		Клапан нереверс- ивный, однораз- ового использ- ования (вид 321960)	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
13		Линии контрол- я давлени- я (вид 271240)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
14		Линия монитор- инга газов (вид 271240).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
15		Маски анестези- ологиче- ские (вид 275780)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/05401 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ РЗН 2019/8818 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
16		Маски кислоро- дные (вид 337070, 167560)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
17		Маски аэрозоль- ные (вид 274020)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
18		Маски лицевые (вид 271390)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ РЗН 2018/7995	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
19		Мешок для дыхател- ьного контура, однораз- ового использ- ования (вид 283370).	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек тность	Нормативный документ	Количе ство	Примечани е	22мм	15мм	10мм
			ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ РЗН 2018/6773					
20		Монито р давлени я (вид 132370)	ФСЗ 2012/11566	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
21		Мундшт ук (вид 283330)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/03551	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	
22		Распыли тель аэрозоля (небулай зер) (вид 324660)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
23		Соедини- тель (вид 327610)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03702	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
24		Соедини- тель (вид 165140)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/05401 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2012/12372 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
25		Тепло/в- лагообм- енник/ба- ктериаль- ный фильтр (вид 218750)	ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСР 2011/11397 ИЛИ РЗН 2019/8405 ИЛИ РЗН 2019/9010	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ИЛИ РЗН 2019/8705 ИЛИ РЗН 2020/9671					
26		Термоме- тр (вид 320750)	ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
27		Тест- колпачо- к защитны- й	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
28		Тестово- е легкое (вид 107580)	ФСЗ 2011/09111	до 2 шт.	при необходим ости	1	1	1
29		Фильтр- ы дыхател- ьные (вид 318730)	ФСР 2011/11397 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			РЗН 2018/7282 ИЛИ РЗН 2019/8405 ИЛИ 2019/8705 ИЛИ РЗН 2019/9010 ИЛИ РЗН 2020/9761					
	3. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологи- ческим и реанимационн- ым оборудование- м, вариант исполнения: реанимационн- ые, в составе:		ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019					
		В составе:						
1		Трубка гофриро- ванная (вид 354450).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053	до 6 шт.		1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ИЛИ ФСЗ 2009/03742					
2		Коннект ор прямой	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 15 шт.		1	1	1
3		Соедини- тель (вид 165140).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/05401 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2012/12372 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 5 шт.		1	1	1
4		Адаптер кислоро- да	ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2012/11566	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
5		Влагосборник (вид 260670).	ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим ости			1
6		Генератор дыхания	ФСЗ 2011/10229	до 100 шт.	при необходим ости			
7		Держатель контура дыхательного (вид 185520).	ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 5 шт.	при необходим ости	1	1	1
8		Держатель масок (вид 322590)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
9		Канюли для СРАР.	ФСЗ 2011/10229	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
		терапии (вид 105850)						
10		Канюли назаль- ные (вид 136410)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ РЗН 2018/7623 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
11		Канюли назаль- ные (типа RAM)	ФСЗ 2011/10229	до 100 шт.	при необходим- ости			1
12		Кислоро- дная трубка (вид 156030).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
13		Камера для увлажни- телей дыхател- ьных смесей (вид 321970)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ ФСЗ 2011/09053					
14		Клапан выдоха (вид 124510)	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
15		Клапаны положит ельного давлени я (вид 108960 и 321960)	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
16		Клапан нереверс ивный, однораз ового использ ования (вид 321960)	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
17		Линии контрол- я давлени- я (вид 271240)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
18		Линия монитор- инга газов (вид 271240).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
19		Линия подачи воды	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
20		Маска анестези- ологиче- ская (вид 275780)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/05401 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ РЗН 2019/8818 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
21		Маски кислоро- дные (вид 167560)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
22		Маски аэрозоль- ные (вид 274020)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
23		Маска носовая аппарата постоян- ного/дву- хфазног- о положит- ельного давлени- я в дыхател- ьных путях (вид 109700)	ФСЗ 2011/10229 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
24		Маска лицевая аппарата постоян- ного/дву- хфазног- о положит- ельного давлени- я в дыхател- ьных путях, однораз	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
		ового использ ования (вид 109710)						
25		Маски лицевые (вид 271390)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ РЗН 2018/7995	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
26		Мешок для дыхател ьного контура, однораз ового использ ования (вид 283370).	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ РЗН 2018/6773	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
27		Монито р давлени я (вид 132370)	ФСЗ 2012/11566	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
28		Мундштук (вид 283330)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/03551	до 100 шт.	при необходимости	1	1	
29		Отражатели тепла (вид 330090)	ФСЗ 2011/09111	до 100 шт.	при необходимости			1
30		Распылитель аэрозоля (небулайзер) (вид 324660)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходимости	1	1	1
31		Соединитель (вид 327610)	ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходимости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
32		Тепло/в- лагообм- енник/ба- ктериаль- ный фильтр (вид 218750)	ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСР 2011/11397 ИЛИ РЗН 2019/8405 ИЛИ РЗН 2019/9010 ИЛИ РЗН 2019/8705 ИЛИ РЗН 2020/9671	до 100 шт	при необходим- ости	1	1	1
33		Термоме- тр (вид 320750).	ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
34		Тест- колпачо- к защитны- й	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
35		Фильтр- ы дыхател- ьные (вид 318730)	ФСР 2011/11397 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ РЗН 2018/7282 ИЛИ РЗН 2019/8405 ИЛИ 2019/8705 ИЛИ РЗН 2019/9010 ИЛИ РЗН 2020/9761					
36		Шапочки- фиксаторы дыхательные (вид 275620)	ФСЗ 2011/10229 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим- ости			1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
37		У- образны й коннект ор (вид 151450)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
	4. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологи- ческим и реанимационн- ым оборудование- м, вариант исполнения: реанимационн- ые, циркуляционн- ые, в составе:		ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019					
		В составе:						

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
1		Трубка гофриро- ванная (вид 354450)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ РЗН 2013/1311 ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 6 шт.		1	1	1
2		Коннект- ор прямой	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 20 шт.		1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
3		У- образны й коннект ор (вид 151450).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 3 шт.		1	1	1
4		Адаптер кислоро- да	ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2012/11566	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
5		Влагосб- орник (вид 260670).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
6		Держате- ль контура дыхател- ьного (вид 185520).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 5 шт.	при необходим- ости	1	1	1
7		Держате- ль масок (вид 322590)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
8		Канюли для СРАР- терапии	ФСЗ 2011/10229	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
		(вид 105850)						
9		Канюли назальн ые (вид 136410)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ РЗН 2018/7623 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
10		Канюли назальн ые (типа RAM)	ФСЗ 2011/10229 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим ости			1
11		Кислоро- дная трубка (вид 156030).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
12		Камера для увлажни- телей дыхател- ьных смесей (вид 321970)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ ФСЗ 2011/09053					
13		Клапан выдоха (вид 124510)	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551	До 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
14		Клапаны положит ельного давлени я (вид 108960 и 321960)	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
15		Клапан нереверс ивный, однораз ового использ ования (вид 321960)	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
16		Линии контрол- я давлени- я (вид 271240)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
17		Линия монитор- инга газов (вид 271240).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
18		Линия подачи воды	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
19		Маски анестези- ологиче- ские (вид 275780)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/05401 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ РЗН 2019/8818 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
20		Маски кислоро- дные (вид 167560)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
21		Маски аэрозоль- ные (вид 274020)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
22		Маска носовая аппарата постоян- ного/дву- хфазног- о положит- ельного давлени- я в дыхател- ьных путях (вид 109700)	ФСЗ 2011/10229 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	
23		Маска лицевая аппарата постоян- ного/дву- хфазног- о положит- ельного давлени- я в	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
		дыхател- ьных путях, однораз- ового использ- ования (вид 109710)						
24		Маски лицевые (вид 271390)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ РЗН 2018/7995	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
25		Мешок для дыхател- ьного контура, однораз- ового использ- ования (вид 283370)	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ РЗН 2018/6773	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1
26		Монито- р давлени- я (вид 132370)	ФСЗ 2012/11566	до 100 шт.	при необходим- ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
27		Отражат ели тепла (вид 330090)	ФСЗ 2011/09111	до 100 шт.	при необходим ости			1
28		Распыли- тель аэрозоля (небулай- зер) (вид 324660)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
29		Соедини- тель (вид 327610)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
30		Соедини- тель (вид 165140)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/05401 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2012/12372 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
31		Тепло/в- лагообм- енник/ба- ктериаль- ный фильтр (вид 218750)	ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСР 2011/11397 ИЛИ РЗН 2019/8405 ИЛИ РЗН 2019/9010	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ИЛИ РЗН 2019/8705 ИЛИ РЗН 2020/9671					
32		Термоме- тр (вид 320750).	ФСЗ 2007/00742	до 100шт.	при необходим ости	1	1	1
33		Тест- колпачо- к защитны й	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1
34		Тестово- е легкое (вид 107580)	ФСЗ 2011/09111	до 2 шт.	при необходим ости	1	1	1
35		Фильтр- ы дыхател- ьные (вид 318730)	ФСР 2011/11397 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим ости	1	1	1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ИЛИ РЗН 2018/7282 ИЛИ РЗН 2019/8405 ИЛИ 2019/8705 ИЛИ РЗН 2019/9010 ИЛИ РЗН 2020/9761					
	5. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологи- ческим и реанимационн- ым оборудование м, вариант исполнения: реанимационн- ые, с встроенным нагревательны- м элементом, в составе:		ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019					
		В составе:						
1		Трубка гофриро- ванная обогрева- емая	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	До 2 шт.		1		1
2		Трубка гофриро- ванная (вид 354450)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ	до 5 шт.		1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ФСЗ 2009/04992 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2009/03742					
3		Коннект ор прямой	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	До 15 шт.		1		1
4		Соедини- тель (вид 165140)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/05401 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2012/12372 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ	до 5 шт.		1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ФСЗ 2011/09111					

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
5		Влагосборник (вид 260670).	ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходимости	1		1
6		Генератор дыхания	ФСЗ 2011/10229	до 100 шт.	при необходимости			1
7		Держатель дыхательного контура (вид 185520).	ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 5 шт.	при необходимости	1		1
8		Держатель масок (вид 322590)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходимости	1		1
9		Канюли для	ФСЗ 2011/10229	до 100 шт.	при необходимости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
		СРАР- терапии (вид 105850)			ости			
10		Канюли назаль- ные (вид 136410)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ РЗН 2018/7623 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
11		Канюли назаль- ные (типа RAM)	ФСЗ 2011/10229	до 100 шт.	при необходим ости			1
12		Кабель соедини- тельный электри- ческий к проводу для подогре- ва дыхател- ьных газов (вид 324410).	РЗН 2014/1416	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
13		Камера для увлажни- телей дыхател- ьных смесей (вид 321970)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ИЛИ ФСЗ 2011/09053					
14		Линии контрол- я давлени- я (вид 271240).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1
15		Линия монитор- инга газов (вид 271240).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1
16		Линия подачи воды	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
17		Маски анестези- ологиче- ские (вид 275780)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/05401 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ РЗН 2019/8818 ИЛИ ФСЗ 2012/13286	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1
18		Маски лицевые (вид 271390)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ РЗН 2018/7995	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1
19		Мешок для дыхател- ьного контура, однораз- ового использ- ования (вид 283370).	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ФСЗ 2009/03742 ИЛИ РЗН 2018/6773	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
20		Монитор давления (вид 132370)	ФСЗ 2012/11566	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
21		Отражат ели тепла (вид 330090)	ФСЗ 2011/09111	до 100 шт.	при необходим ости			1
22		Соедини- тель (вид 327610)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
23		Тепло/в- лагообм- енник/ба- ктериаль- ный фильтр (вид 218750)	ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСР 2011/11397 ИЛИ РЗН 2019/8405 ИЛИ РЗН 2019/9010 ИЛИ РЗН 2019/8705 ИЛИ РЗН 2020/9671	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1
24		Термоме- тр (вид 320750).	ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1
25		Тест- колпачо- к защитны- й	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1
26		Тестово- е легкое (вид 107580)	ФСЗ 2011/09111	до 2 шт.	при необходим- ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
27		Фильтр ы дыхател ьные (вид 318730)	ФСР 2011/11397 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ РЗН 2018/7282 ИЛИ РЗН 2019/8405 ИЛИ 2019/8705 ИЛИ РЗН 2019/9010 ИЛИ РЗН 2020/9761	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
38		Шапочк и- фиксато ры дыхател ьные (вид 275620)	ФСЗ 2011/10229 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим ости			1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
	6. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологи- ческим и реанимационн- ым оборудование- м, вариант исполнения: реанимационн- ые, циркуляционн- ые, с встроенным нагревательны- м элементом, в составе:		ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019					
		В составе:						

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
2		Трубка гофриро- ванная (вид 354450)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 5 шт.	при необходим- ости	1		1
2		Трубка гофриро- ванная обогрева- емая	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 3 шт.		1		1
3		Влагосб- орник (вид 260670).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2009/03742					
4		Коннект ор прямой	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 15 шт.		1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
5		У- образны й коннект ор (вид 151450)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 3 шт.		1		1
6		Держате- ль контура дыхател- ьного (вид 185520).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 5 шт.	при необходим ости	1		1
7		Держате- ль масок (вид 322590)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
8		Канюли для СРАР- терапии	ФСЗ 2011/10229	до 100 шт.	при необходим ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
		(вид 105850)						
9		Кабель соедини- тельный электри- ческий к проводу для подогре- ва дыхател- ьных газов (вид 324410).	РЗН 2014/1416	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1
10		Камера для увлажни- телей дыхател- ьных смесей (вид 321970)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ ФСЗ 2011/09053	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1
11		Линии контрол- я давлени- я (вид 271240)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ФСЗ 2007/00742					
12		Линия мониторинга газов (вид 271240).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
13		Линия подачи воды	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
14		Маски лицевые (вид 271390)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ РЗН 2018/7995	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
15		Мешок для дыхател ьного контура,	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928	до 100 шт.	при необходим ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
		однораз- ового использ- ования, (вид 283370).	ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ РЗН 2018/6773					
16		Огранич- ители потока	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим- ости			1
17		Отражат- ели тепла (вид 330090)	ФСЗ 2011/09111	до 100 шт.	при необходим- ости			1
18		Распыли- тель аэрозоля (небулай- зер) (вид 324660)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1
19		Соедини- тель (вид 165140)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/05401 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2012/12372 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111					
20		Соедини- тель (вид 327610)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
21		Термоме- тр (вид 320750)	ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
22		Тест- колпачо- к защитны й	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
23		Тестово- е легкое (вид 107580)	ФСЗ 2011/09111	до 2 шт.	при необходим ости	1		1
24		Фильтр ы дыхател- ьные (вид 318730)	ФСР 2011/11397 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ РЗН 2018/7282 ИЛИ	до 100 шт.	при необходим ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			РЗН 2019/8405 ИЛИ 2019/8705 ИЛИ РЗН 2019/9010 ИЛИ РЗН 2020/9761					
25		Шапочк и- фиксато ры дыхател ьные (вид 275620)	ФСЗ 2011/10229 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
	7. Устройства дыхательные для совместного использования с анестезиологи- ческим и реанимационн- ым оборудование м, вариант исполнения: реанимационн- ые, циркуляционн- ые, с встроенными нагревательны- ми элементами, в составе:		ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019					
		В составе:						
1		Трубка гофриро- ванная обогрева- емая	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 4 шт.		1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
2		Трубка гофриро- ванная (вид 354450)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до шт. 5		1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
3		У- образны й коннект ор (вид 151450)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 3 шт.		1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
4		Влагосб- орник (вид 260670).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1
5		Держате- ль контура дыхател- ьного (вид 185520).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2011/09111	до 5 шт.	при необходим- ости	1		1
6		Держате- ль масок (вид 322590)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим- ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
7		Канюли для СРАР- терапии (вид 105850)	ФСЗ 2011/10229	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
8		Кабель соедини- тельный электри- ческий к проводу для подогре- ва дыхател- ьных газов (вид 324410).	РЗН 2014/1416	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
9		Камера для увлажни- телей дыхател- ьных смесей (вид 321970)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ ФСЗ 2011/09053	до 100 шт.	при необходим ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
10		Коннект ор прямой	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
11		Линии контрол я давлени я (вид 271240)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
12		Линия монитор инга газов (вид 271240).	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
13		Линия подачи воды	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
14		Маски лицевые (вид 271390)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ 2018/7995	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
15		Мешок для дыхател- ьного контура, однораз- ового использ- ования, (вид 283370).	ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ РЗН 2018/6773	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
16		Монито- р давлени- я (вид 132370)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
17		Ограничители потока	ТУ 32.50.21-003-40945934-2019	до 100 шт.	при необходим ости			1
18		Отражатели тепла (вид 330090)	ФСЗ 2011/09111	до 100 шт.	при необходим ости			1
19		Распылитель аэрозоля (небулайзер) (вид 324660)	ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2009/04992	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
20		Соединитель (вид 165140)	ТУ 32.50.21-003-40945934-2019 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2009/05401 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2012/12372	до 100 шт.	при необходим ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
			ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111					
21		Соедини- тель (вид 327610)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/12928 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
22		Термоме- тр (вид 320750)	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
23		Тест- колпачо- к защитны- й	ТУ 32.50.21- 003-40945934- 2019	до 100 шт.	при необходим ости	1		1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
24		Тестово- е легкое (вид 107580)	ФСЗ 2011/09111	до 2 шт.	при необходим- ости	1		1
25		Фильтр- ы дыхател- ьные (вид 318730)	ФСР 2011/11397 ИЛИ ФСЗ 2012/13286 ИЛИ ФСЗ 2012/11566 ИЛИ ФСЗ 2009/04992 ИЛИ ФСЗ 2009/03551 ИЛИ ФСЗ 2011/09053 ИЛИ РЗН 2013/1311 ИЛИ ФСЗ 2010/08292 ИЛИ ФСЗ 2007/00742 ИЛИ ФСЗ 2011/09111 ИЛИ ФСЗ 2009/03742 ИЛИ РЗН 2018/7282 ИЛИ РЗН 2019/8405 ИЛИ 2019/8705 ИЛИ РЗН 2019/9010 ИЛИ РЗН 2020/9761	до 100 шт.	при необходим- ости			1

№	Наименование	Комплек- тность	Нормативный документ	Количе- ство	Примечани- е	22мм	15мм	10мм
26		Шапочк и- фиксато ры дыхател ьные (вид 275620)	ФСЗ 2011/10229 ИЛИ ФСЗ 2007/00742	до 100 шт.	при необходим ости	1		1
Эксплуатационная документация								
Инструкция по применению (для потребителя) – 1 шт. на транспортную упаковку.								

11 Упаковка

Покупные изделия должны поставляться в индивидуальной и/или потребительской упаковке производителя, при необходимости упаковываются в групповую упаковку совместно с устройством. Устройство должно быть упаковано в индивидуальную (групповую) упаковку. Составные части устройства при необходимости должны упаковываться в индивидуальную упаковку. Потребительская (транспортная) упаковка – ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142. В каждую транспортную упаковку должен быть вложен упаковочный лист. Масса транспортной упаковки брутто - не более 150 кг.

12 Маркировка

Маркировка устройства должна соответствовать требованиям ТУ 32.50.21-003-40945934-2019, быть четкой и разборчивой при нормальном или скорректированном до нормального зрении. Маркировка на индивидуальной упаковке должна быть постоянной и несмываемой. В маркировке устройства могут быть применены символы в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1.

На индивидуальную упаковку наносится следующая маркировка:

- наименование изделия (надпись);
- наименование и адрес места производства (символ, надпись: наименование, адрес);
- наименование и адрес изготовителя, принимающего претензии потребителей (надпись: наименование, адрес);
- логотип предприятия-изготовителя (символ);
- штрих-код (символ);
- код партии (символ, надпись);
- номер по каталогу (символ, надпись);
- состав изделия (надпись);
- тип изделия;
- дата изготовления (символ, надпись);
- использовать до (символ, надпись);
- предупреждение о запрете на повторное применение (символ);
- предупреждение о запрете использования при повреждении упаковки (символ);
- предупреждение о необходимости обратиться к инструкции по применению (символ);
- сведения о пределах температурного диапазона хранения (символ);
- сведения о диапазоне влажности (символ);
- не допускать воздействия солнечного света (символ);
- беречь от влаги (символ);
- апиногенно (символ);

- нетоксично, нестерильно (надпись: «нетоксично», «нестерильно»);
- сведения об утилизации (надпись);
- количество изделий, шт. (надпись);
- номер и дата регистрационного удостоверения (надпись);
- QR-код (Инструкция по применению размещается на официальном сайте производителя в сети "Интернет", а также отправляется по запросу направленному в адрес производителя).

Маркировка покупных изделий маркируется производителем и дополнительно содержит:

- наименование и адрес изготовителя, принимающего претензии потребителей;
- наименование изделия.

Транспортная маркировка изделий содержит:

- наименование изделия;
- тип изделия;
- код партии;
- номер по каталогу;
- наименование и адрес изготовителя, принимающего претензии потребителей;
- наименование и адрес места производства;
- количество изделий;
- дата изготовления;
- дата истечения срока годности;
- условия хранения (сведения о температурном диапазоне хранения, сведения о диапазоне влажности);
- штрих-код;
- масса брутто, кг;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- ограничена возможность штабелирования груза;
- контроль ОТК (Отдел технического контроля);
- QR – код (Инструкция по применению размещается на официальном сайте производителя в сети "Интернет", а также отправляется по запросу направленному в адрес производителя).

На транспортную упаковку могут быть нанесены манипуляционные знаки «Беречь от влаги», «Предел по количеству ярусов в штабеле» (не более 8 ярусов), «Беречь от солнечных лучей», «Верх», «Предел штабелирования по массе» (25 кг) по ГОСТ 14192. Обозначение условий хранения и другие дополнительные надписи должны быть нанесены на тару или ярлык в местах, свободных от транспортной маркировки. Возможно нанесение дополнительной маркировки на индивидуальную и потребительскую упаковки, содержащую информацию в соответствии с требованиями заказчика (например, наименование заказчика, адрес заказчика, рекламные слоганы и т.д.). Дополнительная маркировка не должна вводить в заблуждение потребителя.

13 Условия эксплуатации

Устройство применяется в помещениях и на улице в следующих климатических условиях:

- температура воздуха: от + 10 °С до + 35 °С;
- относительная влажность воздуха: 35-80%;
- атмосферное давление: 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.).

14 Транспортирование

Упакованное устройство транспортируют всеми видами транспортных средств, в крытых средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортируются в следующих климатических условиях:

- температура воздуха: от - 50 °С до + 50 °С;
- относительная влажность воздуха: 0-95%;
- атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

15 Хранение

Хранение устройств осуществляется в закрытых отапливаемых помещениях в следующих климатических условиях:

- температура воздуха: от + 5 °С до + 40 °С;
- относительная влажность воздуха: 0-80%;
- атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.),

Хранение изделия должно осуществляться вдали от нагревательных приборов, в защищенном от солнца месте.

Срок годности устройств составляет 5 лет с даты производства. При использовании в составе Устройств покупных изделий, зарегистрированных в установленном порядке в Росздравнадзоре, срок годности Устройства определяется остаточным сроком годности покупного изделия, имеющего наименьший срок годности.

16 Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие устройств, заявленных в документации показателями качества и характеристиками при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течение всего срока годности. Производитель не несет ответственности за случайные или косвенные убытки, ущерб или расходы, прямо или косвенно связанные с использованием данного изделия; не несет ответственности в отношении изделий, подвергаемых повторной обработке, используемых повторно, подвергаемых воздействию климатических и механических факторов при транспортировании и хранении, отличных от указанных в документации производителя, и не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо всего прочего, гарантии коммерческого качества и пригодность для использования по назначению в отношении таких изделий.

Срок годности изделия с даты производства – 5 лет. Срок годности изделия, в составе которого применяются покупные изделия, определяется остаточным сроком годности покупного изделия, имеющего наименьший срок годности.

17 Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия

17.1 Устройства, не использованные по назначению, с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А.

17.2 Устройства, использованные по назначению, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса Б.

17.3 Устройства, использованные по назначению во фтизиатрии, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса В.

18 Контактная информация

18.1 В случае возникновения вопросов, связанных с применением изделий, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться по указанному адресу: ООО «МЕДИПЛАСТ», 196641, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Дорога на Металлострой, дом 5, литера А, помещение 7-Н, оф.6.

18.2 В случае утери данной инструкции и/или возникновении необходимости ознакомления с инструкцией по применению (для специалистов) потребитель может обратиться по e-mail: mediplast.st.petersburg@gmail.com.

Приложение А: Манипуляционные символы, указанные на упаковке:

Символ	Обозначение
	Использовать до ...
	Дата изготовления
	Код партии
	Номер по каталогу
	Сведения о производителе
	Обратитесь к инструкции по применению
	Температурный диапазон
	Не допускать воздействия солнечного света
	Беречь от влаги
	Запрет на повторное применение
	Не использовать при повреждении упаковки
	Диапазон влажности

