

Генеральный директор  
ООО "БИО-РАД ЛАБОРАТОРИИ"  
Александр Яковлевич Шестаков

«2» \_\_\_\_\_ 2021 г.



Фотографические изображения медицинского изделия  
Набор расходных материалов «QXDx AutoDG Consumable Pack», в составе



**Рис. 1 Внешний вид «Набор расходных материалов «QXD» AutoDG Consumable Pack», в составе»**



Рис. 2 Внешний вид «Набор расходных материалов «QXDx AutoDG Consumable Pack», в составе»

**BIO-RAD**

REF 12001922

Rx Only



480

+15 °C



2020-06-03

LOT

64342501



2021-04-28



(01)X03610520621141  
(11)200003  
(17)210428  
(10)64342501

## QXDx AutoDG Consumable Pack

QXDx Universal Kit for AutoDG ddPCR System (17001378)

- 3 x 5 ddPCR 96-Well Plates
- 1 x 50 ddPCR Pierceable Foil Heat Seals
- 1 x 150 mL Automated Droplet Generation Oil for Probes
- 1 x 15 DG32 Cartridges
- 10 x 96 Pipet Tips for Automated Droplet Generator

EN: For In Vitro Diagnostic Use  
CZ: Pro diagnostiku in vitro  
DE: In-vitro-Diagnostikum  
DK: Til in vitro-diagnostisk brug  
ES: Para uso en diagnóstico in vitro  
FR: Utilisation comme test de diagnostic in vitro  
HU: In vitro diagnosztikai alkalmazásra  
IT: Per uso diagnostico in vitro  
LT: In vitro diagnostiniam naudoti  
NO: Til in vitro-diagnostisk bruk  
PT: Para utilizar no diagnóstico in vitro  
SE: För in vitro-diagnostiskt bruk  
TR: In Vitro Tanılama Kullanımı İçin  
TW: 體外診斷用  
VN: Dùng Cho Chẩn Đoán In Vitro

UNITED STATES, Bio-Rad Laboratories, Inc., 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, CA 94547  
FRANCE, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette

Made in United States

Рис. 3 Маркировка «Набор расходных материалов «QXDx AutoDG Consumable Pack», в составе»

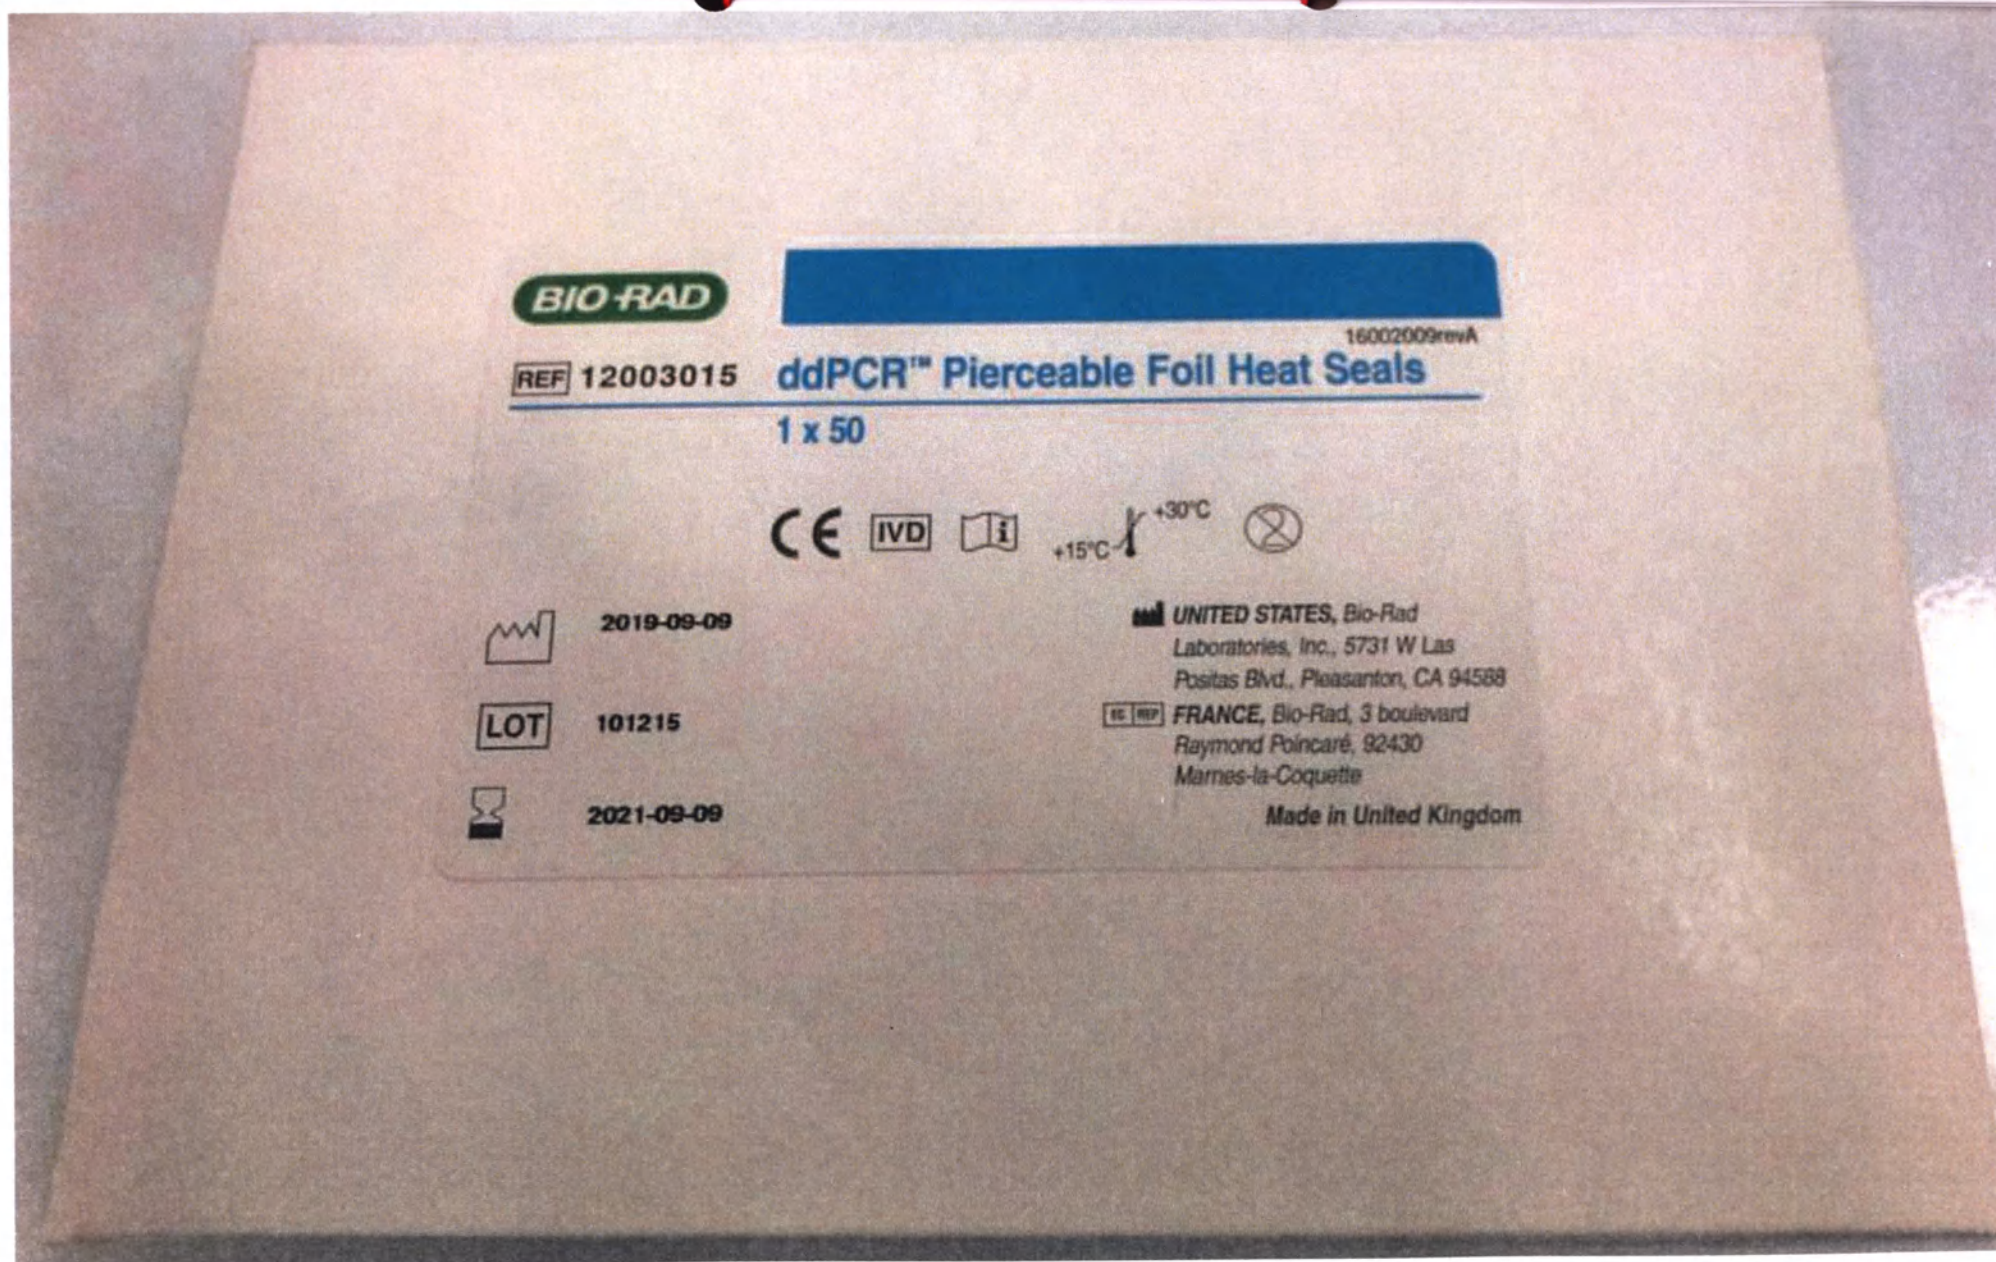
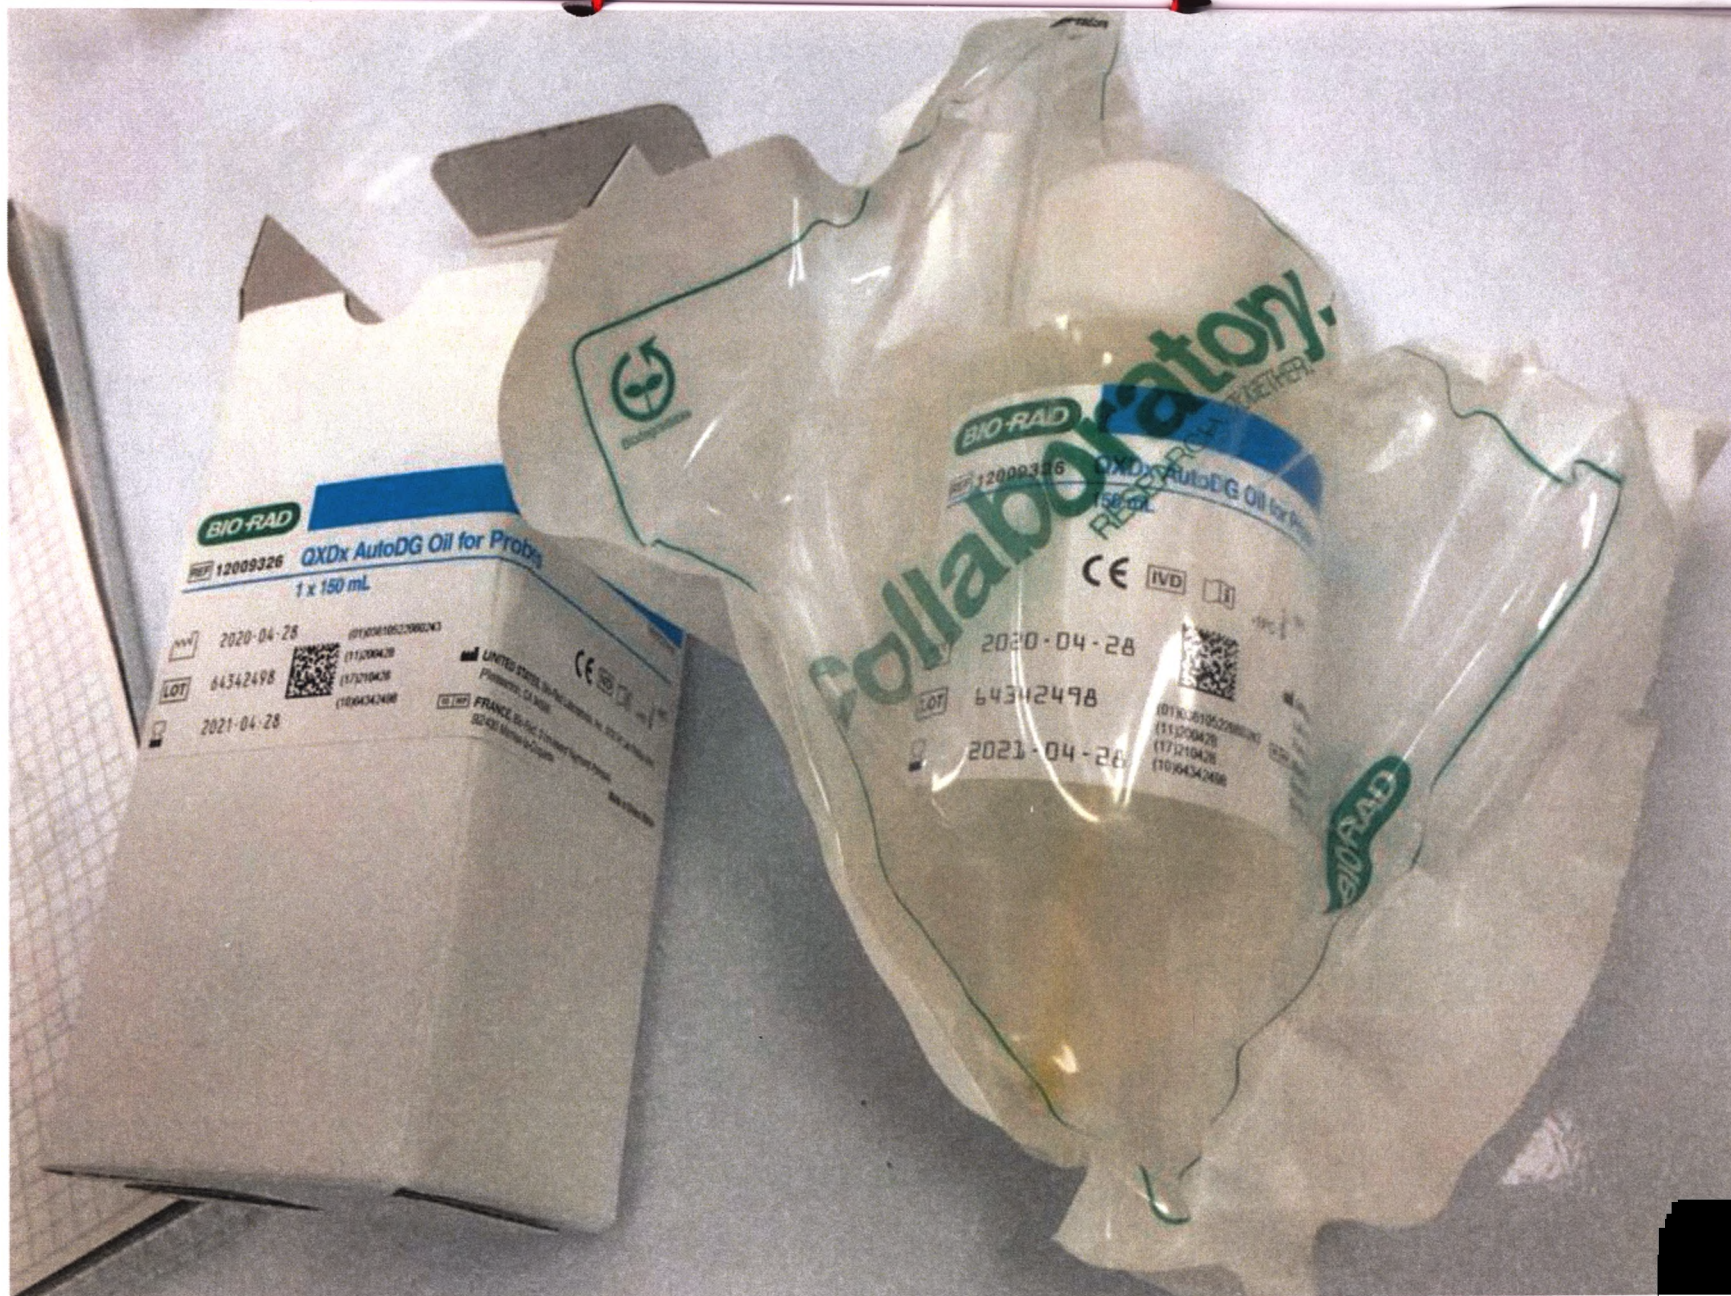


Рис. 4 Маркировка компонента «Набор расходных материалов «QXDx AutoDG Consumable Pack», в составе» - Фольга для запаивания планшетов



**Рис. 5 Внешний вид - Масло для автоматического генератора капель**



Рис. 6 Внешний вид - Планшеты 96-луночные для цифровой капельной ПЦР

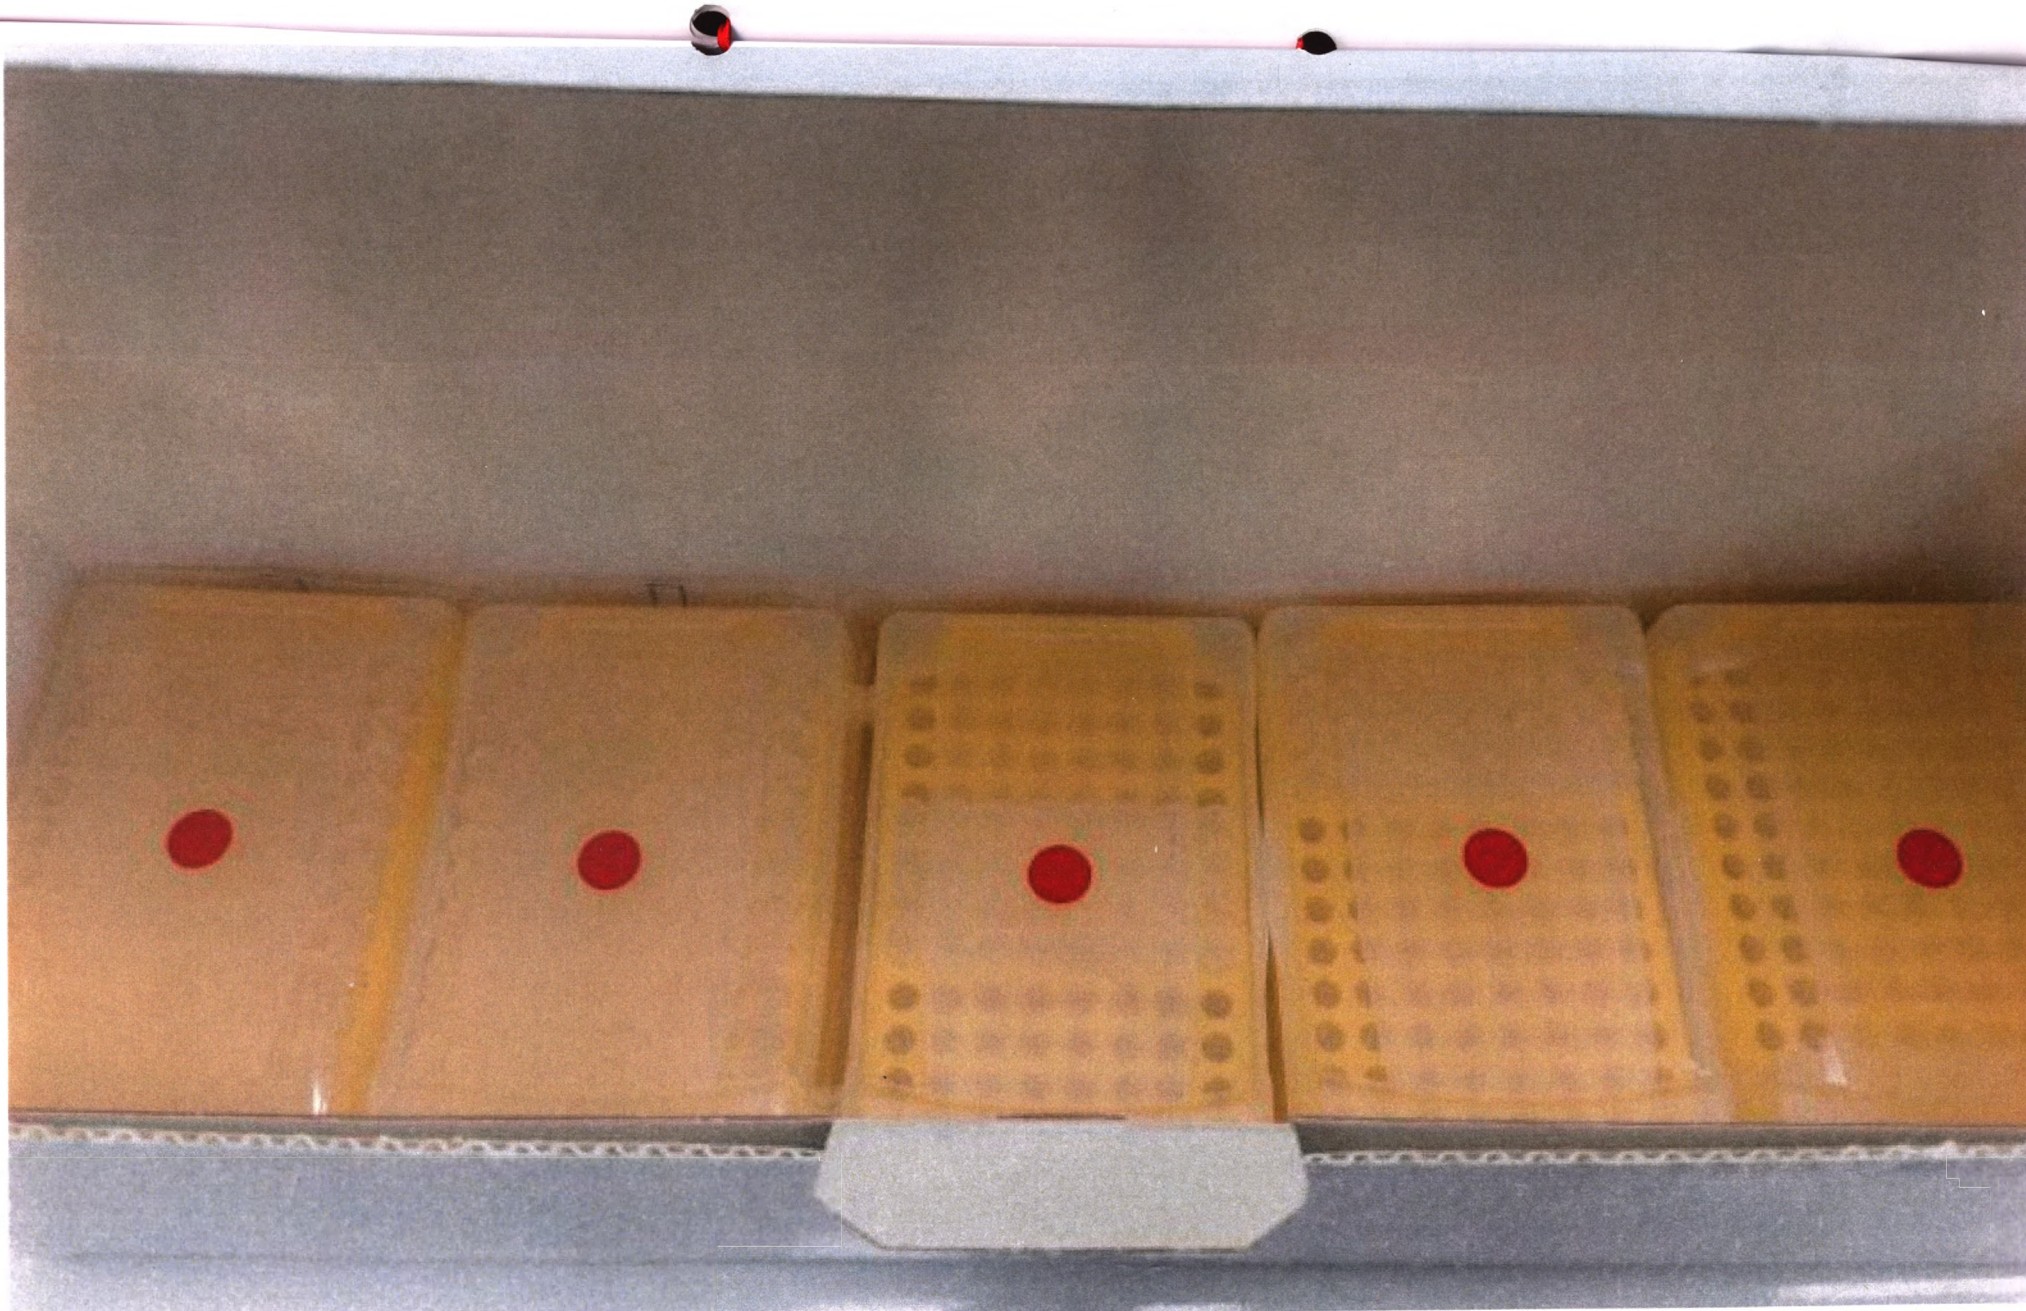


Рис. 7 Внешний вид - Наконечники для пипеток



Рис. 8 Внешний вид - Картриджи DG32

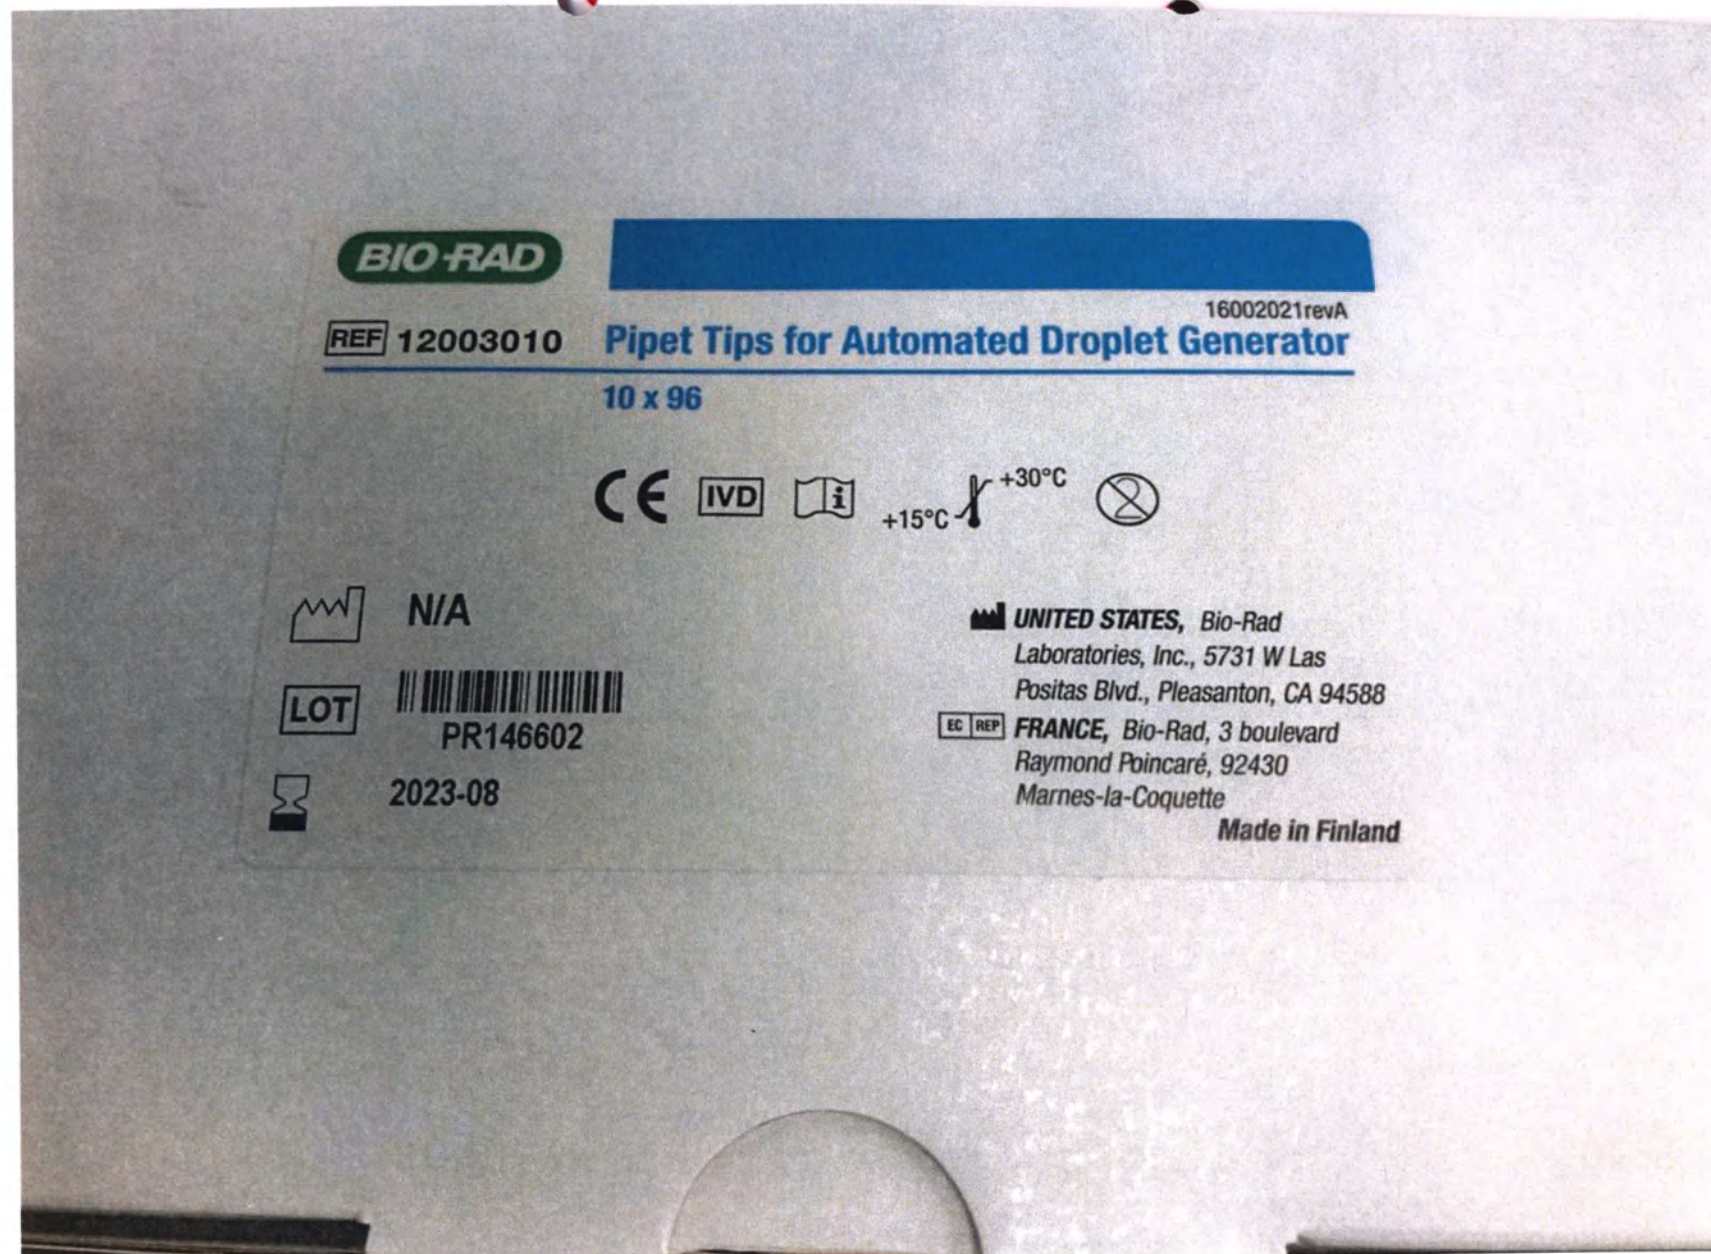


Рис. 9 Маркировка компонента «Набор расходных материалов «QXDx AutoDG Consumable Pack», в составе» - Наконечники для пипеток

**BIO-RAD**

REF 12003016

**DG32™ Cartridges**

16002022revA

1 x 15



+15°C

+30°C



N/A

**LOT** 236469-1

N/A



**UNITED STATES**, Bio-Rad

Laboratories, Inc., 5731 W Las

Positas Blvd., Pleasanton, CA 94588



**FRANCE**, Bio-Rad, 3 boulevard

Raymond Poincaré, 92430

Marnes-la-Coquette

**Made in Germany**

Рис. 10 Маркировка компонента «Набор расходных материалов «QXDx AutoDG Consumable Pack», в составе» - Картриджи DG32



Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 11 листов.

Генеральный директор  
ООО «Био-Рад Лаборатории»  
Шестаков А.Я.