



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17313

На медицинское изделие

Центрифуги серии Avanti J-15 для диагностических целей in vitro

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Бекмен Культер, Инк.", США,

Beckman Coulter, Inc., 250 S. Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, USA

Производитель

"Бекмен Культер, Инк.", США,

Beckman Coulter, Inc., 250 S. Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, USA

Место производства медицинского изделия

Beckman Coulter, Inc., 5355 W.76th Street Indianapolis, IN, USA 46268

Номер регистрационного досье № РД-45384/80014 от 16.11.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.12.119

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 10 листах

приказом Росздравнадзора от 23 мая 2022 года № 4310
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0066917

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17313

Лист 1

На медицинское изделие

**Центрифуги серии Avanti J-15 для диагностических
целей in vitro, варианты исполнения:**

1. Центрифуга Avanti J-15 для диагностических целей in vitro, в составе:

1. Центрифуга настольная Avanti J-15;

2. Документация (информация о безопасности использования, предустановочная инструкция, инструкция по быстрому запуску, информация об опасных веществах и материалах).

3. CD/DVD диски - не более 2 шт.

4. Сетевой кабель, 2,5м, вилка CEE 7/7, разъем совместимый с центрифугами Avanti J-15 и Avanti J-15R.

5. Смазка Spinkote.

6. Силиконовая вакуумная смазка в банке с завинчивающейся крышкой, 1 унция (28 г).

7. Ключ для ротора.

8. Шестигранный ключ.

9. Инструкция по эксплуатации.

10. Угловой ротор JA-10.100 в составе (при необходимости):

- угловой ротор JA-10.100 в комплекте с крышкой;

- смазка Spinkote;

- силиконовая вакуумная смазка в банке с завинчивающейся крышкой, 1 унция (28 г);

- инструкция на угловой ротор JA-10.100;

- документация (Перечень документации, поставляемой с ротором, информация о безопасности использования, инструкция на ротор, проверочный лист комплектации).

11. Бакетный ротор JS-4.750 в составе (при необходимости):

- бакетный ротор JS-4.750 в комплекте с крышкой;

- смазка Spinkote 20 г;

- силиконовая вакуумная смазка в банке с завинчивающейся крышкой, 1 унция (28 г);

- бакеты (4 шт.);

- инструкция на бакетный ротор JS-4.750;

- документация (Перечень документации, поставляемой с ротором, информация о безопасности использования, инструкция на ротор, проверочный лист комплектации).

12. Бакетный ротор JS-4.750 в составе (при необходимости):

- бакетный ротор JS-4.750 в комплекте с крышкой;

- смазка Spinkote;

- силиконовая вакуумная смазка в банке с завинчивающейся крышкой, 1 унция (28 г);

- держатели-подвески металлические для многоруночных планшетов,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0101396

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17313

Лист 2

155 x 128 x 85 мм (4 шт.).

- инструкция на бакетный ротор JS-4.750;

- документация (Перечень документации, поставляемой с ротором, информация о безопасности использования, инструкция на ротор, проверочный лист комплектации).

13. Держатели-подвески металлические для многолуночных планшетов, 155 x 128 x 85 мм (2 шт. в наборе) - не более 20 наборов (при необходимости).

14. Уплотнительные кольца резиновые черные, диаметр 30 мм, толщина 3 мм (не более 10 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

15. Зашелка в сборе (захват - 1 шт., пружина - 1 шт., шайба - 2 шт.) - не более 20 упаковок (при необходимости).

16. Крышки держателей-подвесок пластиковые в сборе с воздушным фильтром, зашелками и резиновым уплотнением, 100 x 145 x 65 мм (2 шт. в наборе) - не более 20 наборов (при необходимости).

17. Подкладки для многолуночных планшетов пластиковые, 102 x 71 x 4 мм (не более 6 шт. в наборе) - не более 20 наборов (при необходимости).

18. Бакеты для ротора JS-4.750 (2 шт. в наборе) - не более 20 наборов (при необходимости).

19. Крышки для бакетов Biocertilled (2 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

20. Воздушный фильтр в пластиковом корпусе, высота 9 мм, диаметр 6 мм (не более 65 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

21. Адаптер пробирок 29x108 мм (6 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

22. Адаптер пробирок 30x115 мм (6 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

23. Адаптер пробирок 18x107 мм (6 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

24. Адаптер пробирок 17x120 мм (6 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

25. Адаптер пробирок 16x82 мм (6 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

26. Адаптер пробирок 11x39 мм (6 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

27. Модульный адаптер 10 мм (2/4шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

28. Модульный адаптер 12 мм (2/4шт./упаковка) - не более 20 упаковок

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0101397

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17313

Лист 3

(при необходимости).

29. Модульный адаптер 13 мм (2/4шт./упаковка) - не более 20 упаковок

(при необходимости).

30. Модульный адаптер 14 мм (2/4шт./упаковка) - не более 20 упаковок

(при необходимости).

31. Модульный адаптер 16 мм (2/4шт./упаковка) - не более 20 упаковок

(при необходимости).

32. Модульный адаптер для конических пробирок 18 мм (2/4шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

33. Модульный адаптер 18мм (2/4шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

34. Модульный адаптер 30 мм (2/4шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

35. Модульный адаптер 29 мм (2/4шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

36. Модульный адаптер 35 мм (2/4шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

37. Модульный адаптер 44 мм (2/4шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

38. Модульный адаптер 11 мм (2 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

39. Модульный адаптер 10 мм (2 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

40. Модульный адаптер 12 мм (2 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

41. Цельный адаптер под конические пробирки 29 x 115 мм (2/4шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

42. Адаптеры для культуральных флаконов 75 см² (2 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

43. Адаптеры для культуральных флаконов 25 см² (2 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

44. Адаптеры для контейнеров с кровью 90 мм (1 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

45. Адаптеры для контейнеров с кровью 97 мм (1 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

46. Держатели пробирок для контейнеров 11 мм (2 шт./упаковка) - не более 20 упаковок

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0101398

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17313

Лист 4

(при необходимости).

47. Держатели пробирок для контейнеров 12 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

48. Держатели пробирок для контейнеров 13 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

49. Держатели пробирок для контейнеров 14 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

50. Держатели пробирок для контейнеров 16 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

51. Держатели пробирок для контейнеров 12 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

52. Держатели пробирок для контейнеров 18 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

53. Держатели пробирок для контейнеров 12 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

54. Держатели пробирок для контейнеров 17 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

55. Держатели пробирок для контейнеров 12 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

56. Держатели пробирок для контейнеров 30 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

57. Держатели пробирок для контейнеров 12 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

58. Держатели пробирок для контейнеров 29 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

59. Держатели пробирок для контейнеров 12 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

60. Держатели пробирок для контейнеров 62 мм (4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

61. Набор металлических держателей. 126 x 87x 60 мм (2 /4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

62. Адаптеры для флаконов и бутылей 62 мм (не более 4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

63. Адаптеры для флаконов и бутылей 62 мм (1 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

64. Адаптеры для флаконов и бутылей 62 мм (1 шт./упаковка) - не более 20 упаковок

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0101399

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17313

Лист 5

(при необходимости).

65. Адаптеры для флаконов и бутылей 70 мм (1 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

66. Адаптеры для флаконов и бутылей 96 мм (1 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

67. Крышка с пружинным фиксатором ротора - не более 20 шт. (при необходимости).

68. Завинчивающаяся крышка ротора - не более 20 шт. (при необходимости).

69. Уплотнительное кольцо ротора малое, 3 мм, диаметр 30 мм - не более 20 шт. (при необходимости).

70. Уплотнительное кольцо завинчивающейся крышки ротора большое, резиновое, 2 мм, диаметр 120 мм - не более 20 шт. (при необходимости).

71. Набор держателей (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок.

72. Фиксирующий винт - не более 20 шт. (при необходимости).

73. Ключ для ротора с Т-образной рукояткой - не более 20 шт. (при необходимости).

74. Набор для чистки роторов в составе (щетка для чистки ротора 32 и 38 мм, щетка для чистки ротора 16 и 25 мм, раствор для чистки ротора 555, 2 флакона) - не более 20 наборов (при необходимости).

75. Раствор для чистки роторов 555 в бутылке, 946 мм - не более 20 шт. (при необходимости).

76. Смазка Spinkote - не более 20 шт. (при необходимости).

77. Вакуумная смазка, силиконовая - не более 20 шт. (при необходимости).

78. Фиксирующий винт - не более 20 шт. (при необходимости).

79. Ключ для ротора с Т-образной рукояткой - не более 20 шт. (при необходимости).

80. Торцовый ключ металлический, крестообразный, с внешней резьбой - не более 20 шт. (при необходимости);

81. Крышка ротора - не более 20 шт. (при необходимости).

II. Центрифуга Avanti J-15R для диагностических целей in vitro, в составе:

1. Центрифуга настольная Avanti J-15R.

2. Документация (информация о безопасности использования, предустановочная инструкция, инструкция по быстрому запуску, информация об опасных веществах и материалах).


3. CD/DVD диски - не более 2 шт.

4. Сетевой кабель, 2,5м, вилка CEE 7/7, разъем совместимый с центрифугами Avanti J-15 и Avanti J-15R.

5. Смазка Spinkote.

6. Силиконовая вакуумная смазка в банке с завинчивающейся крышкой, 1 унция (28 г).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0101400

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17313

Лист 6

7. Ключ для ротора.
8. Шестигранный ключ.
9. Инструкция по эксплуатации.
10. Угловой ротор JA-10.100 в составе (при необходимости):
 - угловой ротор JA-10.100 в комплекте с крышкой;
 - смазка Spinkote;
 - силиконовая вакуумная смазка в банке с завинчивающейся крышкой, 1 унция (28 г);
 - инструкция на угловой ротор JA-10.100;
 - документация (Перечень документации, поставляемой с ротором, информация о безопасности использования, инструкция на ротор, проверочный лист комплектации).
11. Бакетный ротор JS-4.750 в составе (при необходимости):
 - бакетный ротор JS-4.750 в комплекте с крышкой;
 - смазка Spinkote;
 - силиконовая вакуумная смазка в банке с завинчивающейся крышкой. 1 унция (28 г);
 - бакеты (4 шт.);
 - инструкция на бакетный ротор JS-4.750;
 - документация (Перечень документации, поставляемой с ротором, информация о безопасности использования, инструкция на ротор, проверочный лист комплектации).
12. Бакетный ротор JS-4.750 в составе (при необходимости):
 - бакетный ротор JS-4.750 в комплекте с крышкой;
 - смазка Spinkote;
 - силиконовая вакуумная смазка в банке с завинчивающейся крышкой, 1 унция (28 г);
 - держатели-подвески металлические для многолуночных планшетов, 155 x 128 x 85 мм (4 шт.);
 - инструкция на бакетный ротор JS-4.750;
 - документация (Перечень документации, поставляемой с ротором, информация о безопасности использования, инструкция на ротор, проверочный лист комплектации).
13. Держатели-подвески металлические для многолуночных планшетов, 155 x 128 x 85 мм (2 шт. в наборе) - не более 20 наборов (при необходимости).
14. Уплотнительные кольца резиновые черные, диаметр 30 мм, толщина 3 мм (не более 10 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
15. Защелка в сборе (захват - 1 шт., пружина - 1 шт., шайба - 2 шт.) - не более 20 упаковок (при необходимости).
16. Крышки держателей-подвесок пластиковые в сборе с воздушным фильтром, защелками и резиновым уплотнением, 100 x 145 x 65 мм (2 шт. в наборе) - не более 20 наборов (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0101101

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

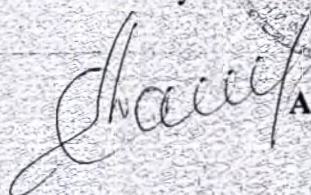
от 23 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17313

Лист 7

17. Подкладки для многолуночных планшетов пластиковые, 102 x 71 x 4 мм (не более 6 шт. в наборе) - не более 20 наборов (при необходимости).
18. Бакеты для ротора JS-4.750 (2 шт. в наборе) - не более 20 наборов (при необходимости).
19. Крышки для бакетов Biocertified (2 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
20. Воздушный фильтр в пластиковом корпусе, высота 9 мм, диаметр 6 мм (не более 65 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
21. Адаптер пробирок 29x 108 мм (6 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
22. Адаптер пробирок 30x115 мм (6 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
23. Адаптер пробирок 18x107 мм (6 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
24. Адаптер пробирок 17x120 мм (6 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
25. Адаптер пробирок 16x82 мм. (6 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
26. Адаптер пробирок 11x39 мм (6 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
27. Модульный адаптер 10 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
28. Модульный адаптер 12 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
29. Модульный адаптер 13 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
30. Модульный адаптер 14 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
31. Модульный адаптер 16 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
32. Модульный адаптер для конических пробирок 18 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
33. Модульный адаптер 18мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
34. Модульный адаптер 30 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0101102

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

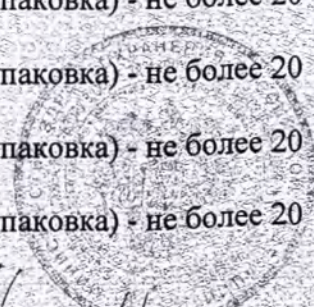
от 23 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17313

Лист 8

35. Модульный адаптер 29 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
36. Модульный адаптер 35 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
37. Модульный адаптер 44 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
38. Модульный адаптер 11 мм (2 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
39. Модульный адаптер 10 мм (2 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
40. Модульный адаптер 12 мм (2 шт./упаковка) не более 20 упаковок (при необходимости).
41. Цельный адаптер под конические пробирки 29 x 115 мм (2/4шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
42. Адаптеры для культуральных флаконов 75 см² (2 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
43. Адаптеры для культуральных флаконов 25 см² (2 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
44. Адаптеры для контейнеров с кровью 90 мм (1 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
45. Адаптеры для контейнеров с кровью 97 мм (1 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
46. Держатели пробирок для контейнеров 11 мм (2 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
47. Держатели пробирок для контейнеров 12 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
48. Держатели пробирок для контейнеров 13 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
49. Держатели пробирок для контейнеров 14 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
50. Держатели пробирок для контейнеров 16 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
51. Держатели пробирок для контейнеров 12 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
52. Держатели пробирок для контейнеров 18 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0101103

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

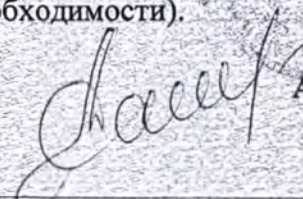
от 23 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17313

Лист 9

53. Держатели пробирок для контейнеров 12 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
54. Держатели пробирок для контейнеров 17 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
55. Держатели пробирок для контейнеров 12 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
56. Держатели пробирок для контейнеров 30 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
57. Держатели пробирок для контейнеров 12 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
58. Держатели пробирок для контейнеров 29 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
59. Держатели пробирок для контейнеров 12 мм (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
60. Держатели пробирок для контейнеров 62 мм (4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
61. Набор металлических держателей, 126 x 87 x 60 мм (2/4 шт./упаковка) не более 20 упаковок (при необходимости).
62. Адаптеры для флаконов и бутылей 62 мм (не более 4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
63. Адаптеры для флаконов и бутылей 62 мм (1 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
64. Адаптеры для флаконов и бутылей 62 мм (1 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
65. Адаптеры для флаконов и бутылей 70 мм (1 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
66. Адаптеры для флаконов и бутылей 96 мм (1 шт./упаковка) - не более 20 упаковок (при необходимости).
67. Крышка с пружинным фиксатором ротора - не более 20 шт. (при необходимости).
68. Завинчивающаяся крышка ротора - не более 20 шт. (при необходимости).
69. Уплотнительное кольцо ротора малое, 3 мм, диаметр 30 мм - не более 20 шт. (при необходимости).
70. Уплотнительное кольцо завинчивающейся крышки ротора большое, резиновое, 2 мм, диаметр 120 мм - не более 20 шт. (при необходимости).
71. Набор держателей (2/4 шт./упаковка) - не более 20 упаковок.
72. Фиксирующий винт - не более 20 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0101104

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 мая 2022 года

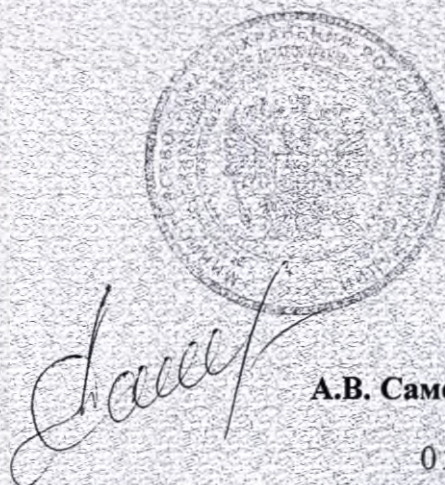
№ РЗН 2022/17313

Лист 10

73. Ключ для ротора с Т-образной рукояткой - не более 20 шт. (при необходимости).
74. Набор для чистки роторов (щетка для чистки ротора 32 и 38 мм, щетка для чистки ротора 16 и 25 мм, раствор для чистки ротора 555 - 2 флакона) - не более 20 наборов (при необходимости).
75. Раствор для чистки роторов 555 в бутылке, 946мл - не более 20 шт. (при необходимости).
76. Смазка Spinkote - не более 20 шт. (при необходимости).
77. Вакуумная смазка, силиконовая - не более 20 шт. (при необходимости).
78. Фиксирующий винт - не более 20 шт. (при необходимости).
79. Ключ для ротора с Т-образной рукояткой - не более 20 шт. (при необходимости).
80. Торцовый ключ металлический, крестообразный, с внешней резьбой - не более 20 шт. (при необходимости).
81. Крышка ротора - не более 20 шт. (при необходимости).

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0101105