

Фотографические изображения

Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Лот: 57235501.

Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Лот: 57235501.





Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Лот: 57235501



Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Лот: 57235501

Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Лот: 57235501, в составе:

1. Калибратор 1 (ACOV2S Cal1), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;
2. Калибратор 2 (ACOV2S Cal2), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;
3. Флакон пустой – 4 шт.;
4. Карточка на контрольном – 1 шт.;
5. Этикетки для флаконов – 12 шт.;
6. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Содержащая анти-SARS-CoV-2 антитела сыворотка крови, используемая для приготовления калибратора, была инактивирована нагреванием в течение 30 минут при 56 °C.

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» («Рох Диагностикс ГмбХ»), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Издание предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рох Диагностикс Рус» (ООО «Рох Диагностикс Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д. 2 Тел: +7 495 229-69-69, факс: +7 495 229-62-64, E-mail: moscow.leser@roche_dia.com

Кат. номер 05200291190


Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Лот: 57235501

1. Калибратор 1 (ACOV2S Cal1), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;



Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Лот: 57235501

2. Калибратор 2 (ACOV2S Cal2), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;

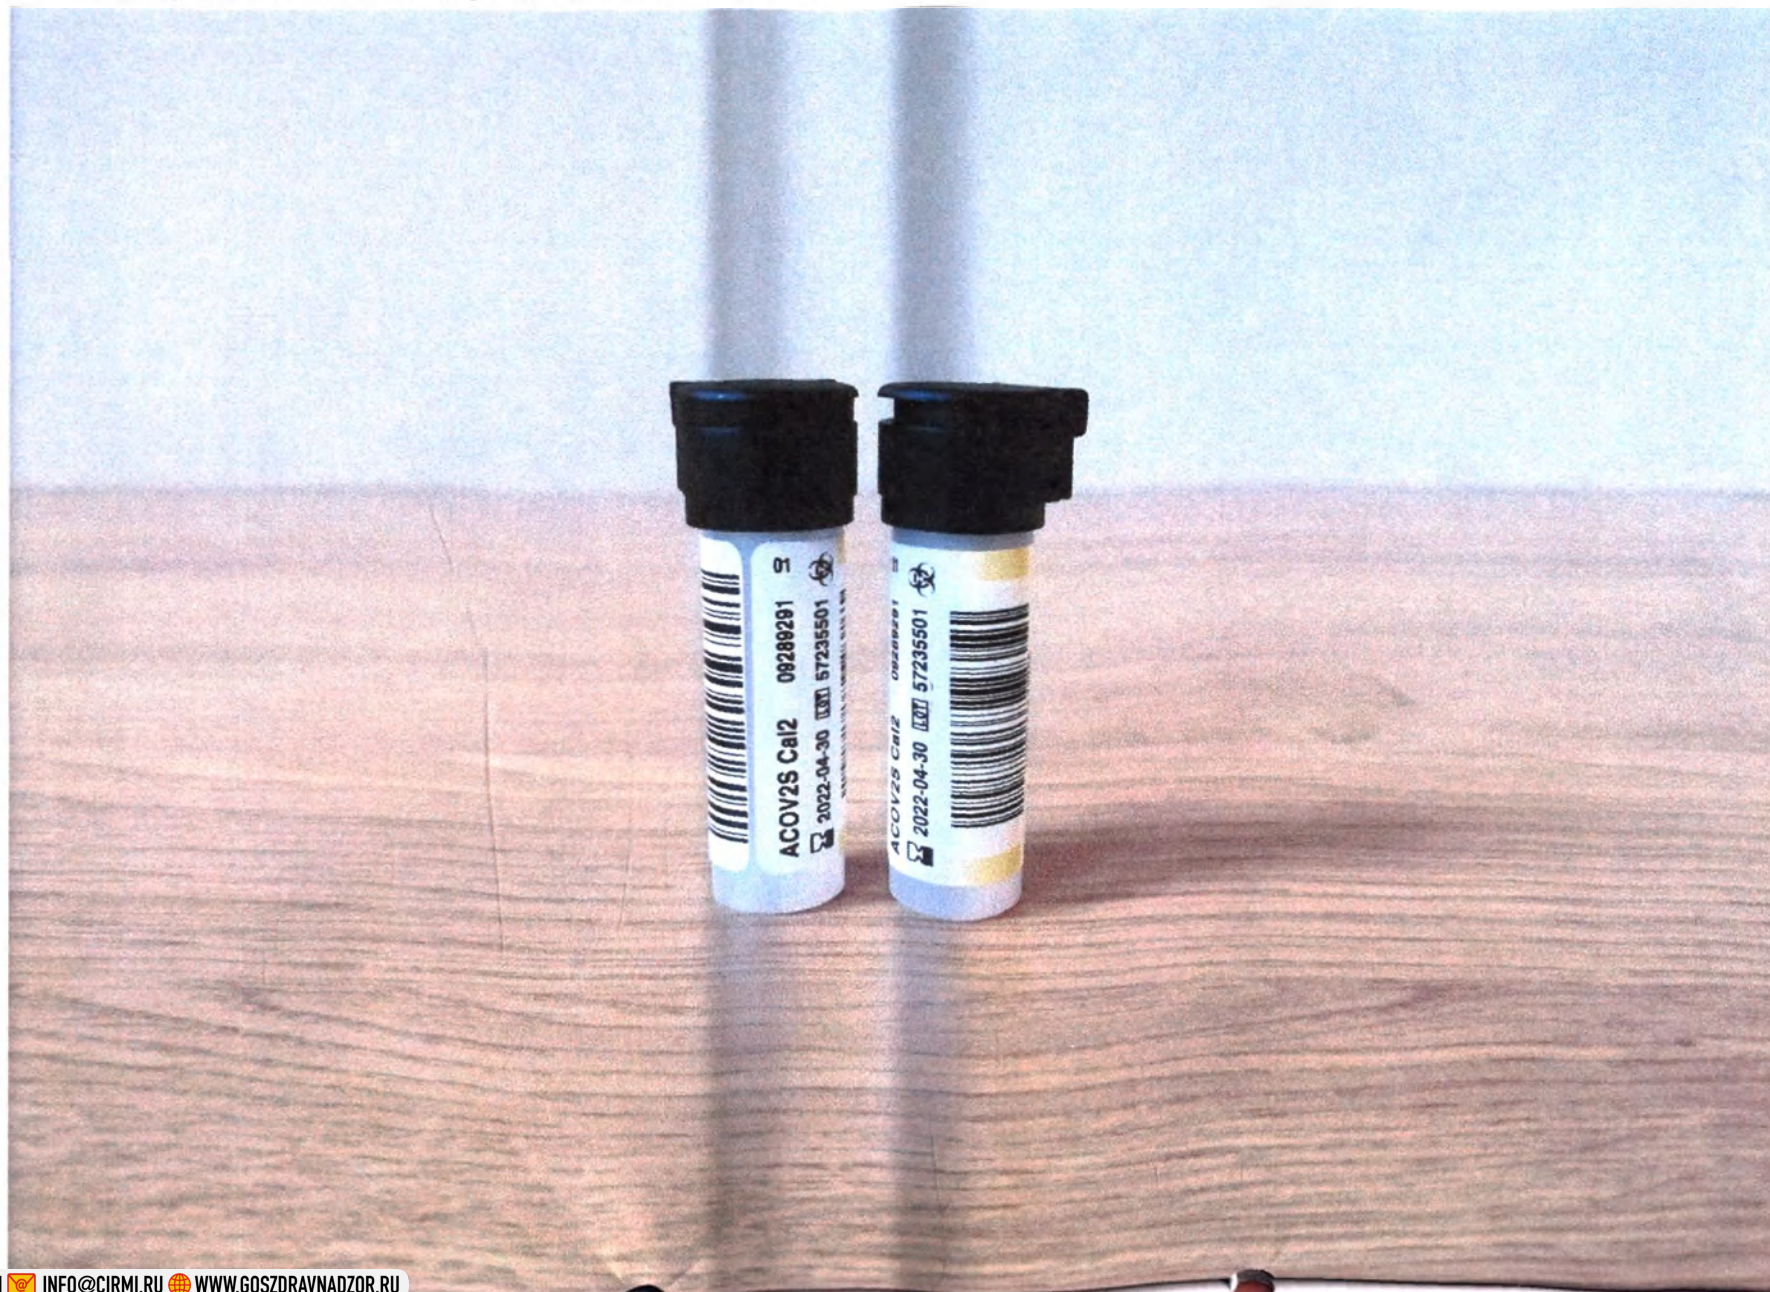

Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Лот: 57235501

3. Флакон пустой – 4 шт.;



Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Лот: 57235501

3. Флакон пустой – 4 шт.;



Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Лот: 57235501

4. Карта со штрих-кодом – 1 шт.;



Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Lot: 57235501

5. Этикетки для флаконов – 12 шт.;



6. Инструкция по применению.

cobas®

[illegible]

Only a few *Leptocarpus* specimens, mostly *L. varians* in origin, were found in the *Leptocarpus* pollen zone.

Ungeplante Ereignisse, wie zum Beispiel ein Brand, können zu erheblichen Schäden an der Infrastruktur führen. Um solche Risiken zu minimieren, ist es wichtig, dass die Betreiber von kritischen Infrastrukturen (KRIs) Maßnahmen ergreifen, um die Widerstandsfähigkeit ihrer Systeme zu erhöhen. Dies kann durch die Implementierung von Redundanz, die Schulung von Personal und die Durchführung von Notfallübungen erreicht werden.

Uptake of iron is linked to several regulatory mechanisms, including the regulation of iron absorption in the gut.

the 1990s, and a new "regionalism" policy of economic integration in the world.

Wang et al. (2010) suggested a theoretical framework of the relationship between the two variables.

...and ...

Caution: *Not* a primary source; see *Contemporary History* for details.

U.S. Department of Health and Human Services

[illegible][illegible]

For more information, contact: E. Joseph
Wolfe/James Wolfson Center

Crabtree and his wife, if you please, please.

Почвоведение и агрохимия

Рассмотрим взаимодействие сфер с радиусом R и массой m с жестким телом.

применяли в соответствии с п. 1.5. статьи 107 Конституции Российской Федерации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Полностью вводить партия/группы на подготовительном этапе нежелательно и даже

Автоматический способ с 411. Растягивание

остатки на боту бинарната температура 20-25 °C. После изоста-

защиты граждан и их имущества от преступных посягательств.

Cardiophila.

[illegible]

вспомогательных расчистках (каждый из них)

 $-20^{\circ}\text{C} (+5^{\circ}\text{C})$.

Каждому владельцу необходимо иметь

Обратите внимание в описании...

достигает 2-3 метра в диаметре на 150° в радиусе от

with a cold, windy northern winter.

Хранение и стабильность

Хранить при 2-8°С.

оправдана необходимость.

Средняя стоимость единицы продукции

mpm -20 °C (x 5 °C)

1/2

1



по доверенности
от 04.02.2021

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
листа (ов)