


«Утверждаю»
Директор
ООО «Медика Продакт»




Михалева Е.М.
«08» июля 2021 г.


Фотографические изображения медицинского изделия
**«Набор реагентов для диагностики ин витро для
автоматического анализатора ChemWell-RPR (ХемВелл-РПР)»**
производства «Аваренесс Технолоджи, Инк.», США
(«Awareness Technology, Inc.», 1935 S.W. Martin Hwy., Palm City, Florida,
34990 USA; Тел.: +(772) 283-6540.
Факс: + (772) 283-8020, E-mail: chemwellsupport@awaretech.com).

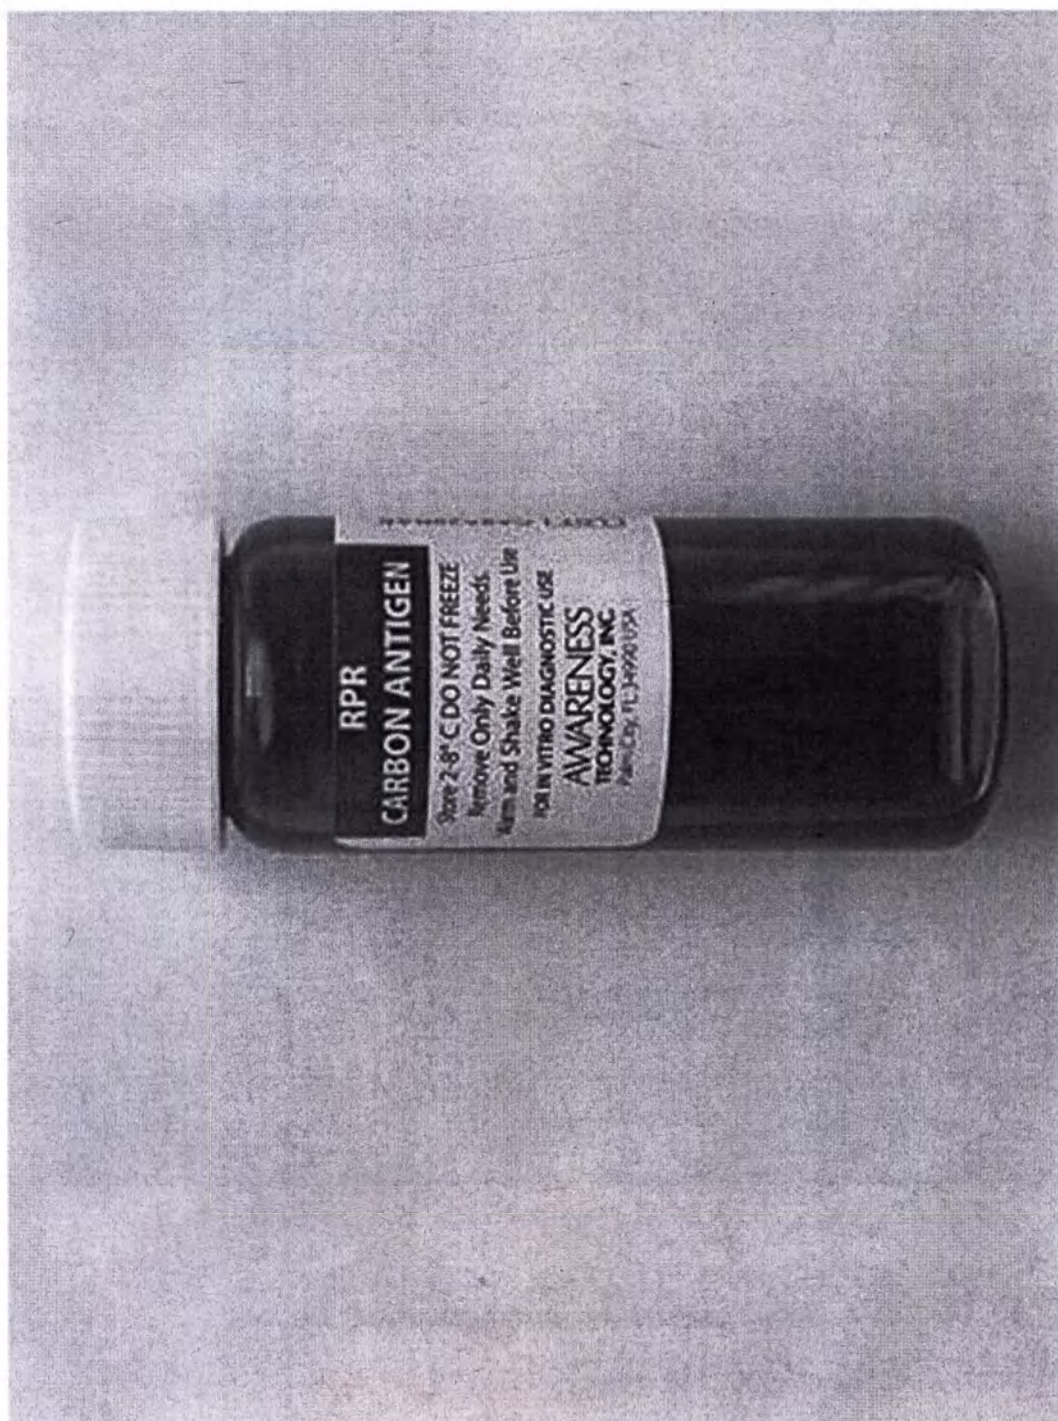


Реагент - RPR-антиген (22мл) - 1 шт.

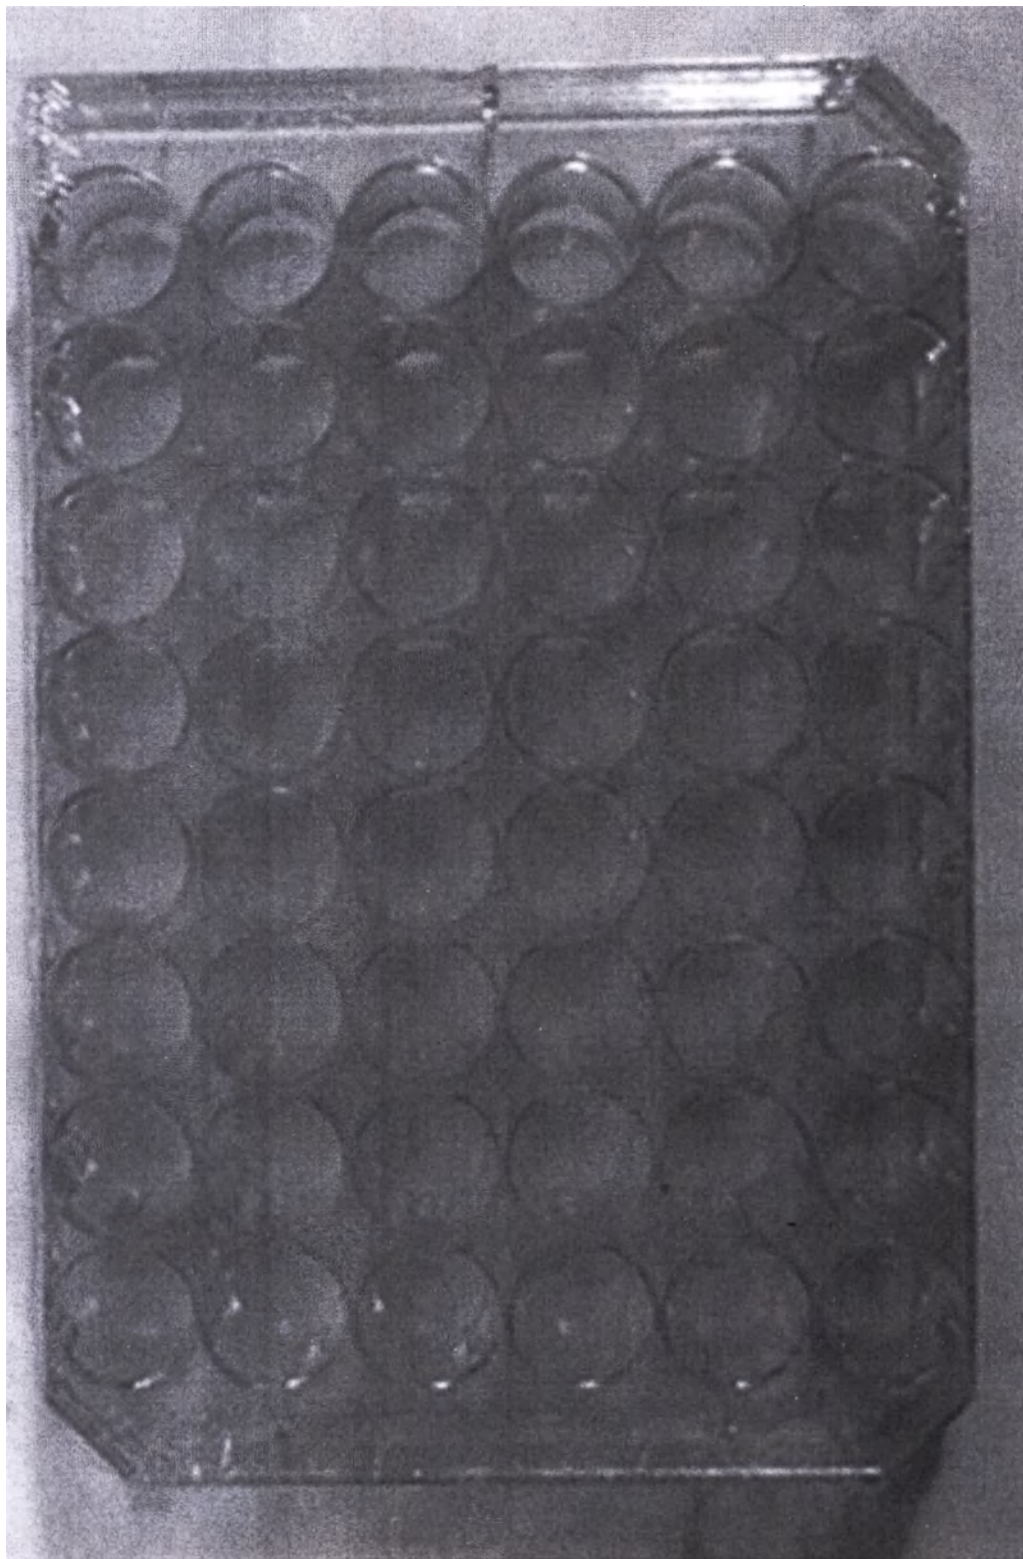

Микропланшет - 10 шт.

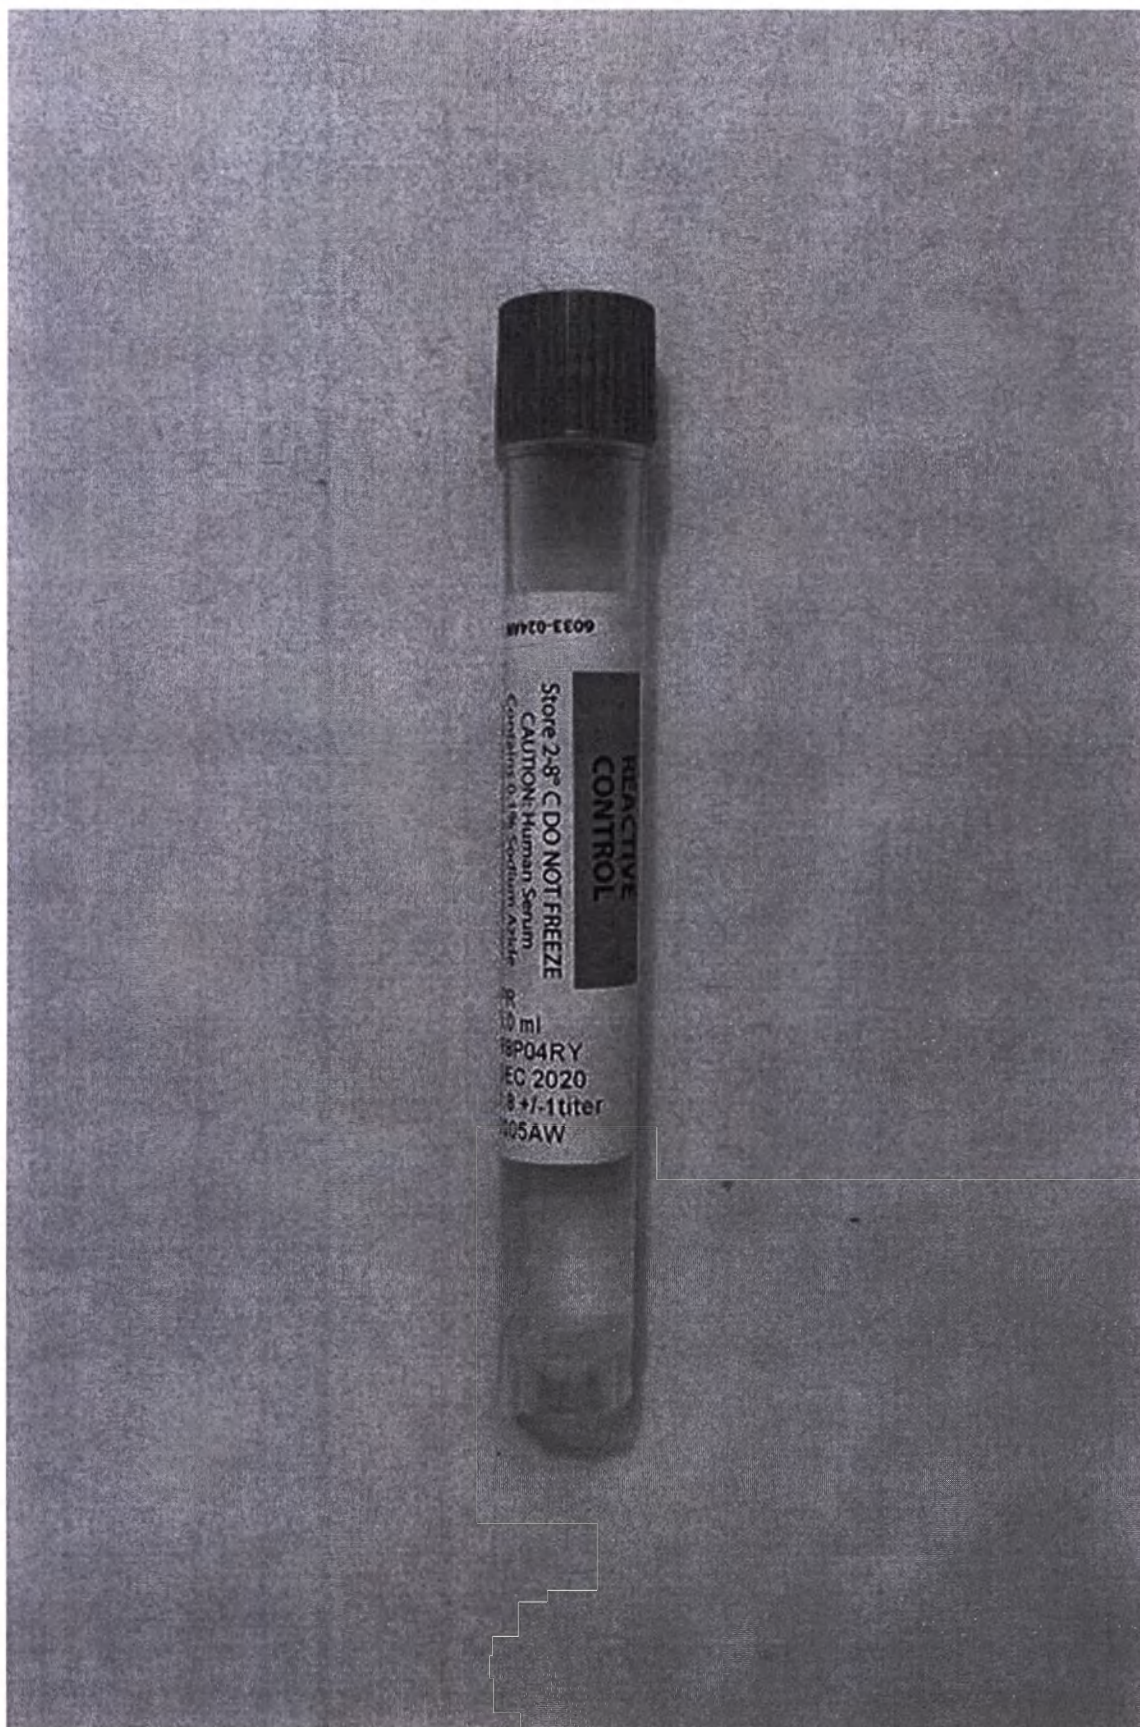

Контрольный материал Reactive control (положительный контроль) - (5 мл) – 1
шт.

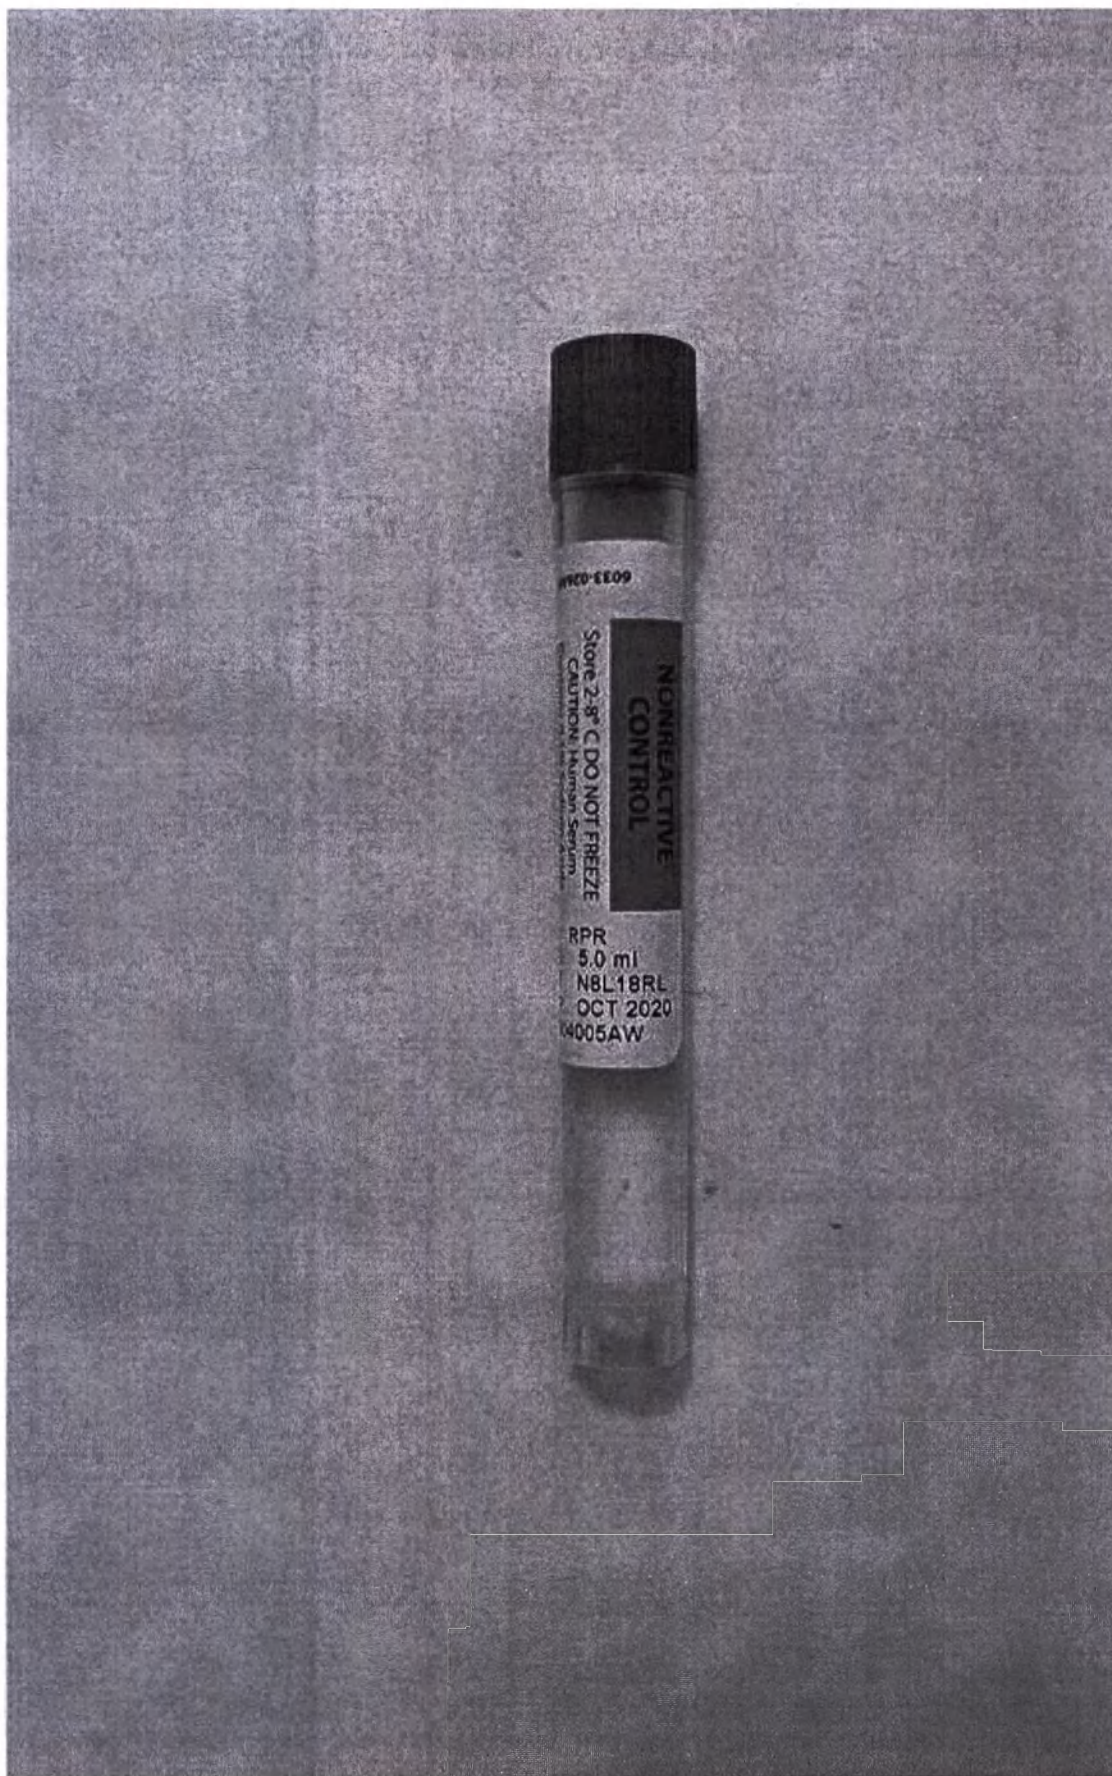

Контрольный материал Nonreactive control (отрицательный контроль) - (5 мл) –
1 шт.

**AWARENESS
TECHNOLOGY, INC.**


AUTOMATED RPR TEST FOR SYPHILIS

Flocculation test for the detection of REAGIN ANTIBODIES in serum or plasma. For use with the ChemWell® RPR Automated Syphilis Analyzer



For *IN VITRO* diagnostic use only

**Temperature Limitation
Do Not Freeze**



WARNING: Contains sodium azide.
and human blood products.



See accompanying instruction.



Manufactured for:
Awareness Technology, Inc.
1935 S.W. Martin Hwy
Palm City, FL 34990 USA



REF

Cat. No.

480 Tests
900480AW





4800 Tests
9004800AW



R_xOnly

LOT



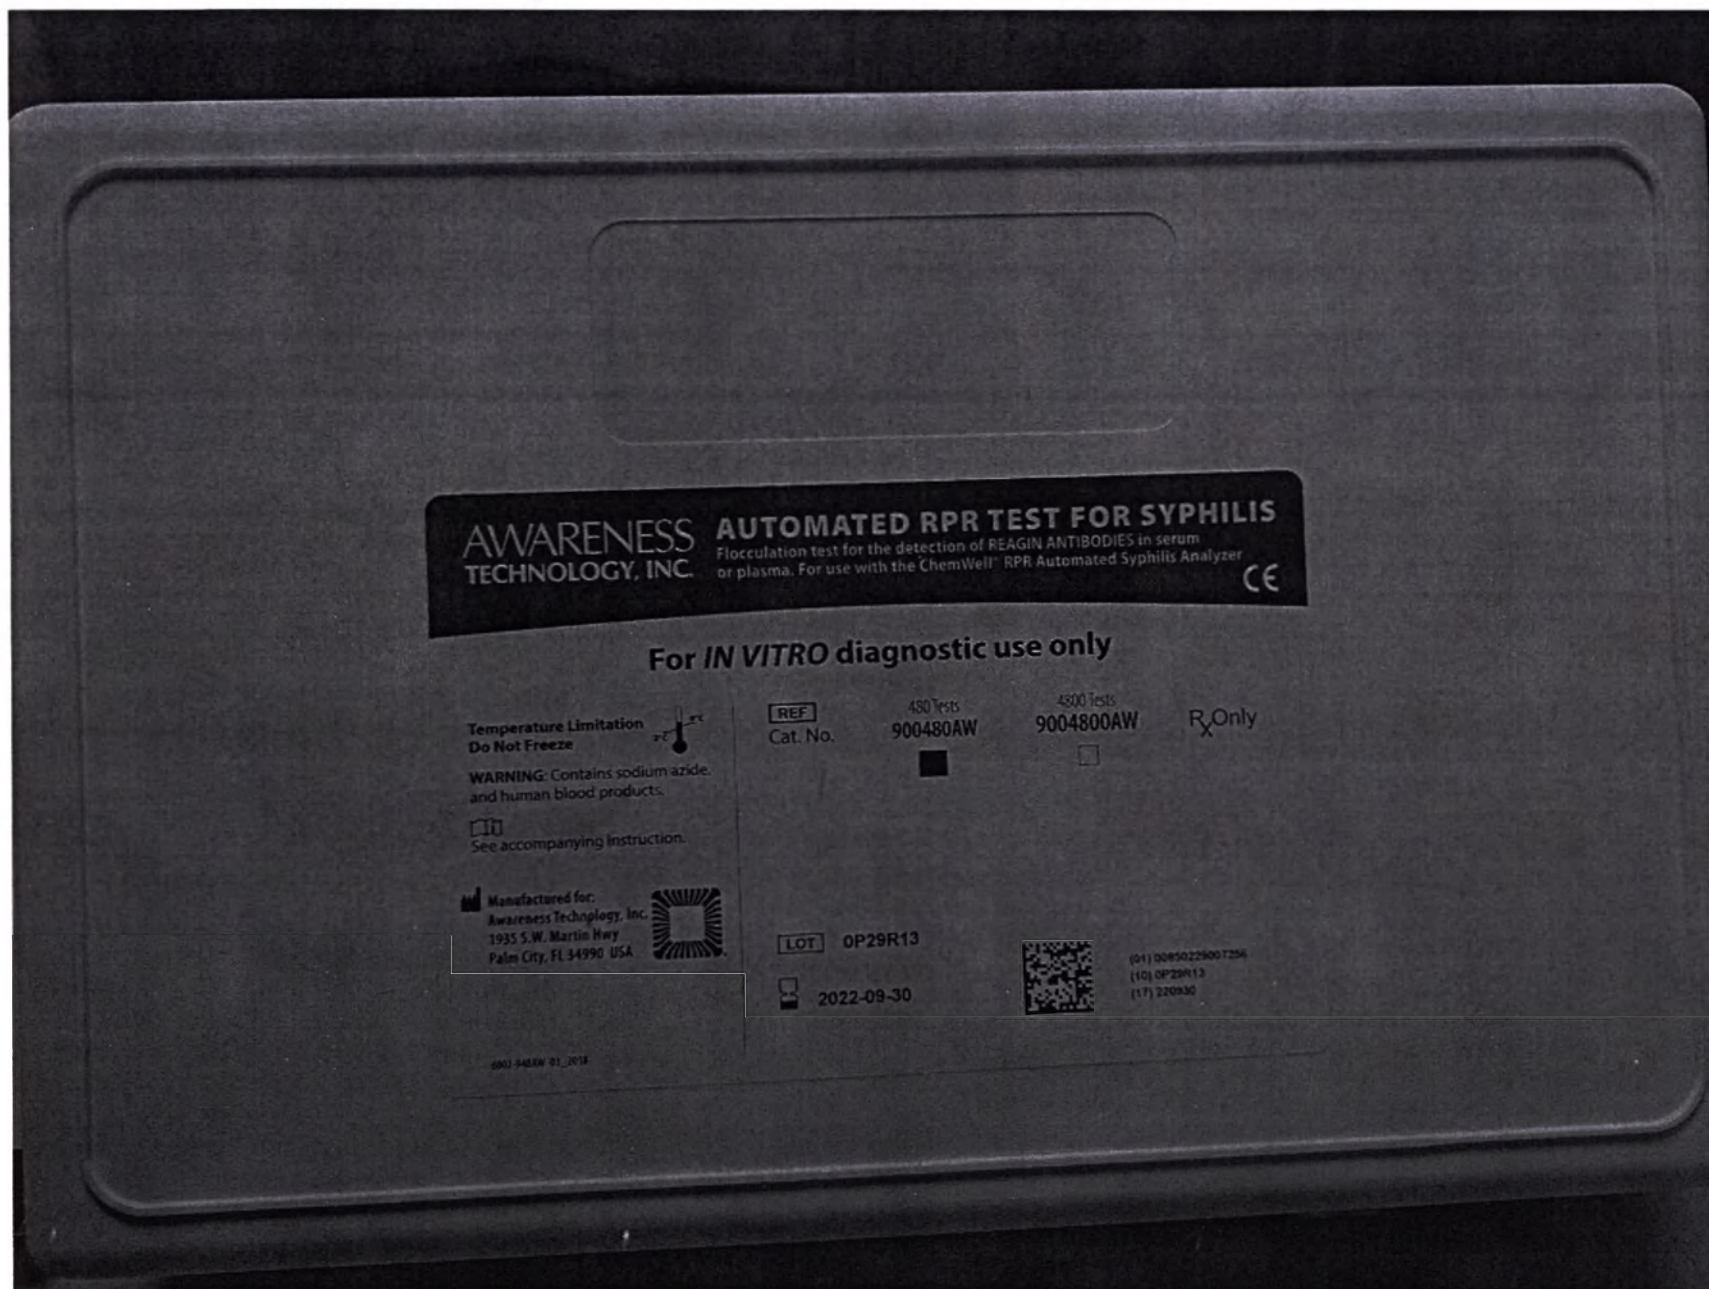

«Набор реагентов для диагностики in vitro для автоматического анализатора ChemWell-RPR (ХемВелл-РПР)» REF _____

QR

Состав:

Инструкция по применению, 1 шт.

Реагент - RPR-антиген (22мл) - 1 шт.

Микропланшет - 10 шт.

Контрольный материал Reactive control (положительный контроль) - (5 мл) – 1 шт.

Контрольный материал Nonreactive control (отрицательный контроль) - (5 мл) – 1 шт.



«Awareness Technology, Inc.»

1935 SW Martin Highway Palm City, FL 34990, USA.

Официальный представитель в России:

ООО «Медика Продакт»

614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27

+7 342 270-08-02

perm@westmedica.com

МАССА НЕТТО _____ КГ


МАССА БРУТТО _____ КГ



ЛОТ



РУ №

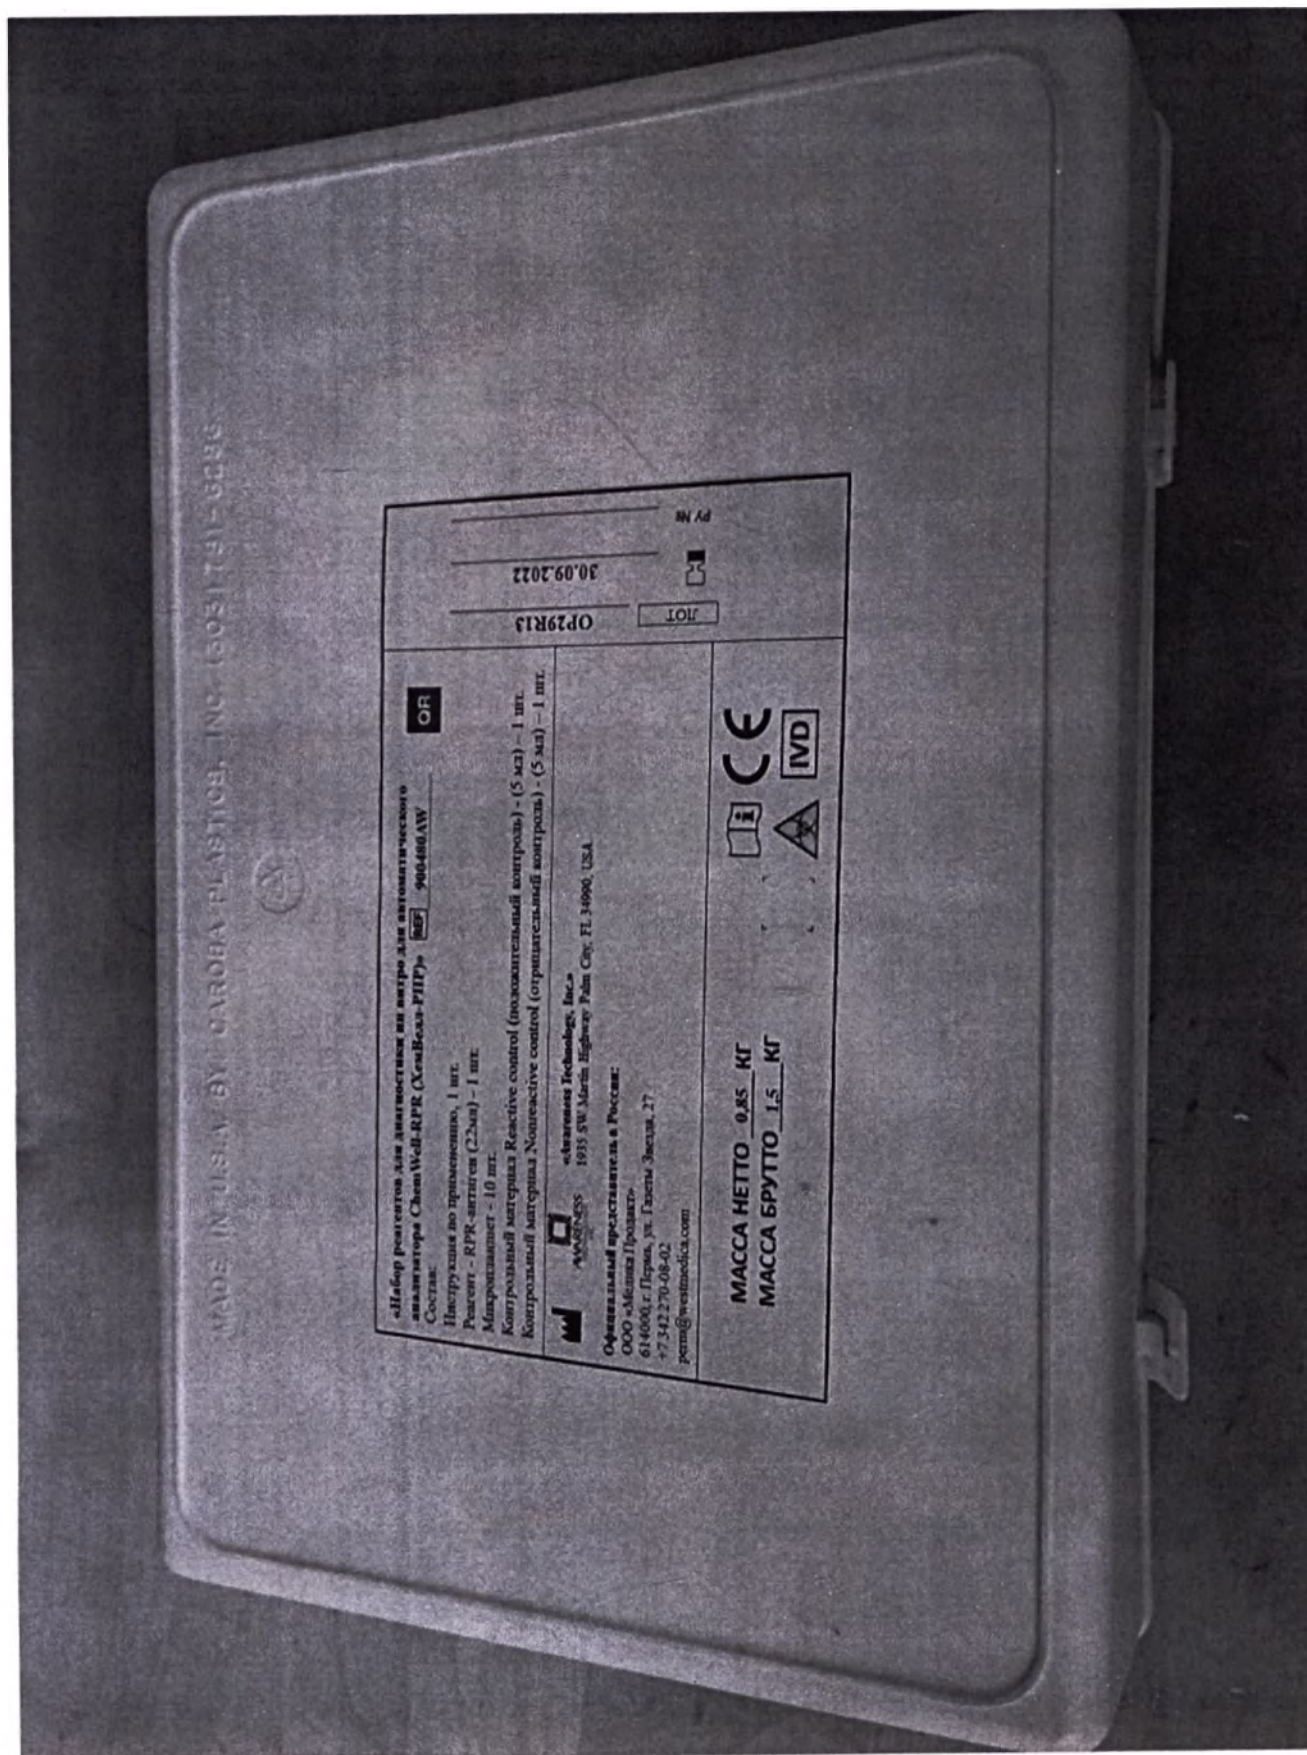

Пример фото маркировки упаковки на русском языке



**AWARENESS
TECHNOLOGY**
Cost Effective by Design

State of FLORIDA
County of MARTIN

The foregoing instrument was acknowledged before me by means of

☒ Physical Presence,

-OR-

☐ Online Notarization.

this 4th day of October 2021 by Steve Andrus

Mary Schaefer
Mary Schaefer, Notary Public - State of Florida
☒ Personally known ☐ Produced Identification

Type of Identification Produced


УТВЕРЖДАЮ / APPROVED
«Awareness Technology, Inc.»

Steve Andrus

(подпись/ signature)


M.I./Stamp

10 4 2021



Инструкция по применению (Operator's manual)

«Набор реагентов для диагностики in vitro для автоматического анализатора ChemWell-RPR (ХемВелл-РПР)»

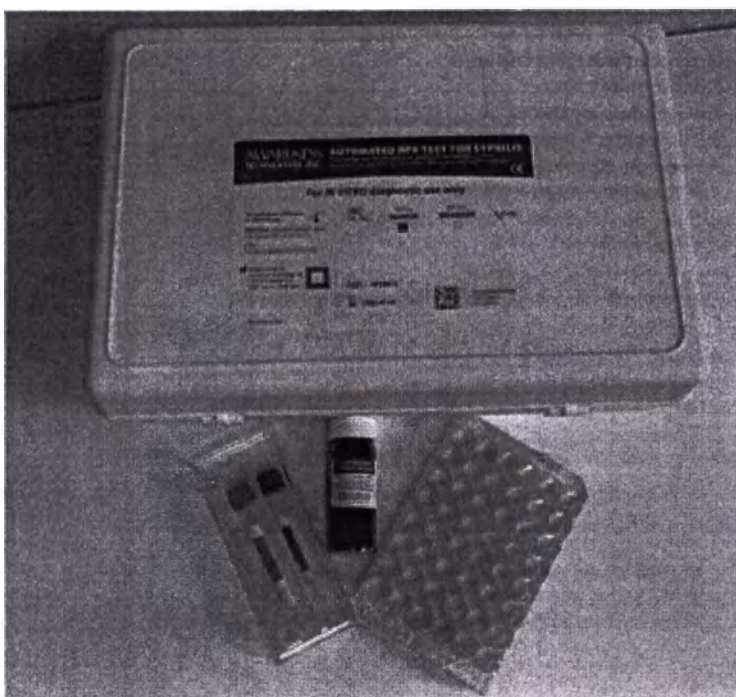

Инструкция по применению

В данном документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
12 лист(ов) бумаги

Михалева Е. М., Директор

