

«Утверждаю»

Директор

ООО «Медика Продакт»

Михалева Е.М.



2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

**«Автоматический анализатор для in-vitro диагностики
сифилиса**

ChemWell-RPR (ХемВелл-РПР)»

производства «Аваренесс Технолоджи, Инк.», США


**(«Awareness Technology, Inc.», 1935 S.W. Martin Hwy., Palm City, Florida
34990, USA; Тел.: 772-283-6540. Факс: 772-283-8020, E-mail:
chemwellsupport@awaretech.com).**



«Автоматический анализатор для in-vitro диагностики сифилиса
Chem Well-RPR(ХемВелл-РПР)», 1 шт.



USB флешка, 1 шт.

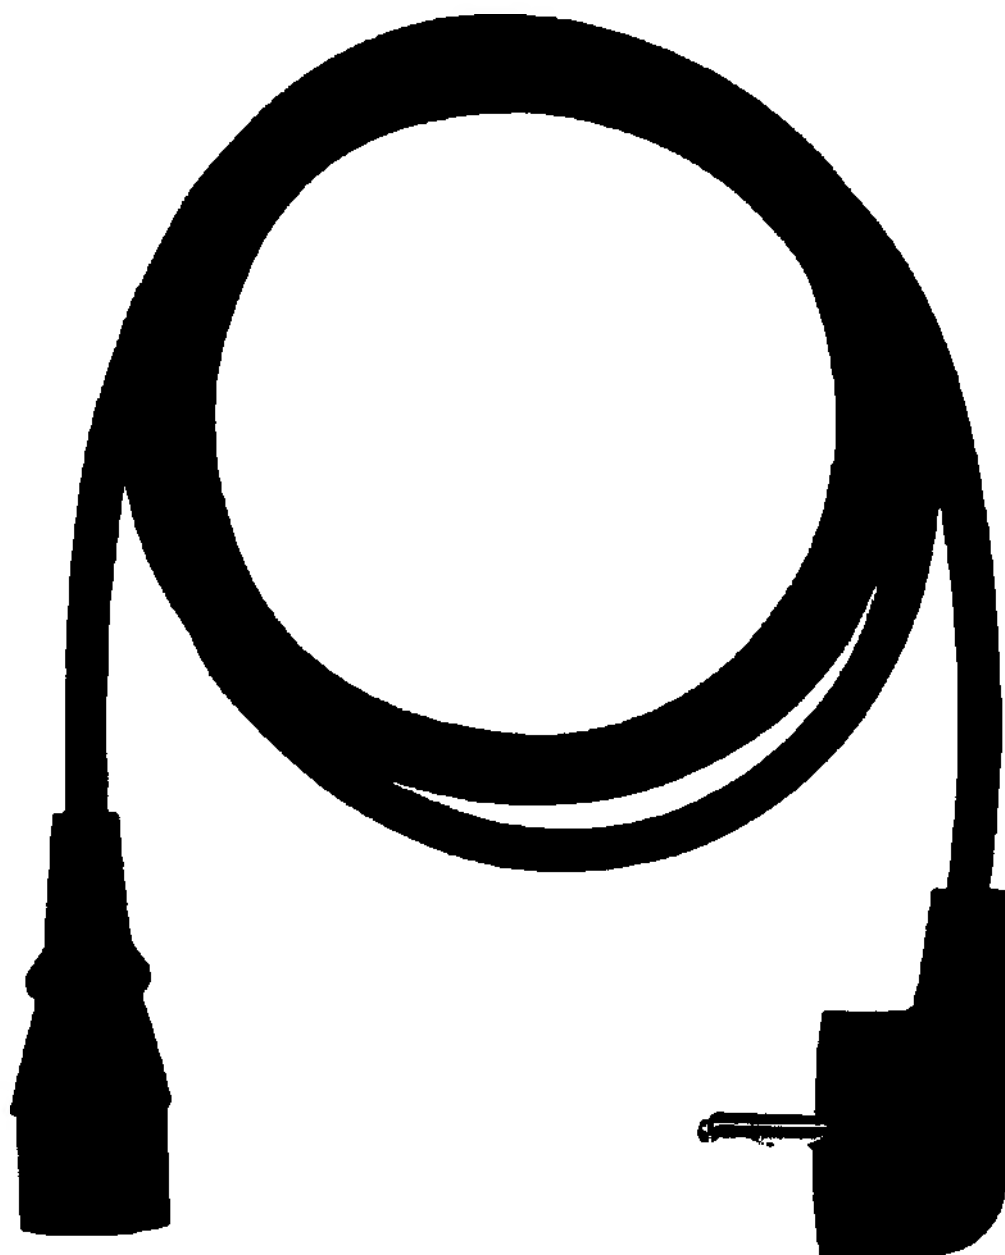


Кабель питания, 1 шт.




Кабель USB, 1 шт.




Штатив для проб, 2 шт.

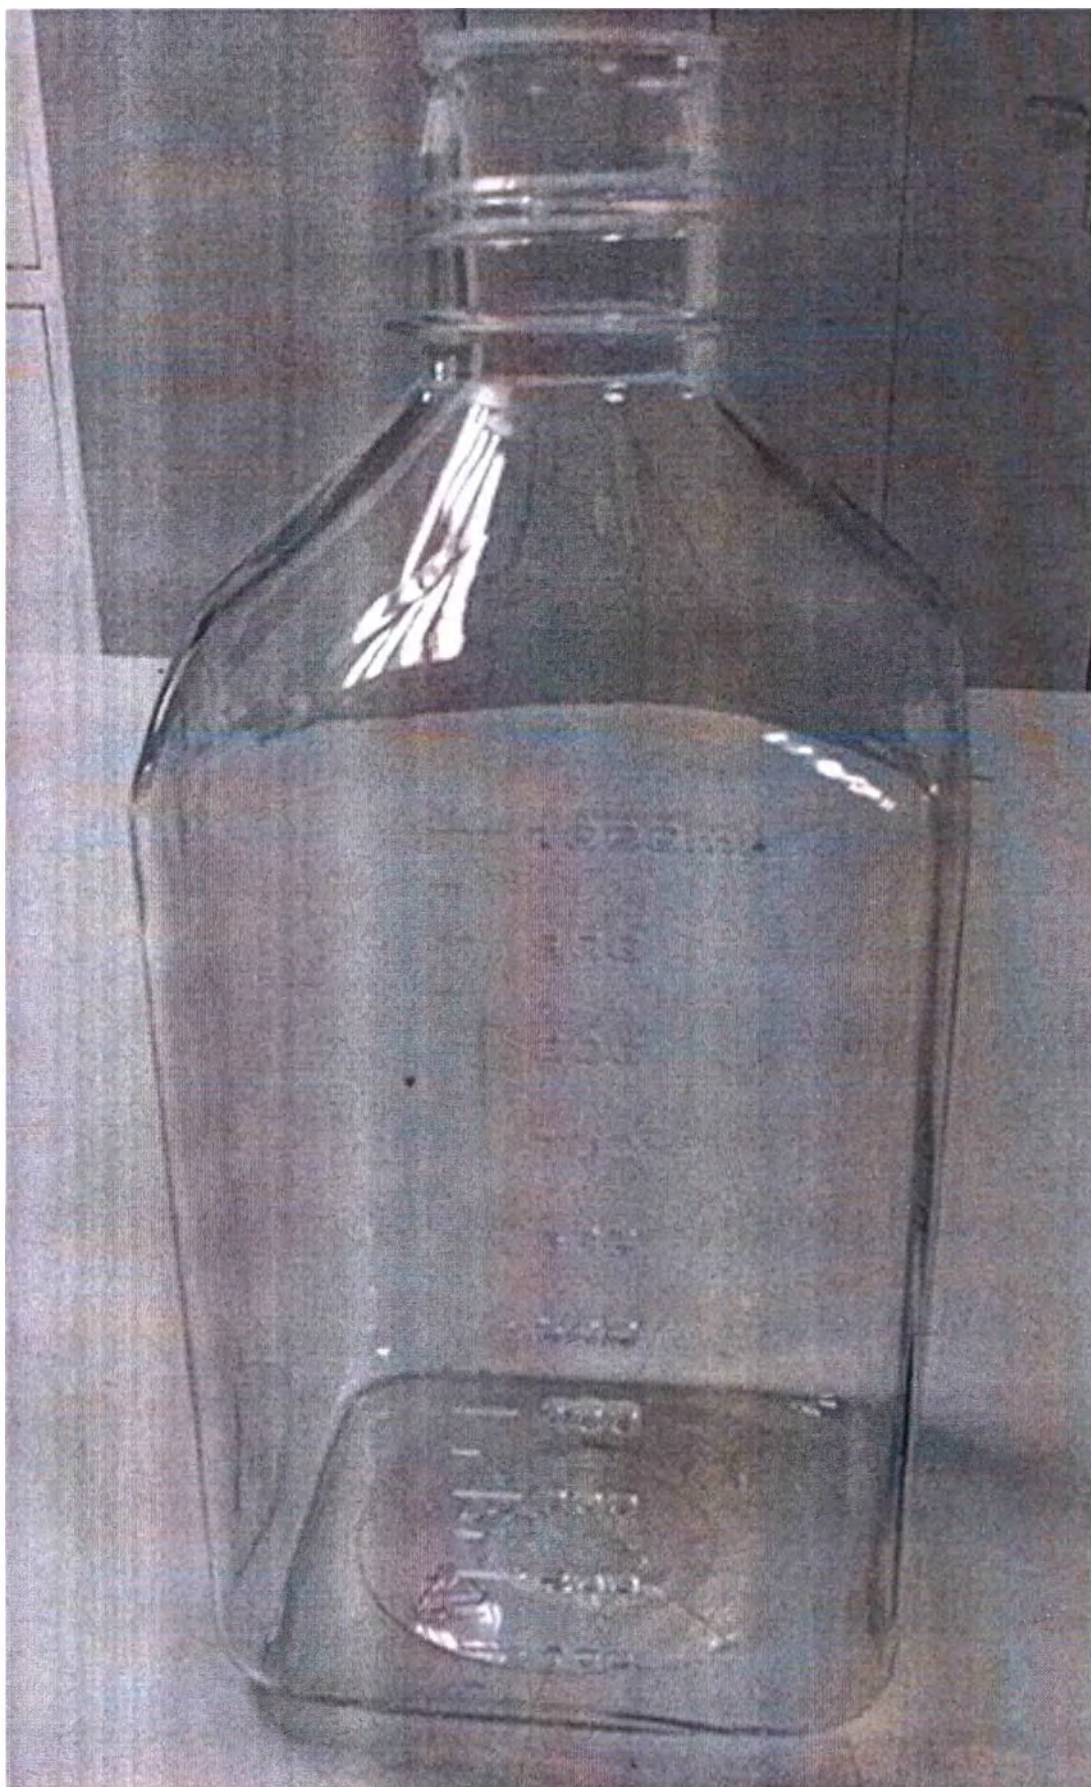


Бутылка для деионизованной воды 1 л, 1 шт.

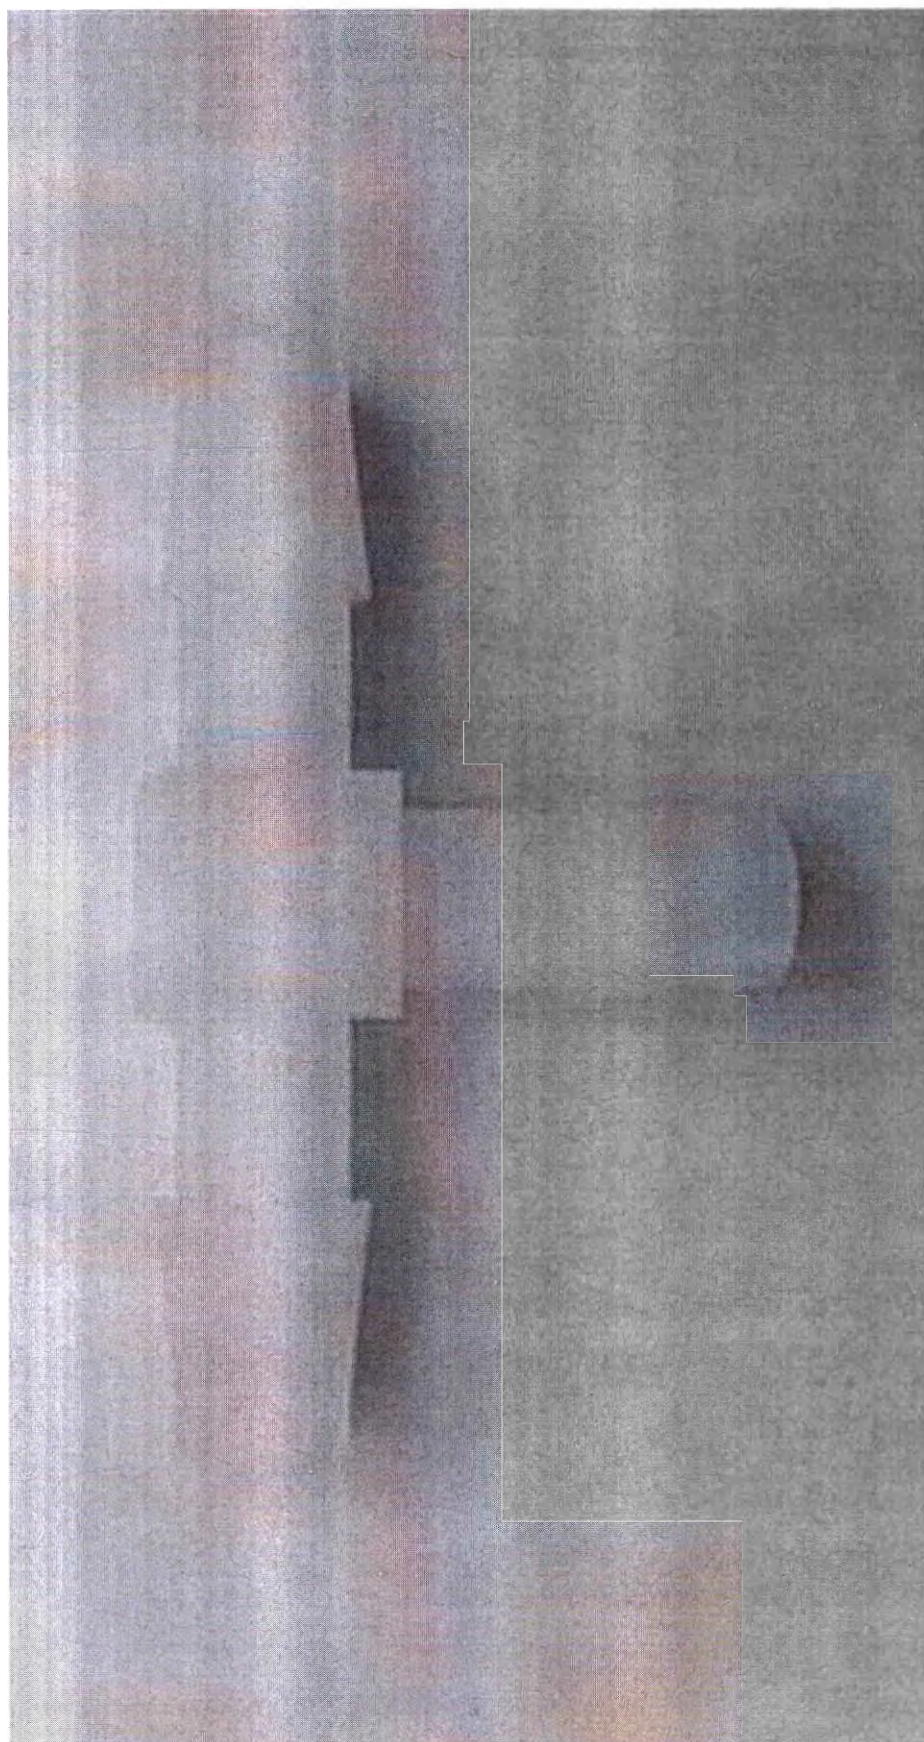

Тройник, 1 шт.

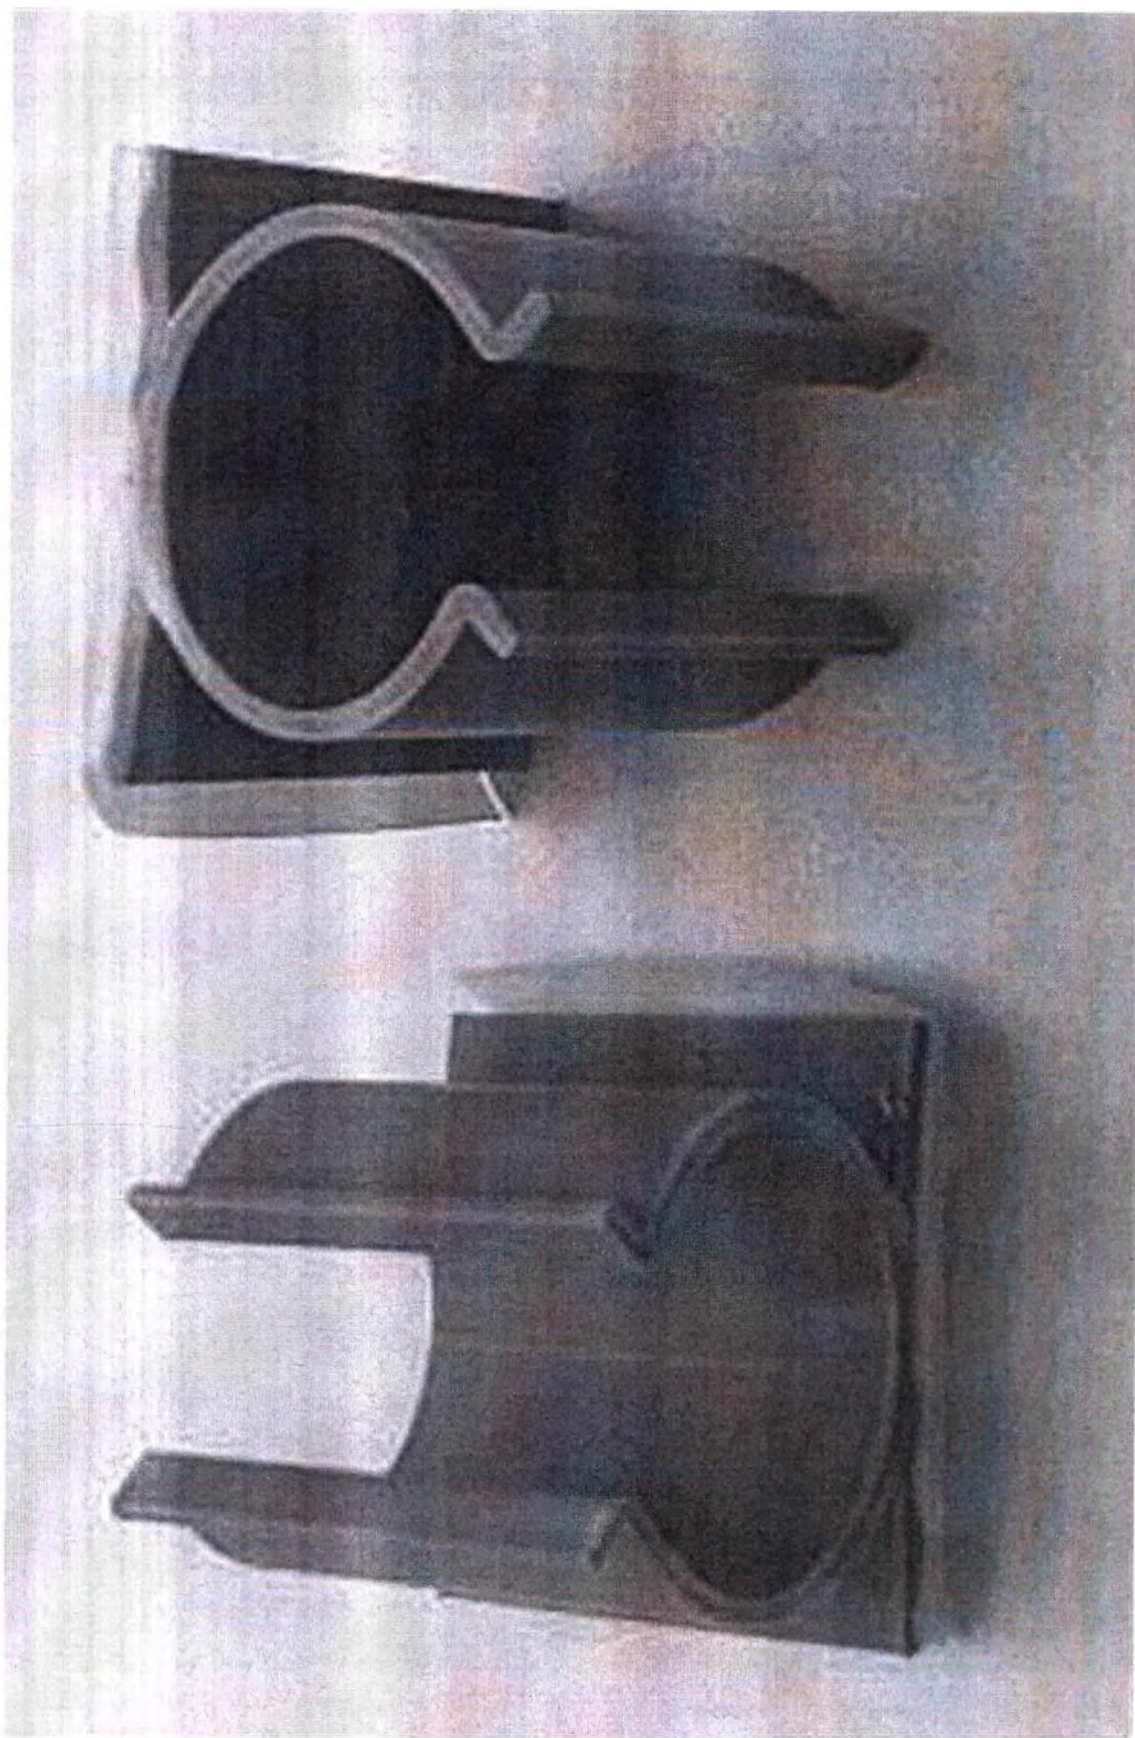

Зажим для трубки для слива отходов, 2 шт.

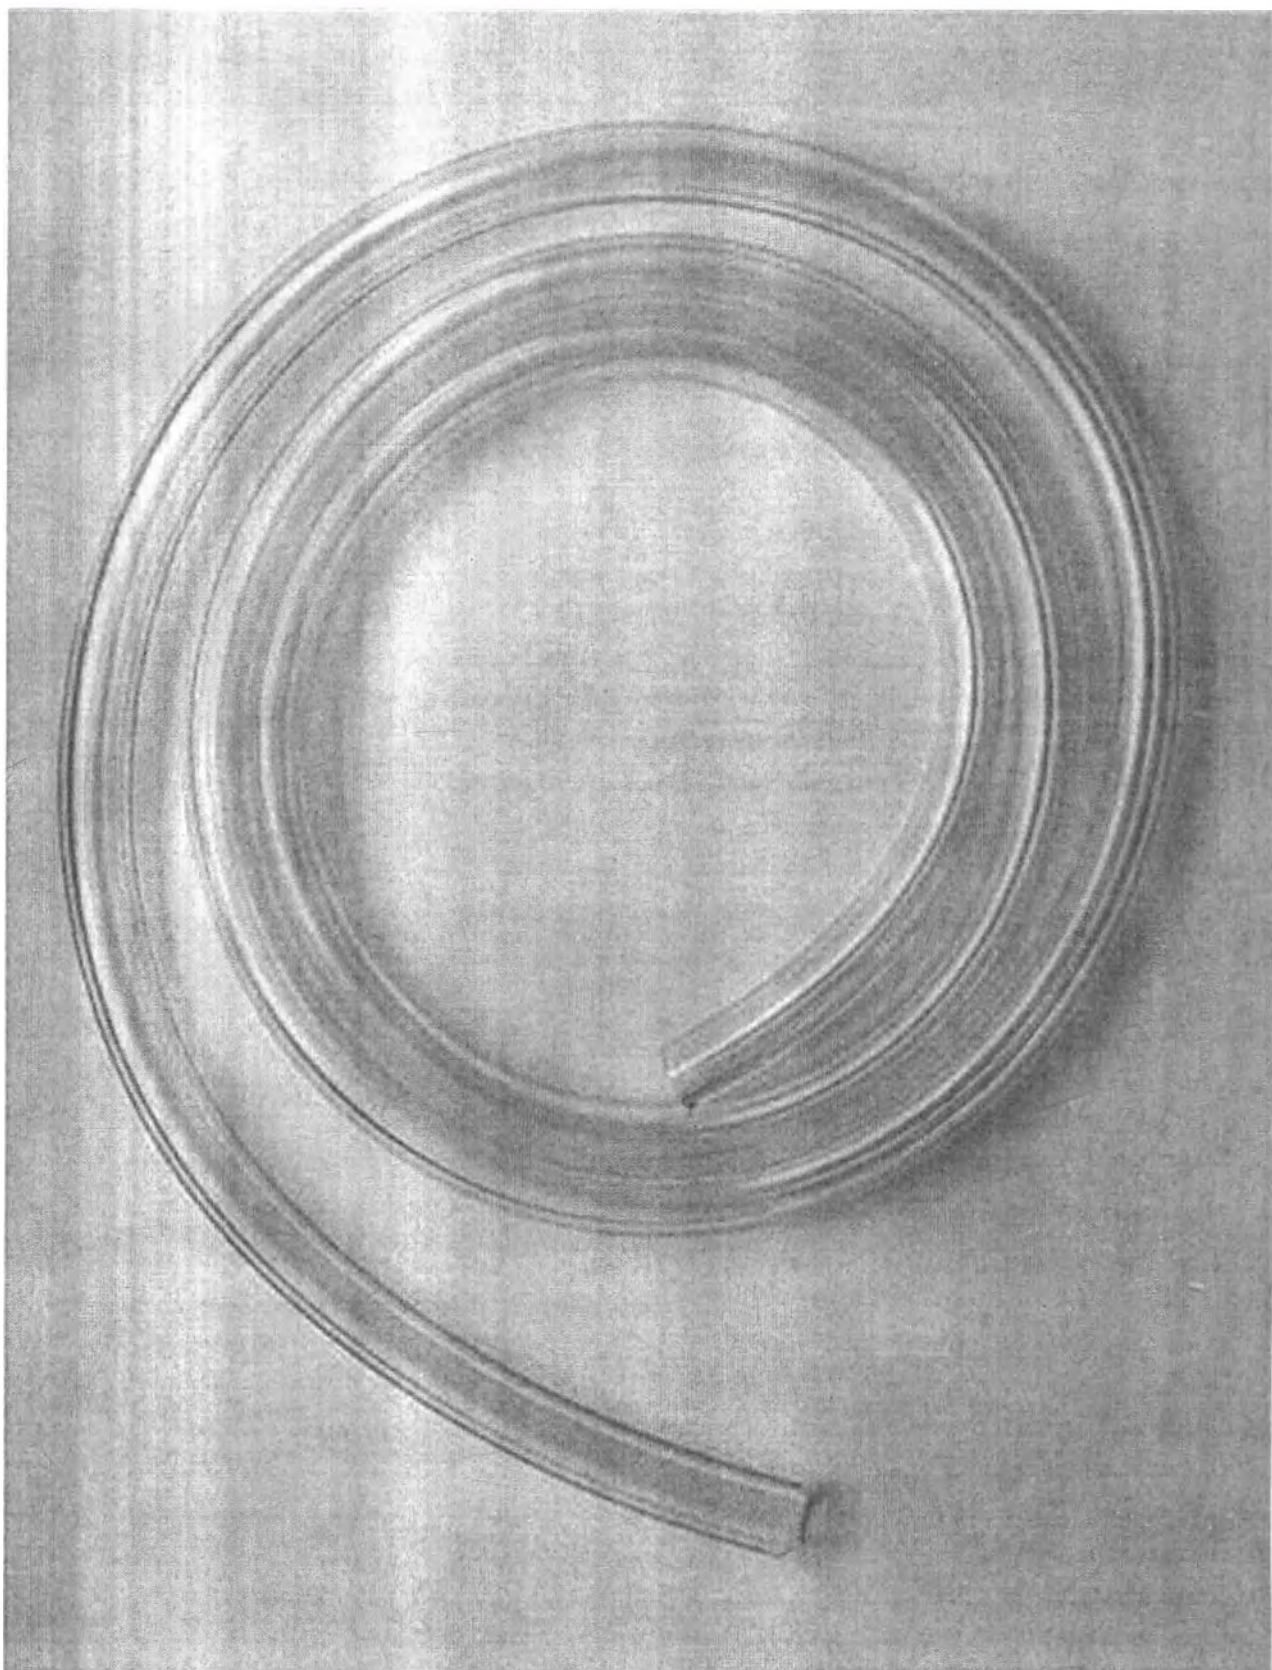

Трубка для слива отходов, 1 шт.



УТВЕРЖДАЮ APPROVED
«Awareness Technology, Inc.»

Steve Andrus

(modicum/ signature)

М.П./Stamp

10.04.2021



Руководство пользователя
(Operator's manual)

«Автоматический анализатор для in-vitro диагностики
сифилиса
ChemWell-RPR (ХемВелл-РПР)»



State of FLORIDA
County of MARTIN


The foregoing instrument was acknowledged before me by means of

☒ Physical Presence,

-OR-

☐ Online Notarization.

this 4th day of October, 2021, by Steve Andrus

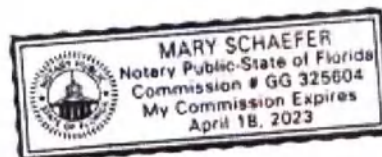

Mary Schaefer

Mary Schaefer, Notary Public - State of Florida

☒ Personally known ☐ Produced Identification Type of Identification Produced _____

Руководство пользователя, 1 шт.



Калибровочная панель, 1 шт.



Комплект ЗИП, 1 шт.

Пример маркировки упаковки на русском языке.

«Автоматический анализатор для
in-vitro диагностики сифилиса
ChemWell-RPR (ХемВелл-РПР)»

QR

REF _____



«Awareness Technology, Inc.»
1935 SW Martin Highway Palm City, FL 34990, USA.

Официальный представитель в России:

ООО «Медика Продакт»
614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27
+7 342 270-08-02
perm@westmedica.com

МАССА НЕТТО _____ КГ
МАССА БРУТТО _____ КГ



IVD

Зав. номер _____



РУ № _____

100-240 В, 50-60 Гц, 160 Вт

Фото маркировки упаковки на русском языке.

«Автоматический анализатор для
in-vitro диагностики сифилиса
ChemWell-RPR (ХемВелл-РПР)»




REF 5801



«Awareness Technology, Inc.»
1935 SW Martin Highway Palm City, FL 34990, USA.

Официальный представитель в России:
ООО «Медика Продакт»
614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27
+7 342 270-08-02
perm@westmedica.com

МАССА НЕТТО 36,5 КГ
МАССА БРУТТО 64,4 КГ



Зав. номер

5801-0103



03.2019

РУ №

100-240 В, 50-60 Гц, 160 Вт

Пример маркировки анализатора на русском языке.

**«Автоматический анализатор для in-vitro диагностики сифилиса
ChemWell-RPR (ХемВелл-РПР)»**

QR

REF _____



«Awareness Technology, Inc.»
1935 SW Martin Highway Palm City, FL 34990, USA.

Официальный представитель в России:
ООО «Медика Продакт»
614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27
+7 342 270-08-02
perm@westmedica.com



IVD




Зав. номер _____



РУ № _____

100-240 В, 50-60 Гц, 160 Вт

Фото маркировки анализатора на русском языке.

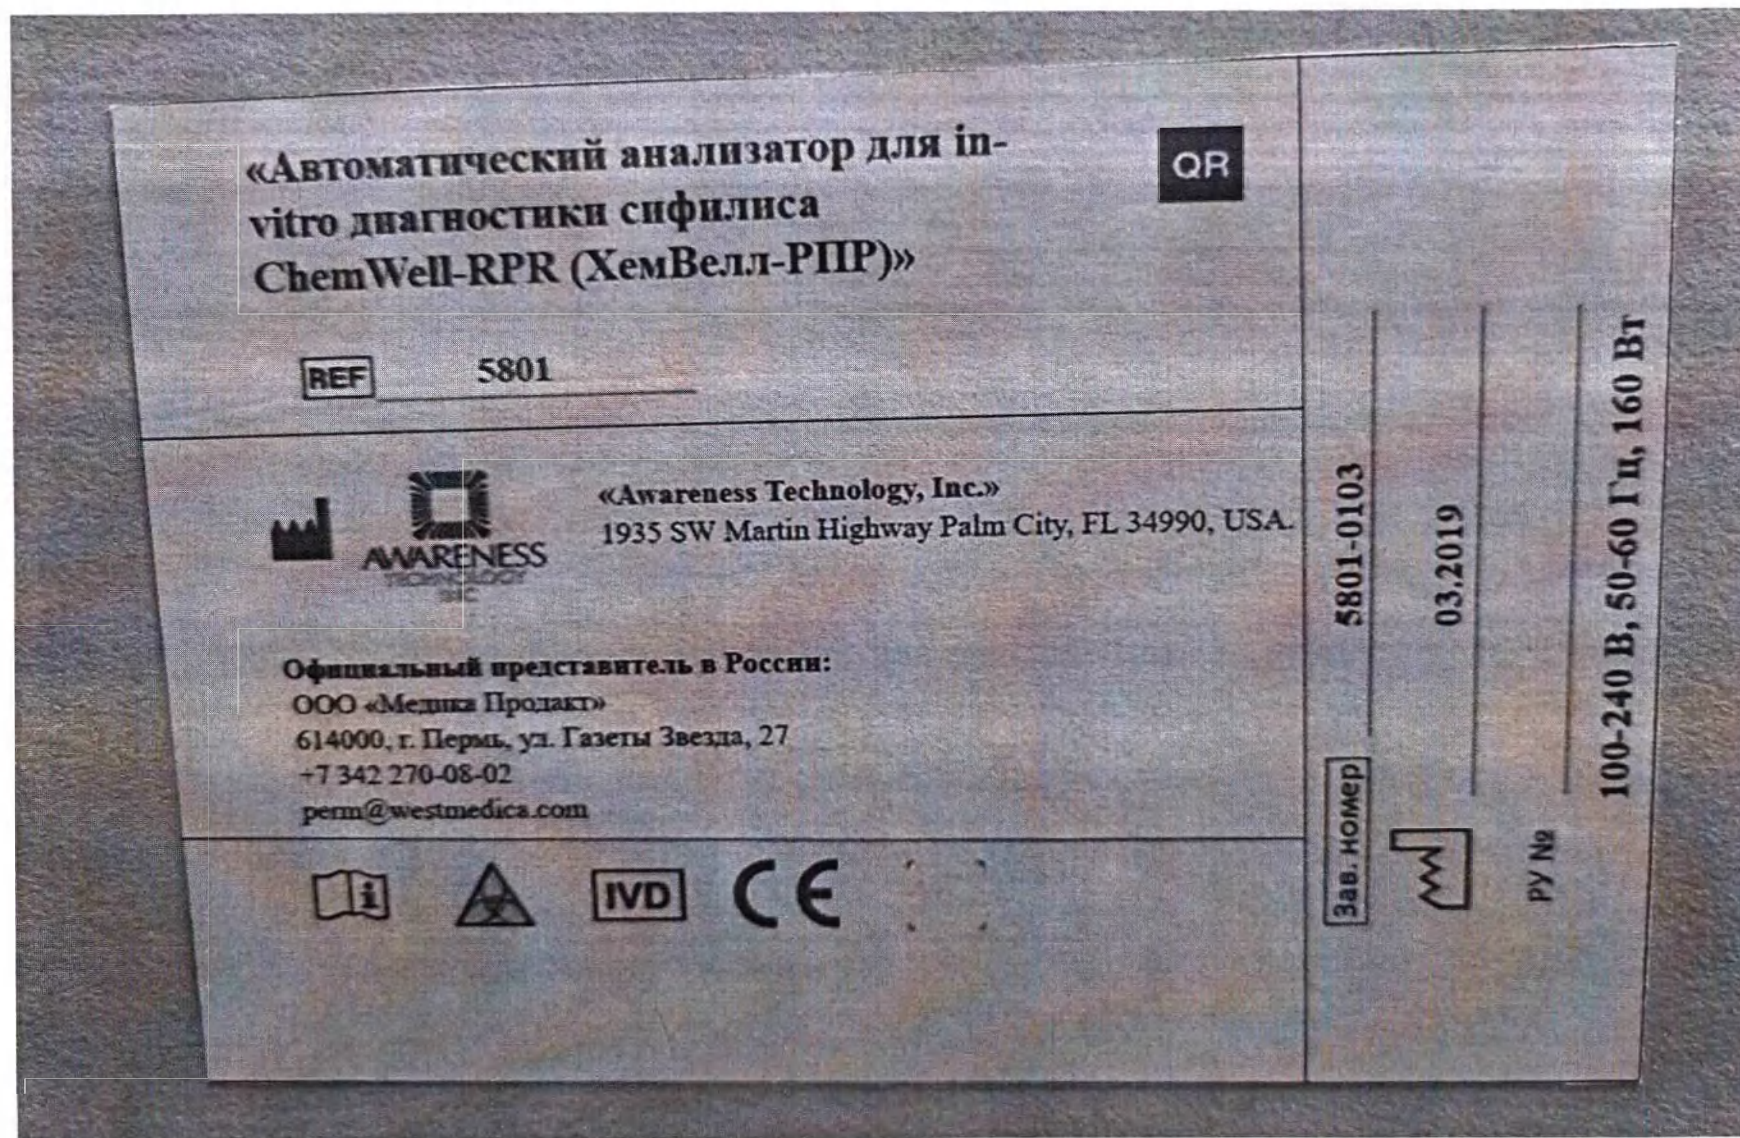

В данном документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
17 лист(-ах/-е) бумаги

Михалева Е. М., Директор

