


Руководитель направления по регистрации продукции
для диагностической визуализации,
высокотехнологичной терапии и
ультразвуковой диагностики
ООО «Сименс Здравоохранение»



Е.С. Тисленко
«28» марта 2022 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**«Система цифровая рентгеновская для маммографии MAMMOMAT Revelation с
принадлежностями»**

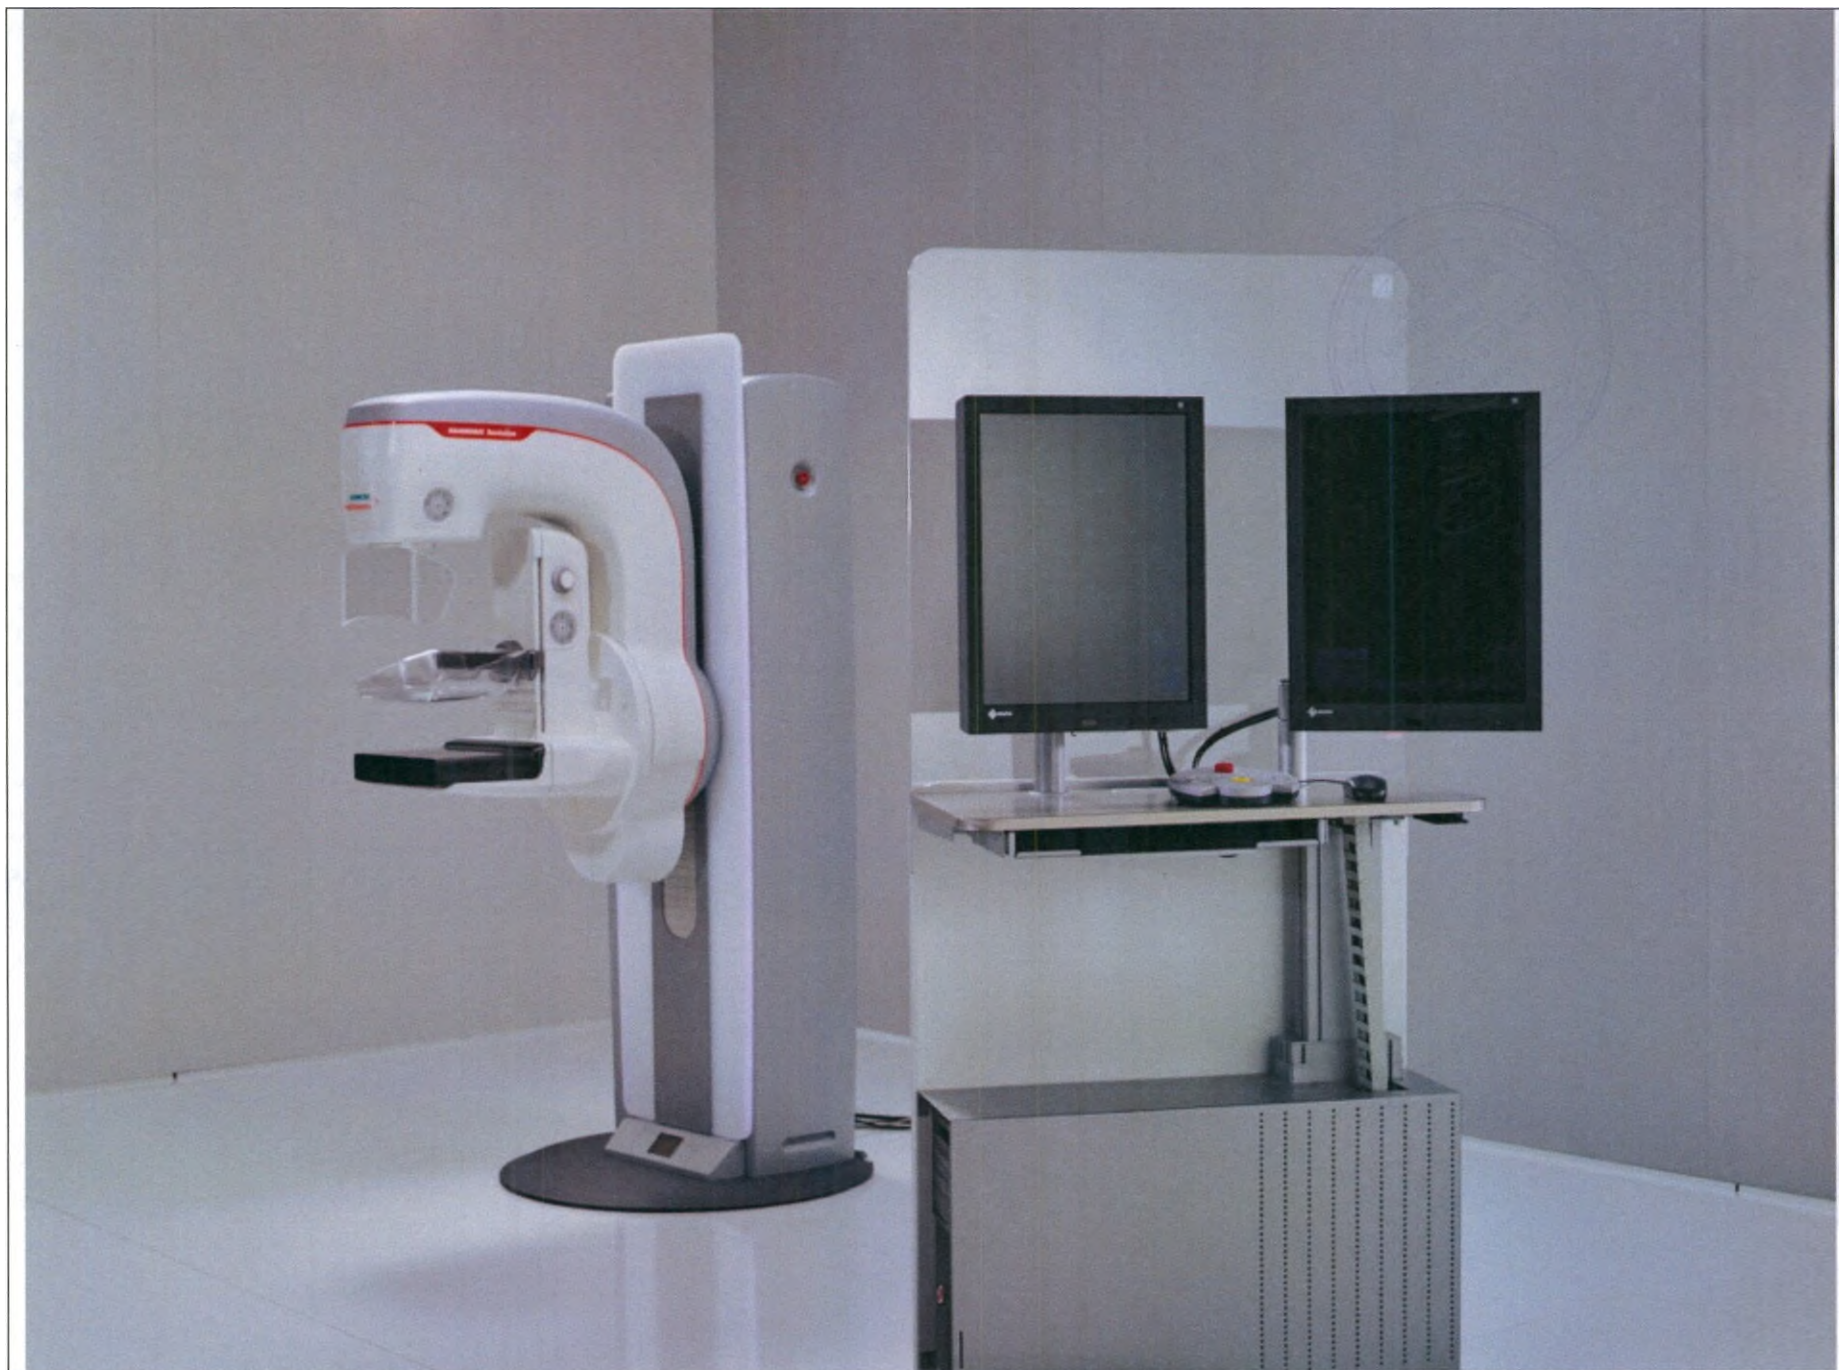

Система цифровая рентгеновская для маммографии MAMMOMAT Revelation с принадлежностями. Фотография общего вида.

Руководитель направления по регистрации продукции
для диагностической визуализации,
высокотехнологичной терапии и
ультразвуковой диагностики
ООО «Сименс Здравоохранение»



Е.С. Тисленко

«28» марта 2022 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**«Система цифровая рентгеновская для маммографии MAMMOMAT Revelation с
принадлежностями»**

Система цифровая рентгеновская для маммографии MAMMOMAT Revelation с принадлежностями

Регистрационное удостоверение: РЗН XXXX/XXXX от dd.мм.гггг

Страна производства: Германия

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствует медицинское изделие; массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.96

~1P/N/PE 208/220/230/240/277 В

50/60 Гц

7,5 кВА / 0,5 кВА

~2P/N/PE 208/220/230/240/277/400 В


Маркировка медицинского изделия на русском языке



1. Стойка с вращающимся маммографическим штативом, цифровым детектором, рентгеновской трубкой, кожухом, генератором и панелями управления.




2. Консоль оператора.

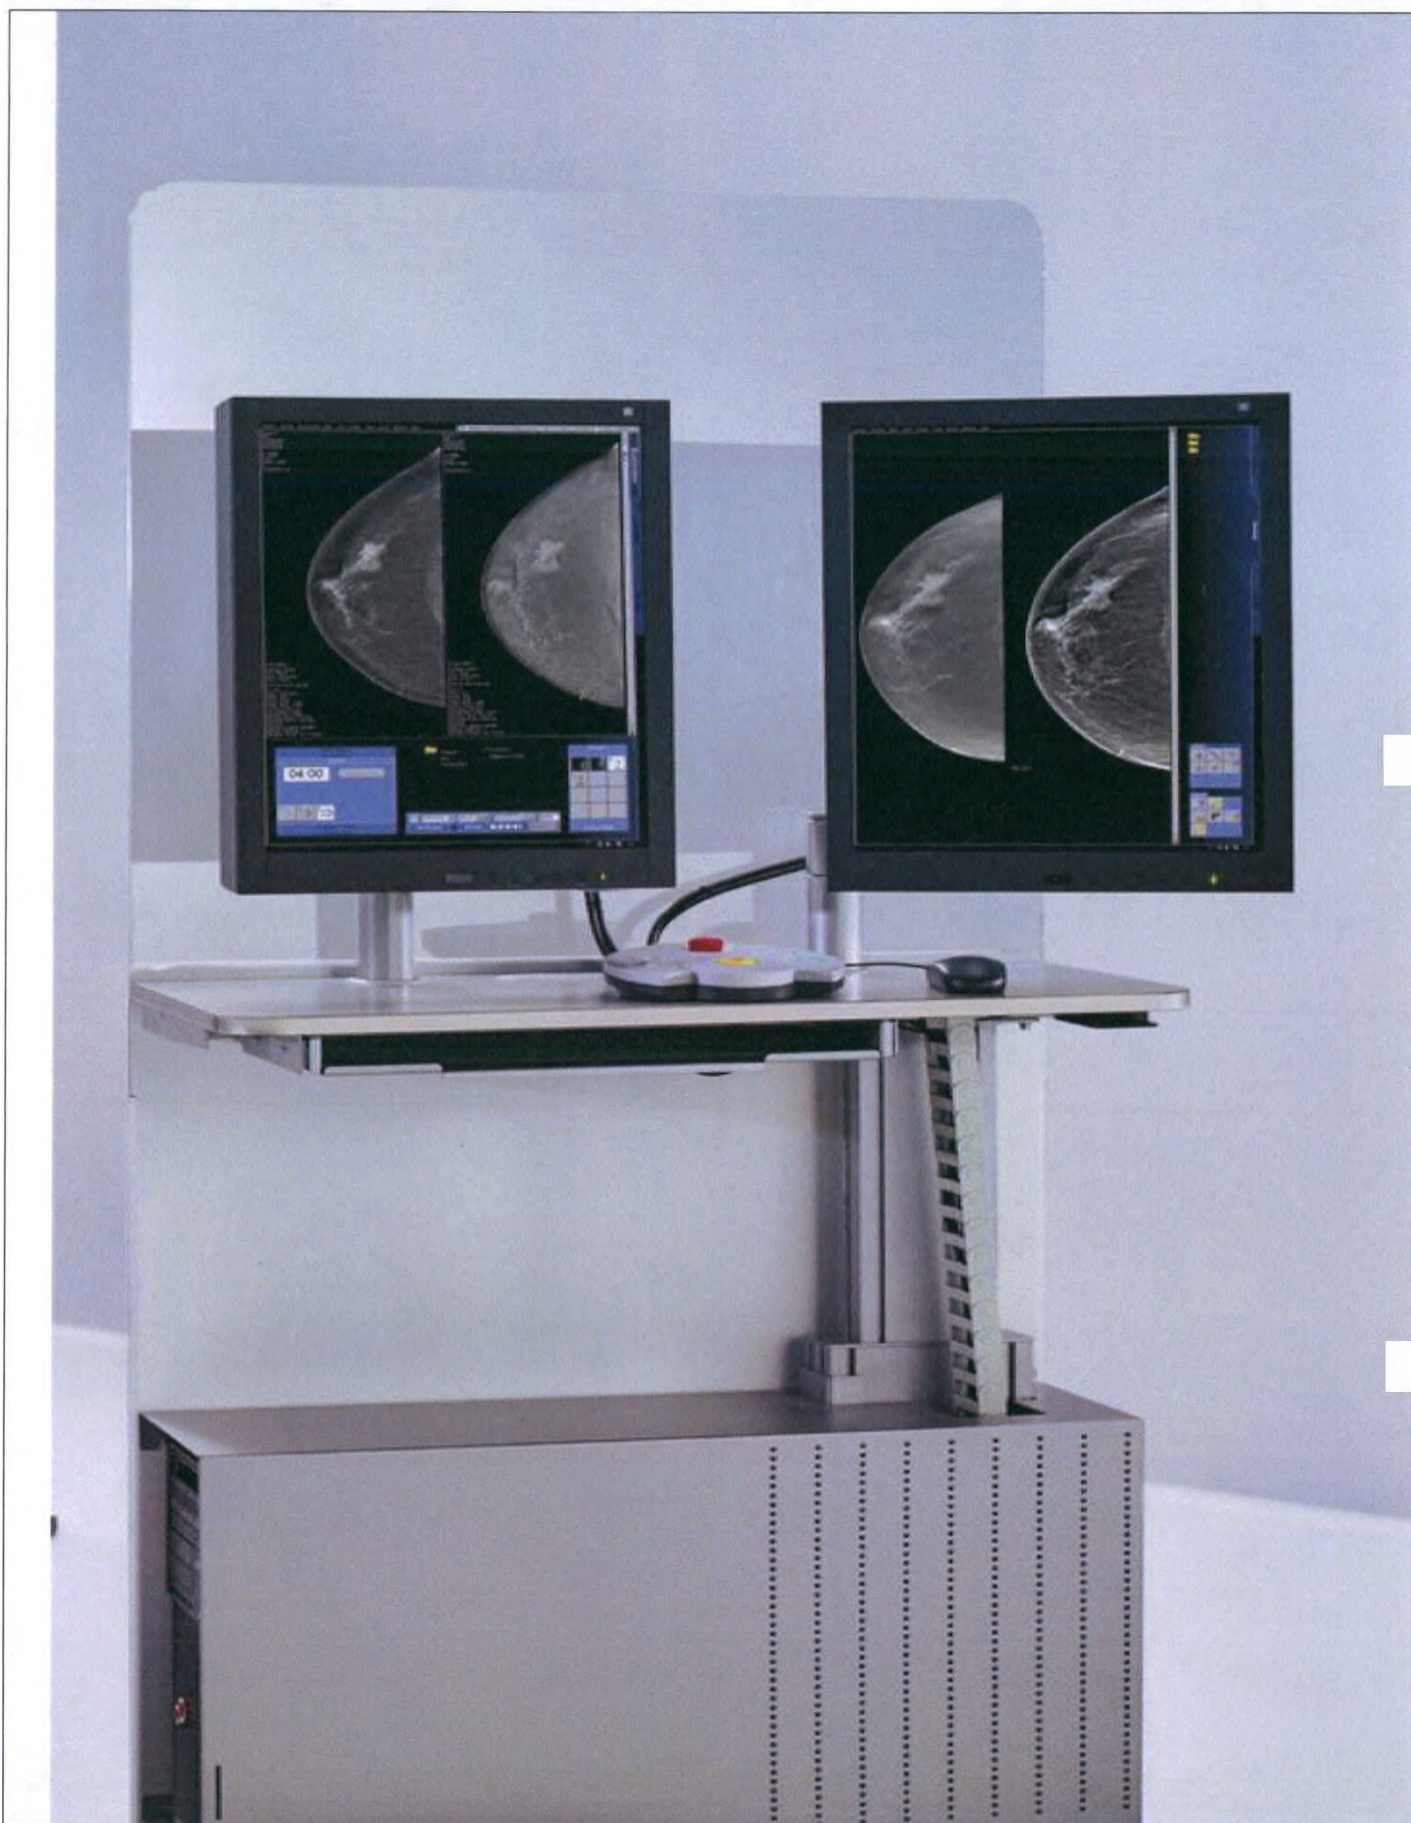

3. Рабочая станция рентгенолаборанта, вариант исполнения:

3.1. Рабочая станция рентгенолаборанта стандартная в составе: блок системный, монитор специальный, клавиатура специальная, мышь специальная.

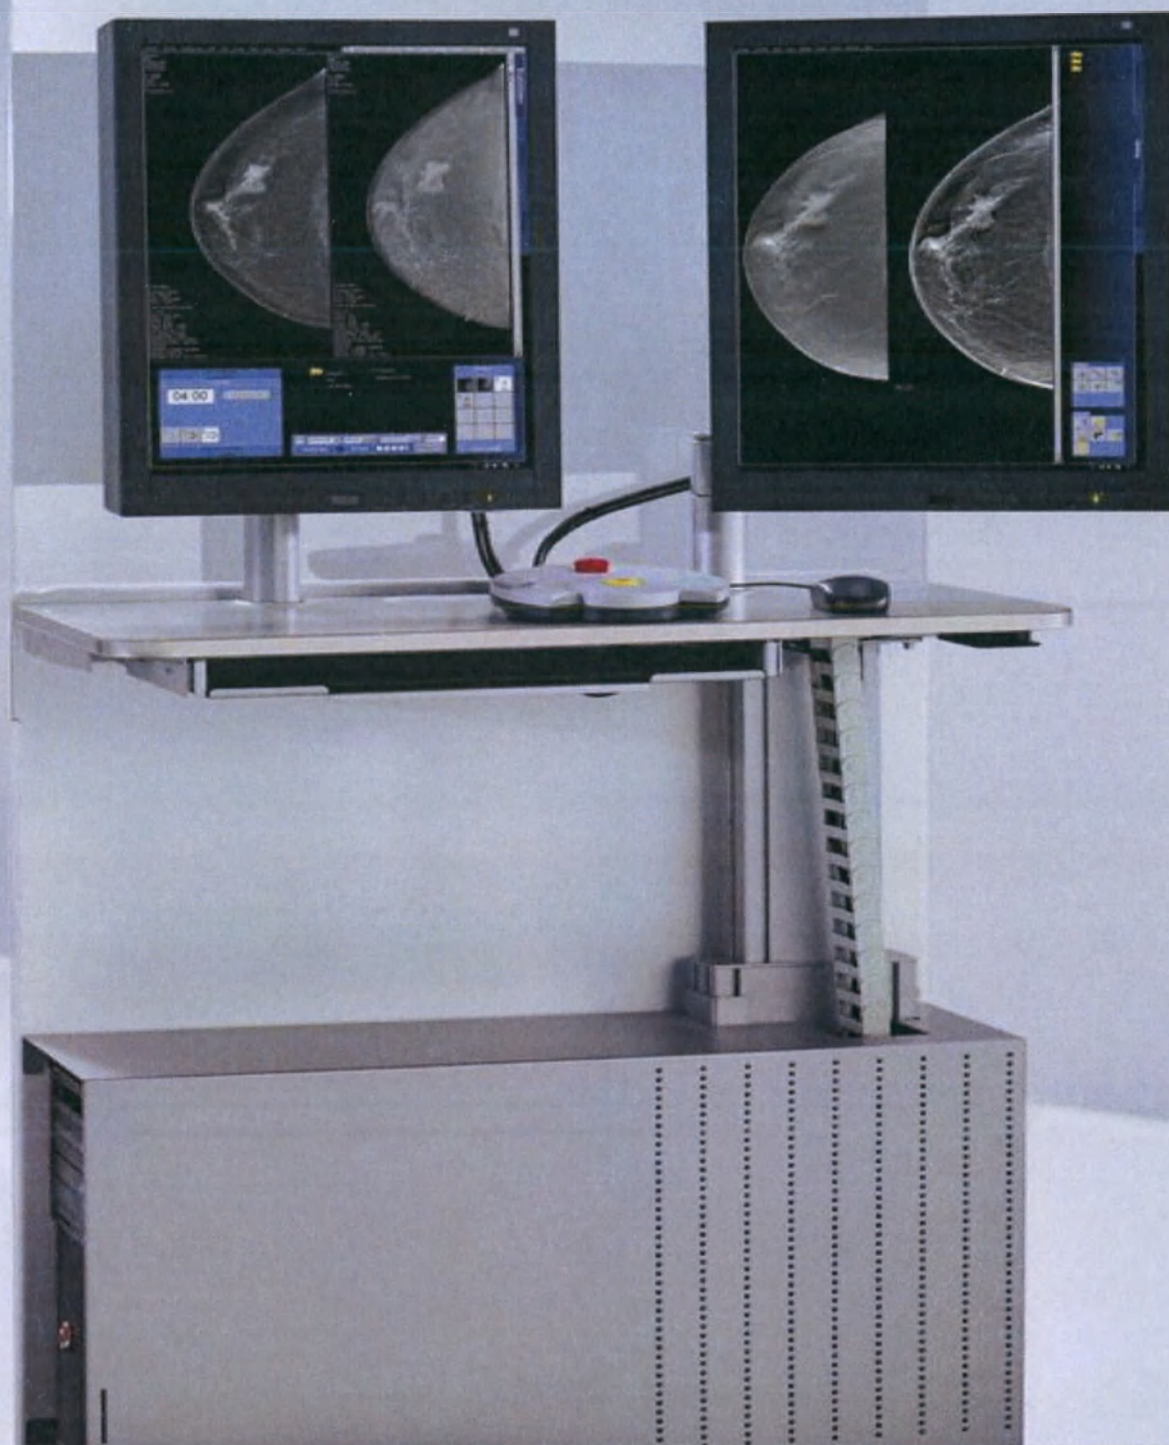

3. Рабочая станция рентгенолаборанта, вариант исполнения:

3.2. Рабочая станция рентгенолаборанта с возможностью работы в режиме томосинтеза в составе: блок системный, монитор специальный, клавиатура специальная, мышь специальная.



MAMMOMAT Revelation

Руководство пользователя
VC20

siemens-healthineers.com

SIEMENS
Healthineers

4. Документация пользователя на русском языке.

Material

11105038

SW Lic. High Def. Tomo 6 month (Key)



5. Программный режим возможности работы в режиме томосинтеза.

Material

11105341

SW Lizenz Dual Energy (key)



6. Программный режим контрастной маммографии (TICEM).


Material

11105341

SW Lizenz Dual Energy (key)



7. Программный режим контрастной маммографии (TICEM), лицензия на 6 месяцев.

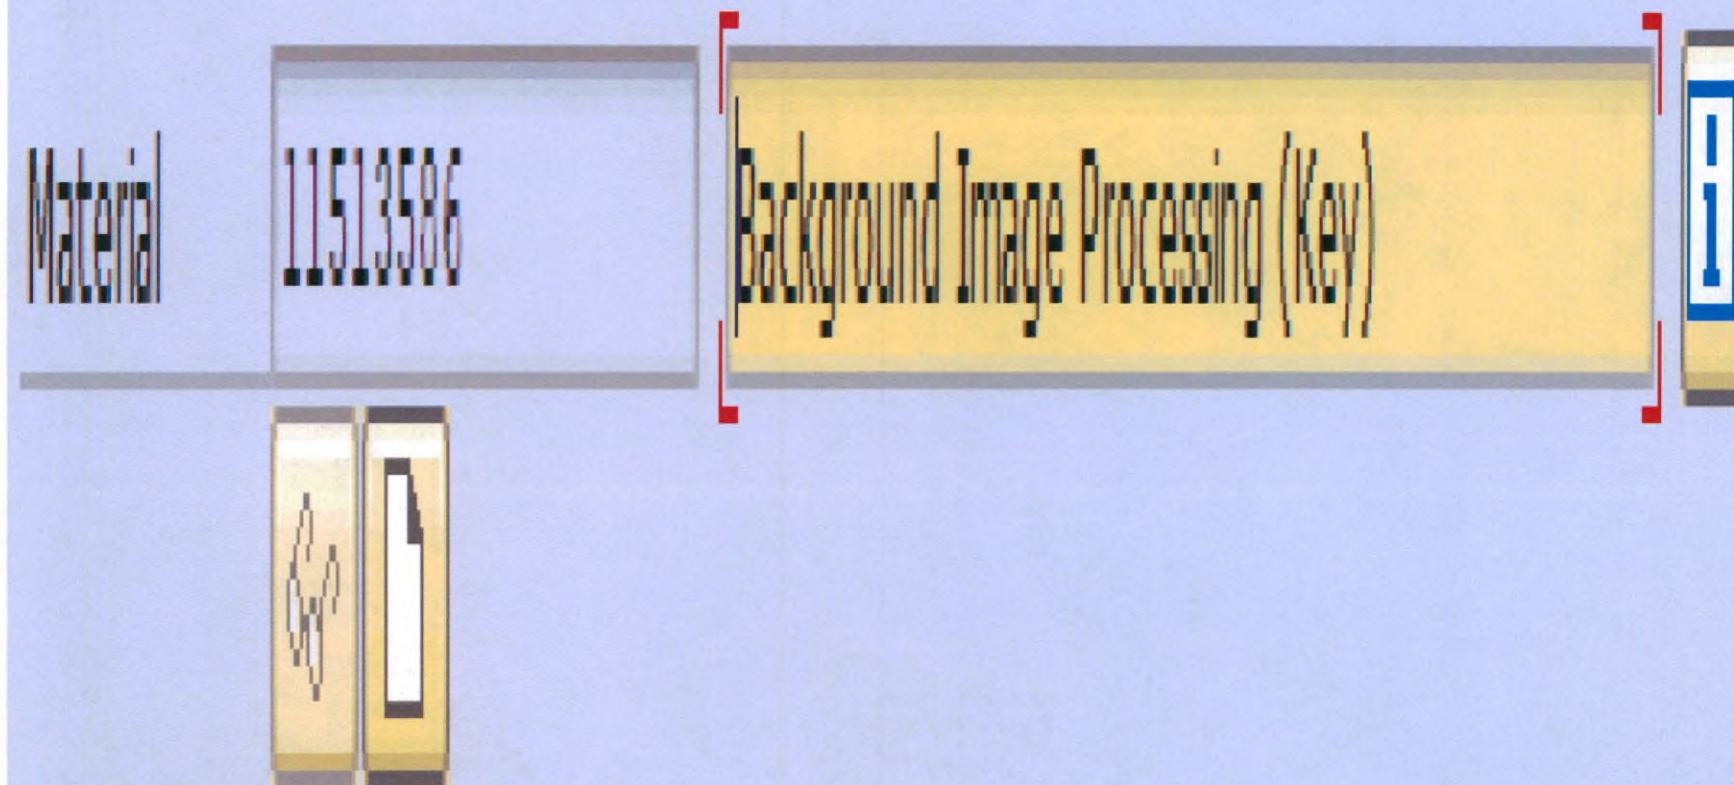

8. Программный режим повышения пропускной способности (повышения эффективности рабочего процесса)

Material

11105344

SW Lizenz Breast density (key)



9. Программный режим измерения плотности молочной железы (Insight BD).

Material

11105345

Liz. Breast density 6 Monate (key)



10. Программный режим измерения плотности молочной железы (Insight BD) (лицензия на 6 месяцев).

Material

11064776

SECURITY_PRIVACY_BASIC (key)




11. Программный режим безопасности.


Material

11343168


Virtual Client RIS

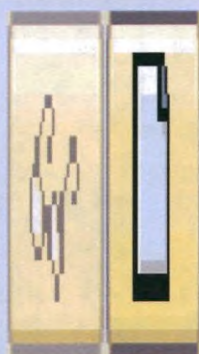


12. Программный режим возможности интеграции с другими программами.

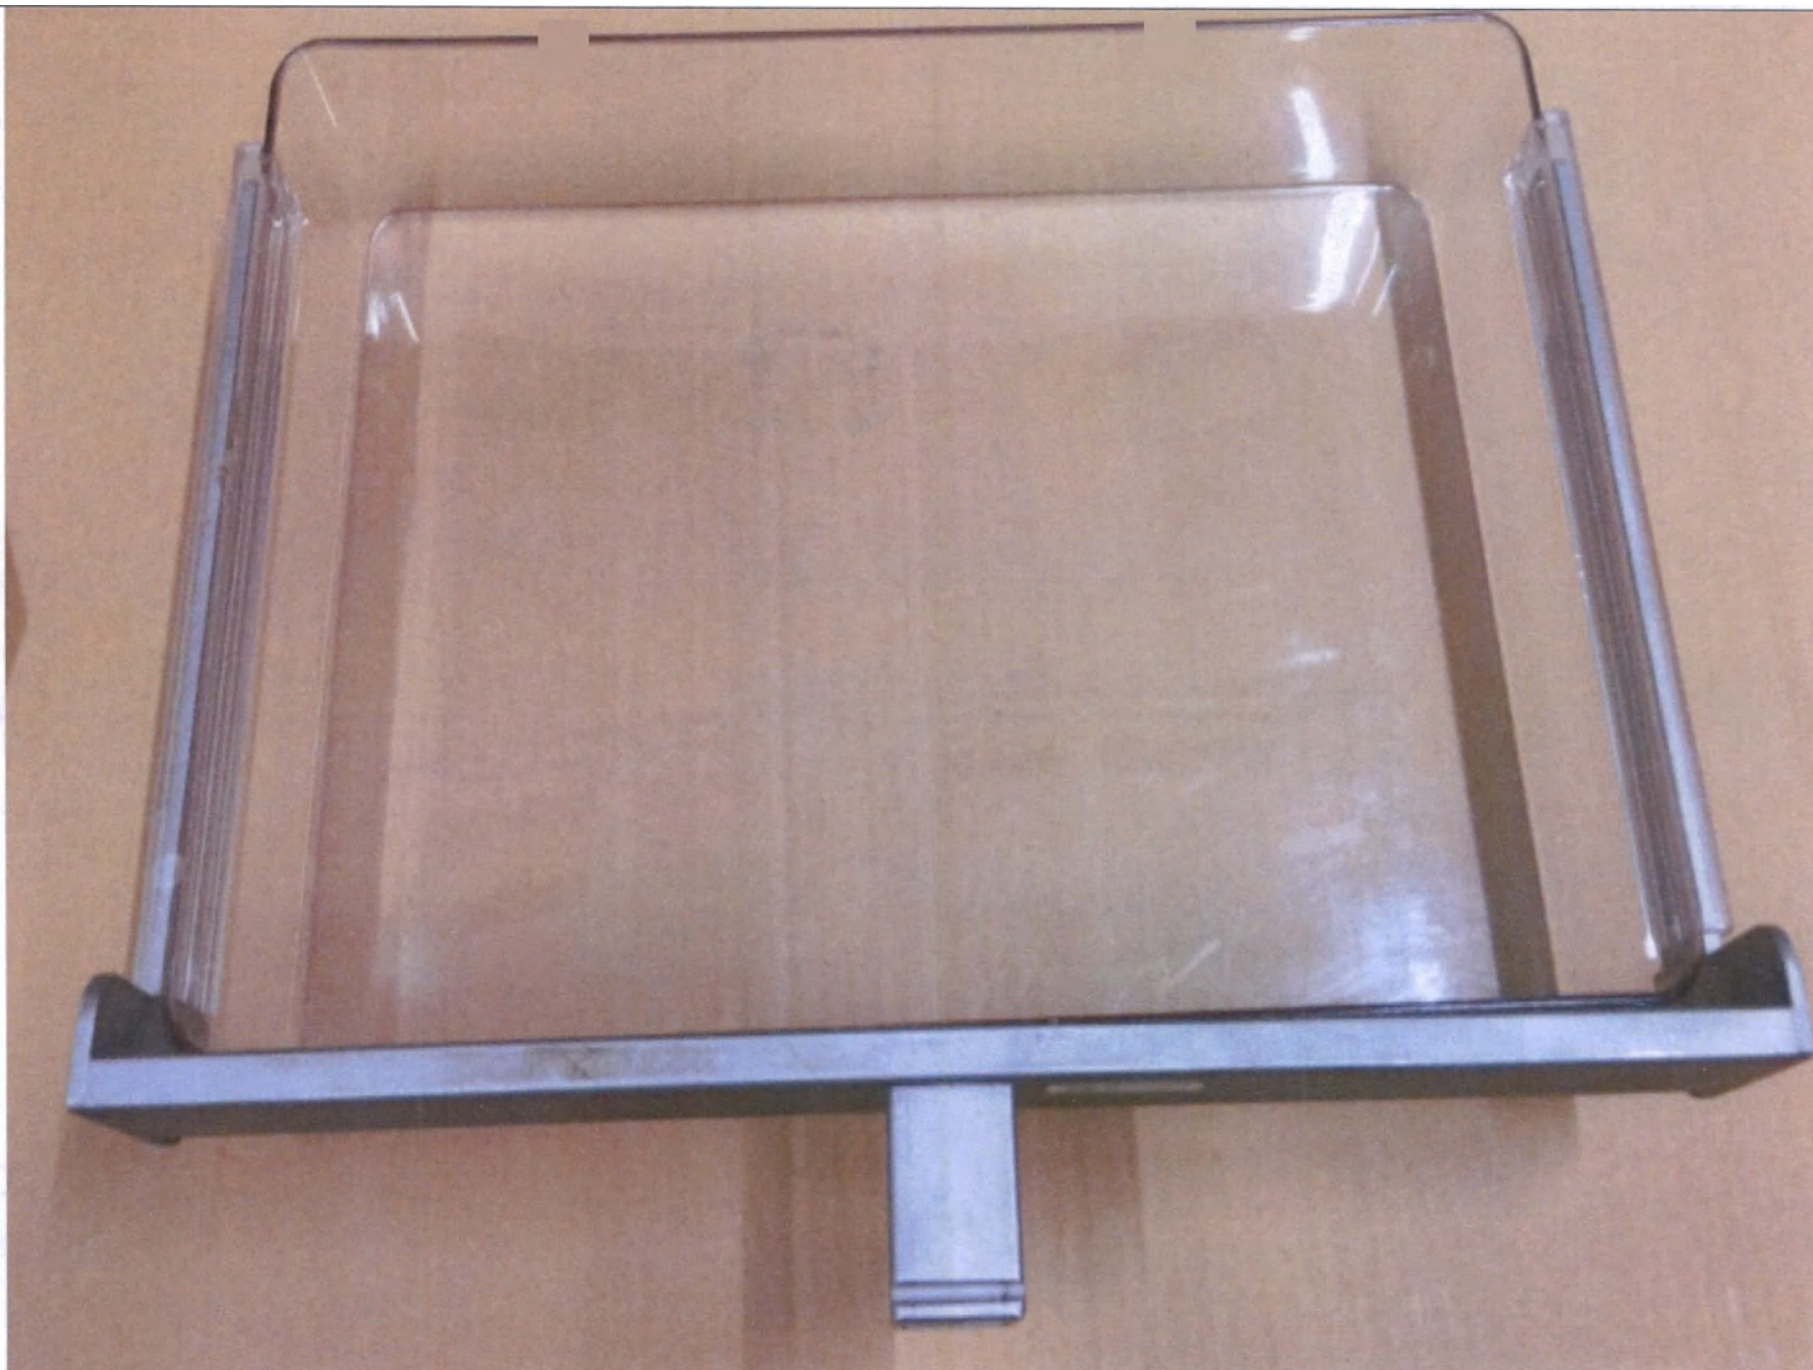


13. Пластина компрессионная для томосинтеза.

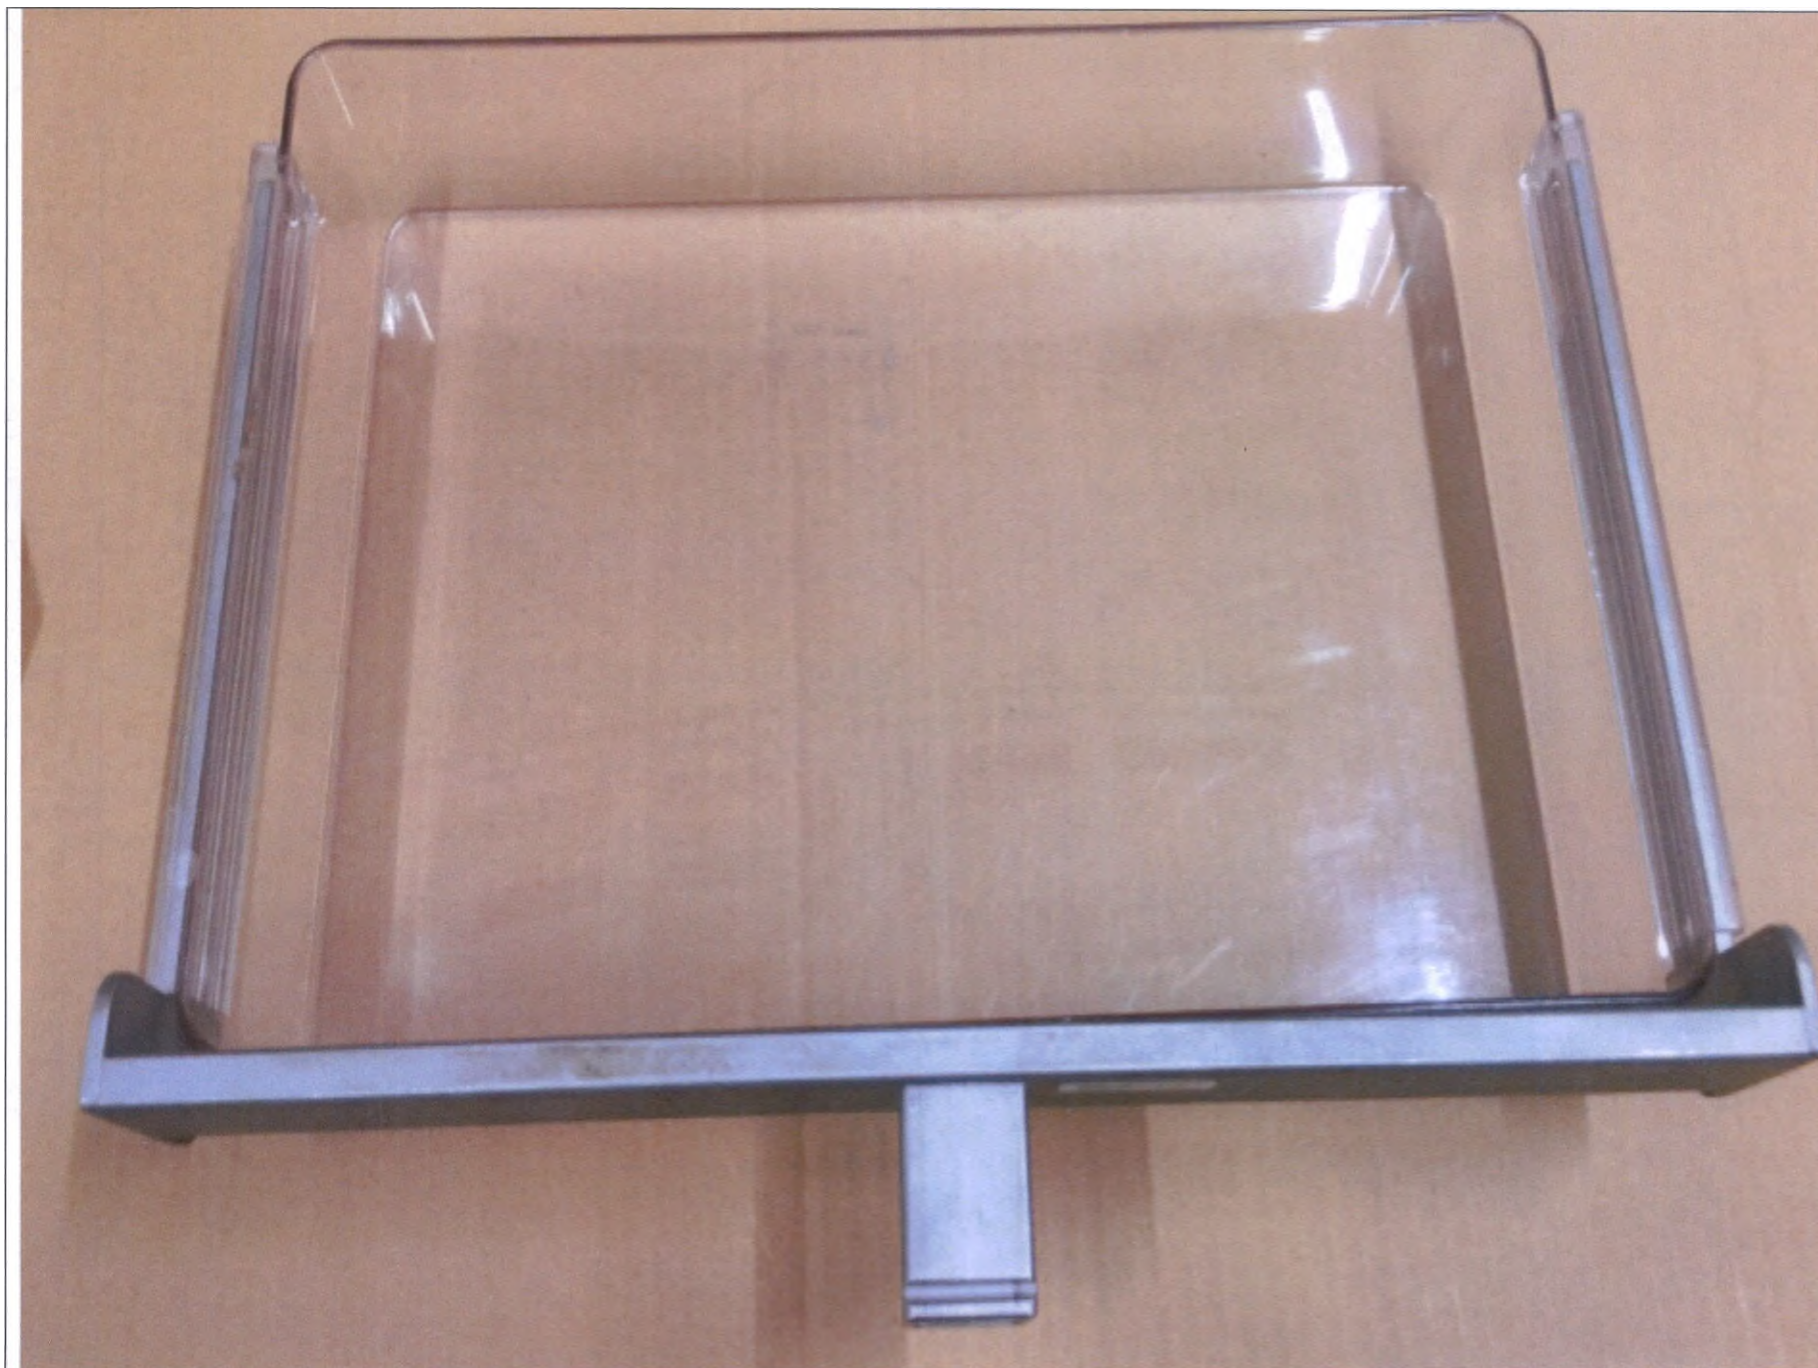


14. Вставка для компрессионной пластины для томосинтеза.

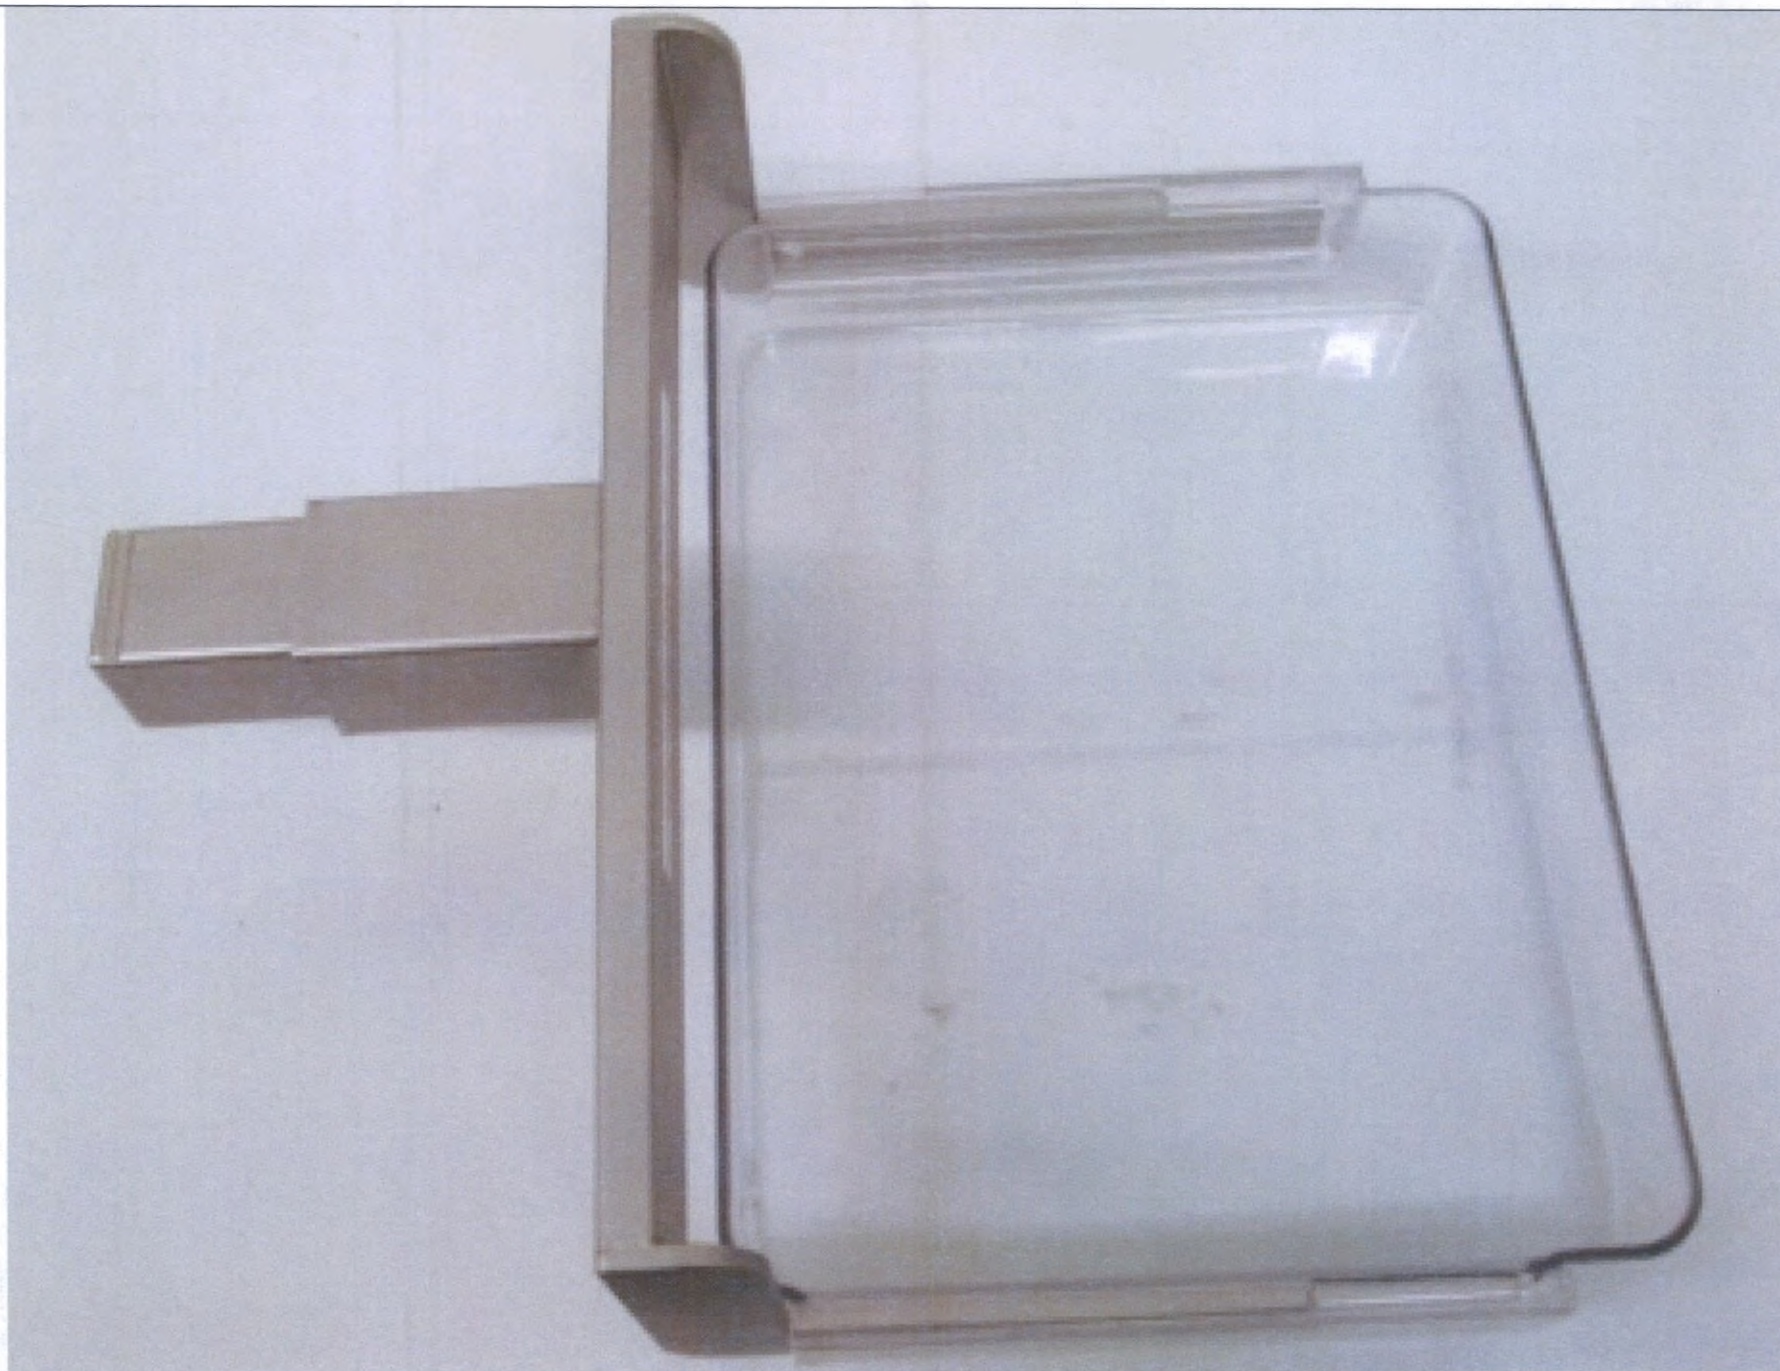


15. Пластина компрессионная стандартная 18х24, с высоким краем

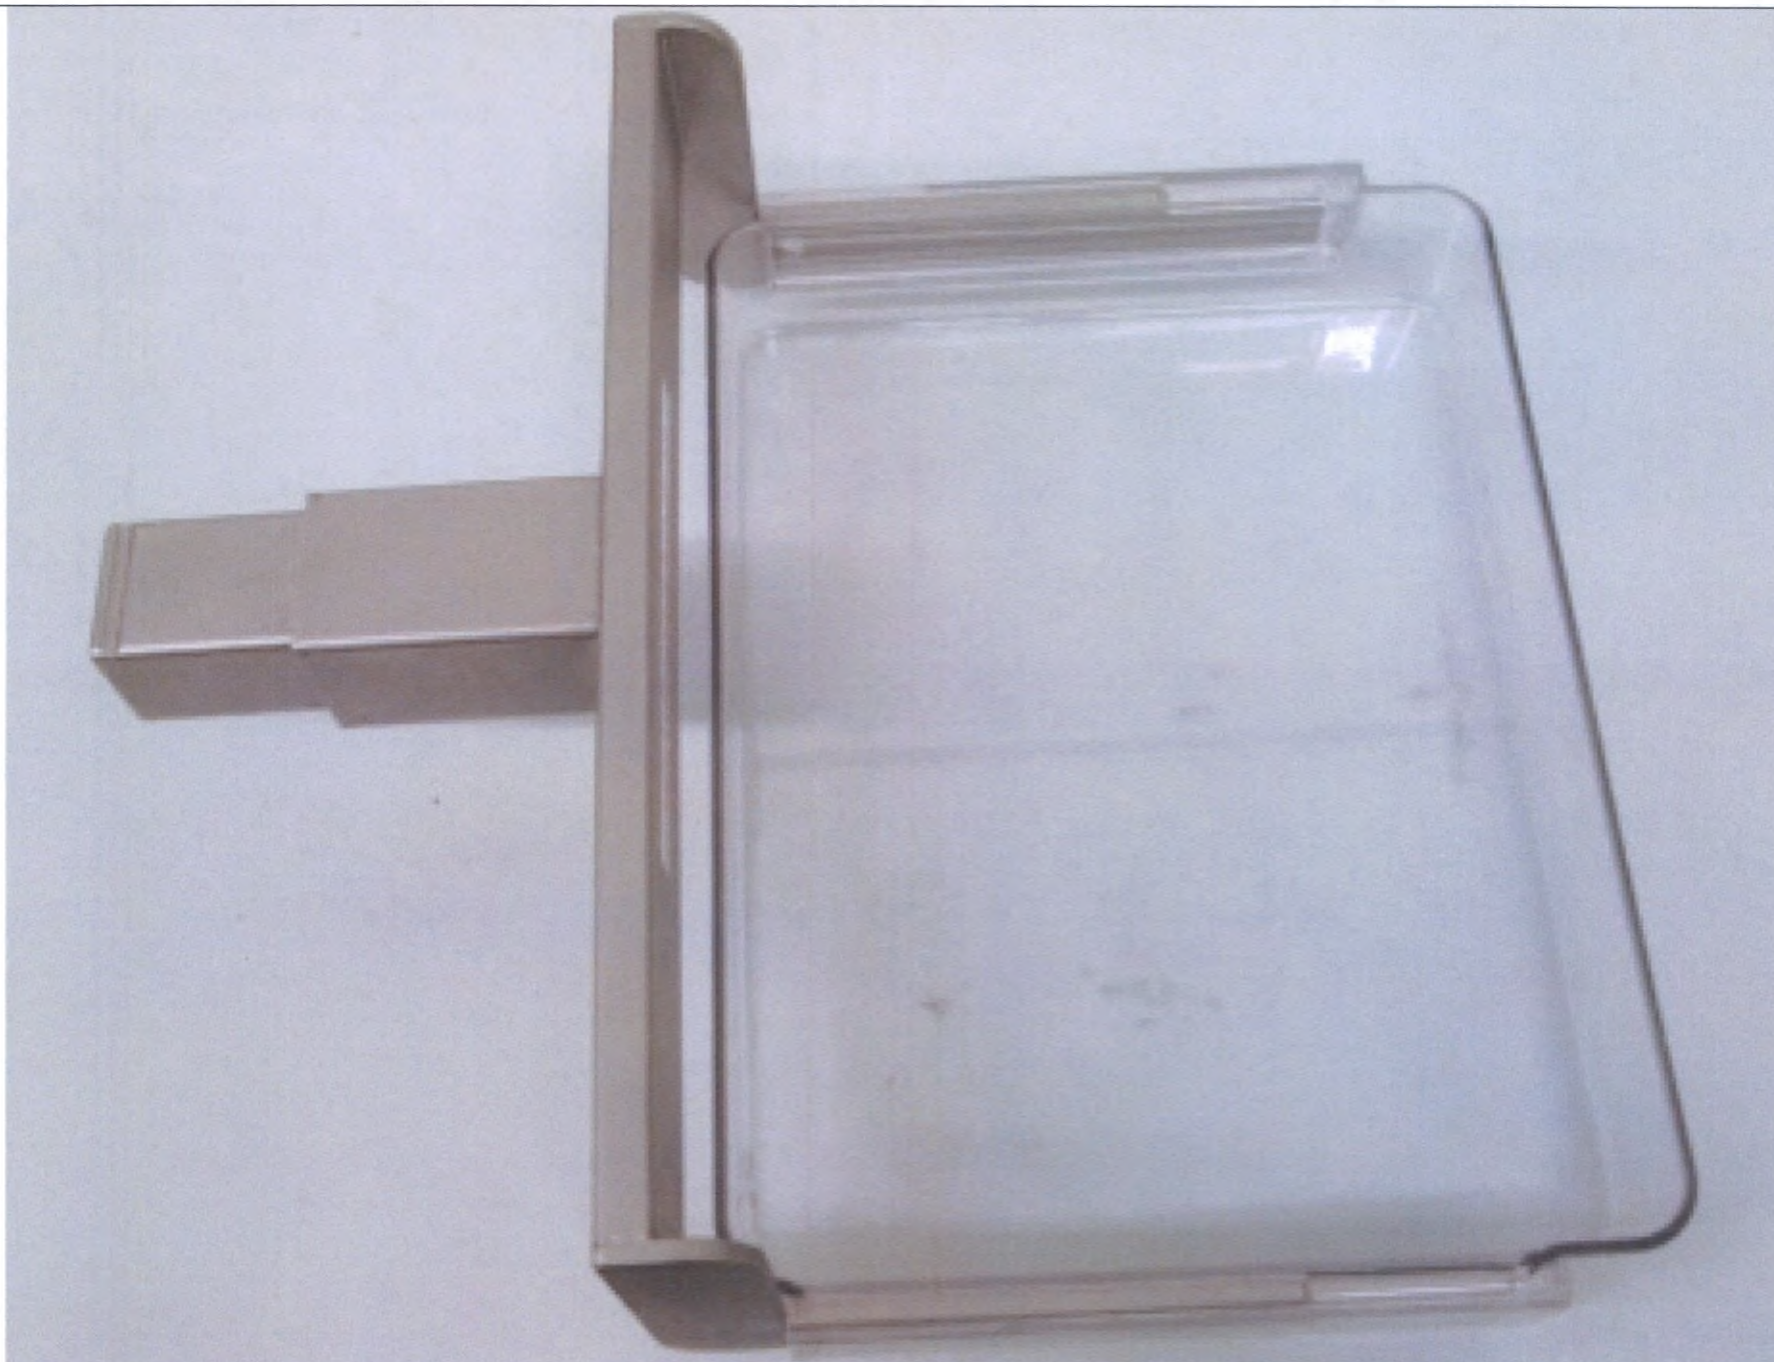


16. Вставка для пластины компрессионной стандартной 18х24 с высоким краем.

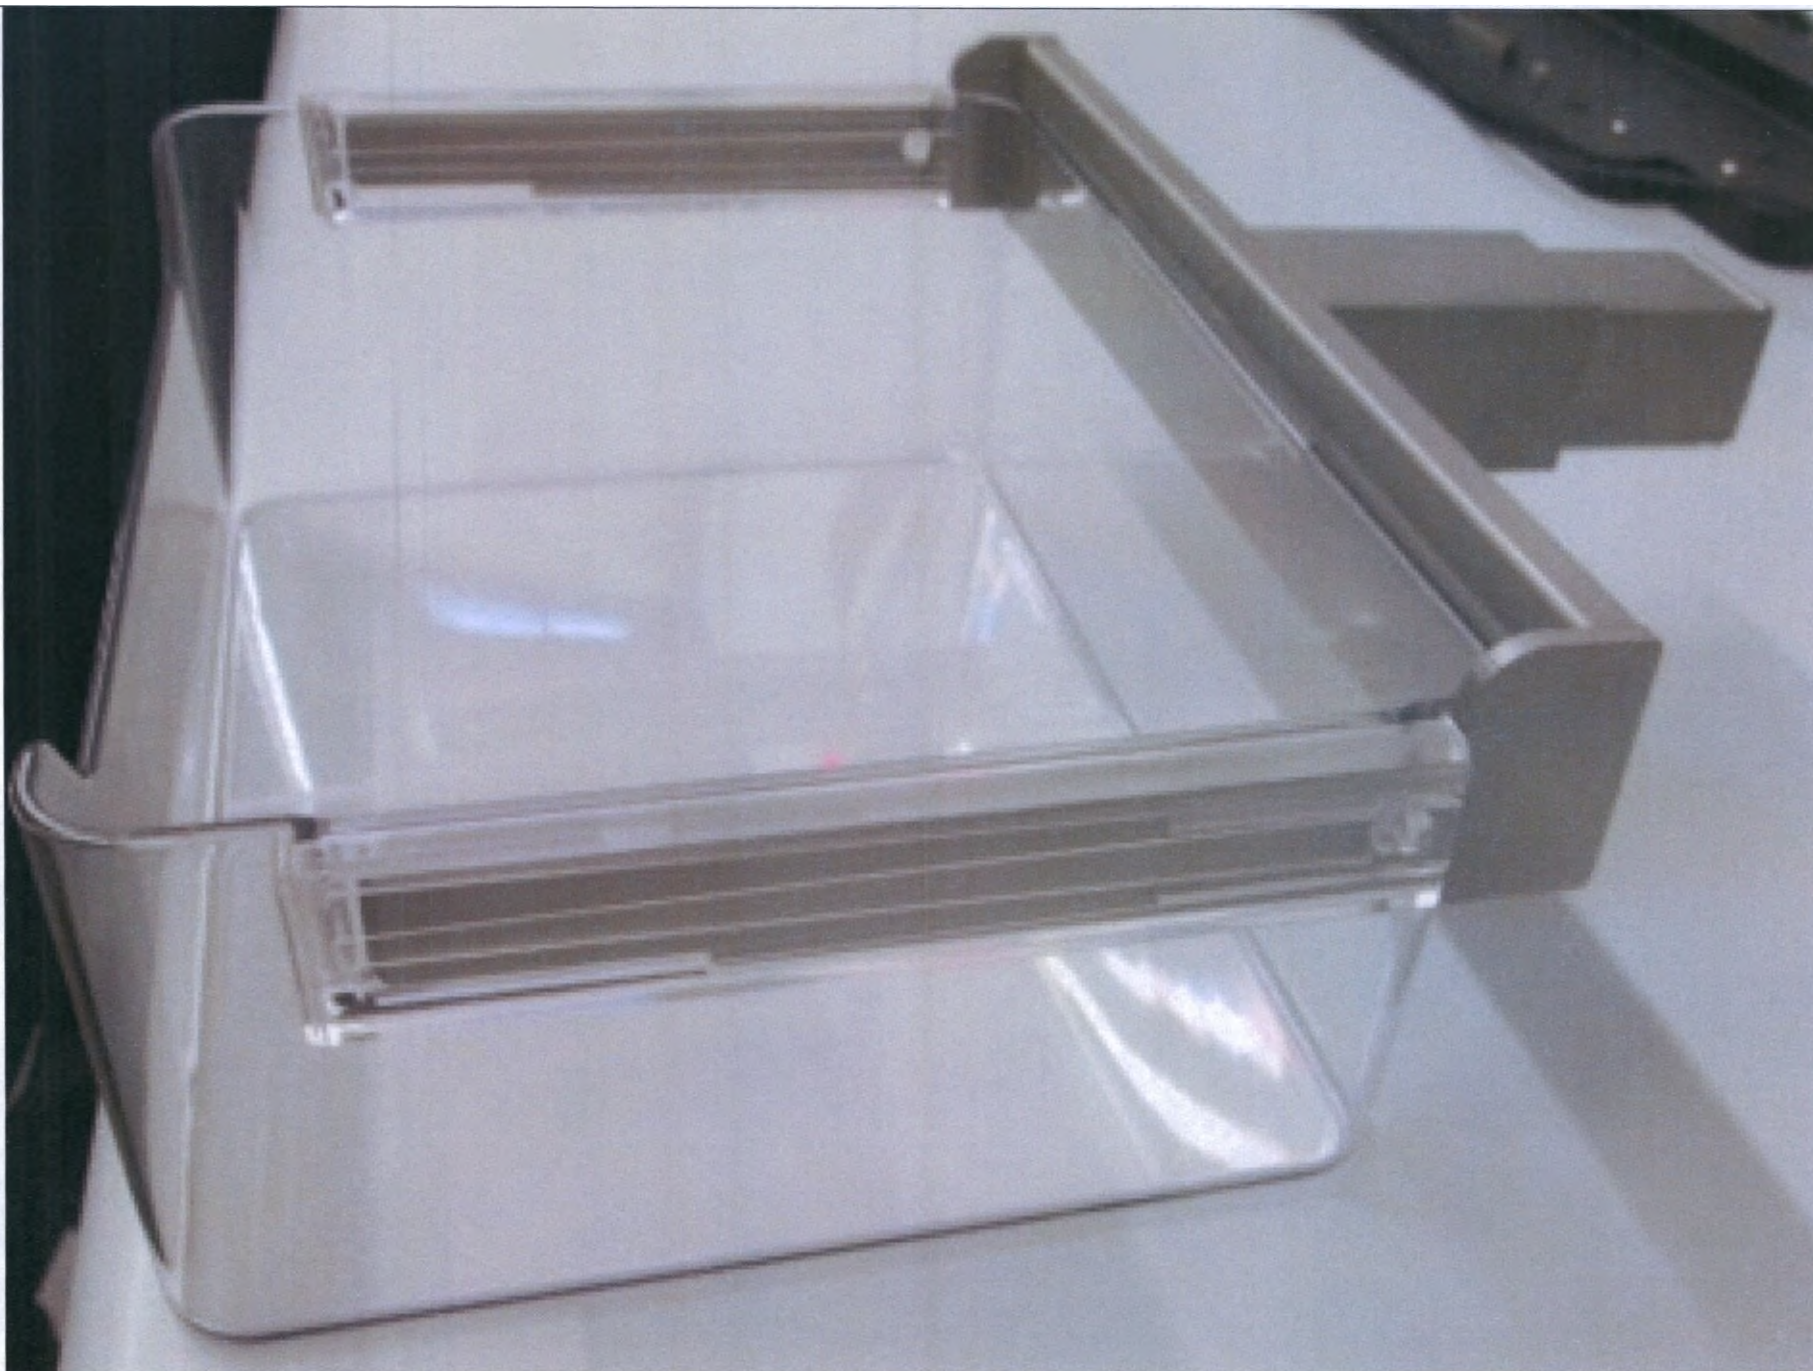


17. Пластина компрессионная стандартная 24x30, с высоким краем.

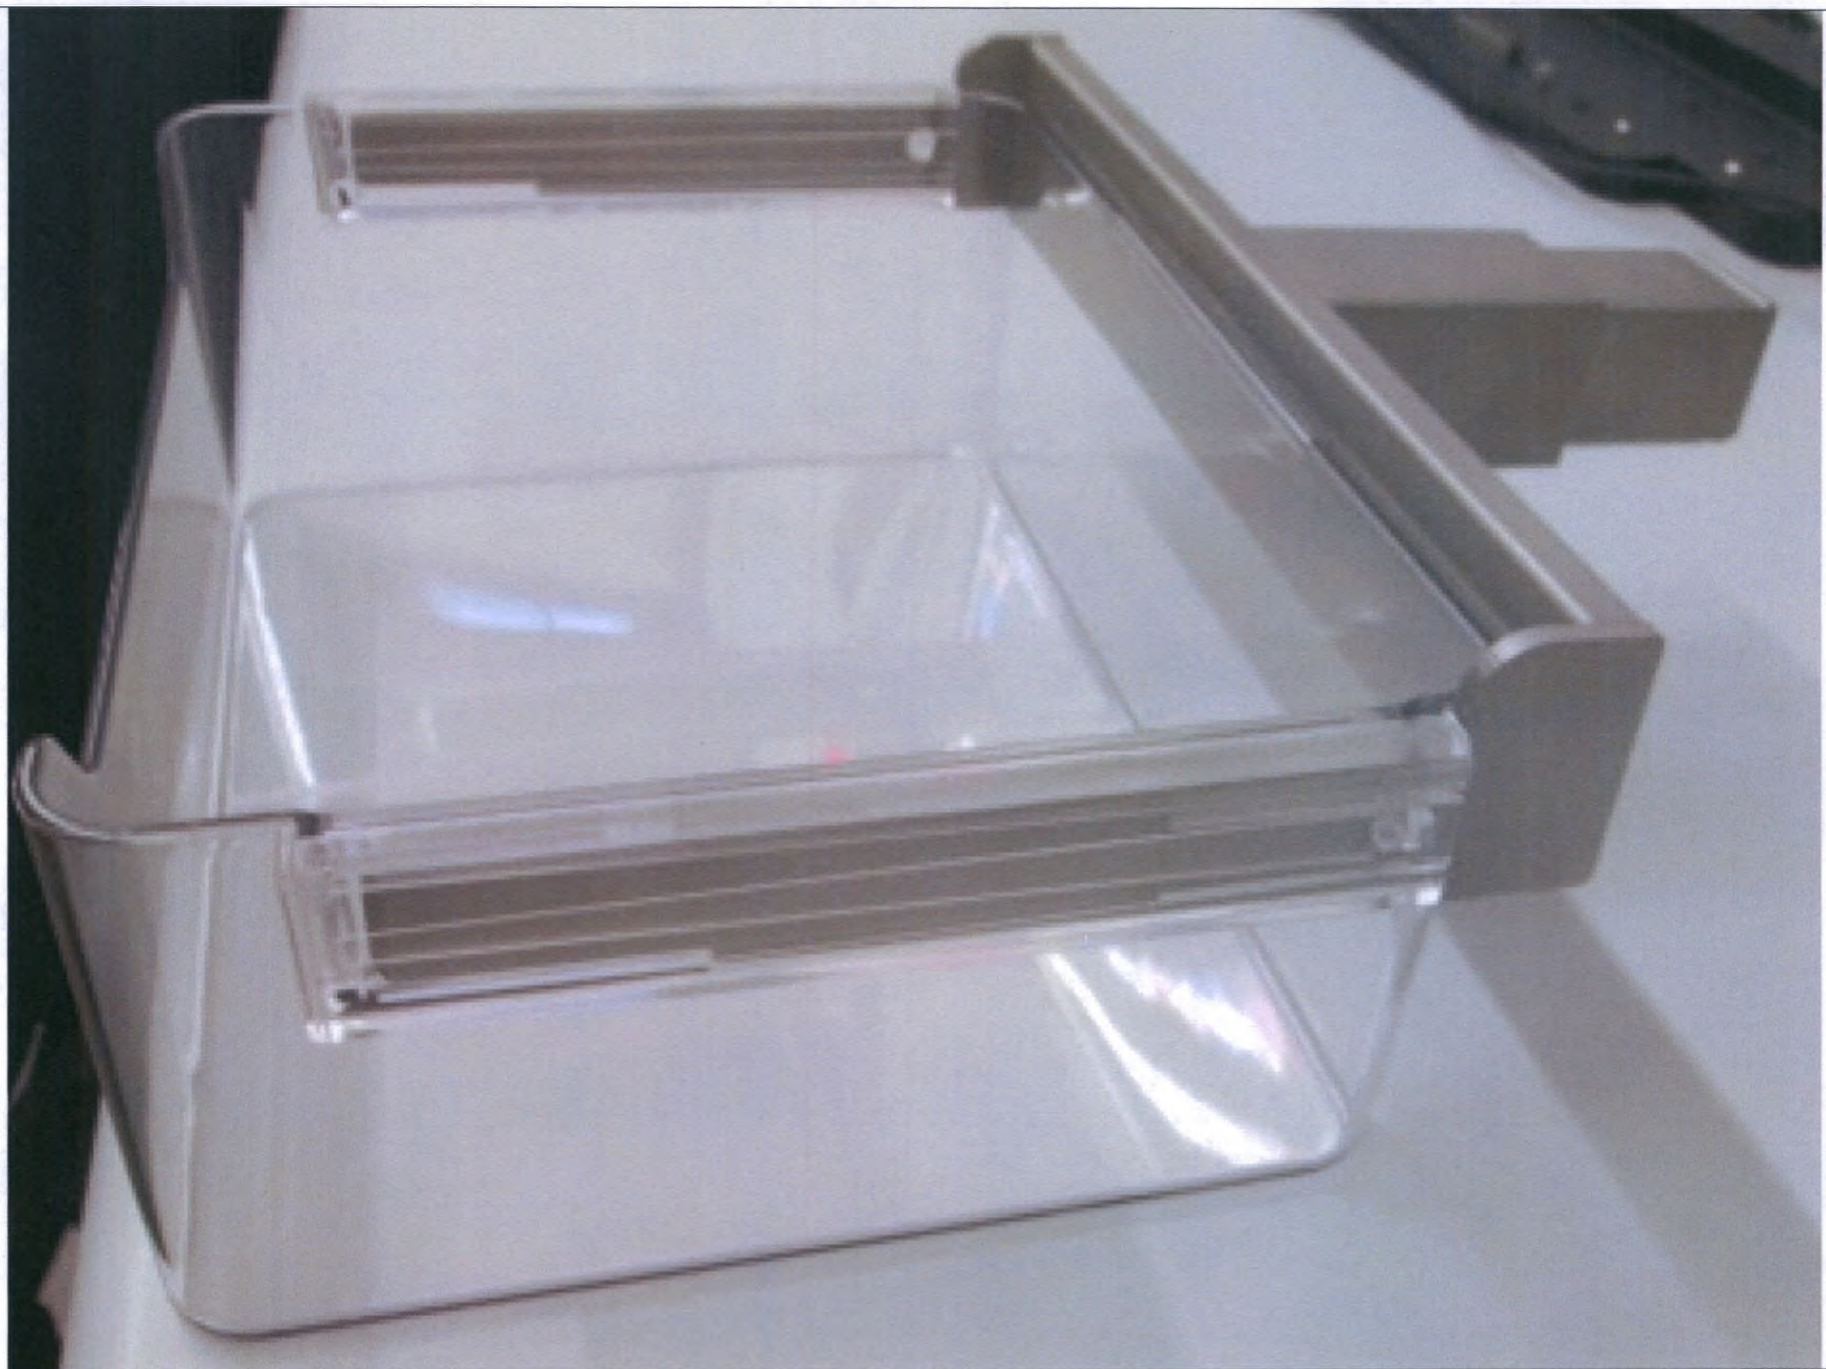

18. Вставка для пластины компрессионной стандартной 24х30 с высоким краем.

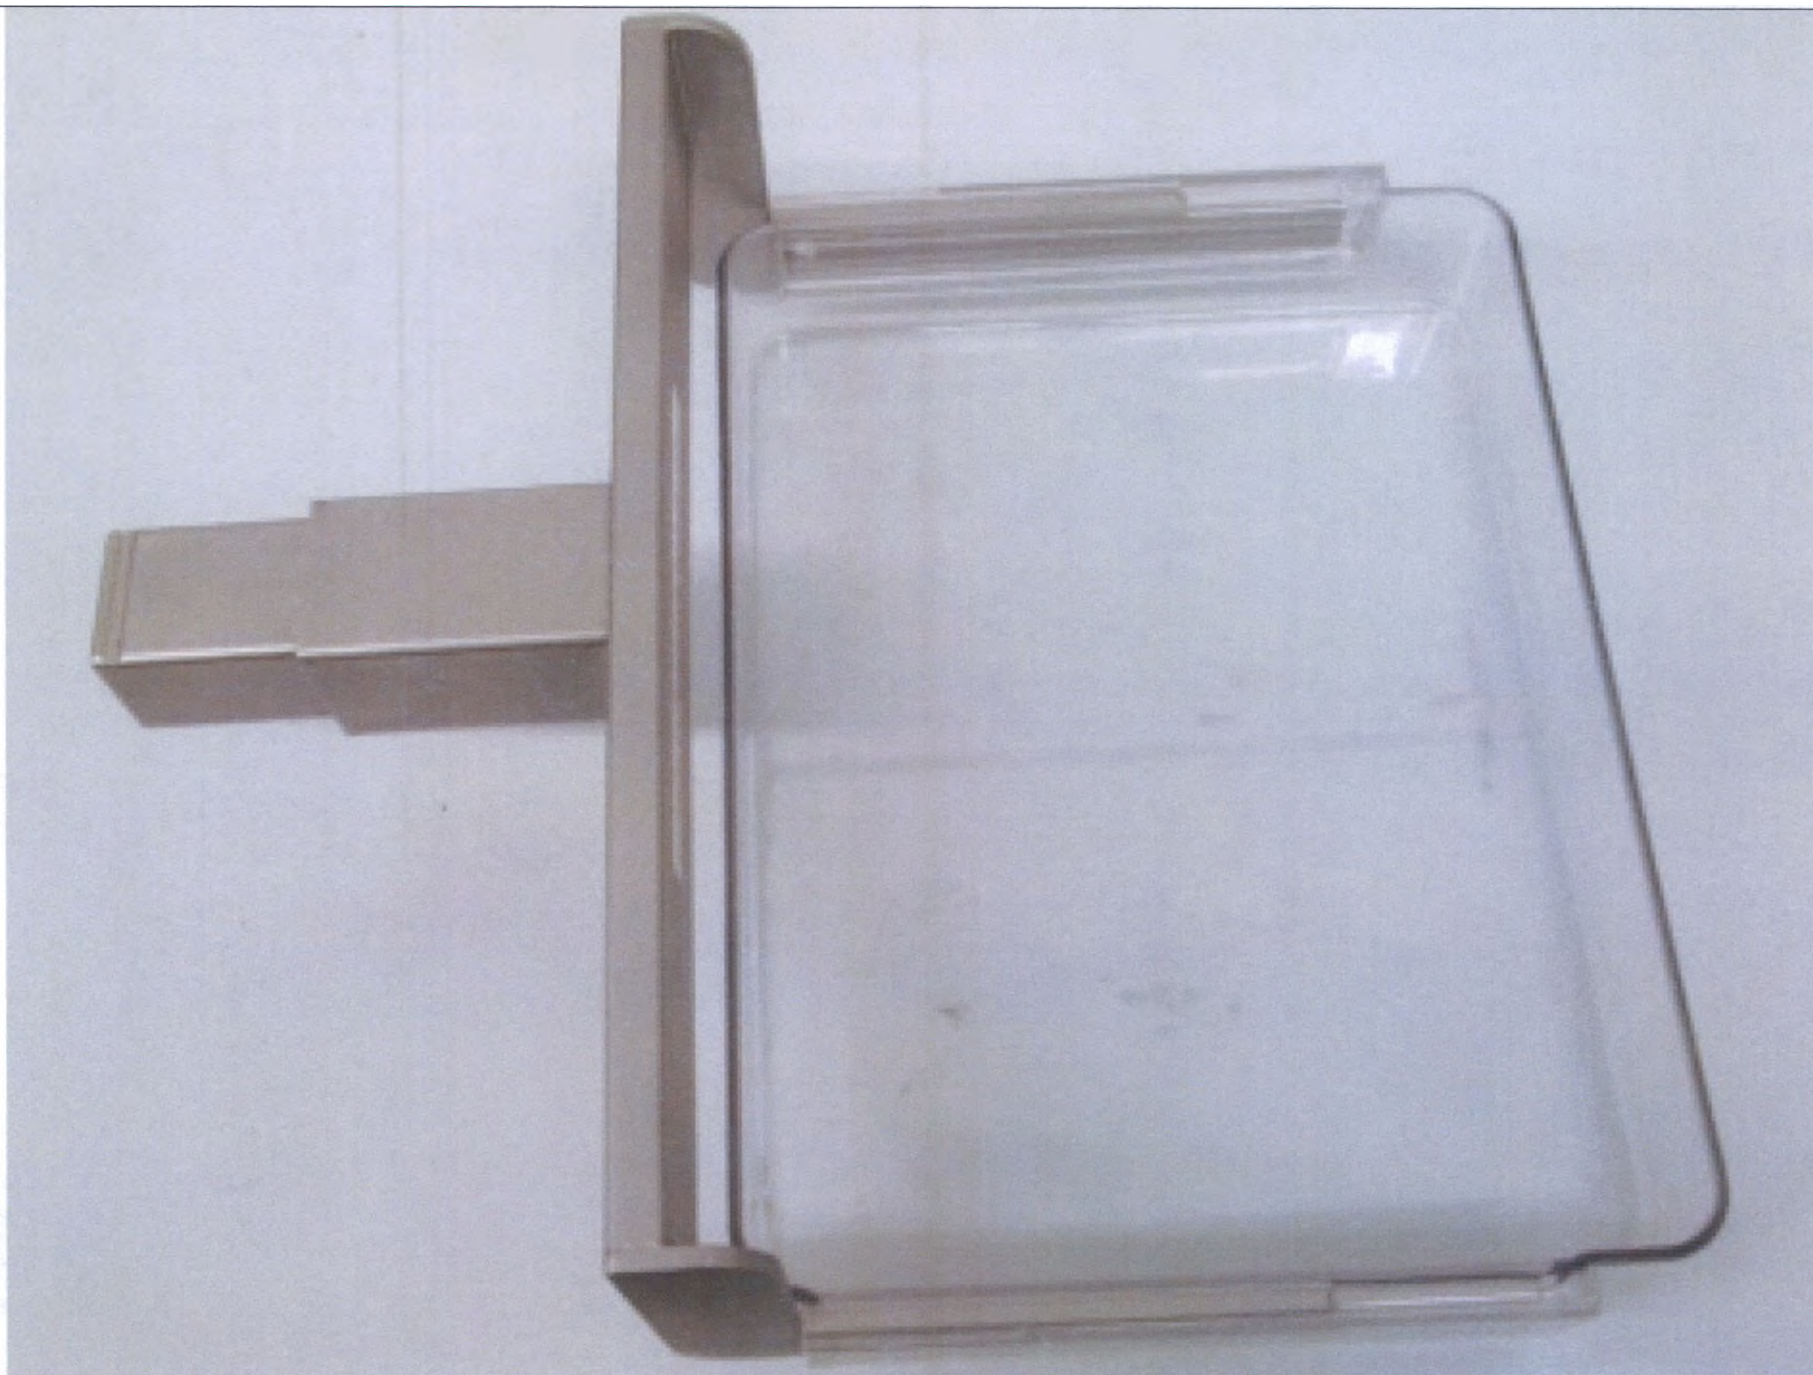

19. Пластина компрессионная стандартная 18x24, с низким краем.

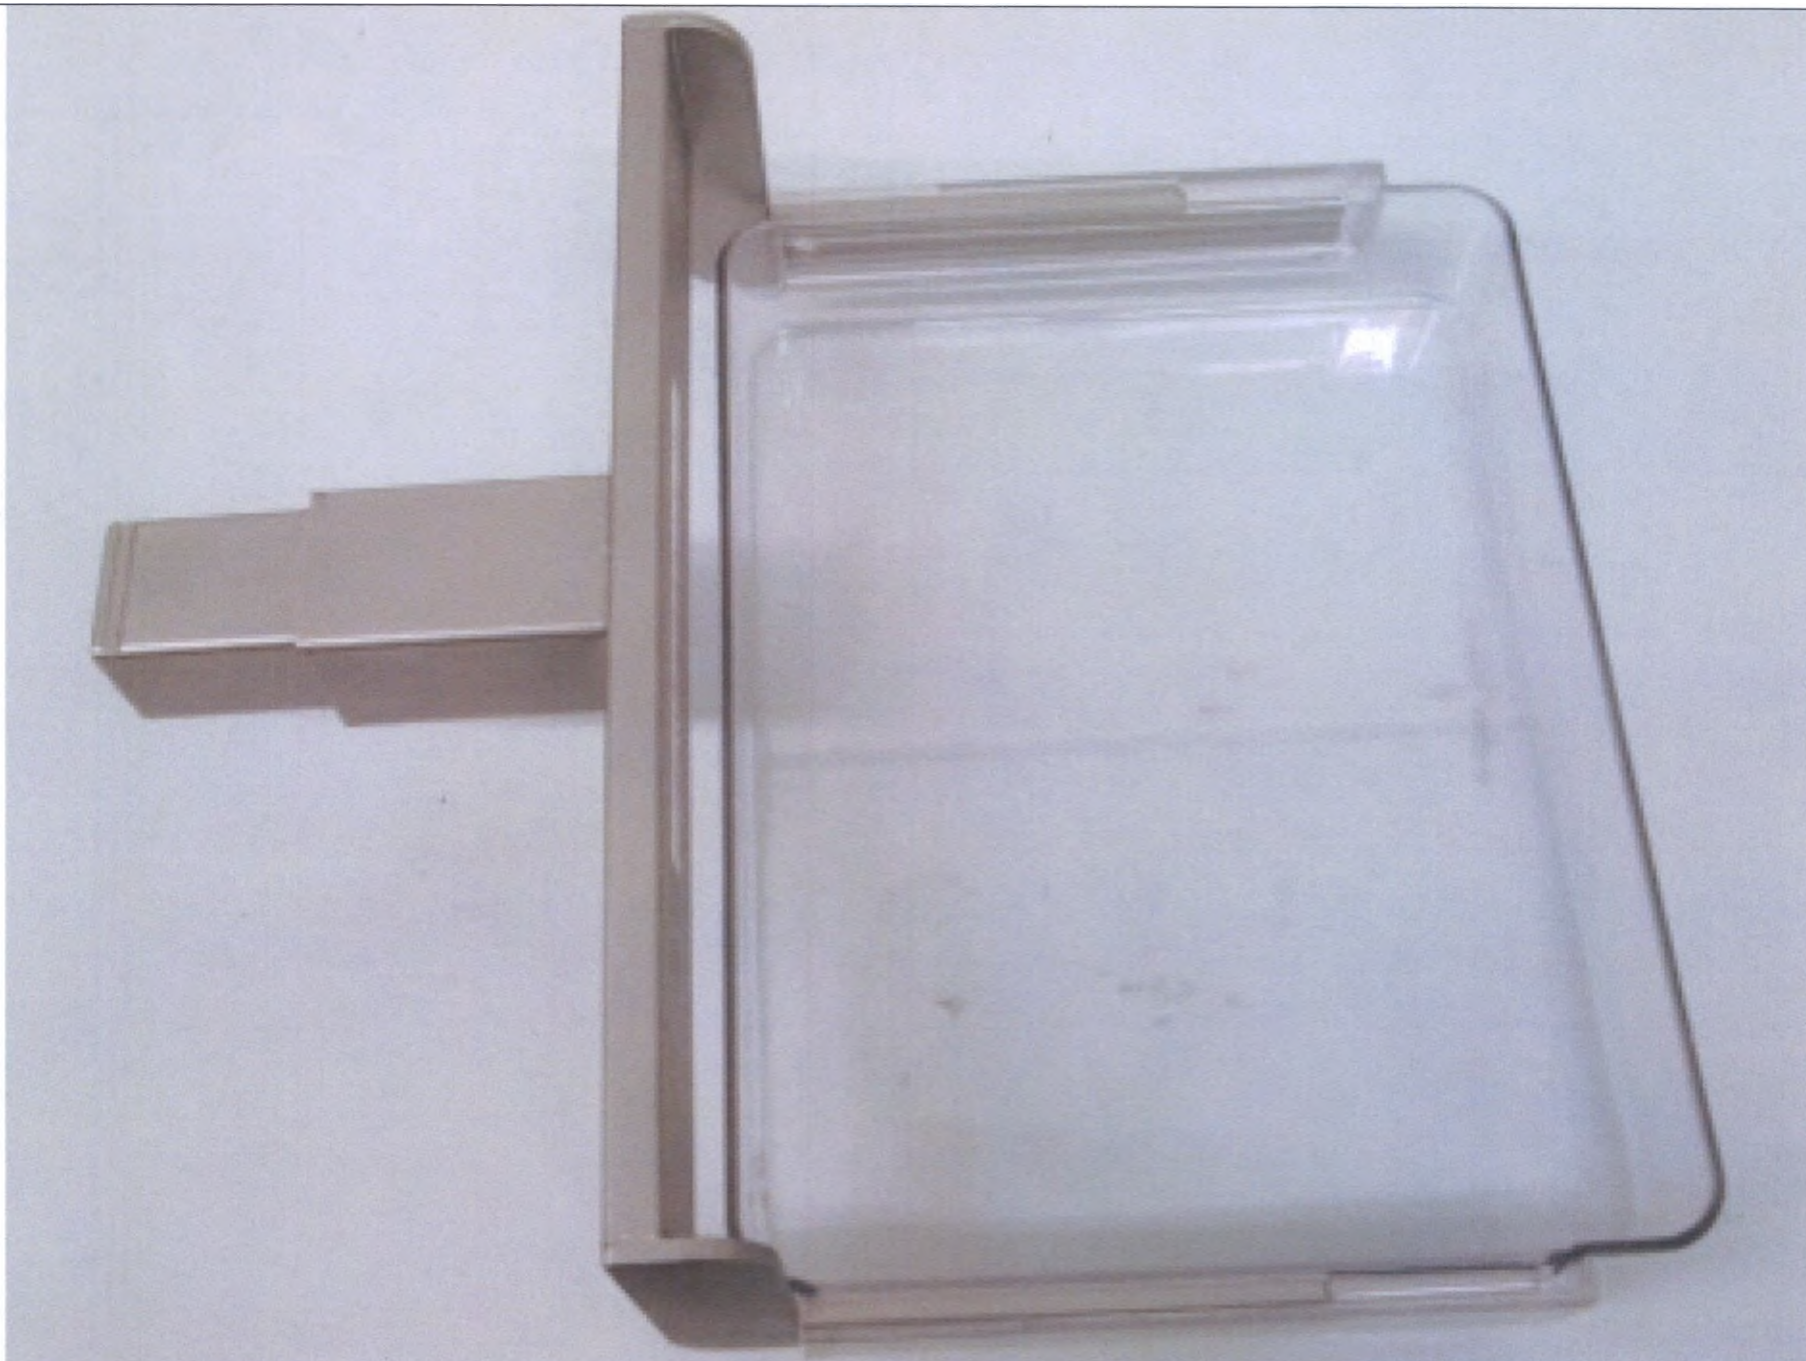


20. Вставка для пластины компрессионной стандартной 18х24 с низким краем.




21. Пластина компрессионная стандартная 24x30, с низким краем.



22. Вставка для пластины компрессионной стандартной 24х30 с низким краем.

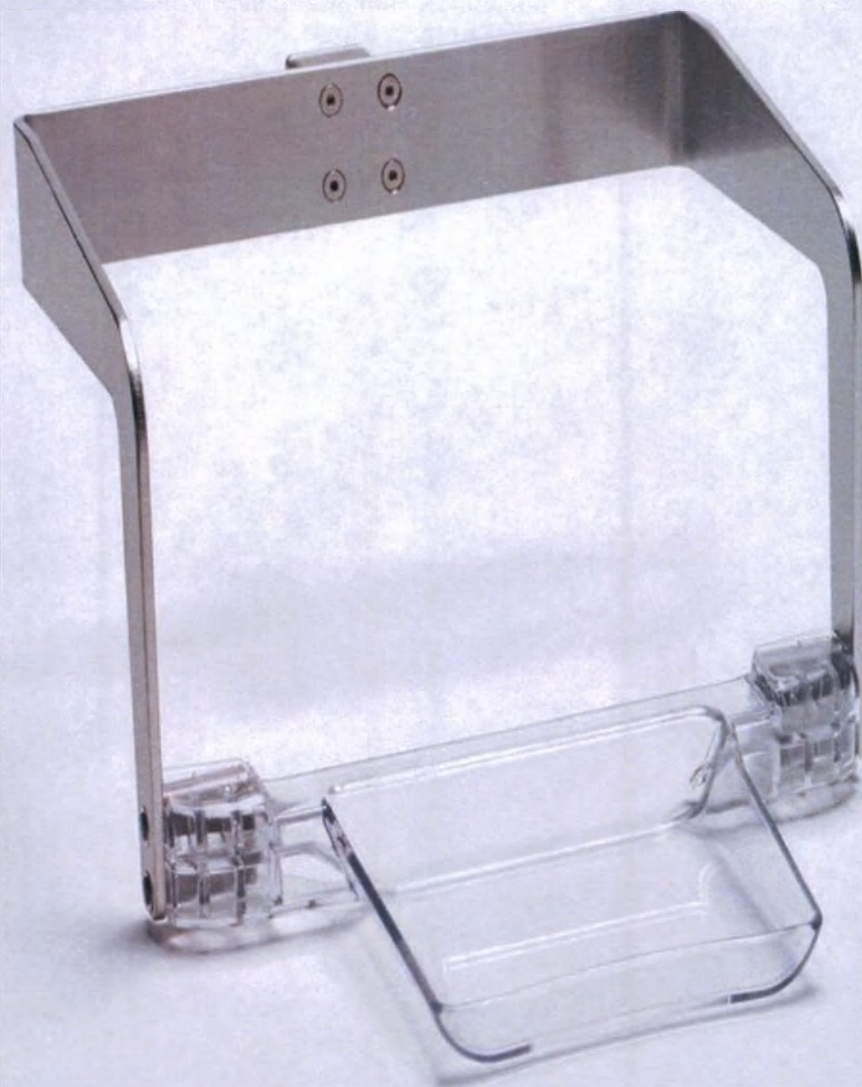


23. Пластина компрессионная для прицельных снимков, 9х9.

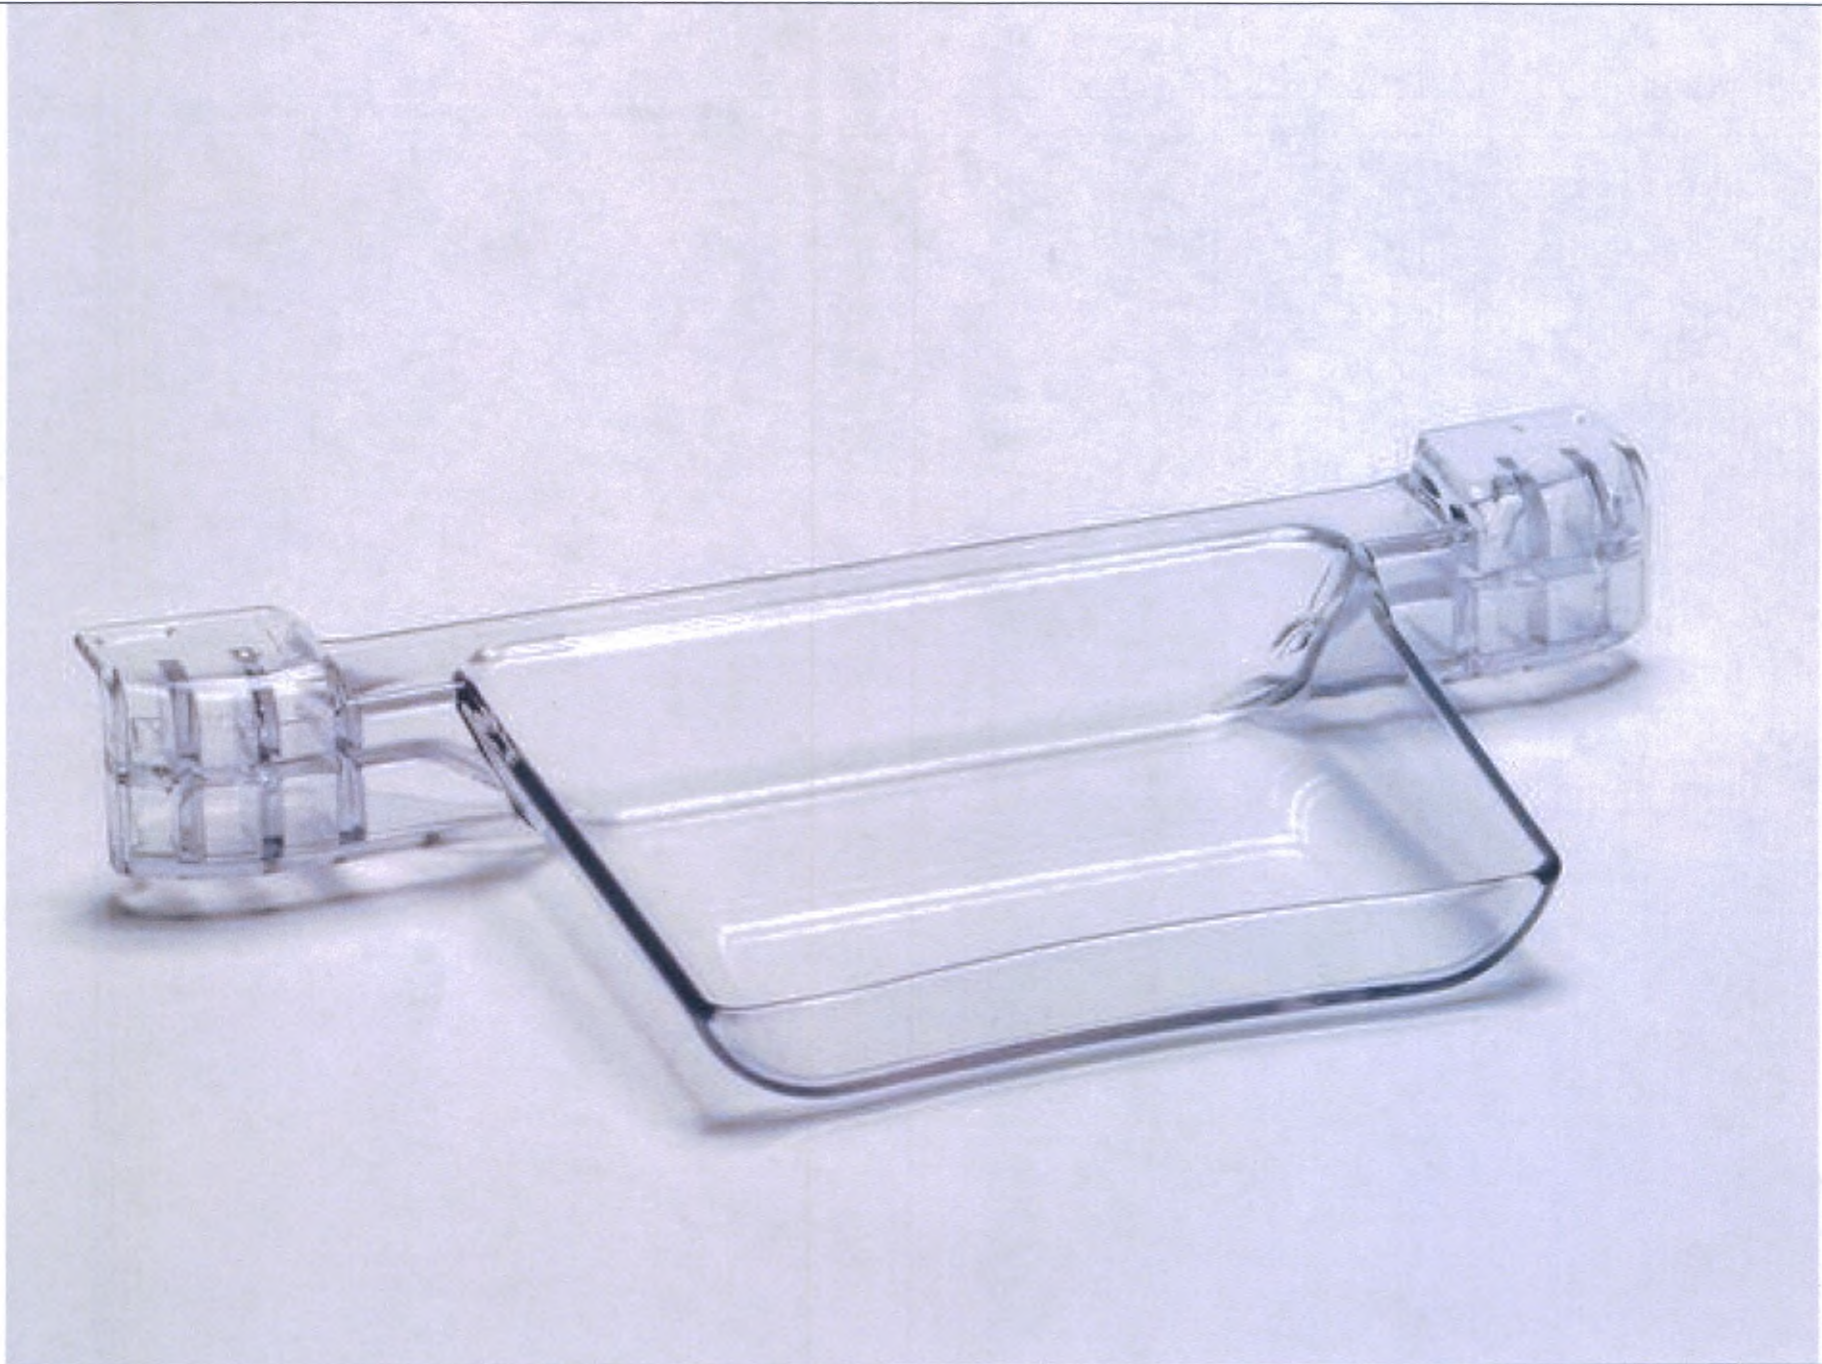


24. Вставка для пластины компрессионной для прицельных снимков, 9x9.



25. Пластина компрессионная для аксиллярных проекций, 8x20.

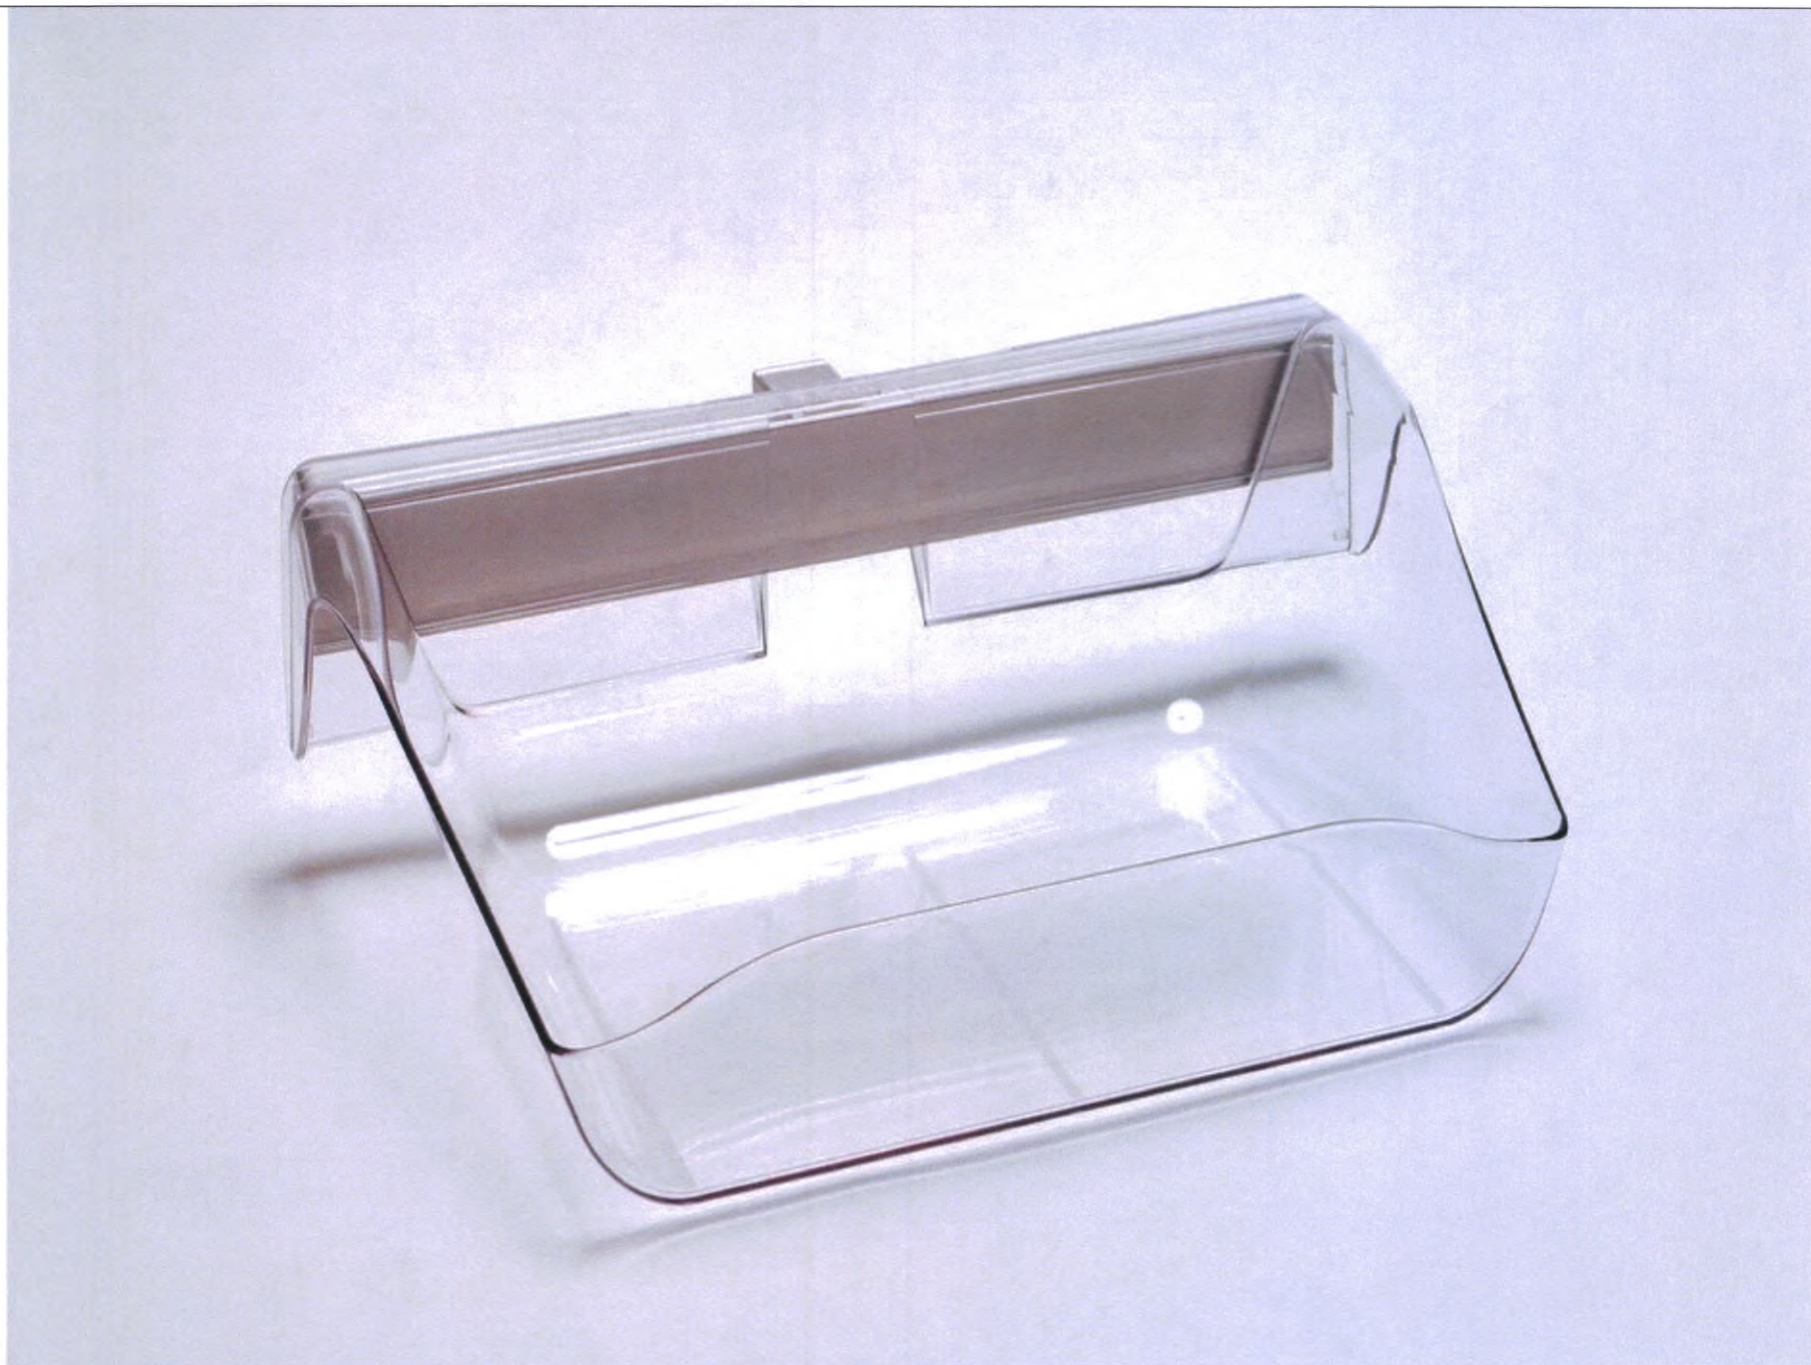

26. Вставка для пластины компрессионной для аксиллярных проекций, 8x20.

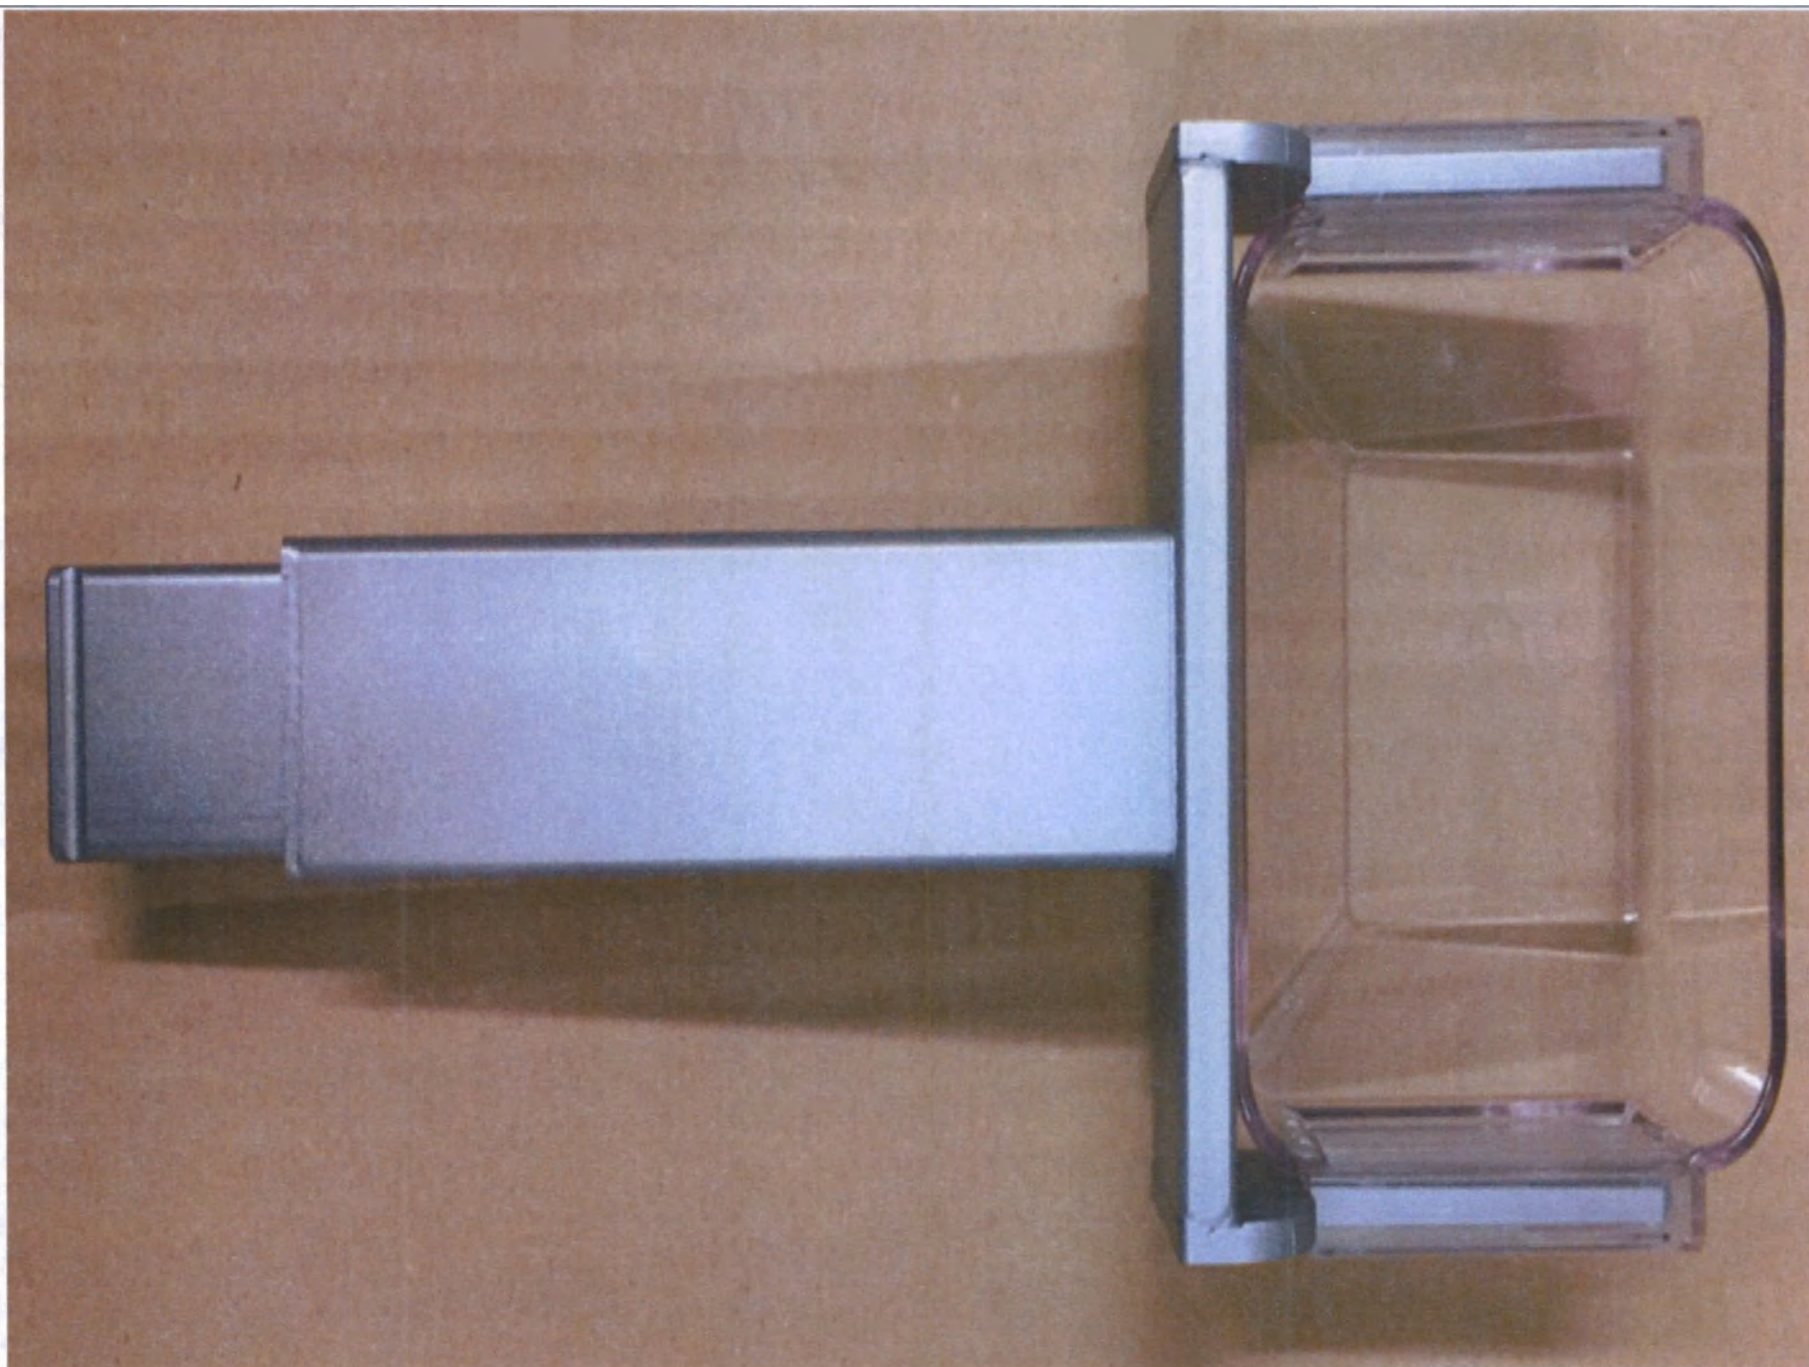

27. Пластина компрессионная для специальных снимков.



28. Вставка для пластины компрессионной для специальных снимков.



29. Пластина компрессионная для прицельных снимков, 18x24.



30. Вставка для пластины компрессионной для прицельных снимков, 18x24.



31. Выключатель экспозиции ножной.



32. Выключатель экспозиции ручной.



33. Монитор для консоли оператора.




34. Экран защитный для консоли оператора



35. Устройство бесперебойного питания.




36. Ножной переключатель с четырьмя педалями

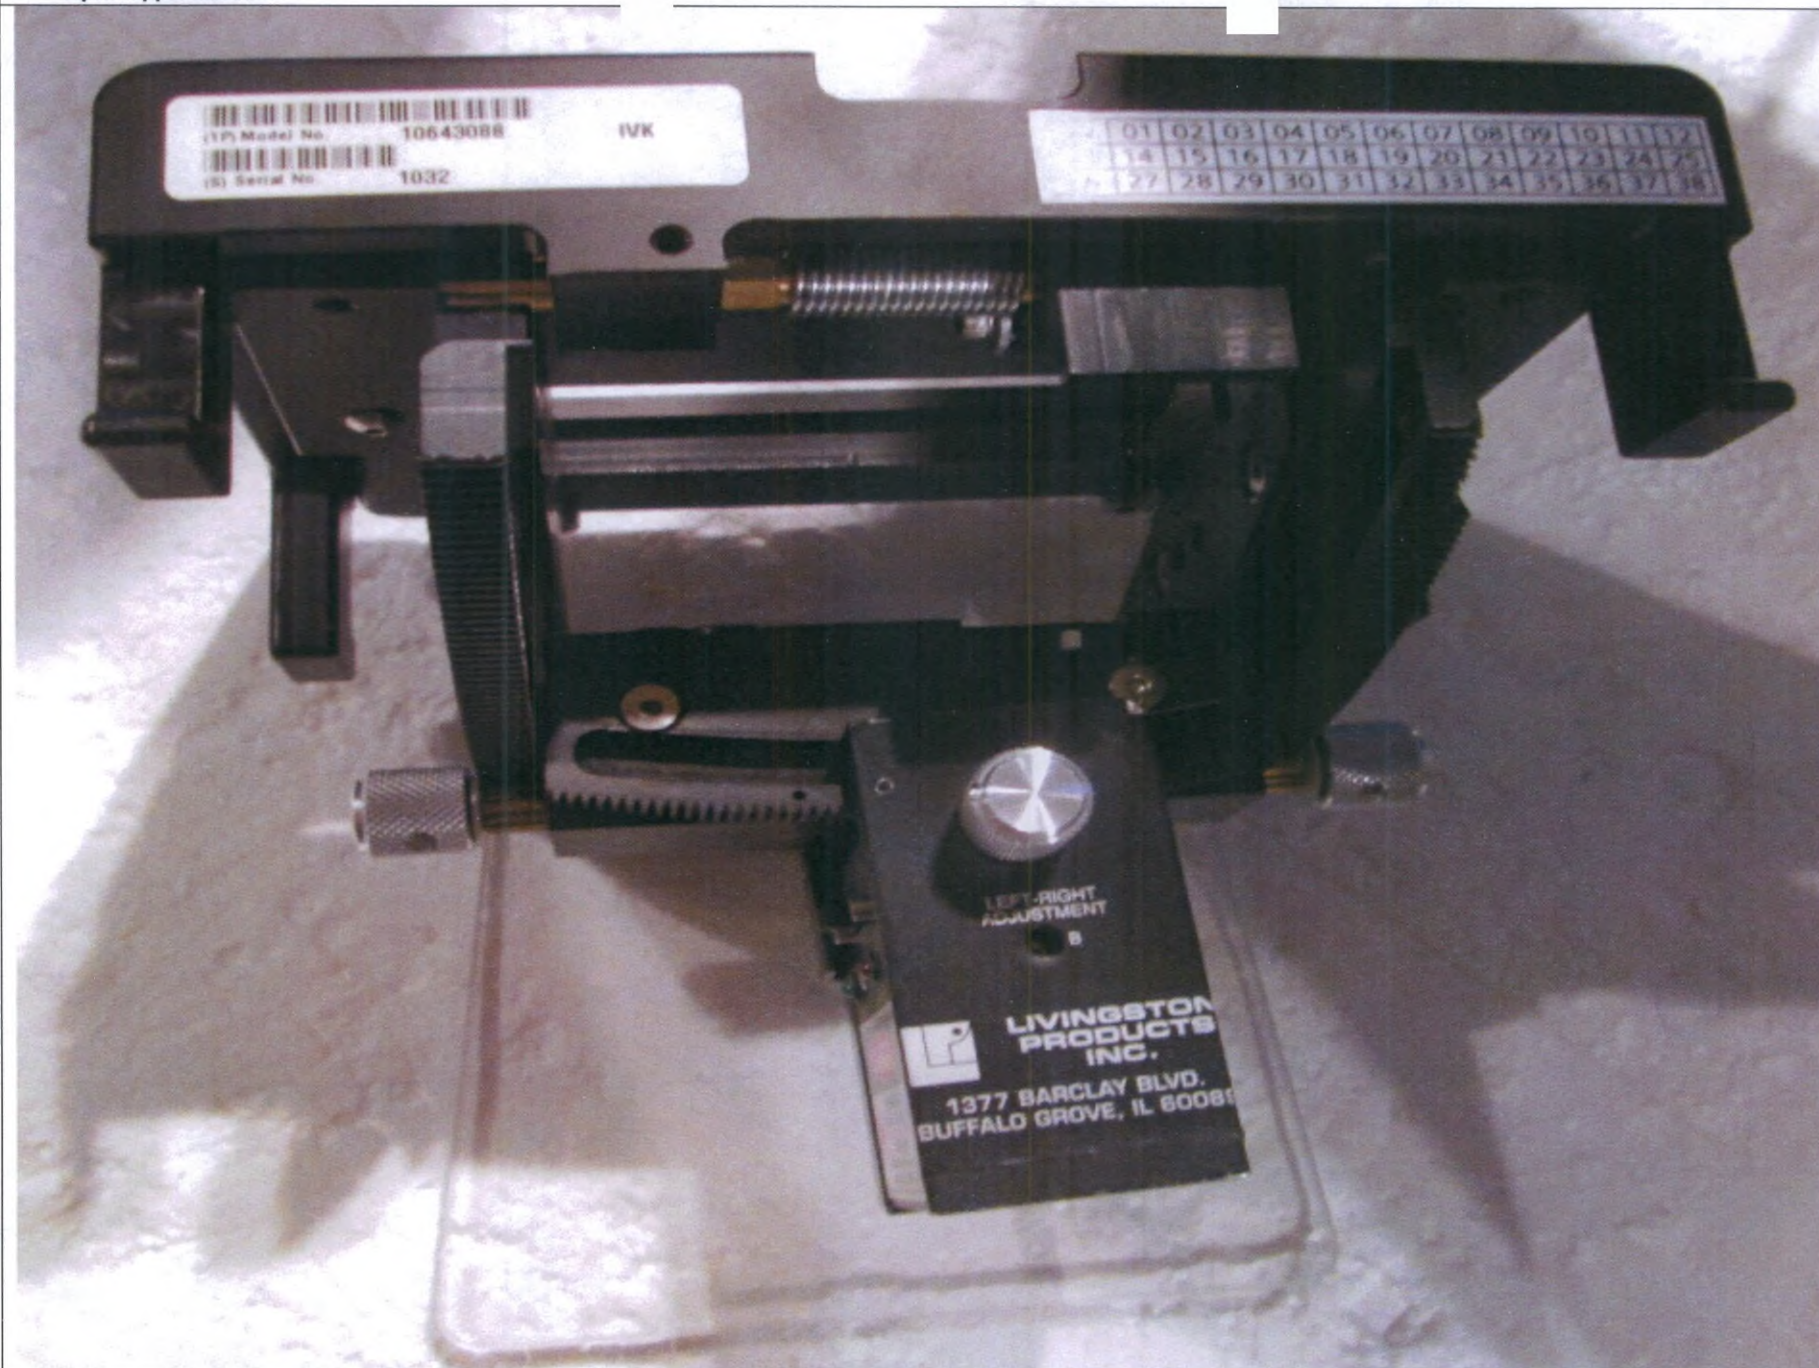

1. Пластина компрессионная с лазерным перекрестием для ручной биопсии или маркирования.



2. Пластина компрессионная для биопсии

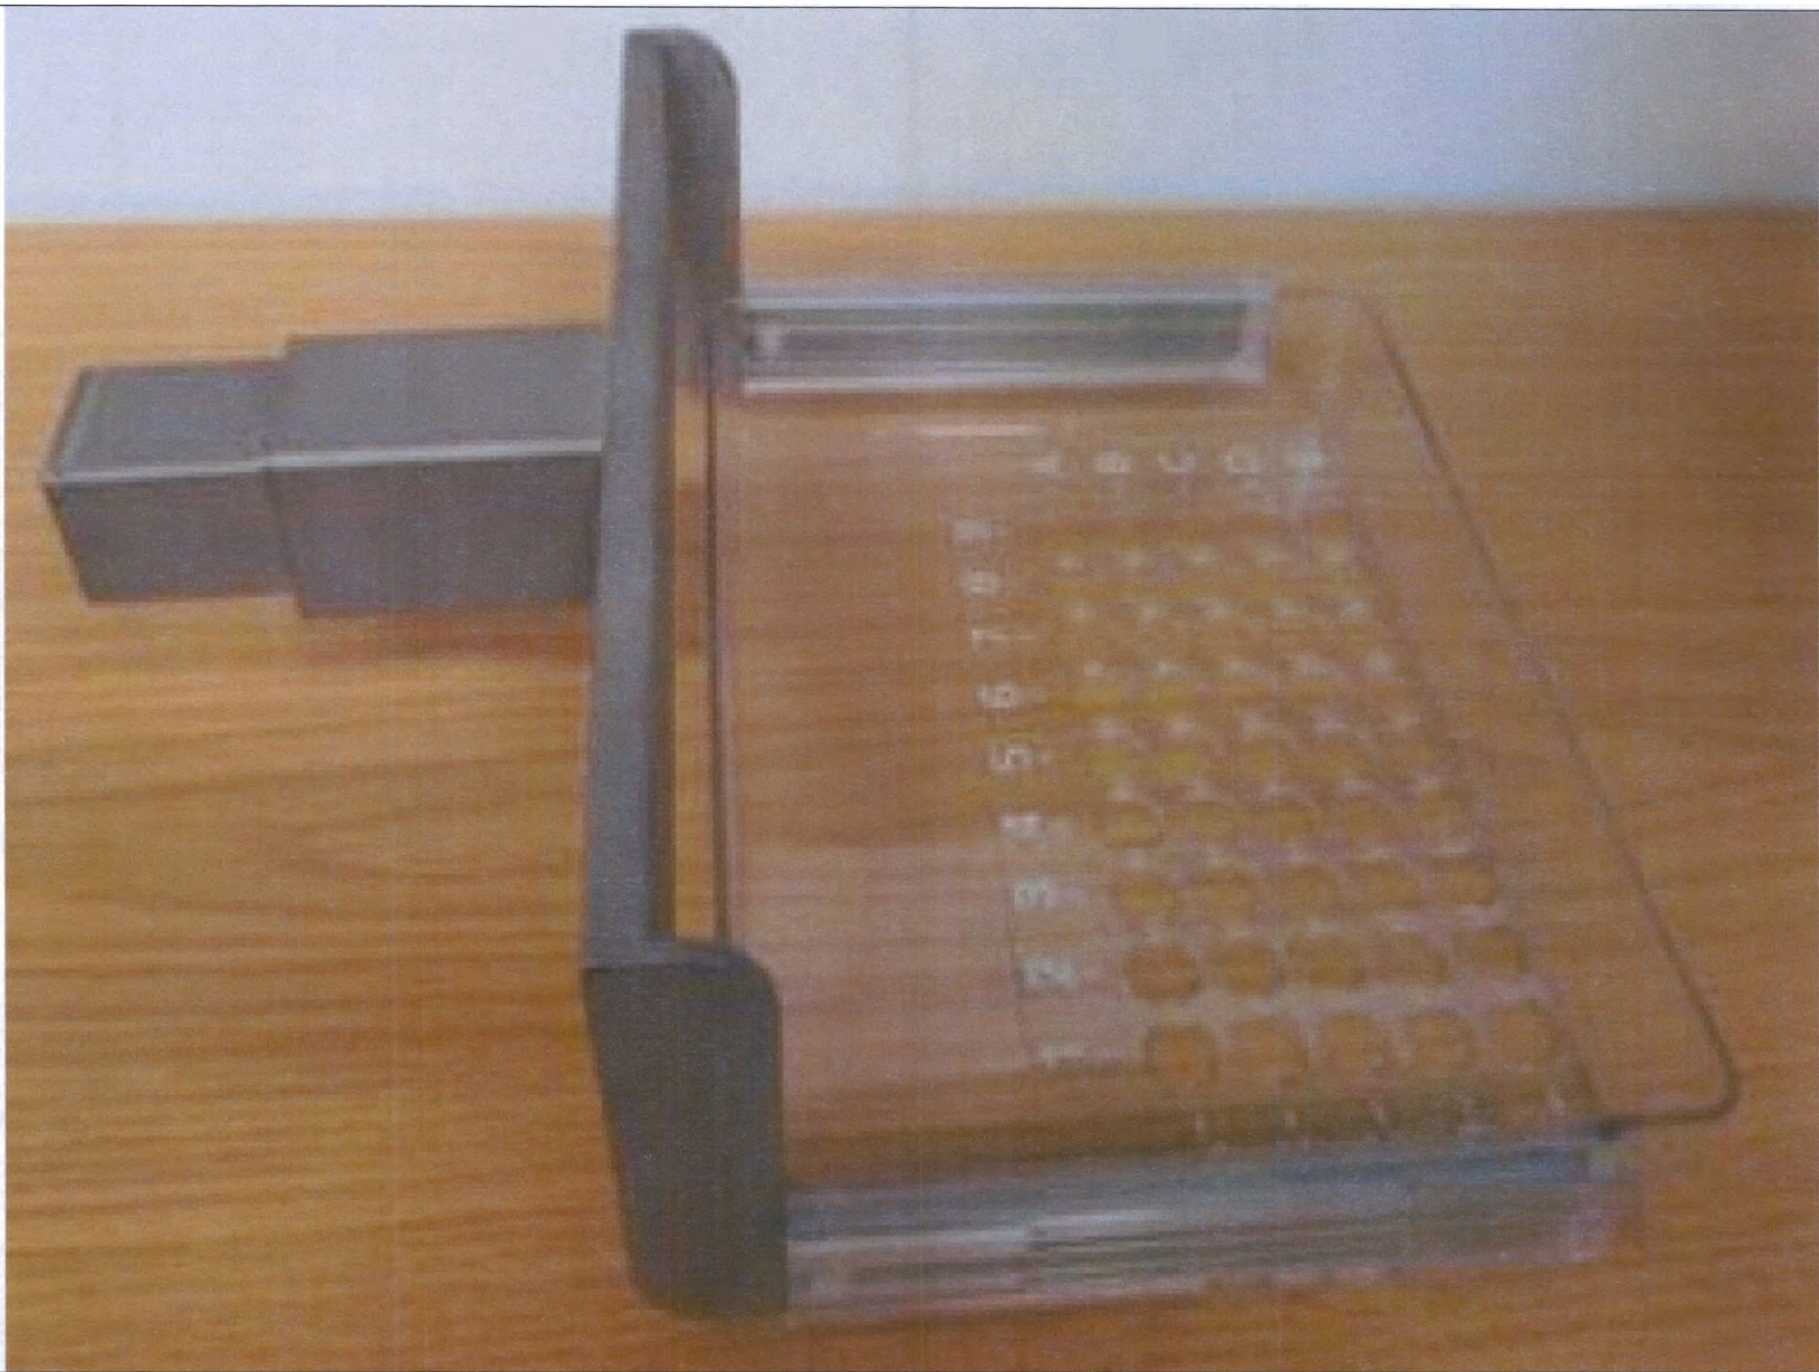


3. Вставка для компрессионной пластины для биопсии




4. Вставка для компрессионной пластины для стереотаксической биопсии (вертикальное направление иглы).




5. Вставка для компрессионной пластины для стереотаксической биопсии (горизонтальное направление иглы).

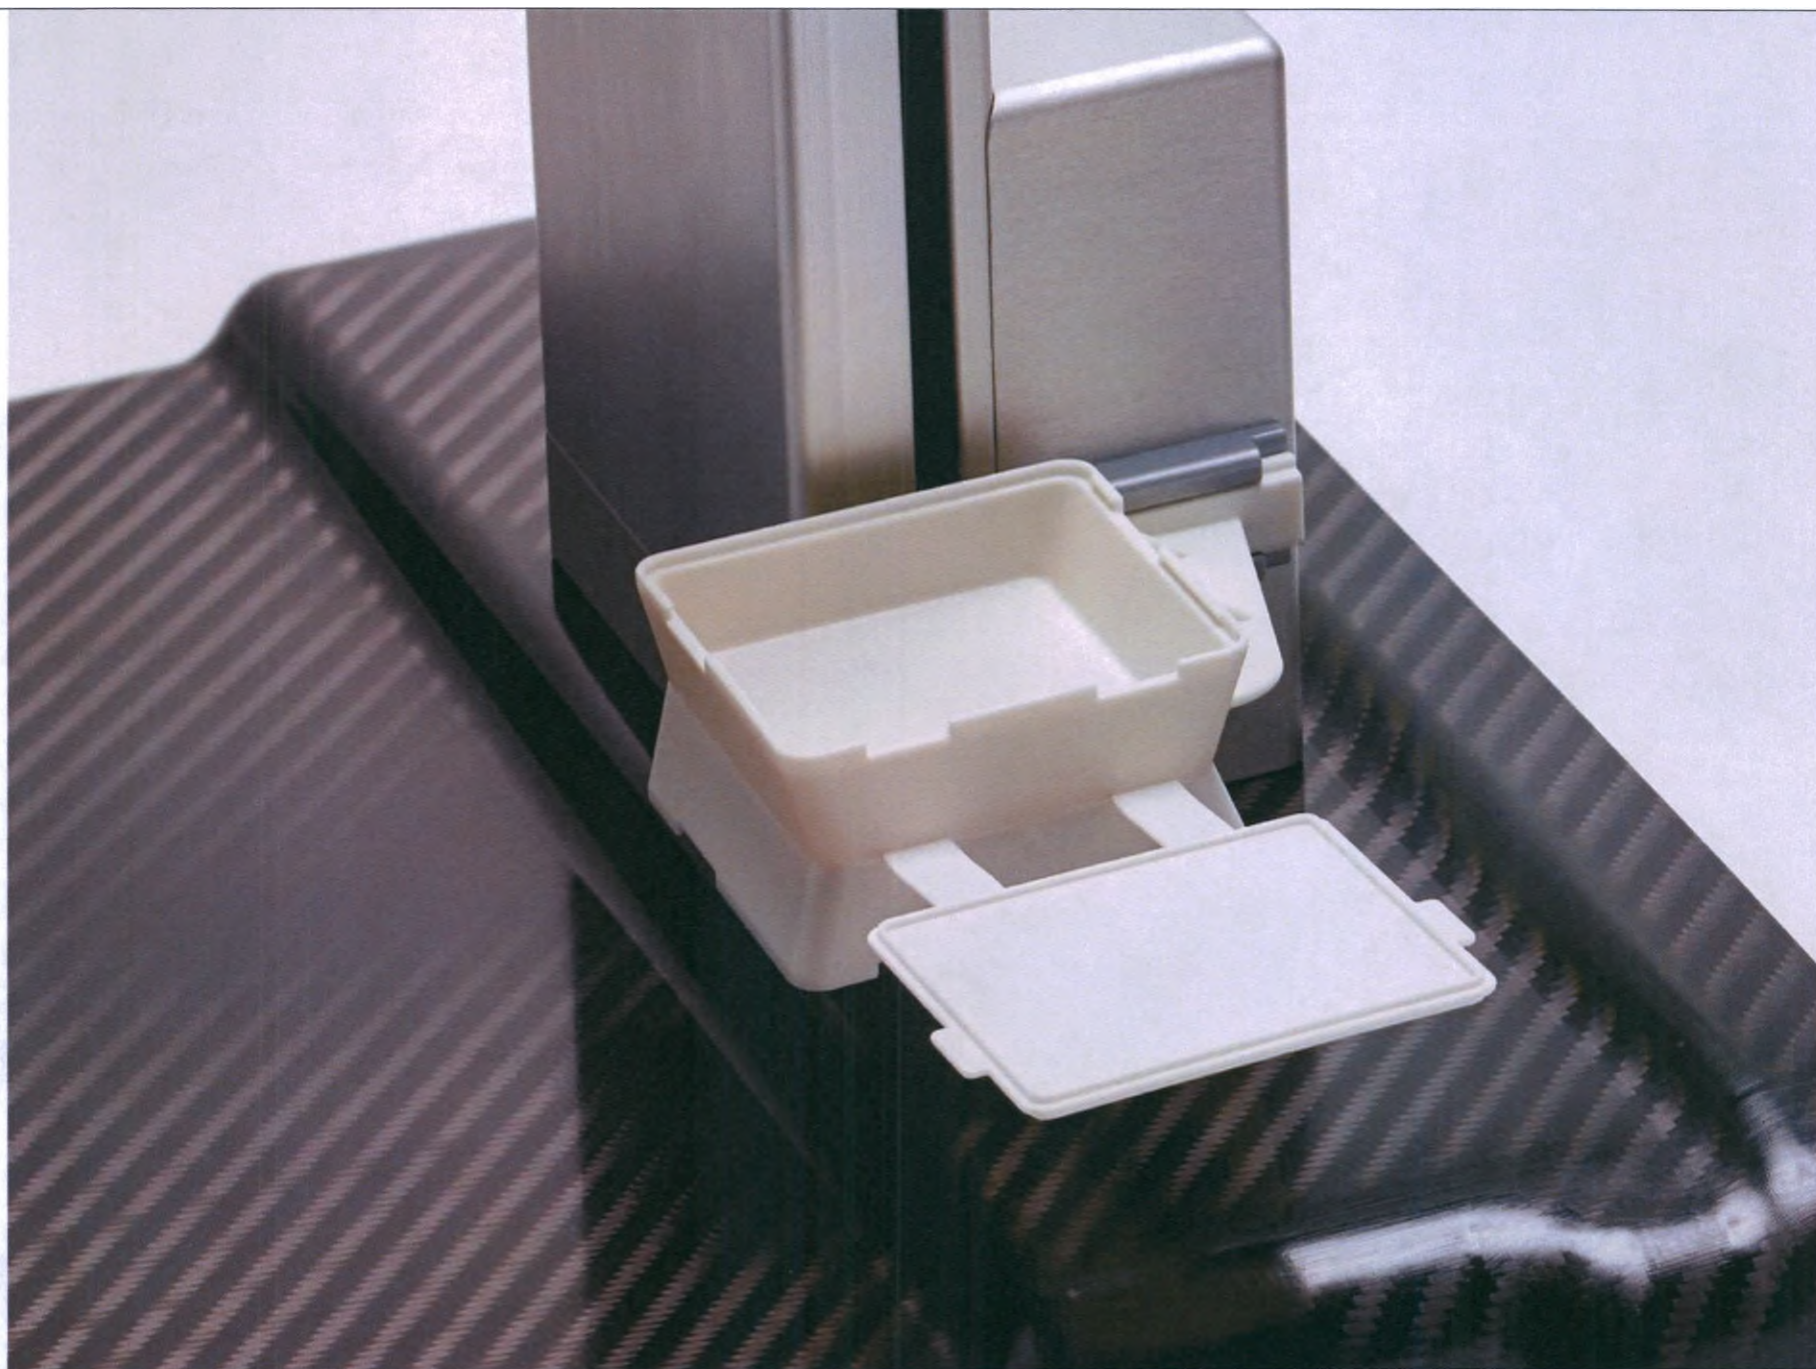

6. Лоток для материала.

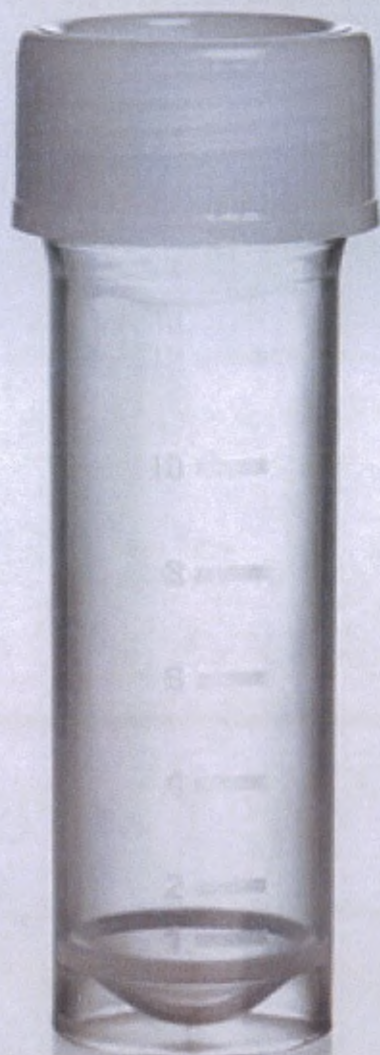


7. Вкладки для лотков для материала (не более 1000 шт.)

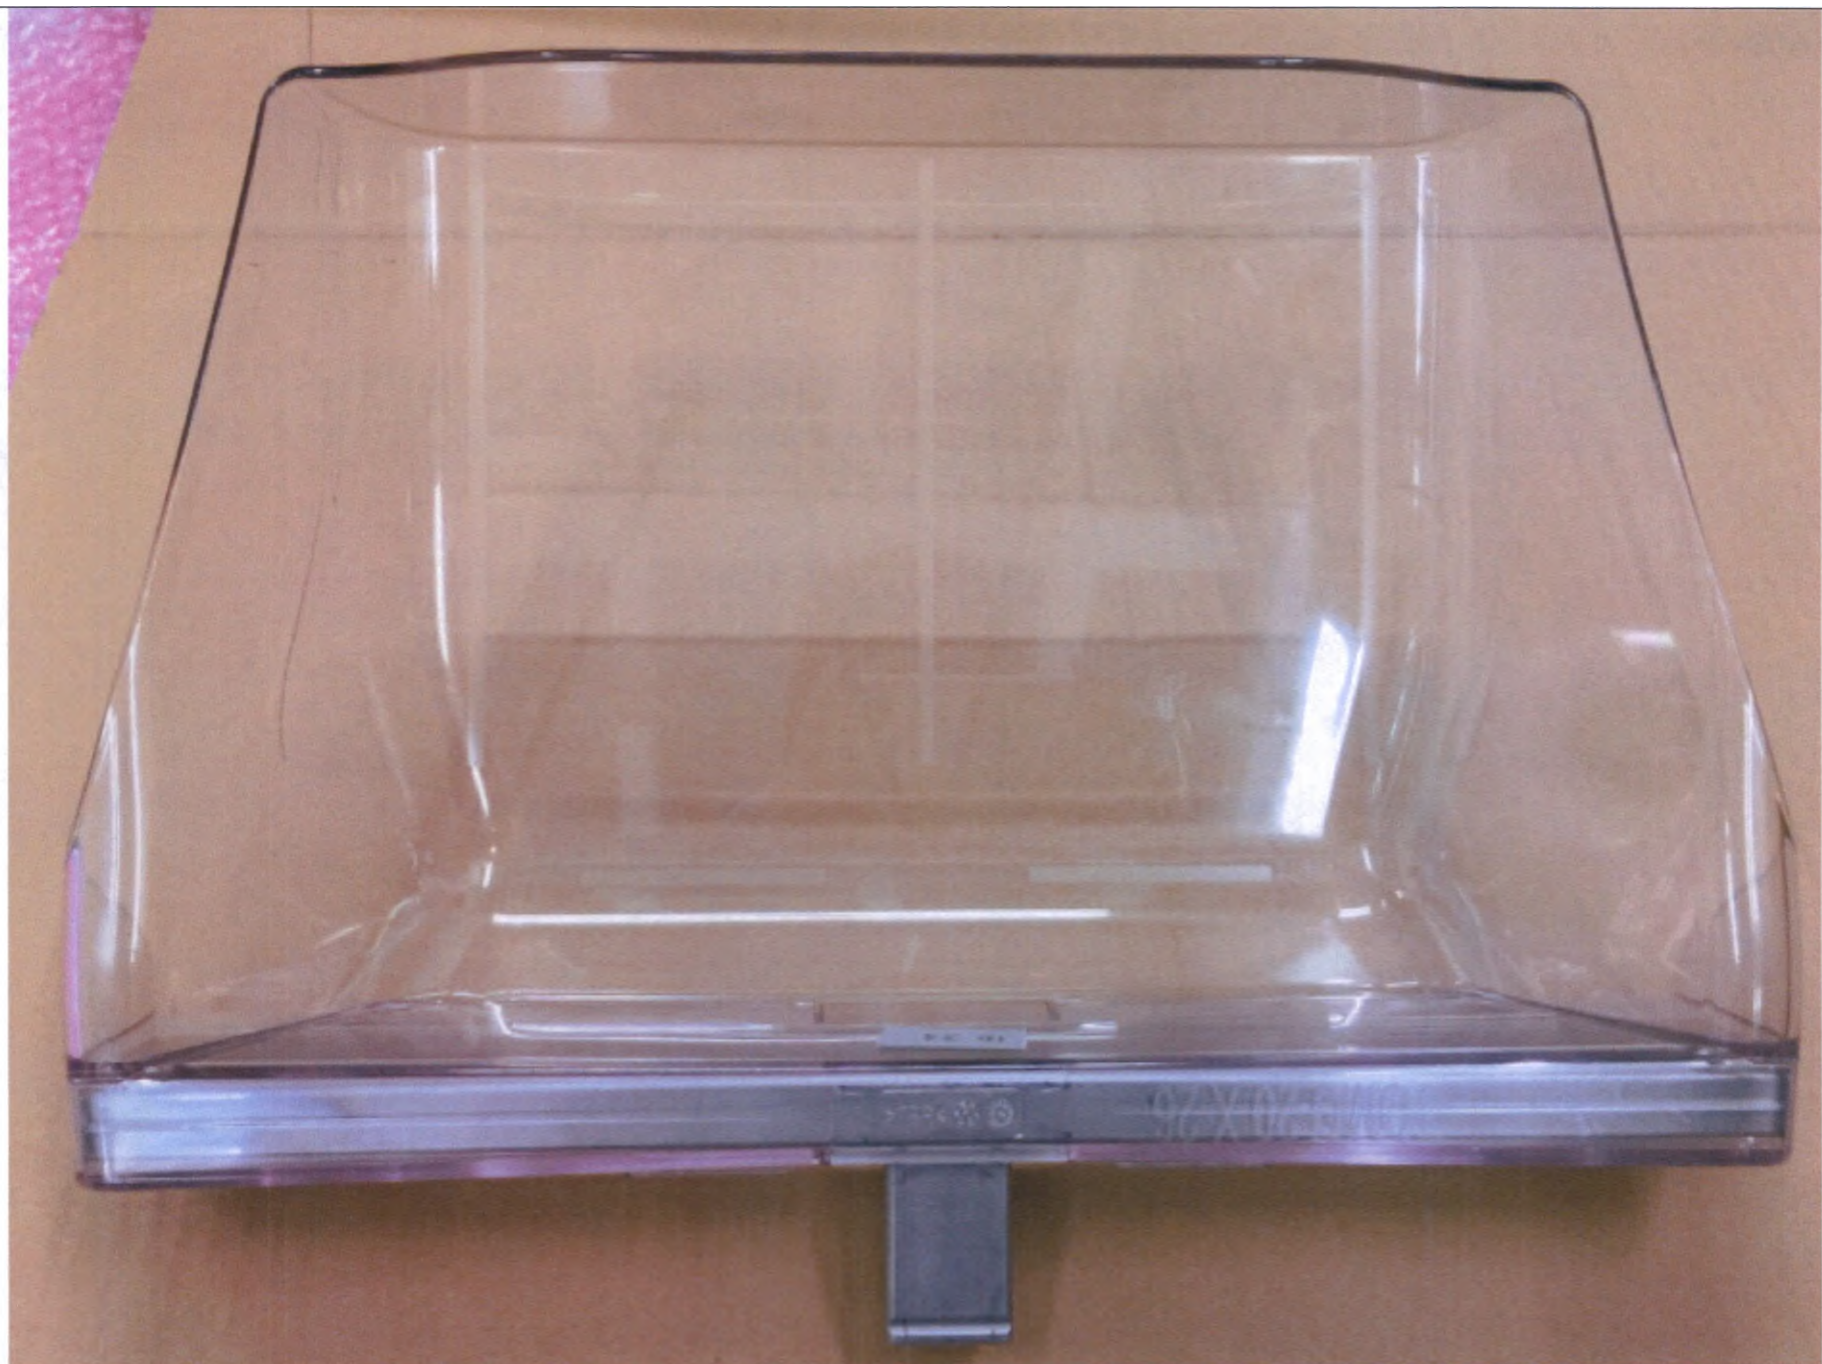


8. Пластина компрессионная мягкая 20х26.




9. Пластина компрессионная мягкая 12х24.

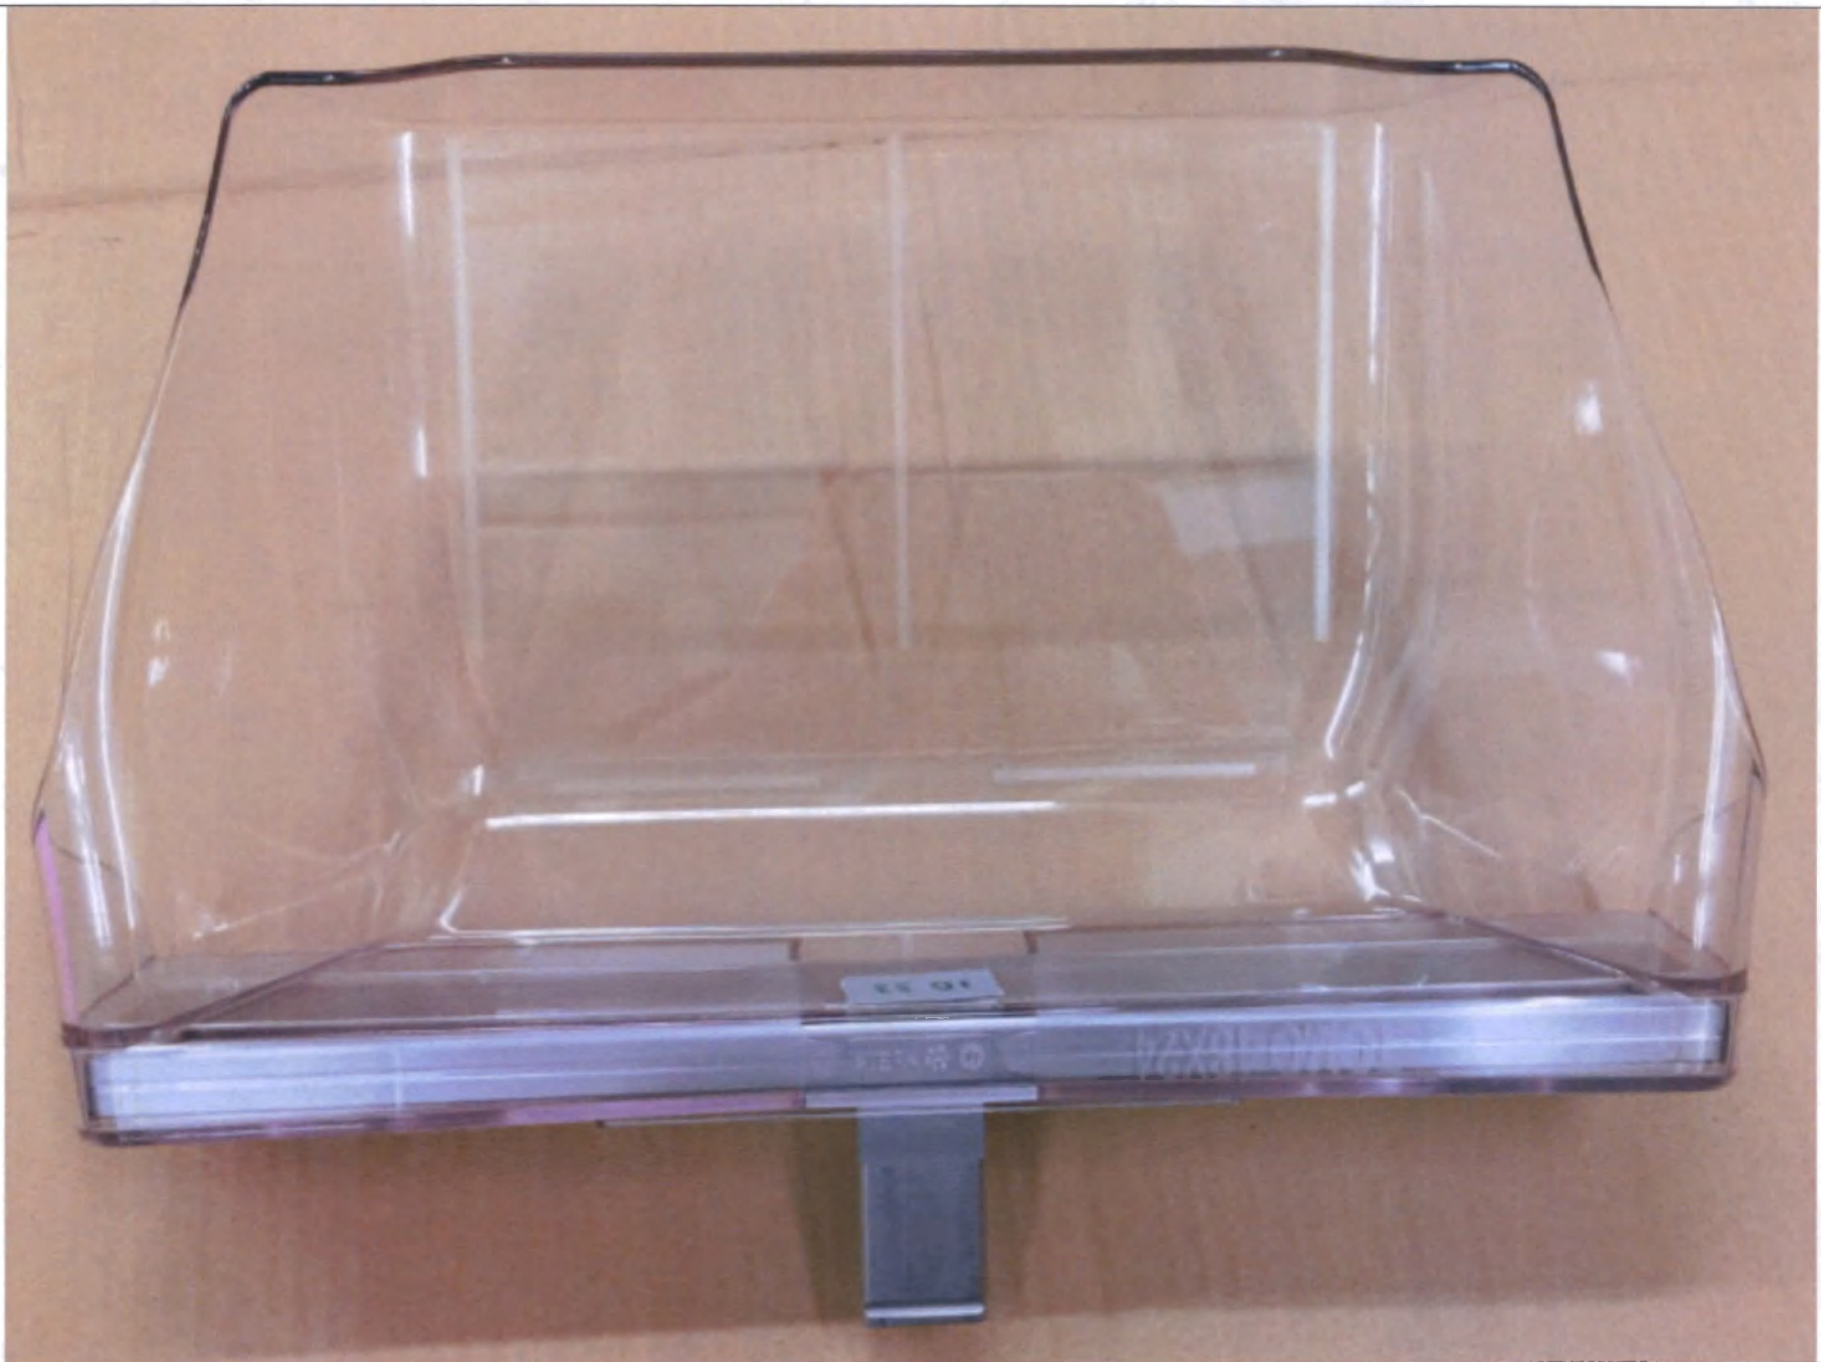


10. Пластина компрессионная мягкая 18x24.

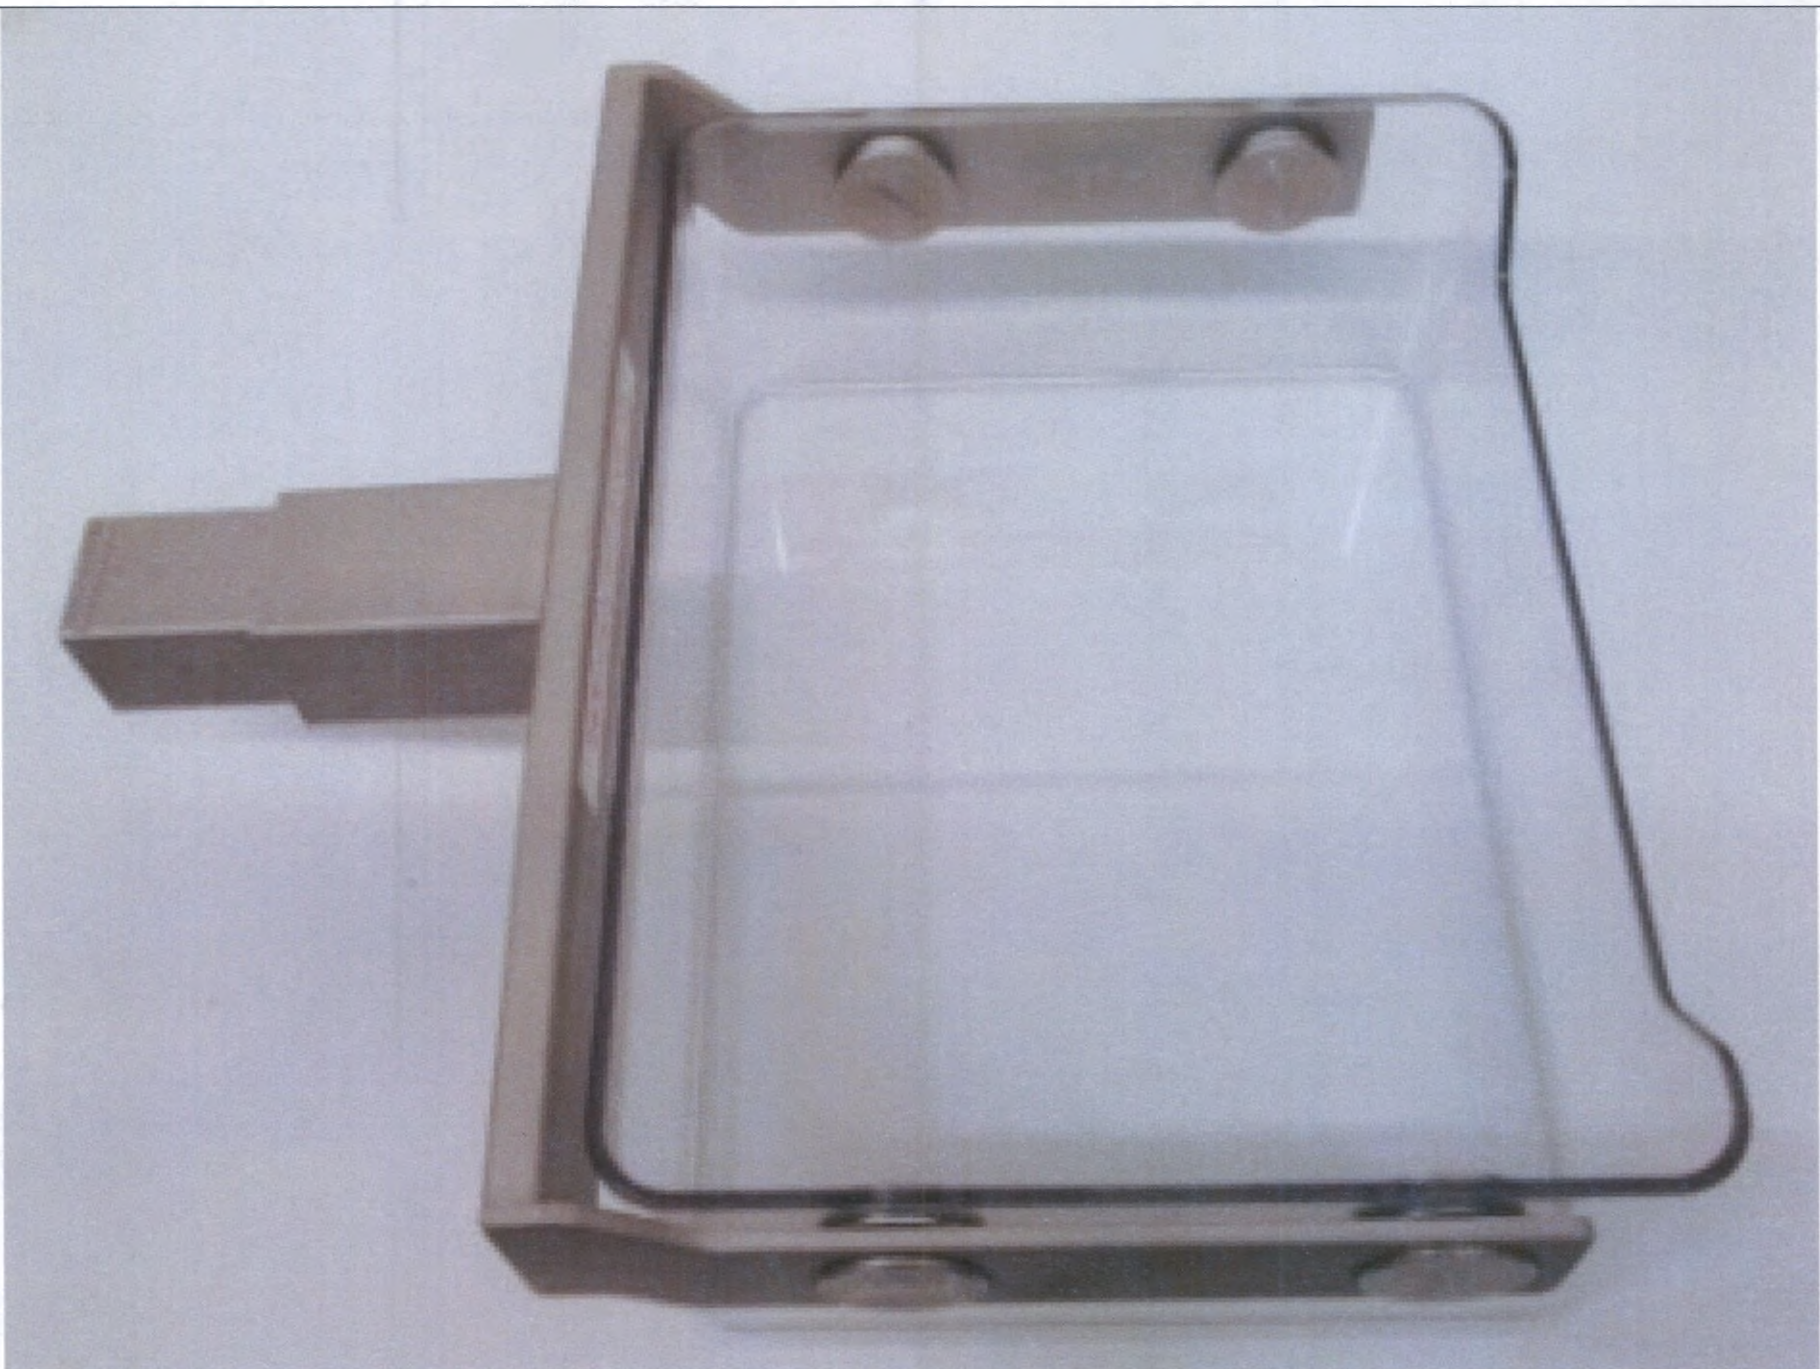


11. Пластина компрессионная гибкая 18x24

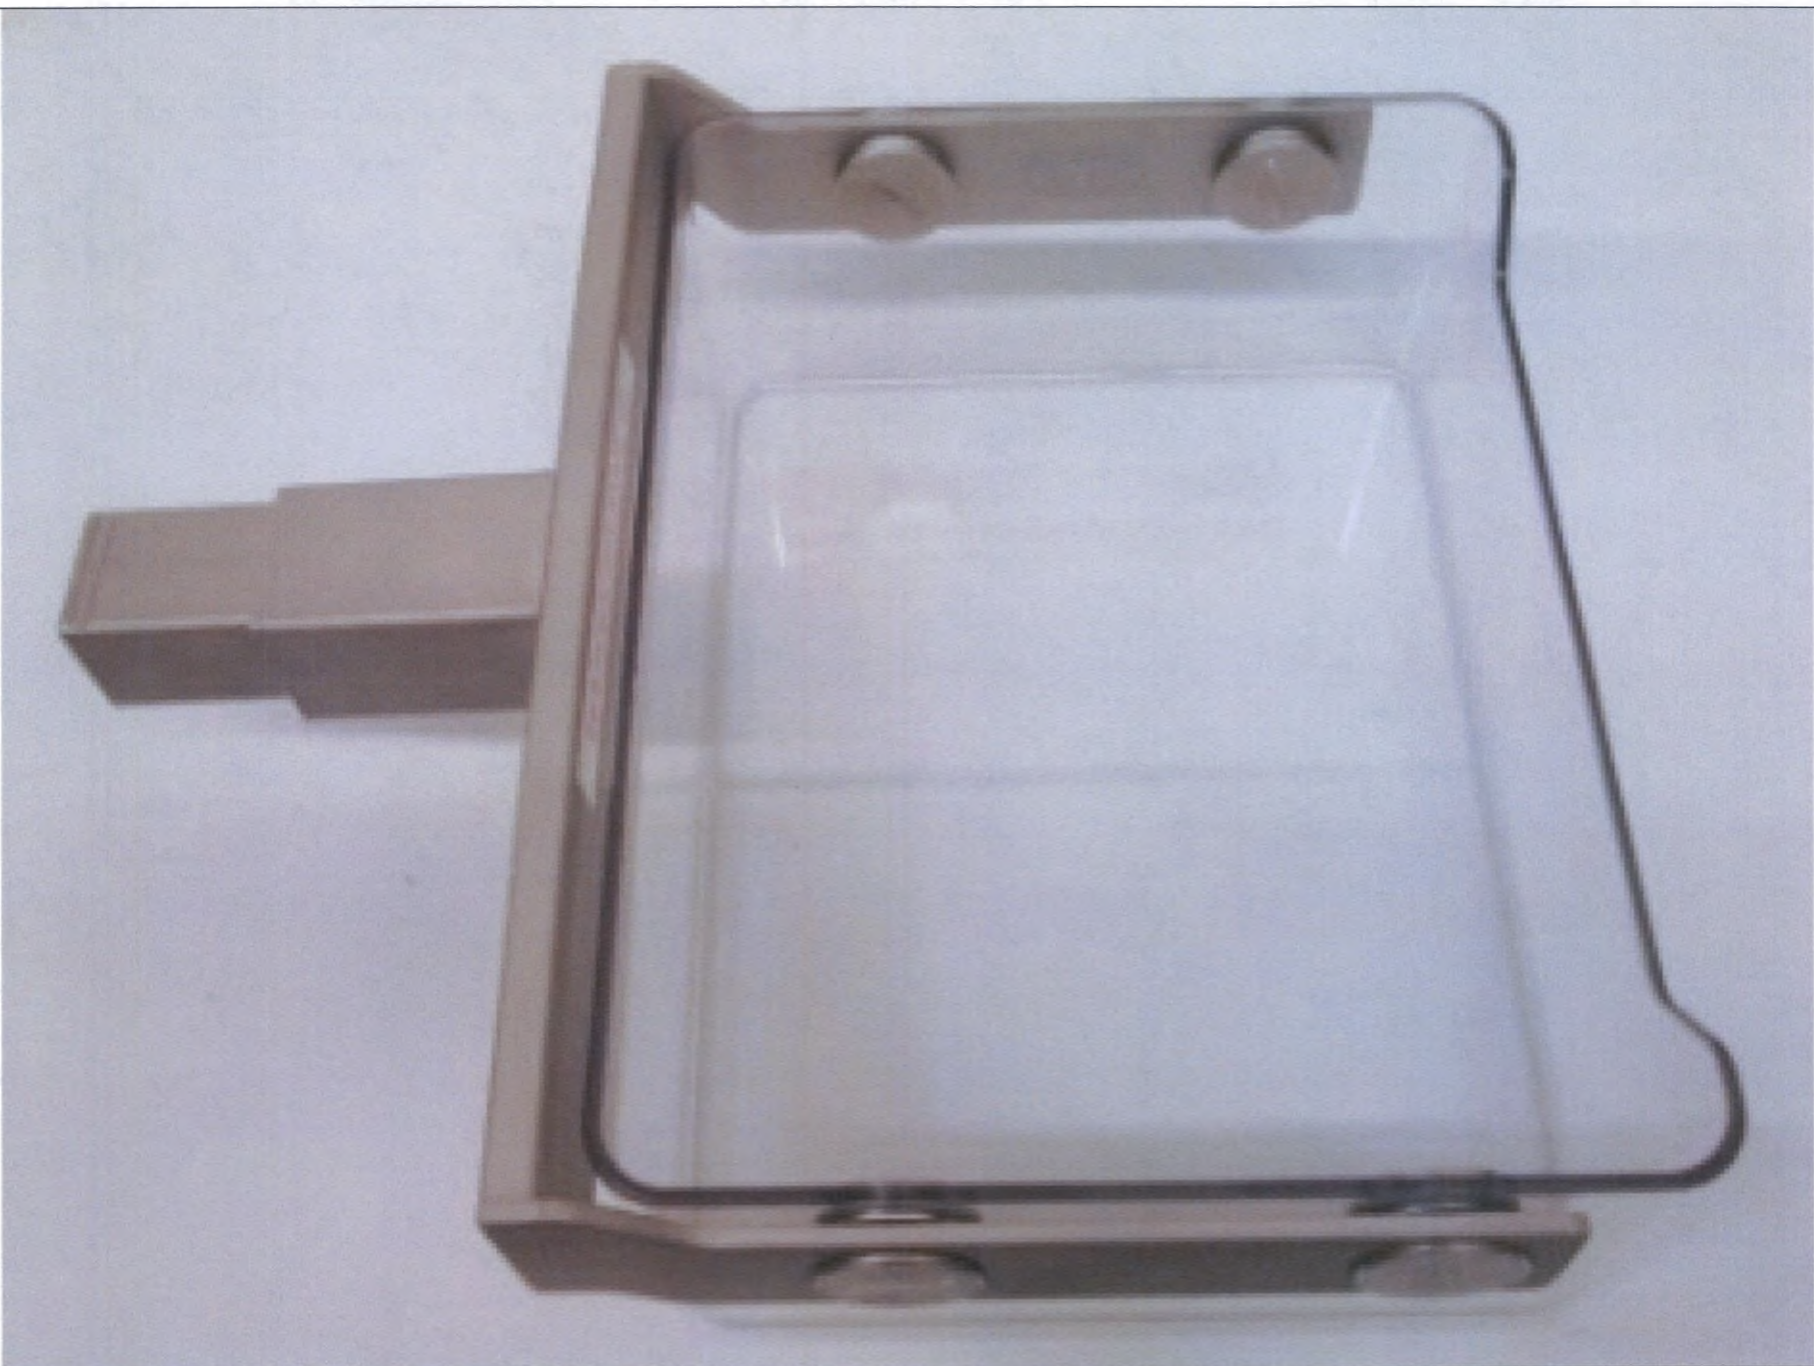


12. Вставка для пластины компрессионной гибкой 18х24.

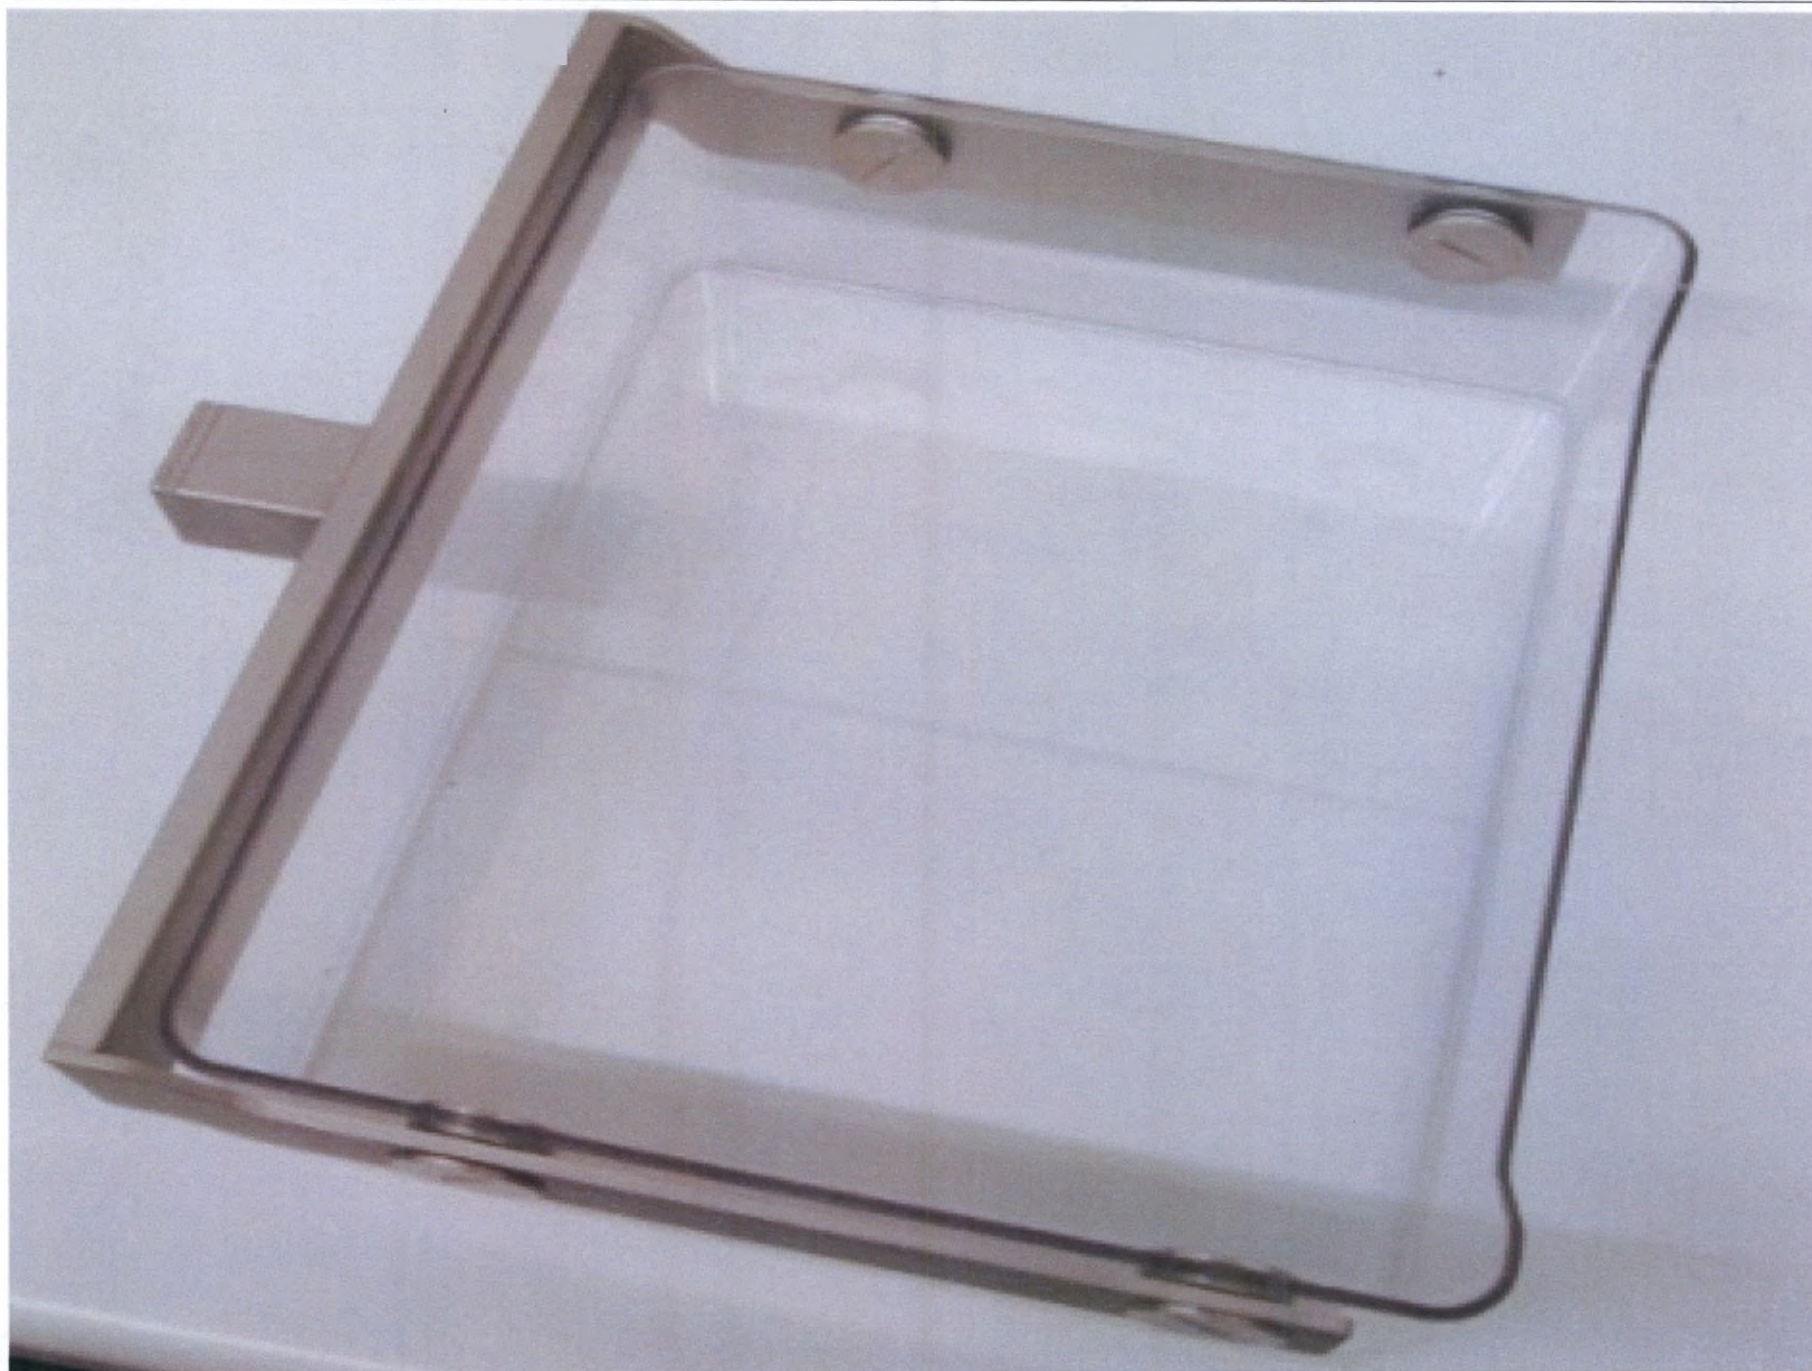

13. Пластина компрессионная гибкая 24x30

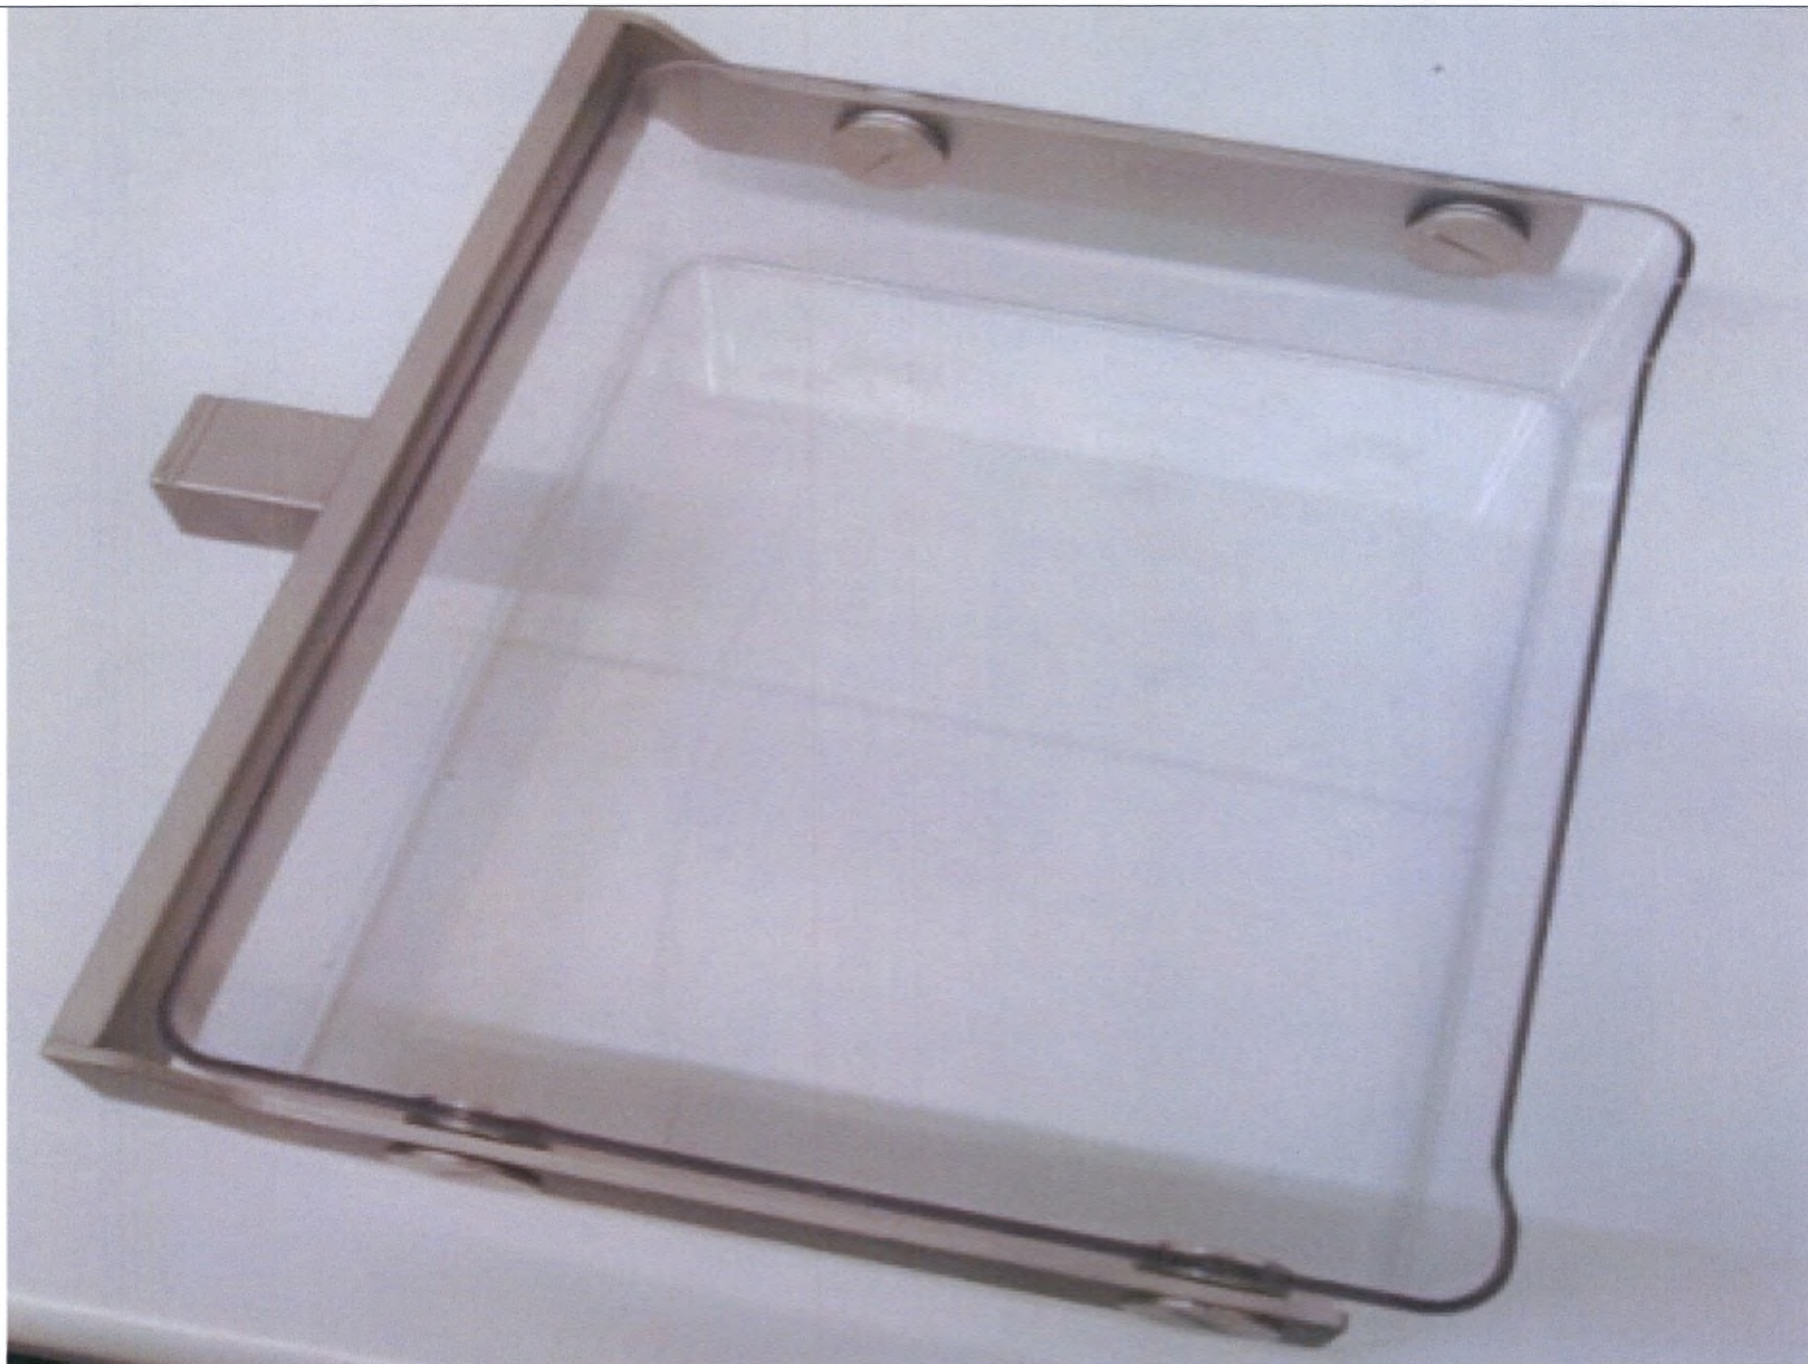

14. Вставка для пластины компрессионной гибкой 24х30

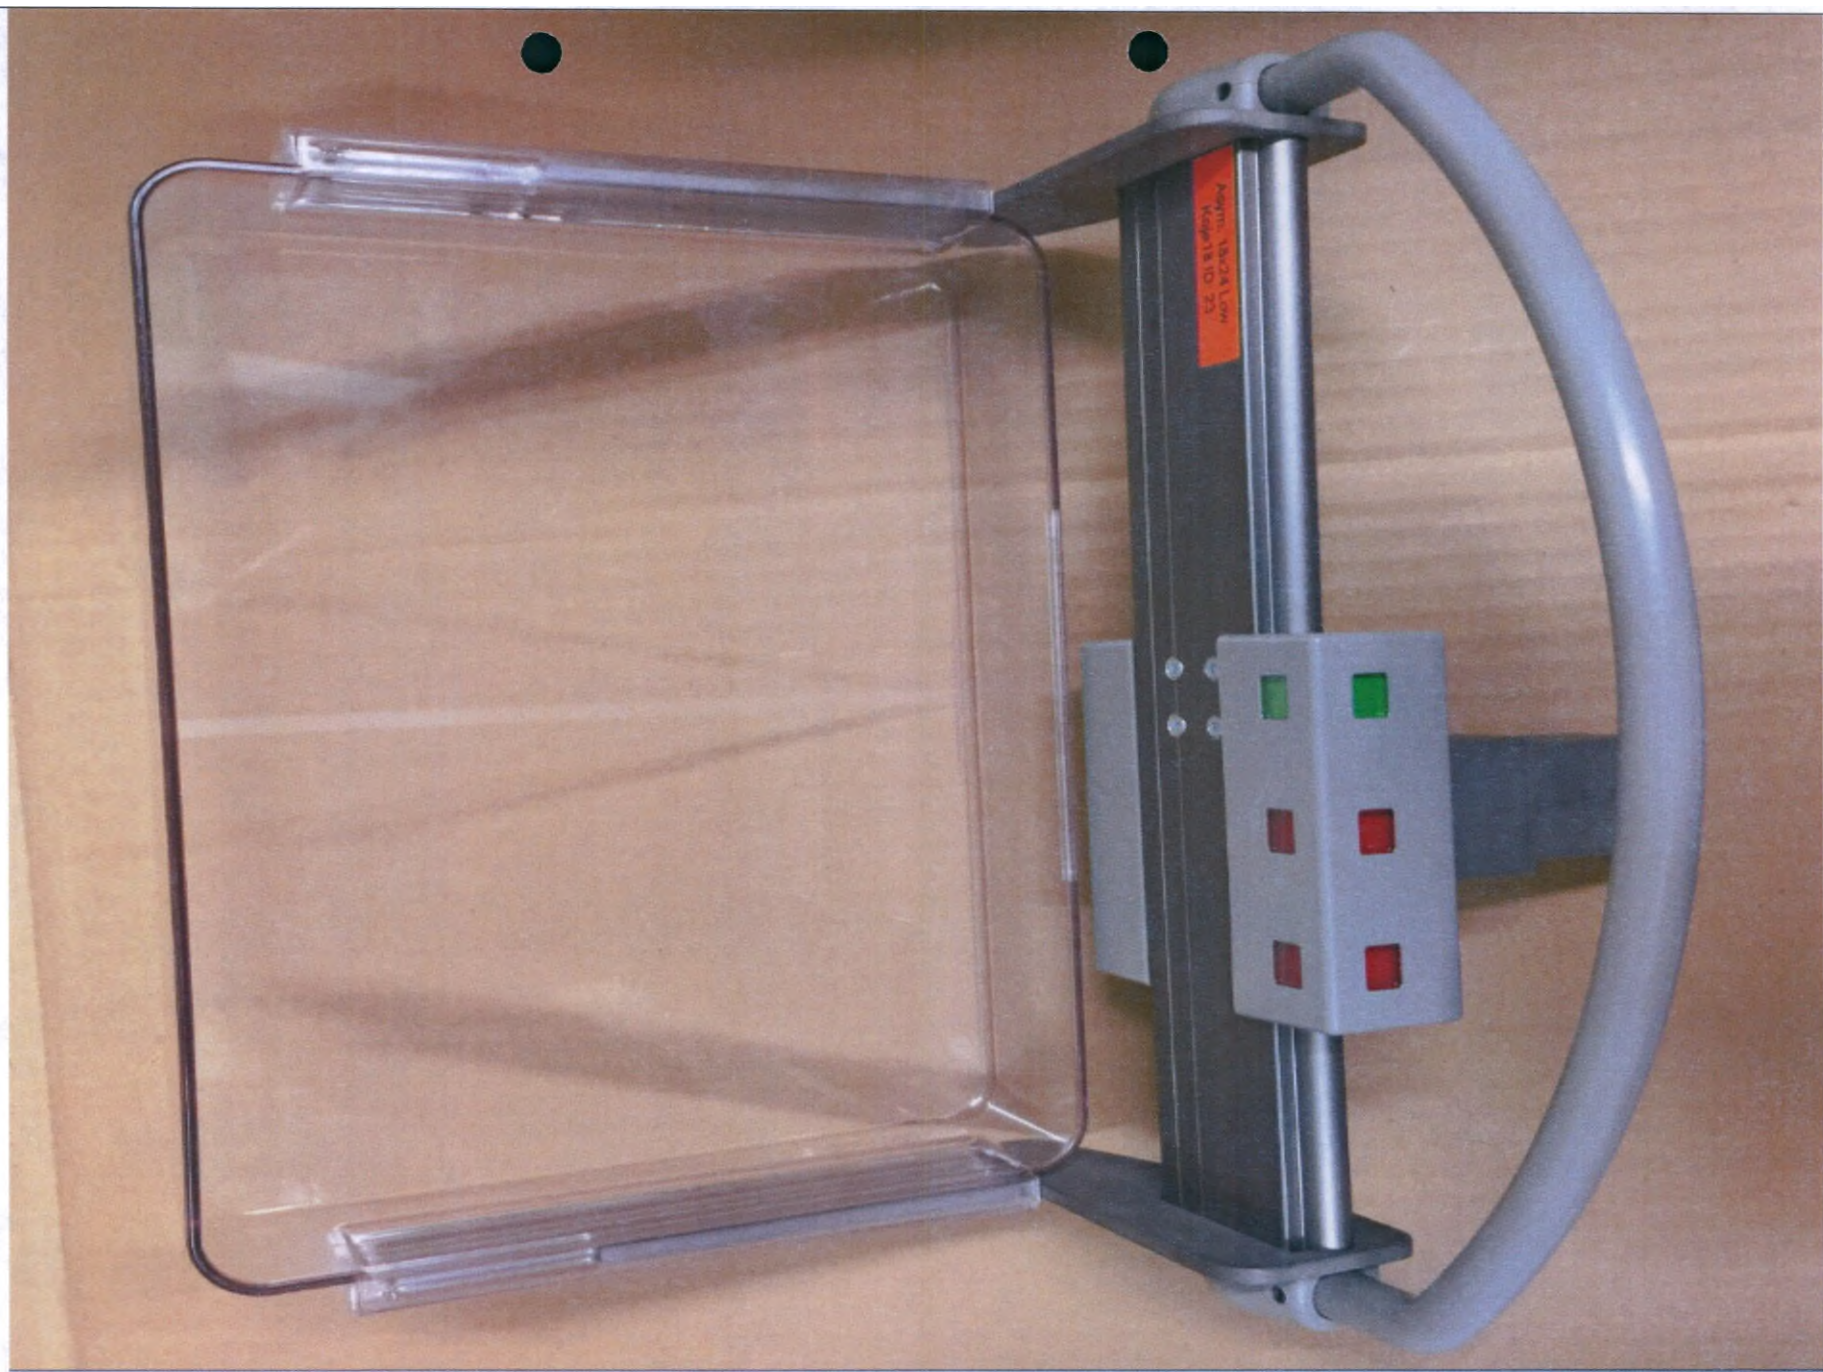

15. Пластина компрессионная сдвигающаяся 18x24, с высоким краем.



16. Пластина компрессионная сдвигающаяся 18x24, с низким краем.



17. Устройство для стереотаксической биопсии.



18. Устройство для стереотаксической биопсии с возможностью работы в режиме томосинтеза.



19. Пластина увеличительная для проведения биопсии



Пластина увеличительная для проведения биопсии



Version: 2.1.0.0.64


Patient Demographics

Patient Name: Jane Doe
Patient ID: CAD000000
Patient DOB: 10/20/1934
Accession #:
Study Date: 03/02/2000 09:28:15 PM

b⁺



← 2.8

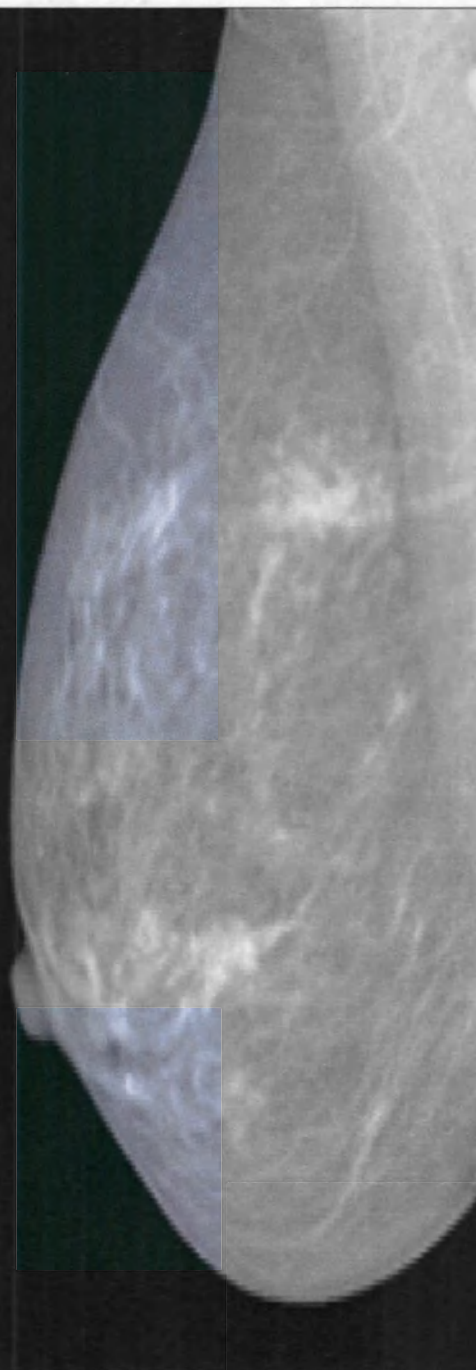

20. Устройство автоматического анализа.




21. Столик увеличительный 1,5.




22. Столик увеличительный 1,8.




23. Набор пластин компрессионных для столика увеличительного, в составе:- пластина компрессионная 16x20

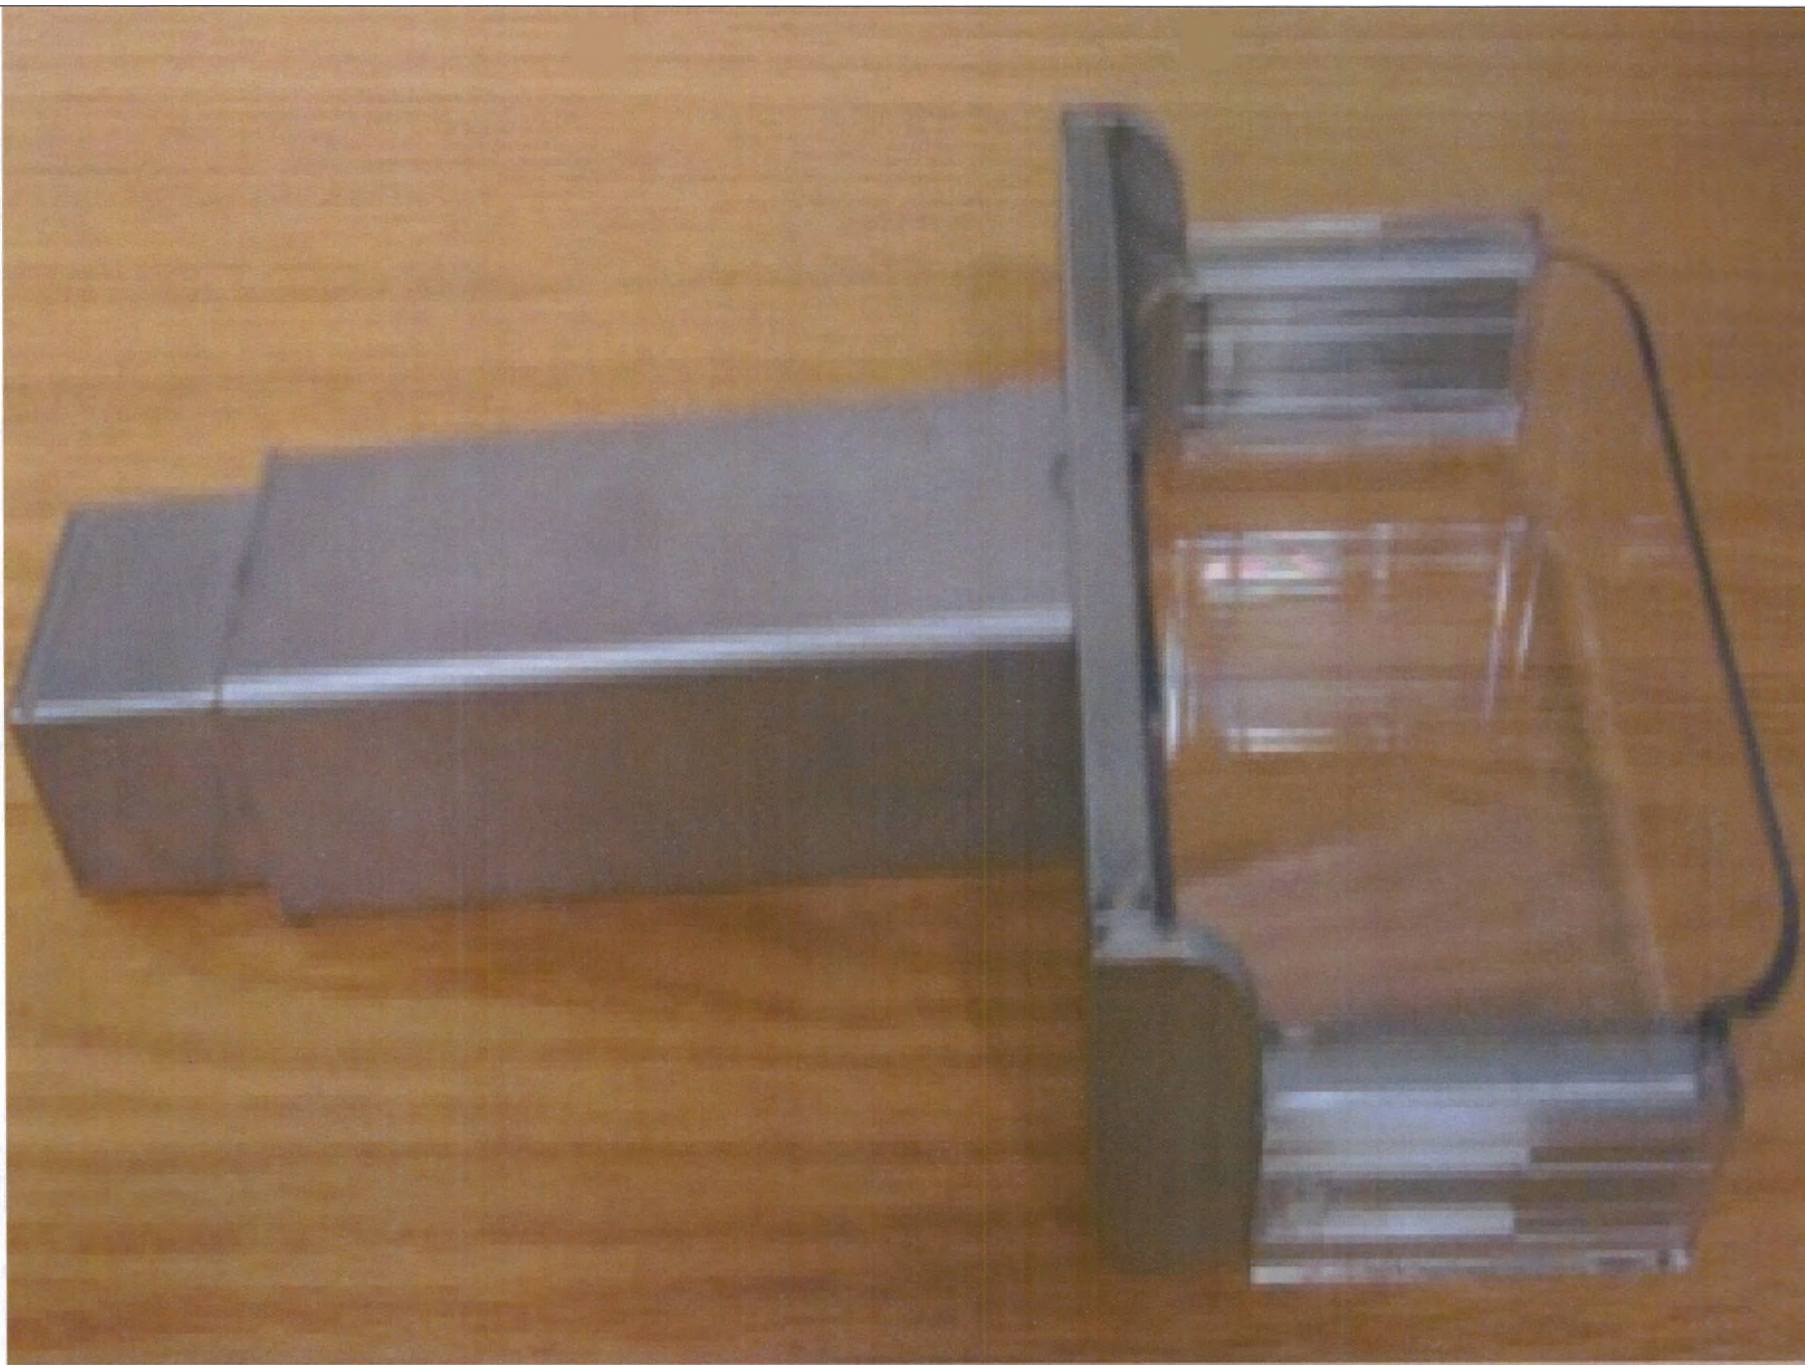

Набор пластин компрессионных для столика увеличительного, в составе:- пластина компрессионная 9х9.

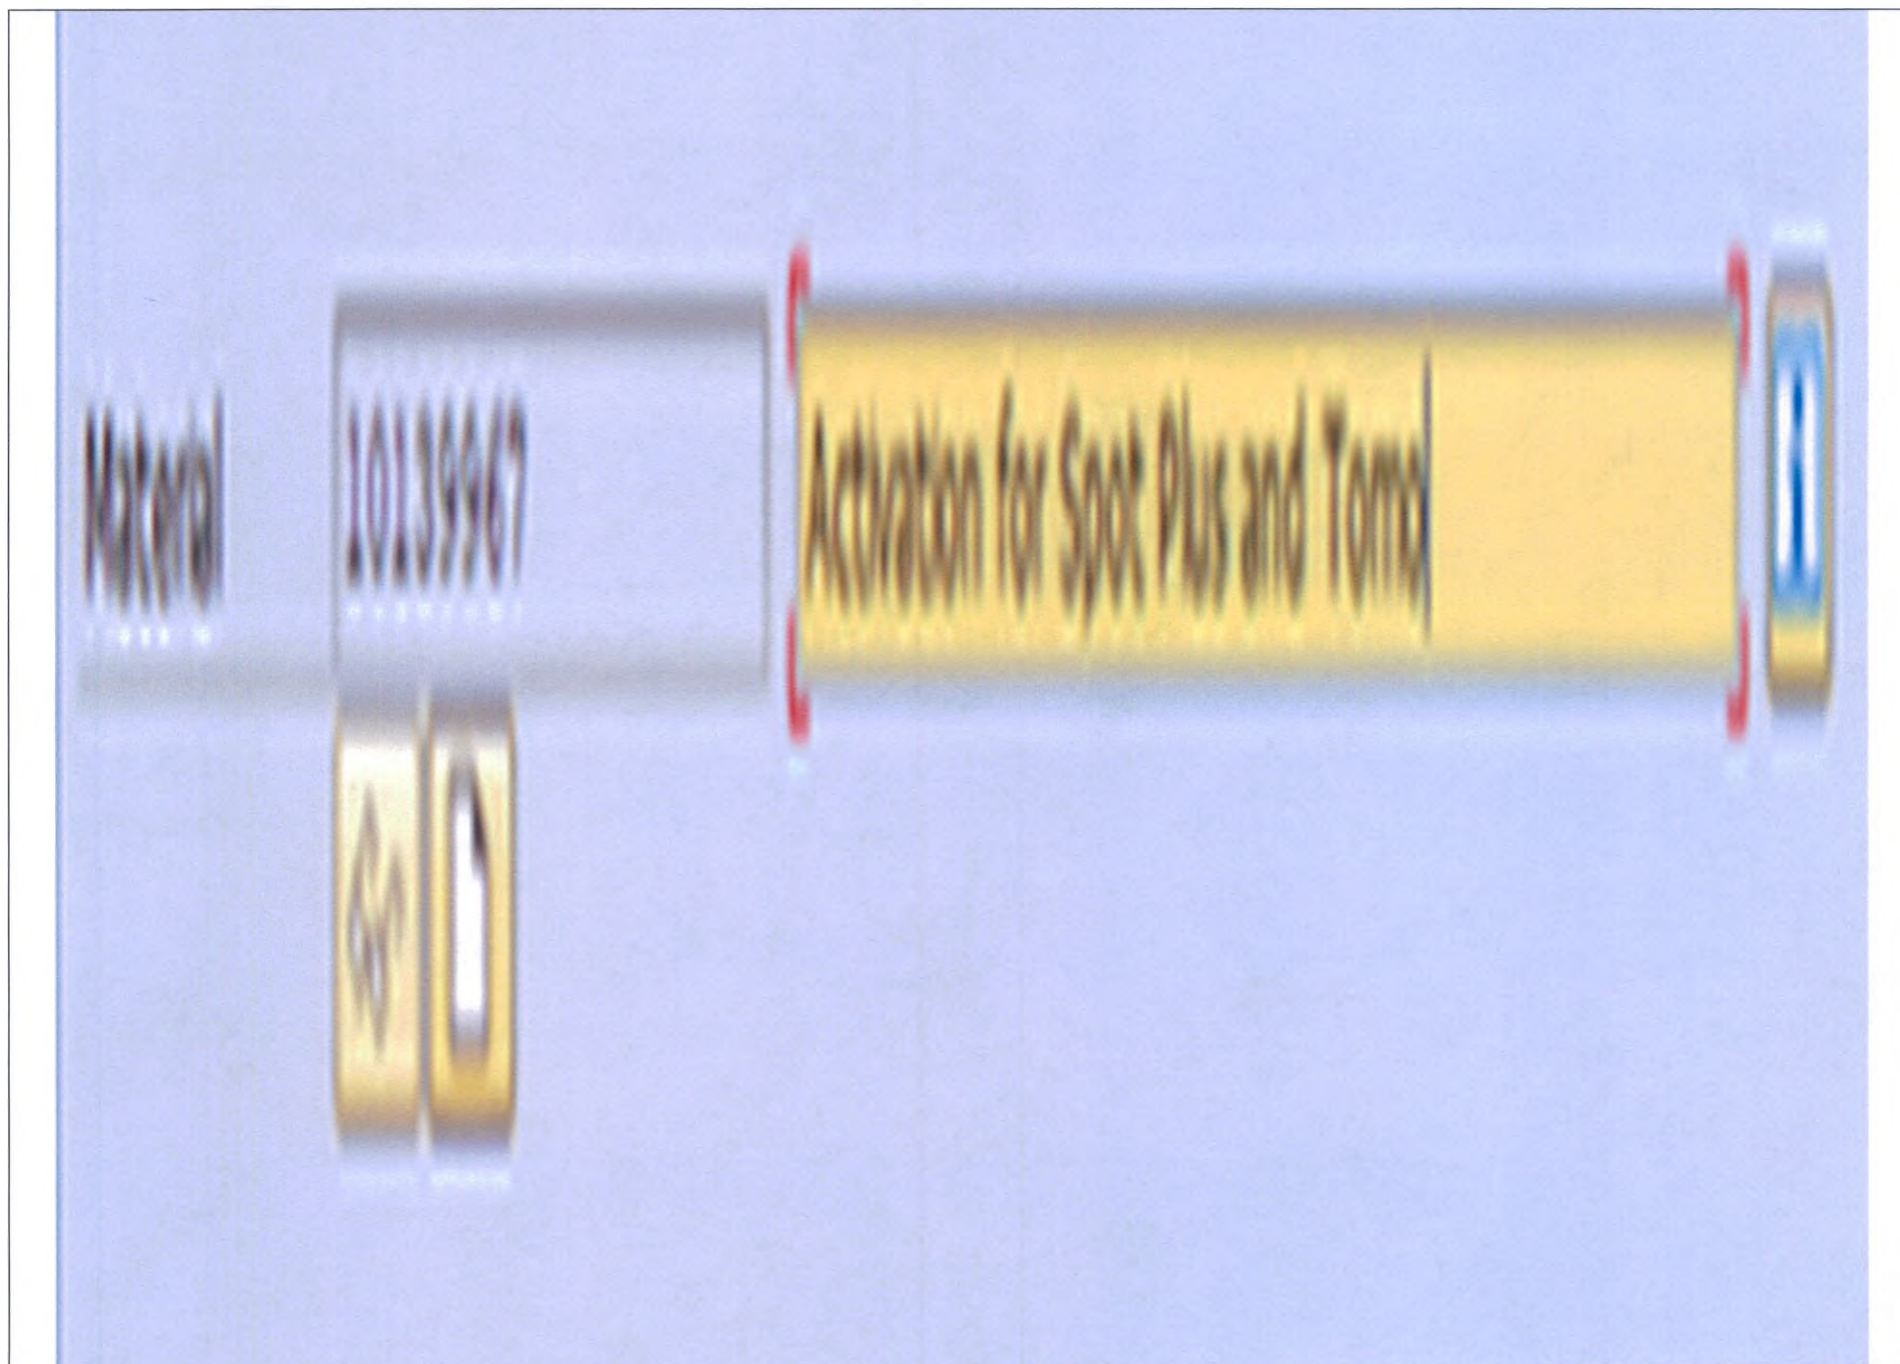


24. Пластина компрессионная для прицельных снимков в режиме томосинтеза, 18x24

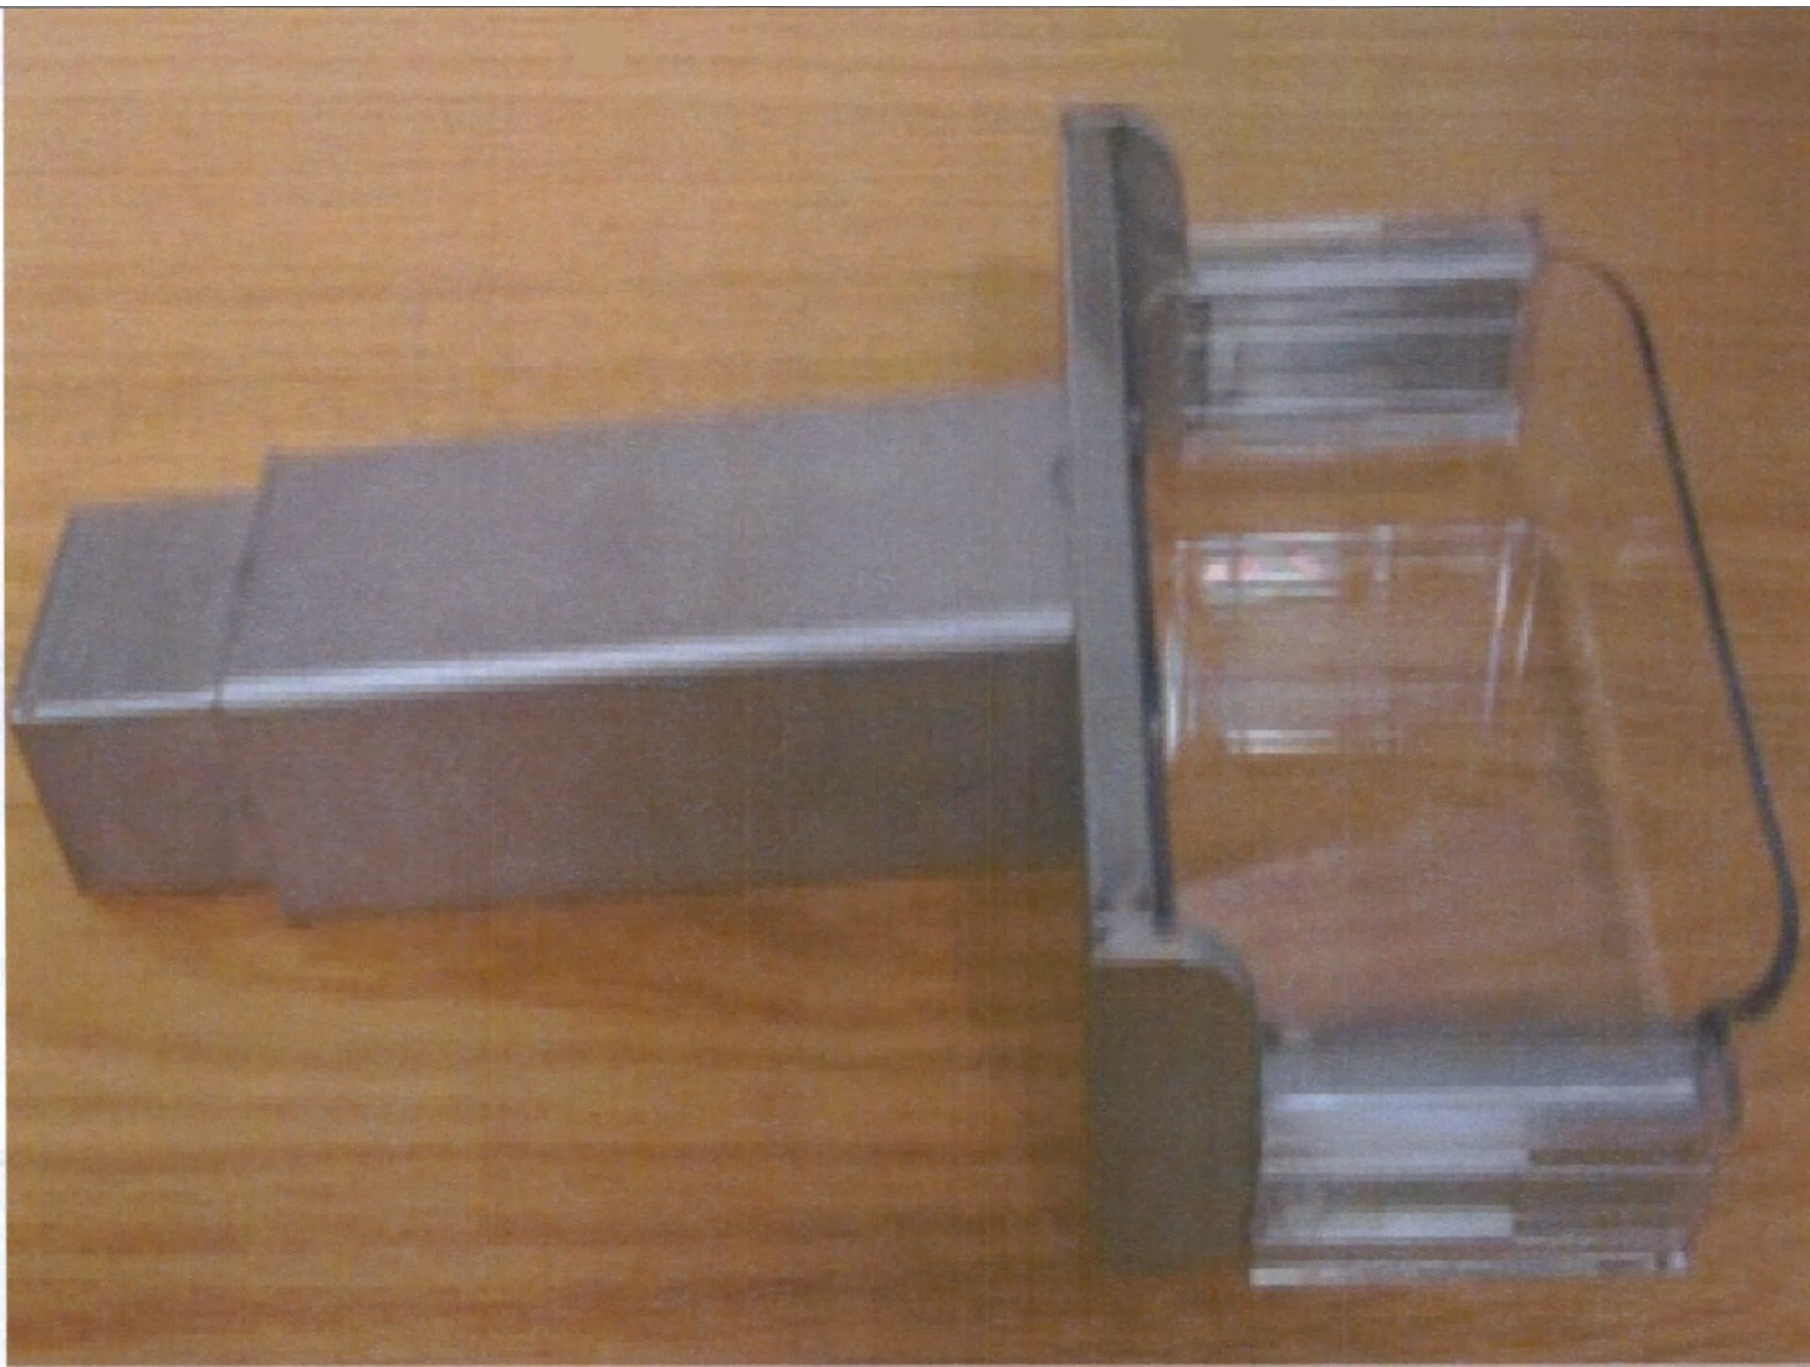


25. Вставка для пластины компрессионной для столика увеличительного (9x9)




26. Вставка для пластины компрессионной для столика увеличительного (16x20)

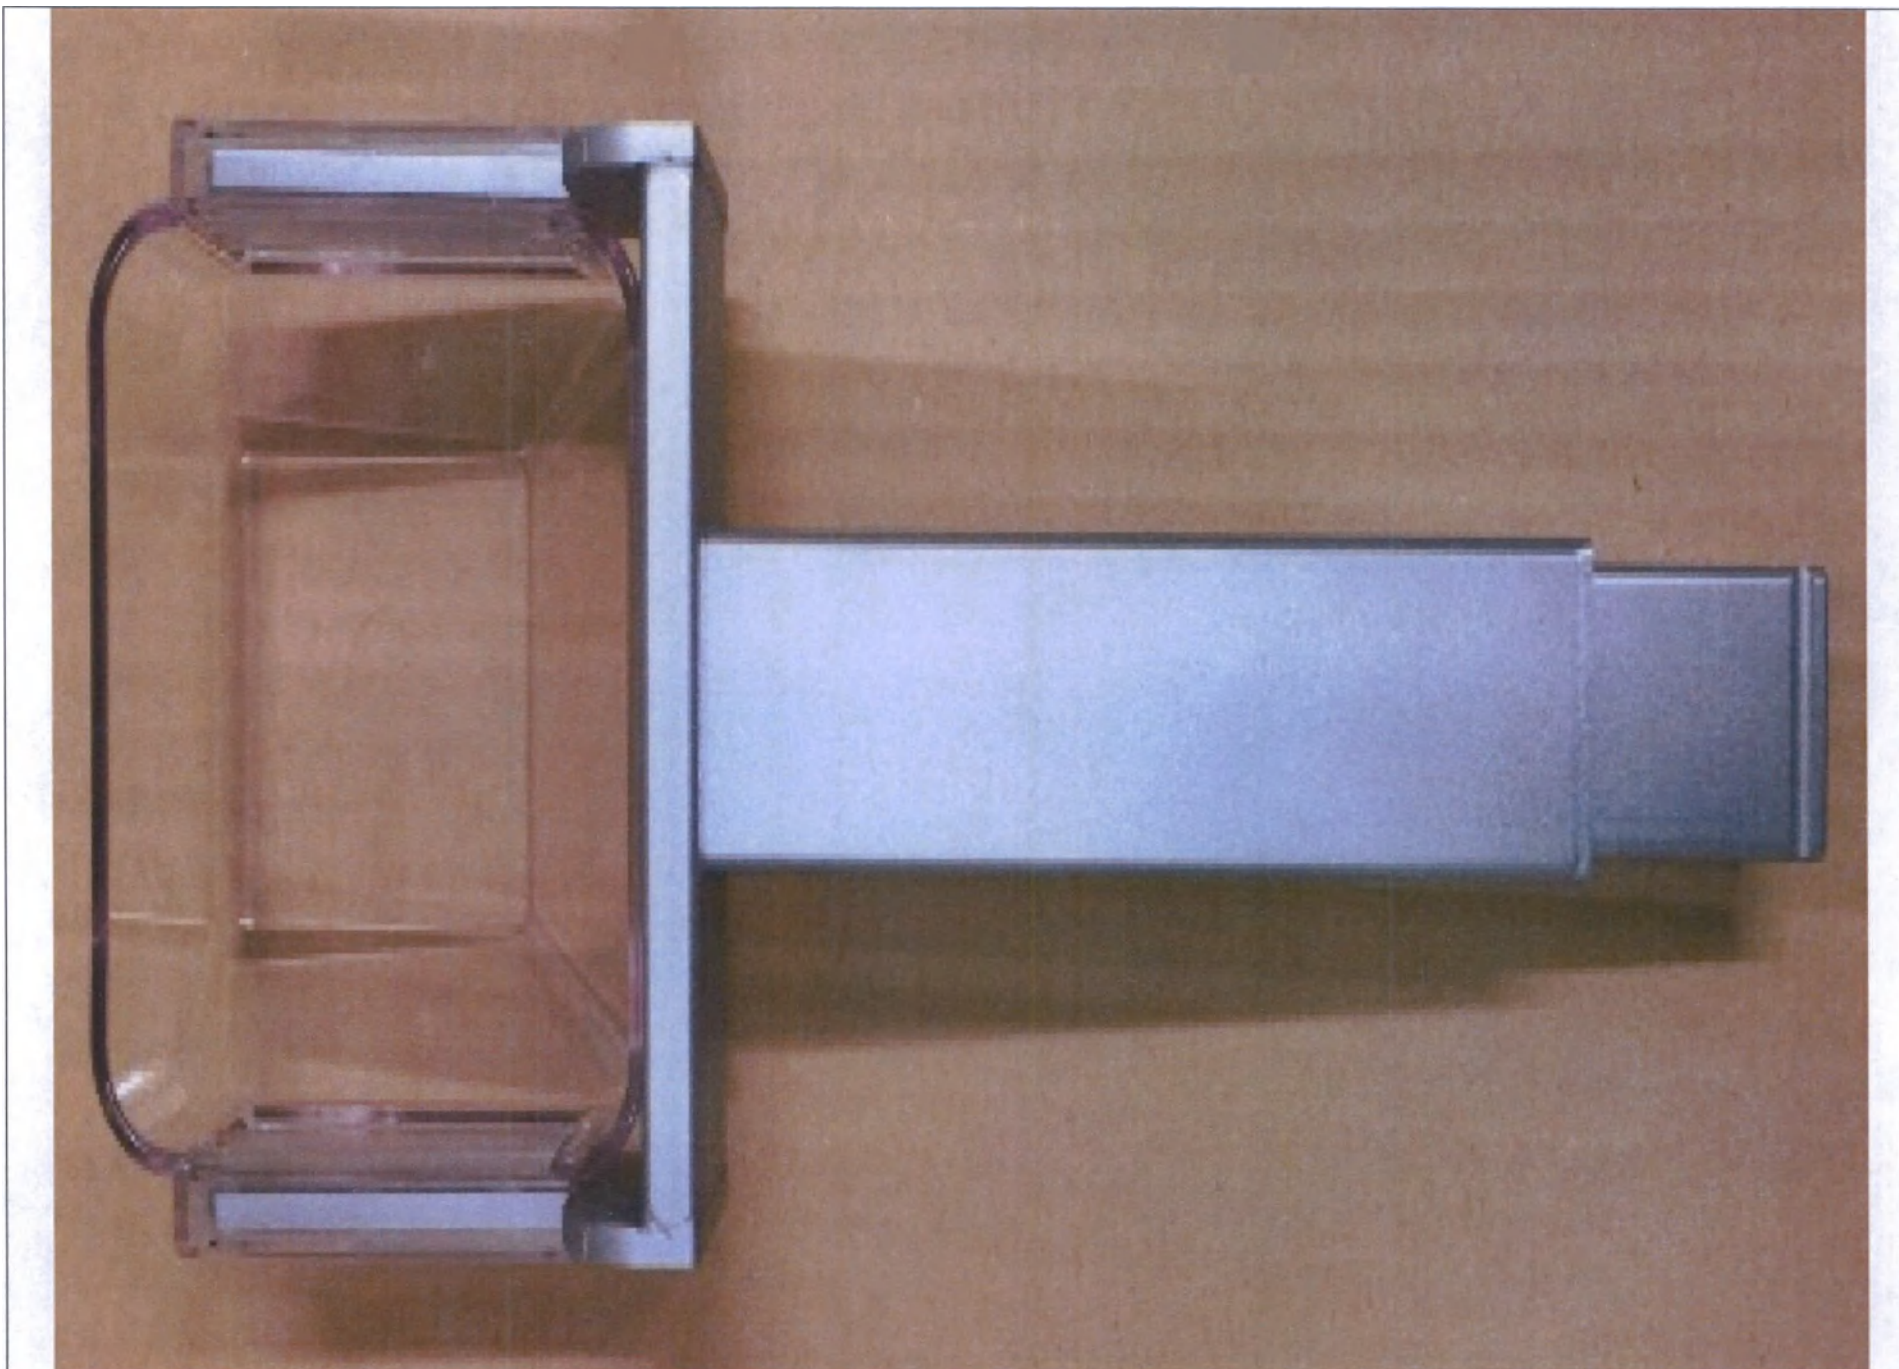

27. Пластина компрессионная для съемки с увеличением.

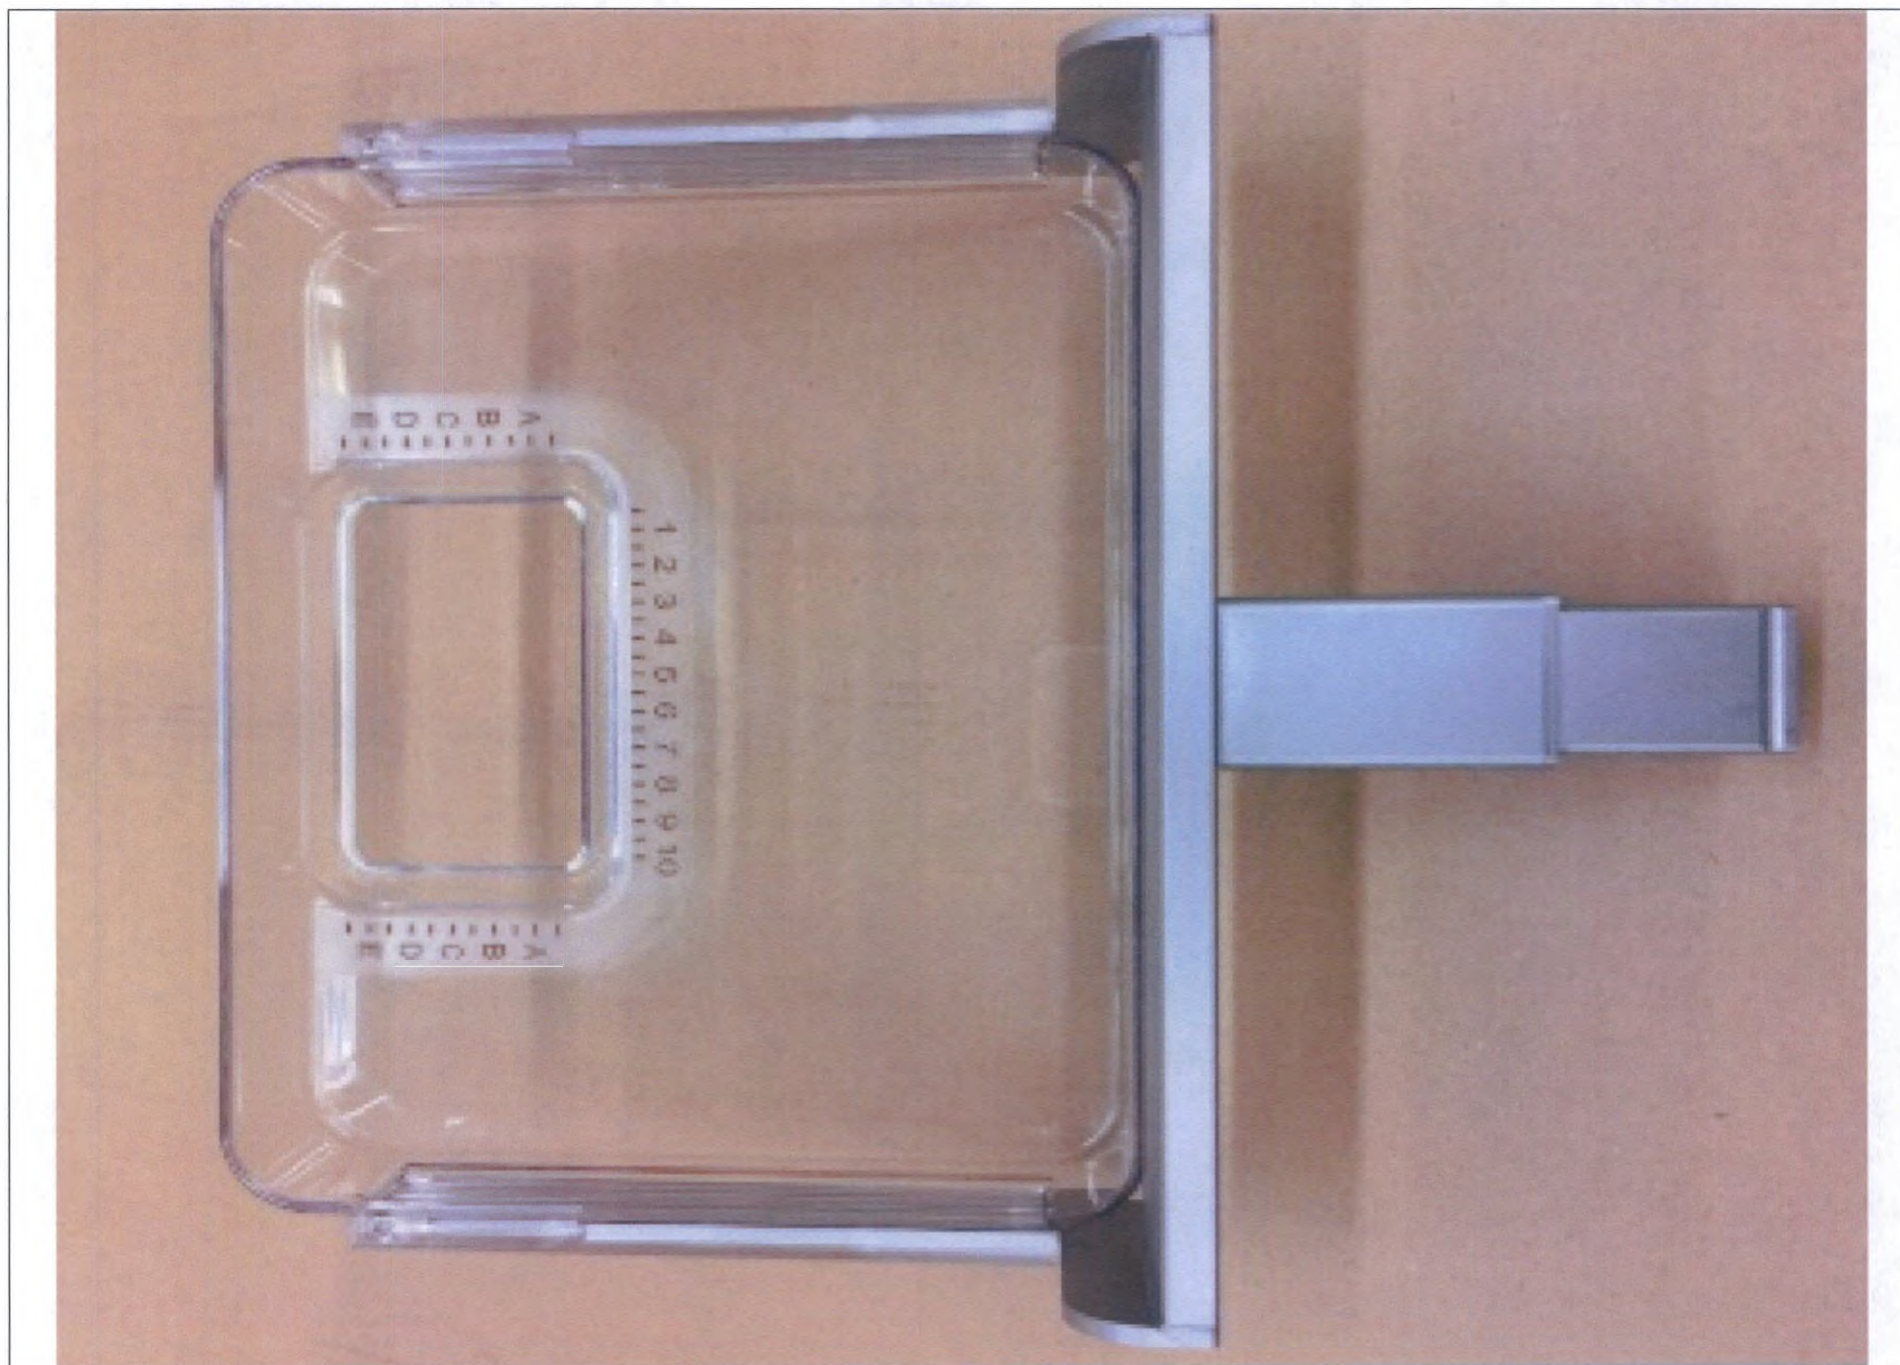


28. Вставка для компрессионной пластины для съемки с увеличением.

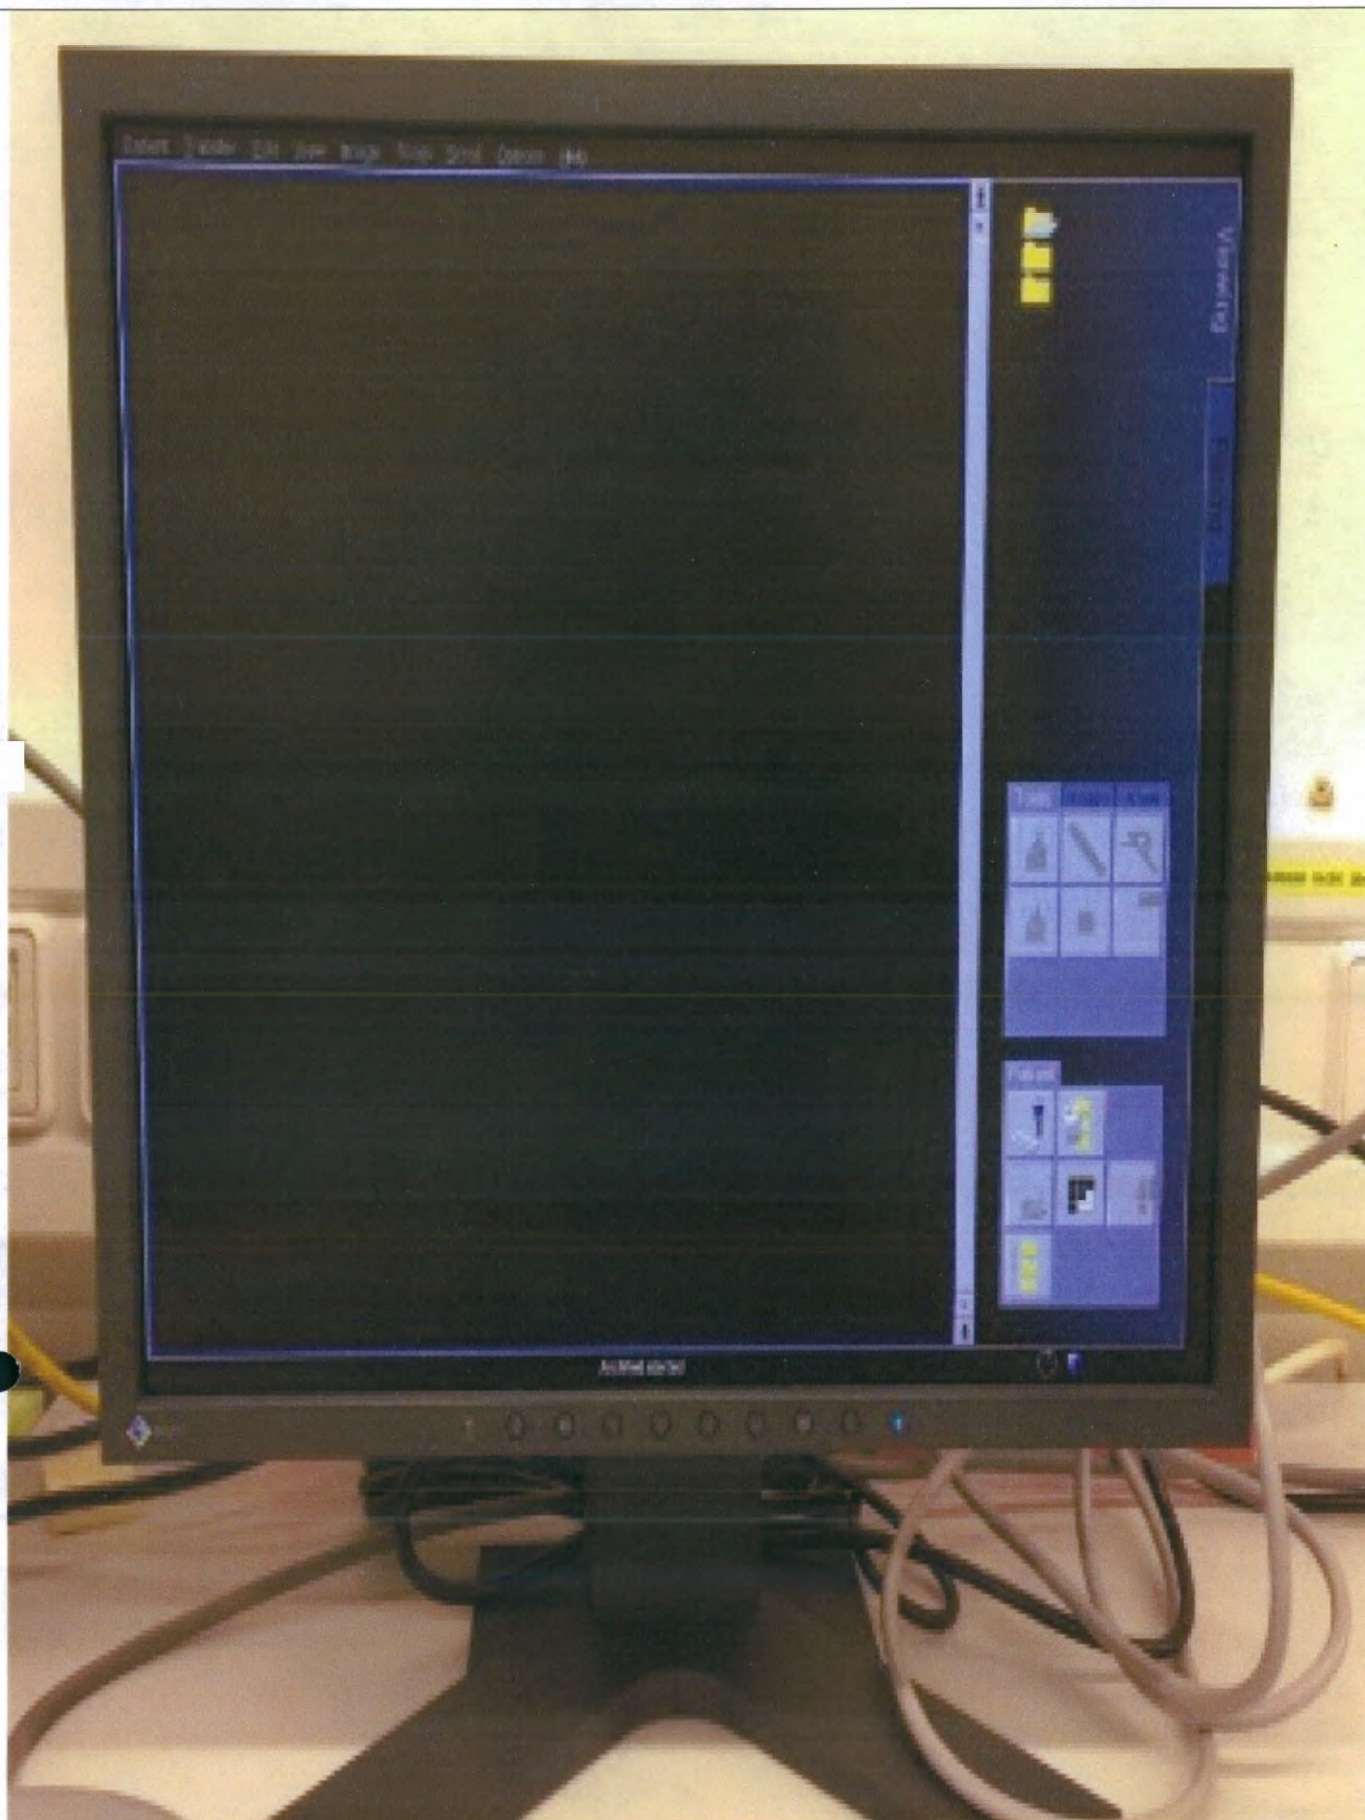

29. Монитор.




30. Монитор высокого разрешения.

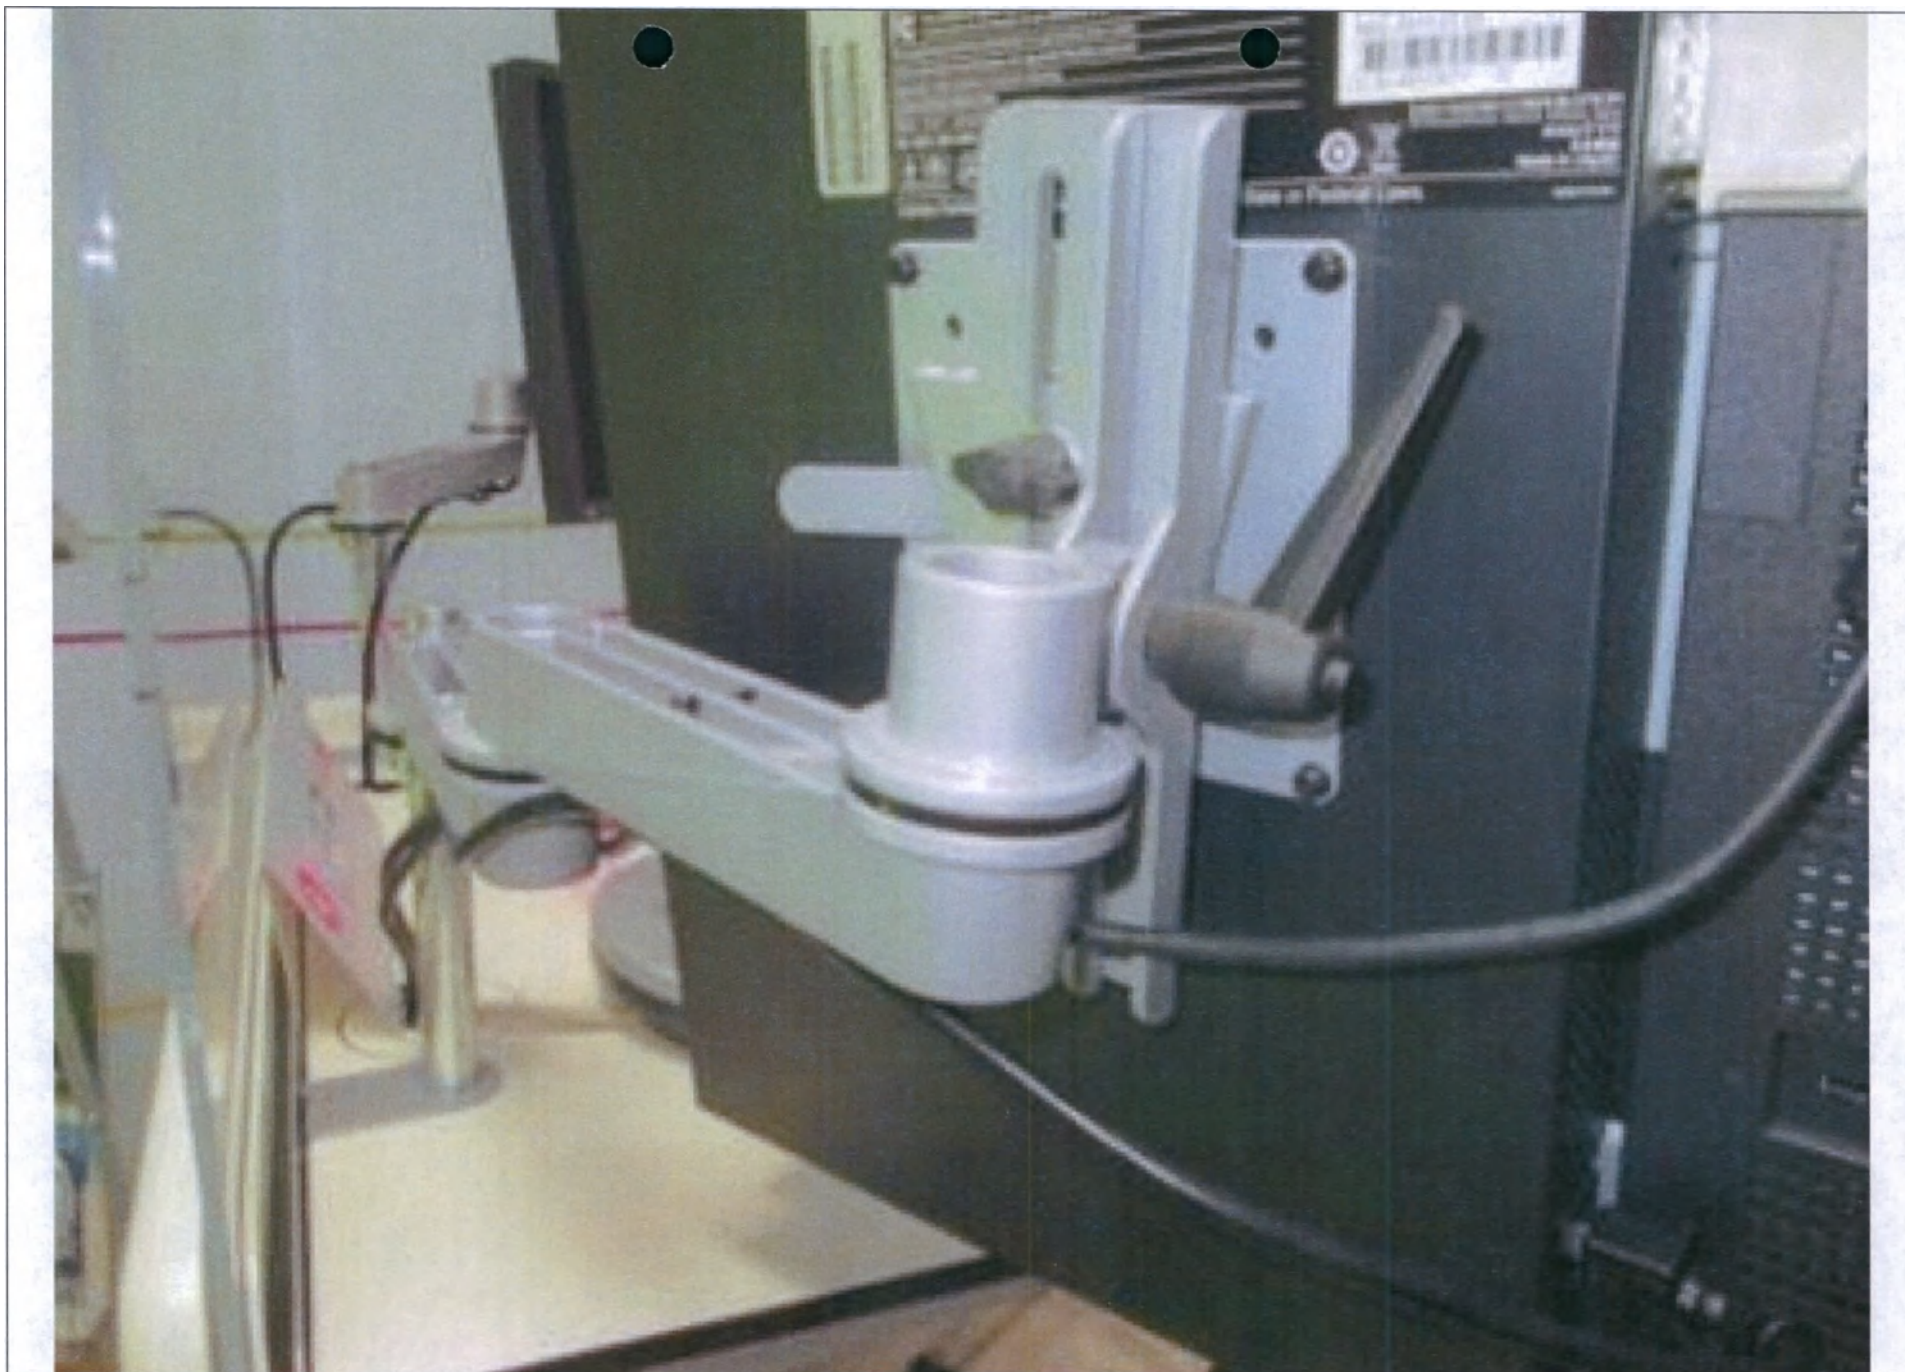


31. Держатель для монитора




32. Экран световой декоративный.

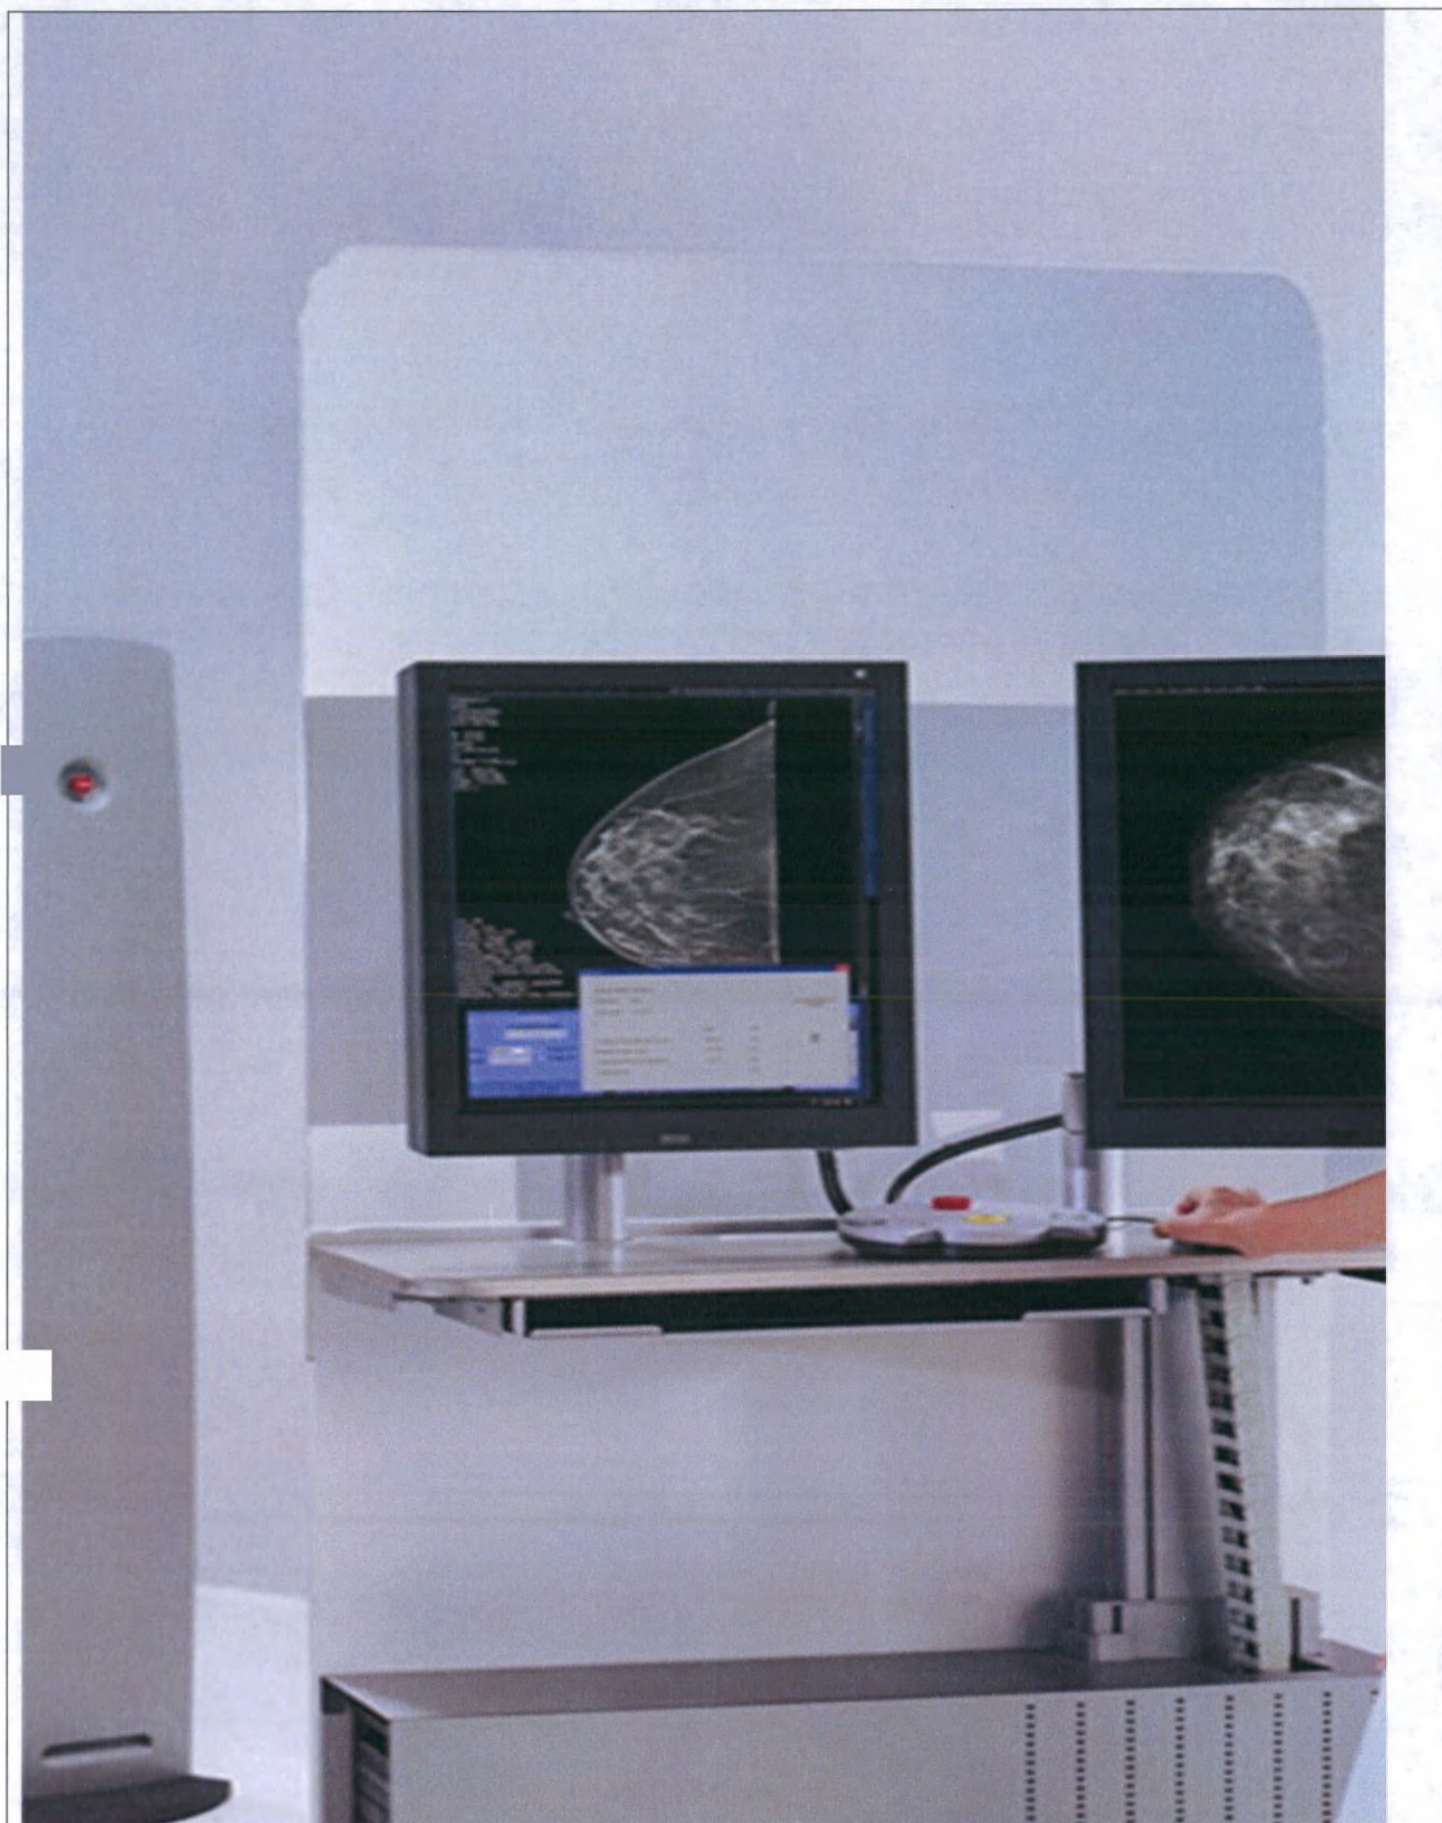

33. Экран защитный для консоли оператора увеличенной высоты (не более 5 шт.)

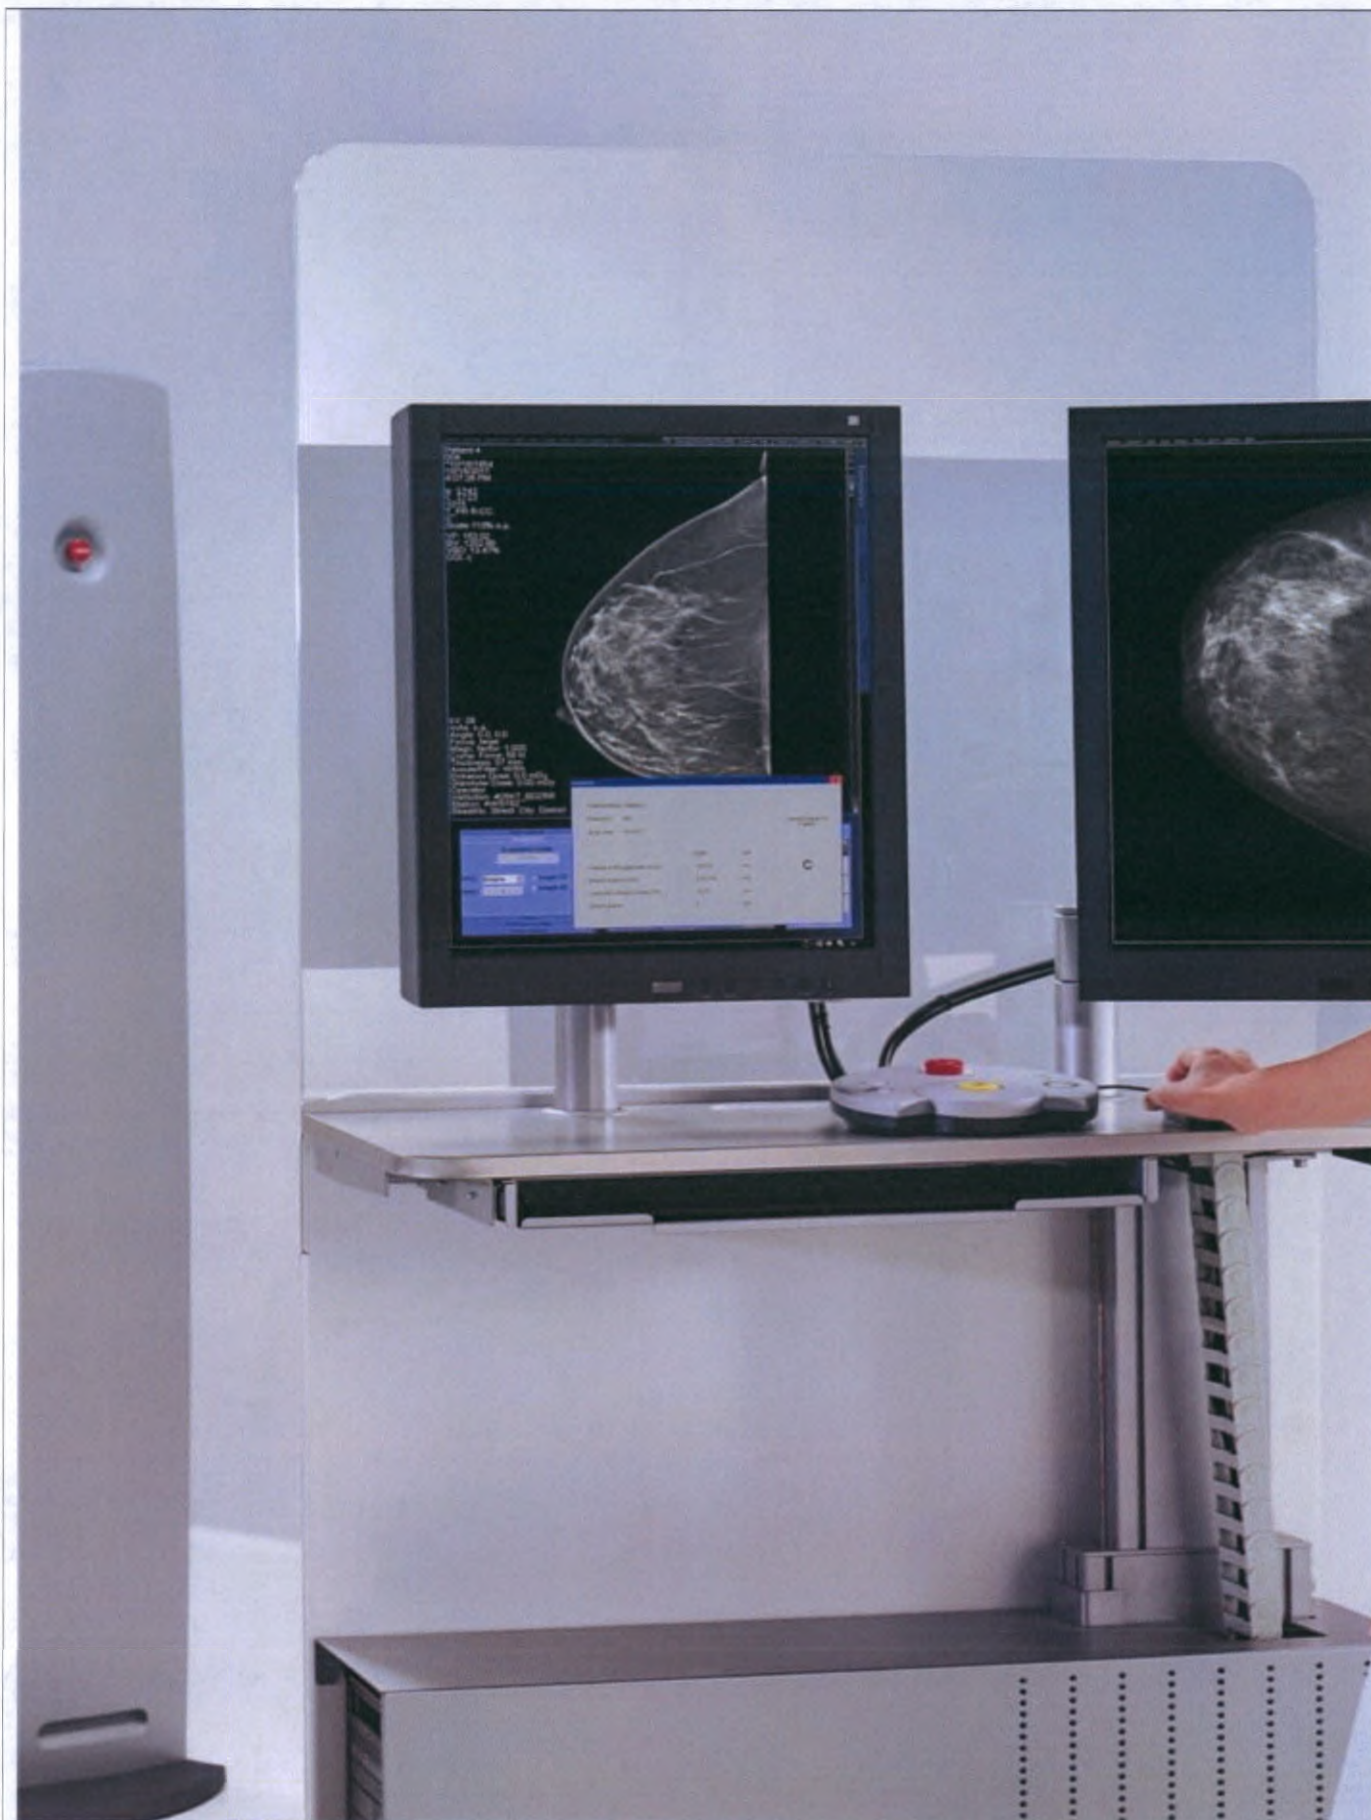


34. Экран защитный для консоли оператора для установки в транспорте

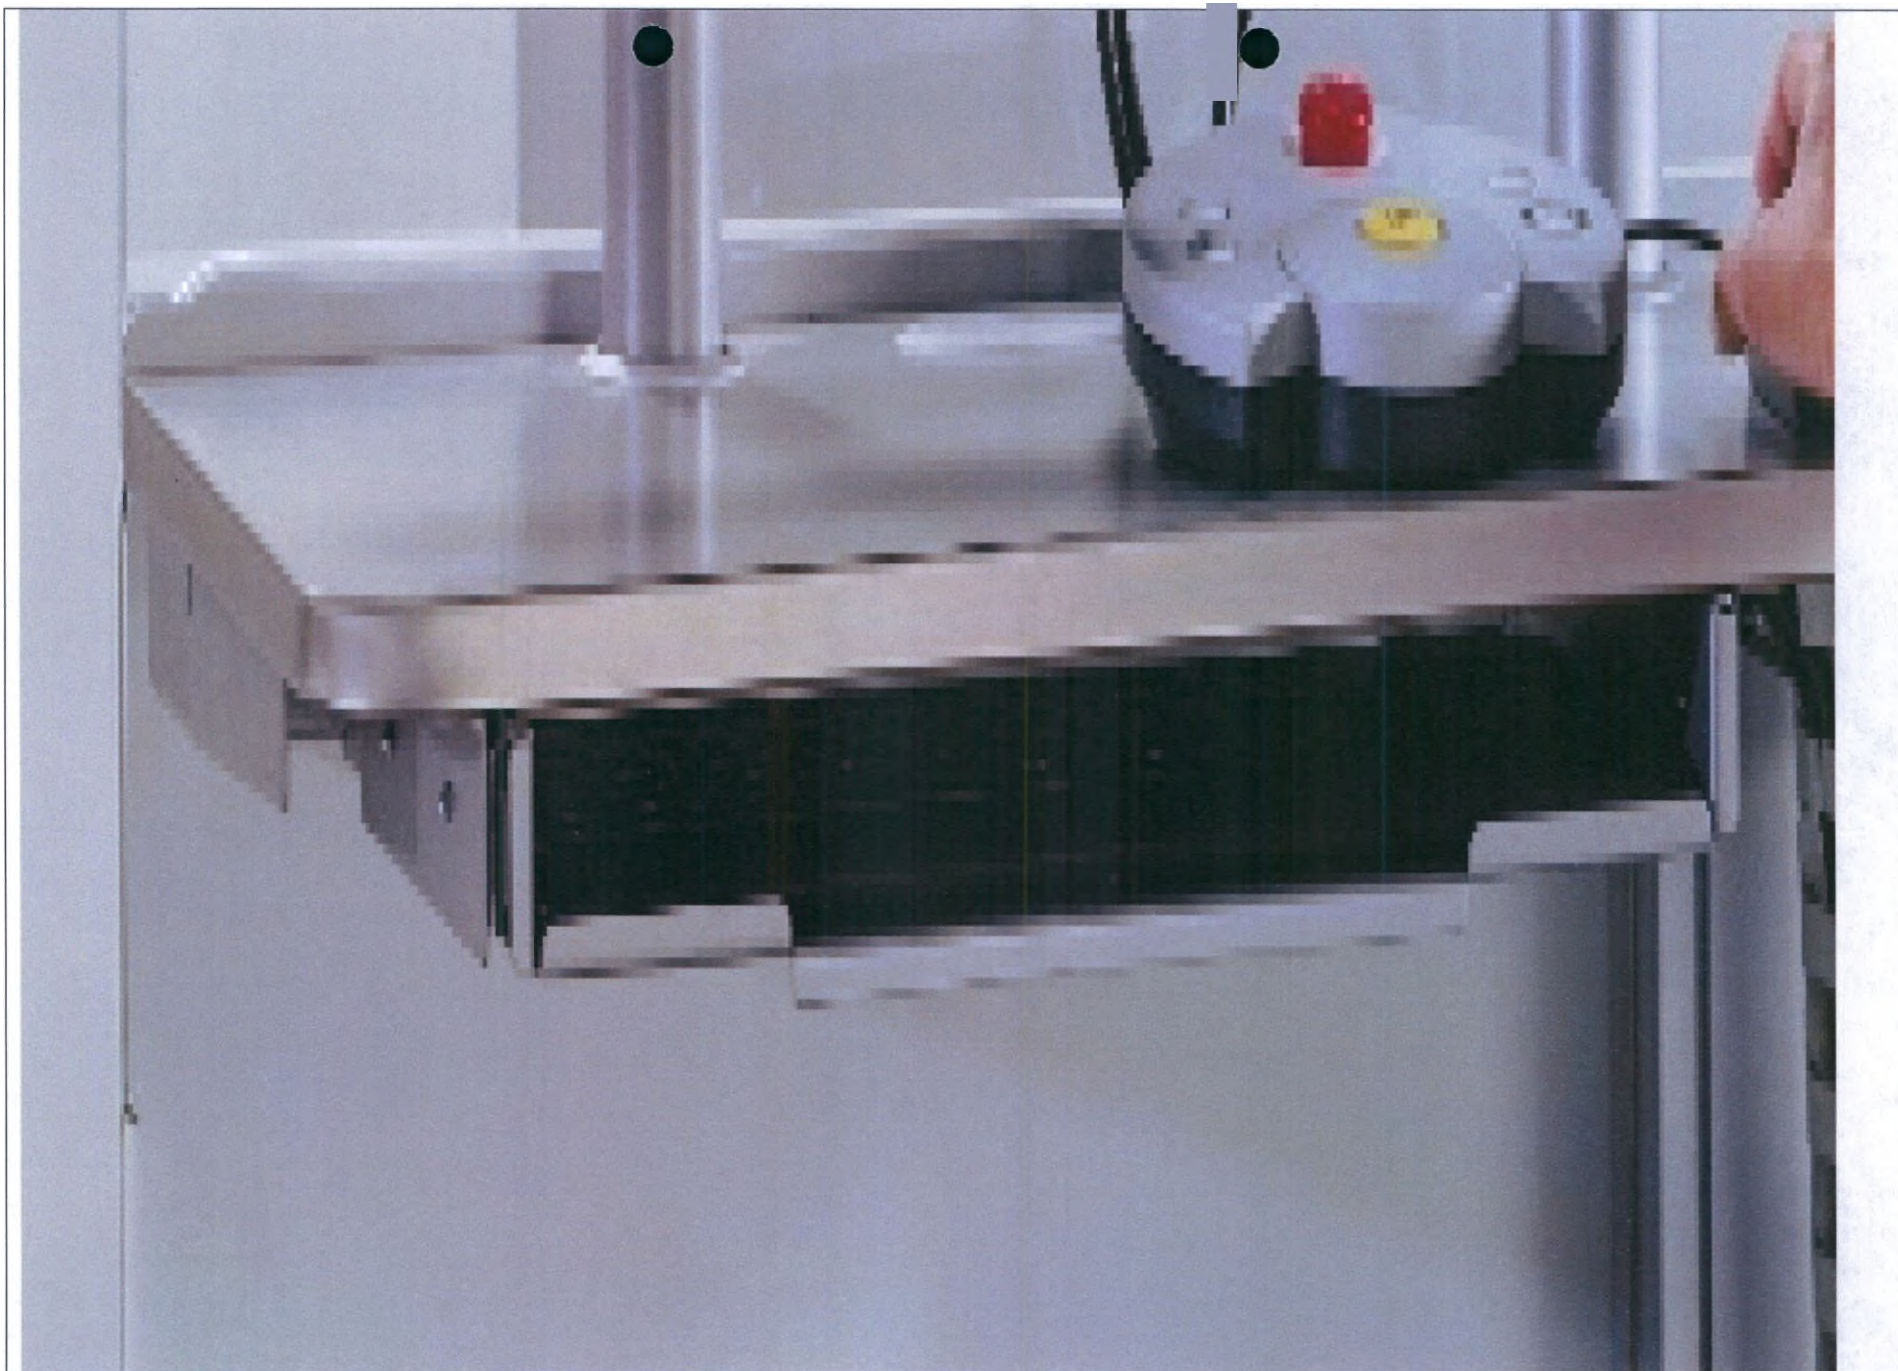

35. Лоток для клавиатуры для консоли оператора



36. Защитный экран для лица

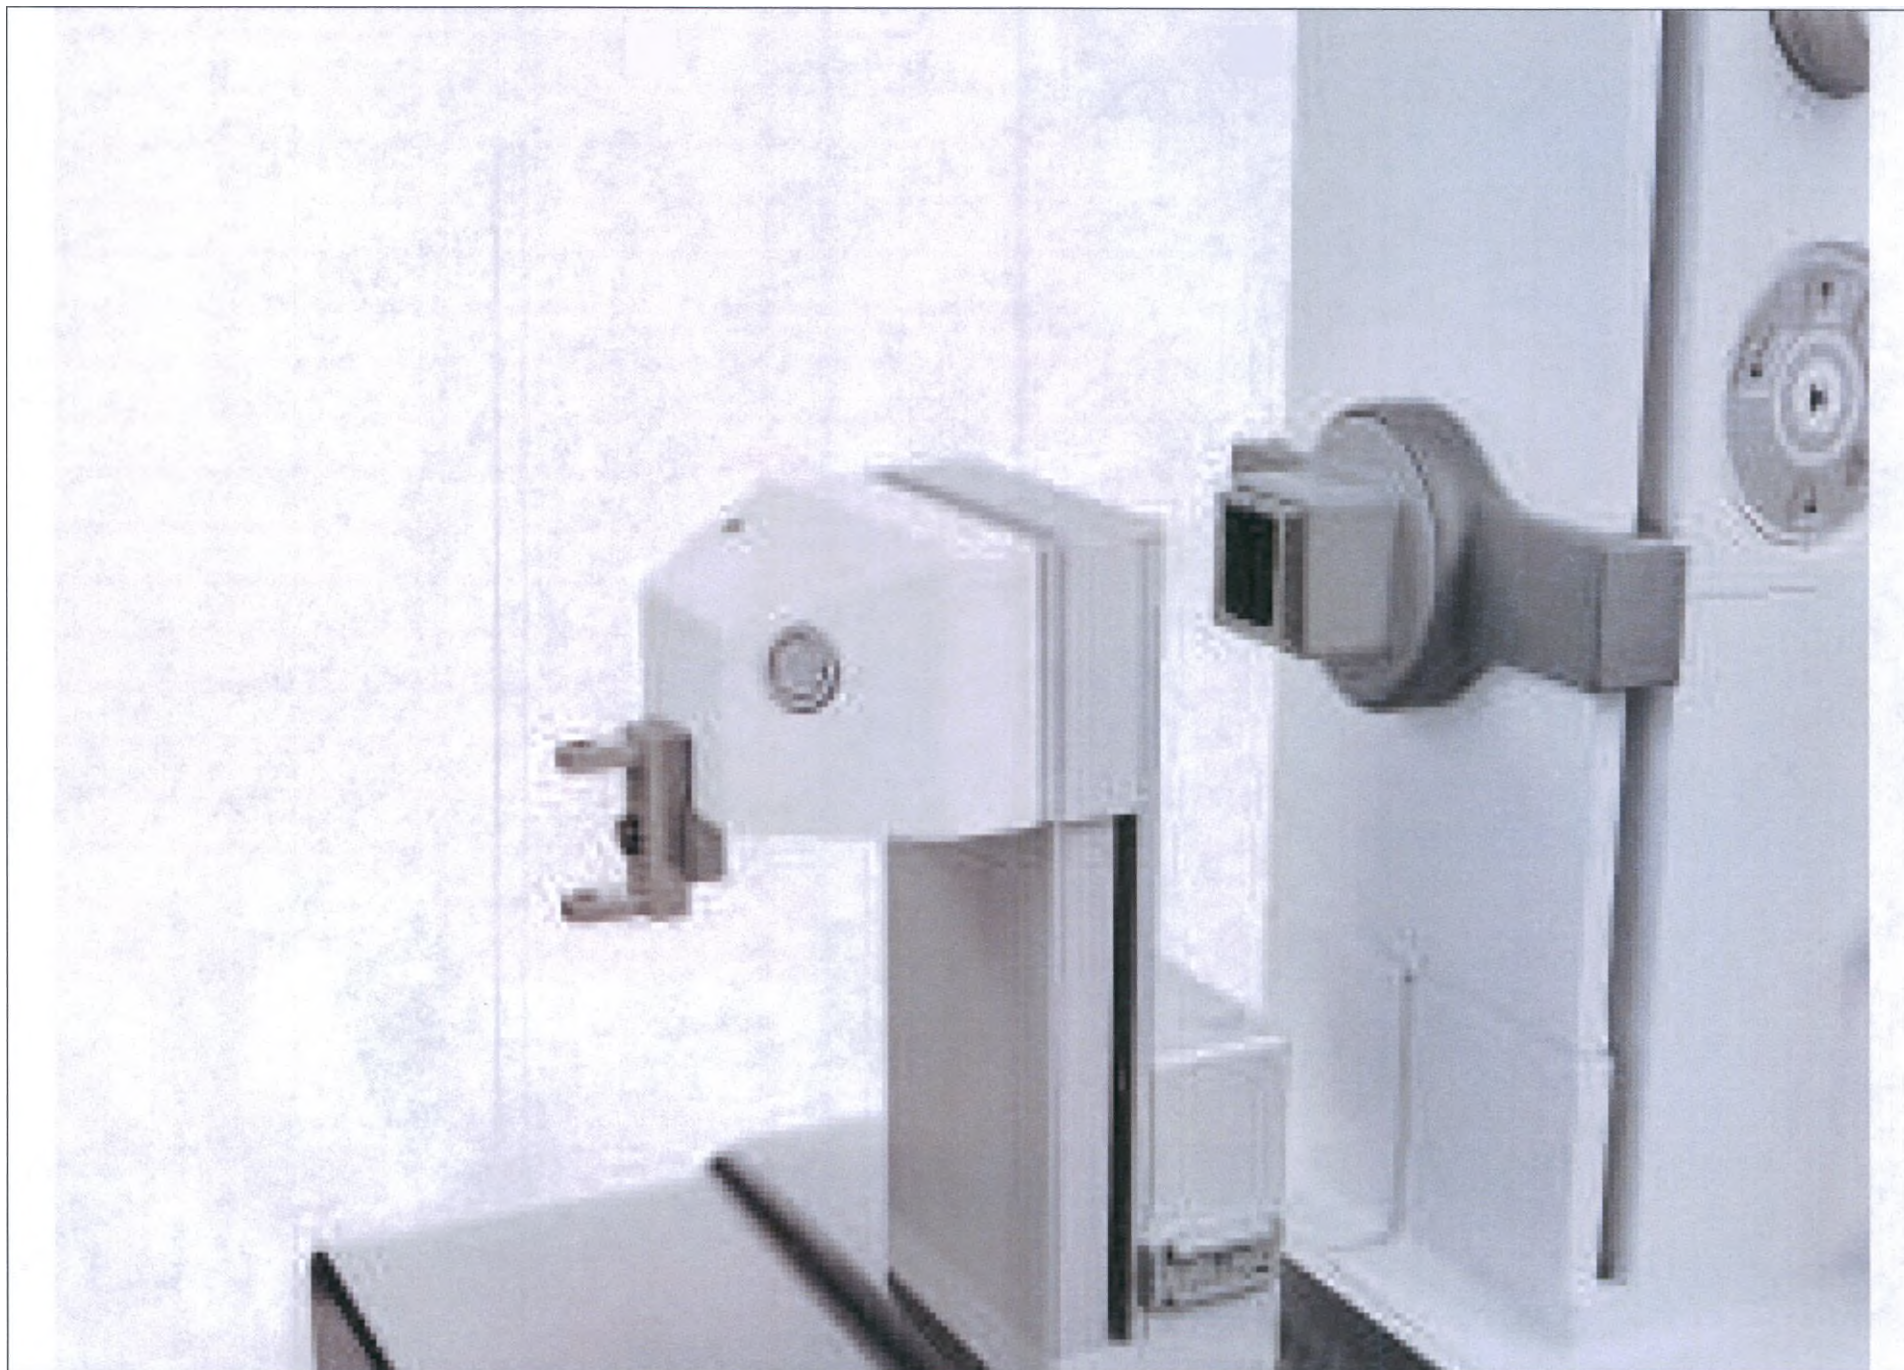


37. Держатель вертикальный стандартный



38. Держатели устройства для вакуумной биопсии



39. Держатель настенный для компрессионных пластин

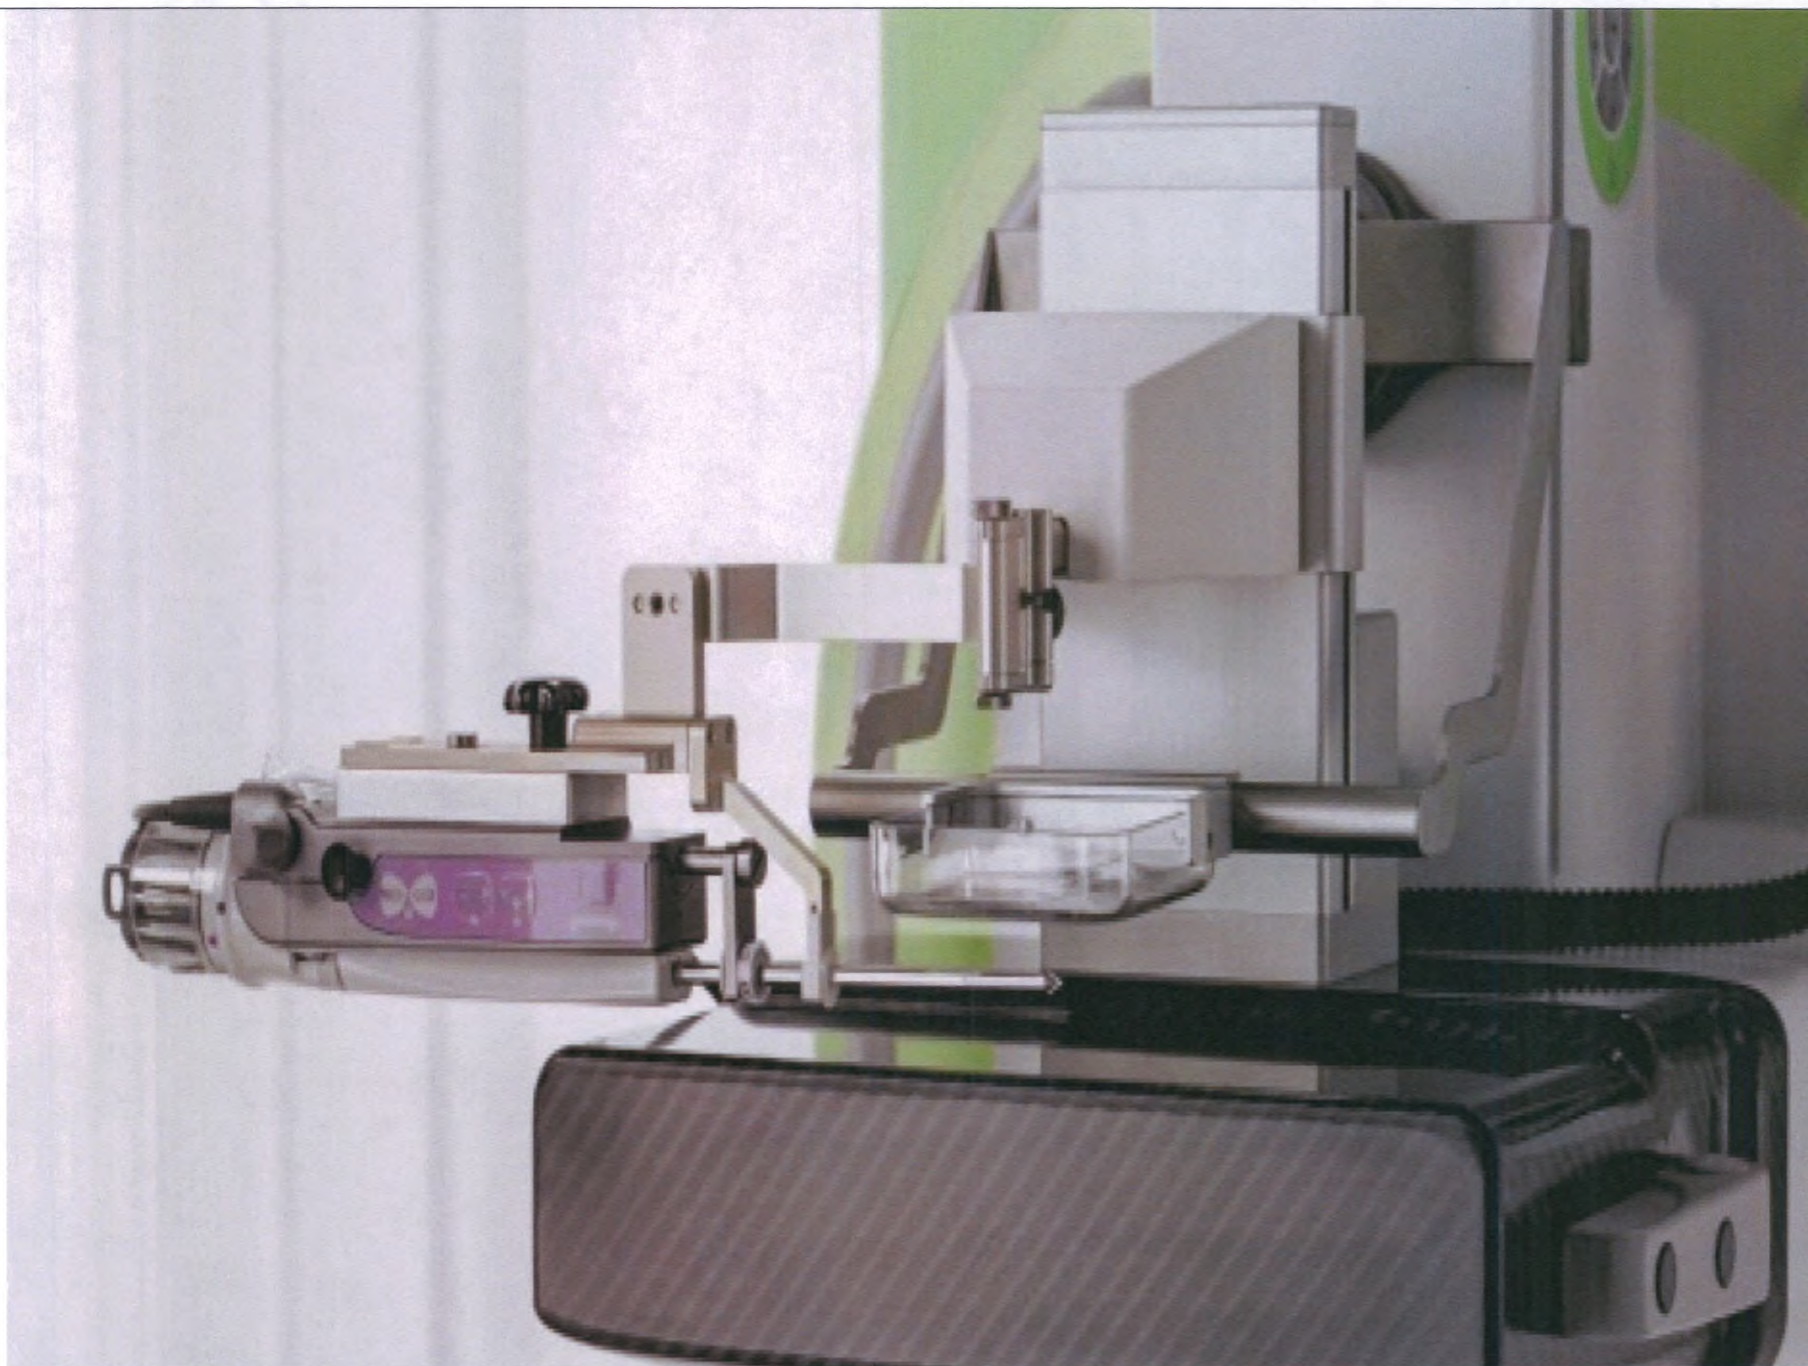

40. Держатель боковой стандартный




41. Сателлитные консоли управления, в составе: - системный блок; клавиатура; мышь; мониторы; программное обеспечение сателлитной консоли управления.

Material

10305305

SW_Key MG BREAST_ONE_CLICK

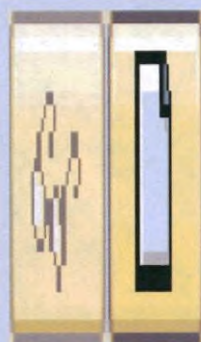

42. Дополнительные лицензионные ключи для спутниковой консоли управления: -Ключи лицензионные для корреляции изображения

Material

10305303

SW-Key MG_BREAST_CORRELATION




Дополнительные лицензионные ключи для сателлитной консоли управления: - Ключи лицензионные для просмотра CAD

Material

10305301

SW-Key MG_BREAST_TOMO

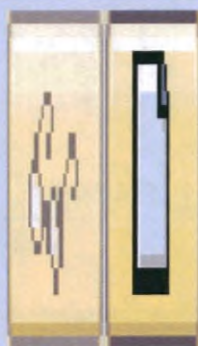

Дополнительные лицензионные ключи для спутниковой консоли управления: - Ключи лицензионные для просмотра данных томографии


Material

10305300


SW-Key MG BREAST_TASK MAIN




Дополнительные лицензионные ключи для спутниковой консоли управления: - Ключи лицензионные для чтения маммографических изображений.

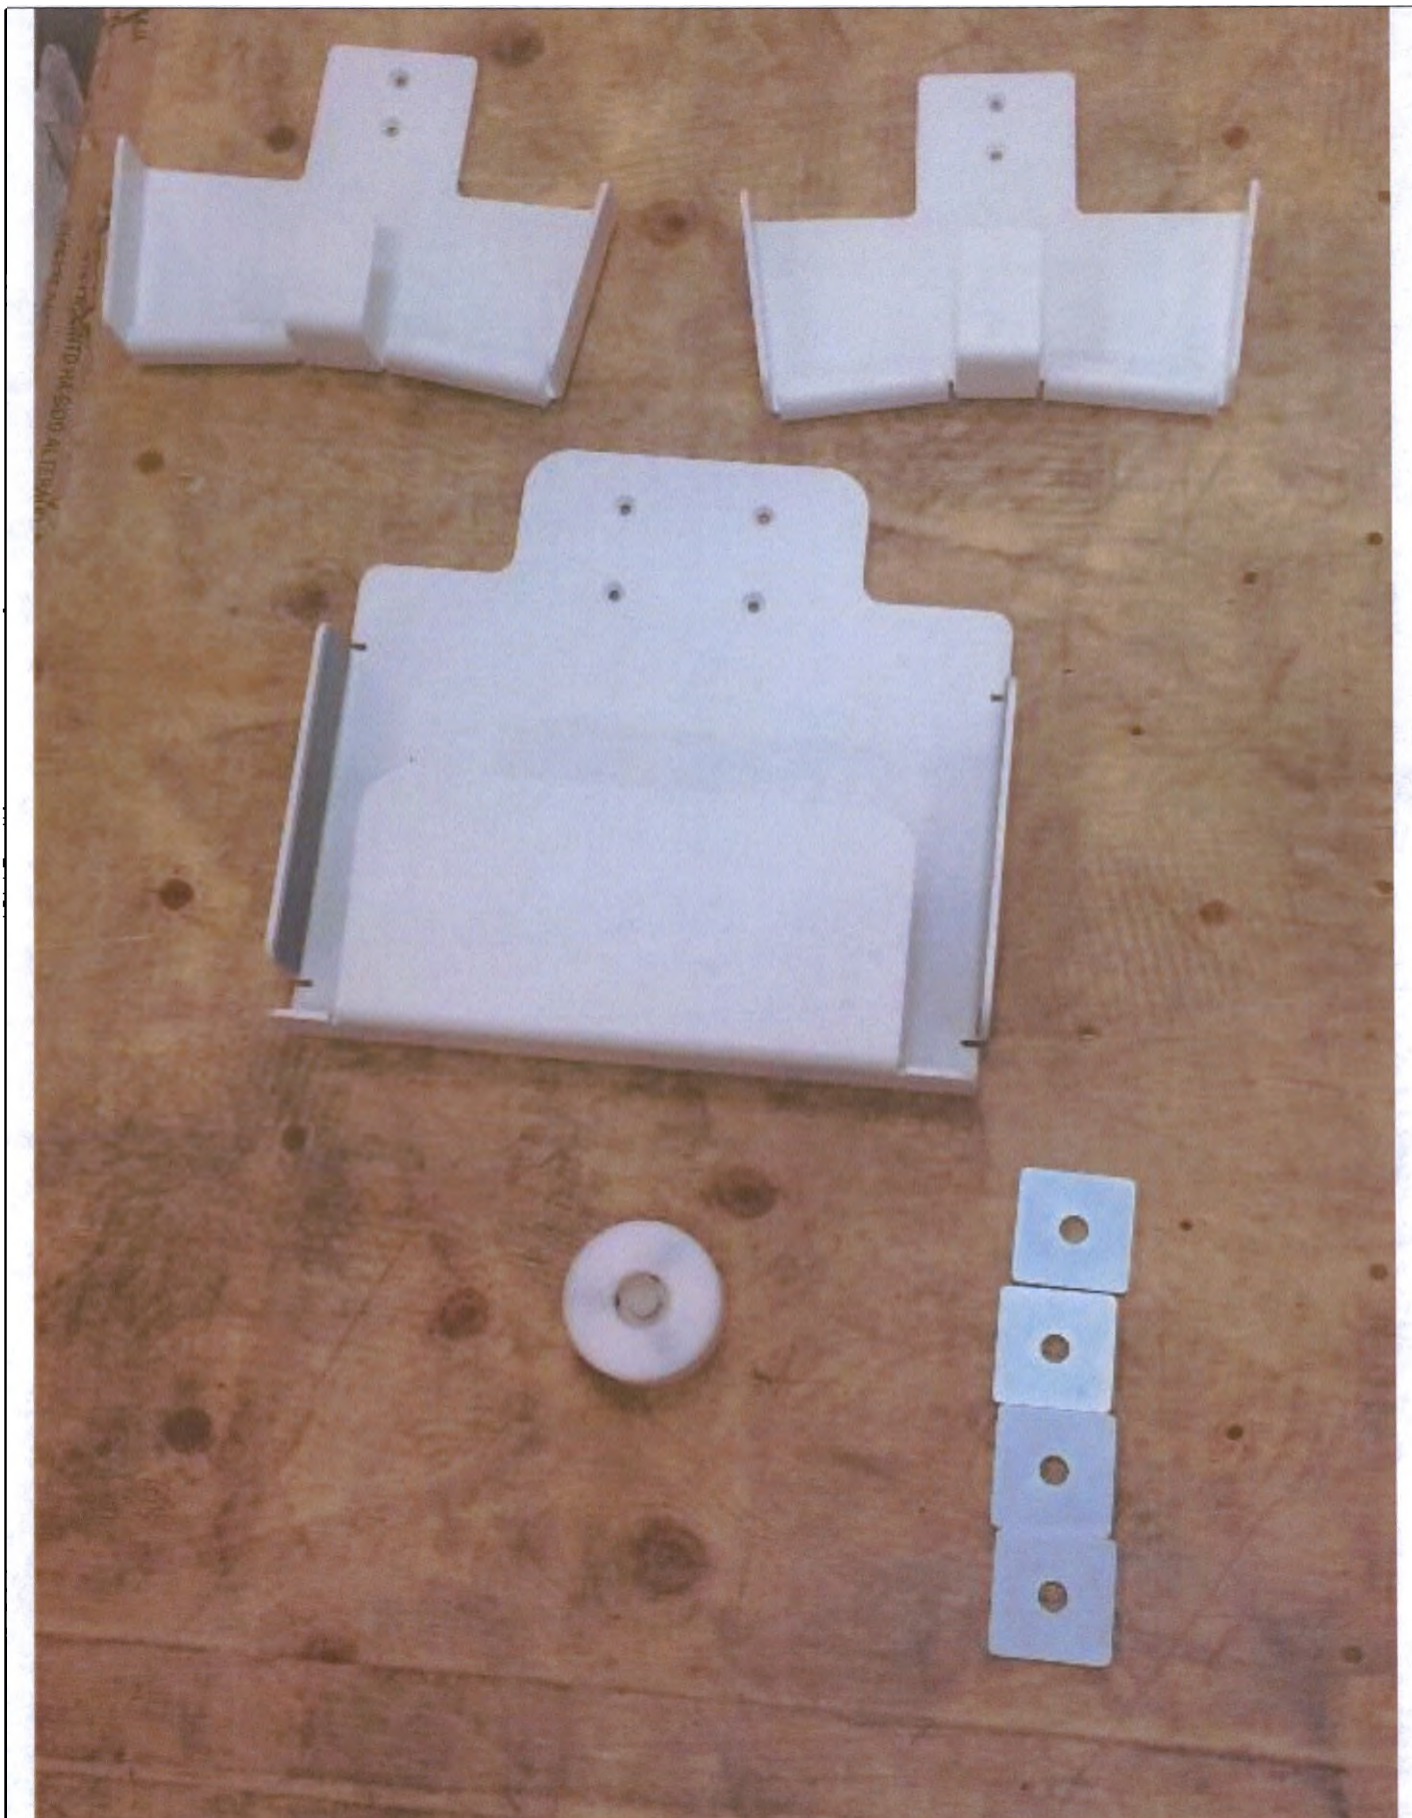

43. Устройства для установки маммографа в транспорте, в составе: держатель ножного переключателя; держатель консоли управления; нейлоновый цилиндр; принадлежности для установки; пенопластовая форма.

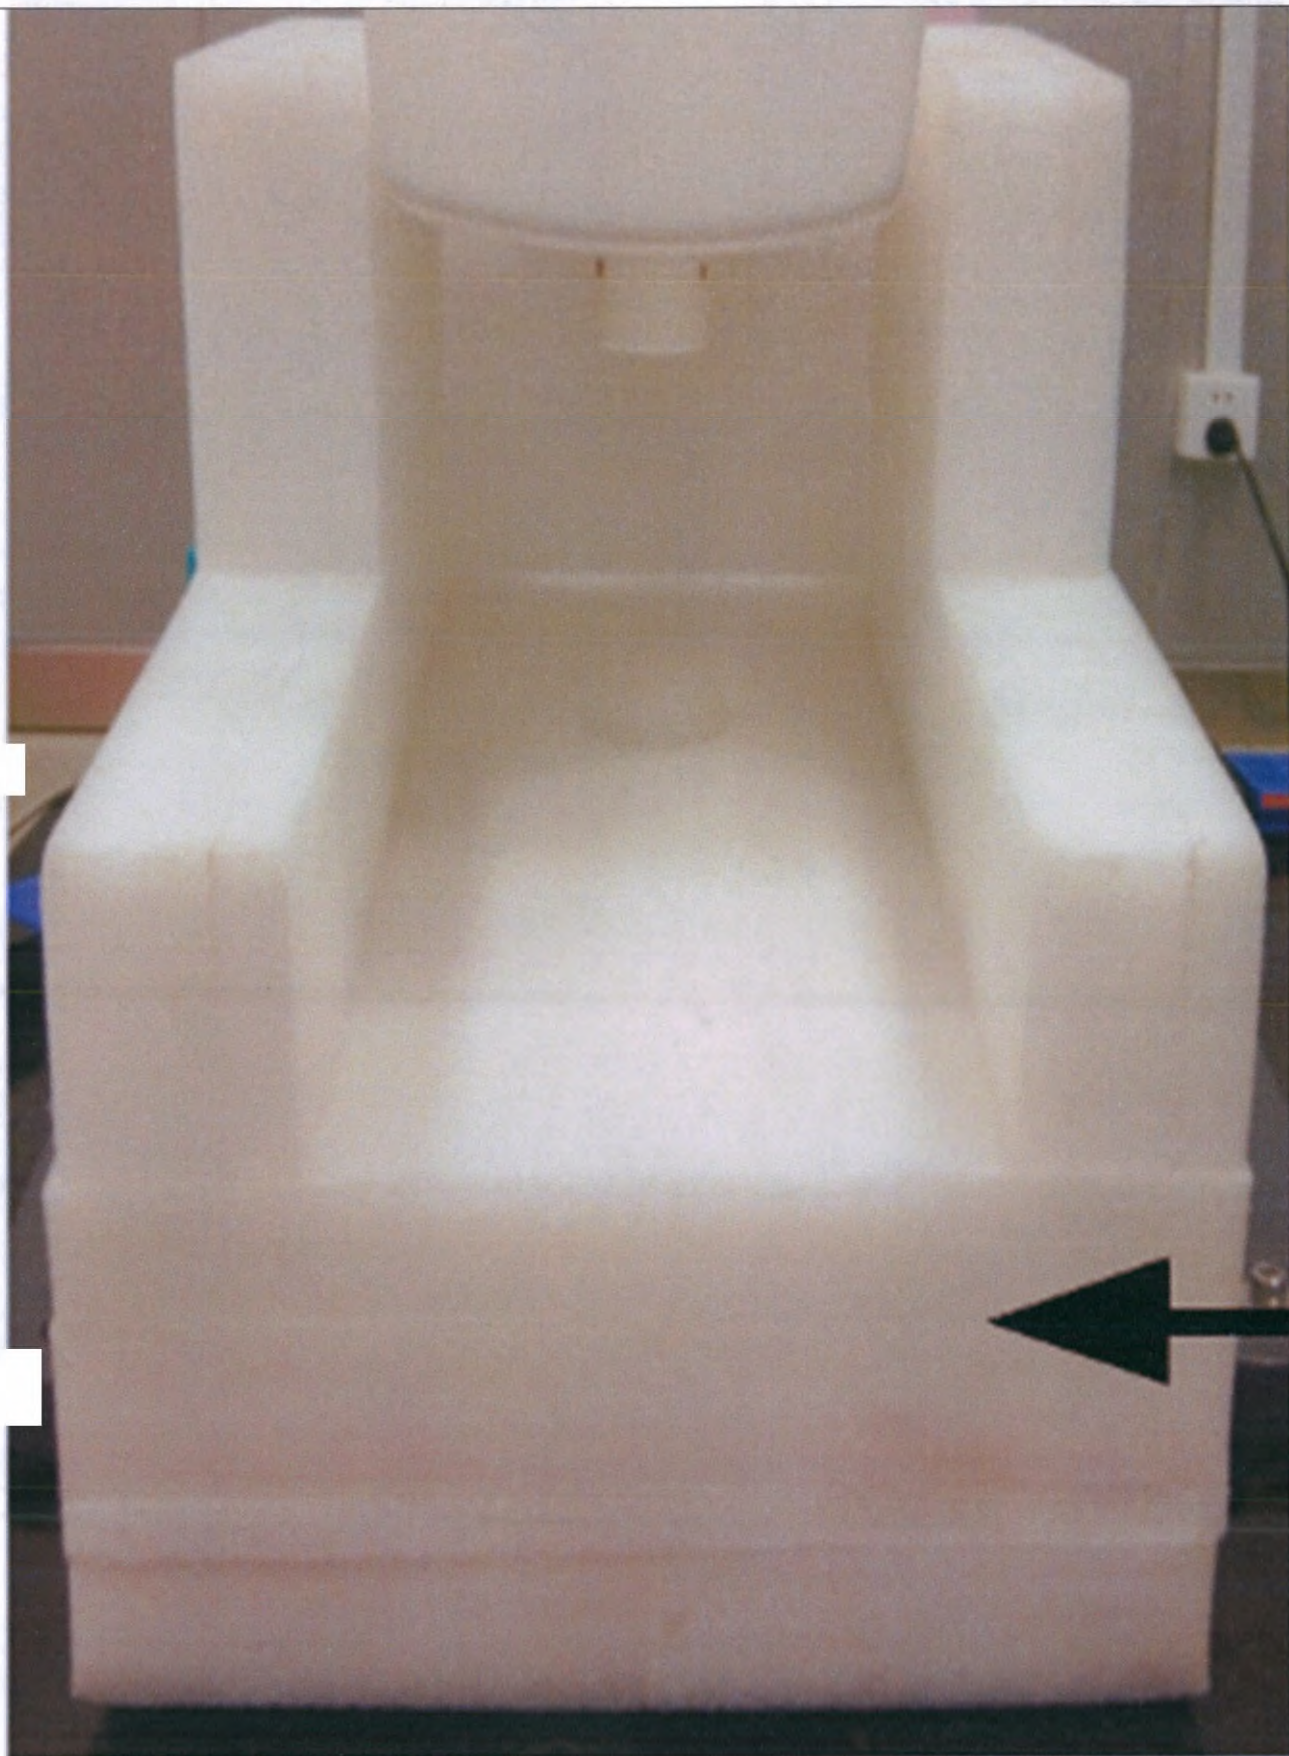

Устройства для установки маммографа в транспорте, в составе: держатель ножного переключателя; держатель консоли управления; нейлоновый цилиндр; принадлежности для установки; пенопластовая форма.

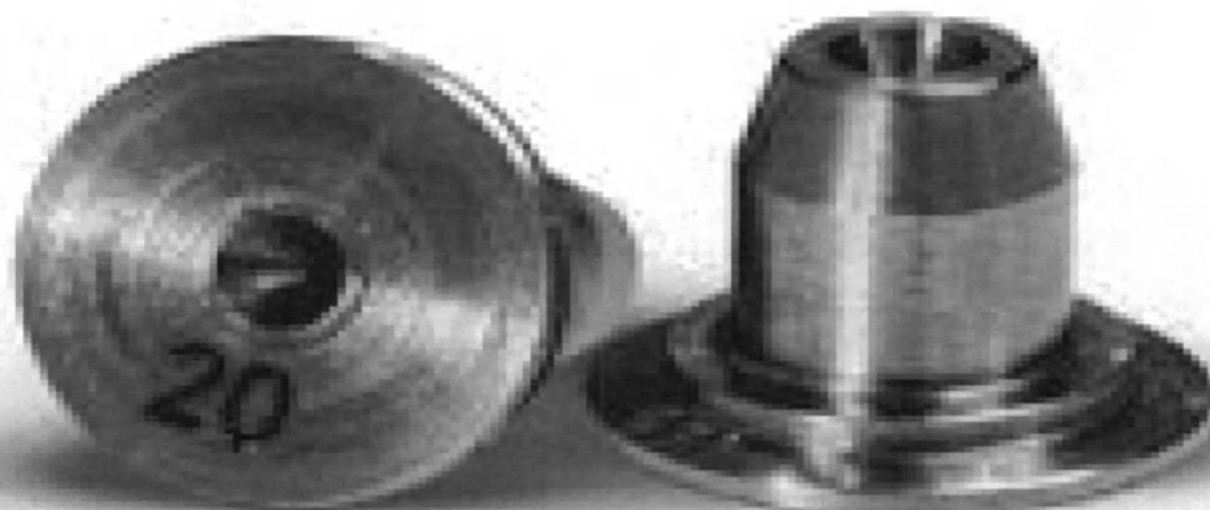

44. Втулки для биопсии многоразовые



45. Втулки для биопсии одноразовые

Всего прошито и пронумеровано
18 листа (ов).

ООО «Сиенс Здравоохранение»





Всего прошито и пронумеровано
_____ листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»