


Фотографическое изображение медицинского изделия

**Реагент VITROS Коронавирус SARS-CoV-2 IgG 2 в кассете
(VITROS Anti-SARS-CoV-2 IgG 2 Reagent Pack) для качественного и
полуколичественного иммунодиагностического определения
иммуноглобулинов класса G к коронавирусу SARS-CoV-2 методом
усиленной хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS, лот 0230**

Реагент VITROS Коронавирус SARS-CoV-2 IgG 2 в кассете, лот 0230

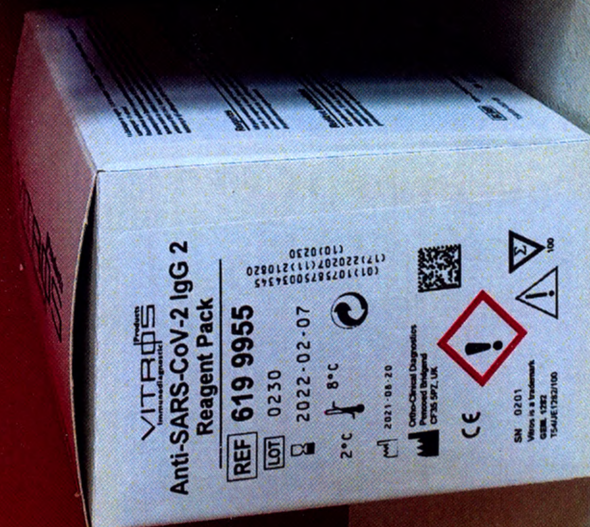

619 9955

Реагент VITROS Коронавирус SARS-CoV-2 IgG 2
в кассете (VITROS Anti-SARS-CoV-2 IgG 2
Reagent Pack) для качественного и
полуколичественного иммунодиагностического
определения иммуноглобулинов класса G к
коронавирусу SARS-CoV-2 методом усиленной
хемилюминесценции на анализаторах серии
VITROS, лот 0230


Назначение: для качественного и
полуколичественного иммунодиагностического
определения иммуноглобулинов класса G к
рецептор-связывающему домену (RBD) S1
субъединицы шиповидного белка коронавируса
SARS-CoV-2 в человеческой сыворотке методом
усиленной хемилюминесценции на анализаторах
серии VITROS (VITROS ECi/ECiQ, VITROS 3600,
VITROS 5600, VITROS XT 7600) в качестве
вспомогательного средства диагностики
коронавируса SARS-CoV-2

Регистрационное удостоверение в РФ:

Уполномоченная организация на территории
РФ: ООО «Орто-Клиникал Диагностикс», Россия,
143026, Московская область, г.о. Одинцовский,
дер. Сколково, ул. Новая, дом. 100, стр. 9

Версия_

Реагент VITROS Коронавирус SARS-CoV-2 IgG 2 в кассете, лот 0230. Кассета с реагентом

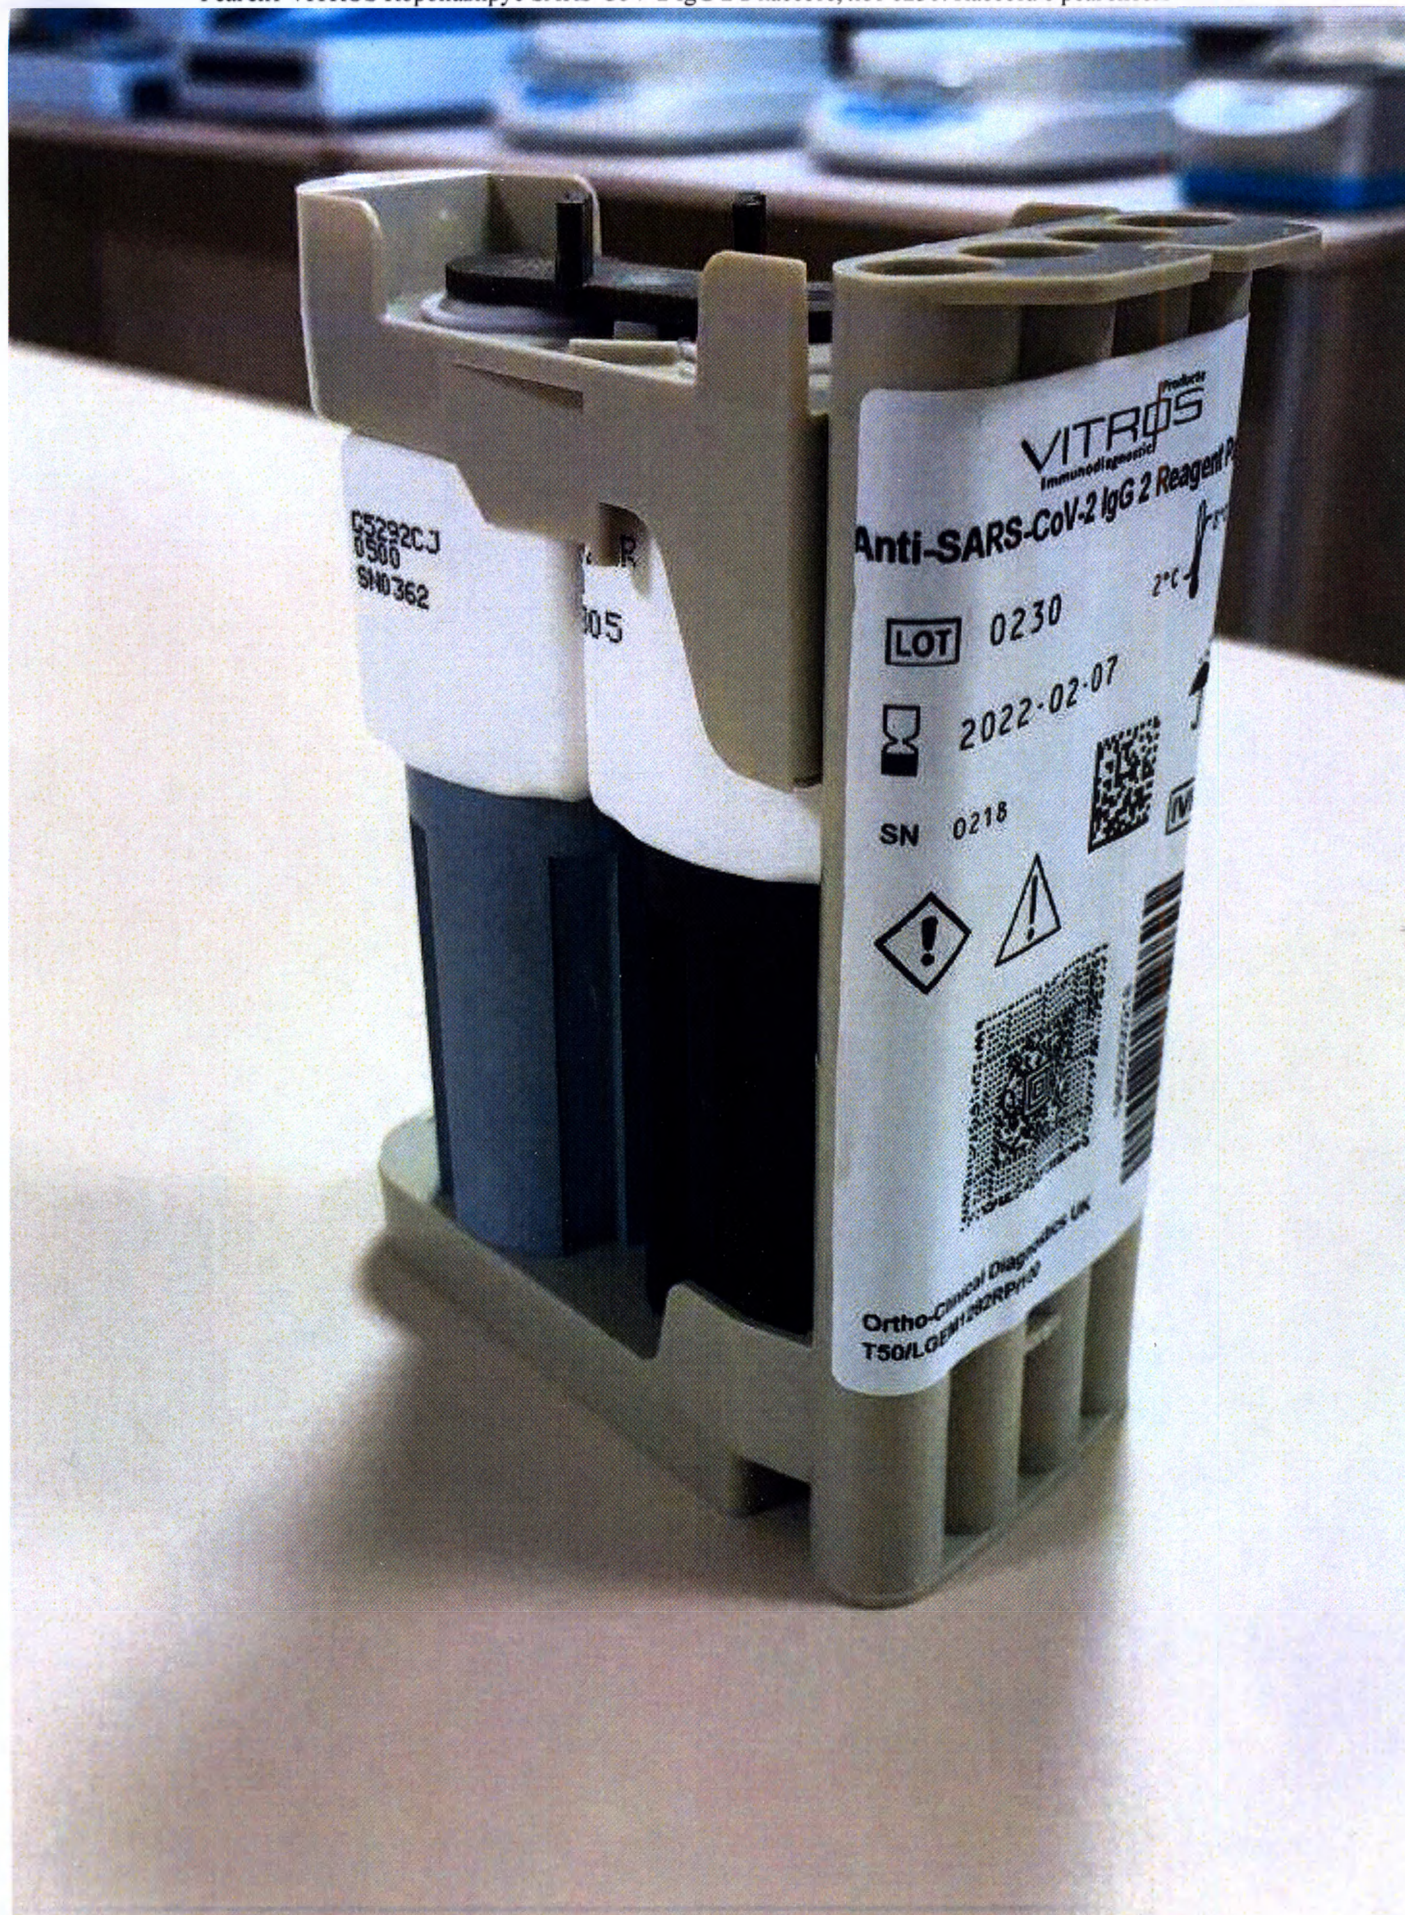

КОПИЯ ВЕРНА

ВСЕГО 4 листов

« 11 » 12 2021 г.

Генеральный Директор

ООО «Орто-Клиникал Диагностика»

Сергеенко В.К.

