

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Медквадрат»



Сулумов З.Р.

2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Интрамедуллярная система остеосинтеза в вариантах исполнения

Производитель:

CANWELL MEDICAL COMPANY LIMITED
(КАНВЭЛЛ МЕДИКАЛ КОМПАНИ ЛИМИТЕД), Китай
No.466 South Xianhua Street, High-Tech Industrial Zone,
Jinhua, Zhejiang Province, 321016, China
+86 0579-89119170

Место производства:

CANWELL MEDICAL COMPANY LIMITED
(КАНВЭЛЛ МЕДИКАЛ КОМПАНИ ЛИМИТЕД), Китай
No.466 South Xianhua Street, High-Tech Industrial Zone,
Jinhua, Zhejiang Province, 321016, China
+86 0579-89119170




Рисунок 1. Стержень проксимальный для остеосинтеза бедренной кости, стандартный (Примечание: все изделия внешне идентичны и различаются только типоразмерами)











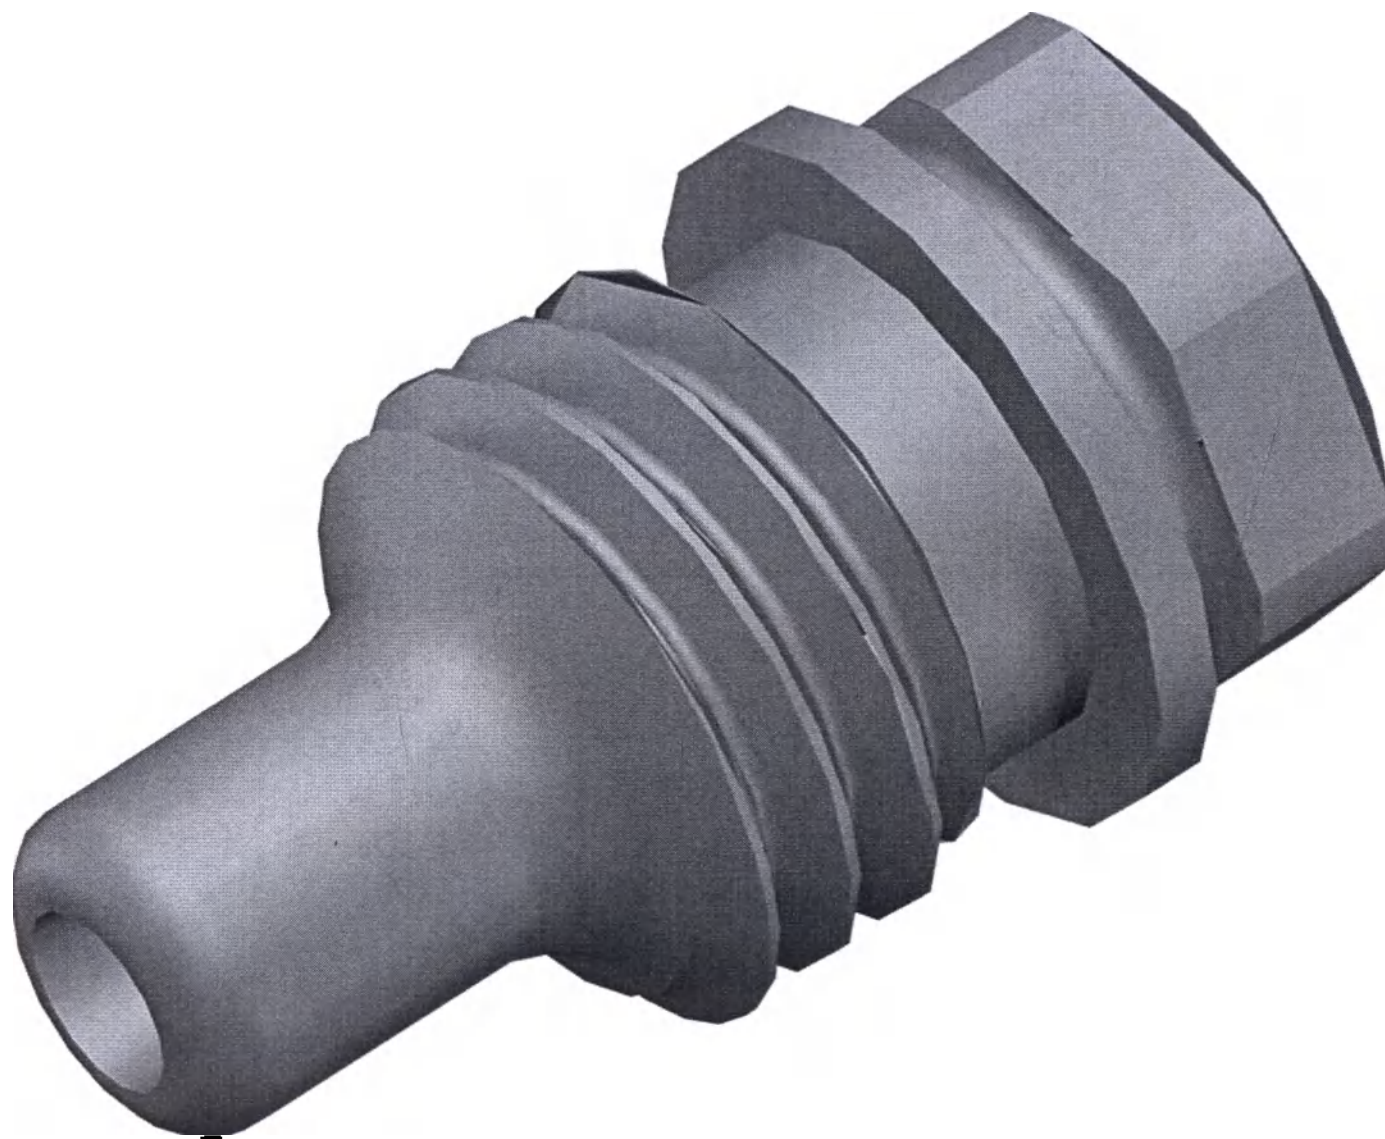






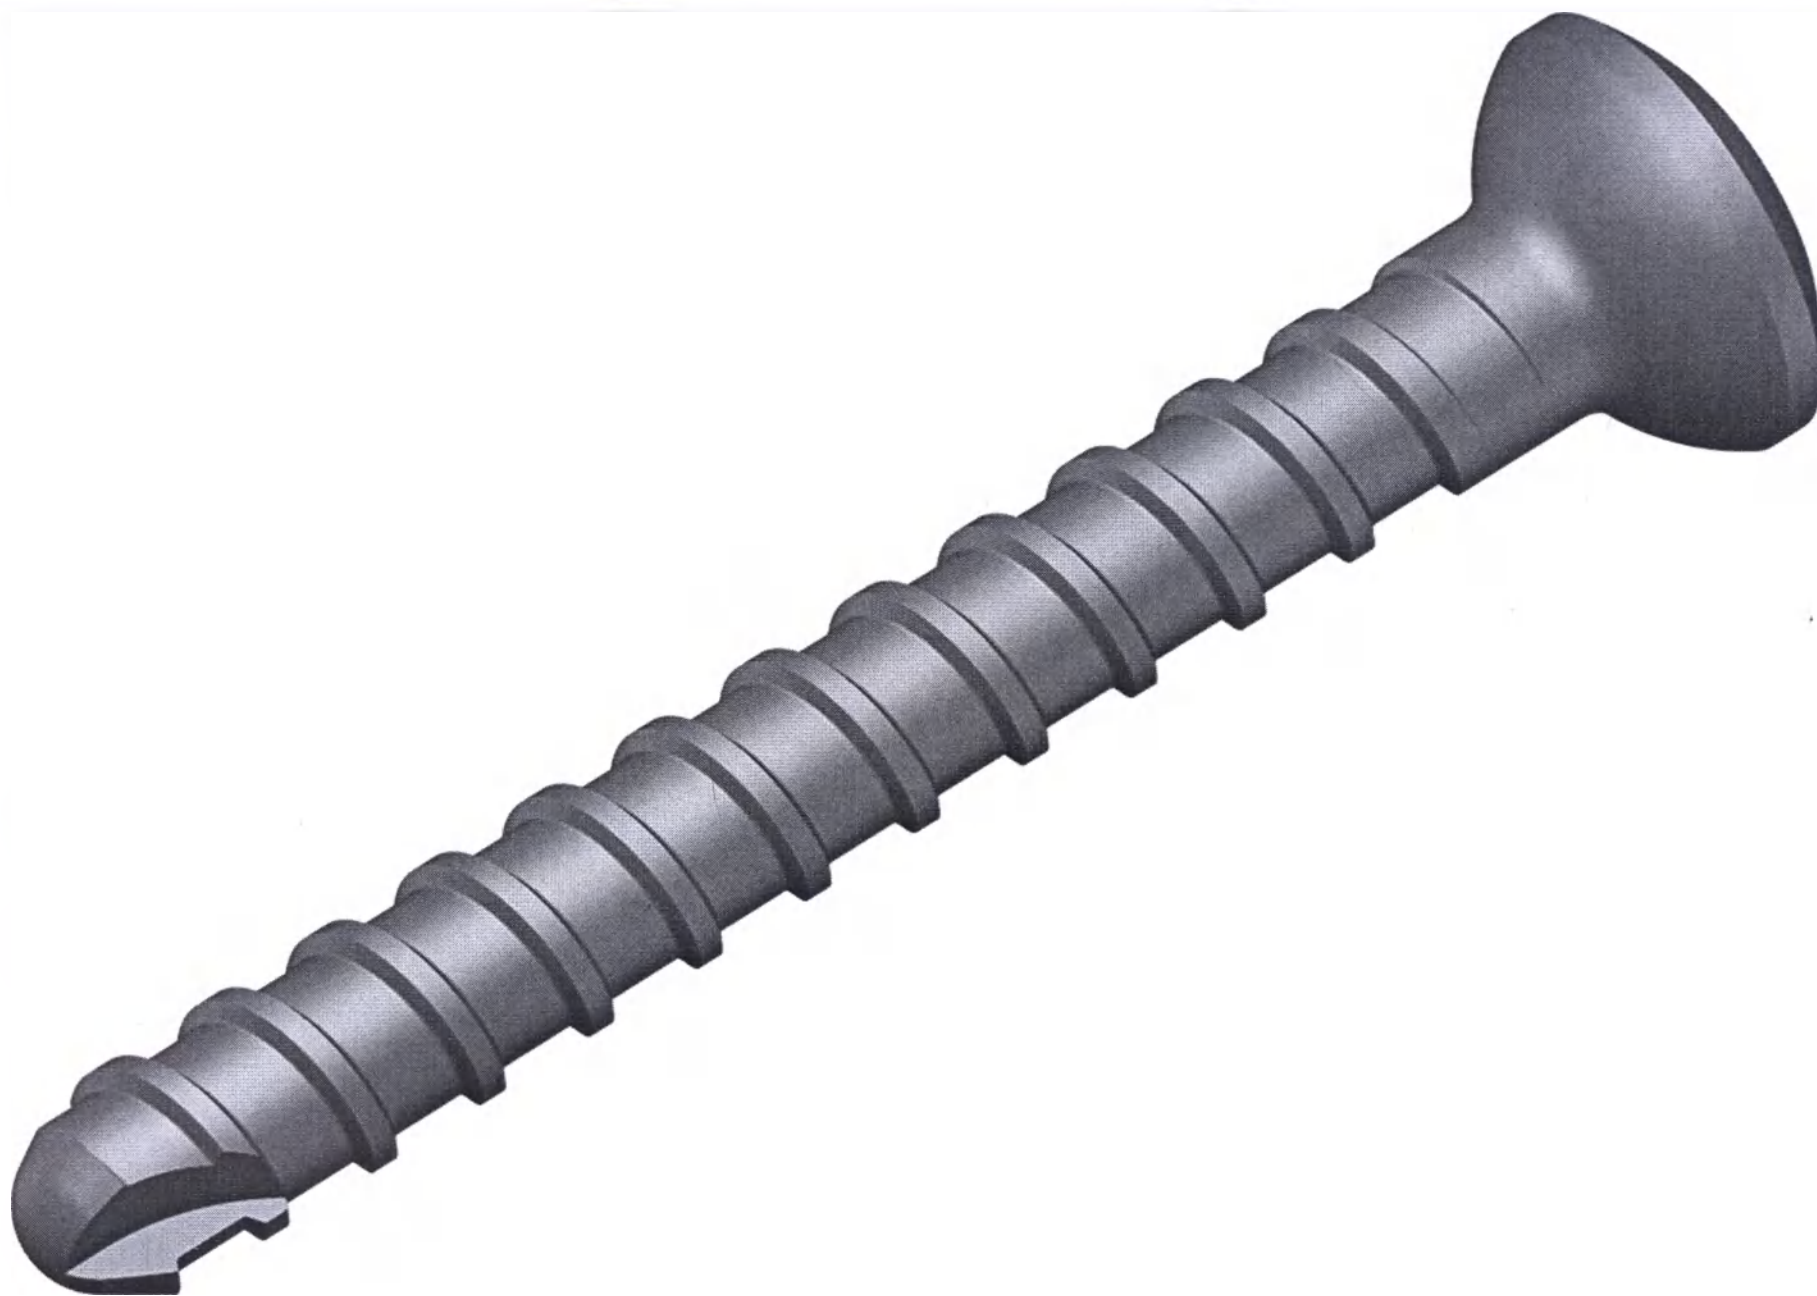


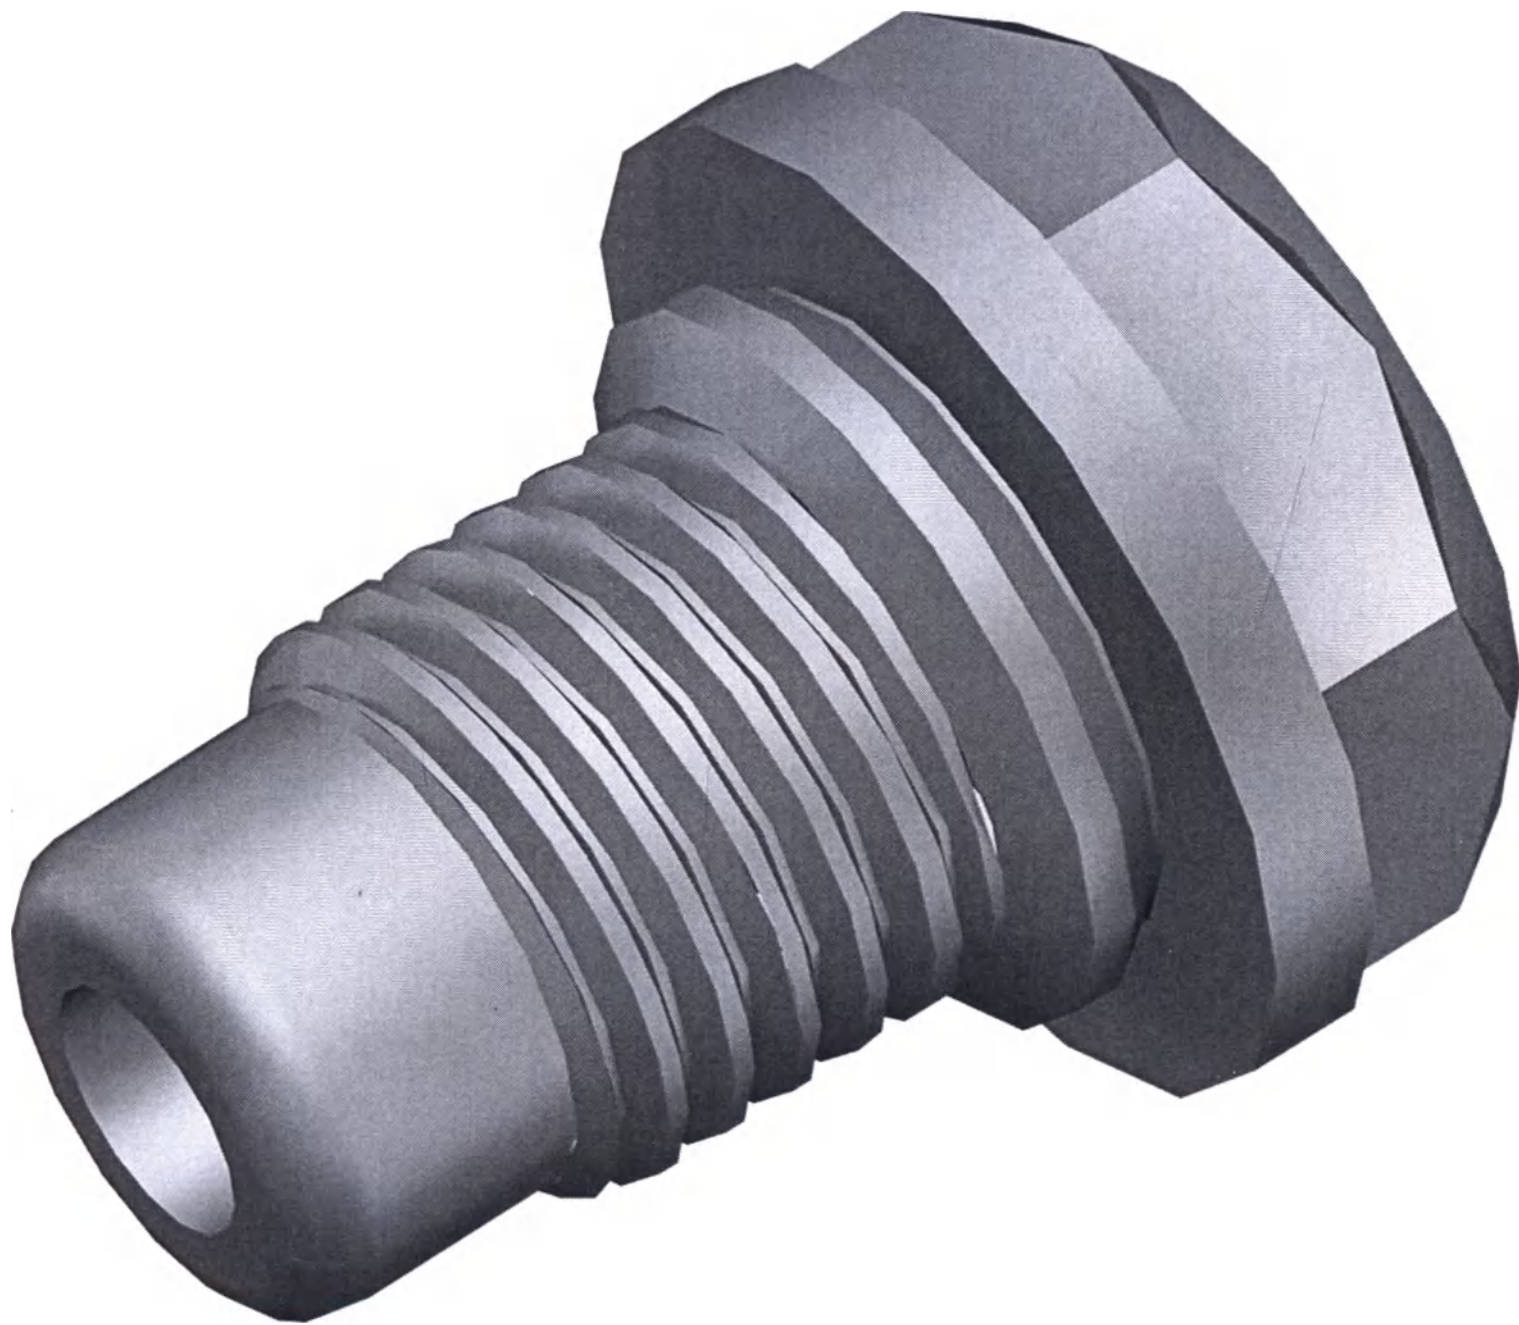

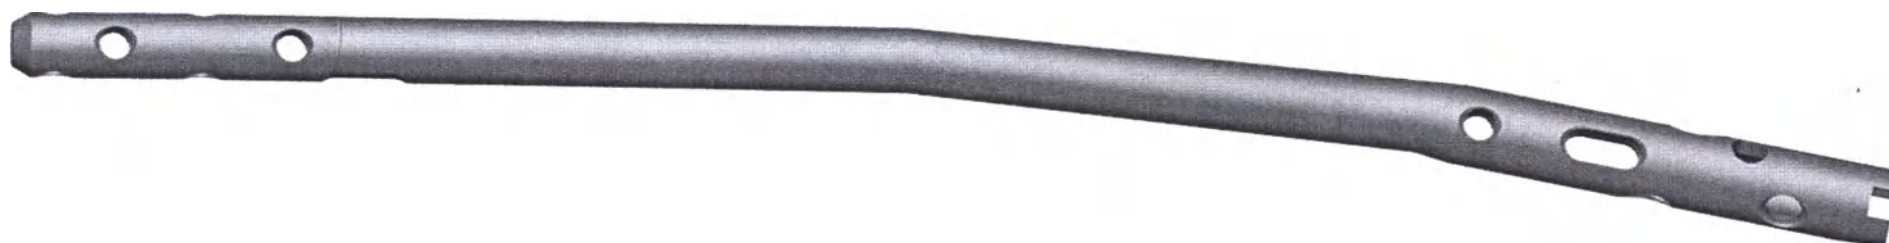





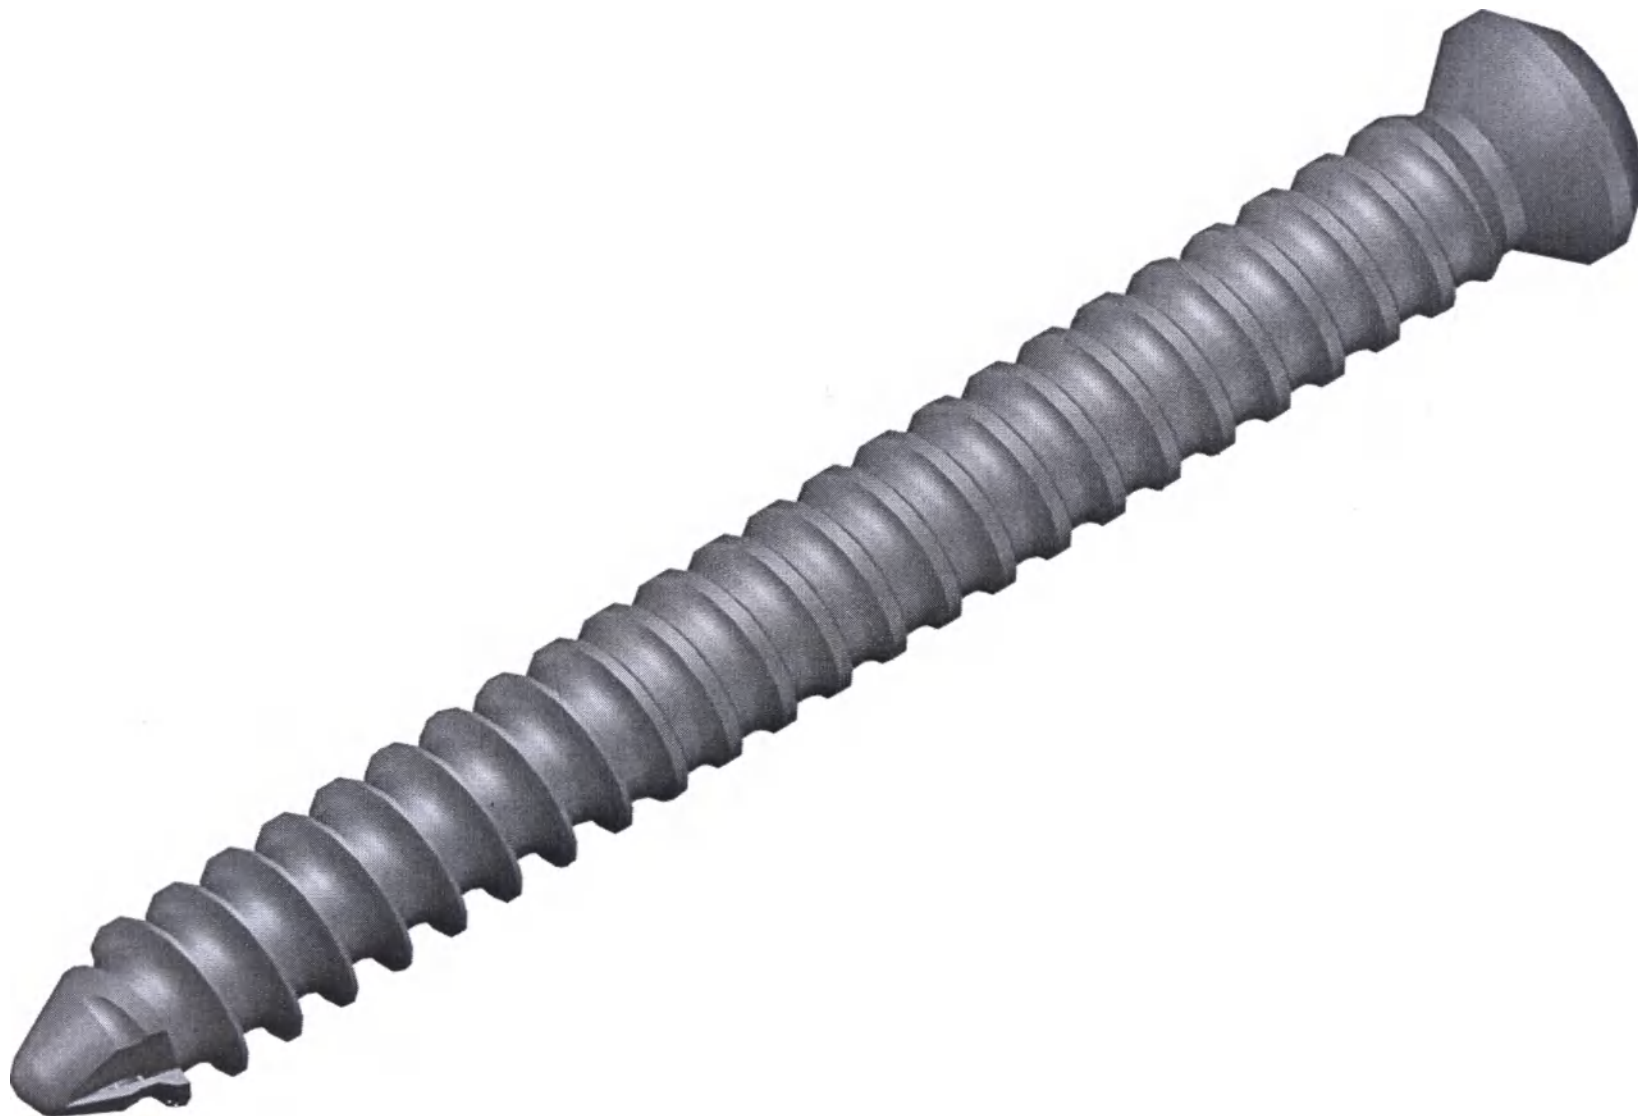






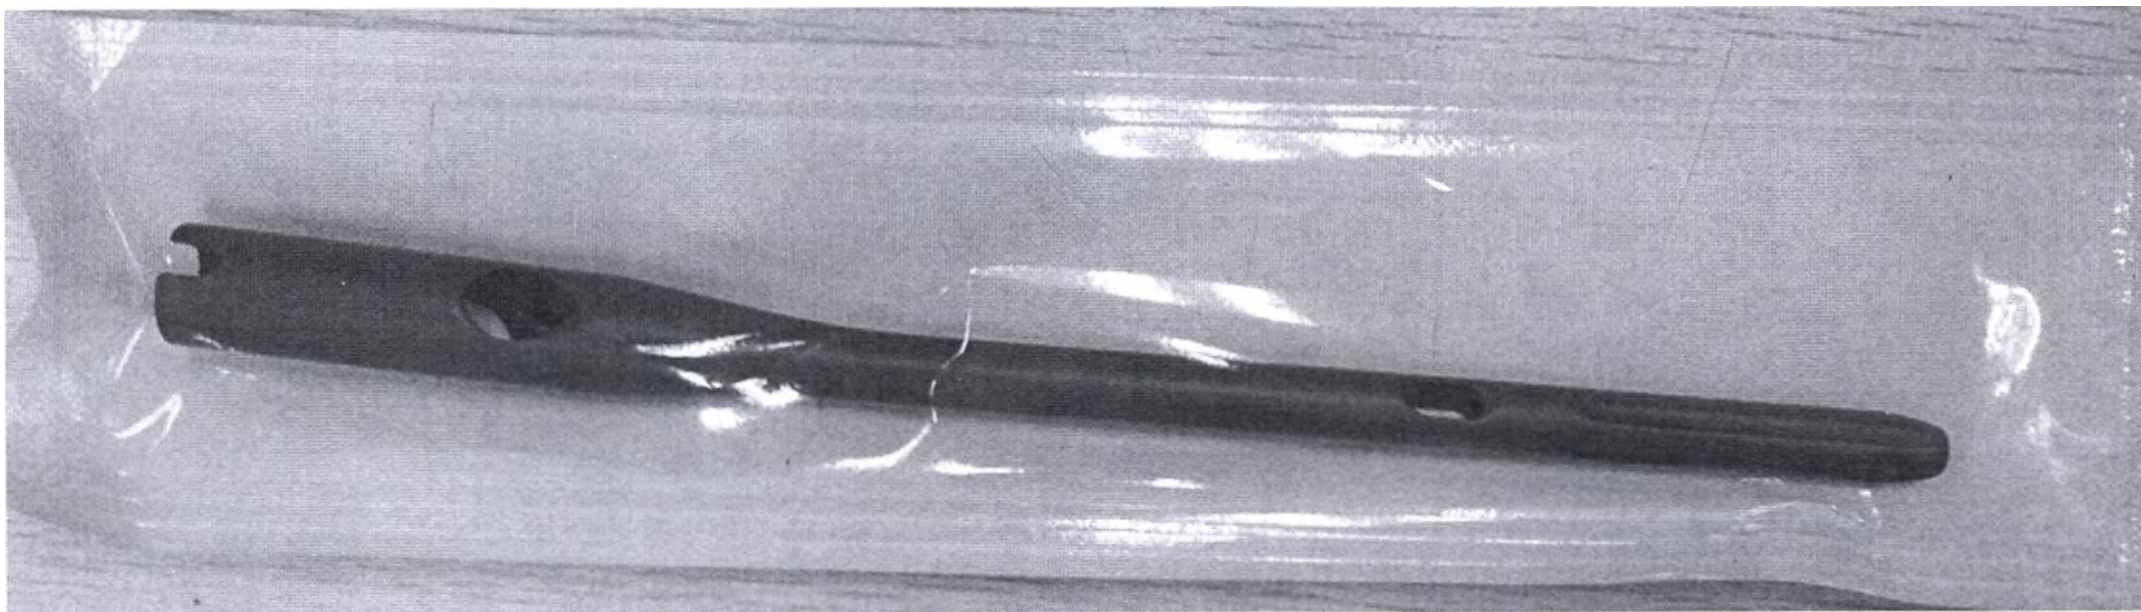


Рисунок 18. Внешний вид первичной упаковки. Термоизолирующий бумажно-пластиковый пакет.



Рисунок 19. Внешний вид финишной упаковки. Полиэтиленовый пакет PE / PVC (PE - polyethylene – полиэтилен / PVC - polyvinyl chloride - поливинилхлорид)



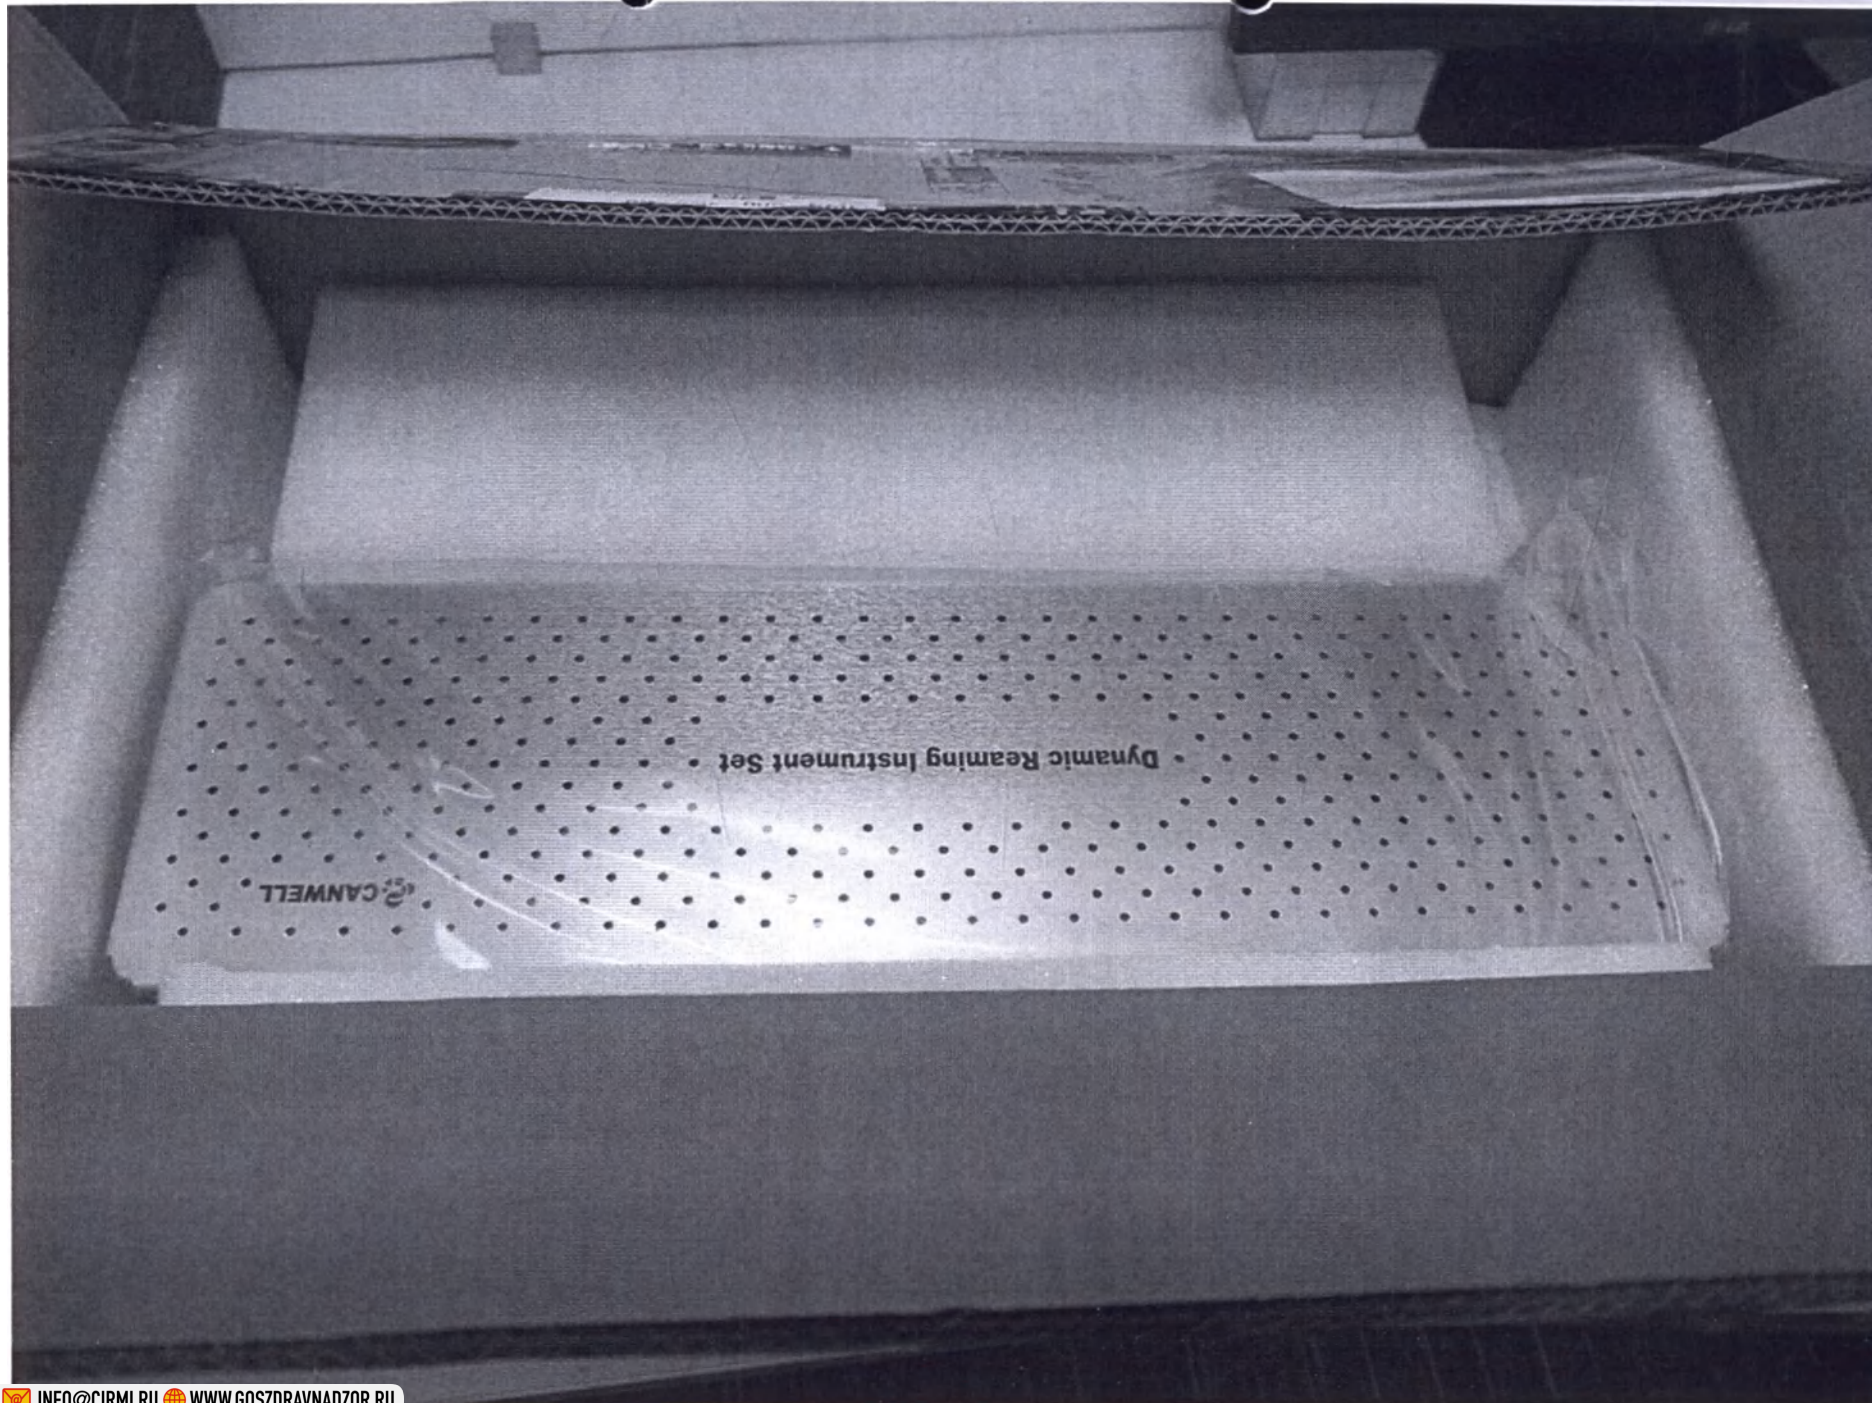

Интрамедуллярная система остеосинтеза, вариант исполнения SDG04
Стержень проксимальный для остеосинтеза бедренной
кости (тип: SDG04), стандартный: 11x240 мм

Тип: SDG04

MAT: Ti6Al4V

REF

Размер: Ø11x240

Количество:

1

LOT



CANWELL MEDICAL CO., LTD. (КАНВЕЛЛ МЕДИКАЛ КО. ЛТД.),

+86 0579-89119170

Китай

Llins.service@gmail.com

 No.466 South Xianhua Street, High-Tech Industrial Zone, Jinhua, Zhejiang
 Province, 321016, China

упп

ООО «Медквадрат»

+7-926-714-17-46,

 142715, Россия, Московская область,
 совхоз им. Ленина, д. 22 кв. 205

+7-915-160-09-68

e-mail: info@canwell.ru

Условия транспортирования: температура воздуха от +5°C до +35°C при относительной влажности от 35% до 80% (неконденсирующаяся) и атмосферном давлении 500 – 1060 гПа вдали от воздействия прямых солнечных лучей.

Условия хранения: хранить изделие в упаковке предприятия-изготовителя в сухом, чистом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, при контролируемой температуре. Температура воздуха от +5°C до +35°C при относительной влажности от 35% до 80% (неконденсирующаяся) и атмосферном давлении 500 – 1060 гПа.

Рисунок 22. Макет маркировки первичной упаковки для распространения на территории РФ

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

23 лист 2

Генеральный директор

ООО «Медквадрат»

Сулумов З.Р.

