

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»

Горшкова Н.А.

2020 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

Набор реагентов для определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 (включая группу «О») и 2 на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM HIV Ag/Ab Combo (Atellica IM CHIV))

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

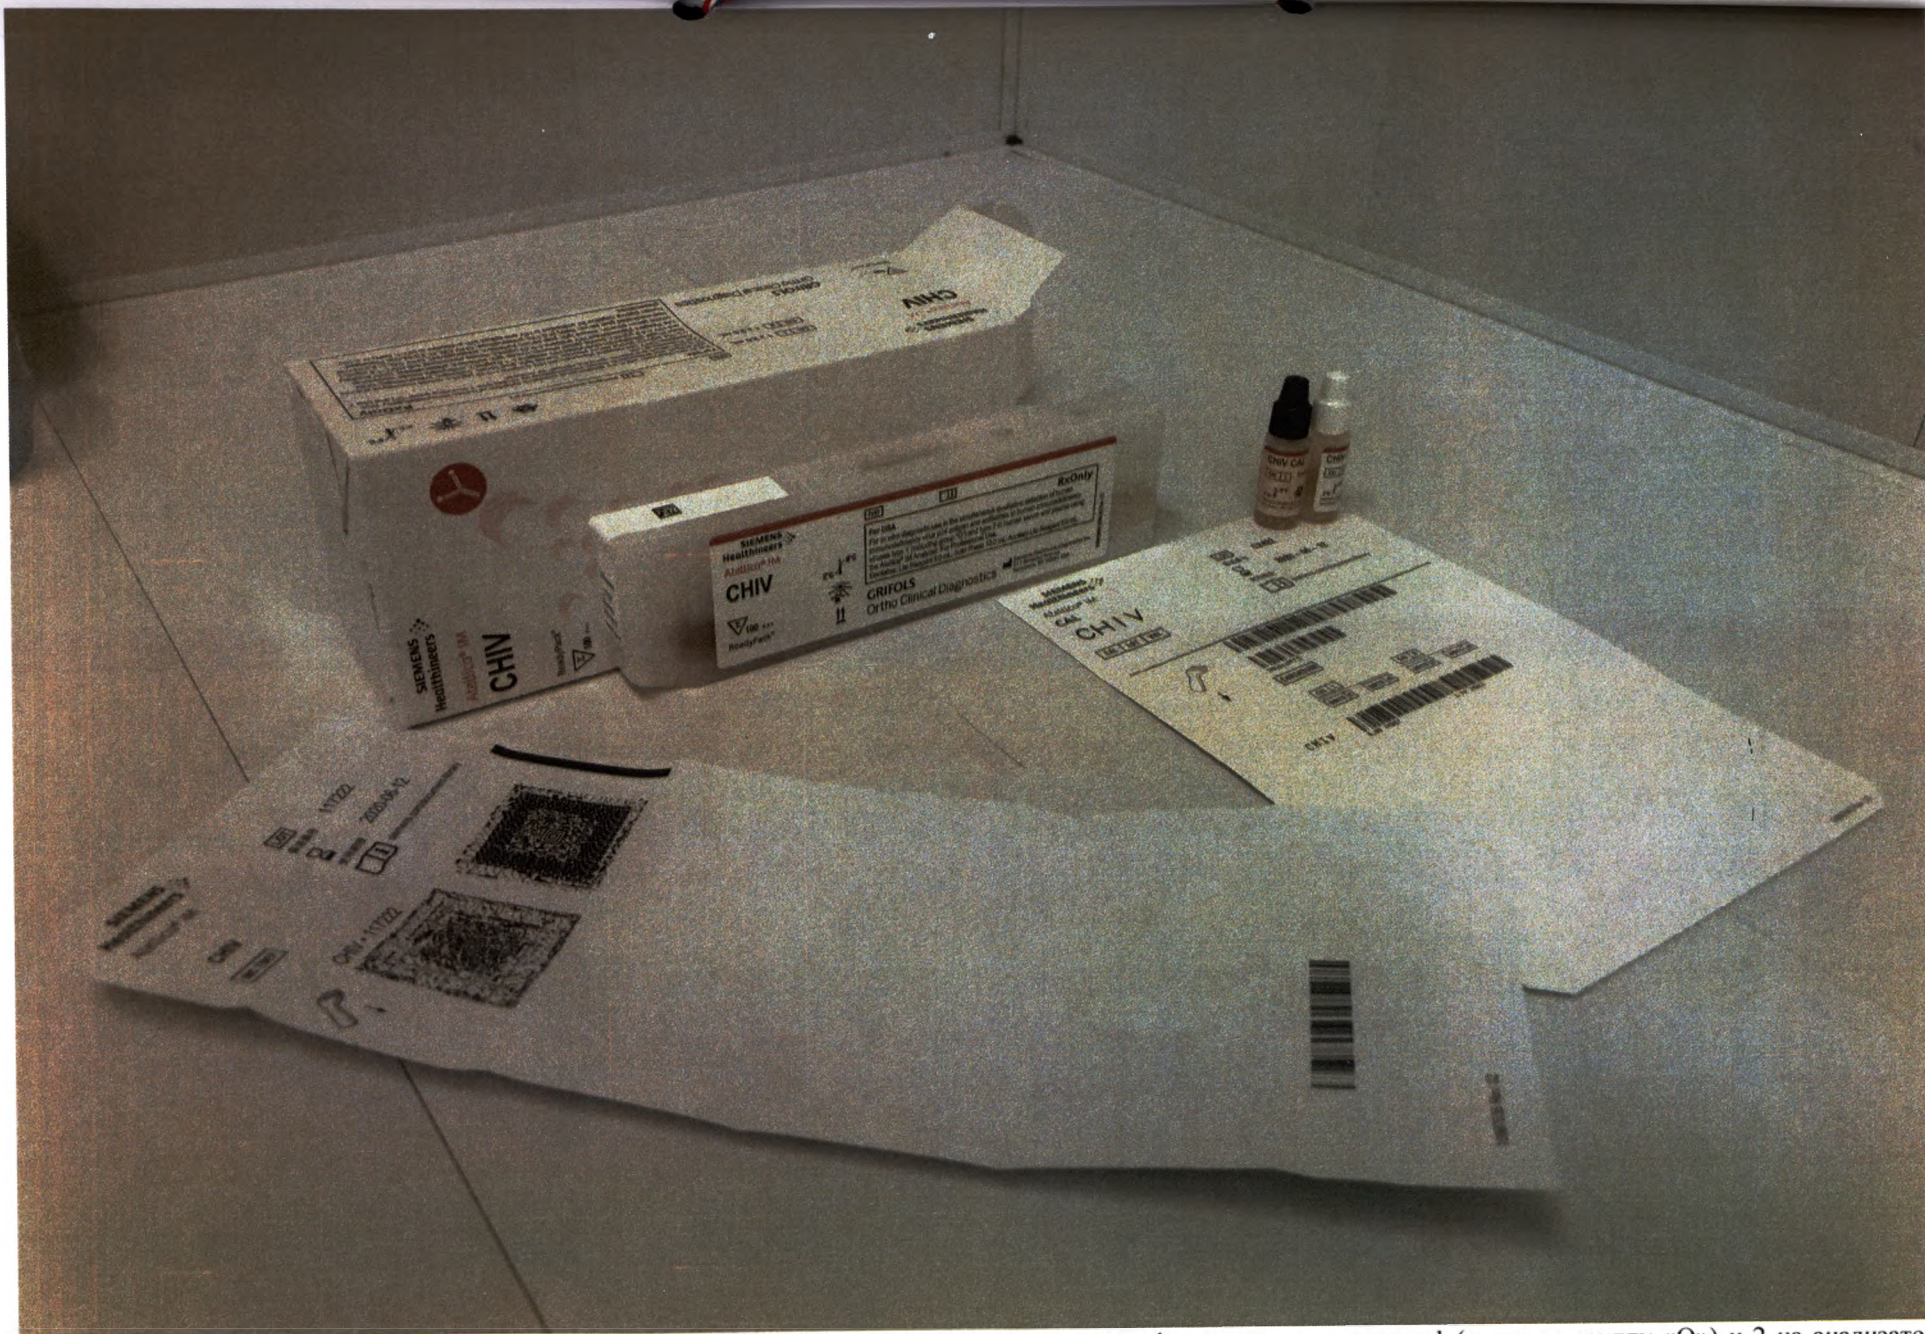


Рисунок 1. Набор реагентов для определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 (включая группу «О») и 2 на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM HIV Ag/Ab Combo (Atellica IM CHIV)). Общий вид

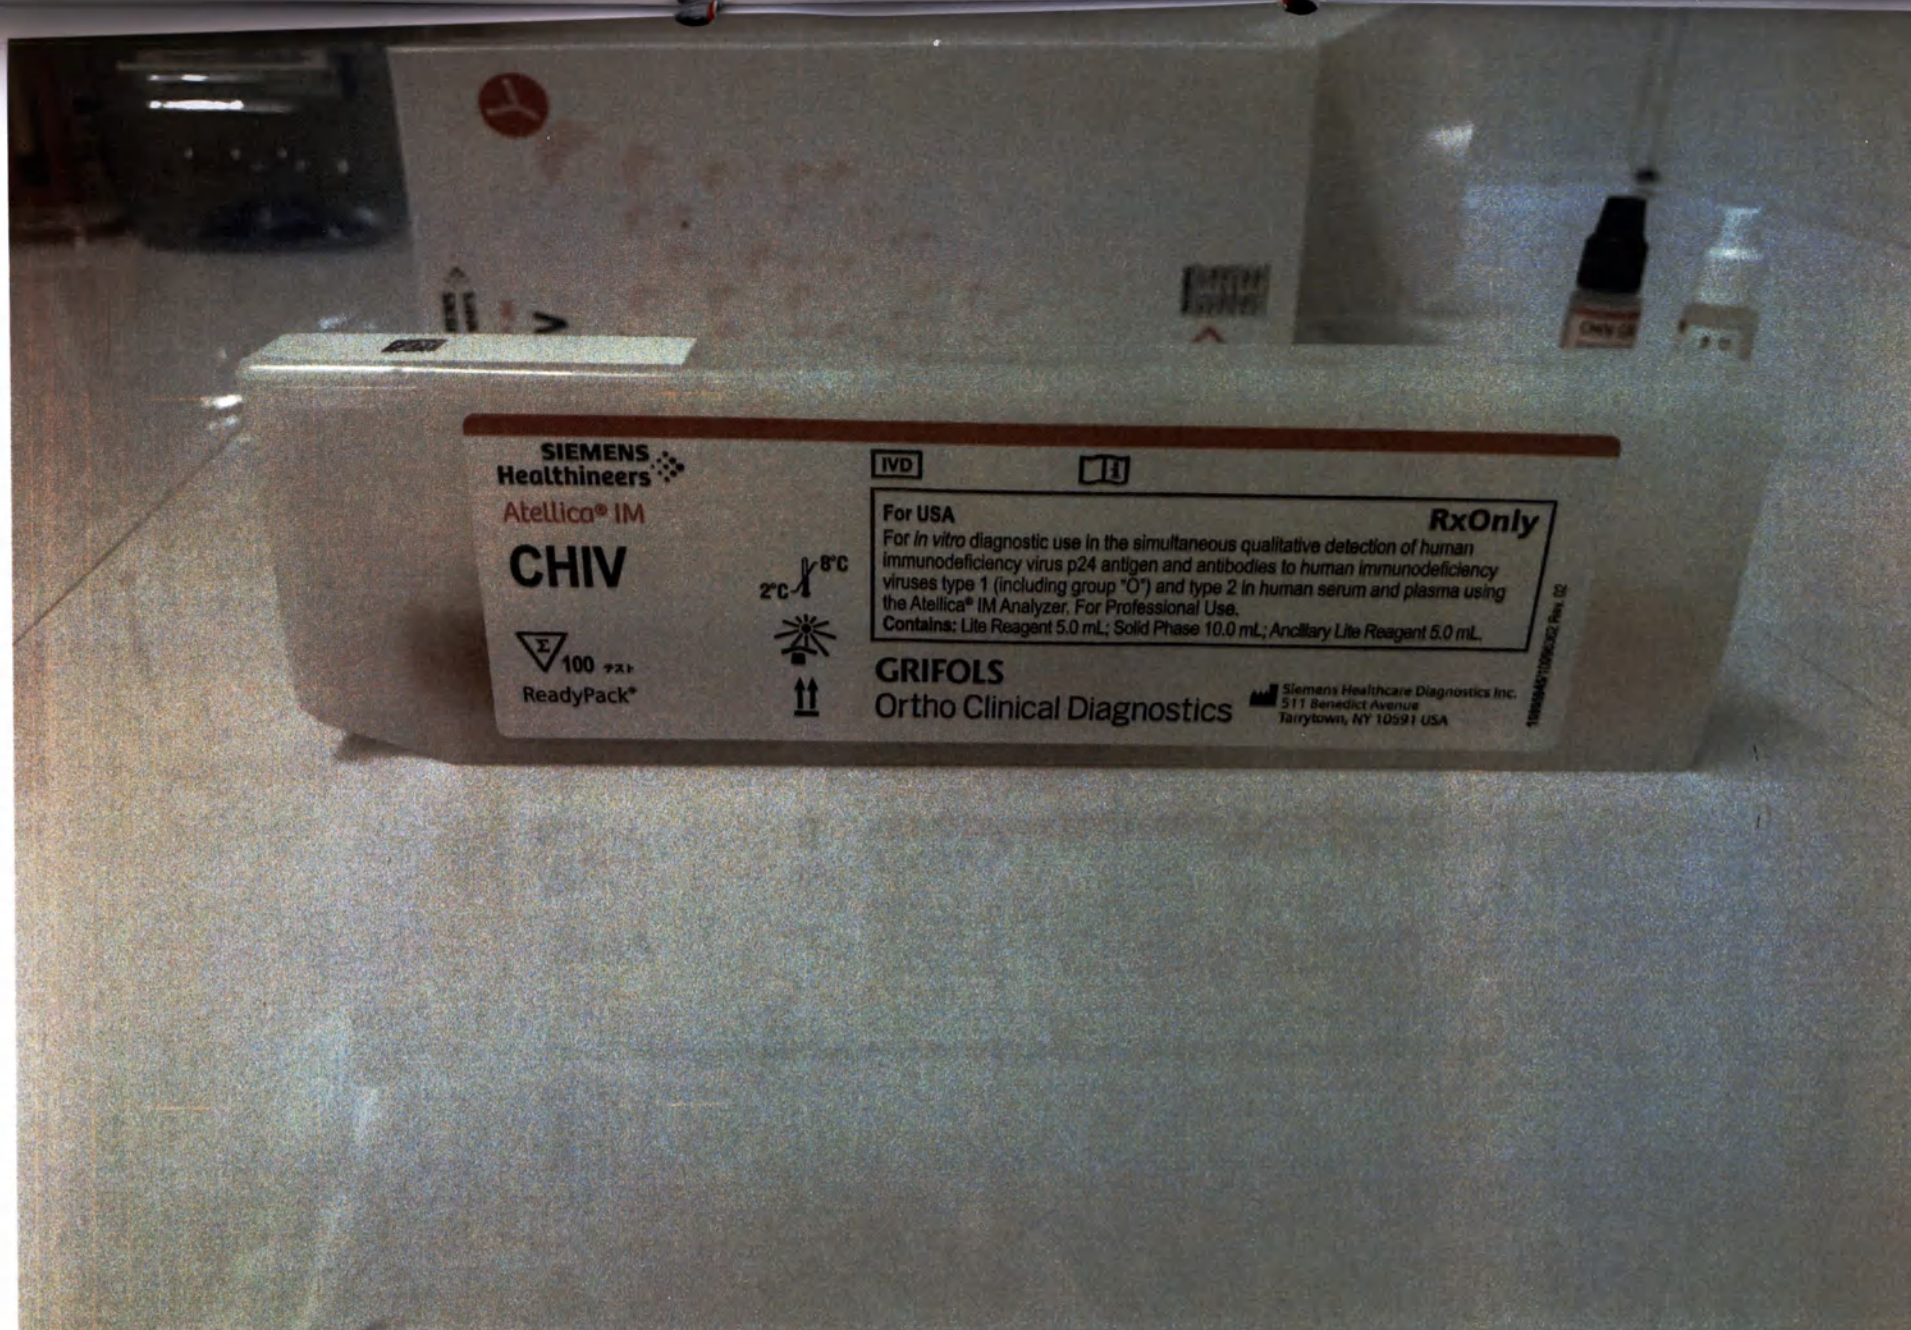


Рисунок 2. Набор реагентов для определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 (включая группу «О») и 2 на анализаторах иммунохимической серии Atellica (Atellica IM HIV Ag/Ab Combo (Atellica IM CHIV)): Первичный реагент Atellica IM CHIV

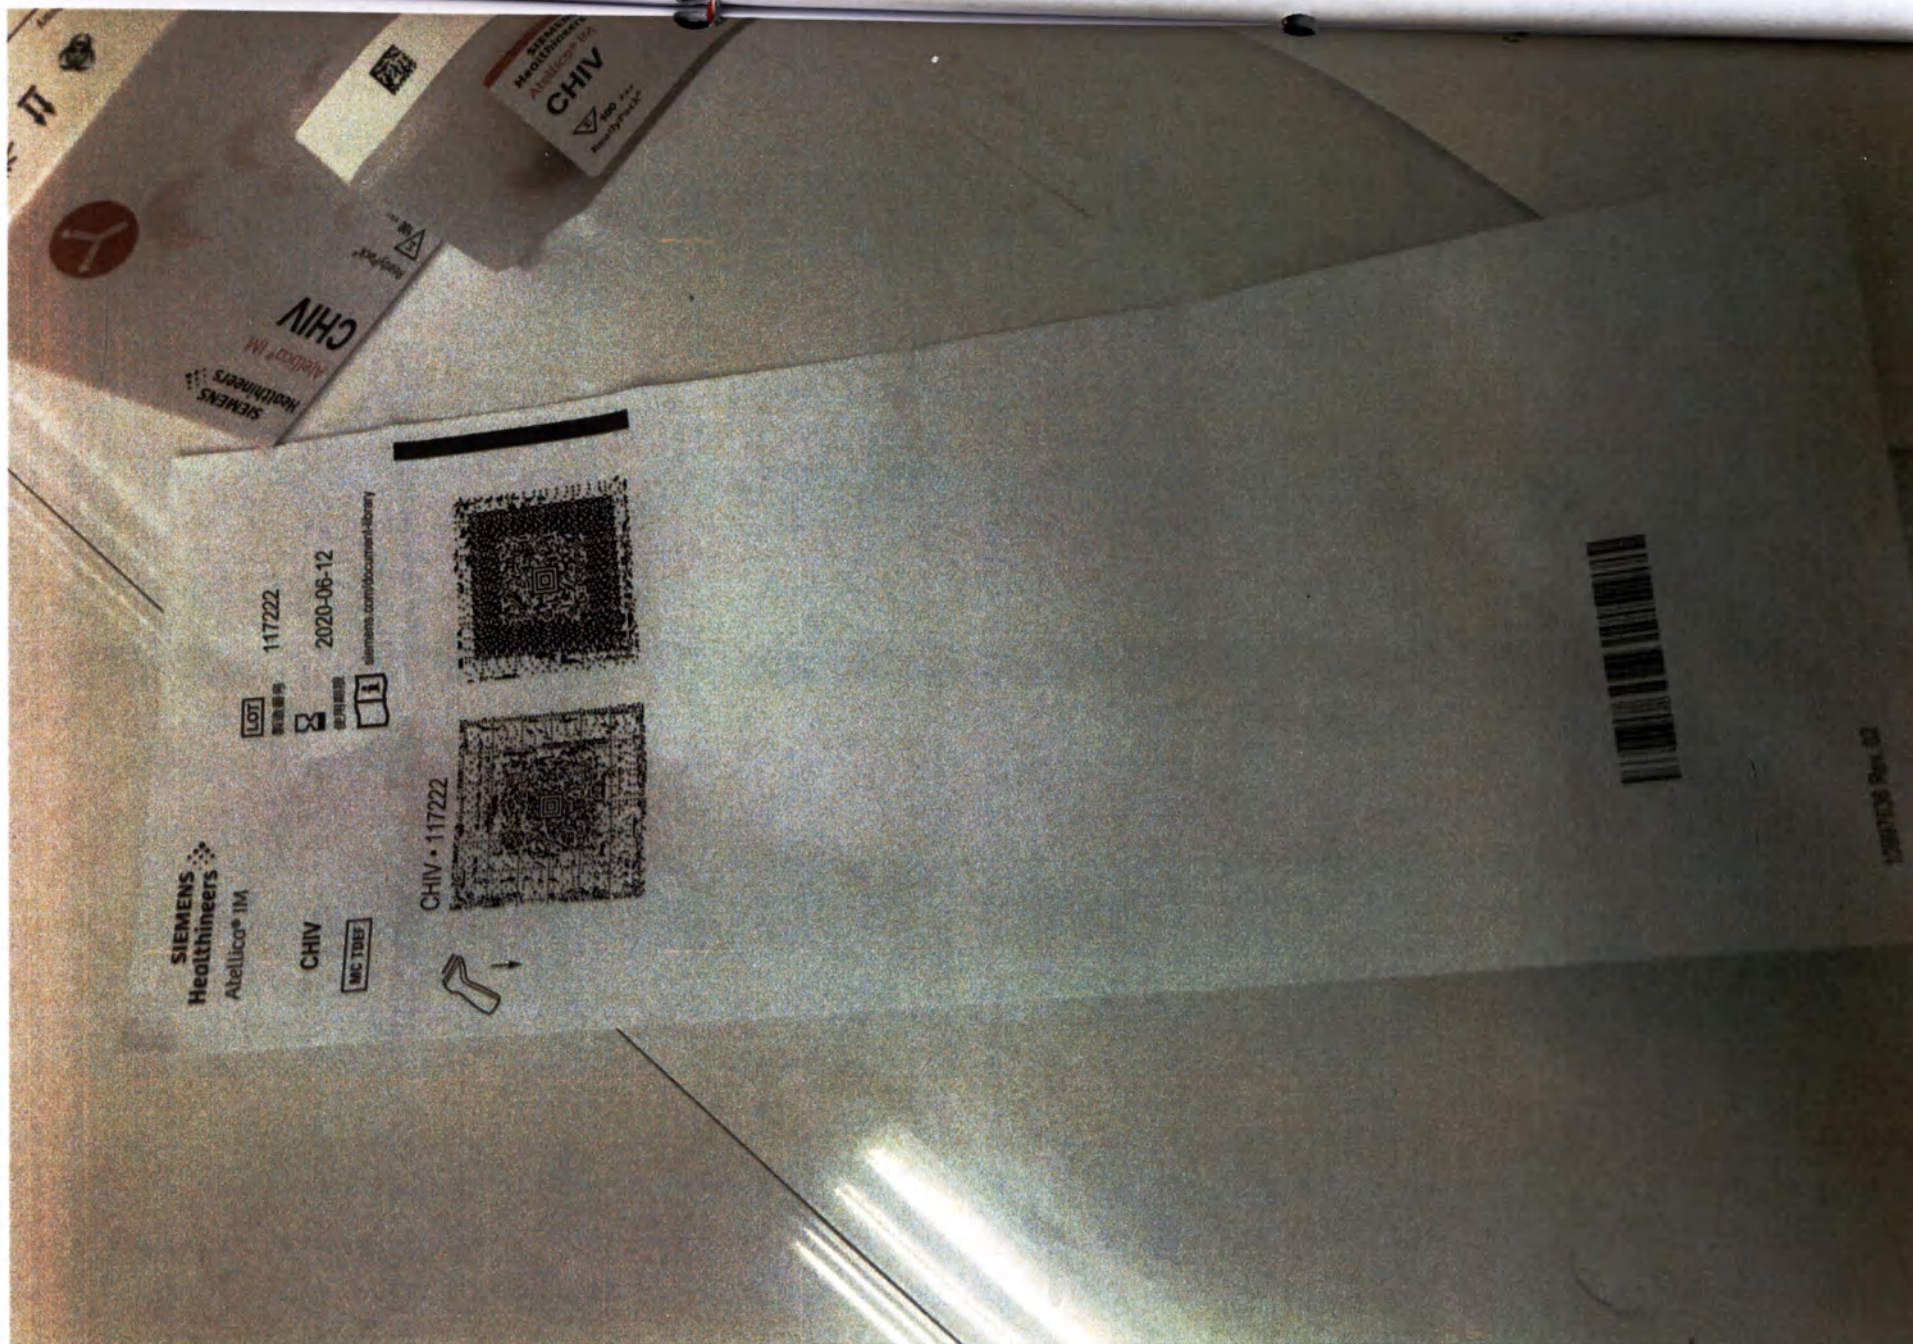


Рисунок 3. Набор реагентов для определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 (включая группу «О») и 2 на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM HIV Ag/Ab Combo (Atellica IM CHIV)): Вкладыш со штрих-кодом MC TDEF для Atellica IM CHIV



Рисунок 4. Набор реагентов для определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 (включая группу «О») и 2 на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM HIV Ag/Ab Combo (Atellica IM CHIV)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM CHIV CAL L, 2,0 мл

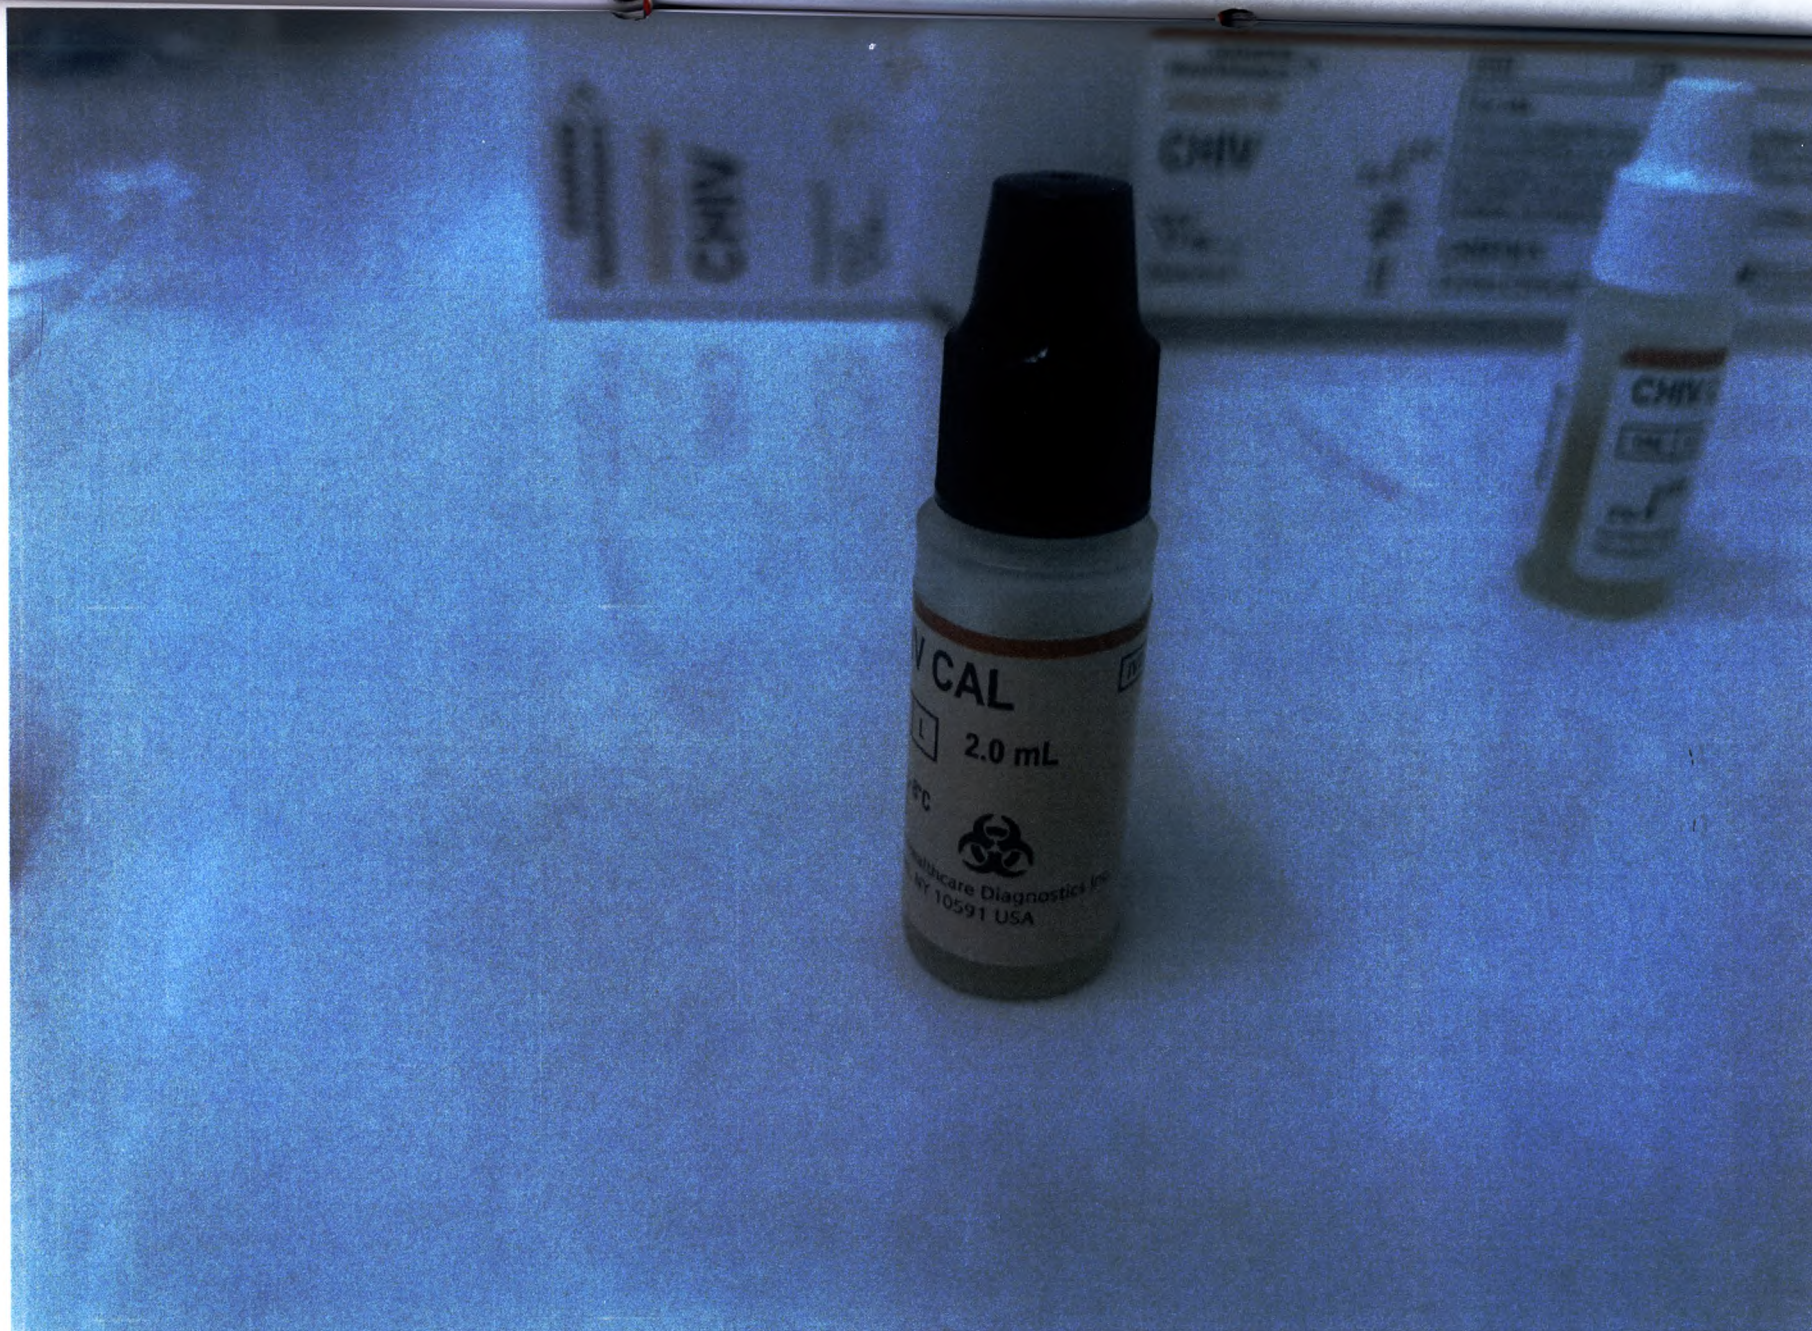


Рисунок 5. Набор реагентов для определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 (включая группу «О») и 2 на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM HIV Ag/Ab Combo (Atellica IM CHIV)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM CHIV CAL L, 2,0 мл

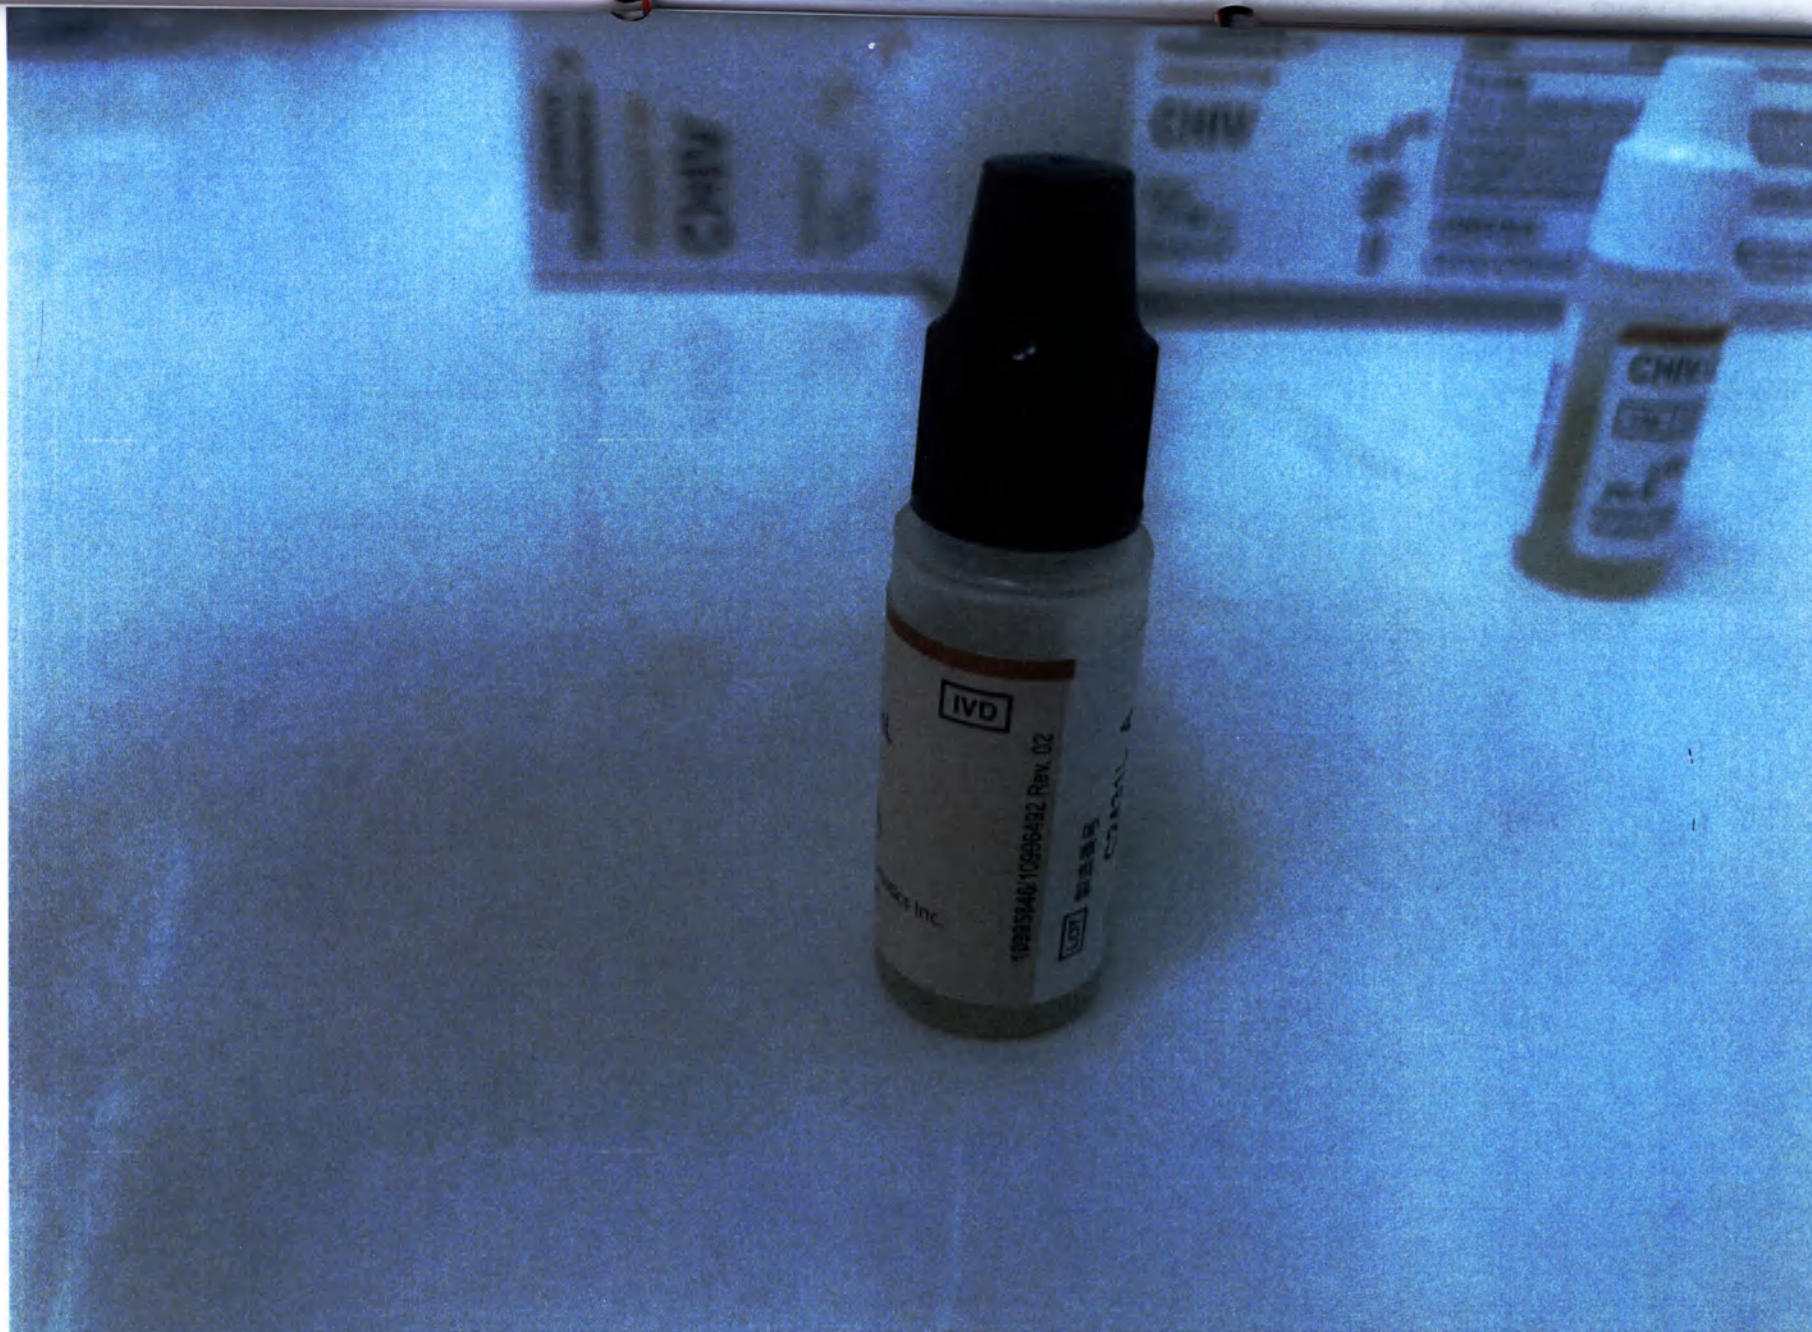


Рисунок 6. Набор реагентов для определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 (включая группу «О») и 2 на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM HIV Ag/Ab Combo (Atellica IM CHIV)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM CHIV CAL L, 2,0 мл

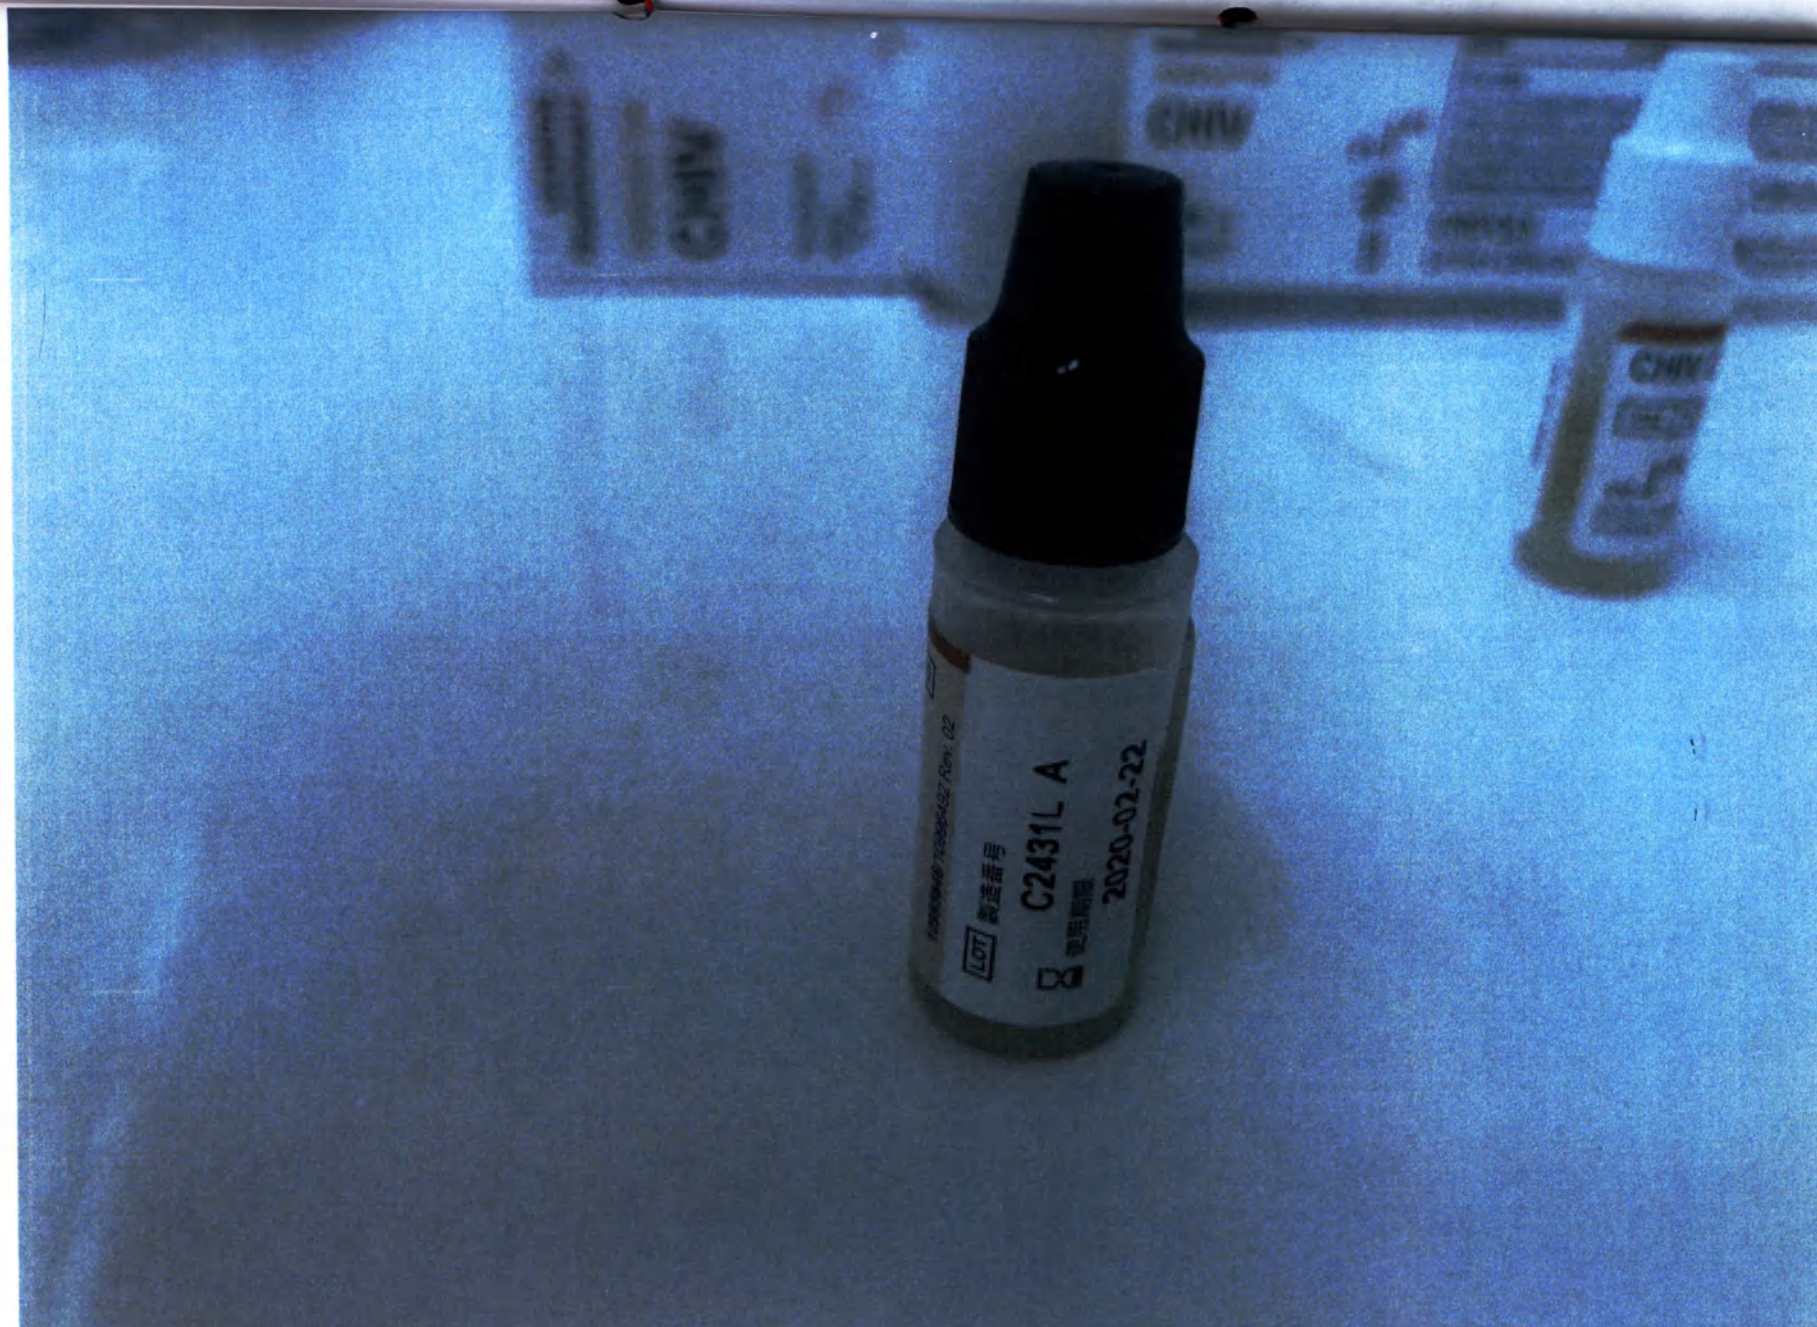


Рисунок 7 Набор реагентов для определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 (включая группу «О») и 2 на анализаторах

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 8. Набор реагентов для определения антигена p24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 (включая группу «О») и 2 на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM HIV Ag/Ab Combo (Atellica IM CHIV)): Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM CHIV CAL H, 2,0 мл



Рисунок 9 Набор реагентов для определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 (включая группу «О») и 2 на анализаторах

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU tellica IM HIV Ag/Ab Combo (Atellica IM CHIV)): Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM CHIV CAL H, 2,0 мл

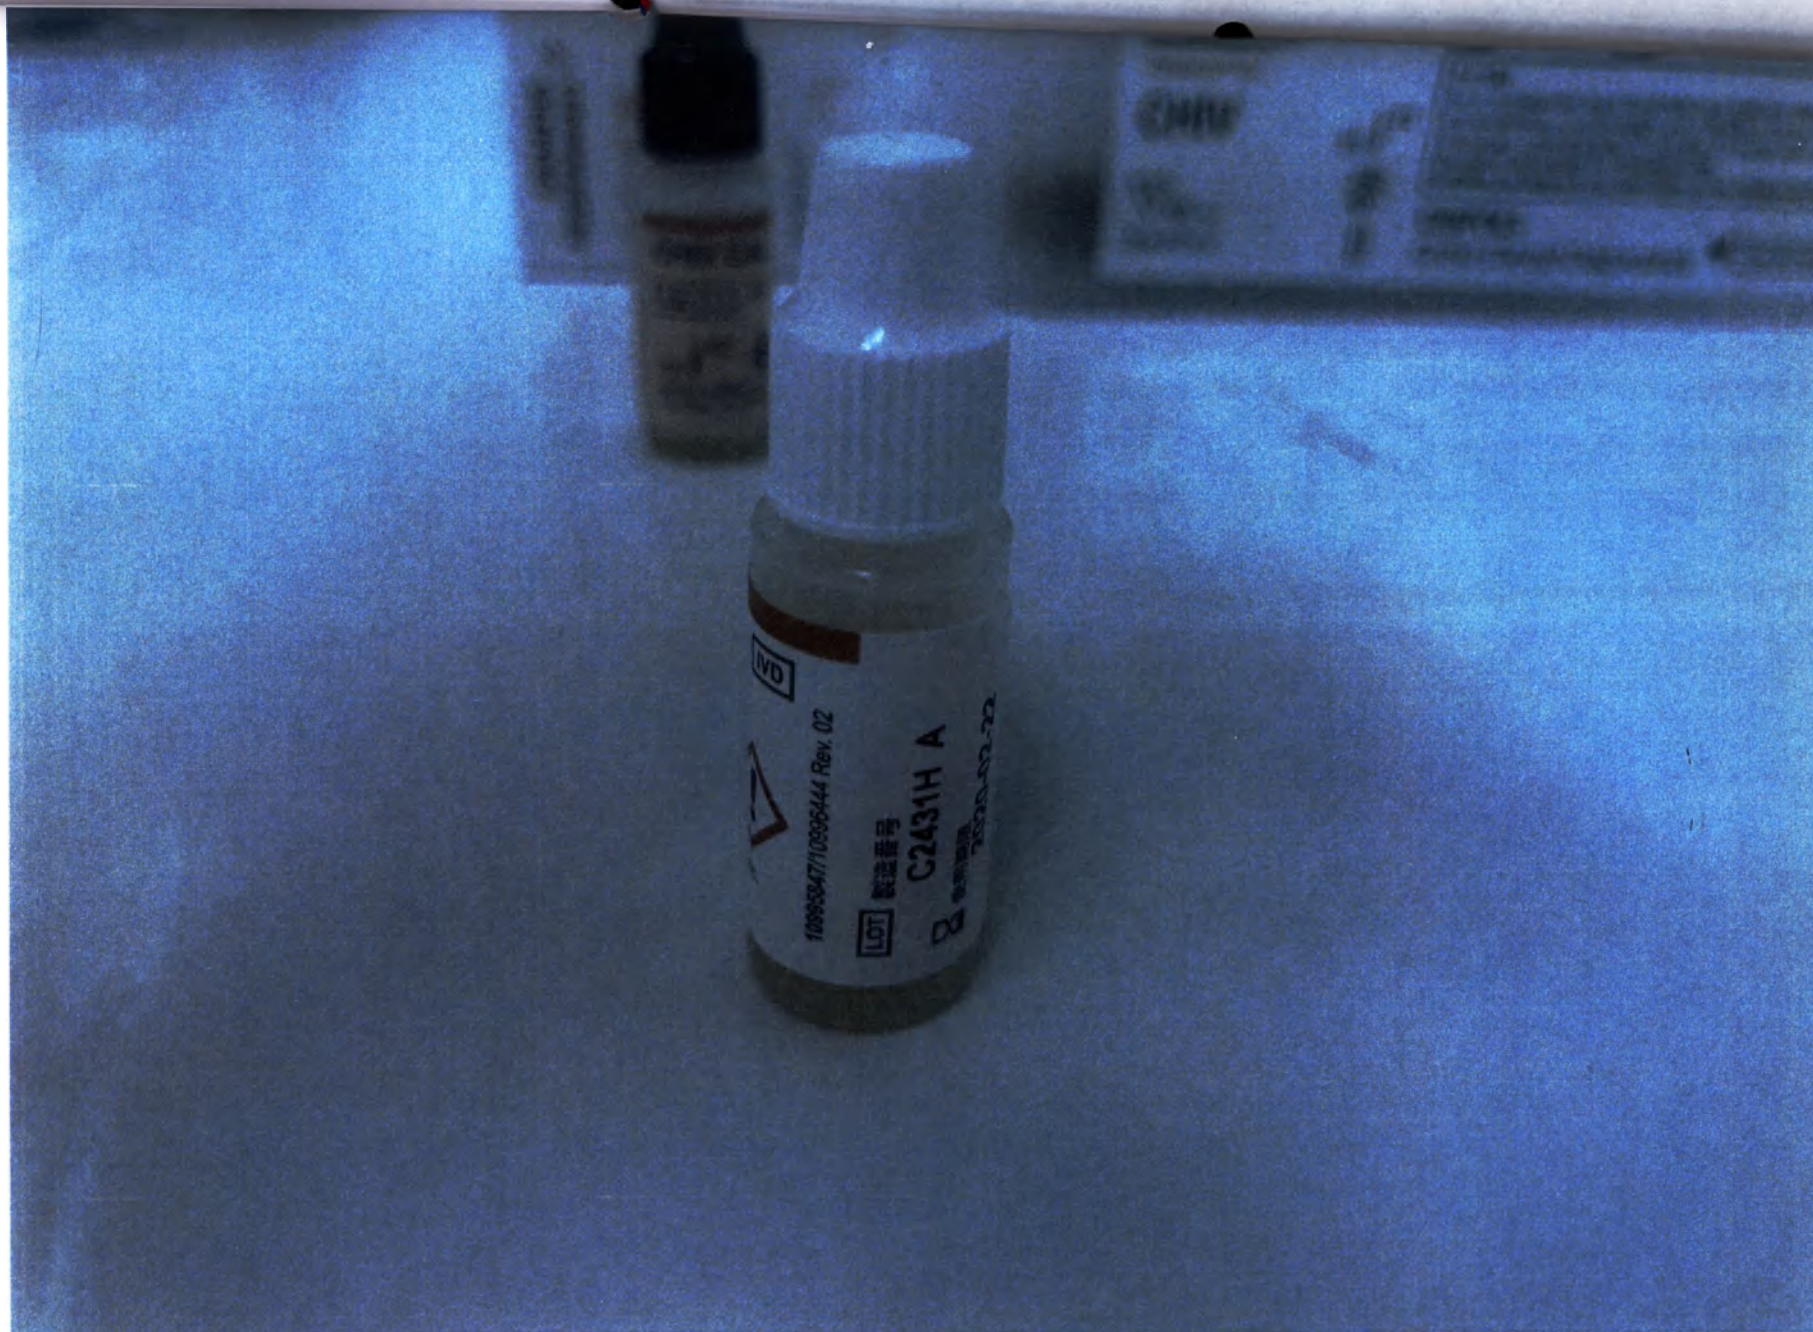


Рисунок 10. Набор реагентов для определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 (включая группу «О») и 2 на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM HIV Ag/Ab Combo (Atellica IM CHIV)): Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM CHIV CAL H, 2,0 мл

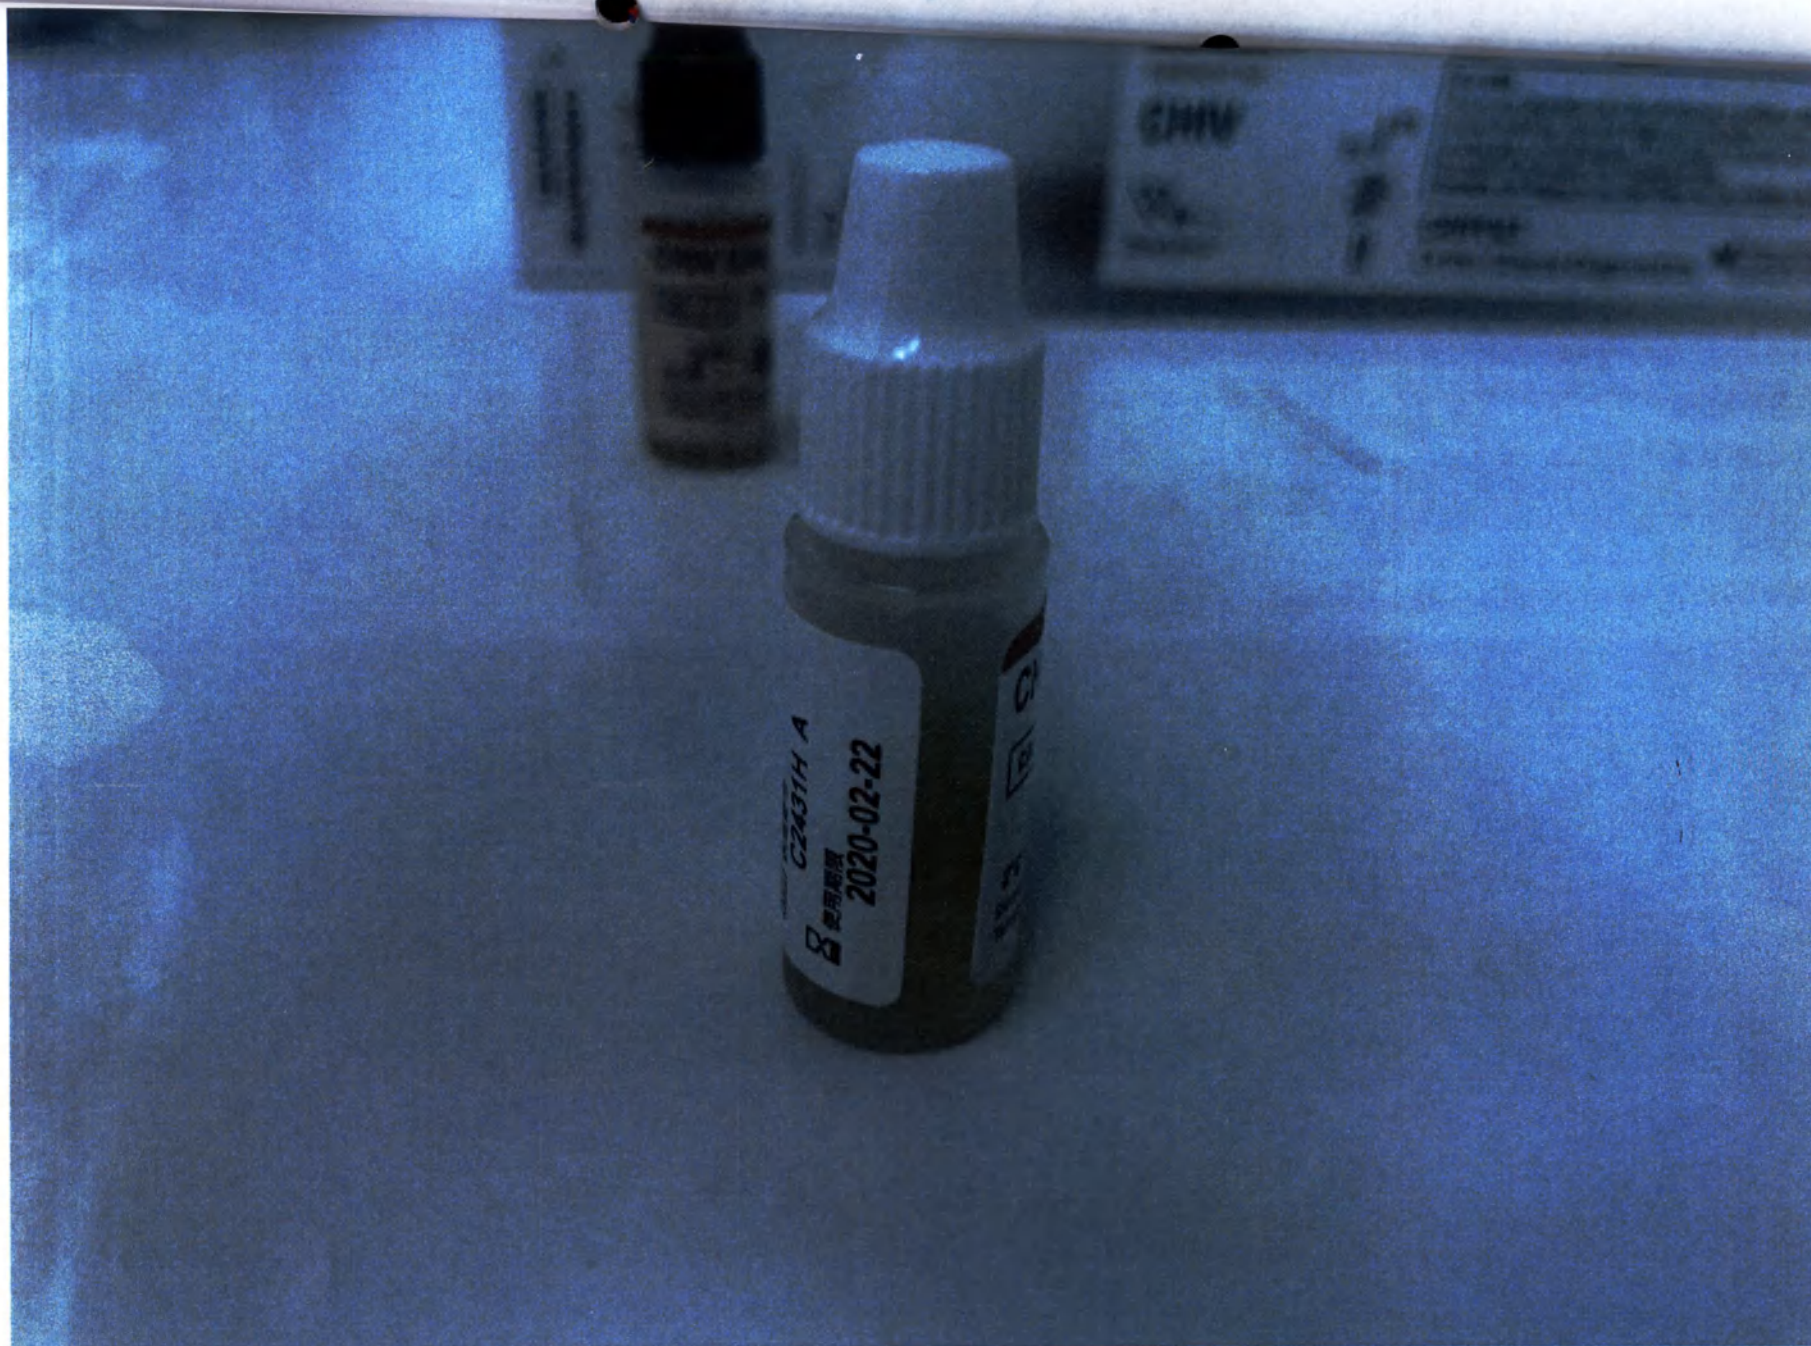


Рисунок 11. Набор реагентов для определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 (включая группу «О») и 2 на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM HIV Ag/Ab Combo (Atellica IM CHIV)): Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM CHIV CAL H, 2,0 мл



Рисунок 12. Набор реагентов для определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 (включая группу «О») и 2 на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM HIV Ag/Ab Combo (Atellica IM CHIV))
Лист значений параметров лота калибратора.

