

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МЕДТРЕЙД СПб»
И. С. Рогач
«15» _____ 2021 г.


**МАКЕТ МАРКИРОВКИ И УПАКОВКИ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

«Насос шприцевой НР-30, с принадлежностями»

Производитель: MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD,

1. Маркировка изделия

1.1 Маркировка производителя «Основной блок HP-30»

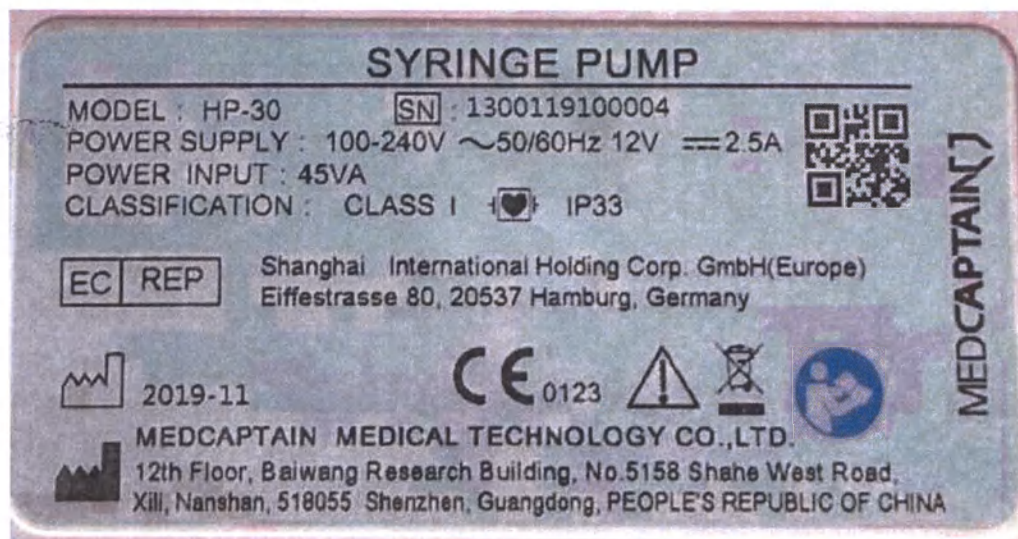

Макет стикера для Российской Федерации «Основной блок HP-30»

Основной блок HP-30



MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТРЕЙД СПБ»
Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург, пр-т Московский, 79А, литер А, 3Н, 4Н, пом. 123


тел./факс: Тел. 8 (343) 28-70-500, 8 (800) 775-36-85.

info@cmtrade.ru

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие: № РЗН 20XX/XXXX
от XX _____ 20XX года.



: см. на упаковке.



: см. на упаковке.

Срок службы: не более 10 лет

Условия хранения и применения: см. вложенную инструкцию, только для профессионального применения.

1.2 Маркировка производителя «Устройство для вызова медсестры»



Макет стикера для Российской Федерации «Устройство для вызова медсестры»

Наименование:

Устройство для вызова медсестры

Модель: MP-2


LOT см. на упаковке

Производитель: MEDCAPTAIN

MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

1.3 Маркировка производителя «Контроллер PCA»

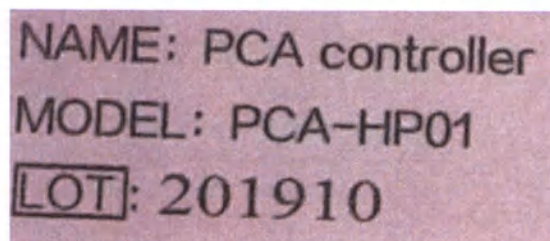

Макет стикера для Российской Федерации «Контроллер PCA»

Наименование: Контроллер PCA

Модель: PCA-HP01

LOT см. на упаковке

Производитель: MEDCAPTAIN

MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Маркировка содержит:

Наименование изделия	
Информация о производителе	
Информация об импортёре	
№ Регистрационного удостоверения	
Срок службы	
Условия хранения	
NAME :	Наименование изделия
MODEL	Модель изделия
POWER SUPPLY	Обозначение требований к источнику электропитания Диапазон входного напряжения, частота напряжения электропитания, максимальная входная мощность блока питания
POWER INPUT	Мощность
CLASSIFICATION :	Классификация
	Тип рабочей части аппарата CF
SN	Серийный номер: технический код изделия
	Производитель (название и адрес компании)
	Дата производства (год, месяц)
EC REP	Обозначение представителя в ЕС: Включает в себя обозначение представителя в ЕС, название компании, почтовый адрес.
CE 0123	Знак соответствия CE и номер
	Осторожно! Обратитесь к руководству по эксплуатации. Указывает на необходимость для пользователя, ознакомиться с важной информацией инструкции по применению, такой как предупреждения и меры предосторожности, которые не могут по разным причинам, размещены на медицинском изделии
	УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (WEEE): Этот символ используется для защиты окружающей среды, он указывает, что утилизация электрооборудования и электронного оборудования не должна проводиться как утилизация несортированных отходов, а должна проводиться отдельно.
	Обратитесь к Руководству по эксплуатации
LOT	Код партии Указывает код партии, которым изготовитель идентифицировал партию изделия

2. Маркировка на упаковке:

2.1 Маркировка производителя на упаковке «Насос шприцевой НР-30, с принадлежностями»



Макет стикера для Российской Федерации «Насос шприцевой НР-30, с принадлежностями»

Насос шприцевой НР-30, с принадлежностями



MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Импортёр: Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТРЕЙД СПБ»

Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург, пр-т Московский, 79А, литер А, 3Н, 4Н, пом. 123
тел./факс: Тел. 8 (343) 28-70-500, 8 (800) 775-36-85. info@cmtrade.ru



: см. на упаковке.



: см. на упаковке.

Срок службы: не более 10 лет

Условия хранения и применения: см. вложенную инструкцию, только для профессионального применения.

2.2 Маркировка производителя на упаковке «Принадлежности к Насос шприцевой НР-30, с принадлежностями»



Макет стикера для Российской Федерации «Принадлежности к Насос шприцевой НР-30, с принадлежностями»

Принадлежности к Насос шприцевой НР-30 с принадлежностями



MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Импортёр: Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТРЕЙД СПБ»

Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург, пр-т Московский, 79А, литер А, 3Н, 4Н, пом. 123 тел./факс: Тел. 8 (343) 28-70-500, 8 (800) 775-36-85. info@cmtrade.ru



: см. на упаковке.



: см. на упаковке.

Срок службы: не более 10 лет

Условия хранения и применения: см. вложенную инструкцию, только для профессионального применения.

2.3 Маркировка производителя на упаковке «Устройство для вызова медсестры»



Макет стикера для Российской Федерации с переводом «Устройство для вызова медсестры»


Наименование:

Устройство для вызова медсестры

Серийный номер: XXXX-XXXXX-XX

Дата производства: XXXX-XX-XX

2.4 Маркировка на упаковке «Контроллера PCA»

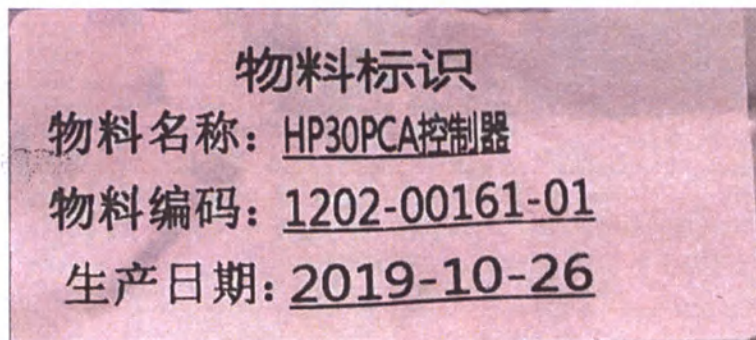

Макет стикера для Российской Федерации с переводом «Контроллера PCA»


Наименование: Контроллера PCA Серийный номер: <u>XXXX-XXXX-XX</u> Дата производства: <u>XXXX-XX-XX</u>

Маркировка содержит:

Наименование изделия	
Информация о производителе	
Информация об импортёре	
Срок службы	
Условия хранения	
NAME :	Наименование изделия
MODEL :	Модель изделия
QUANTITY :	Количество
P/N	Заводской номер
SN	Серийный номер: технический код изделия
	Производитель (название и адрес компании)
	Дата производства (год, месяц)
EC REP	Обозначение представителя в ЕС: Включает в себя обозначение представителя в ЕС, название компании, почтовый адрес.
CE 0123	Знак соответствия CE и номер
	УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (WEEE): Этот символ используется для защиты окружающей среды, он указывает, что утилизация электрооборудования и электронного оборудования не должна проводиться как утилизация несортированных отходов, а должна проводиться отдельно.
LOT	Код партии Указывает код партии, которым изготовитель идентифицировал партию изделия

	«Пределы температуры» Любой из видов излучения может влиять на свойства груза или изменять их (например, непроявленные пленки)
	«Хрупкое. Осторожно.» Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом
	«Беречь от влаги» Необходимость защиты груза от воздействия влаги
	«Беречь от солнечных лучей» Не допускать воздействия солнечного света Указывает, что медицинское изделие необходимо защищать от воздействия солнечного света
	«Вверх» Указывает правильное вертикальное положение груза
	«Диапазон влажности» Указывает диапазон влажности, в пределах которого медицинское изделие надежно сохраняется
	«Ограничение атмосферного давления» Указывает значения атмосферного давления, в пределах которых медицинское изделие надежно сохраняется
	Максимальное количество одинаковых грузов, которое можно штабелировать один на другой, где n-предельное количество ярусов

Маркировка на транспортной упаковке

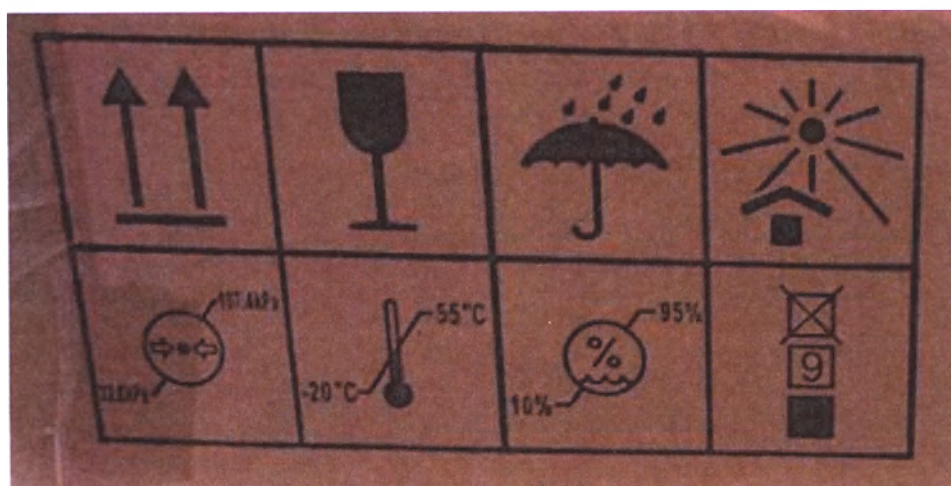

Макет стикера на транспортную упаковку

Насос шприцевой HP-30, с принадлежностями:



MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТРЕЙД СПБ»

Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург, пр-т Московский, 79А, литер А, 3Н, 4Н, пом. 123 тел./факс: Тел. 8 (343) 28-70-500, 8 (800) 775-36-85. info@cmtrade.ru

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие: № РЗН 20XX/XXXX от XX
20XX года.



: см. на упаковке.



: см. на упаковке.

Срок службы: не более 10 лет

Условия хранения и применения: см. вложенную инструкцию, только для профессионального применения.

Маркировка содержит:

Наименование изделия	
Информация о производителе	
Информация об импортере	
Срок службы	
Условия хранения	
№ регистрационного удостоверения	
NAME :	Наименование изделия
MODEL :	Модель изделия
QUANTITY :	Количество
P/N :	Заводской номер
SN	Серийный номер: технический код изделия
	Производитель (название и адрес компании)
	Дата производства (год, месяц)
EC REP	Обозначение представителя в ЕС: Включает в себя обозначение представителя в ЕС, название компании, почтовый адрес.
CE 0123	Знак соответствия CE и номер
	УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (WEEE): Этот символ используется для защиты окружающей среды, он указывает, что утилизация электрооборудования и электронного оборудования не должна проводиться как утилизация несортированных отходов, а должна проводиться отдельно.
	«Пределы температуры» Любой из видов излучения может влиять на свойства груза или изменять их (например, непроявленные пленки)
	«Хрупкое. Осторожно.» Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом
	«Беречь от влаги» Необходимость защиты груза от воздействия влаги
	«Беречь от солнечных лучей» Не допускать воздействия солнечного света Указывает, что медицинское изделие необходимо защищать от воздействия солнечного света
	«Вверх» Указывает правильное вертикальное положение груза
	«Диапазон влажности» Указывает диапазон влажности, в пределах которого медицинское изделие надежно сохраняется
	«Ограничение атмосферного давления» Указывает значения атмосферного давления, в пределах которых медицинское изделие надежно сохраняется
	Максимальное количество одинаковых грузов, которое можно штабелировать один на другой, где n-предельное количество ярусов

4. Транспортная упаковка:

Основной блок НР-30 помещается в амортизирующий материал (вспененный полиэтилен) и укладывается в картонную коробку.

Принадлежности упаковываются в полиэтиленовый пакет и помещаются в картонную коробку.

Коробка с основным блоком и коробка с принадлежностями упаковывается в картонный короб.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 11
_____ листах



«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «МЕДТРЕЙД СПБ»

Н.С. Рогач

2021 г.



**Фотографическое изображение
общего вида медицинского изделия**

Наименование медицинского изделия: Насос шприцевой НР-30 с принадлежностями


Производитель: MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

I. Состав:


1. Основной блок HP-30




2. Сетевой кабель

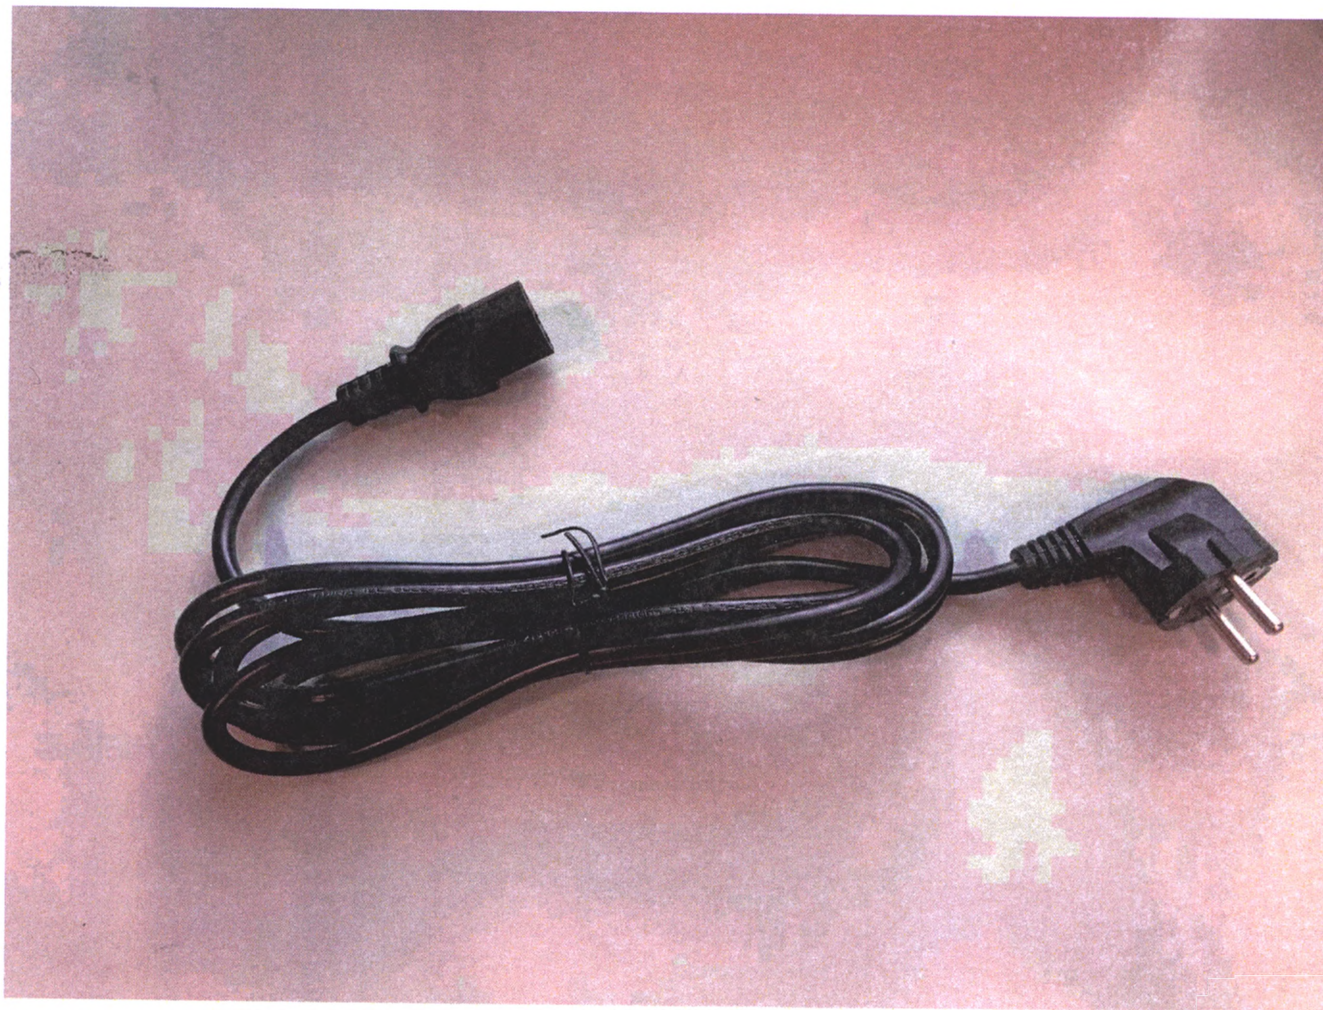

3. Зажим для крепления к стойке

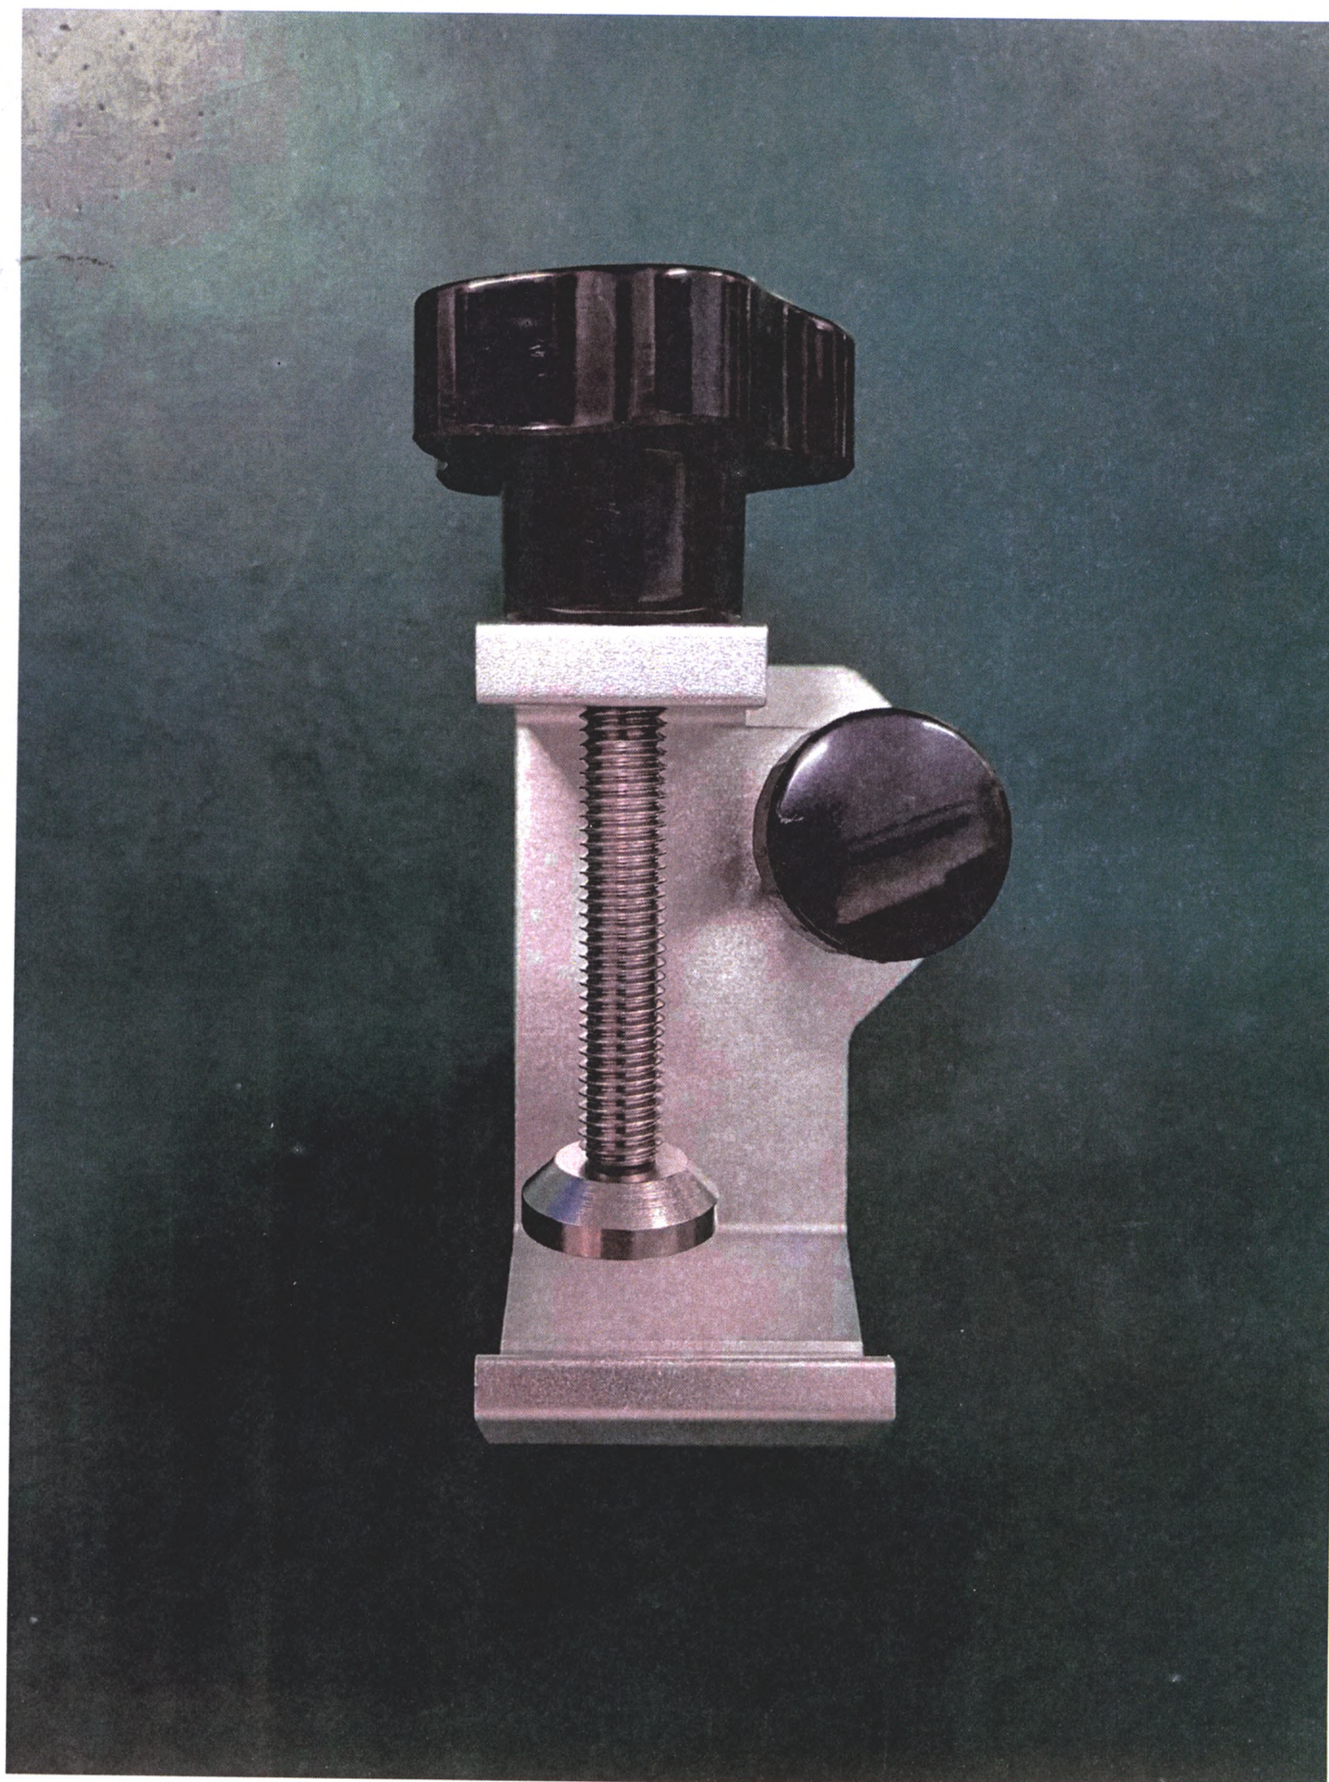


4. Рукоятка

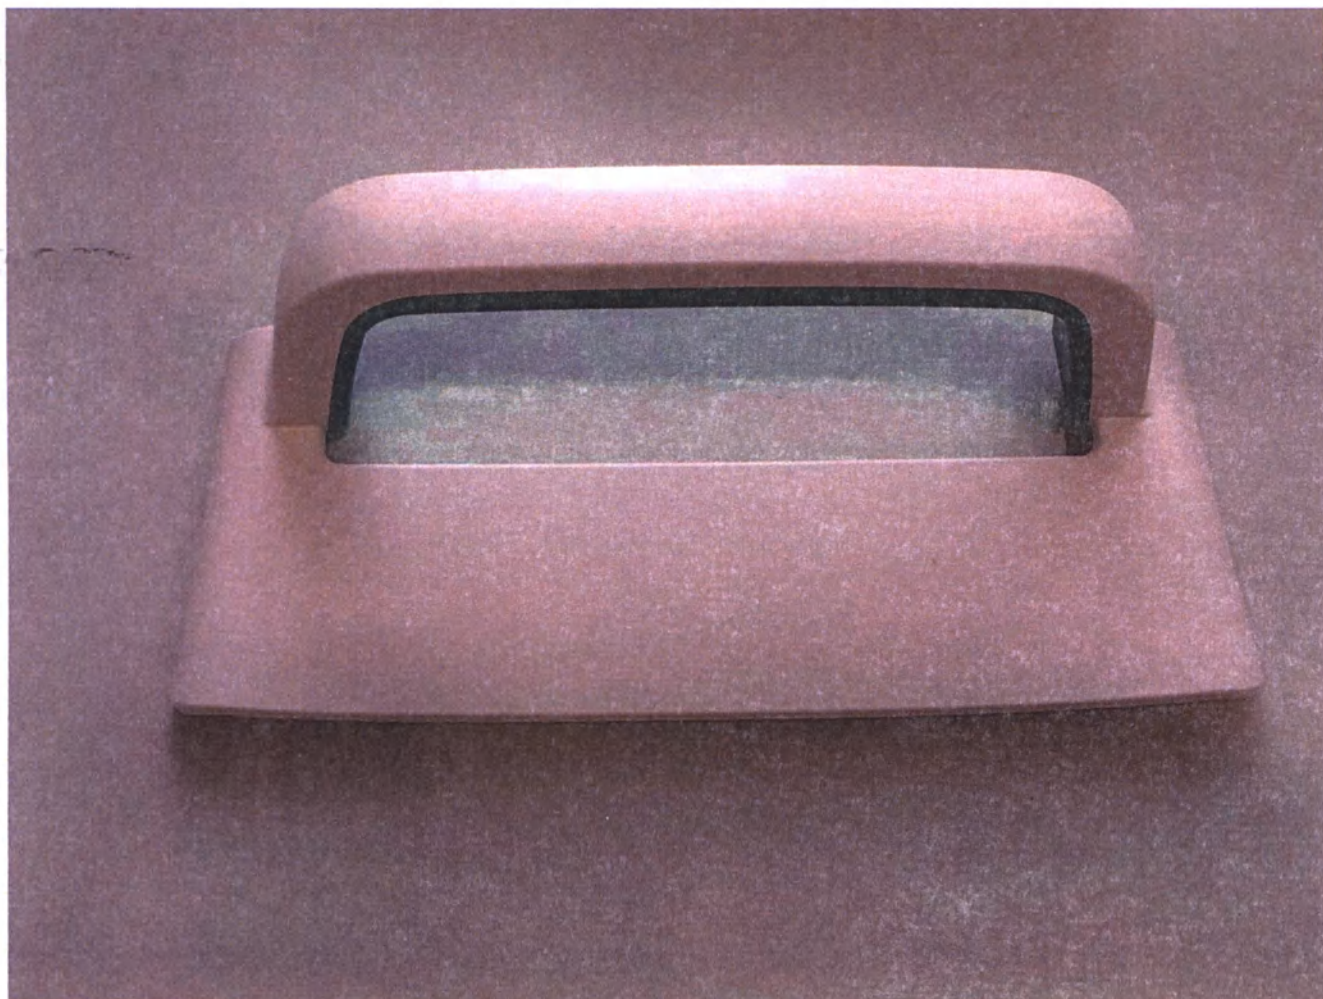

- 5. Встроенный Wi-Fi модуль (при необходимости)
- 6. Встроенный аккумулятор литиевой

7. Блокирующее устройство

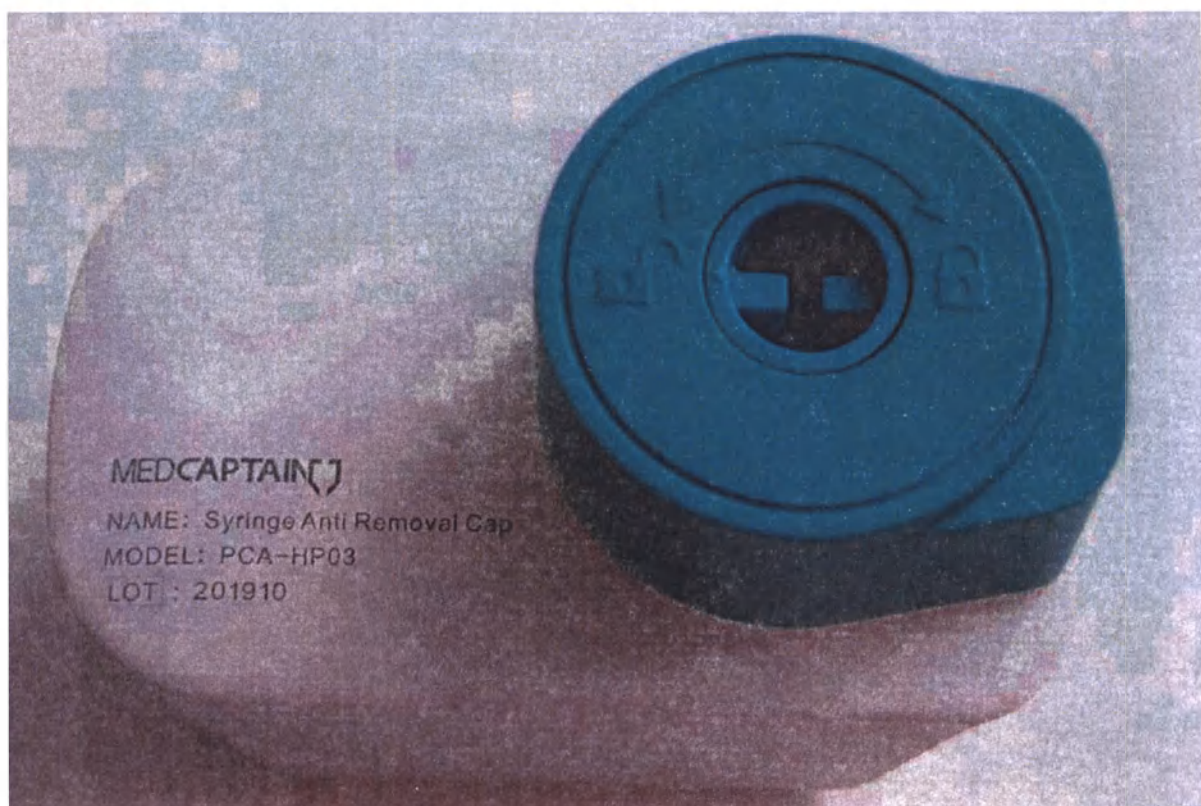

8. Ключ для блокирующего устройства



9. Руководство по эксплуатации


10. Краткое руководство по эксплуатации

II. Принадлежности

1. Устройство для вызова медсестры.



2.Контроллер PCA

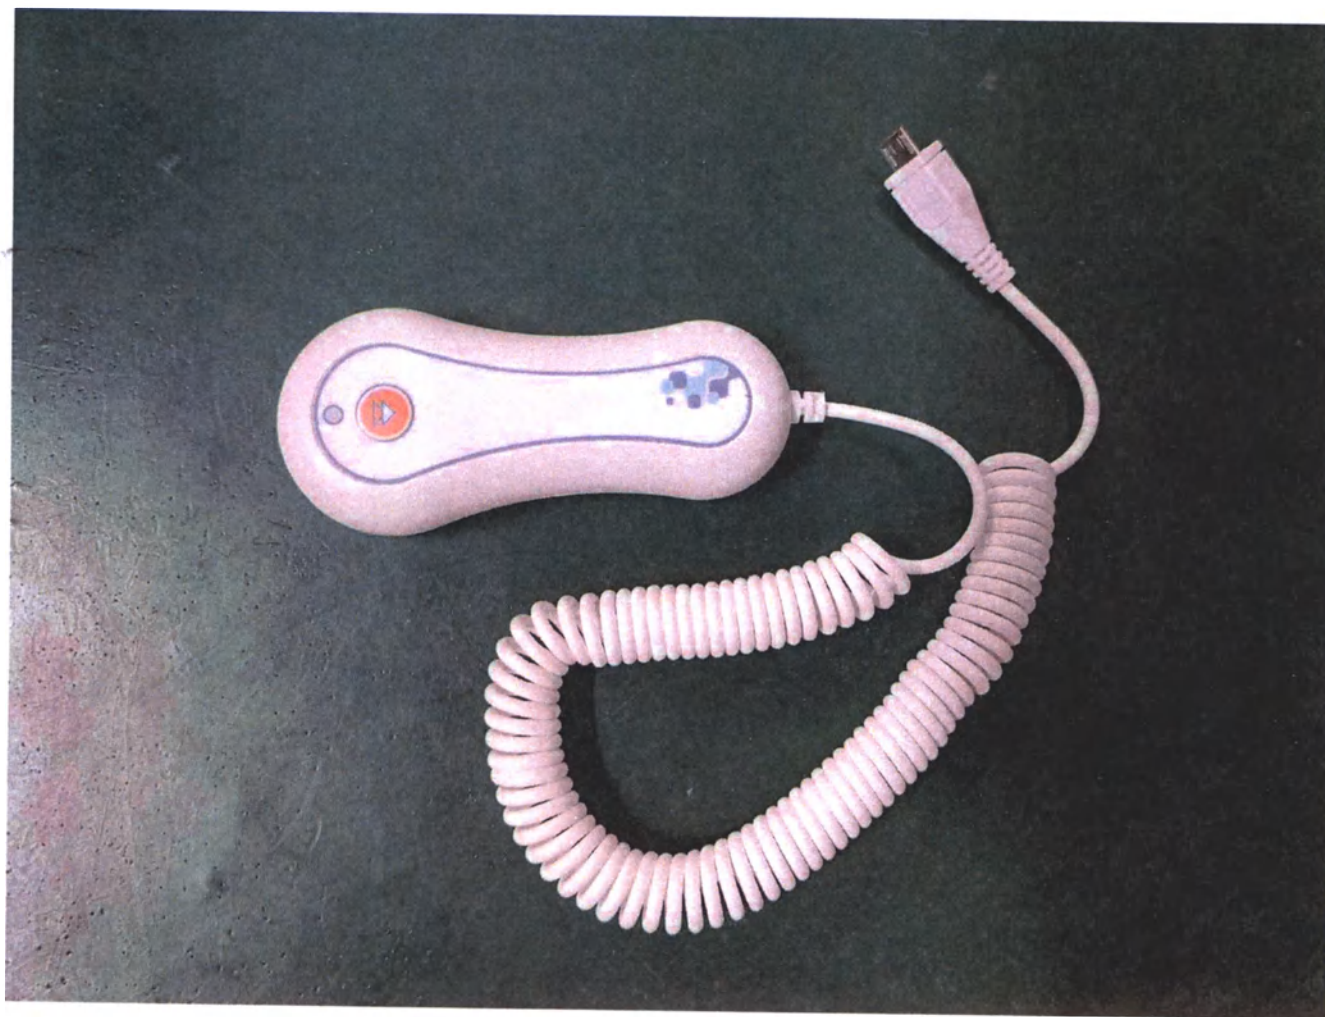

3. Сканер штрих-кода.



Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 9

_____ листах

