

Фотографии медицинского изделия
Аппарат универсальный рентгенографический
диагностический
Р-600 «Униарм-Флюорограф-Плюс»
производства ООО «ВКО Медпром», Россия




МЕДПРОМ


**АППАРАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ Р-600
«УНИАРМ-ФЛЮОРОГРАФ-ПЛЮС» ИСПОЛНЕНИЕ 1**

ПРОИЗВОДСТВА ООО «ВКО МЕДПРОМ», РОССИЯ


Процедурная:

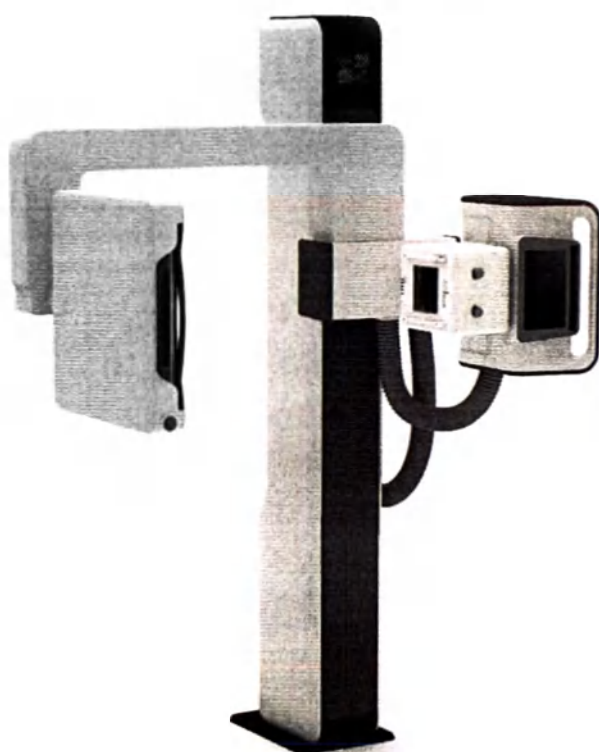

**Штатив с поворотным
кронштейном**

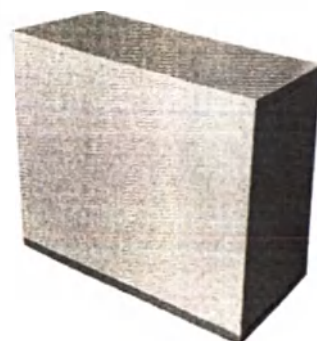

РПУ

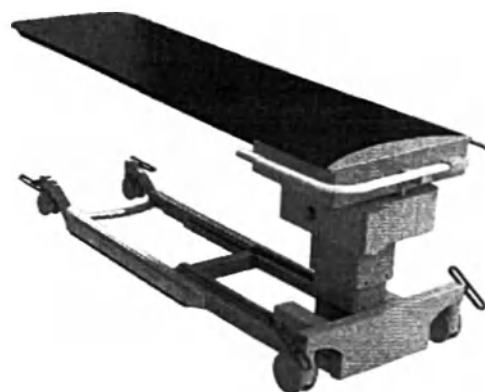

Стол-каталка

Пультовая:



АРМ оператора




МЕДПРОМ


**АППАРАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ Р-600
«УНИАРМ-ФЛЮОРОГРАФ-ПЛЮС» ИСПОЛНЕНИЕ 2**

ПРОИЗВОДСТВА ООО «ВКО МЕДПРОМ», РОССИЯ


Процедурная:

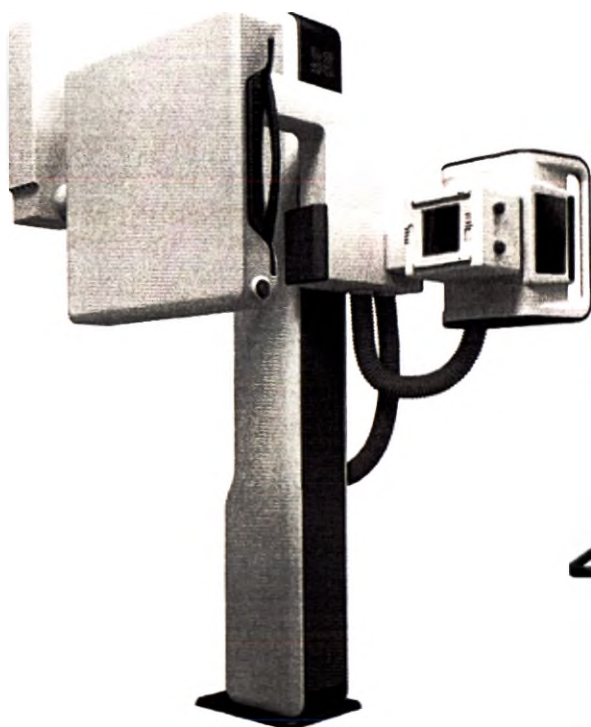

**Штатив с поворотным
кронштейном**

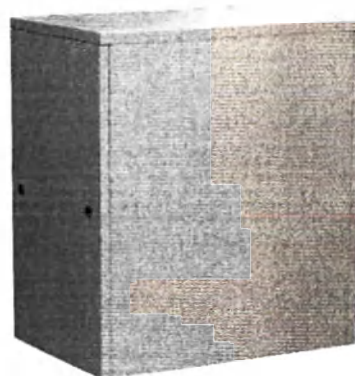

РПУ

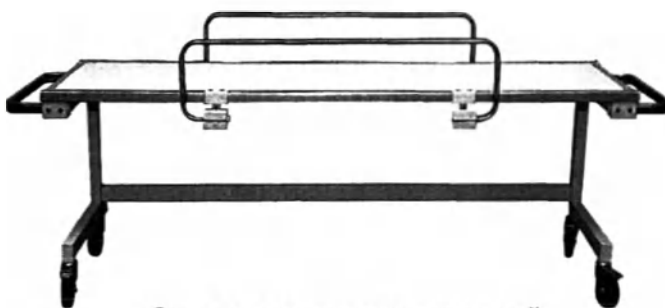

Стол пациента передвижной

Пультовая:



АРМ оператора




МЕДПРОМ

**АППАРАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ Р-600
«УНИАРМ-ФЛЮОРОГРАФ-ПЛЮС» ИСПОЛНЕНИЕ 3**

ПРОИЗВОДСТВА ООО «ВКО МЕДПРОМ», РОССИЯ

Процедурная:

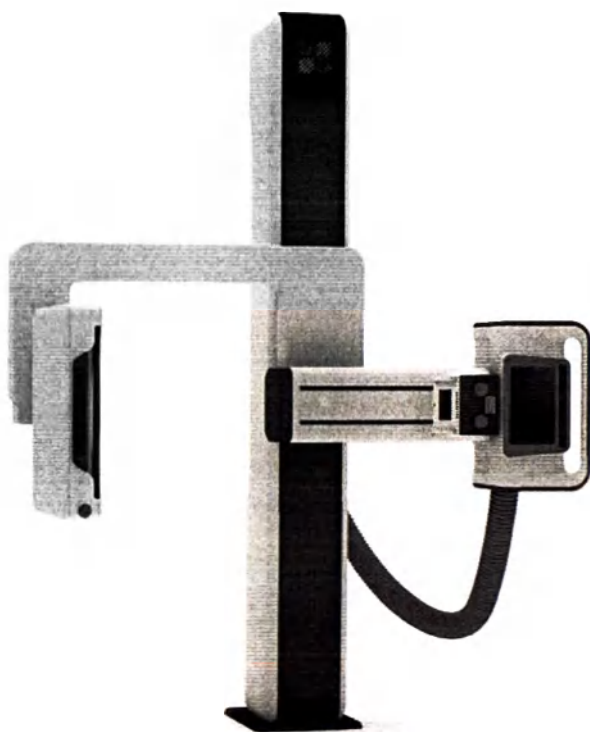

**Штатив с поворотным
кронштейном**




РПУ



**Рентгенопрозрачный стол-каталка
серии Prognost**

Пультная:

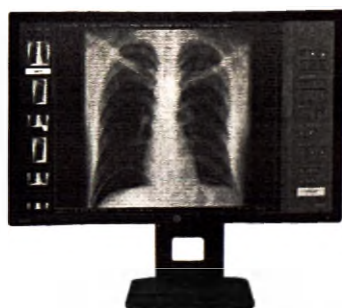

АРМ оператора




МЕДПРОМ

**АППАРАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ Р-600
«УНИАРМ-ФЛЮОРОГРАФ-ПЛЮС» ИСПОЛНЕНИЕ 4**

ПРОИЗВОДСТВА ООО «ВКО МЕДПРОМ», РОССИЯ

Процедурная:

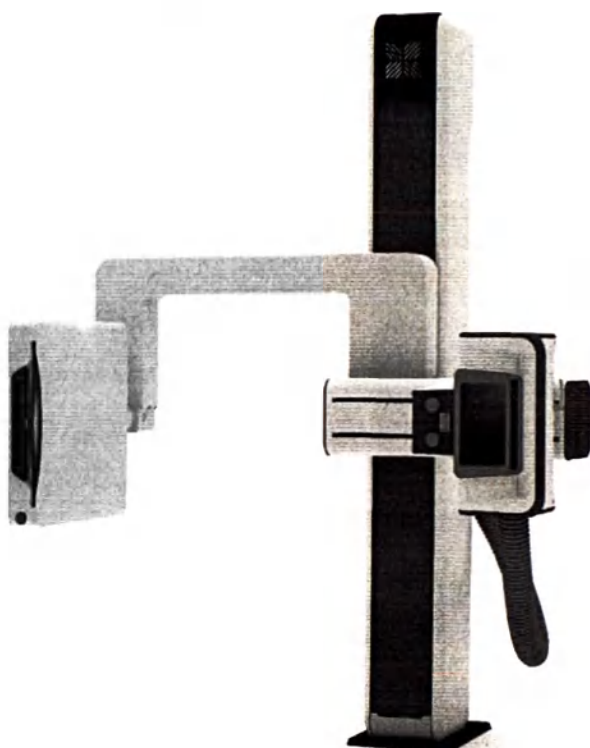

**Штатив с поворотным
кронштейном**



РПУ



**Рентгенопрозрачный
стол-каталка X Mobile**

Пультная:




АРМ оператора


**АППАРАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ Р-600
«УНИАРМ-ФЛЮОРОГРАФ-ПЛЮС» ИСПОЛНЕНИЕ 5**

ПРОИЗВОДСТВА ООО «ВКО МЕДПРОМ», РОССИЯ

Процедурная:

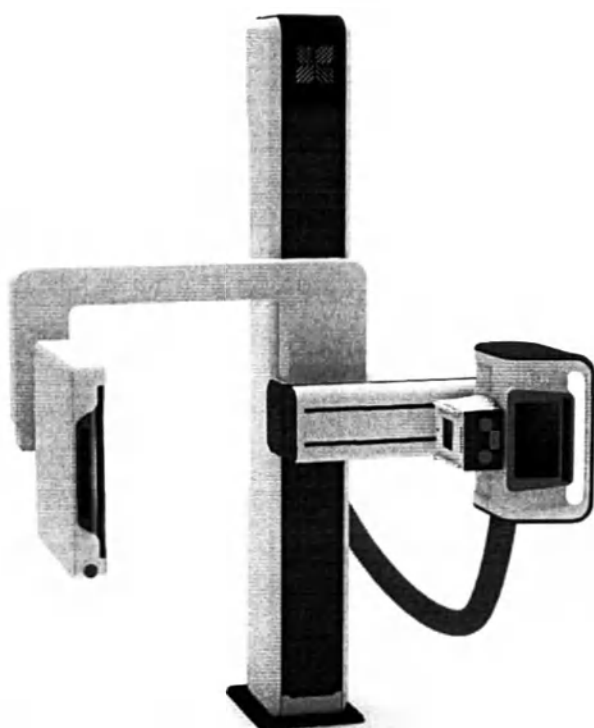

**Штатив с поворотным
кронштейном**

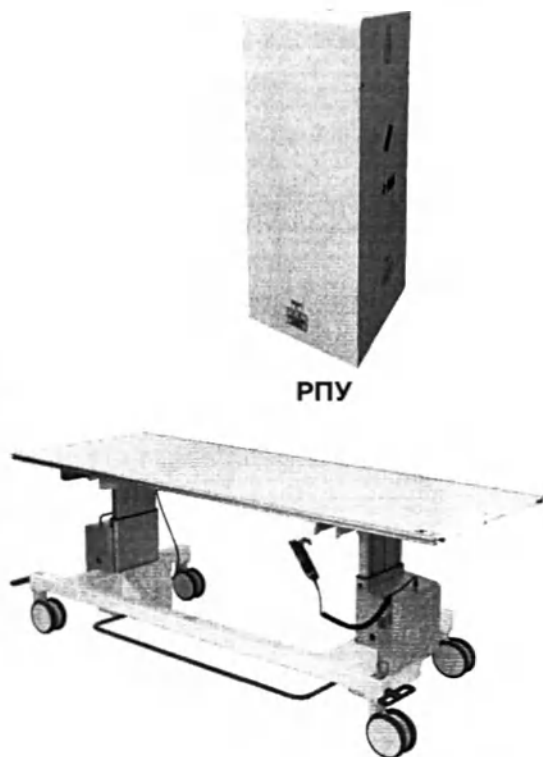

**Рентгенопрозрачный стол-каталка
серии Prognost**

Пультовая:



АРМ оператора

**АППАРАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ Р-600
«УНИАРМ-ФЛЮОРОГРАФ-ПЛЮС» ИСПОЛНЕНИЕ 6**

ПРОИЗВОДСТВА ООО «ВКО МЕДПРОМ», РОССИЯ


Процедурная:



**Штатив с поворотным
кронштейном**



РПУ

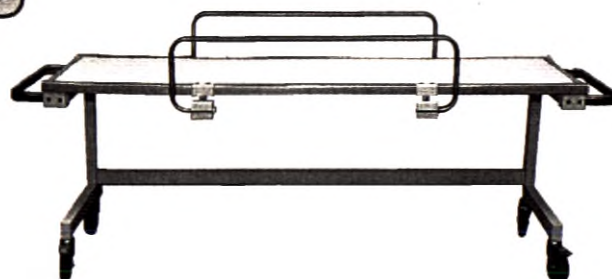


Стол пациента передвижной

Пультовая:




АРМ оператора

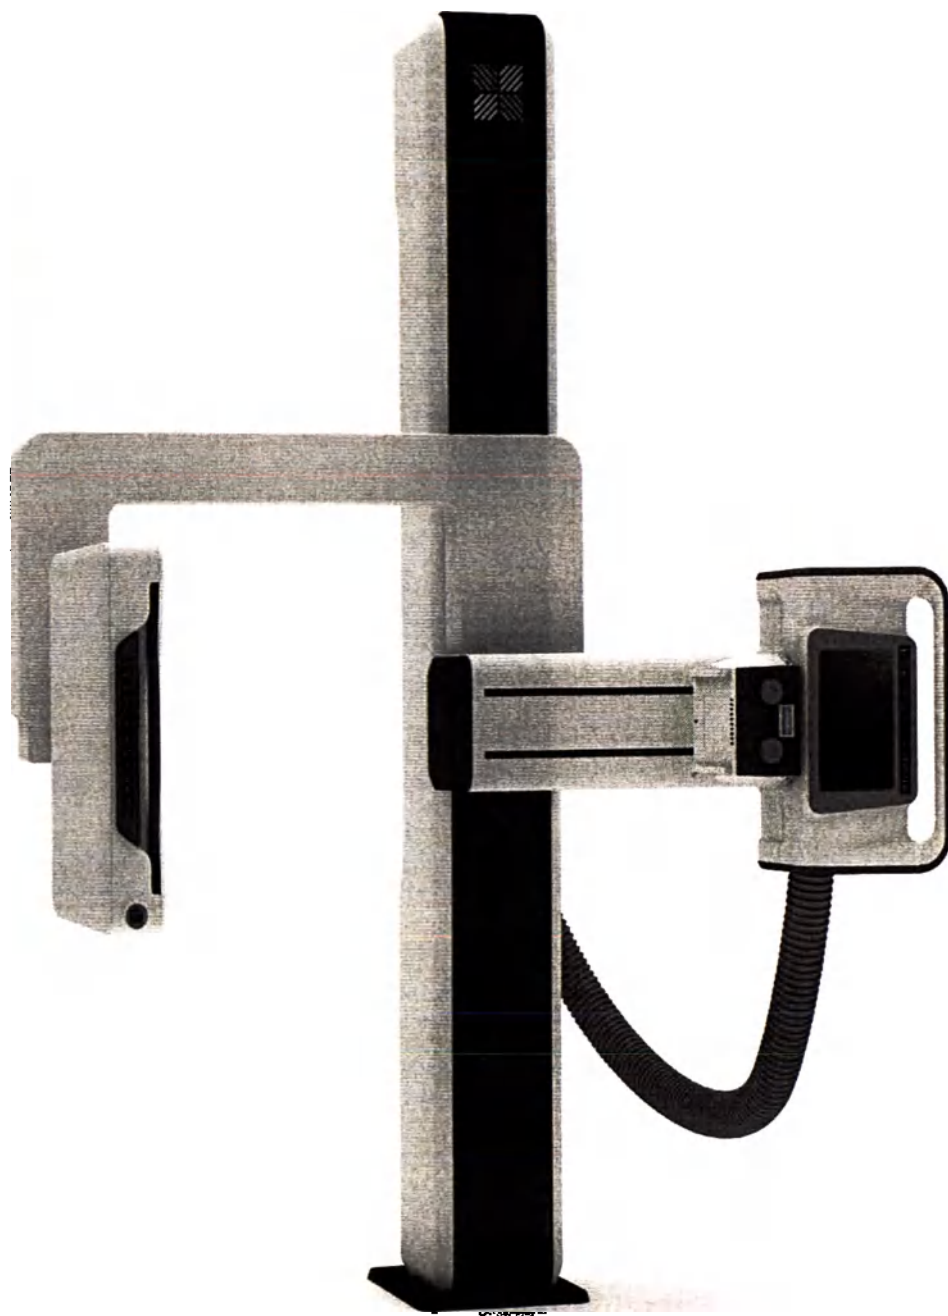


**Штатив с поворотным кронштейном Y1-B0200 по спецификации,
производства ООО «ВКО Медпром», Россия**




Штатив с поворотным кронштейном Y1-B0300 по спецификации,
производства ООО «ВКО Медпром», Россия

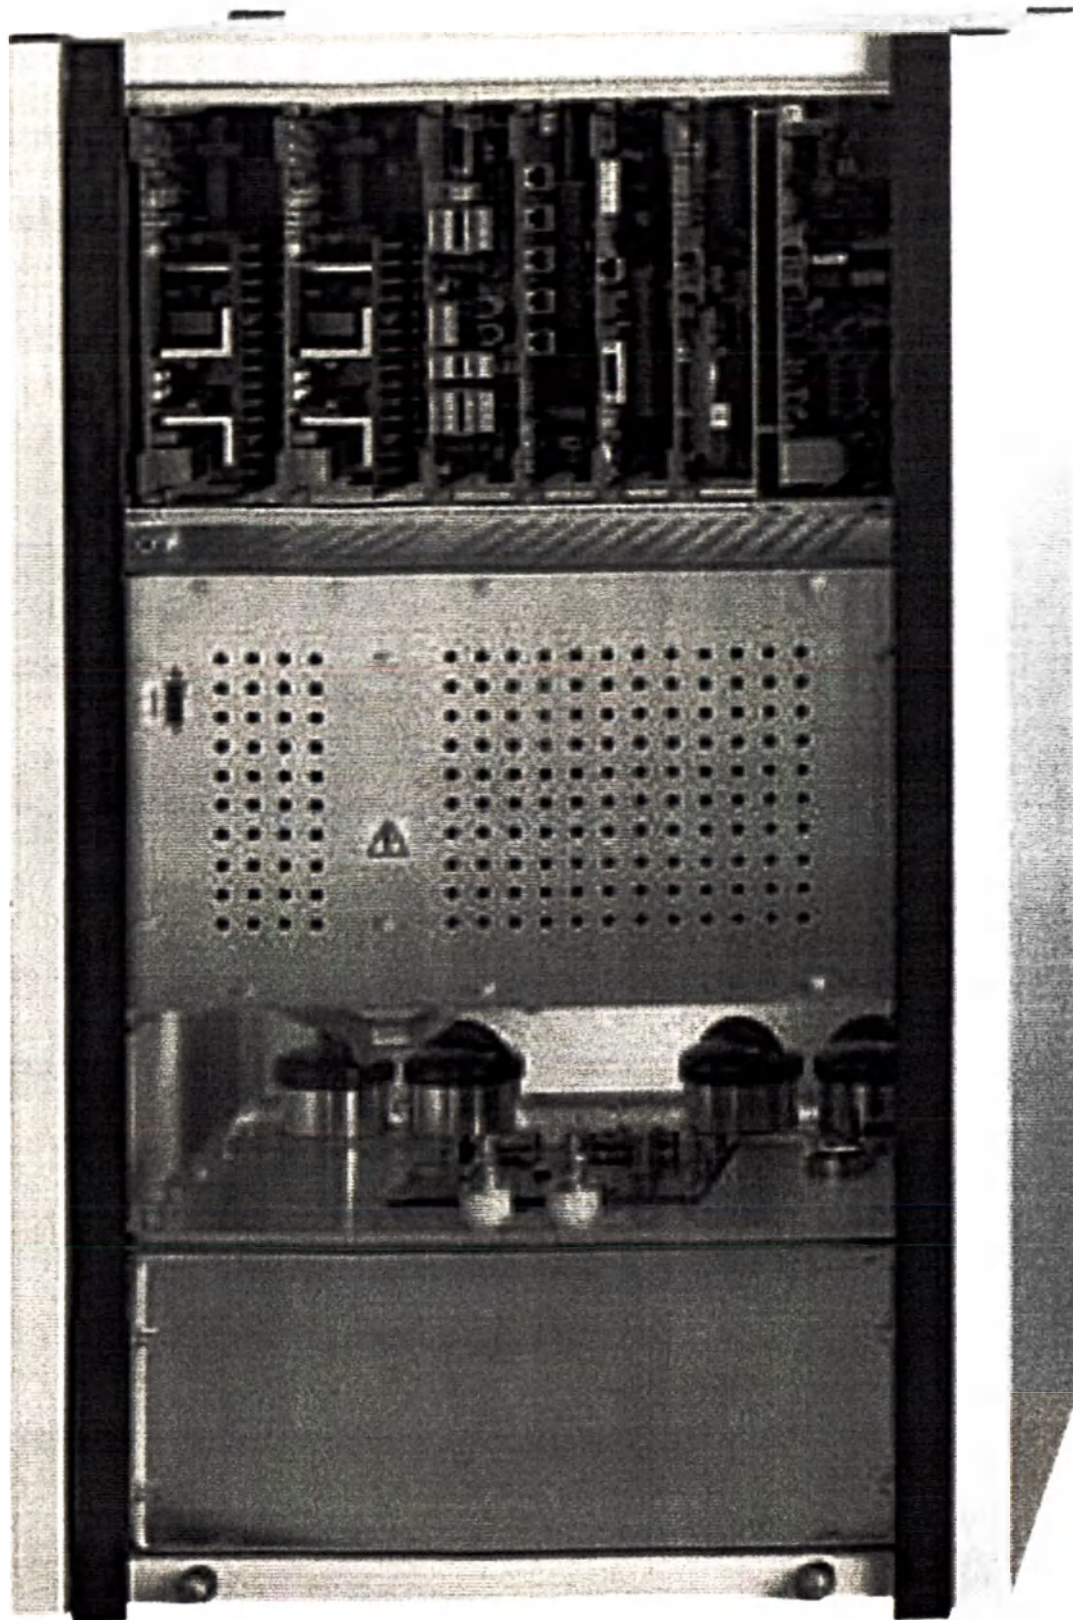


Рентгеновское питающее устройство (РПУ) серии ZR75PN50 или серии ZR75PN65 или серии ZR75PN80, производства Spellman, США или Spellman High Voltage Electronics GmbH, Германия или Spellman High Voltage Electronics (SIP) Co., Ltd, Китай

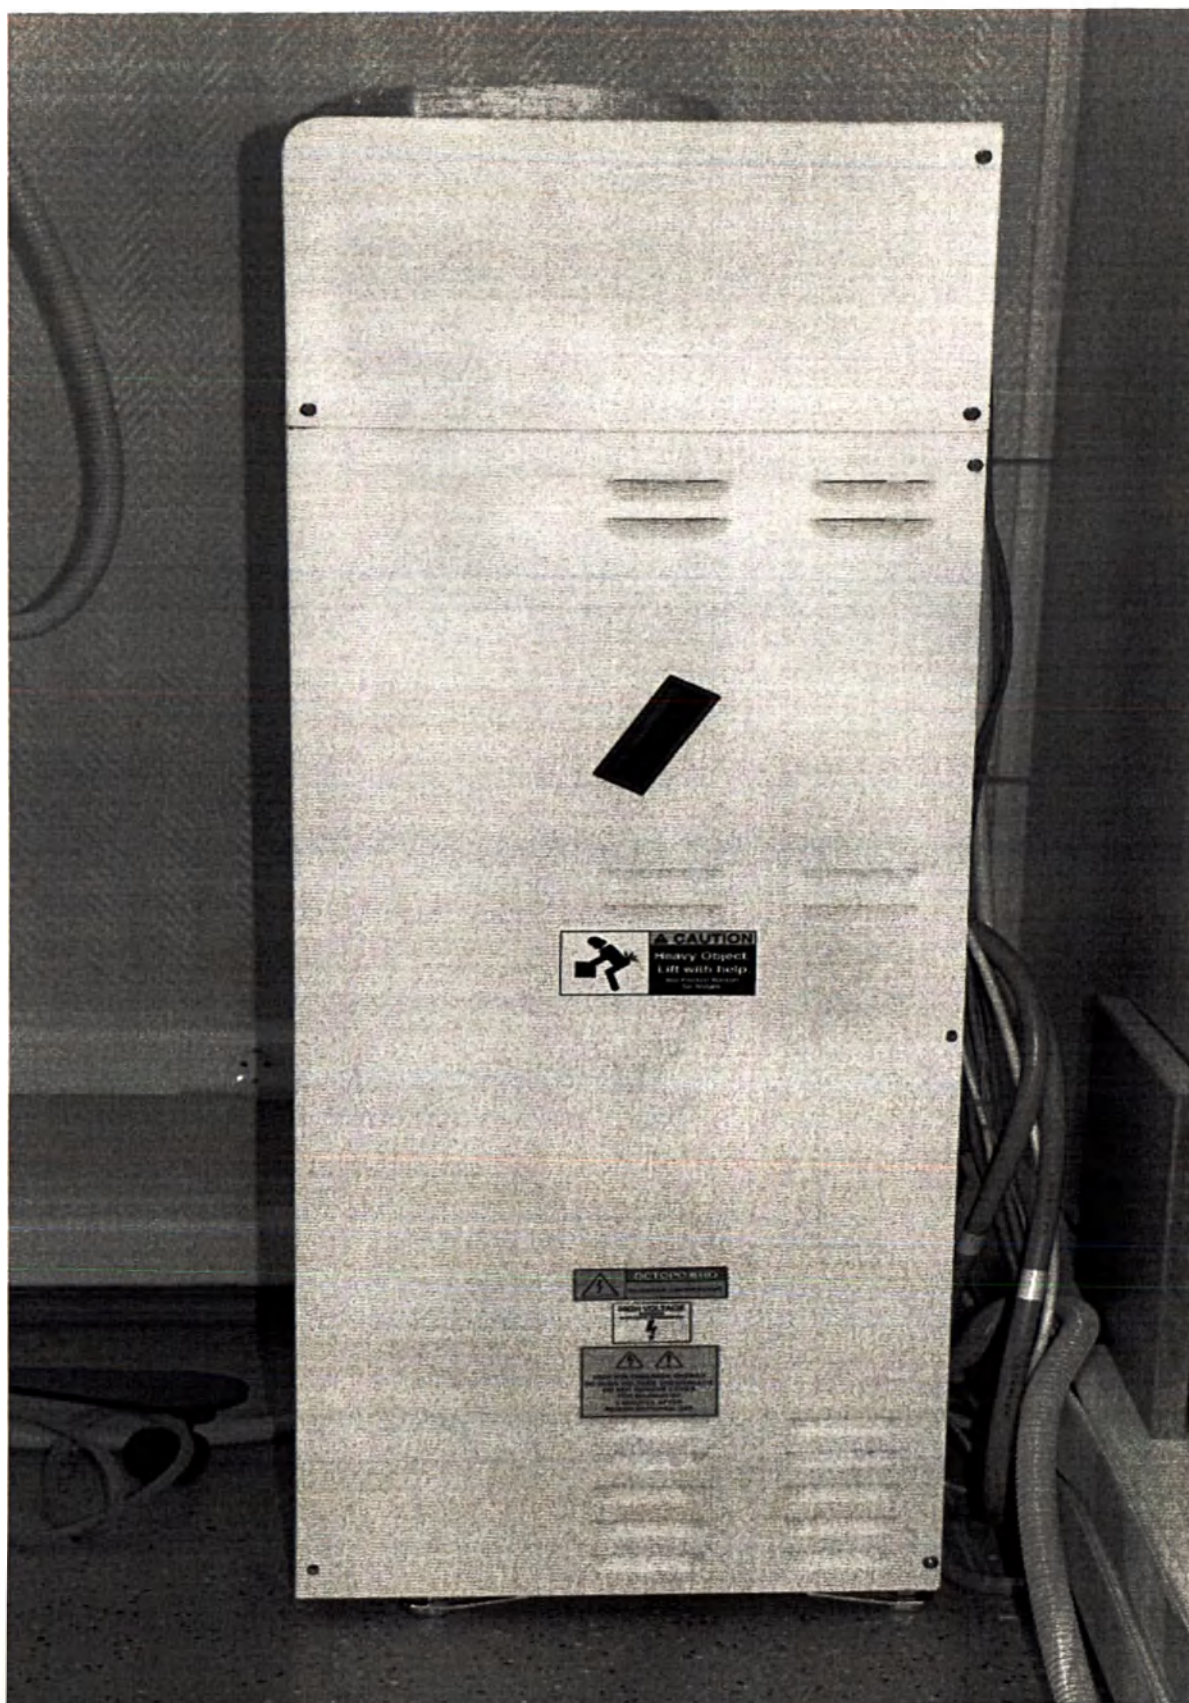

Рентгеновское питающее устройство (РПУ) серии CMP 200 или INDICO IQ 50 kW или INDICO IQ 65 kW или INDICO IQ 80 kW, производства Communications & Power Industries Canada Inc., Канада

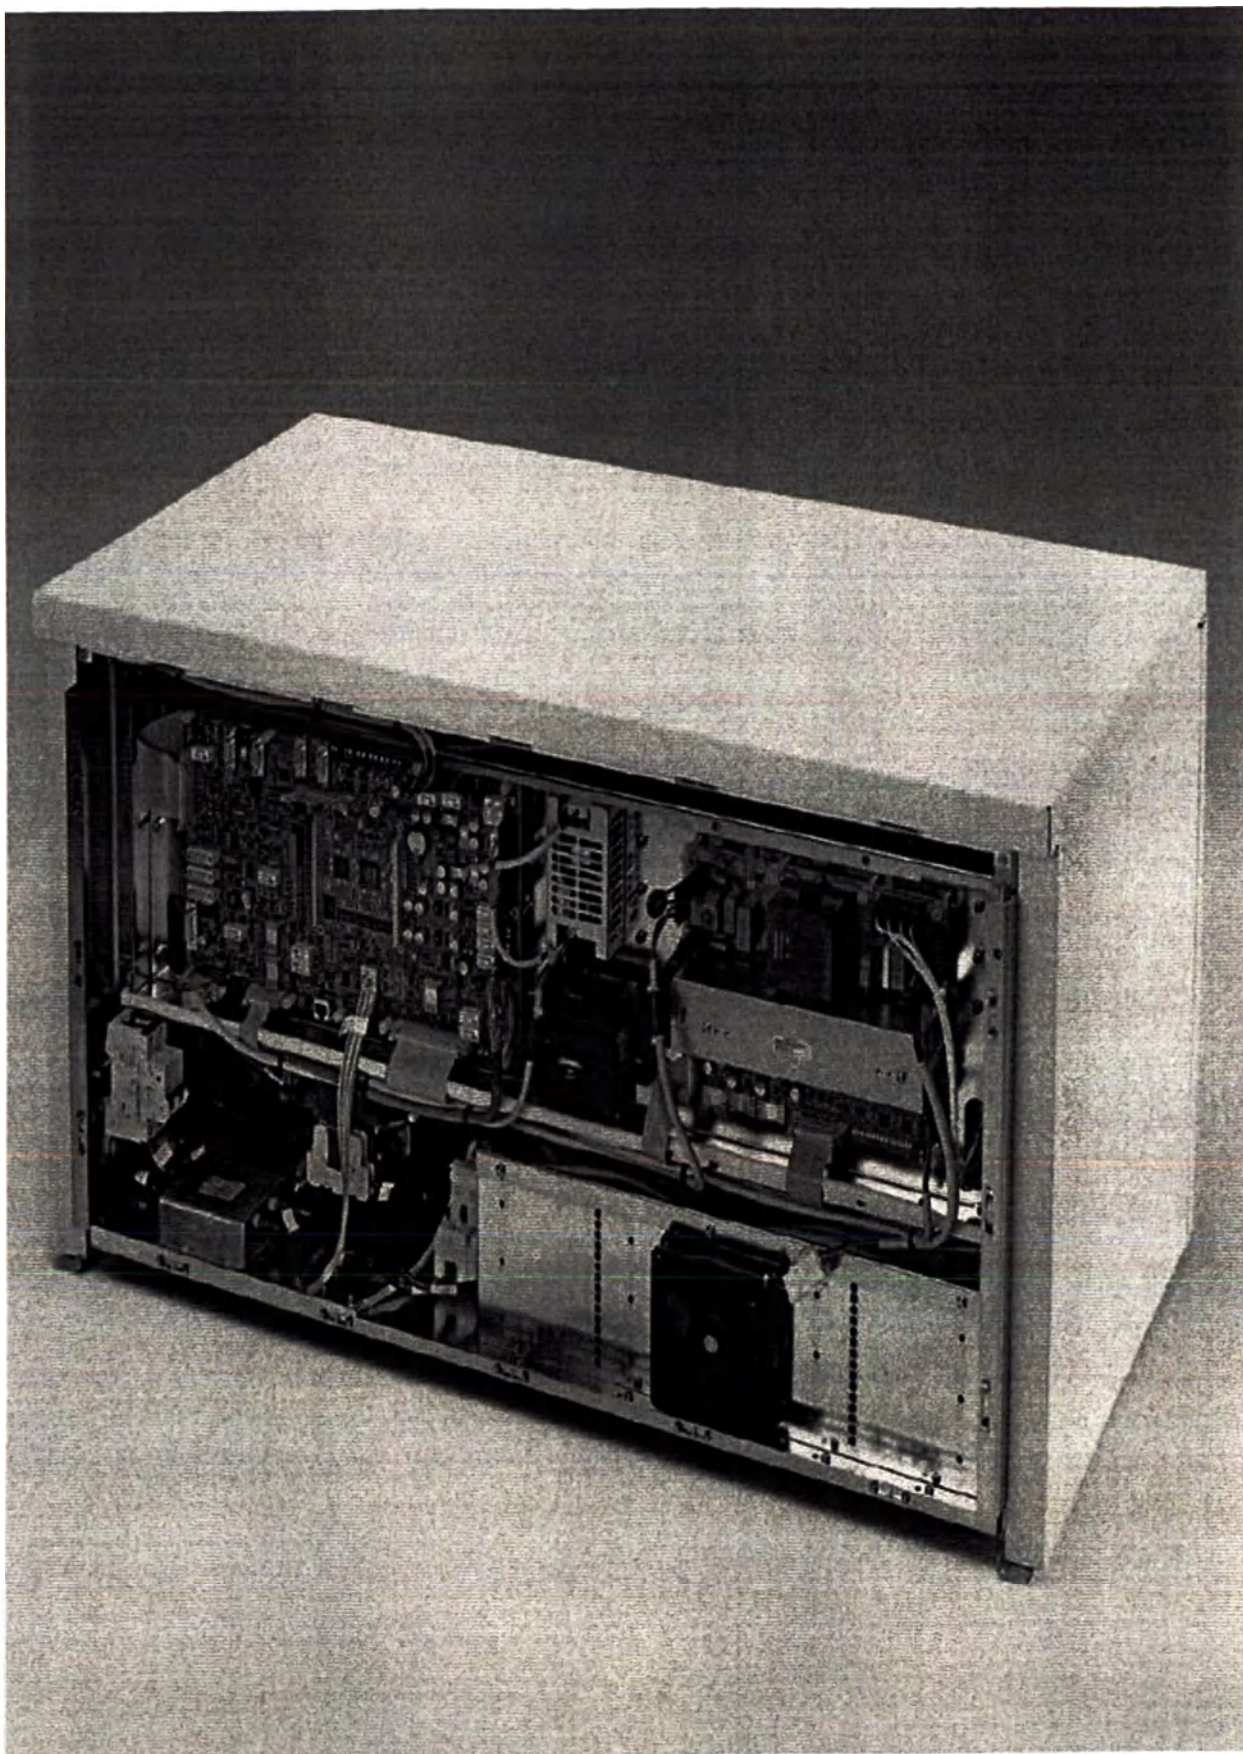


Рентгеновское питающее устройство (РПУ) Polydoros RF 80 55kW или Polydoros RF 80 65kW или Polydoros RF 80 80kW, производства Siemens, Германия

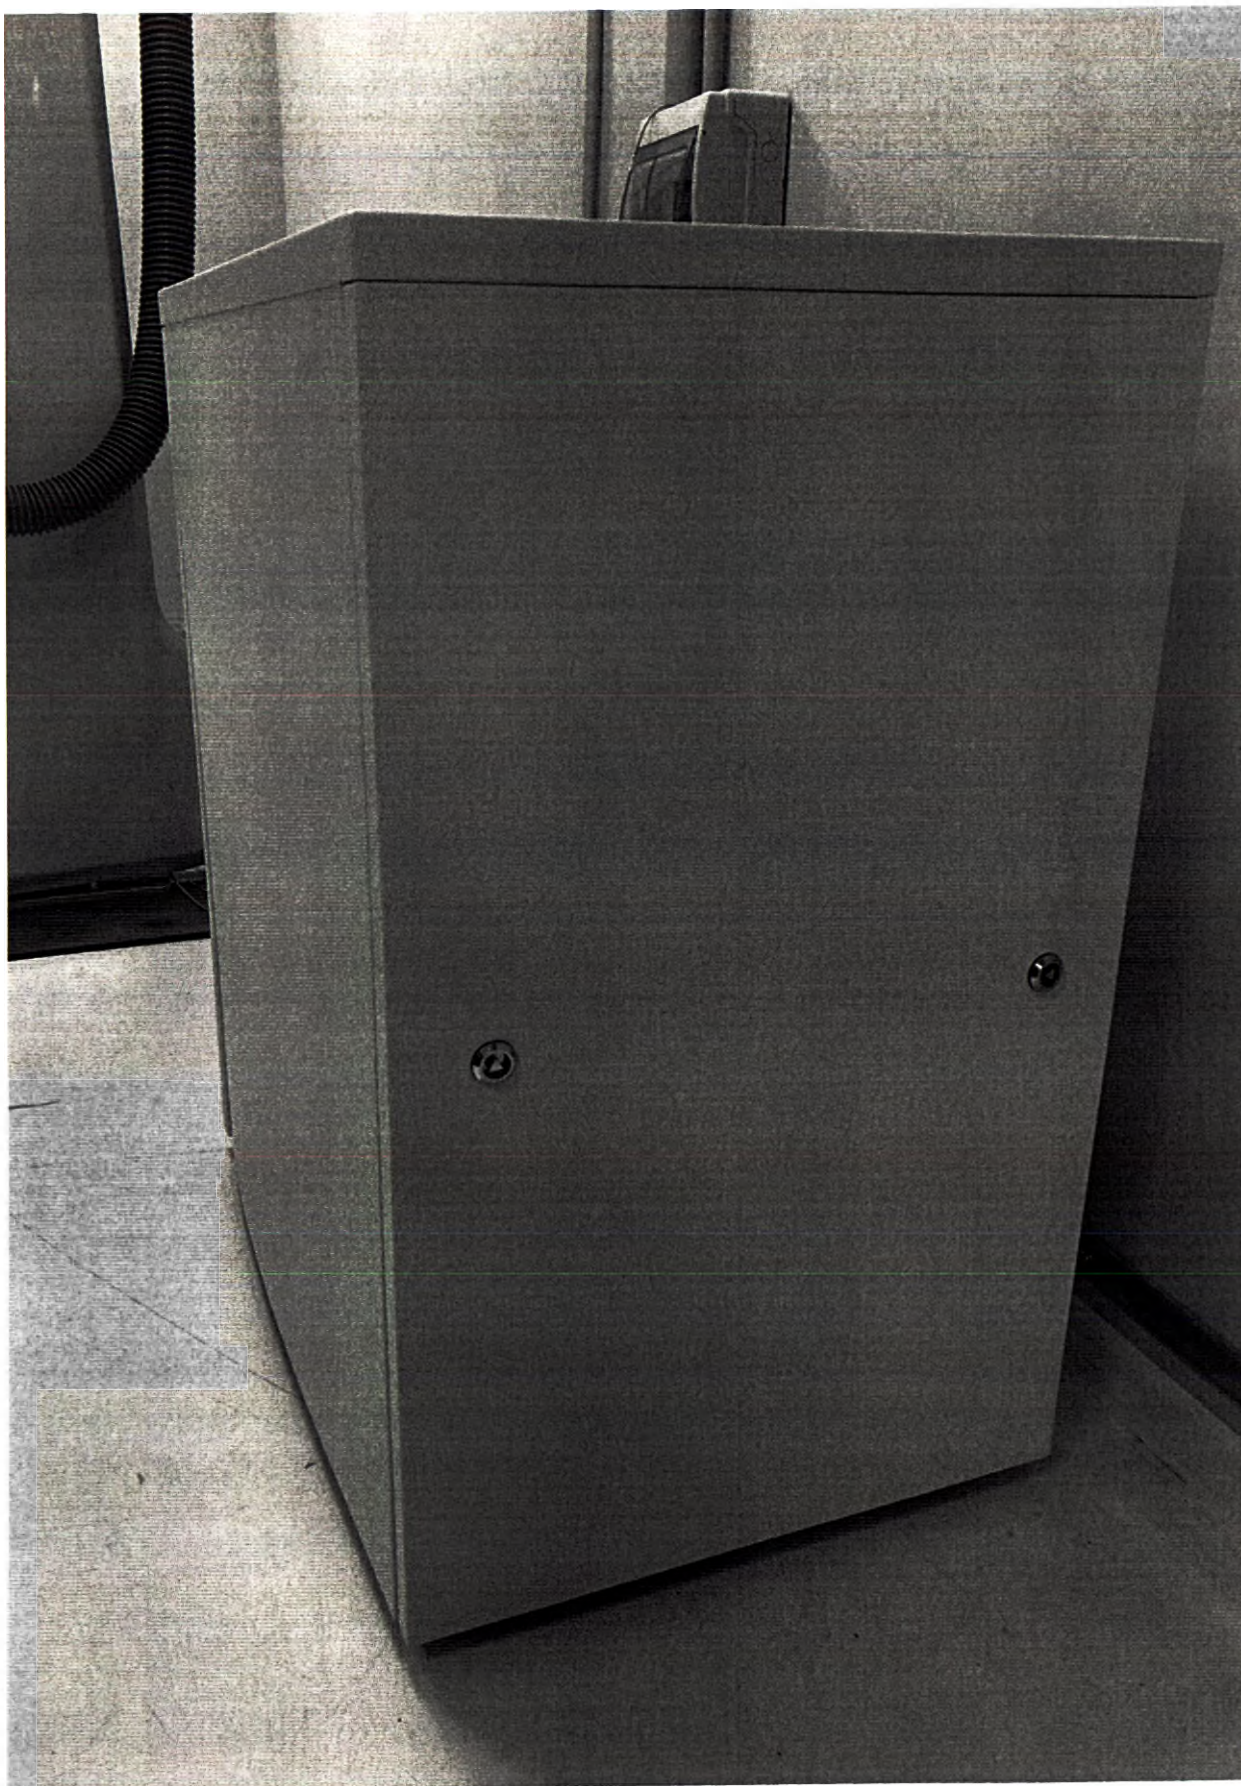


Рентгеновское питающее устройство (РПУ) X1-B0600 или X1-B0700 или X1-B0800, производства ООО «ВКО Медпром», Россия




Комплект (пара) кабелей высоковольтных с наконечниками
производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex
Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation,
Филиппины или Varex Imaging Corporation, Китай или Tianjin
Wanbo Wire & Cable Co.,Ltd, Китай

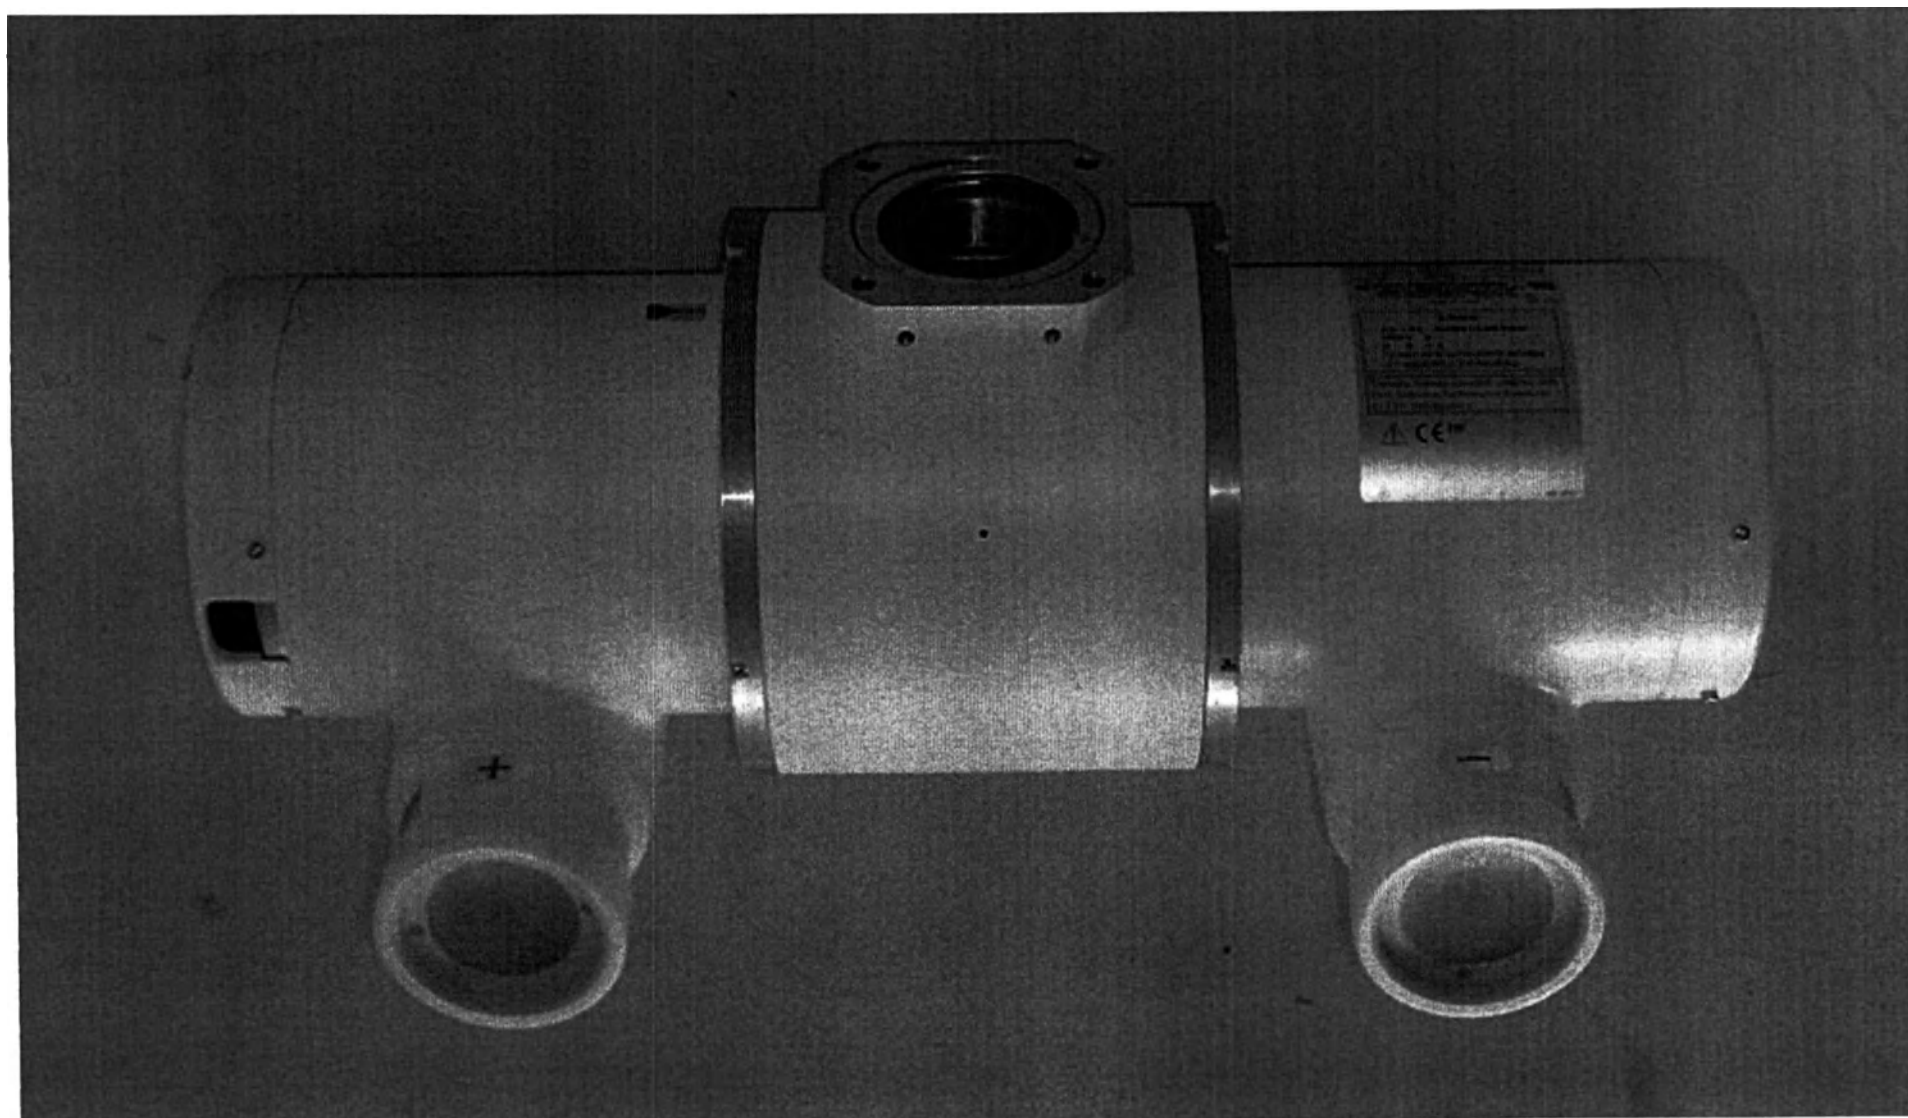


Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой E7242 или E7252 или E7864, производства Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd, Япония

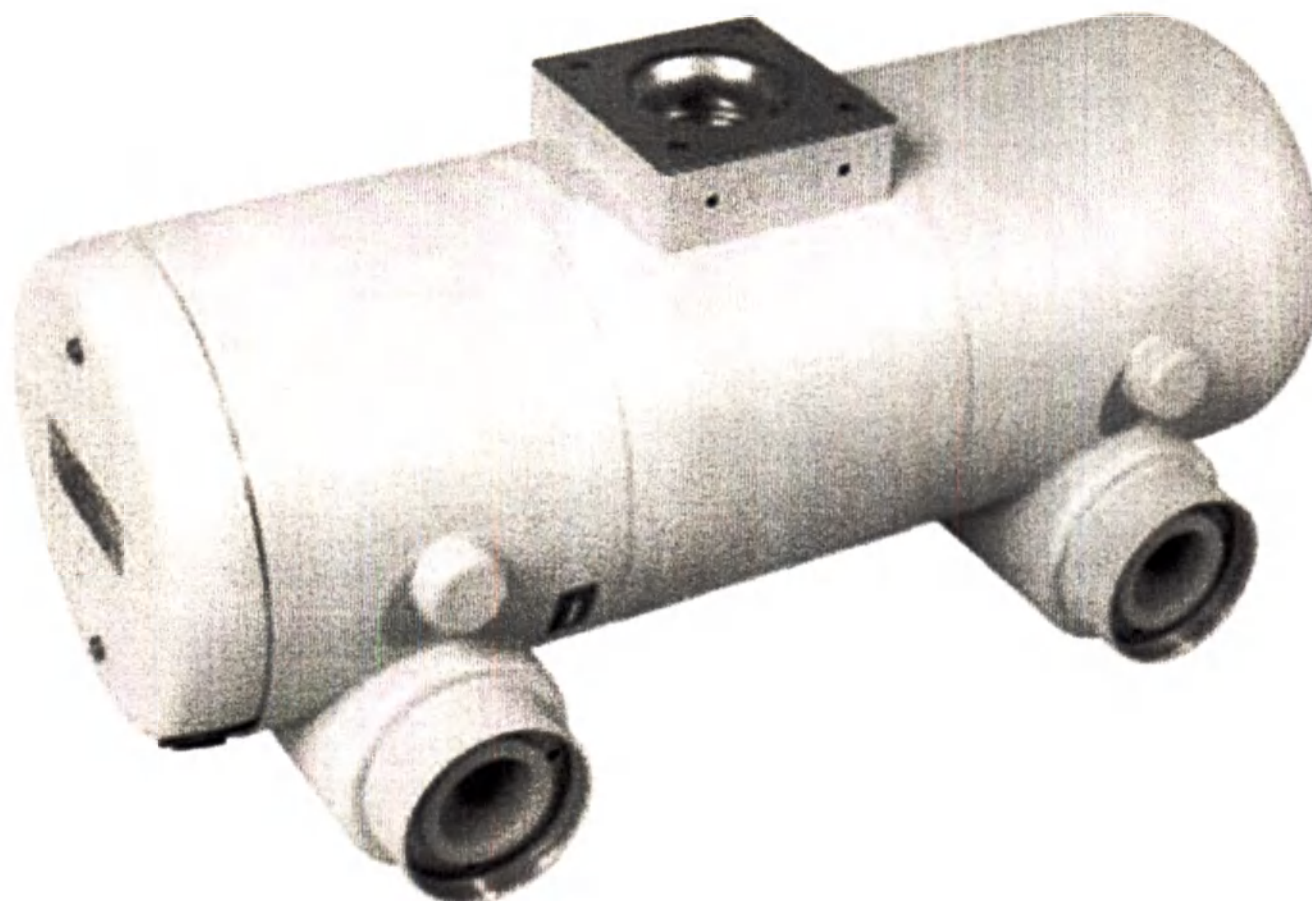

Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой А-297/В-130Н, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины

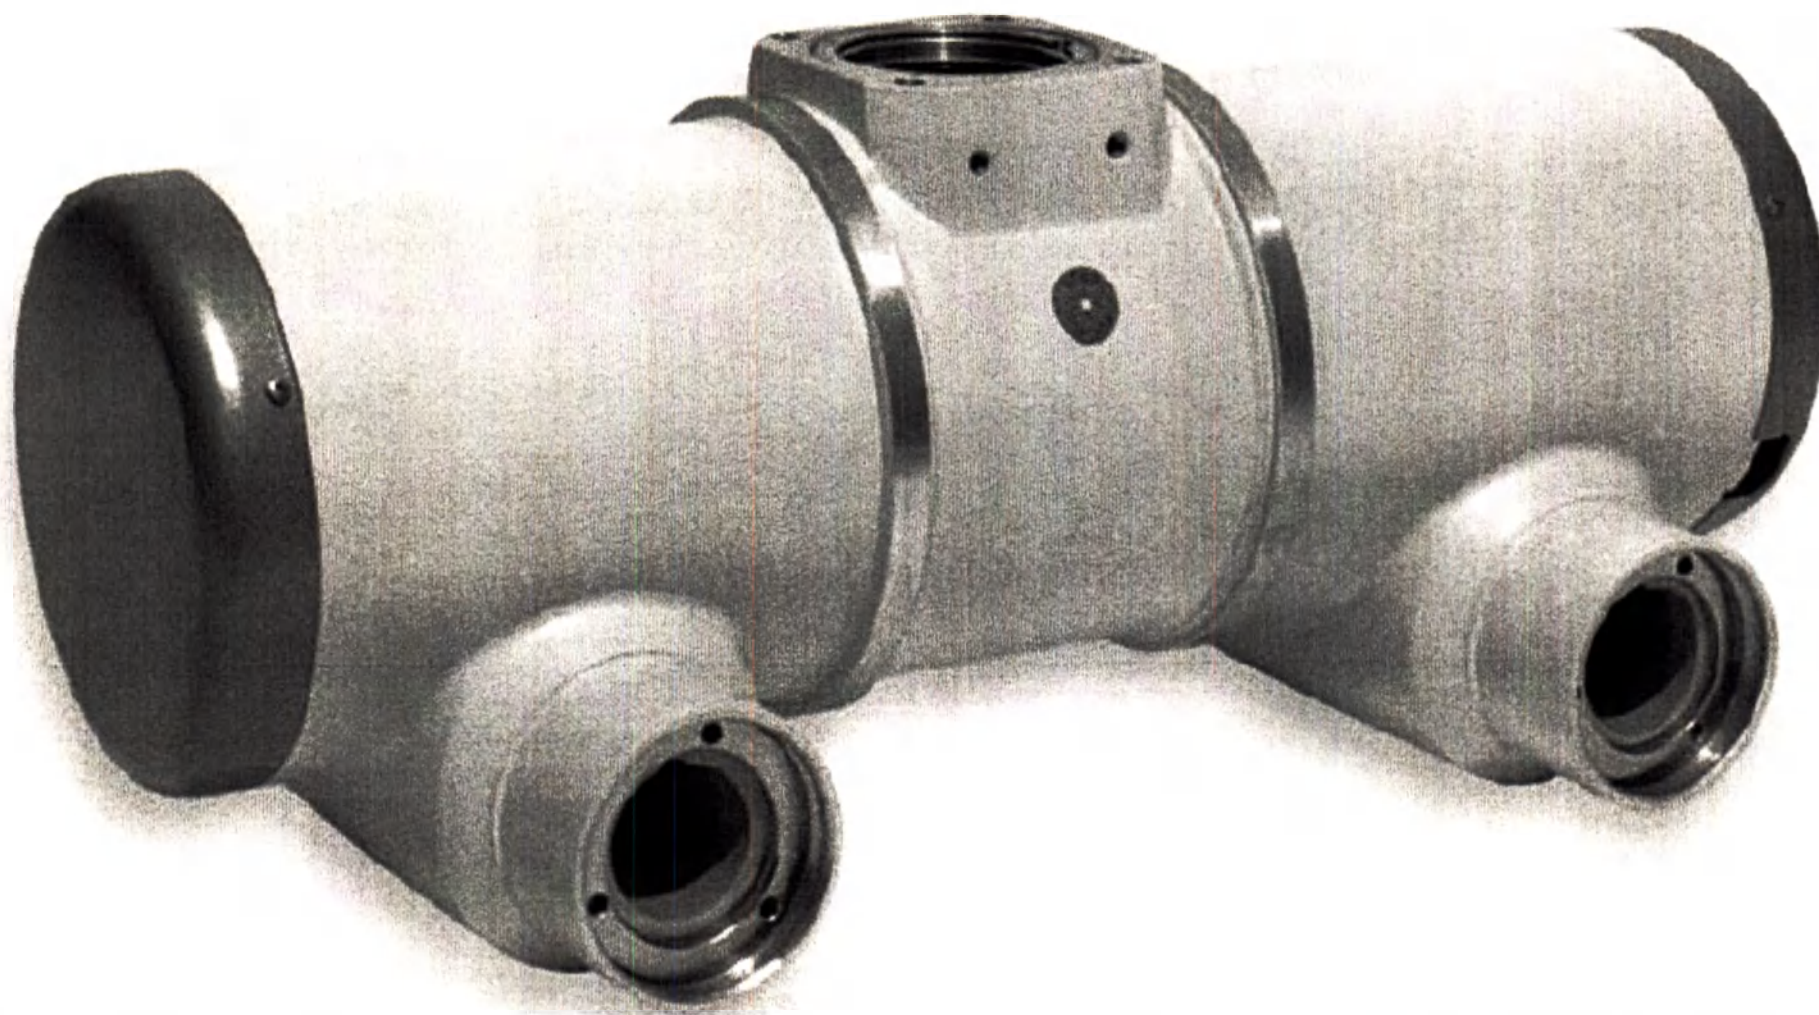

Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой RAD 14/Leo, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины

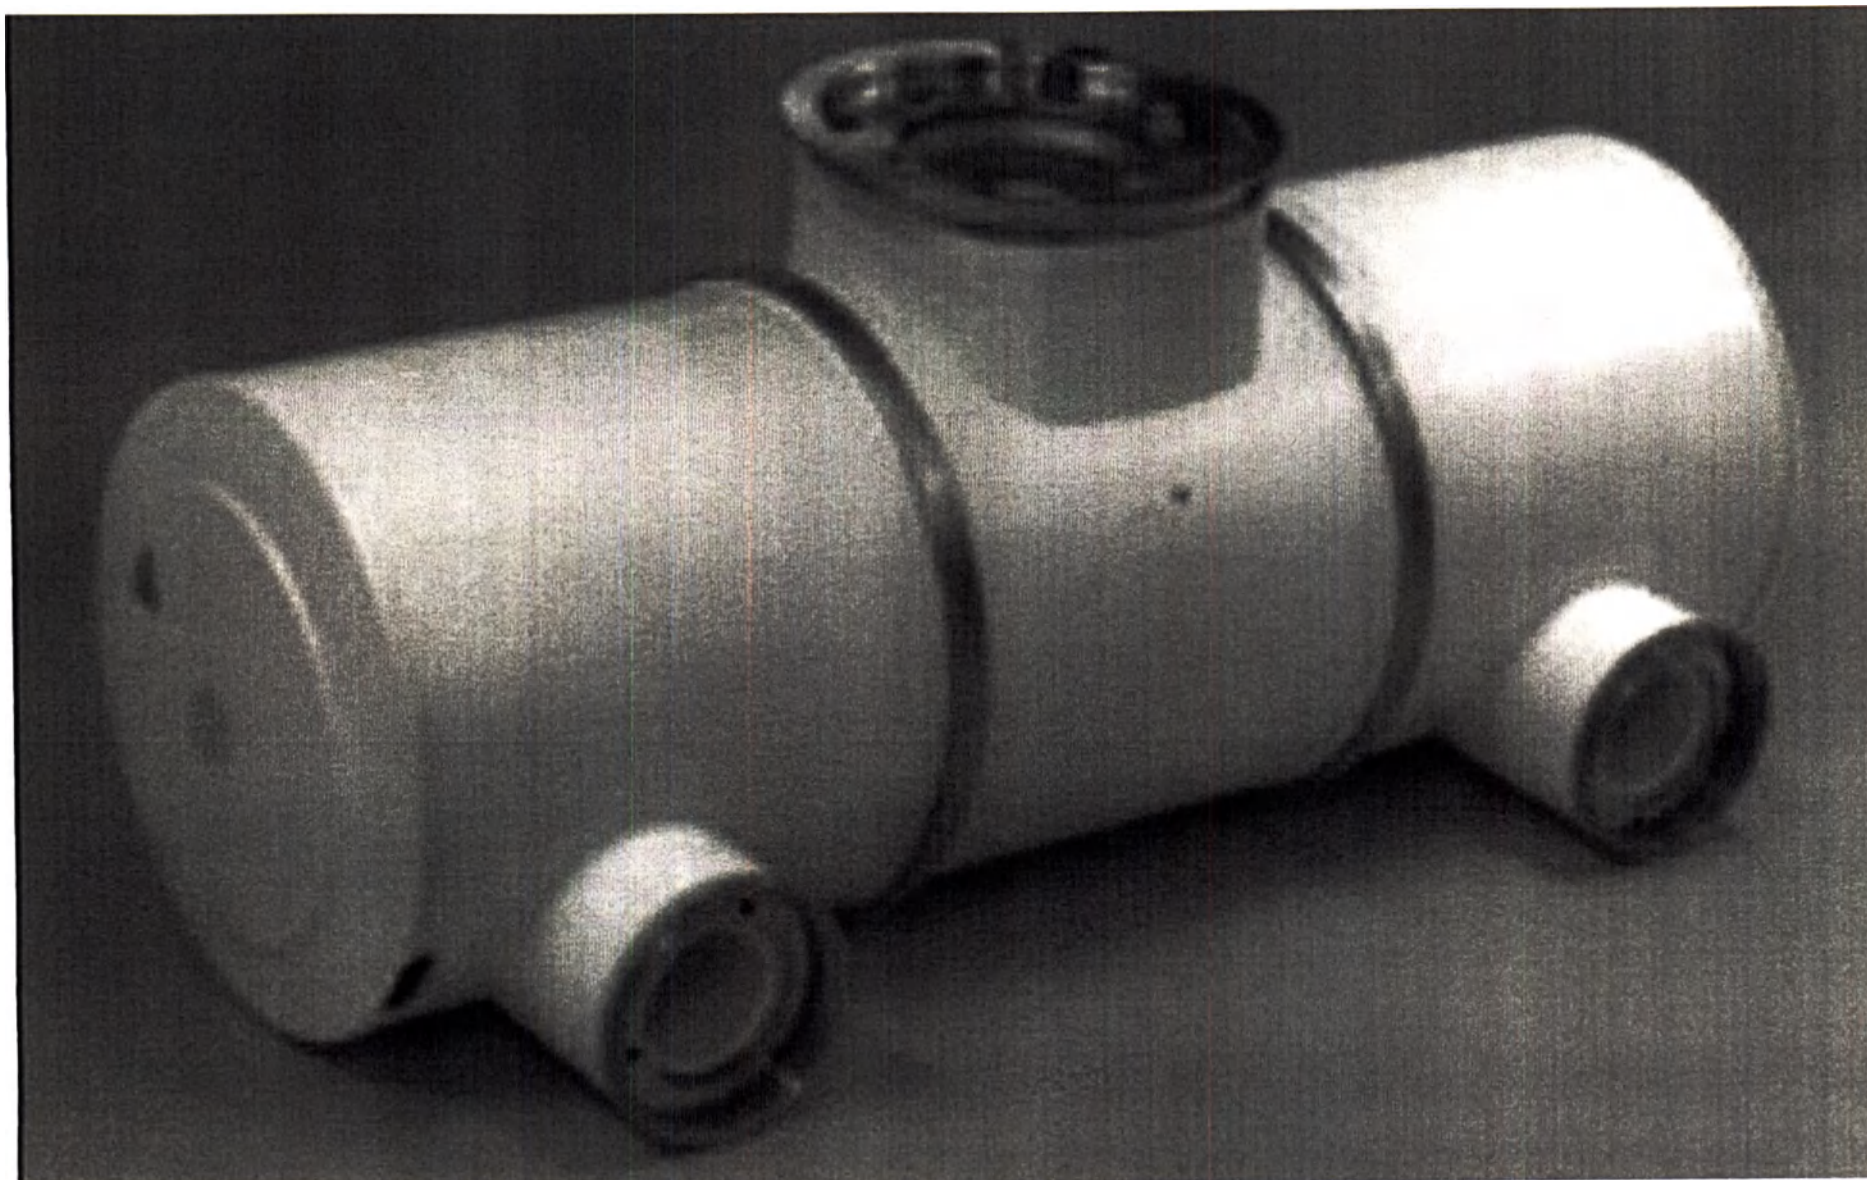


Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой SV 150/40/80HC-100 или SV 150/40/80C-100
производства Siemens, Германия




Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии R 221, производства Ralco srl., Италия




Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии R 225, производства Ralco srl., Италия

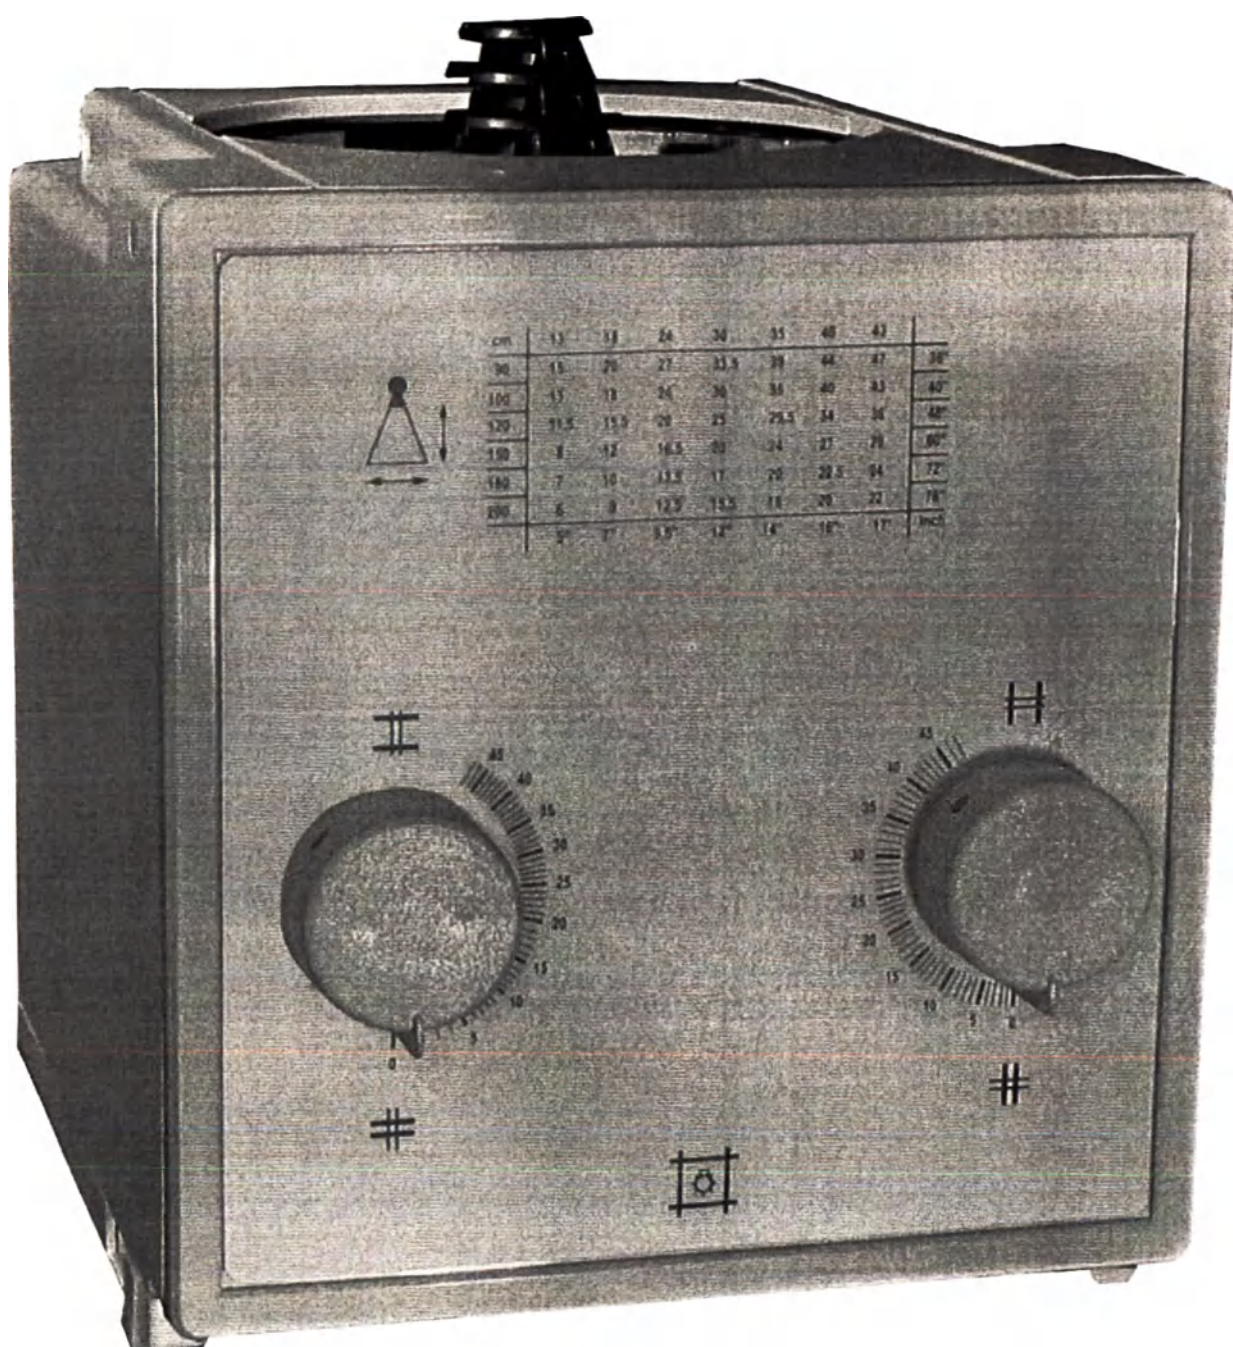


Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии R 302, производства Ralco srl., Италия

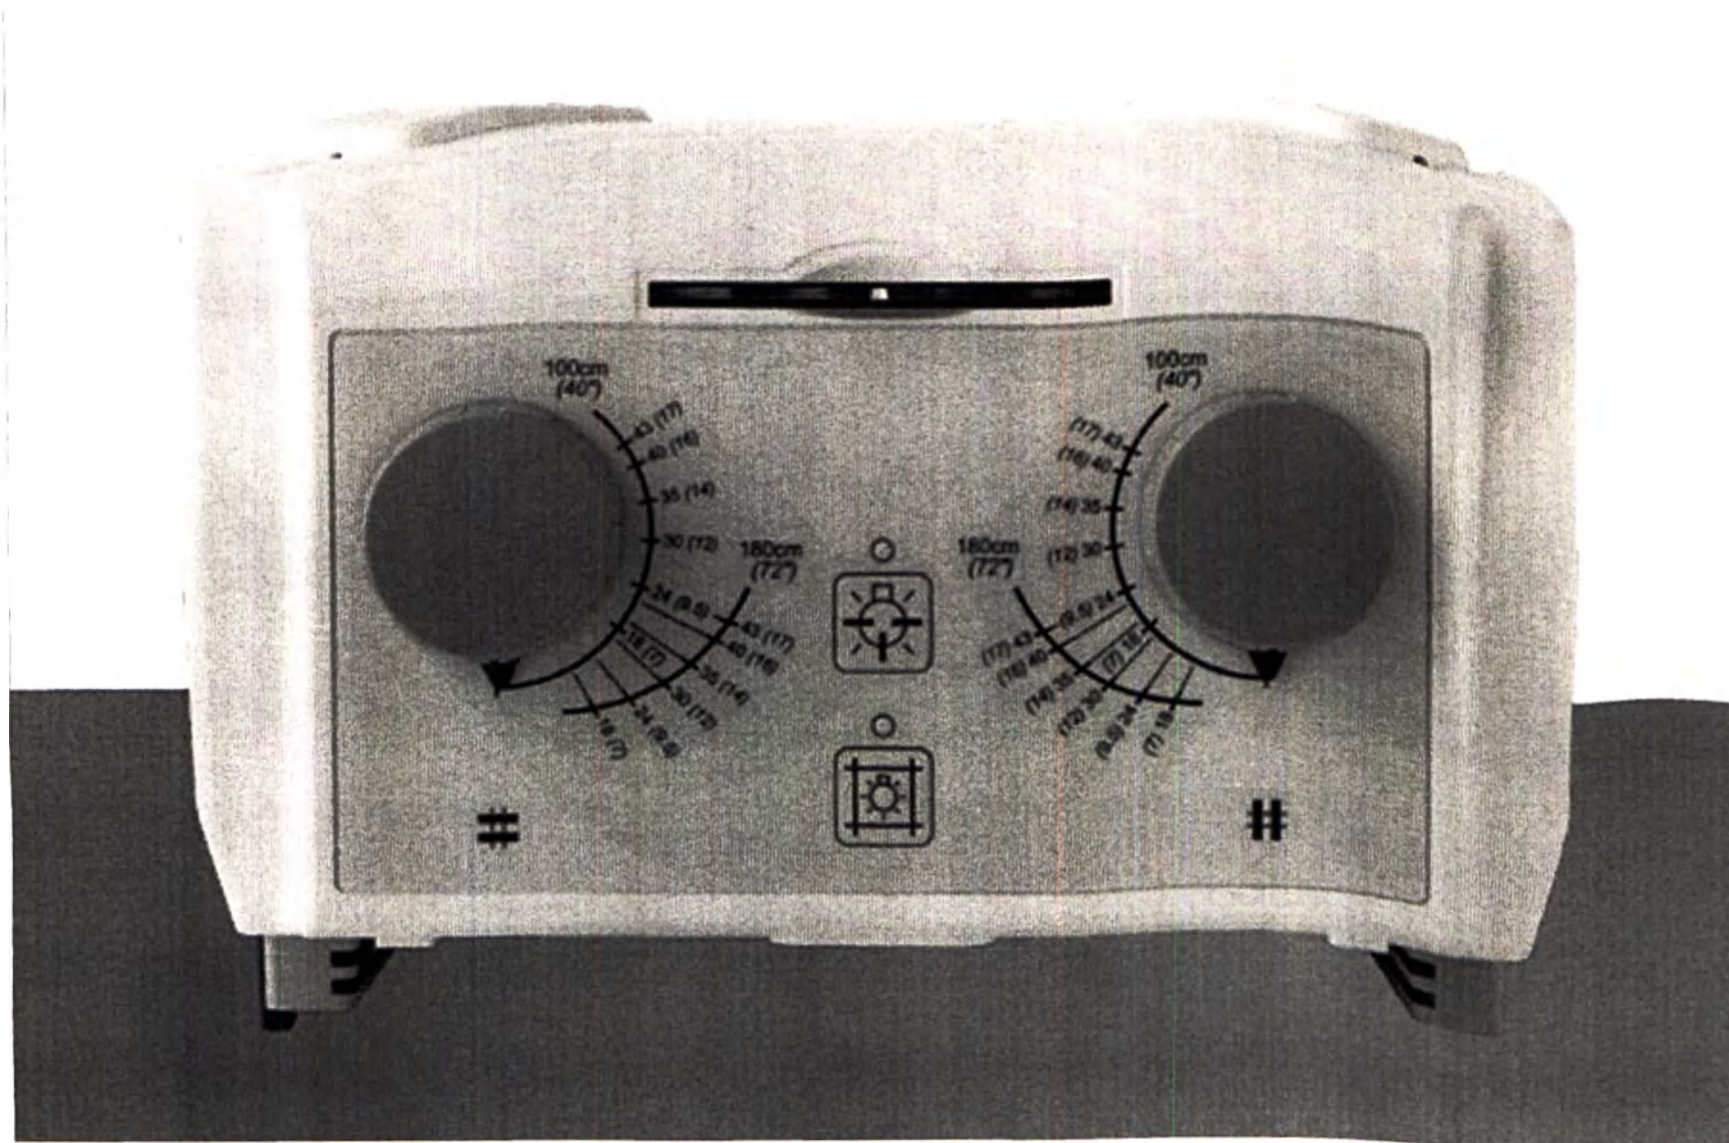


Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии Optica 10 или серии Optica 20, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины

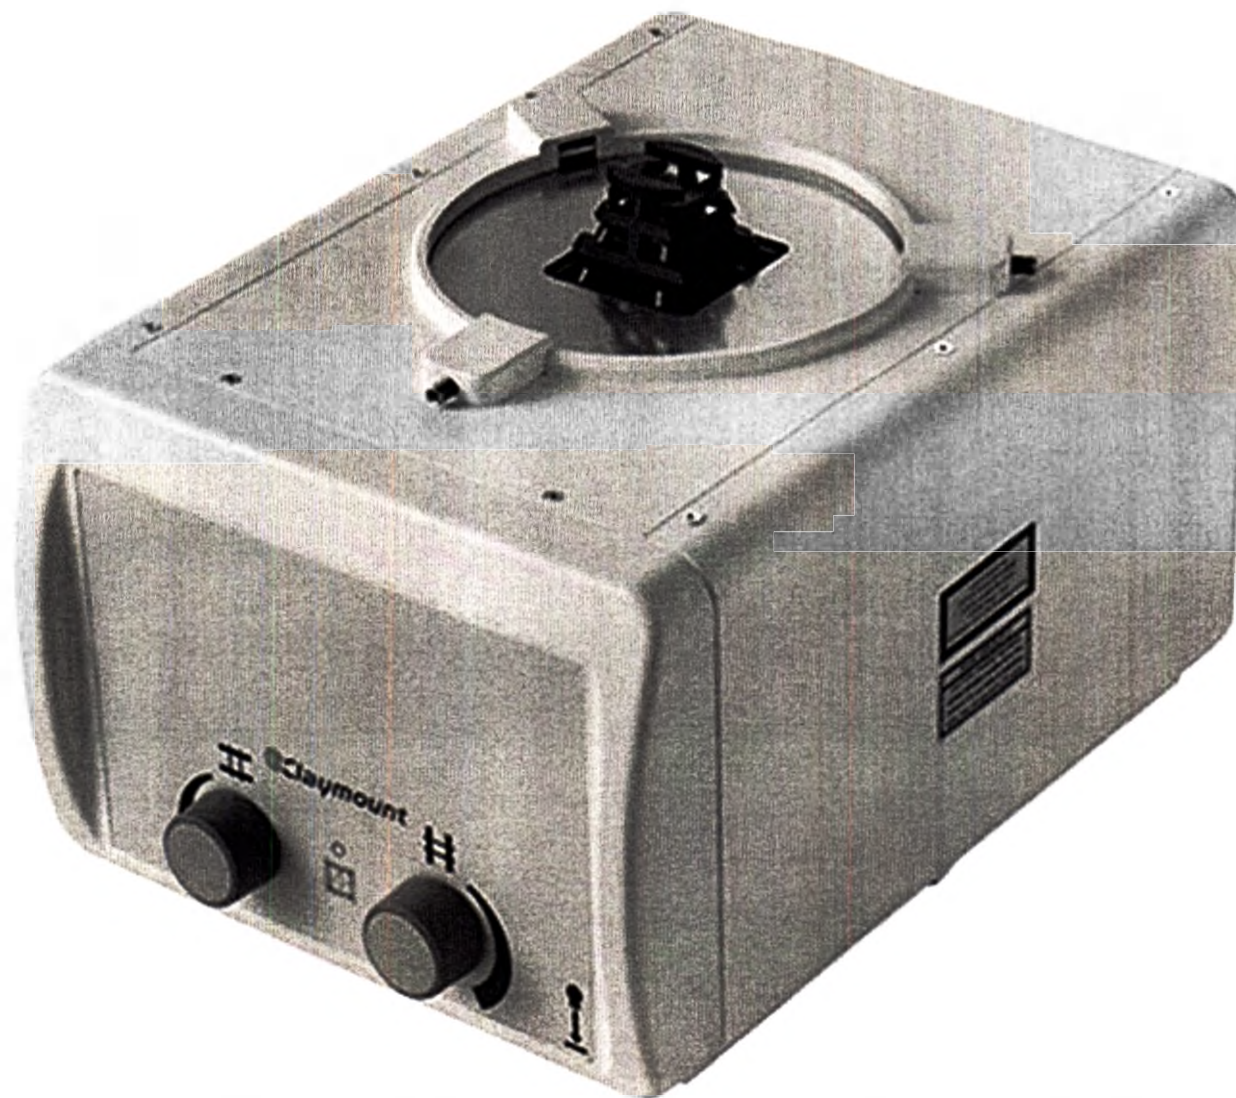


Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии Optica 30, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины

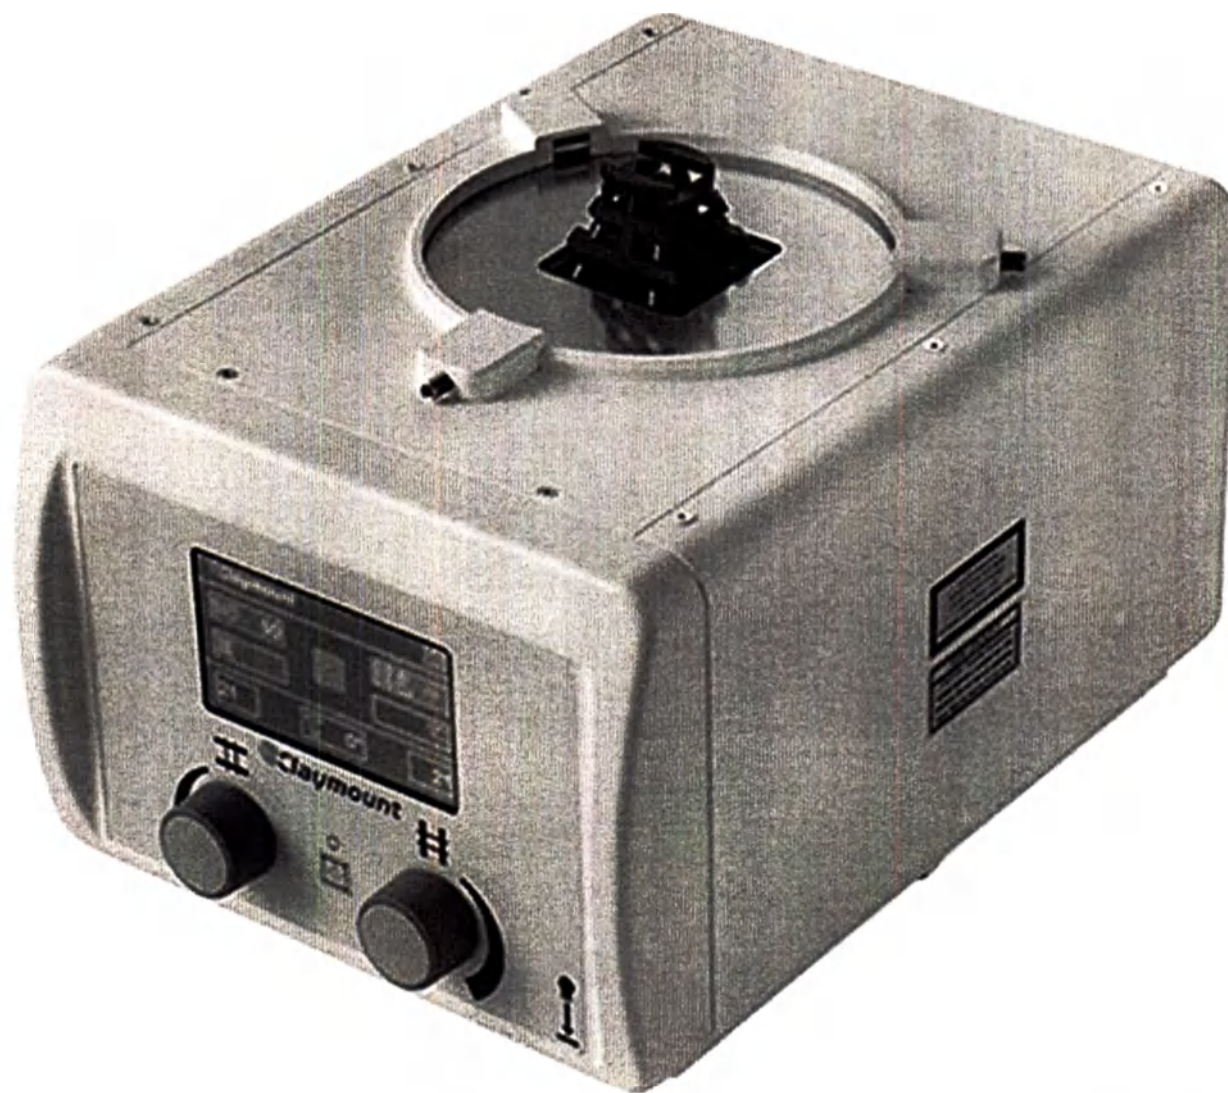


Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии Optica 40, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины

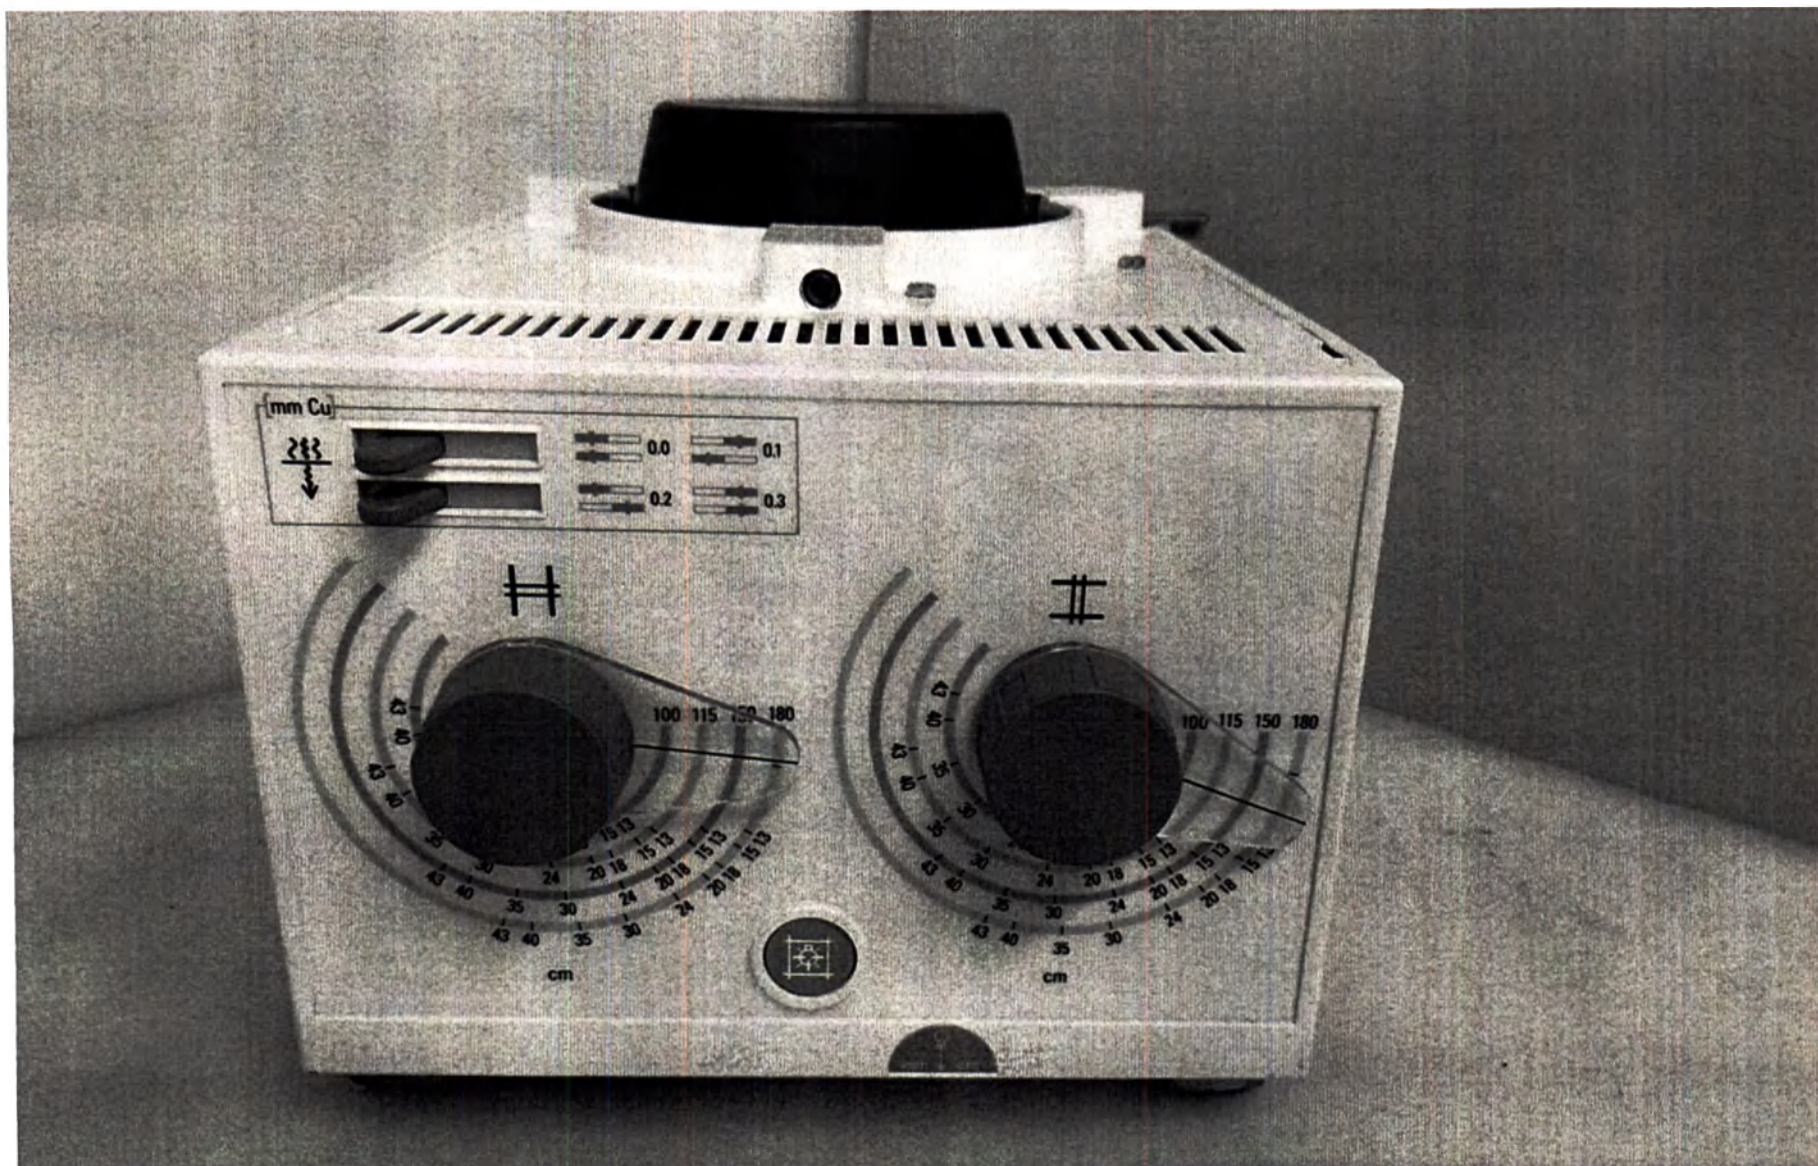


Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии ML 01 II, производства Siemens, Германия

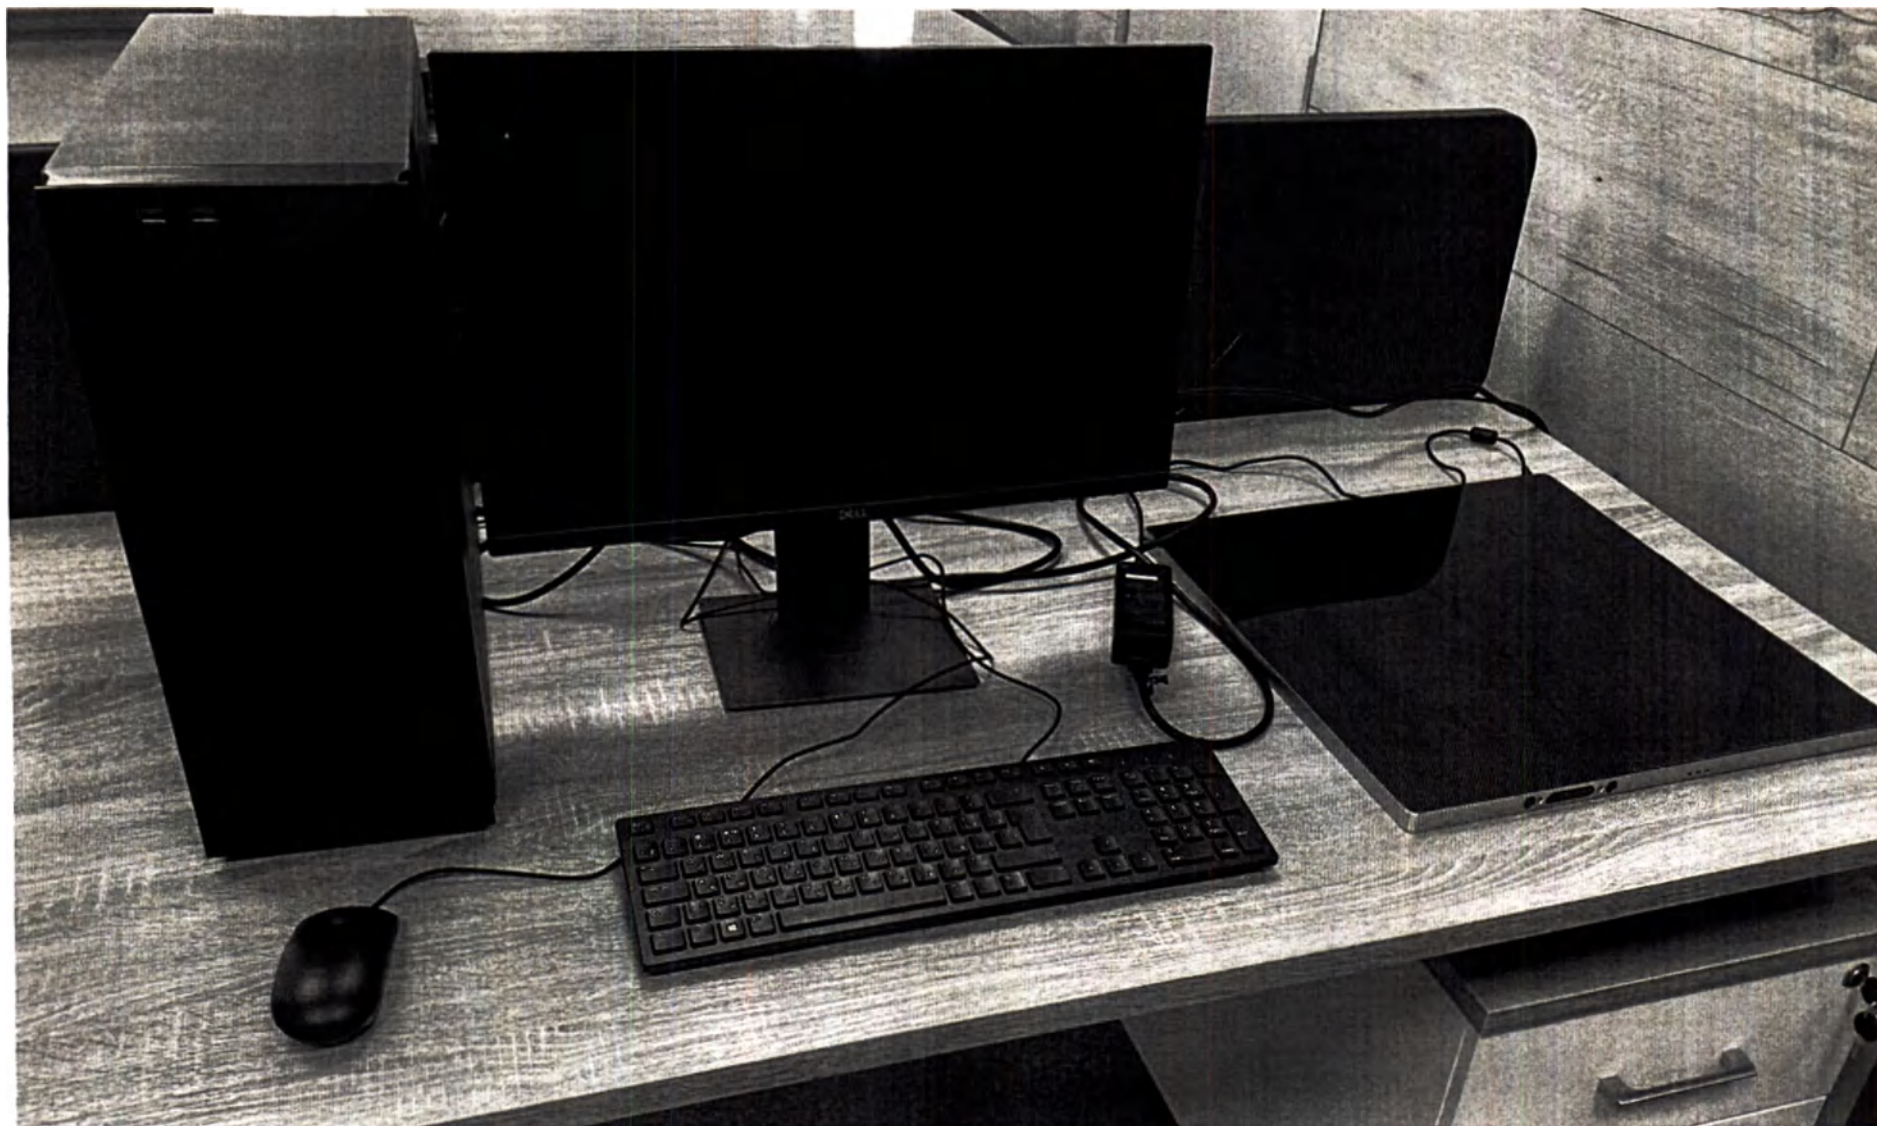


Комплекс аппаратно-программный для регистрации и обработки рентгеновских изображений
«СОЛО ДР-МТ», производства АО «МТЛ», Россия

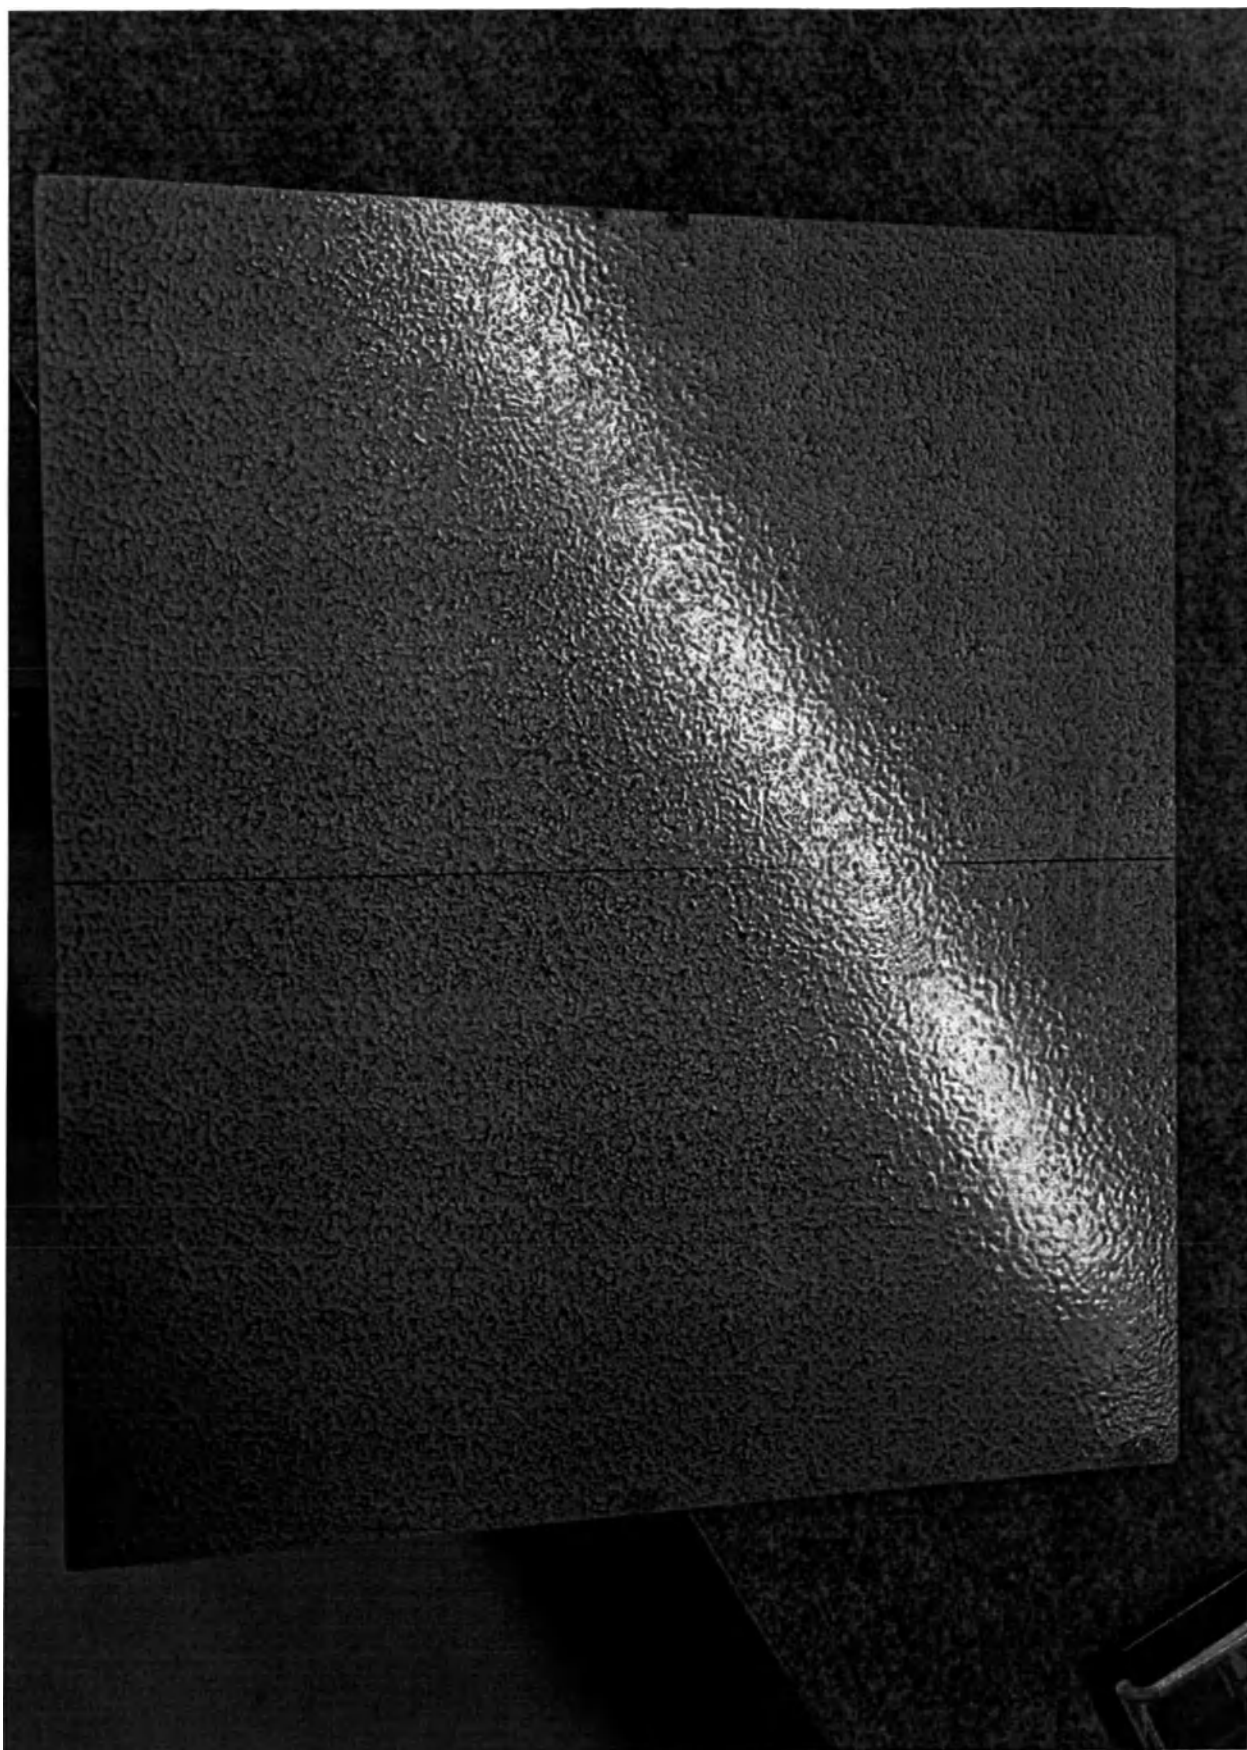


**Растр рентгеновский отсеивающий Lysholm, производства Gridline
А.В., Швеция**

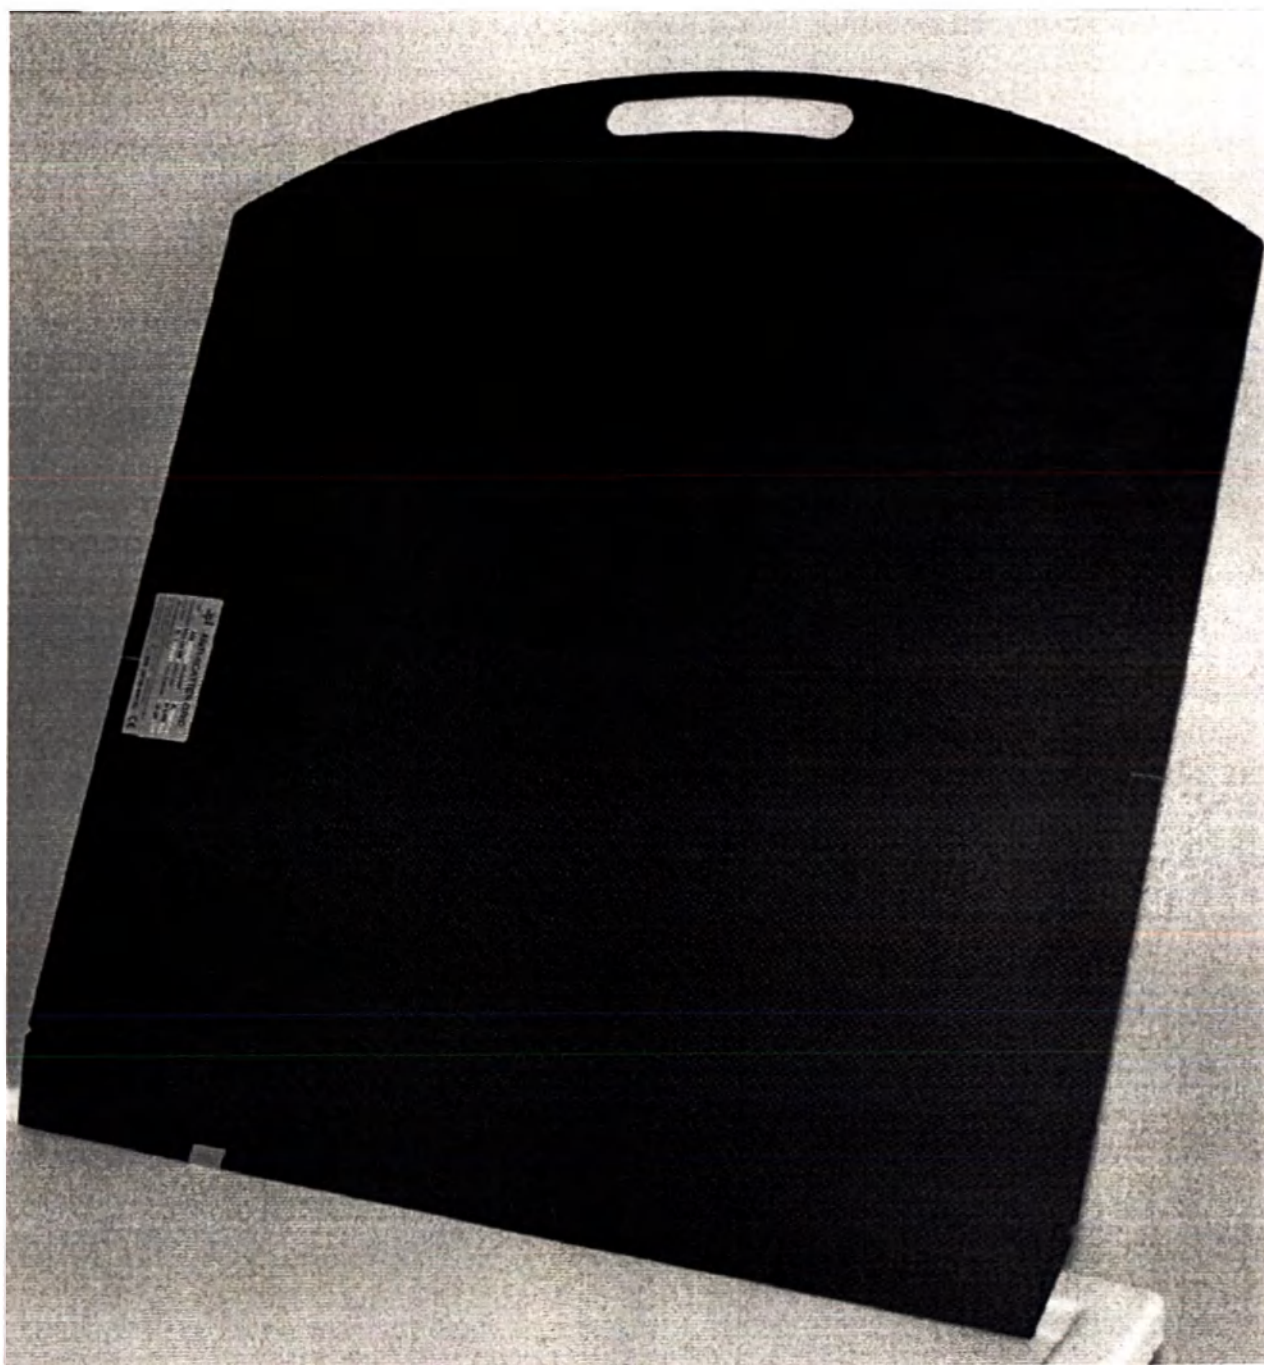

Растр рентгеновский отсеивающий JPI, производства JPI Healthcare Co., Ltd, Республика Корея

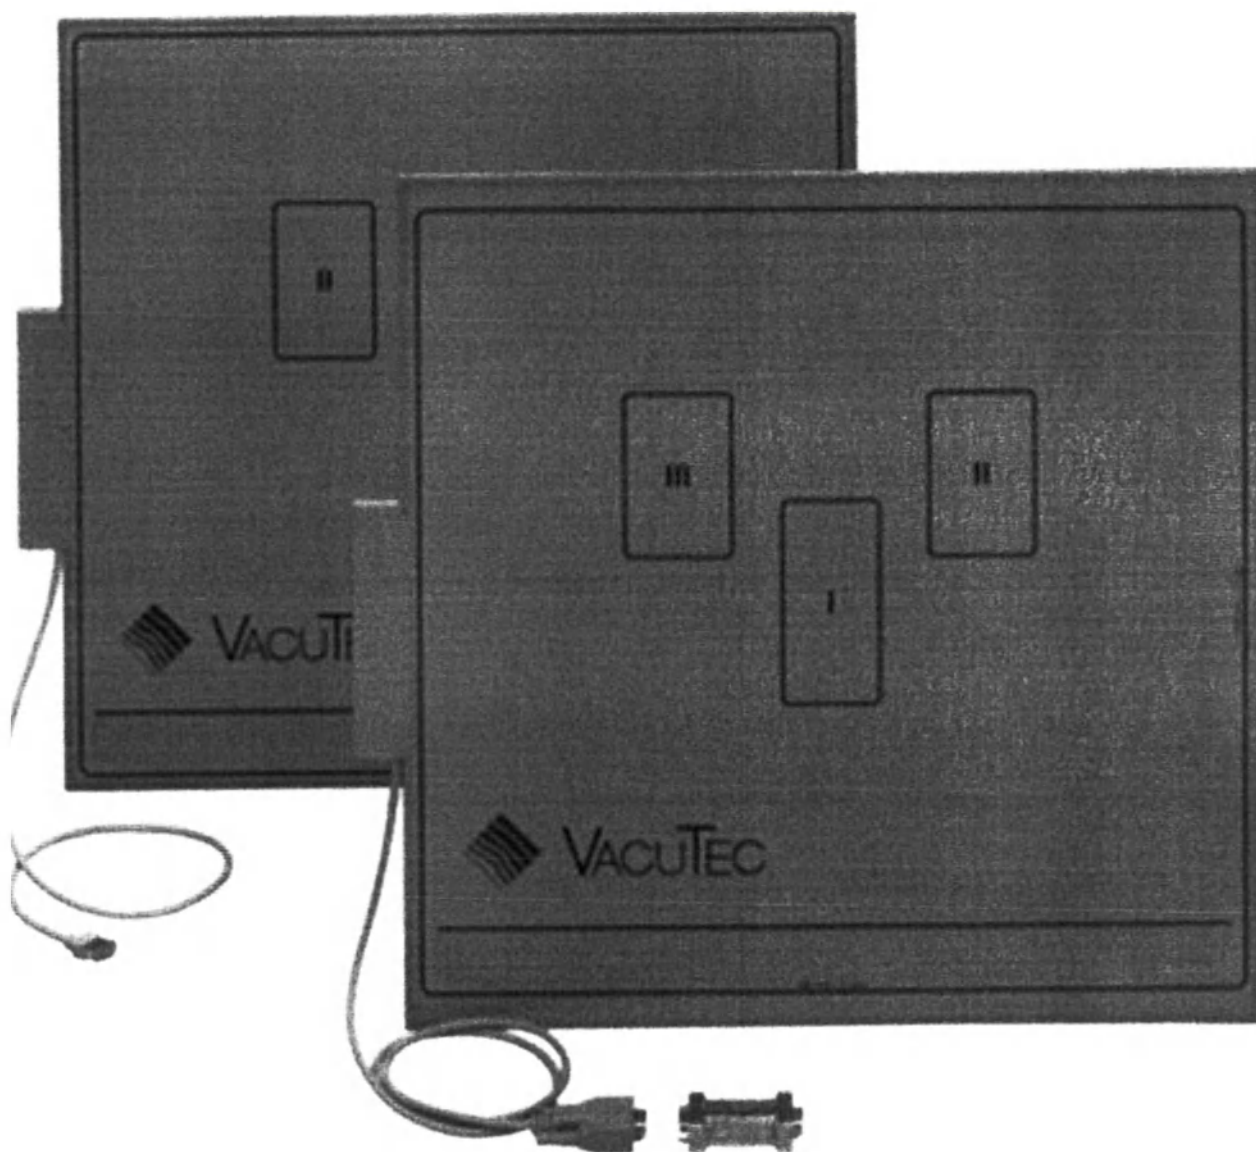

Ионизационная камера серии 70, производства VacuTec, Meßtechnik GmbH, Германия

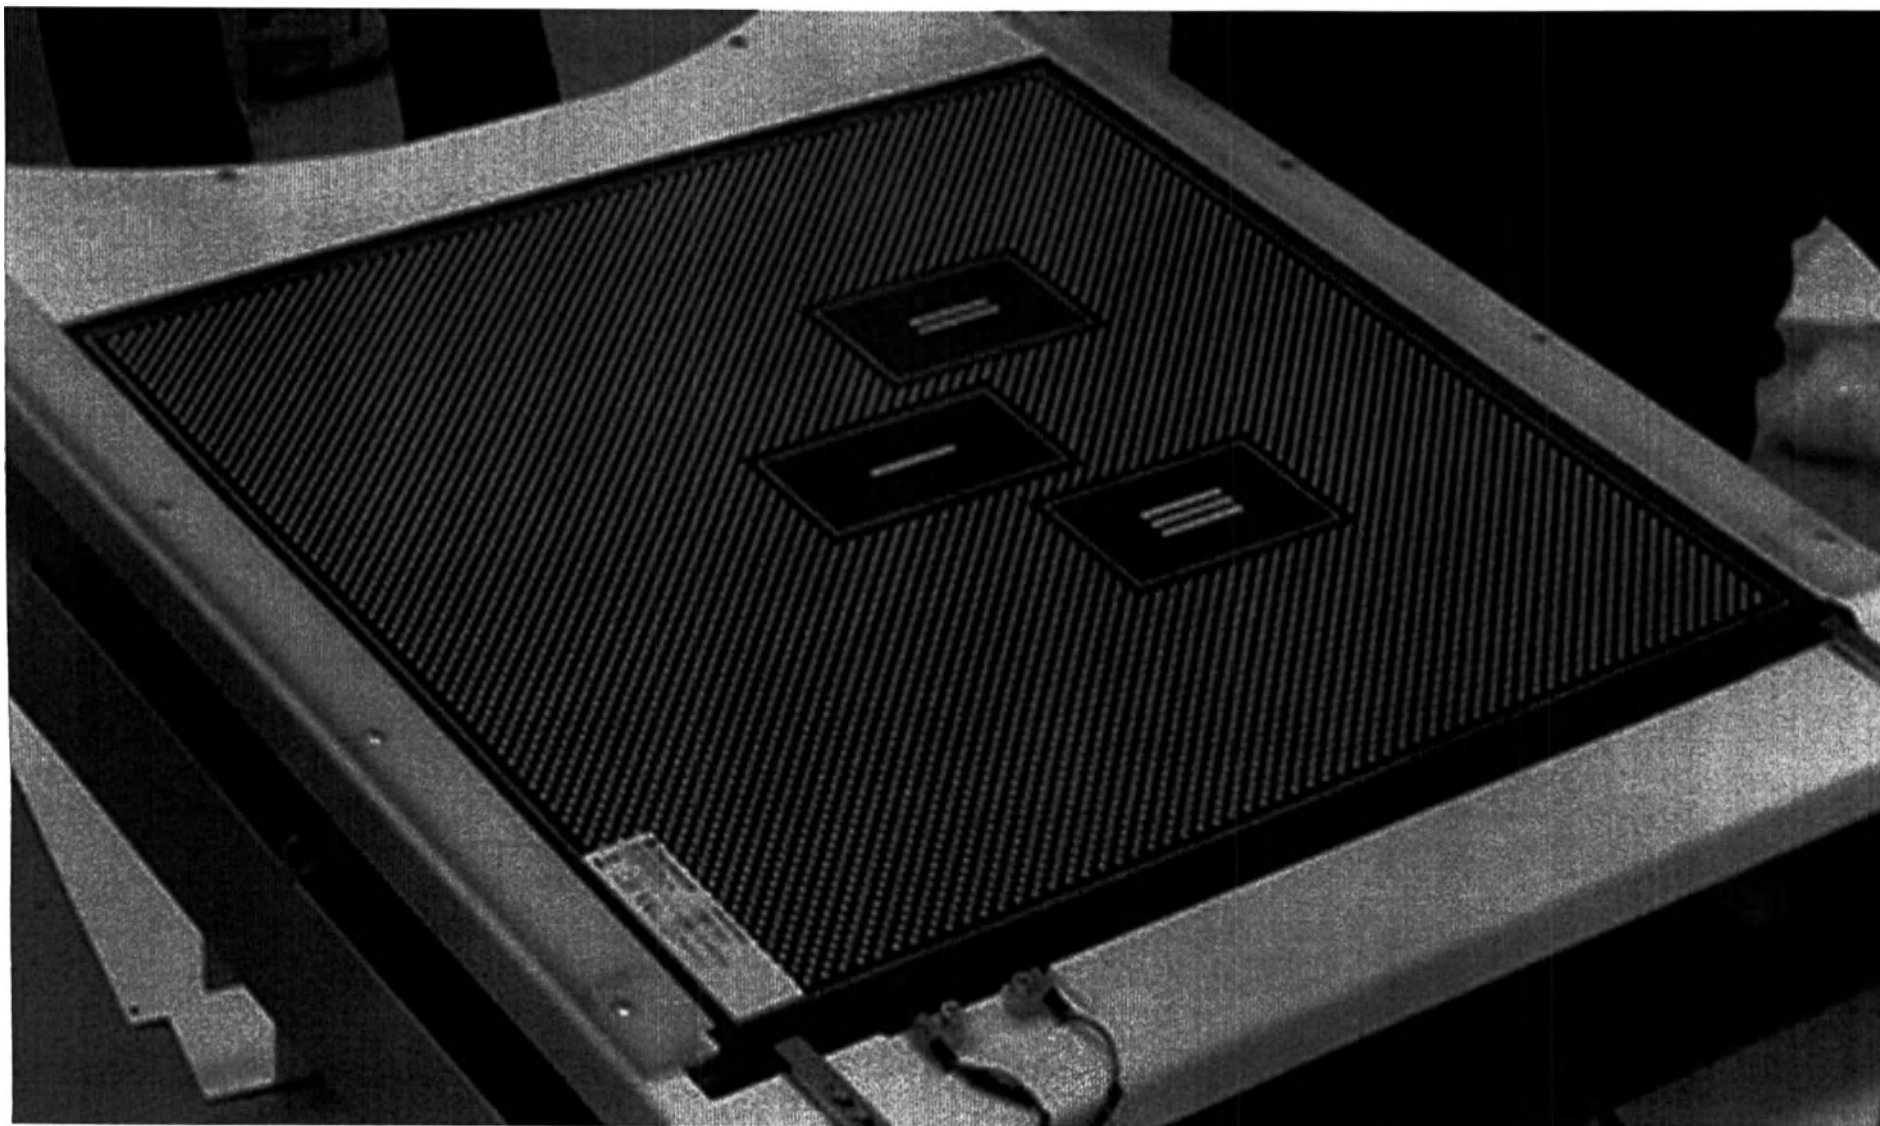


Ионизационная камера серии SSMC, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или
Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины



Устройство включения экспозиции, производства Dongzi Medical System Co., Китай или OMRON Corporation, Япония



Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов серии EM,
производства Tecnint HTE s.r.l., Италия

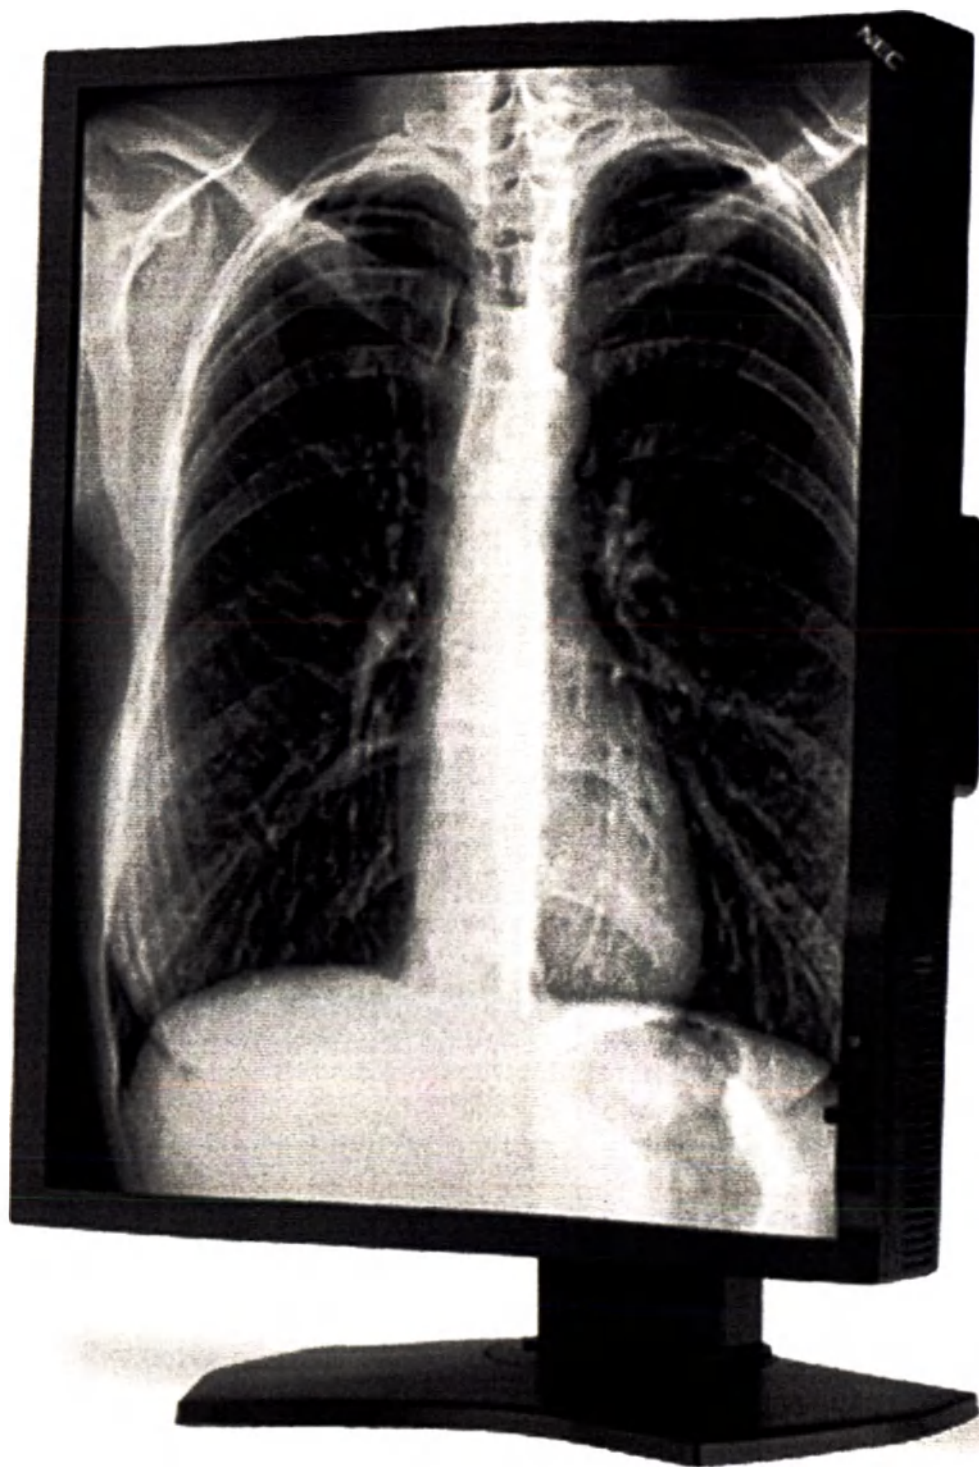


Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов NEC, производства NEC Display Solutions Ltd, Япония или Compal Electronics (China) Co., Ltd, Китай или Compal Display Electronics (Kunshan) Co., Ltd, Китай



Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов серии С или серии М или серии R, производства Nanjing Jusha Display Technology Co., Ltd, Китай




Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов серии Z, производства Hewlett-Packard Co., США или Wistron Corporation, Тайвань или Wistron Mexico S.A. de C.V, Мексика или Wistron InfoComm (Zhongshan) Corporation, Китай или All Technology (Zhongshan) Co. Ltd, Китай или Wistron InfoComm (Czech) s.r.o., Чешская Республика (на фото изображен монитор ЖК с диагональю 24 дюйма серии Z, производства Hewlett-Packard Co., США)

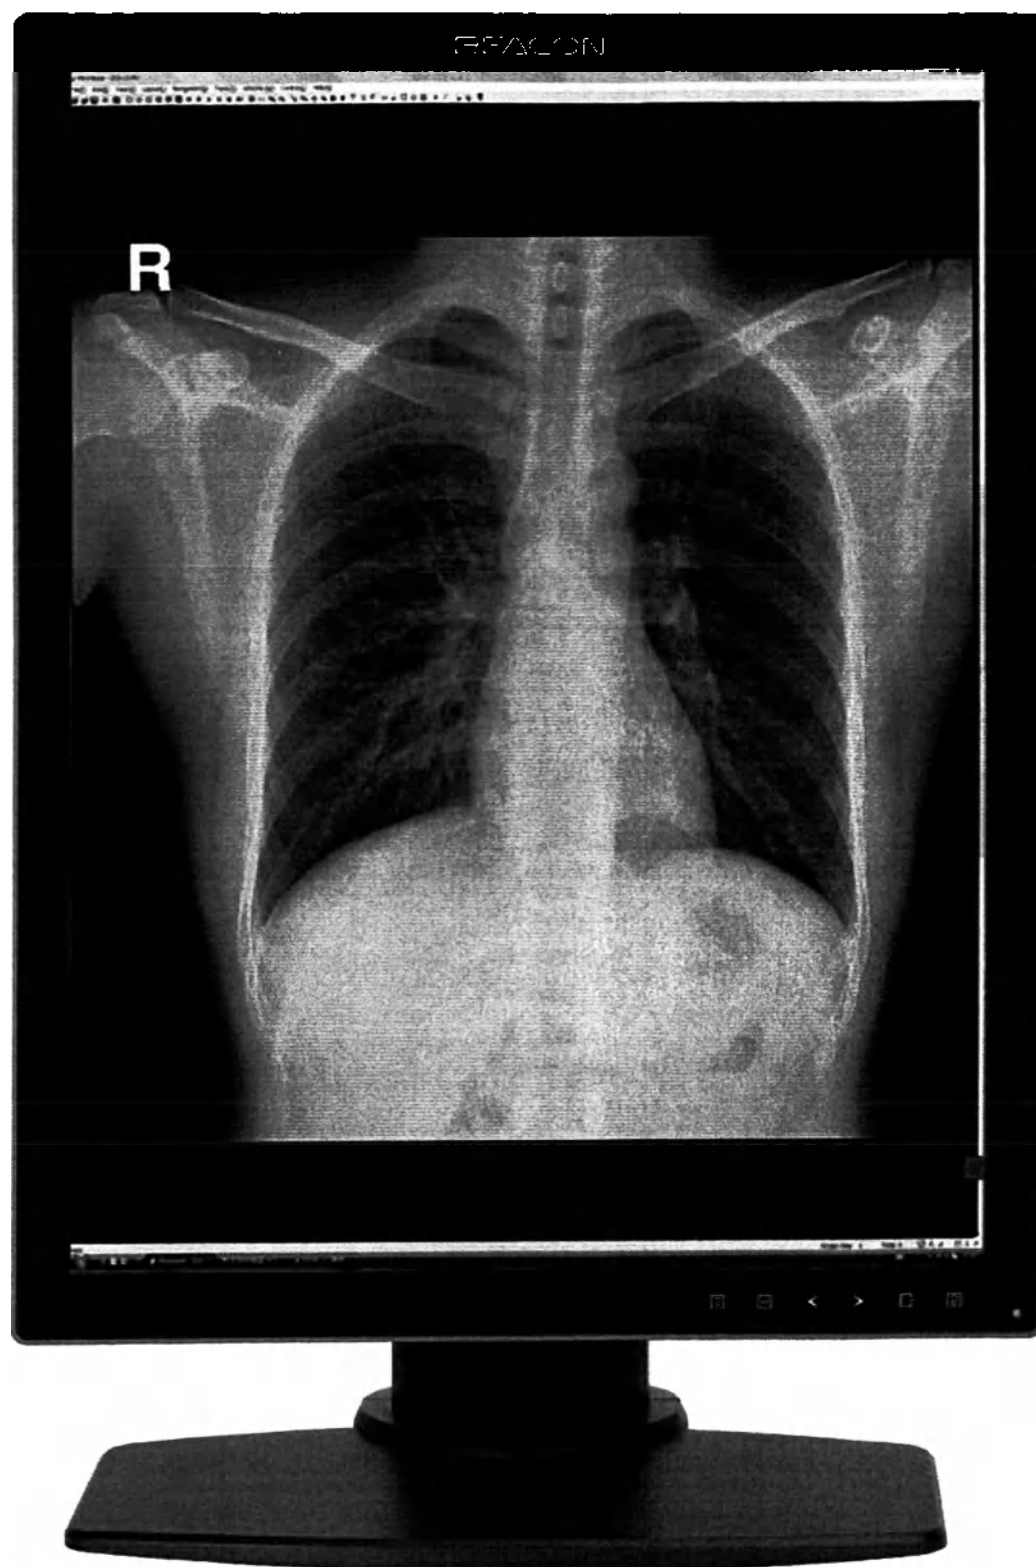


**Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов Beacon,
производства Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd, Китай**




Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов Barco, производства Barco N.V., Бельгия

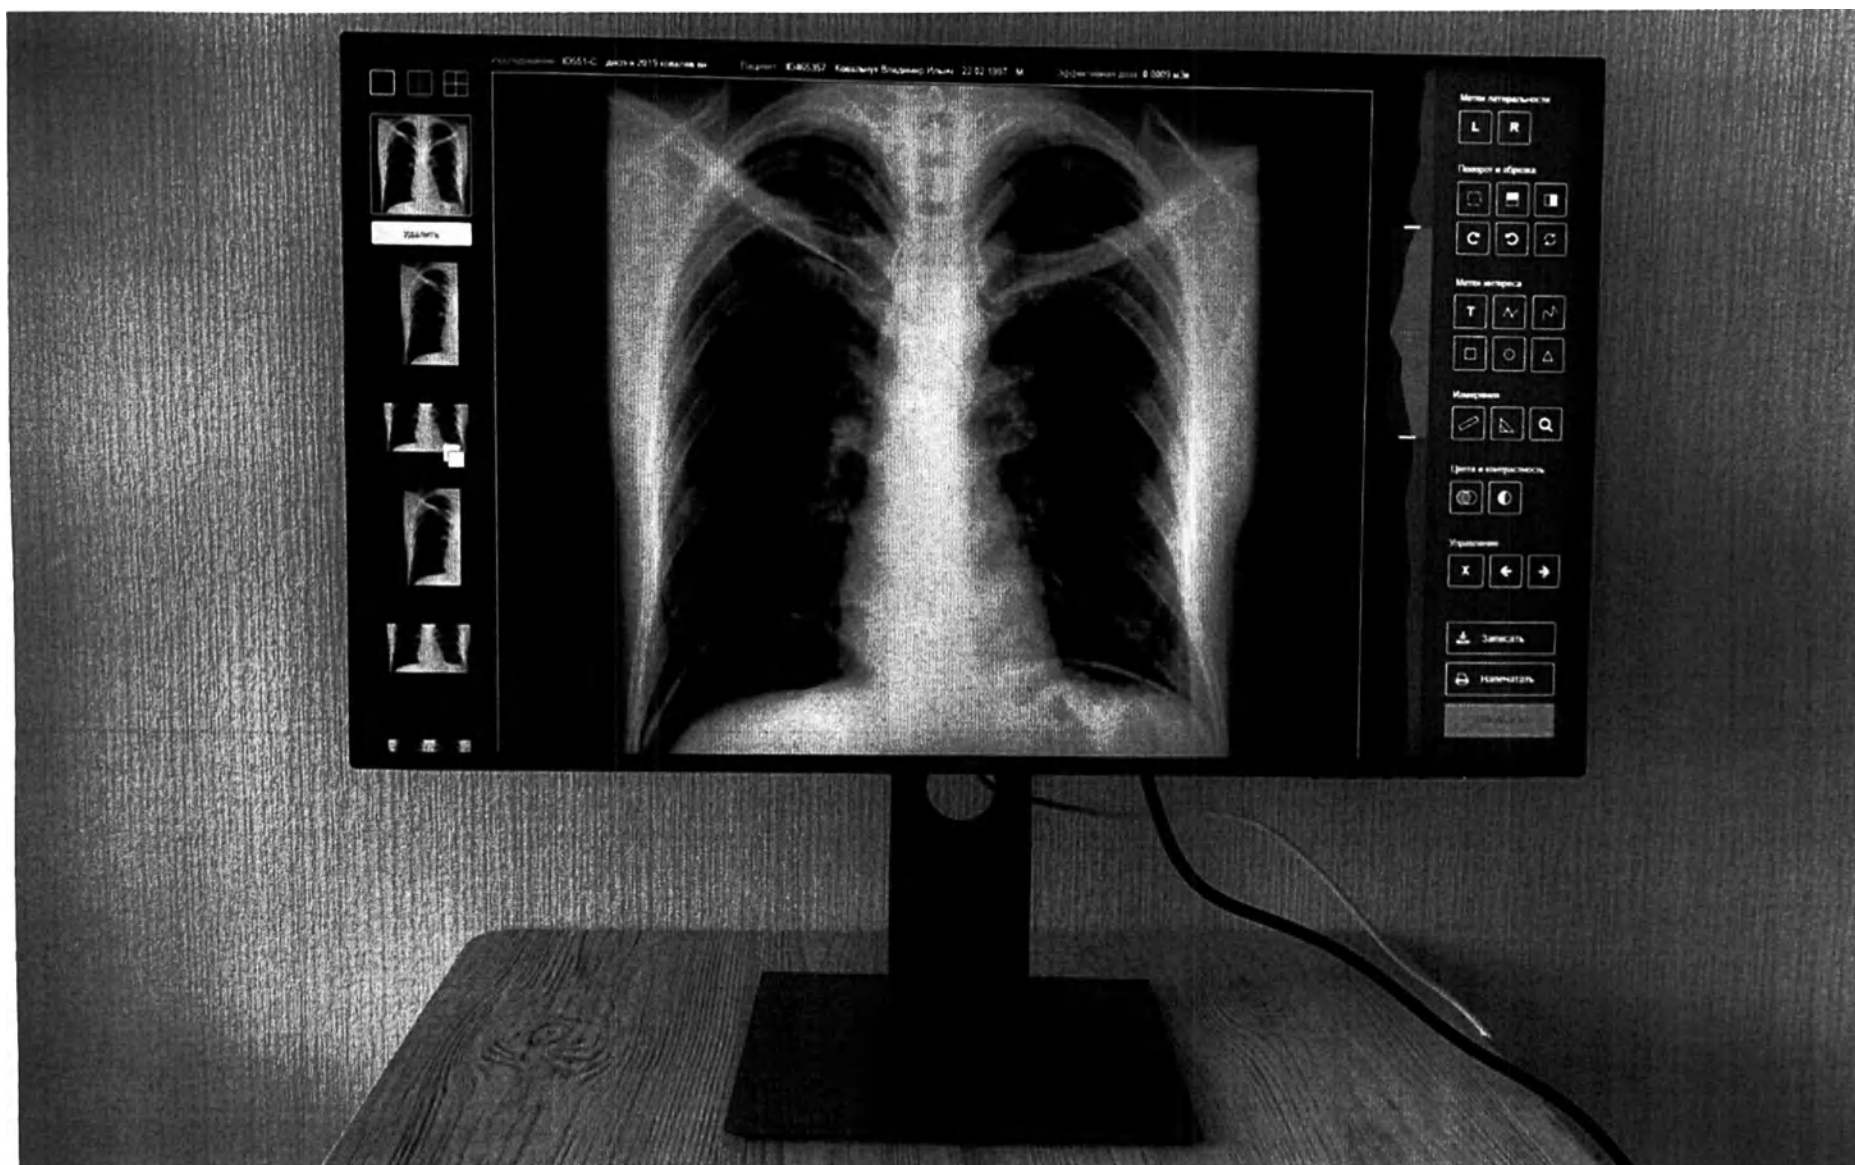


Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов DELL, производства DELL, Китай

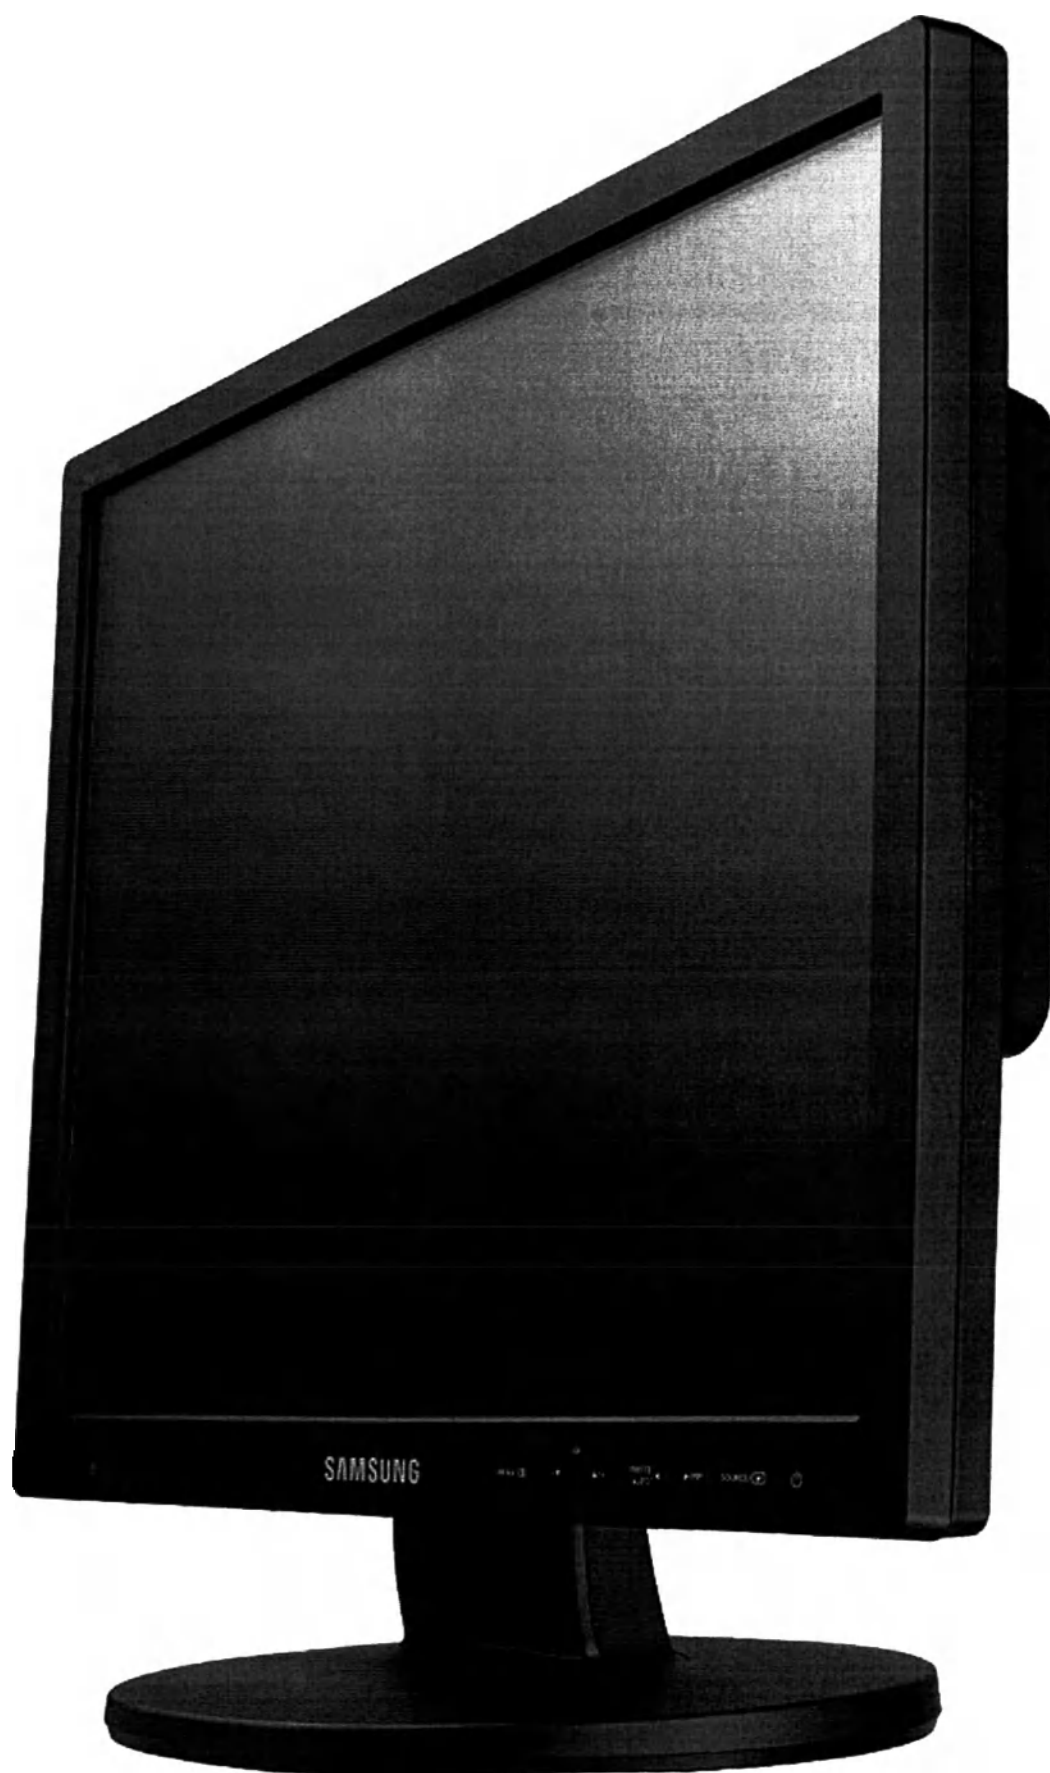

**Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов Samsung,
производства Samsung, Республика Корея**

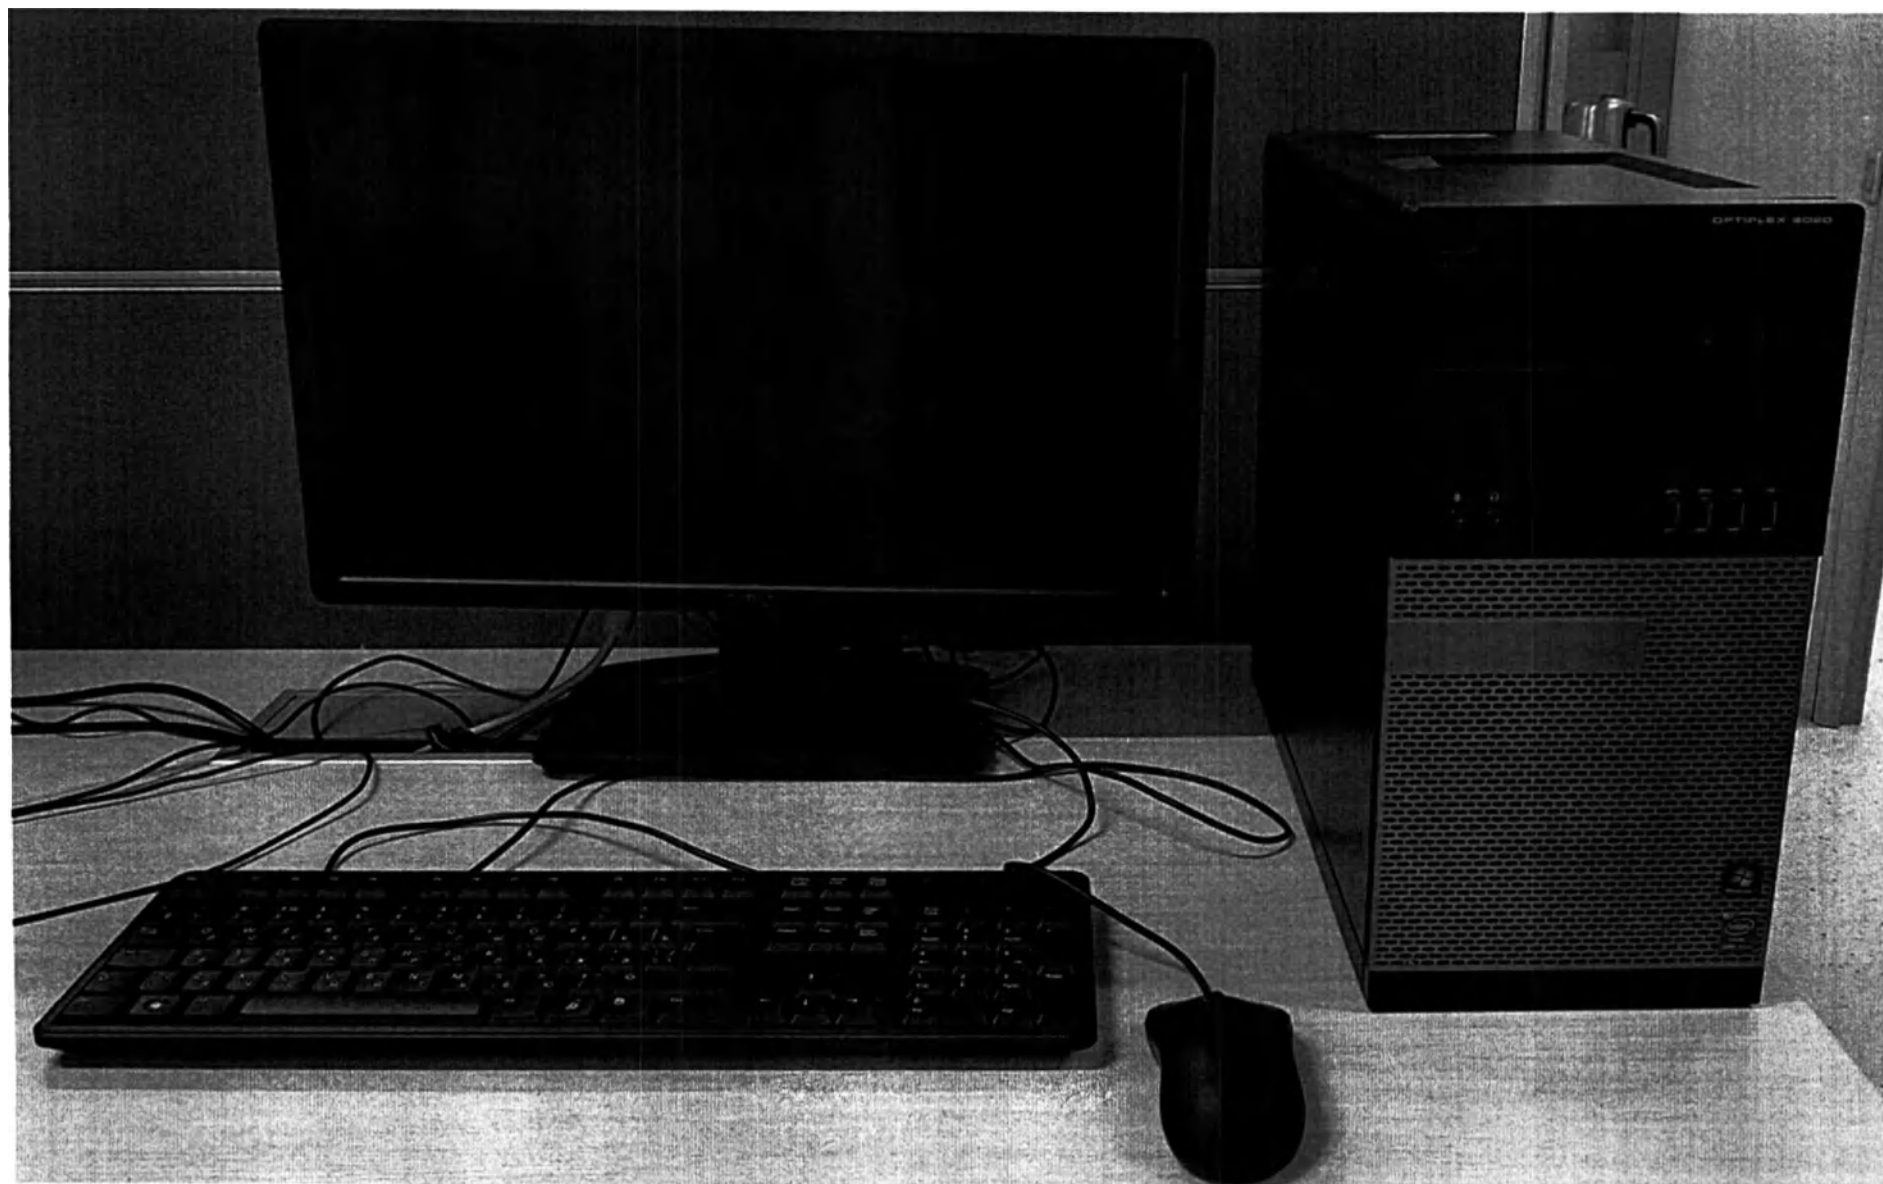


Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога «ДИАРМ-МТ-Плюс», производства АО «МТЛ», Россия

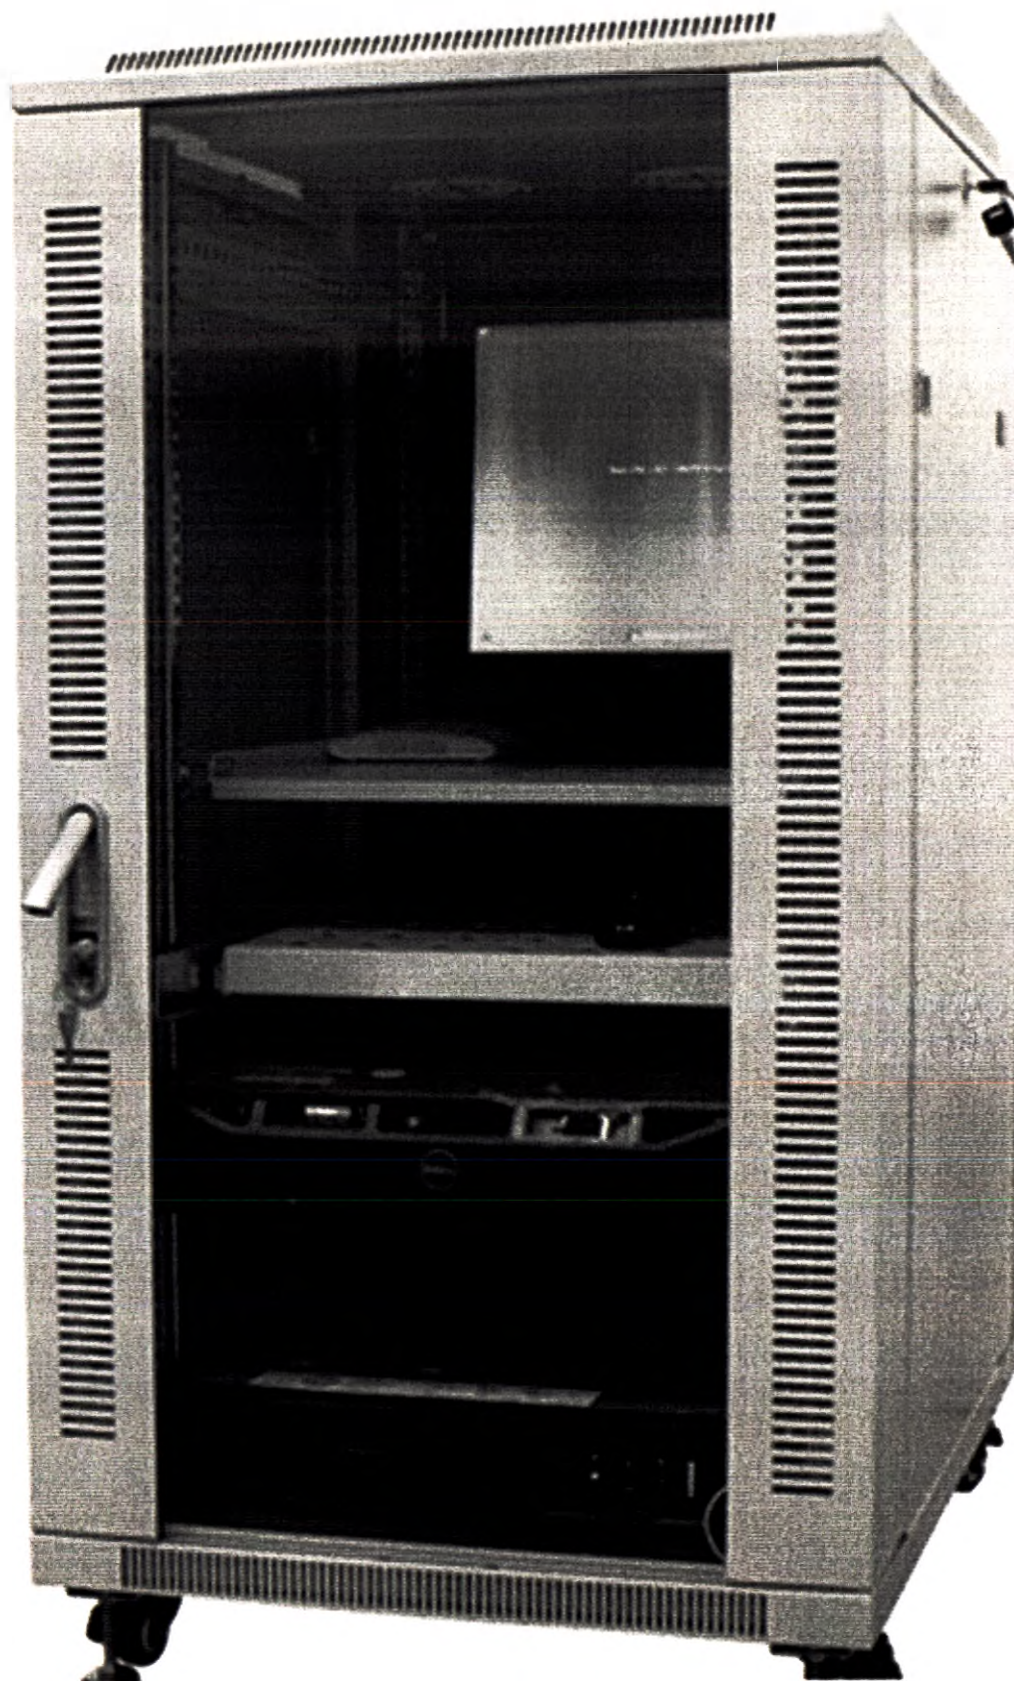


Радиологическая информационная система «ИнтеГРИС-МТ-Плюс»,
производства АО «МТЛ», Россия




**Рентгенопрозрачный стол-каталка серии X Mobil, производства
ROESYS MedTec GmbH, Германия**

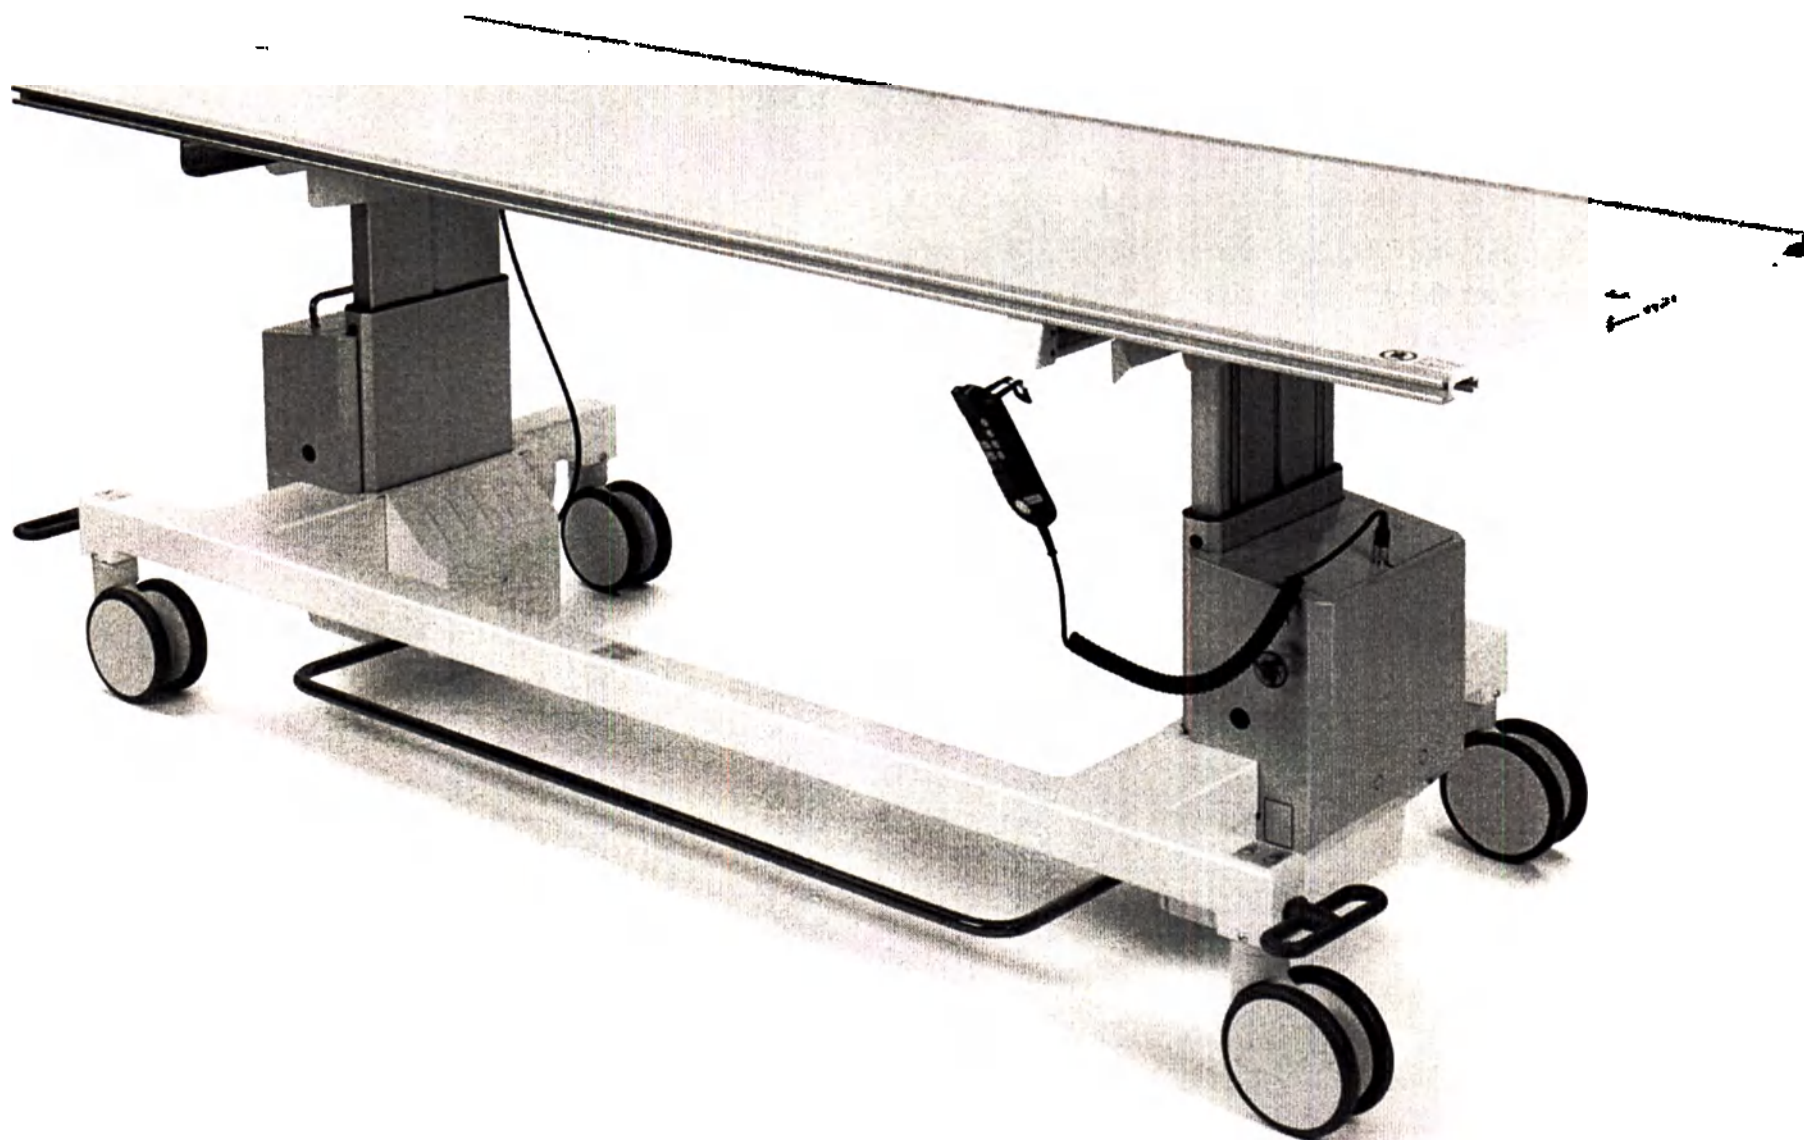


Рентгенопрозрачный стол-каталка серии Prognost, производства PROTEC GmbH & Co. KG, Германия

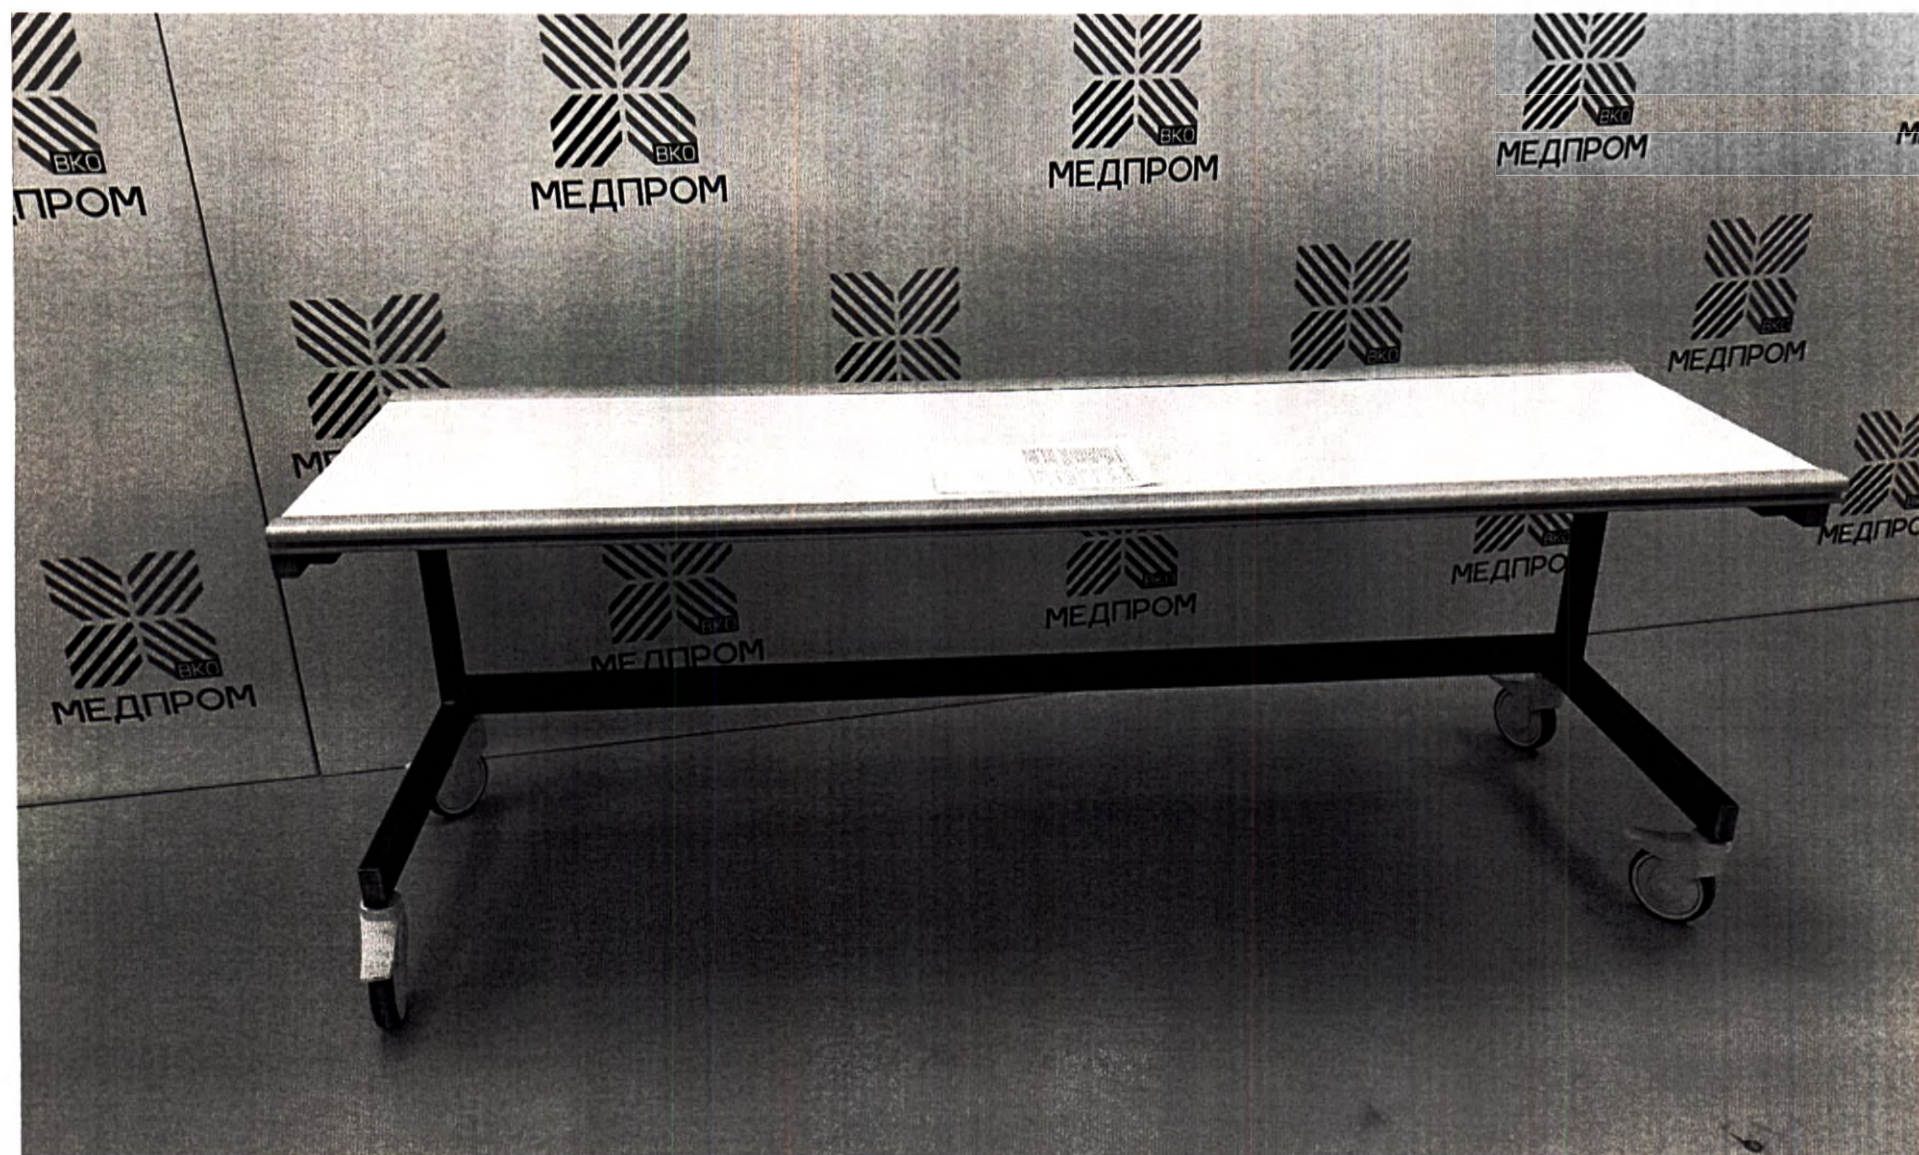

Стол пациента передвижной Y1-B0100, производства ООО «ВКО Медпром», Россия

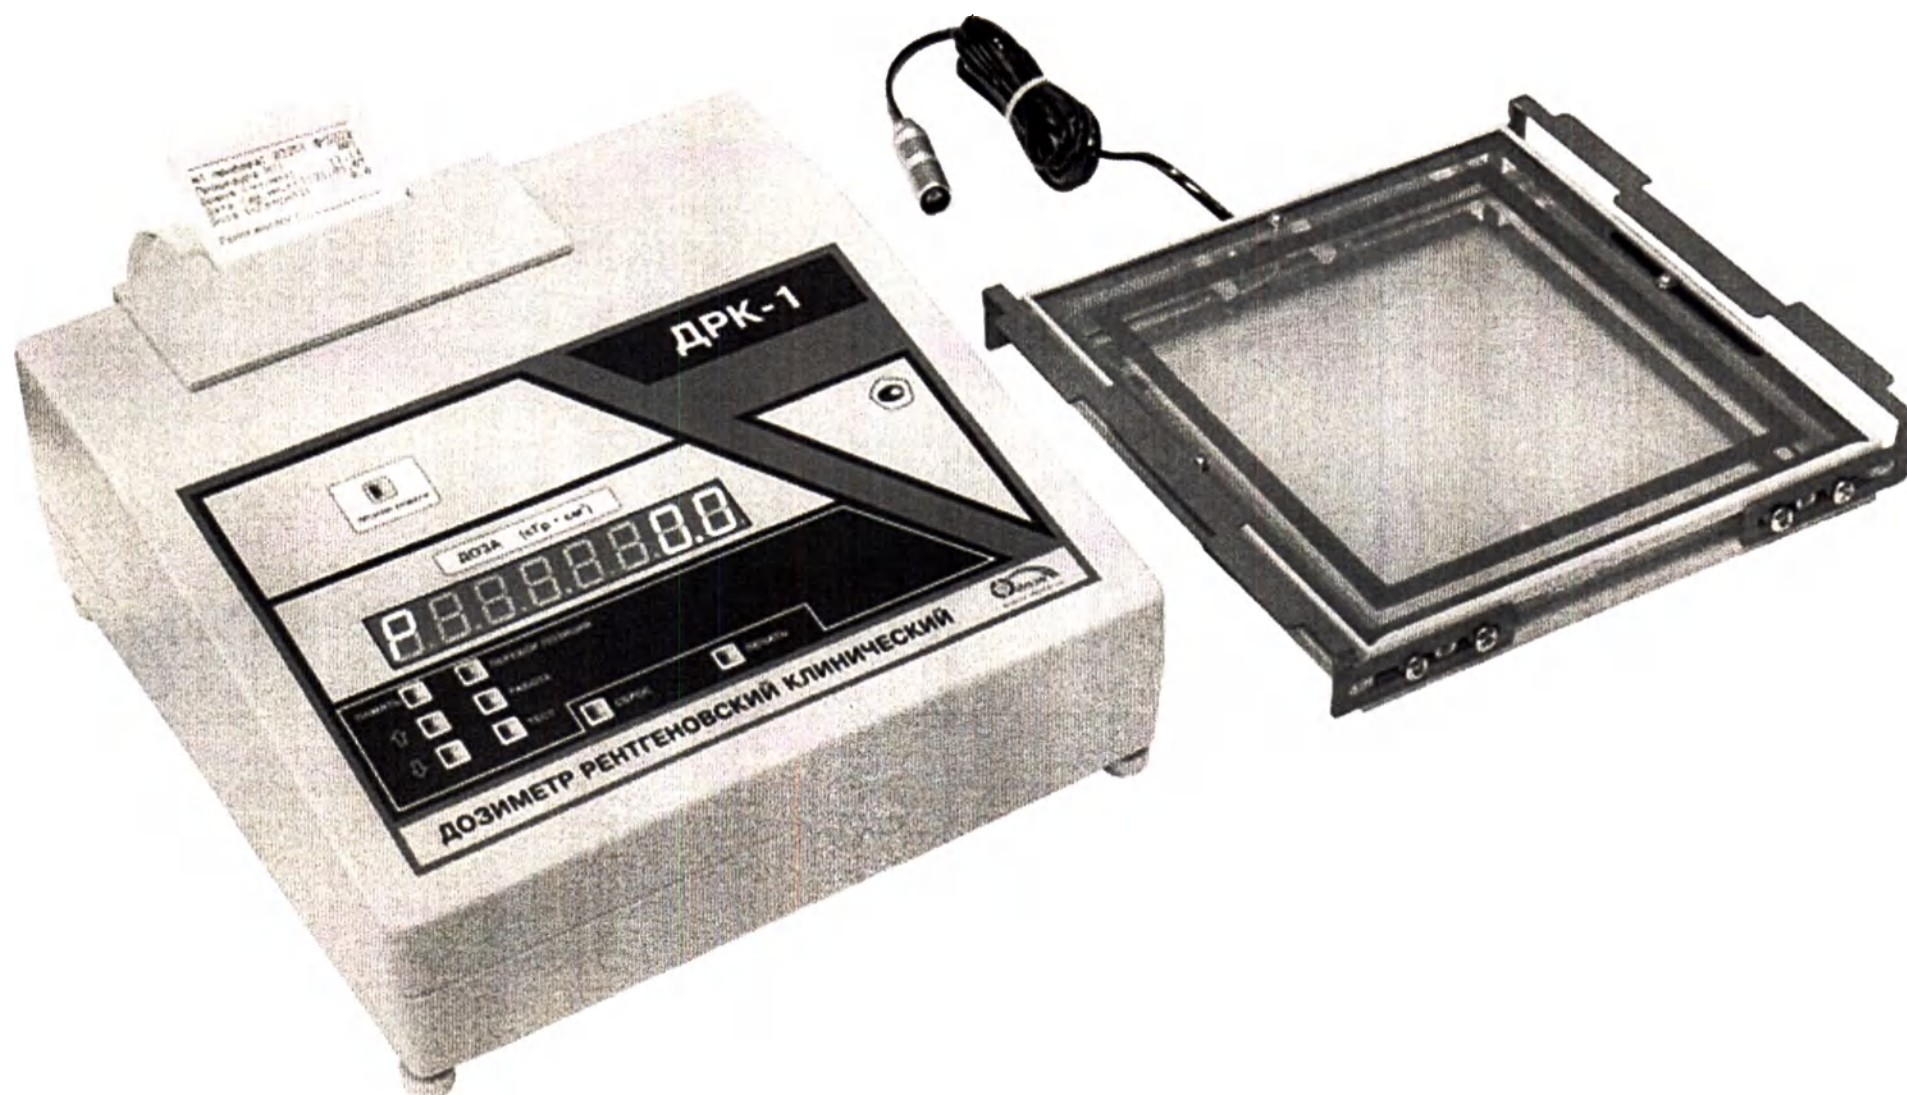


Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1, производства НПП «Доза», Россия

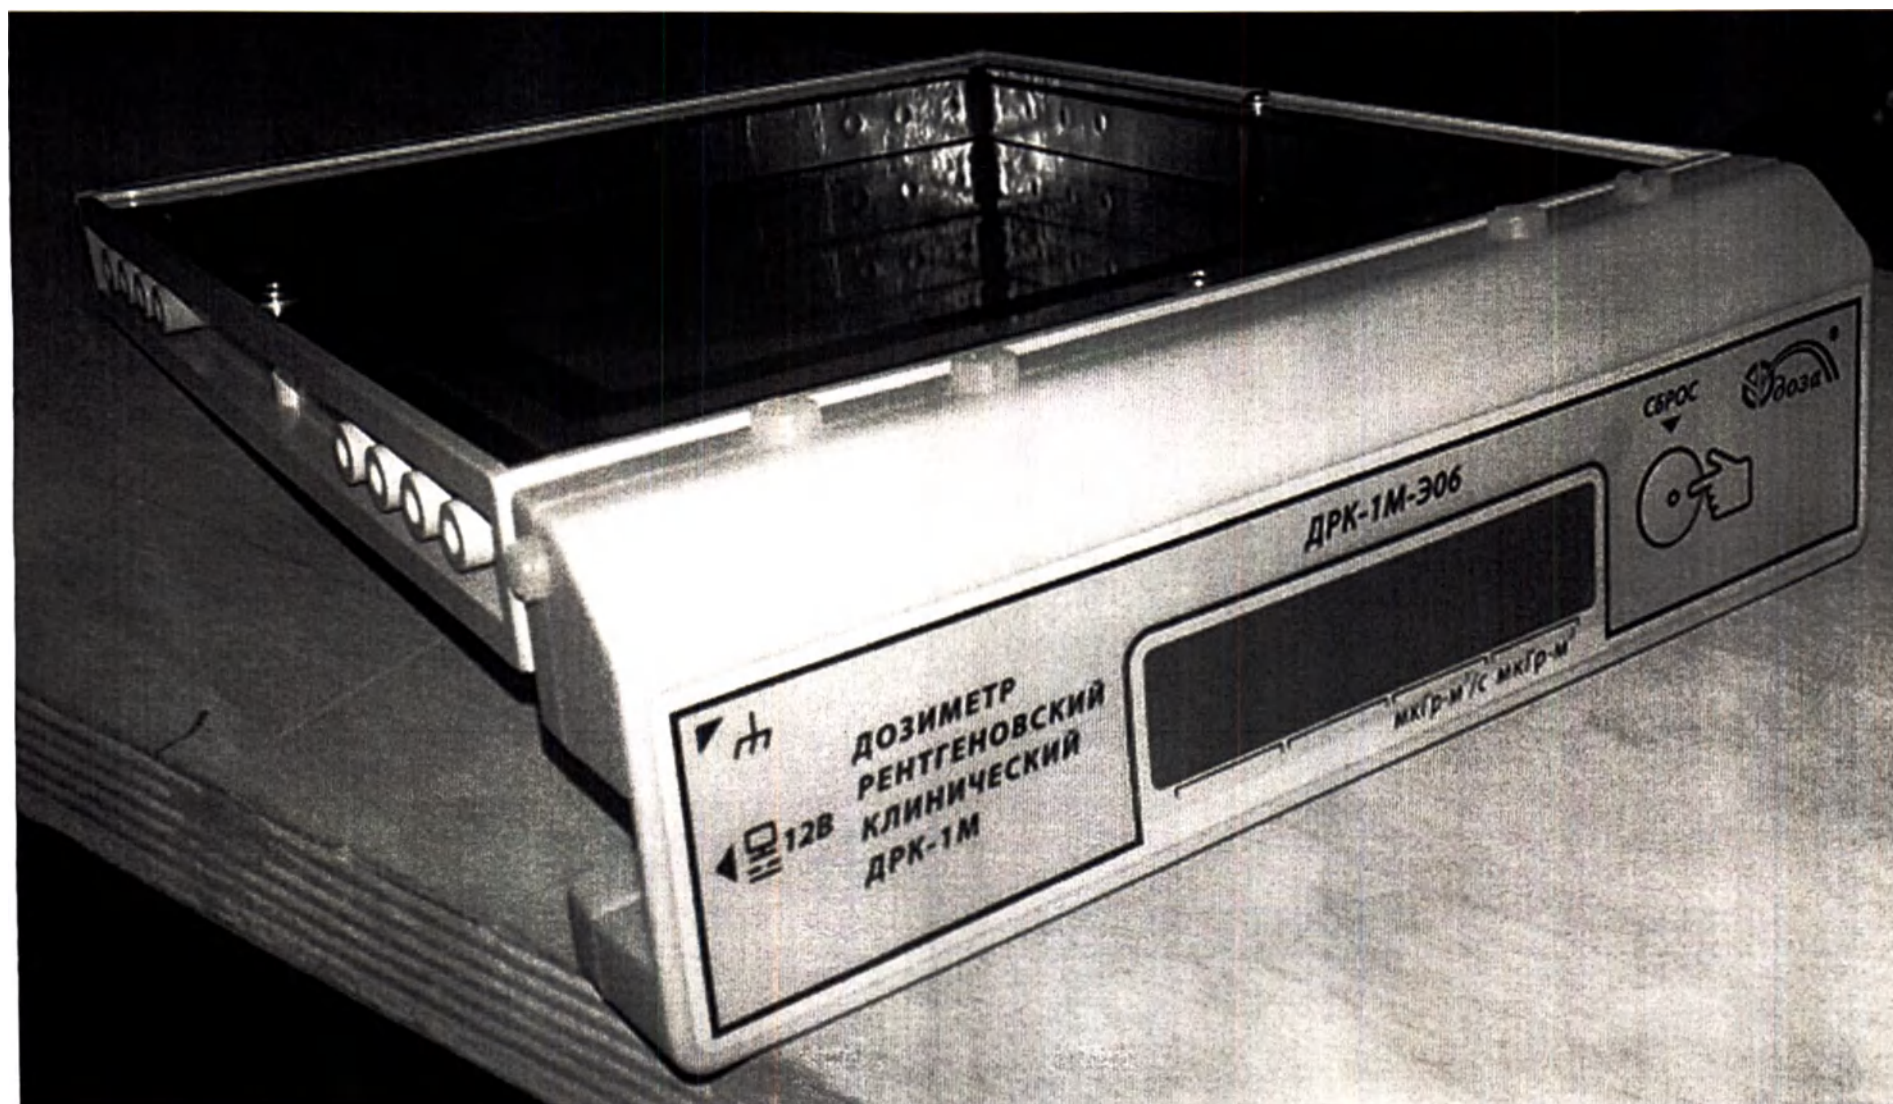


Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М, производства НПП «Доза», Россия




Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур
серии VacuDap System, производства VacuTec, Meßtechnik GmbH,
Германия.

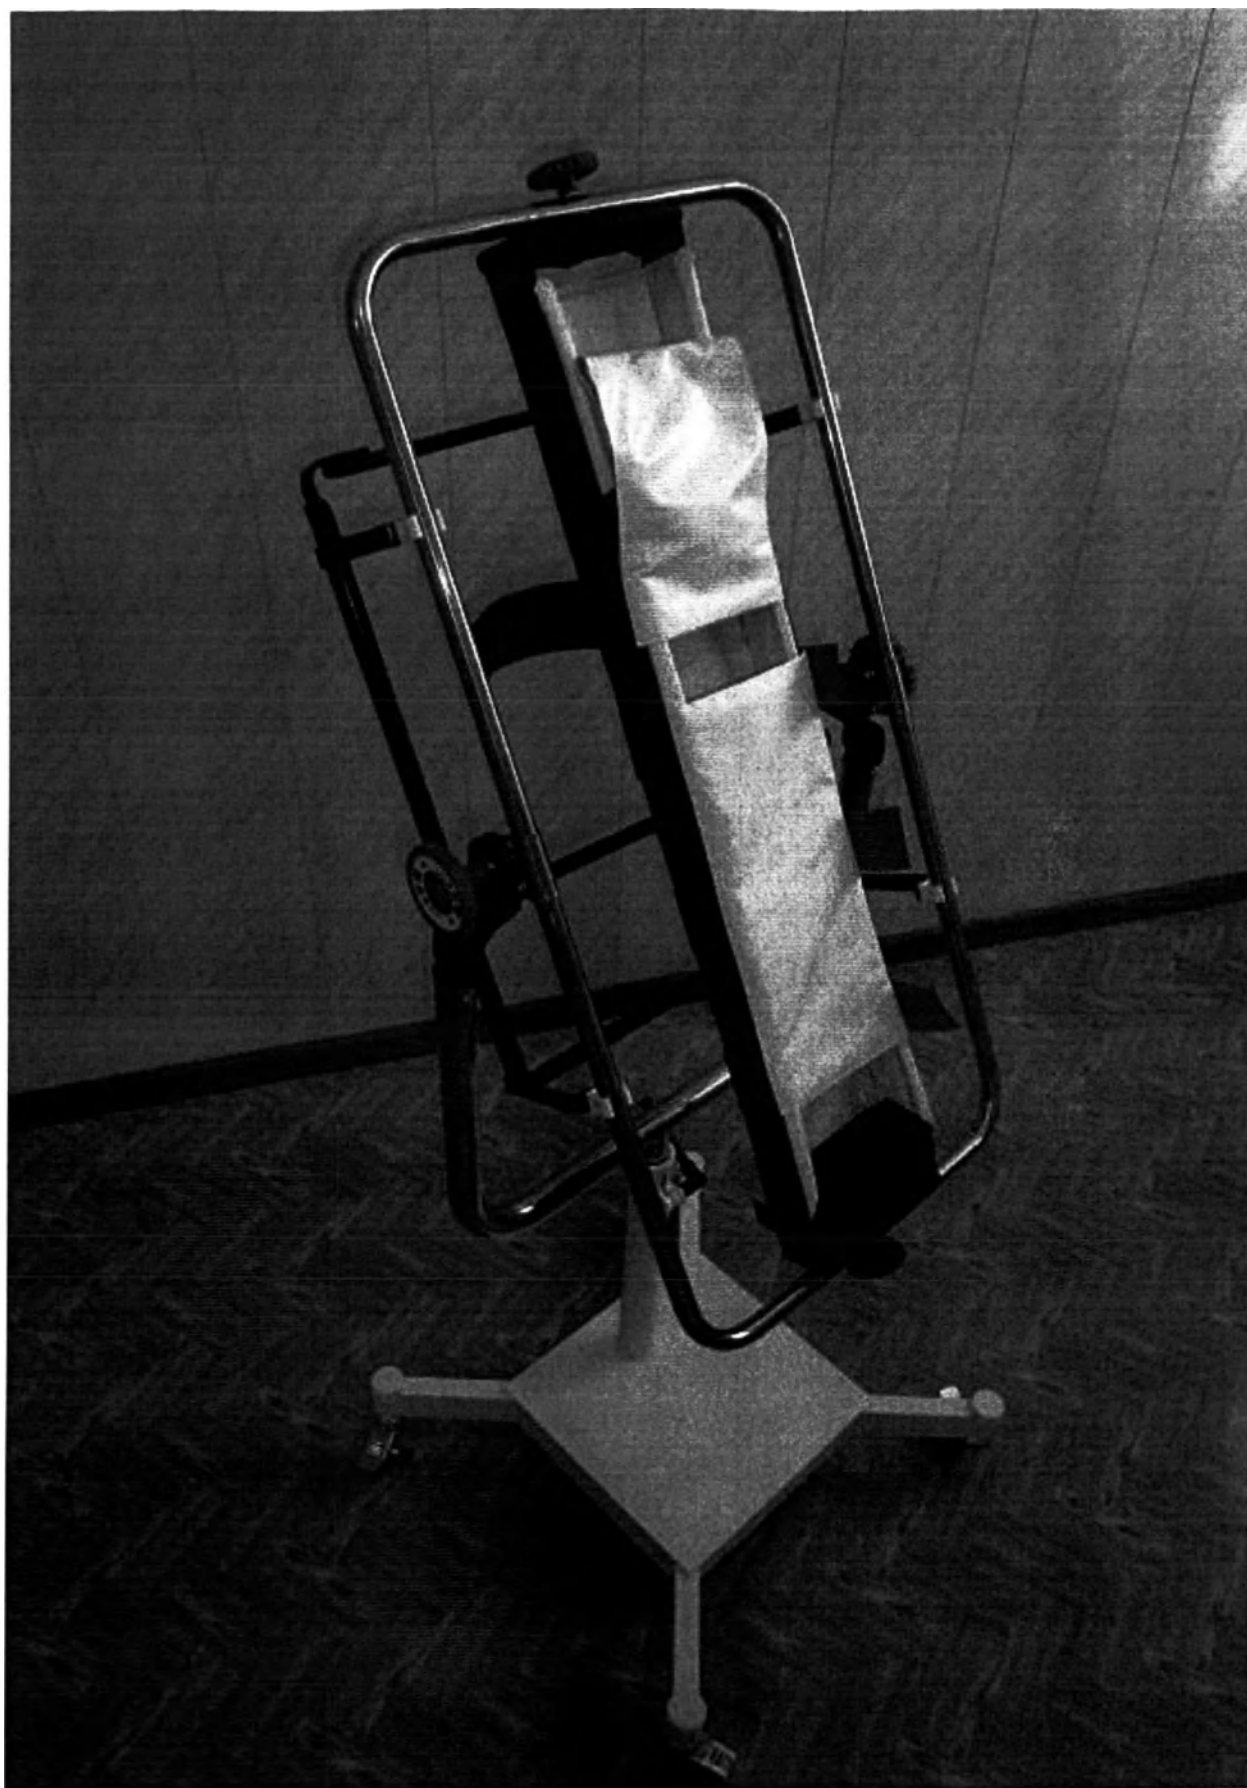


**Крепление детское универсальное по ТУ 9452-001-80020198-2010,
производства ИП Давлетов Д.Я., Россия**

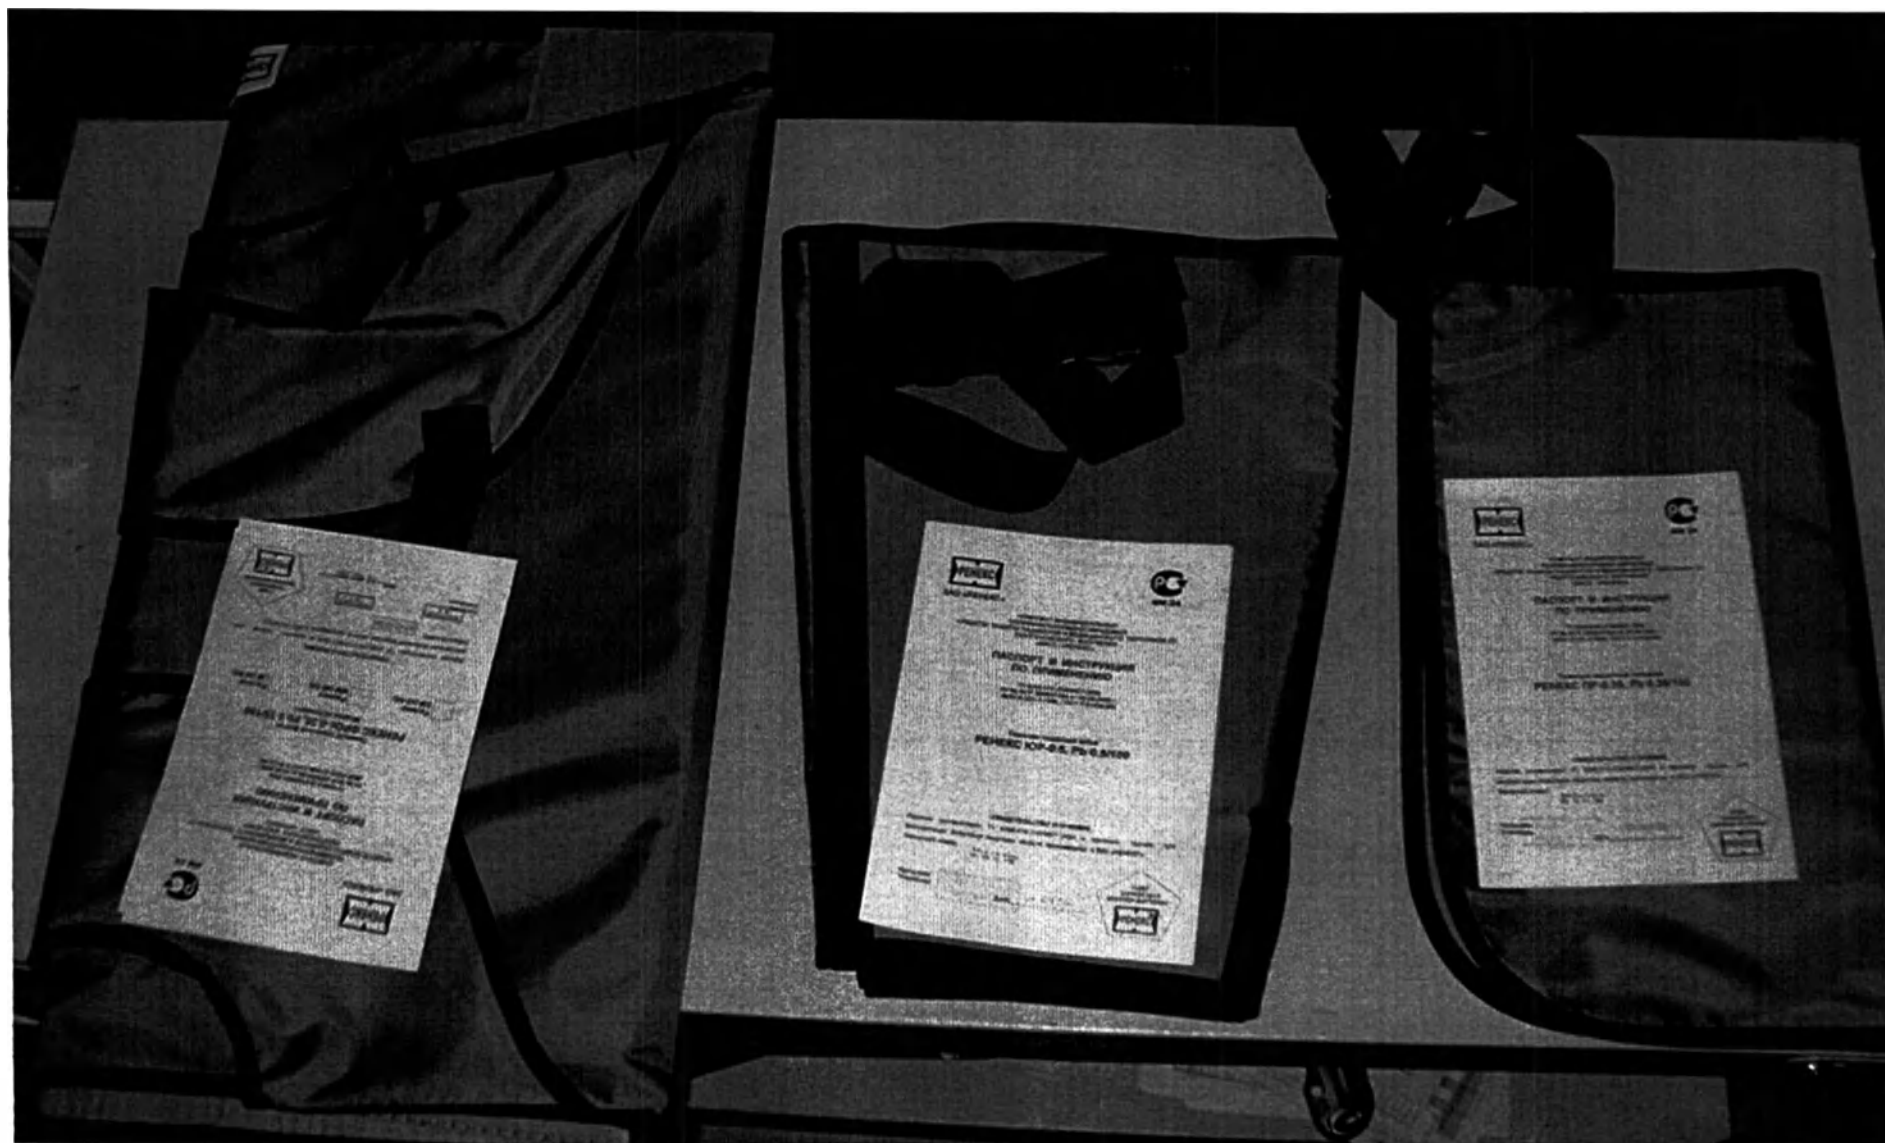

Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС» по ТУ 9398-010-21009821-2004, производства ЗАО «Ренекс», Россия

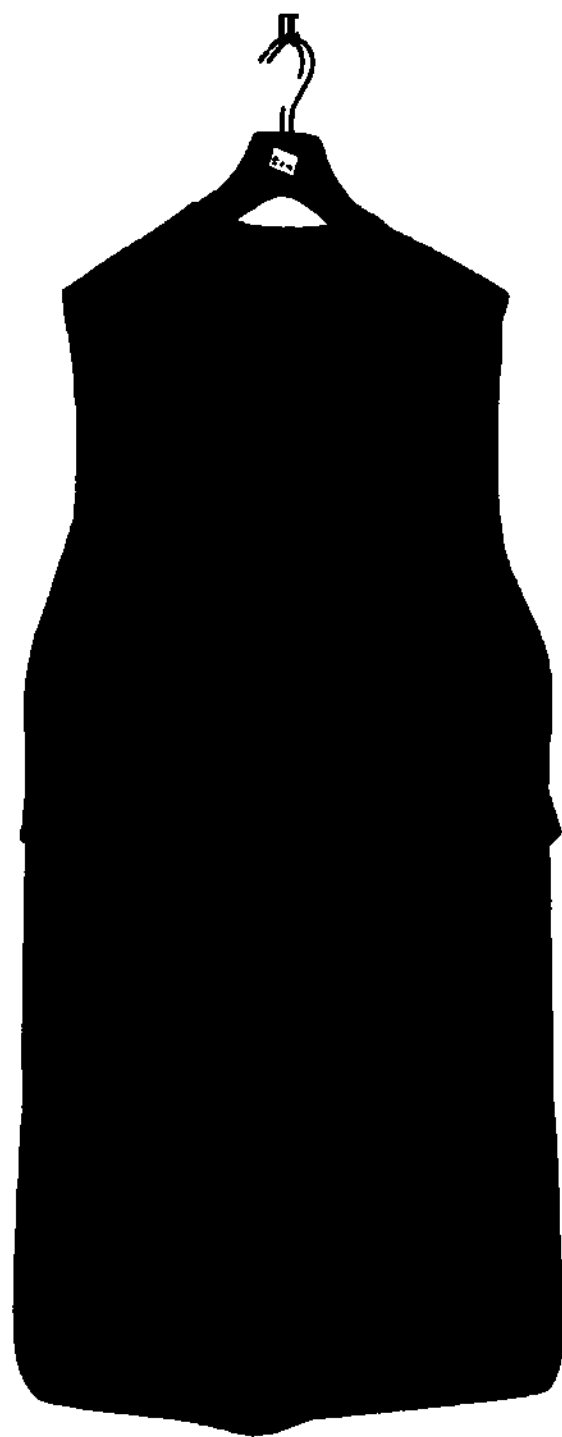


Комплекты рентгенозащитных средств из материала резиносвинцового для индивидуальной защиты врача, пациента и для использования в микропедиатрии при рентгенодиагностических исследованиях КСИЗ-РС и КСИЗмп-РС по ТУ 9452-001-42879986-2006, производства ООО «МП НПФ «Гаммамед-П», Россия

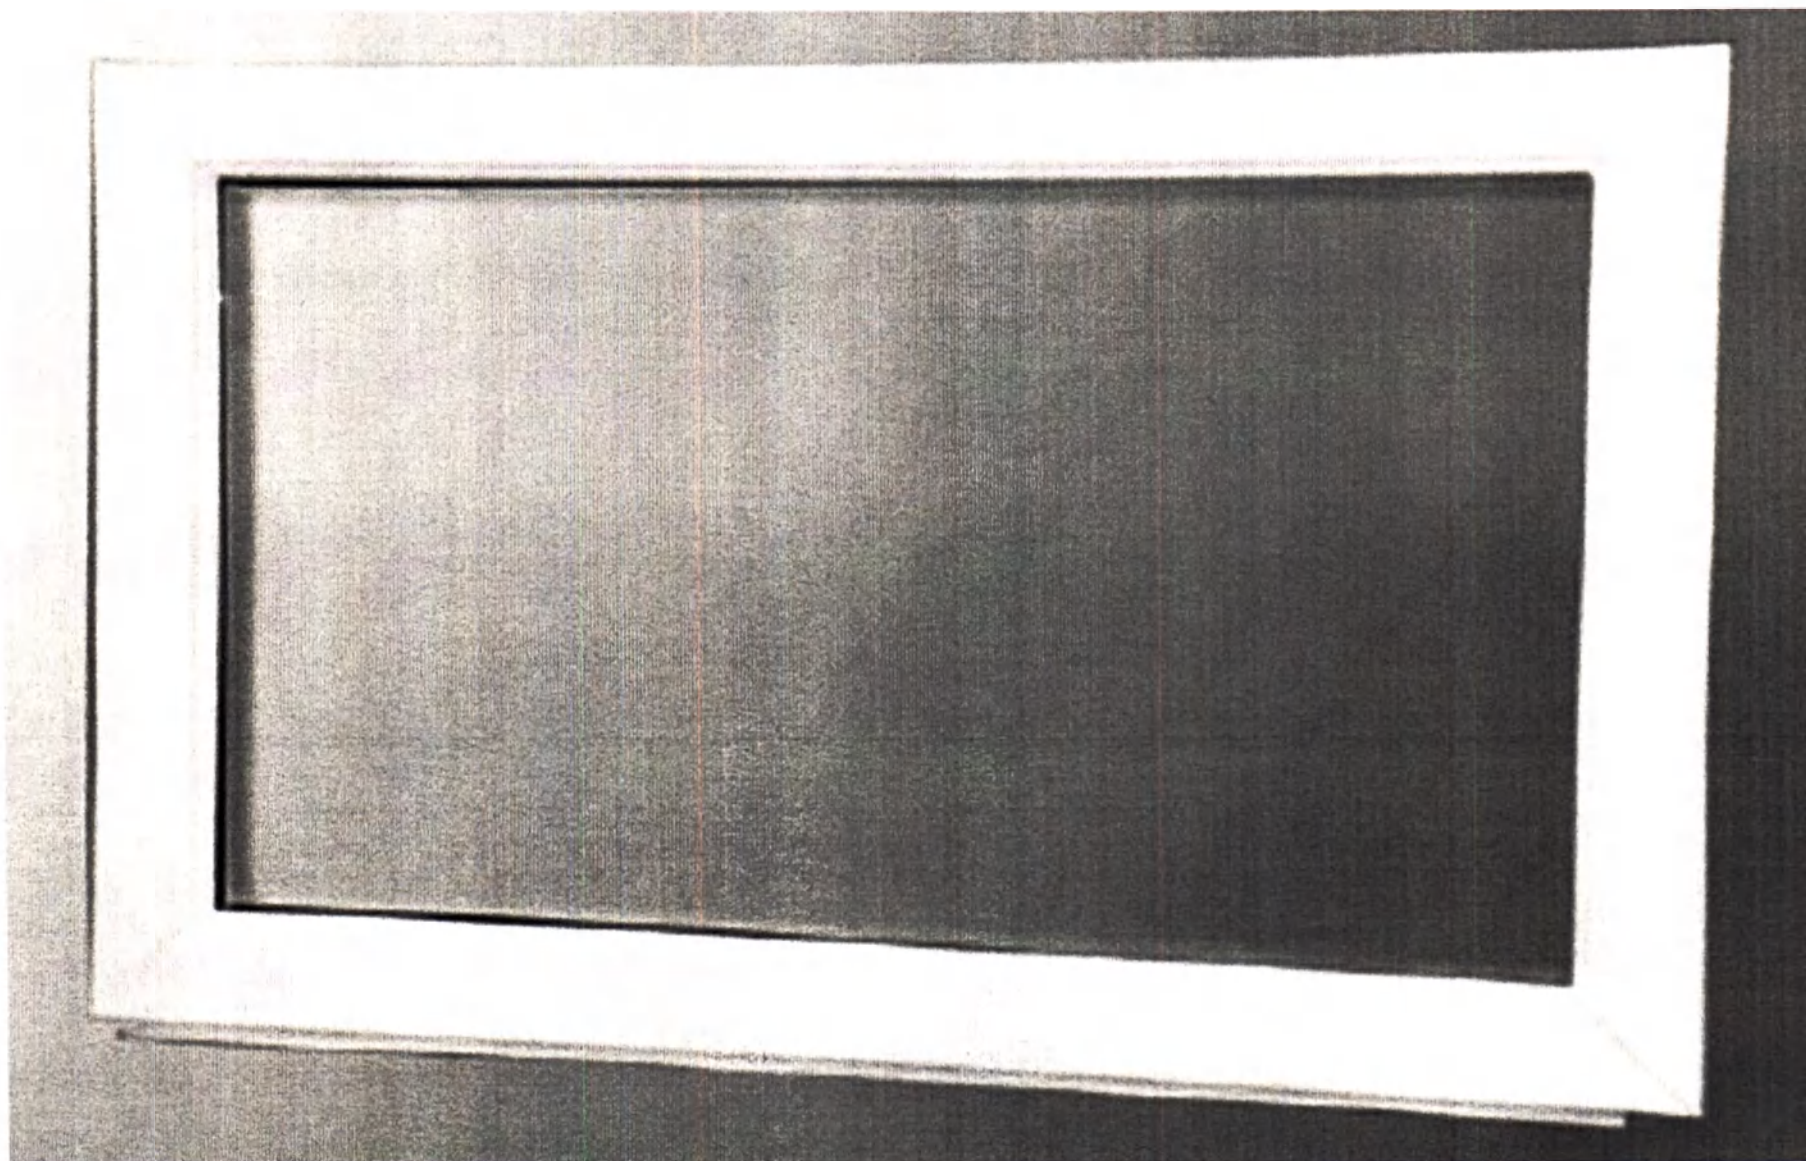

Окно рентгенозащитное серии MASO, производства Hans O.Mahn & Co. KG, Германия или РЕНЕКС ОСРЗ, производства ЗАО «Ренекс». Россия



Устройство вертикальной фиксации пациента при съемке в режиме панорамирования (сшивка изображений – панорамное сканирование) ОН-С0060, производства ООО «ВКО Медпром», Россия

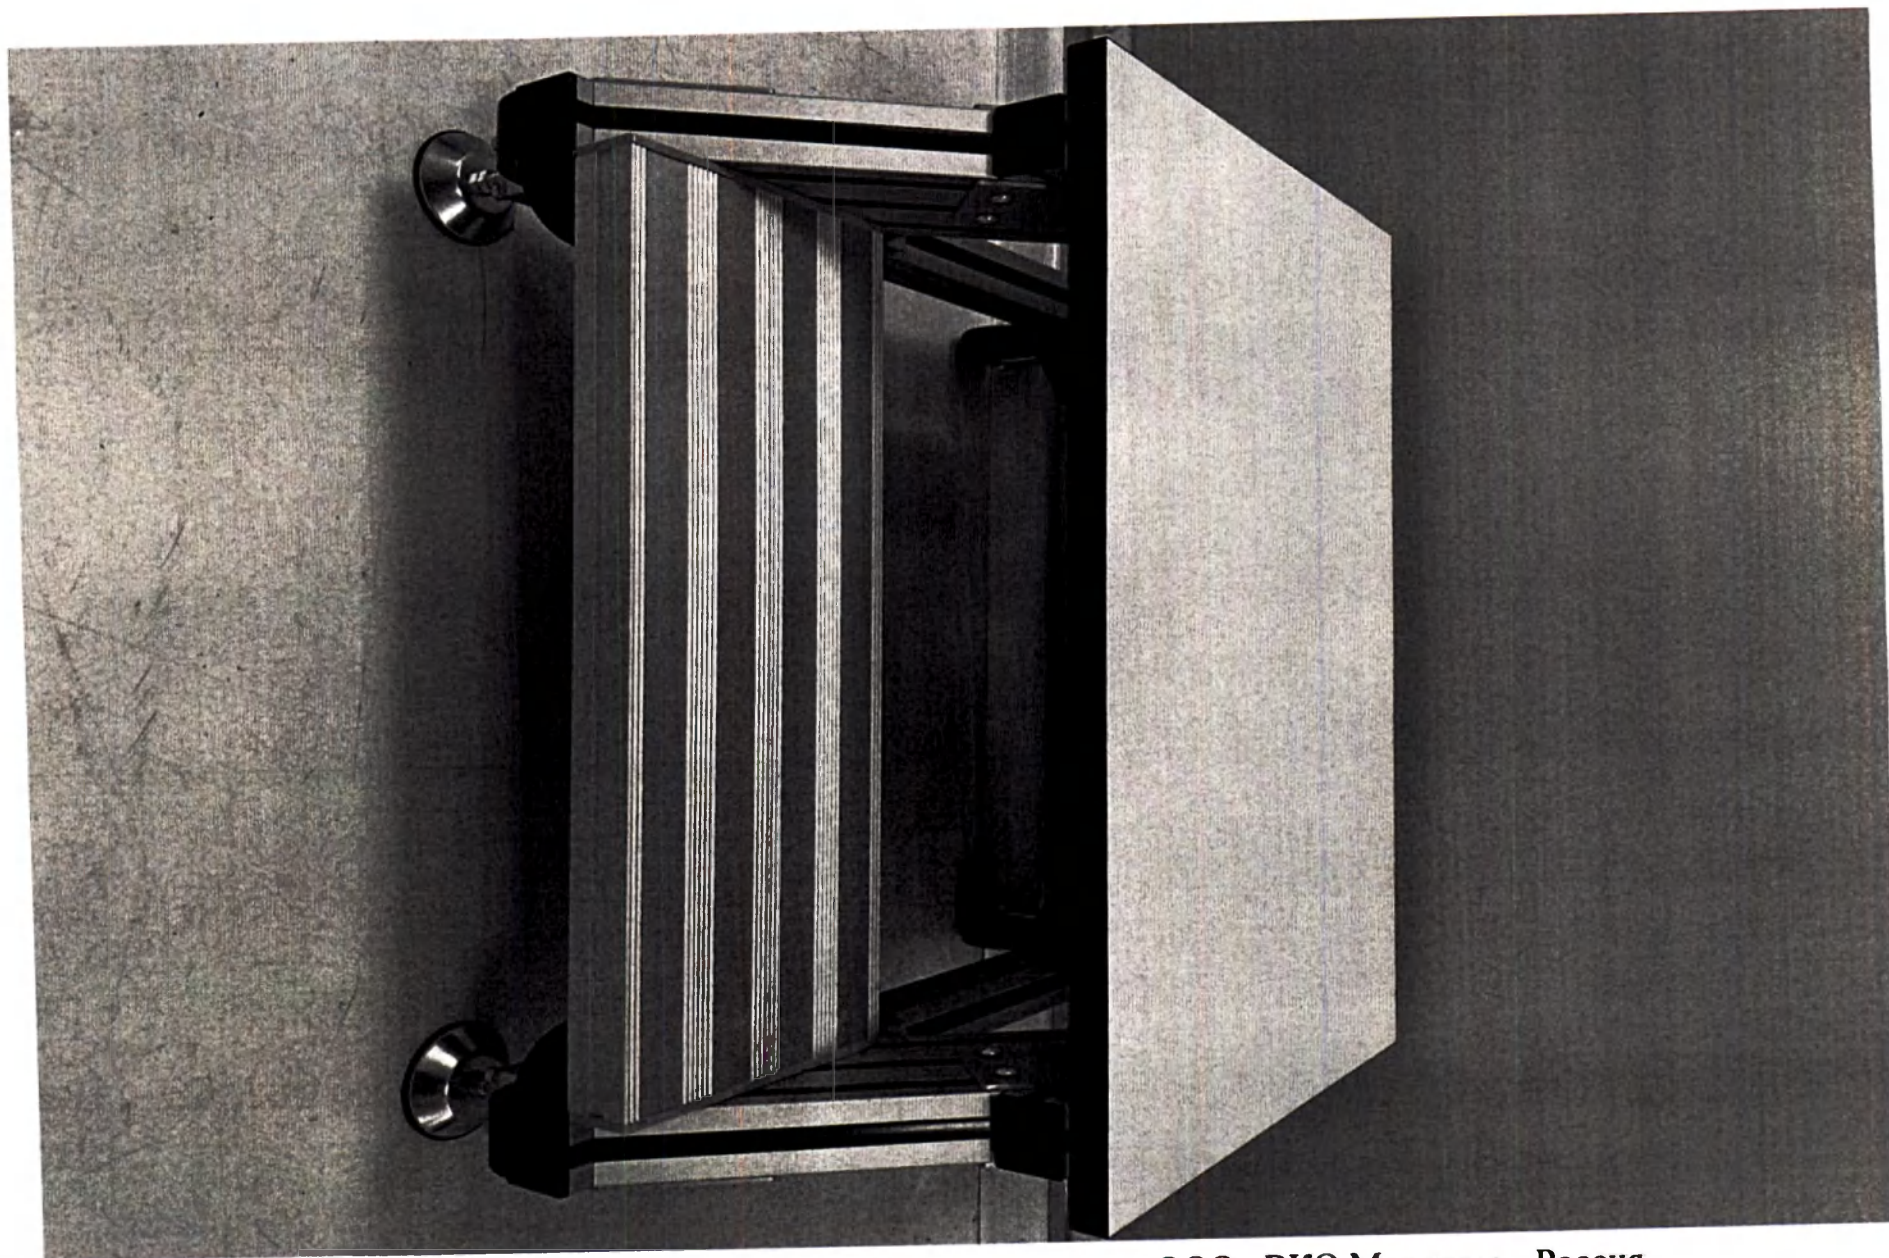

Устройство для съемки стоп Y1-C1250, производства ООО «ВКО Медпром», Россия

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 52


(пятидесяти двух) листах

Генеральный директор
ООО «ВКО Медпри» Мещеряков О.В.




Фотографии маркировки медицинского изделия
Аппарат универсальный рентгенографический
диагностический
Р-600 «Униарм-Флюорограф-Плюс»
производства ООО «ВКО Медпром», Россия

Маркировка располагается на составных частях, указанных ниже.

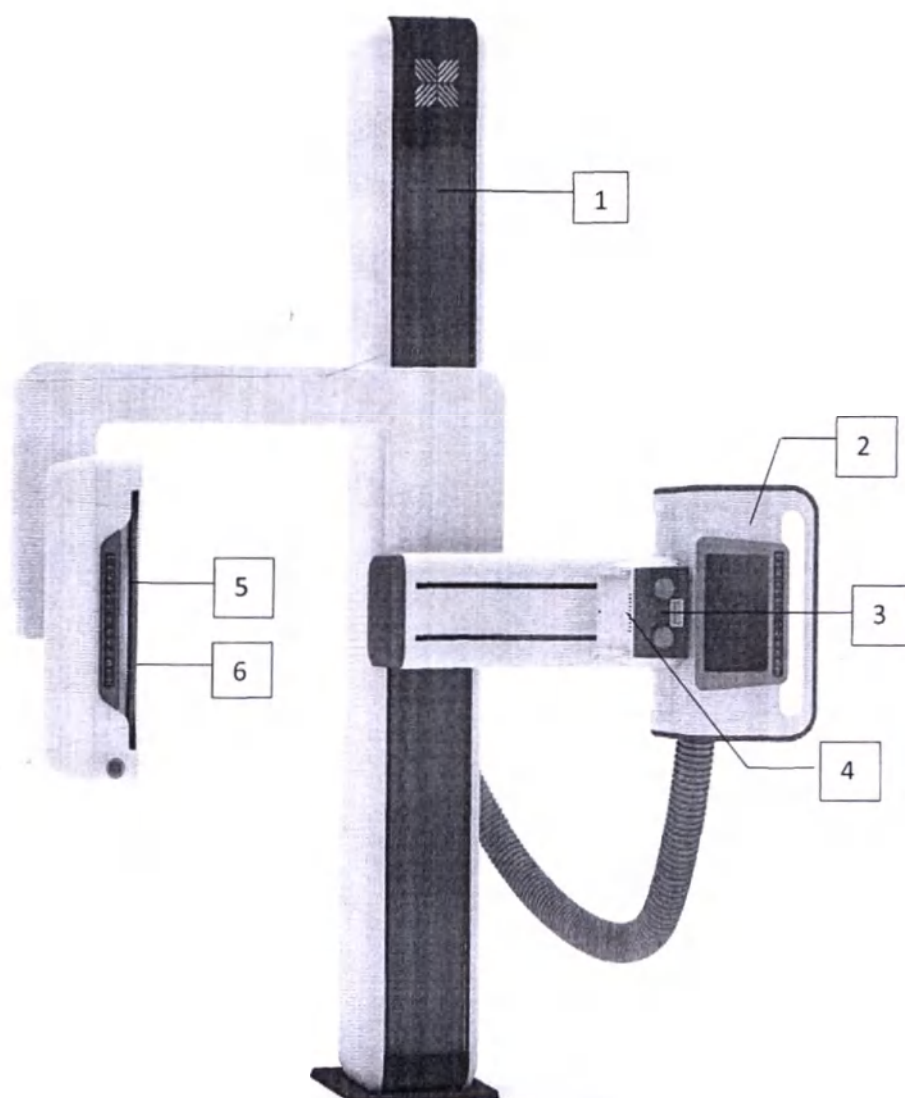

Штатив с поворотным кронштейном Y1-B0200, производства ООО «ВКО Медпром», Россия

1	Штатив с поворотным кронштейном Y1-B0200	На поворотном кронштейне
2	Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой	На обратной стороне излучателя (под кожухом)
3	Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением	На задней панели коллиматора
4	Дозиметр рентгеновского излучения клинический	На обратной стороне дозиметра (под кожухом)
5	Растр рентгеновский отсеивающий	На растре
6	Ионизационная камера	На ионизационной камере, если имеется

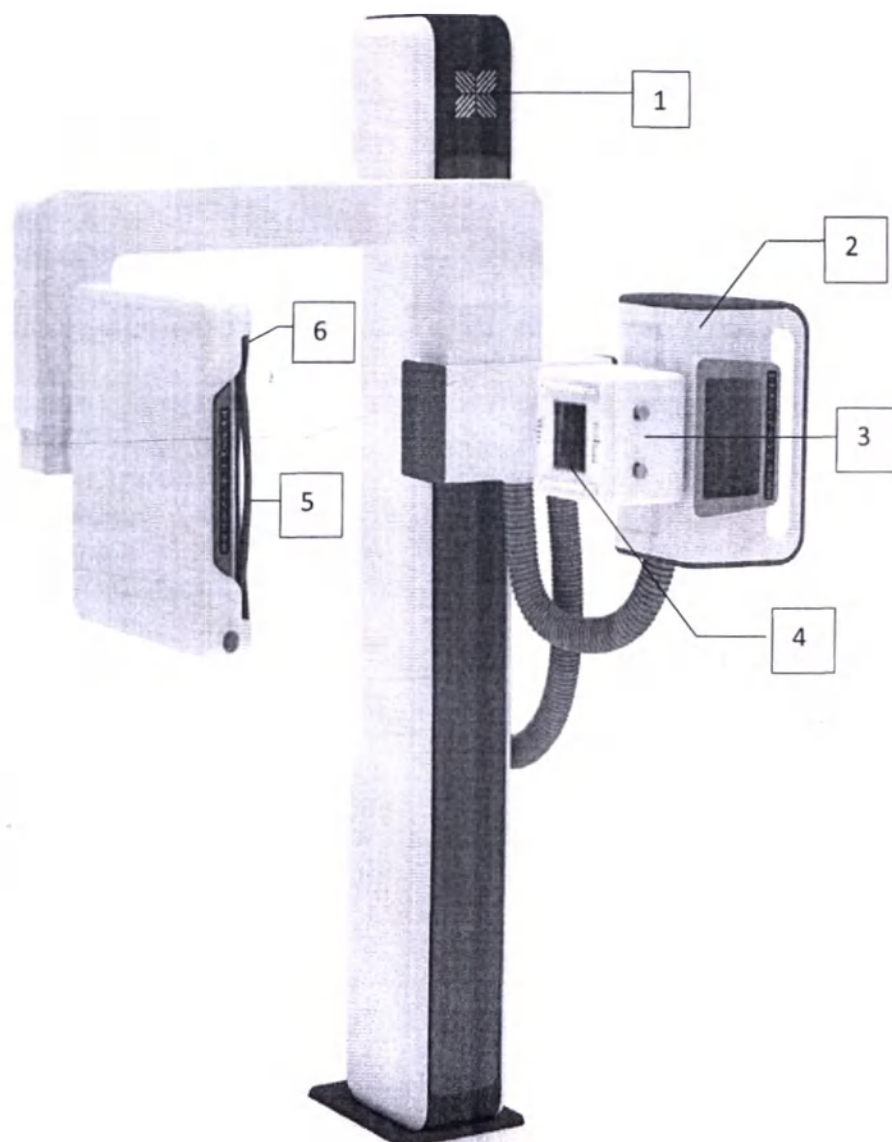


Штатив с поворотным кронштейном Y1-B0300, производства ООО «ВКО Медпром», Россия

1	Штатив с поворотным кронштейном Y1-B0300	На поворотном кронштейне
2	Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой	На обратной стороне излучателя (под кожухом)
3	Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением	На задней панели коллиматора
4	Дозиметр рентгеновского излучения клинический	На обратной стороне дозиметра (под кожухом)
5	Растр рентгеновский отсеивающий	На растре
6	Ионизационная камера	На ионизационной камере, если имеется

Кроме того, маркировка располагается на следующих частях, в том числе покупных


7	Рентгеновское питающее устройство (РПУ)	На боковой стороне генератора
8	Комплекс аппаратно-программный для регистрации и обработки рентгеновских изображений «СОЛО ДР-МТ»	На системном блоке
9	Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога «ДИАРМ-МТ-Плюс»	На системном блоке
10	Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов	На обратной стороне монитора
11	Радиологическая информационная система «ИнтеГРИС-МТ-Плюс»	На боковой стороне шкафа
12	Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС» по ТУ 9398-010-21009821-2004	На упаковке
13	Комплекты рентгенозащитных средств из материала резиносвинцового для индивидуальной защиты врача, пациента и для использования в микропедиатрии при рентгенодиагностических исследованиях КСИЗ-РС и КСИЗмп-РС по ТУ 9452-001-42879986-2006	На упаковке

- 1 Штатив с поворотным кронштейном У1-В0200 или У1-В0300 по спецификации, производства ООО «ВКО Медпром», Россия

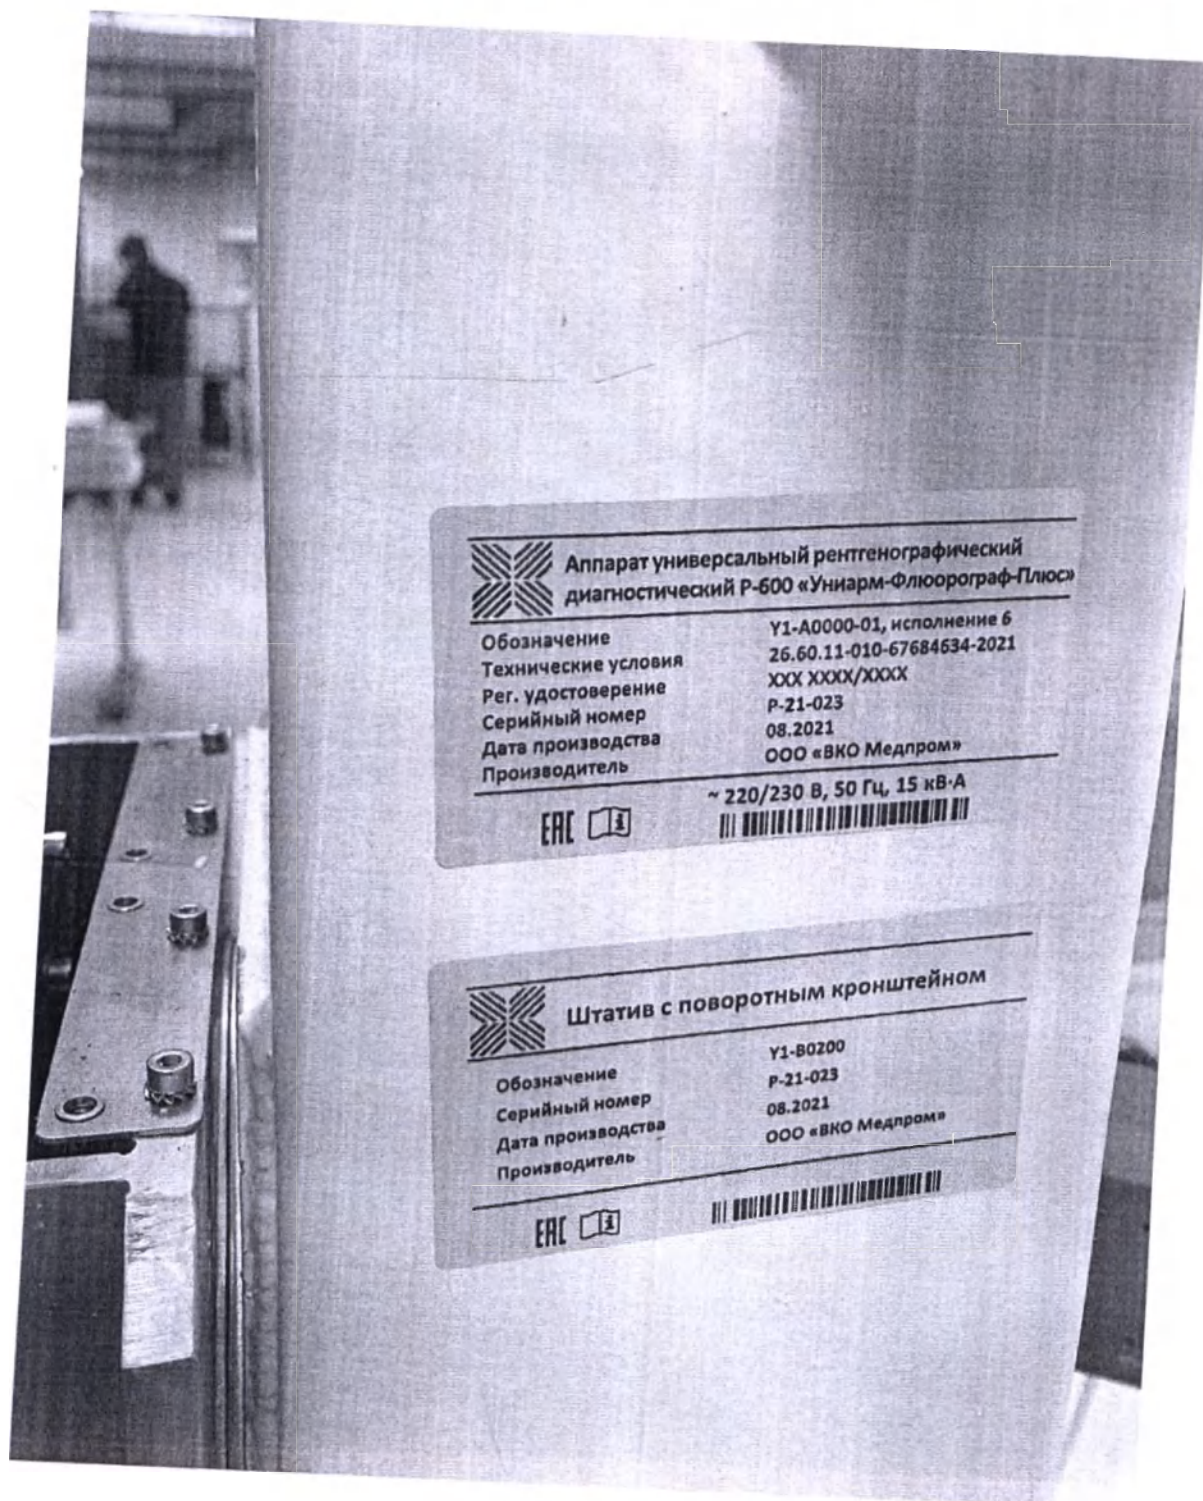


2 Излучатель

- 2.1 Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой серии E7242 или серии E7252 или серии E7864, производства Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd, Япония

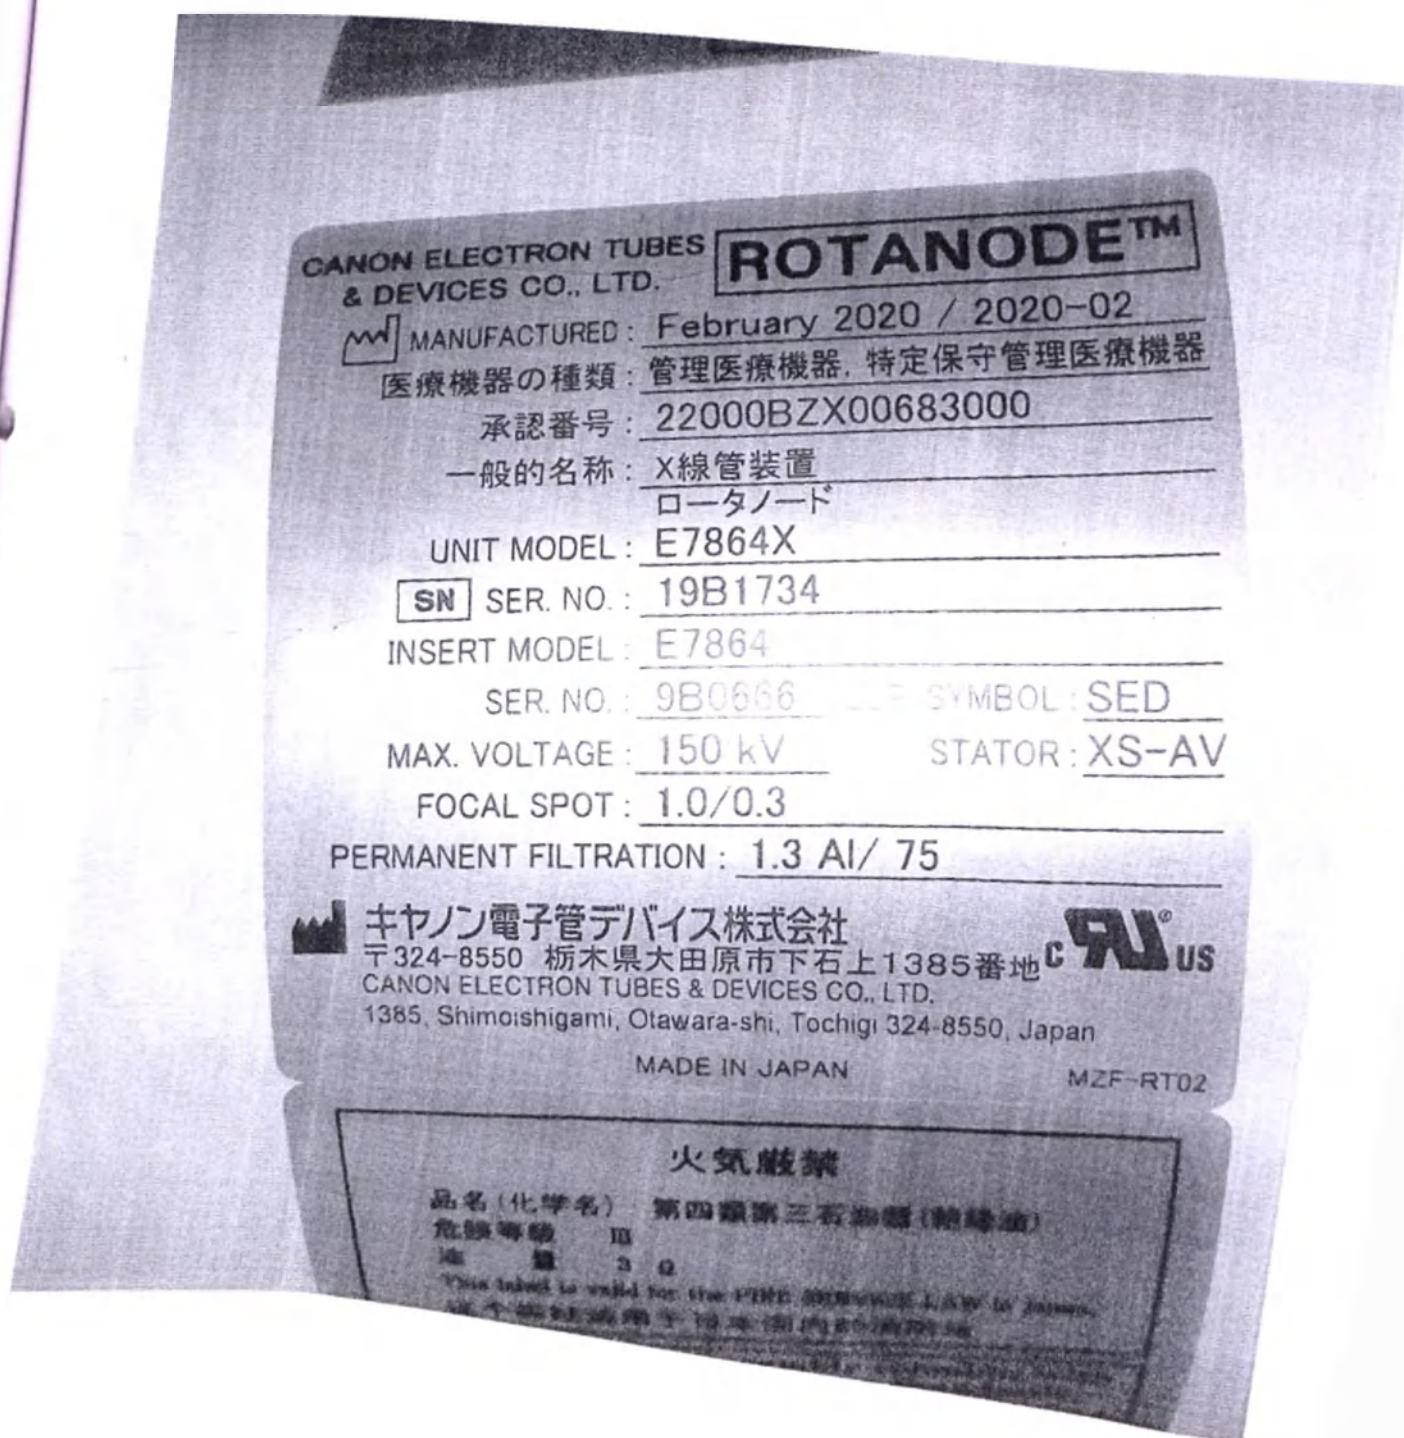

- 2.2 Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой A-297/B-130H, или RAD 14/Leo производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины

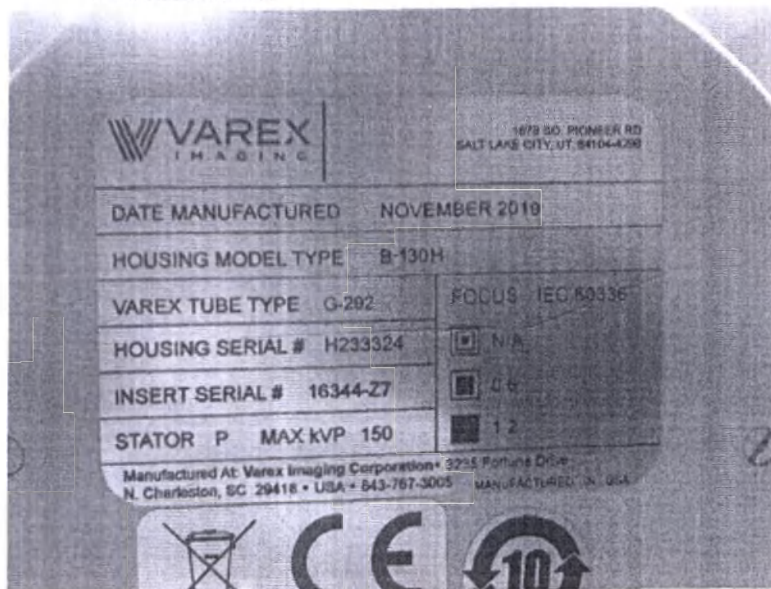


- 2.3 Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой SV 150/40/80HC-100 или SV 150/40/80C-100 производства Siemens, Германия




3 Коллиматор


3.1 Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии R 221, производства Ralco srl., Италия

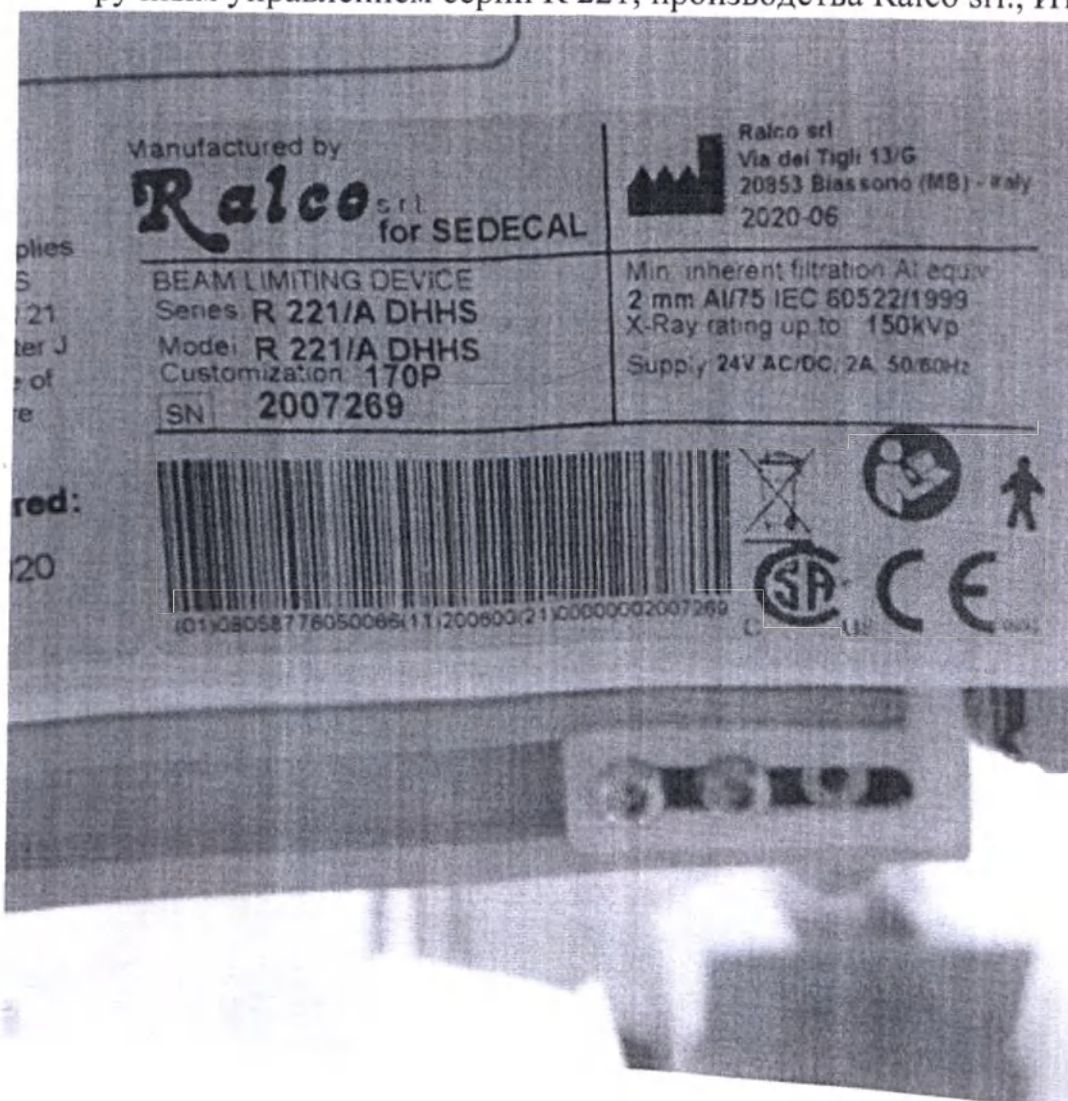


- 3.2 Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии R 225, производства Ralco srl., Италия

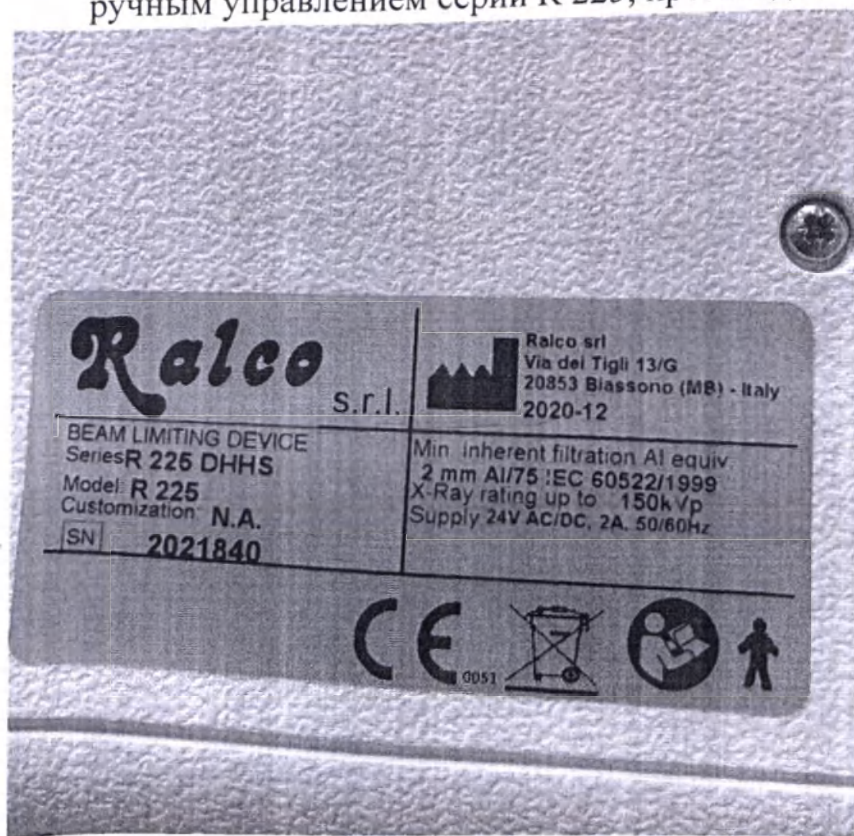

- 3.3 Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии R 302, производства Ralco srl., Италия

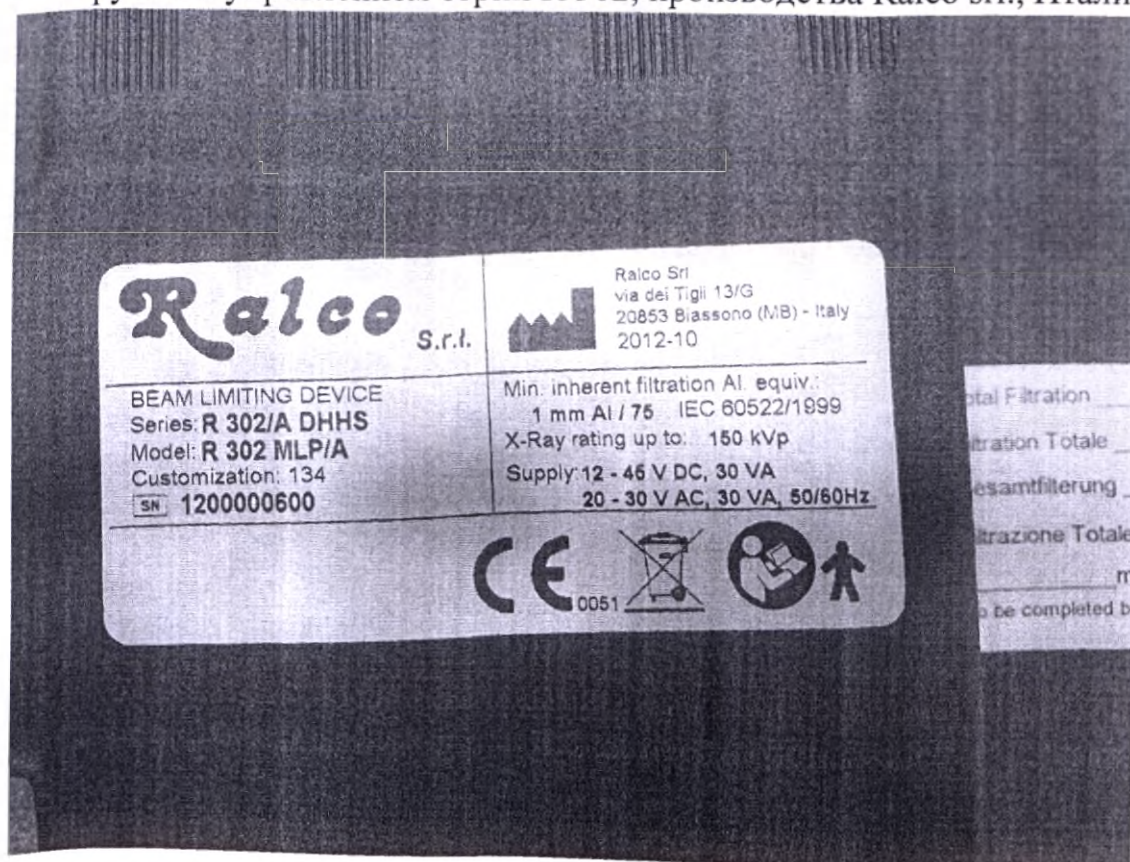

- 3.4 Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии Optica 10 или серии Optica 20 или серии Optica 30 или серии Optica 40, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины


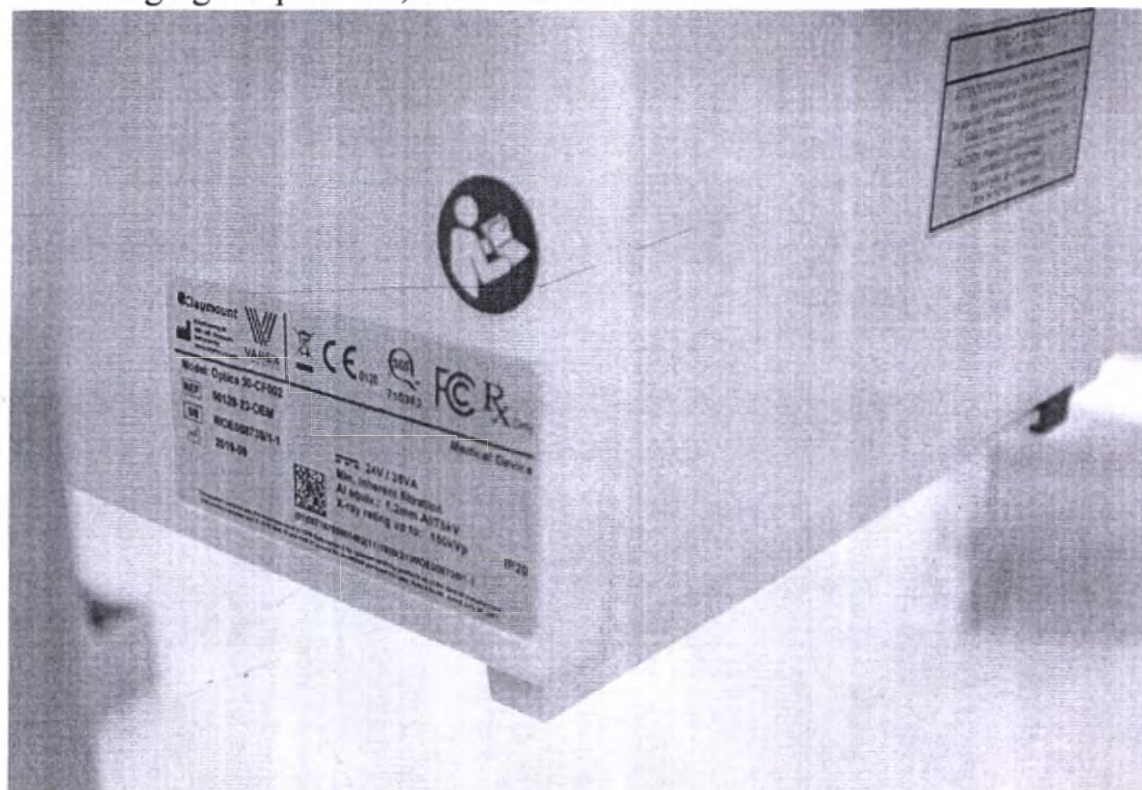


3.5 Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии ML 01 II, производства Siemens, Германия




4 Дозиметр

4.1 Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М, производства НПП «Доза», Россия

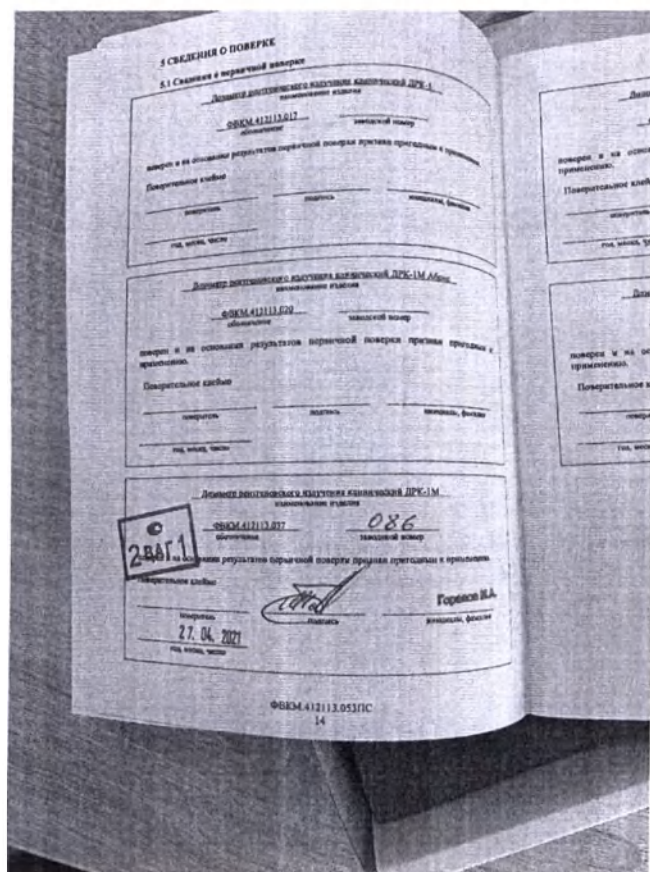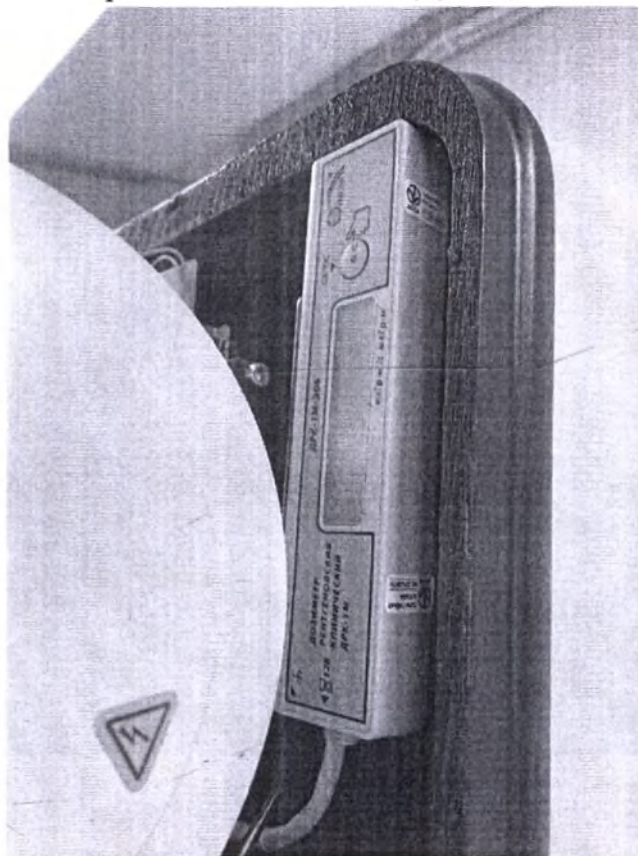


4.2 Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур серии VacuDap System, производства VacuTec, Meßtechnik GmbH, Германия .

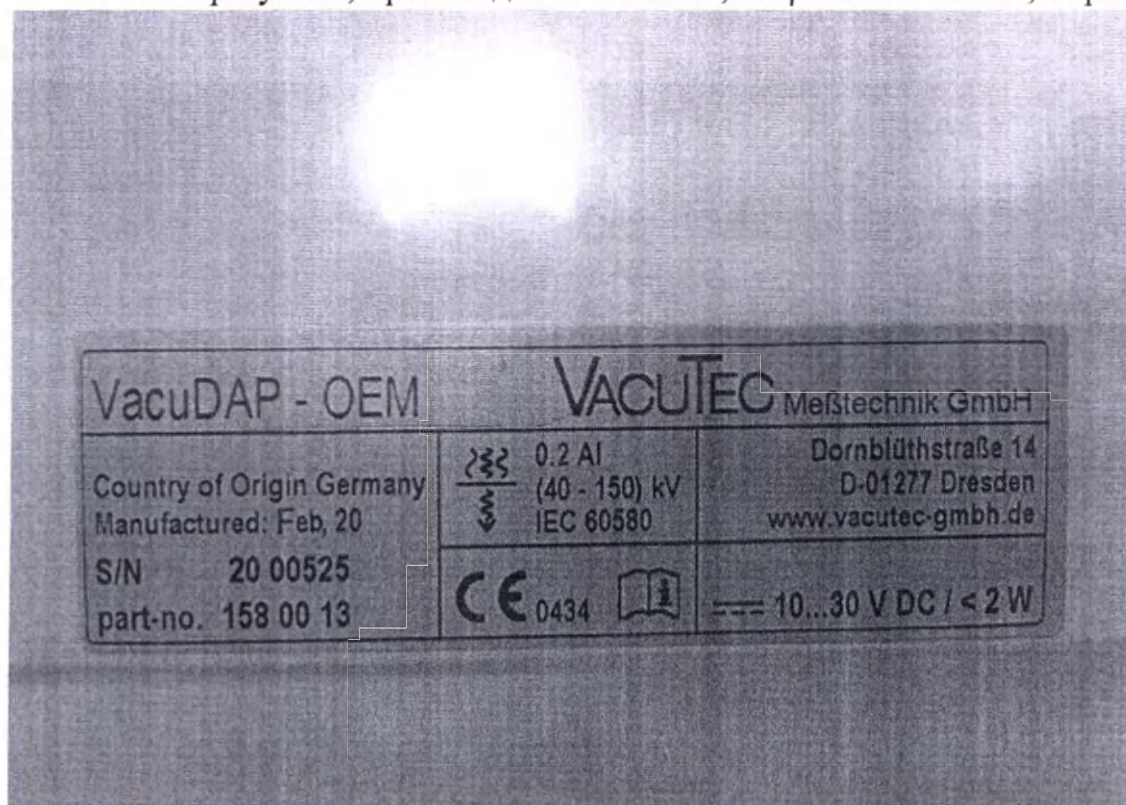


5 Растр

5.1 Растр рентгеновский отсеивающий Lysholm, производства Gridline A.B., Швеция

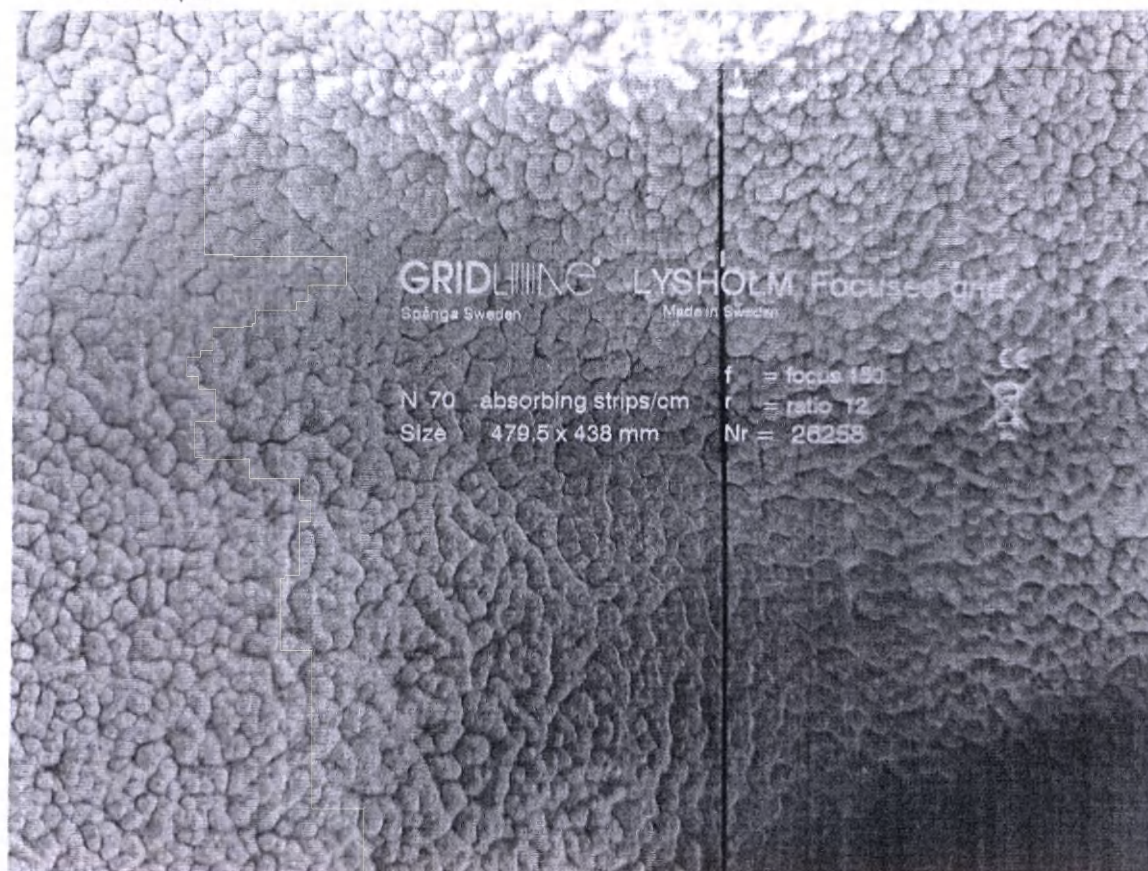


5.2 Растр рентгеновский отсеивающий JPI, производства JPI Healthcare Co., Ltd, Республика Корея

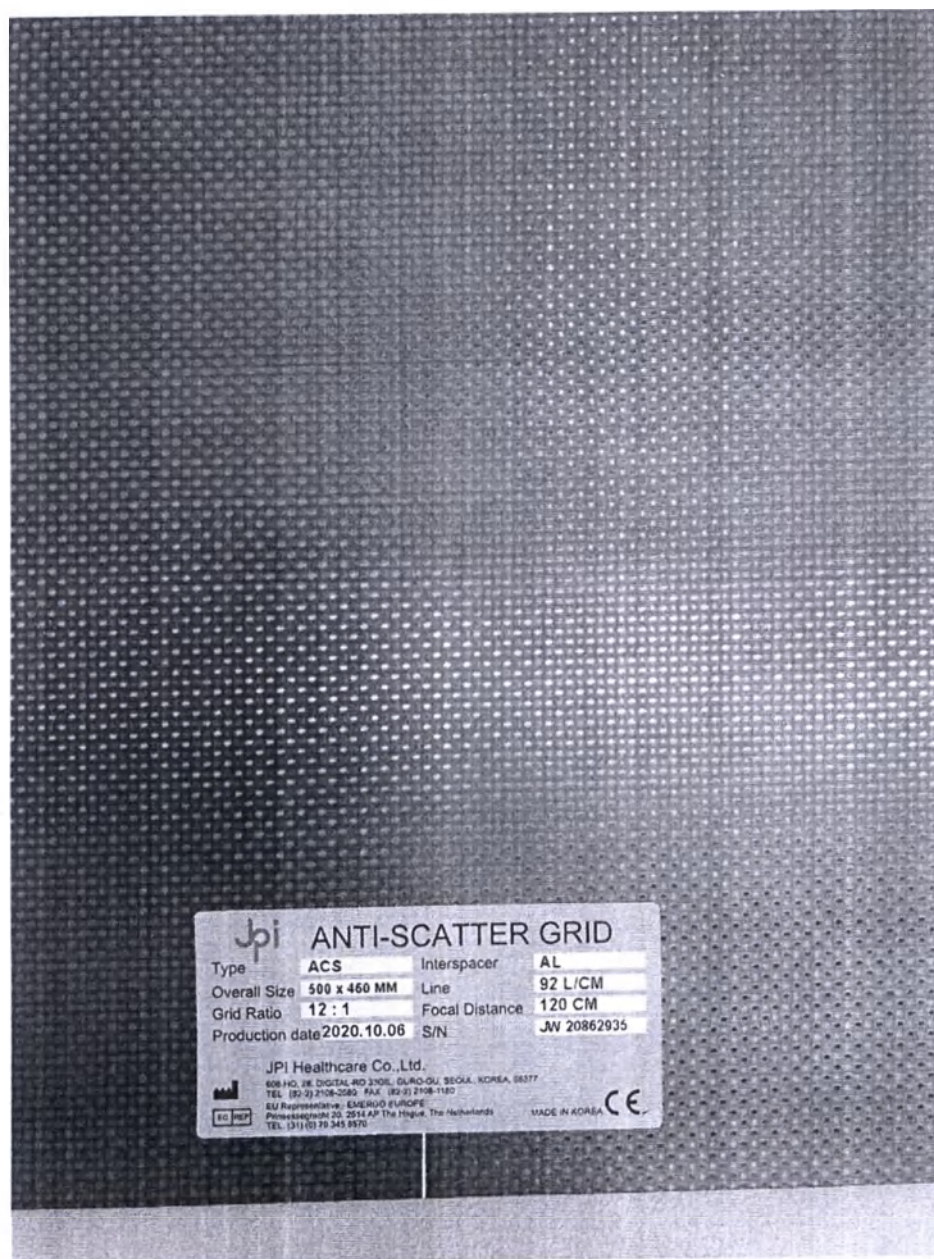


6 Ионизационная камера

6.1 Ионизационная камера серии 70, производства VacuTec, Meßtechnik GmbH, Германия

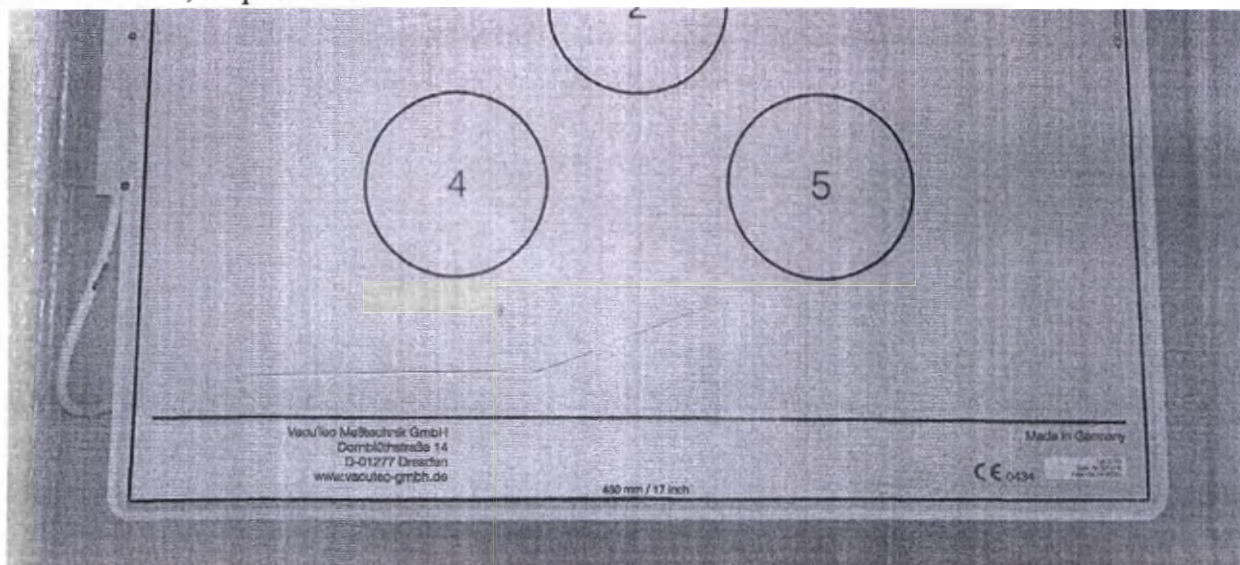


6.2 Ионизационная камера серии SSMC, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины

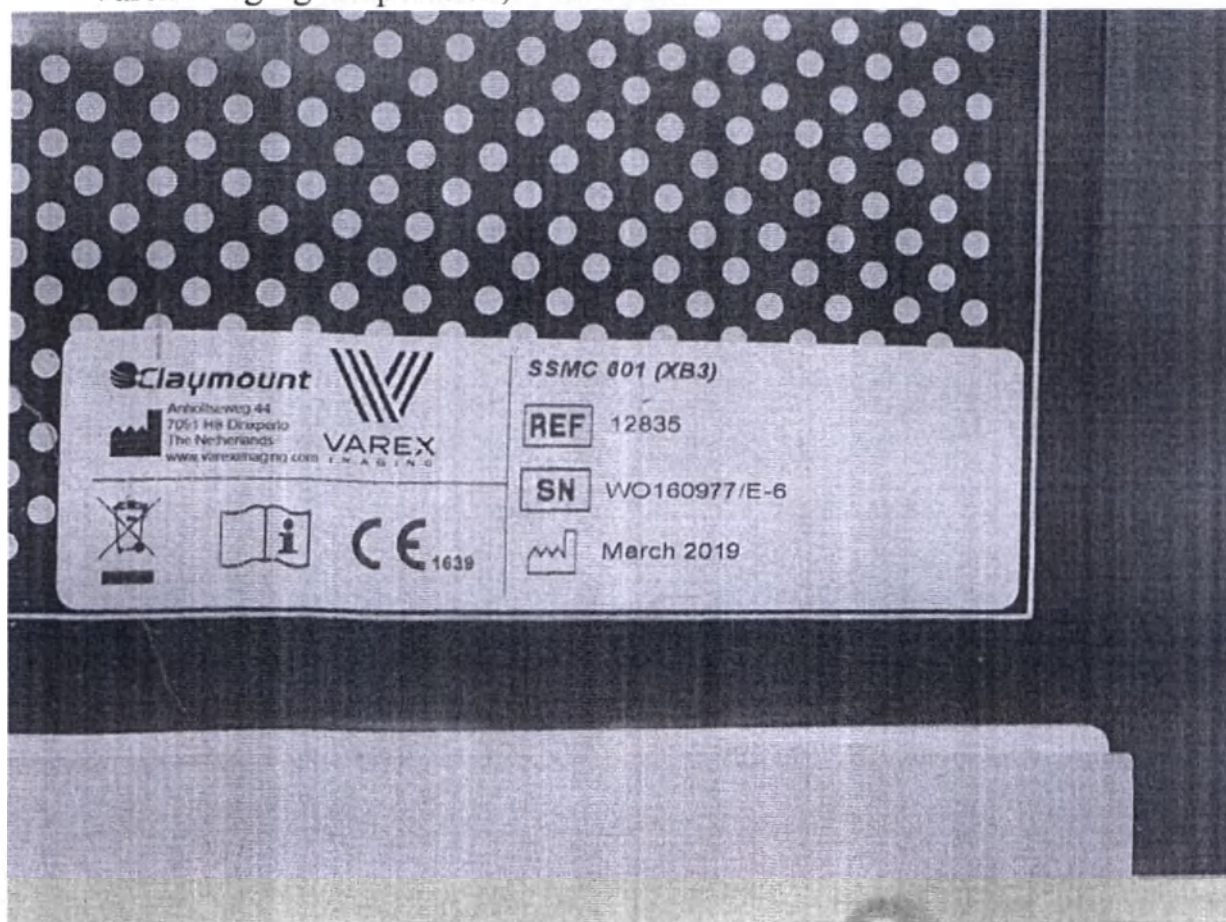

7 Рентгеновское питающее устройство (РПУ)

- 7.1 Рентгеновское питающее устройство (РПУ) серии ZR75PN50 или серии ZR75PN65 или серии ZR75PN80, производства Spellman, США или Spellman High Voltage Electronics GmbH, Германия или Spellman High Voltage Electronics (SIP) Co., Ltd, Китай

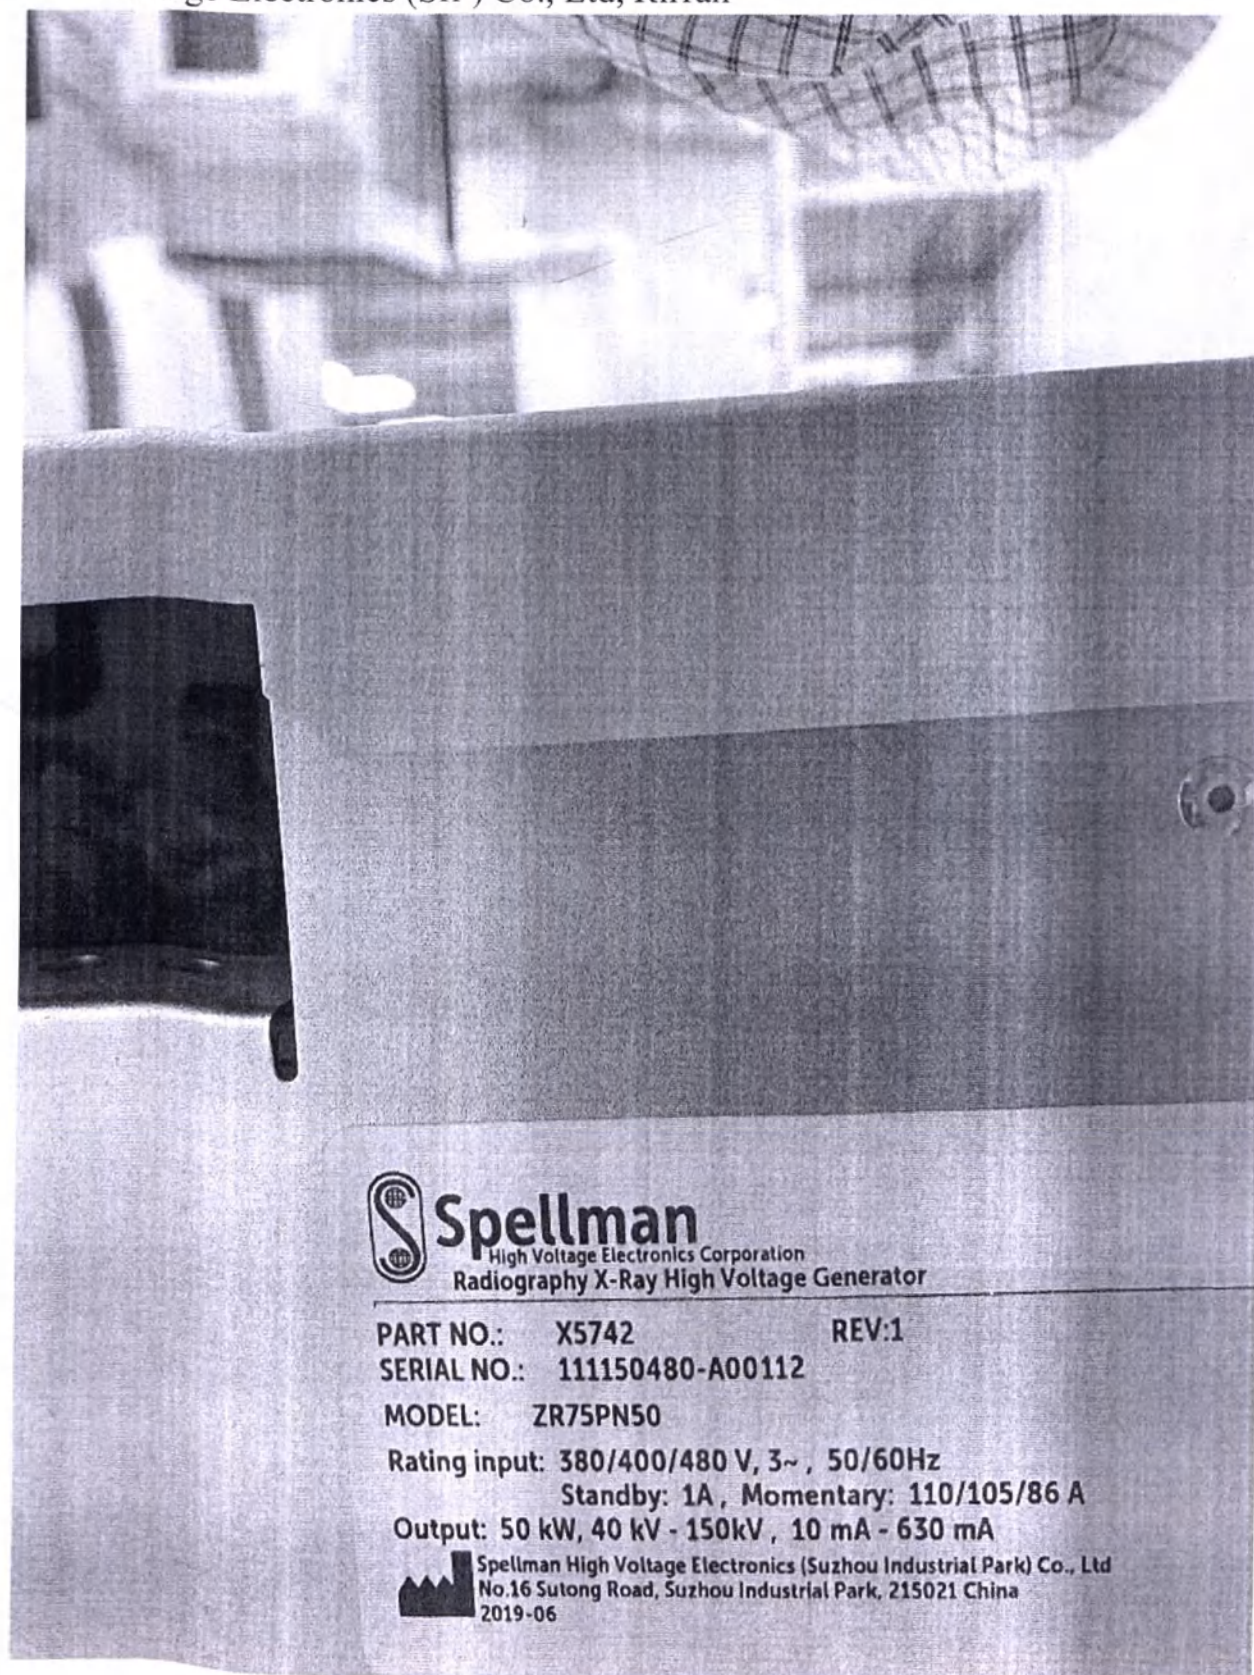


7.2 Рентгеновское питающее устройство (РПУ) серии CMP 200,
производства Communications & Power Industries Canada Inc., Канада


SYSTEM CONTAINS SOFTWARE	
PART NO.:	
90623700	
REVISION:	
AA	
COMPATIBLE WITH SYSTEM MODEL :	
VZW2558FB812	

RoHS	MANUFACTURED FOR	
	MEDICAL TECHNOLOGIES Ltd.	
	109052 Moscow, Russia	
	BY	
	Communications & Power Industries Canada Inc.	
	45 River Drive, Georgetown, Ontario, Canada, L7G 2J4	
	MADE IN CANADA	
MODEL NO.:	VZW2558FB812	
CONFIGURATION:	-35	
SERIES:	G200RF-1T-MT-50KW	
PART NO.:	VZW2558FB812-35	
SERIAL NO.:	AMQ01515H19	
MFG. DATE:	August 2019	
VOLTS AC:	400-480	
	MOMENTARY	NOMINAL
AMPS AC:	107-90	3
FREQ:	50/60 Hz	PHASE: 3
COMPLIES WITH IEC 60601-2-54: 2009 & CDRH RADIATION PERFORMANCE STANDARD 21 CFR, SUBCHAPTER J		

- 7.3 Рентгеновское питающее устройство (РПУ) INDICO IQ 50 kW или INDICO IQ 65 kW или INDICO IQ 80 kW, производства Communications & Power Industries Canada Inc., Канада

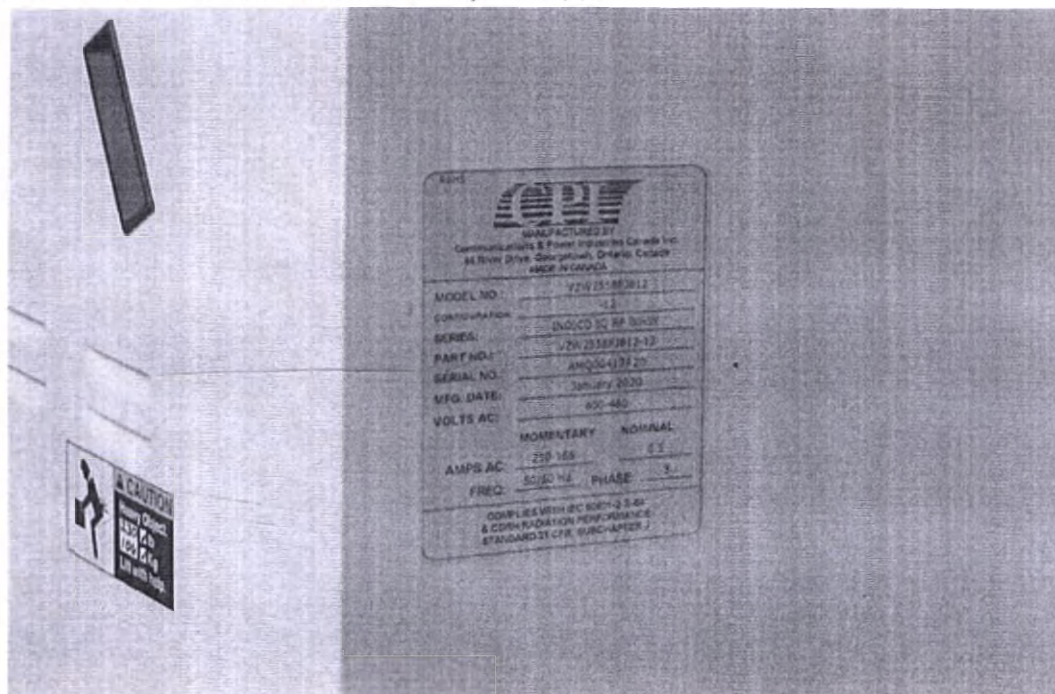


- 7.4 Рентгеновское питающее устройство (РПУ) Polydoros RF 80 55kW или Polydoros RF 80 65kW или Polydoros RF 80 80kW, производства Siemens, Германия

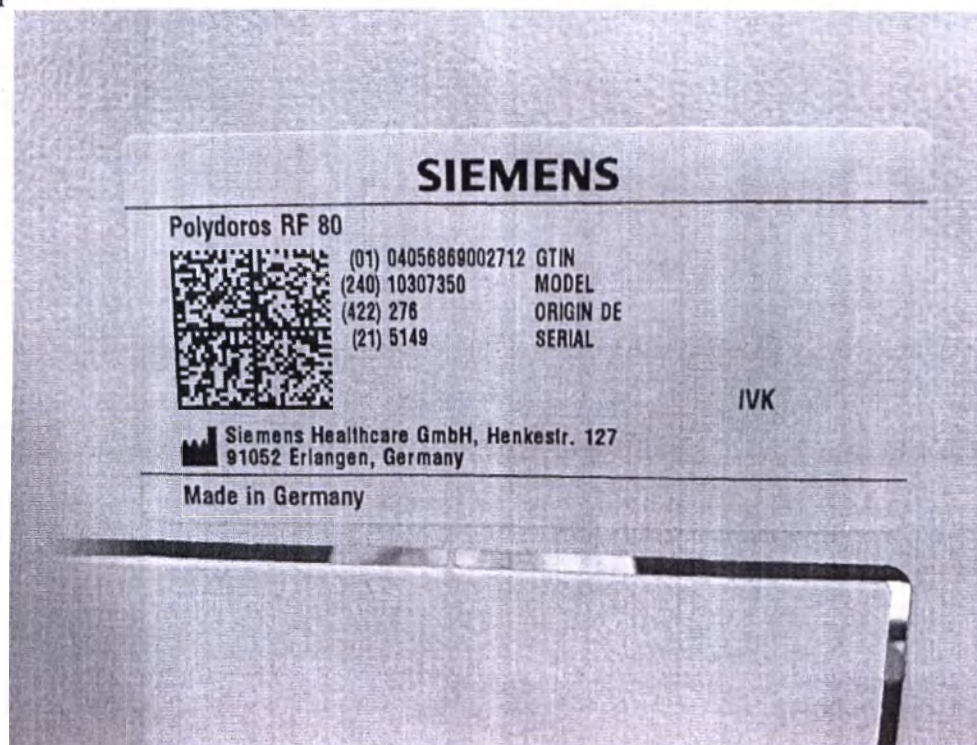


Рентгеновское питающее устройство (РПУ)	
Обозначение	X1-80800
Серийный номер	P-21-023
Дата производства	08.2021
Производитель	ООО «ВКО Медпром»

EAC 3N~ 380/400 В, 50 Гц

8 Комплекс аппаратно-программный для регистрации и обработки рентгеновских изображений «СОЛО ДР-МТ», производства АО «МТЛ», Россия

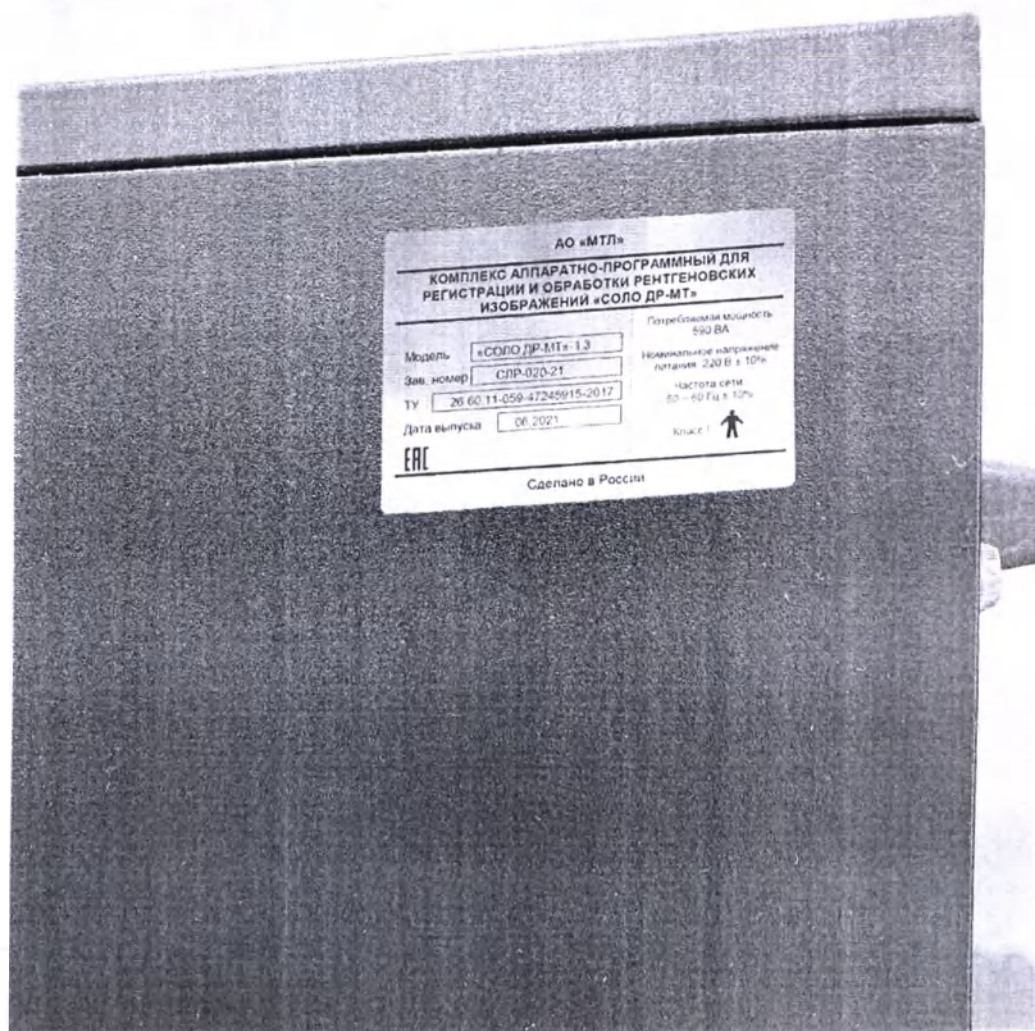

9 Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога «ДИАРМ-МТ-Плюс», производства АО «МТЛ», Россия

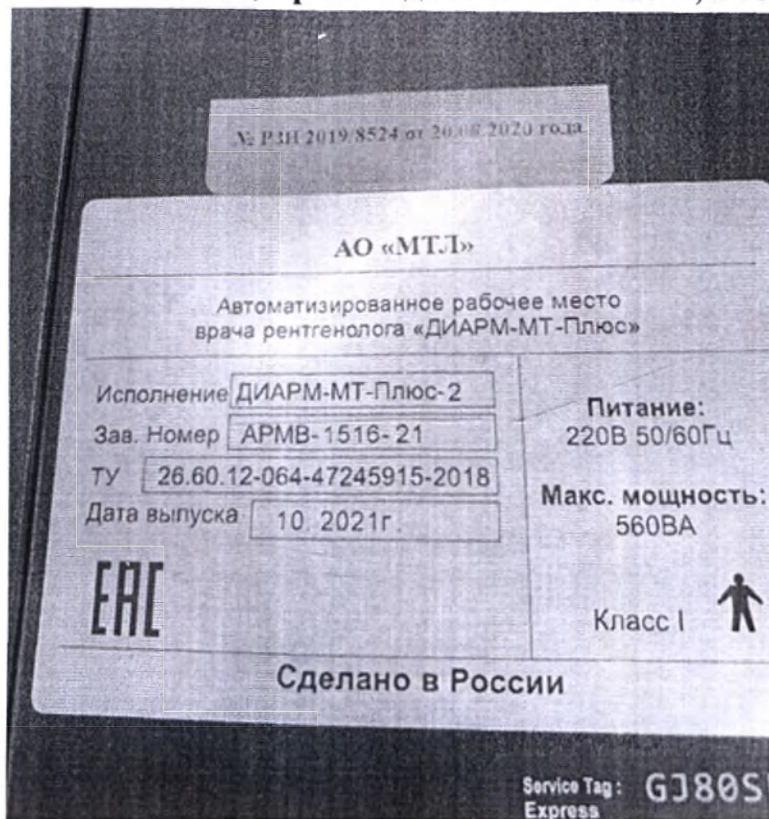


10 Монитор


10.1 Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов NEC, производства NEC Display Solutions Ltd, Япония или Compal Electronics (China) Co., Ltd, Китай или Compal Display Electronics (Kunshan) Co., Ltd, Китай



10.2 Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов серии С или серии М или серии R, производства Nanjing Jusha Display Technology Co., Ltd, Китай

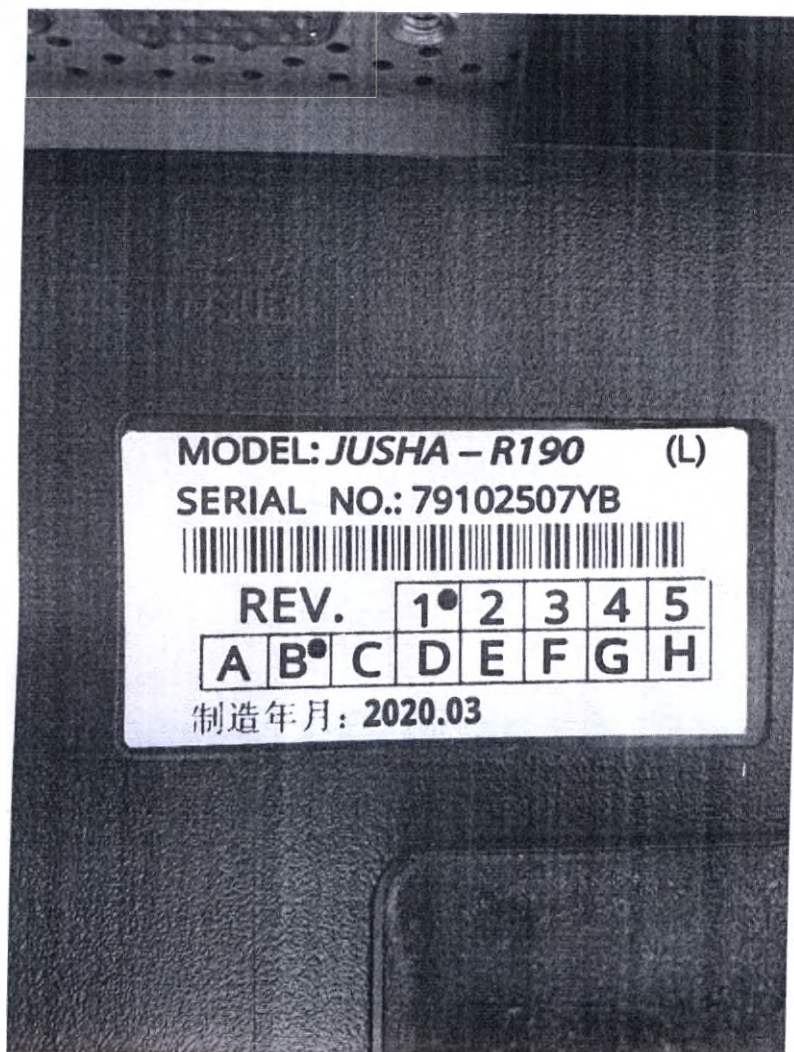


- 10.3 Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов серии Z, производства Hewlett-Packard Co., США или Wistron Corporation, Тайвань или Wistron Mexico S.A. de C.V, Мексика или Wistron InfoComm (Zhongshan) Corporation, Китай или All Technology (Zhongshan) Co. Ltd, Китай или Wistron InfoComm (Czech) s.r.o., Чешская Республика (на фото изображен монитор ЖК с диагональю 24 дюйма серии Z, производства Hewlett-Packard Co., США)

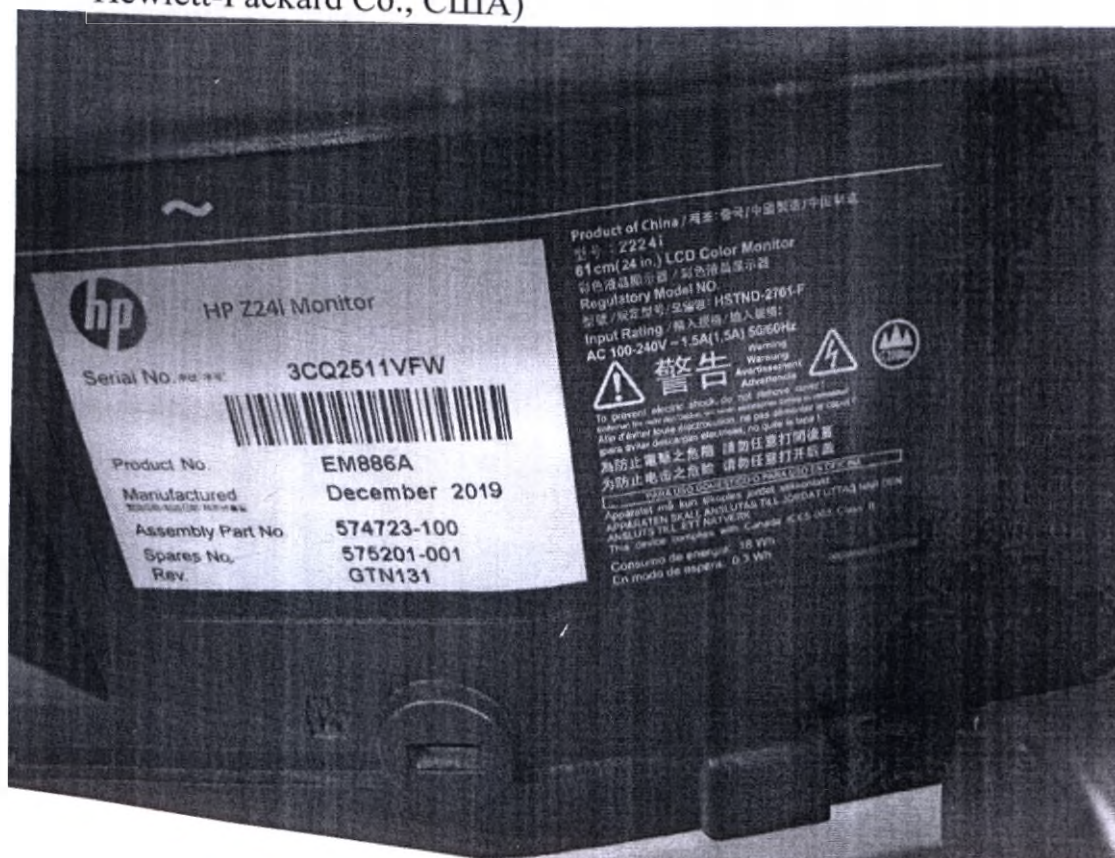

10.4 Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов Beacon, производства Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd, Китай




10.5 Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов DELL, производства DELL, Китай

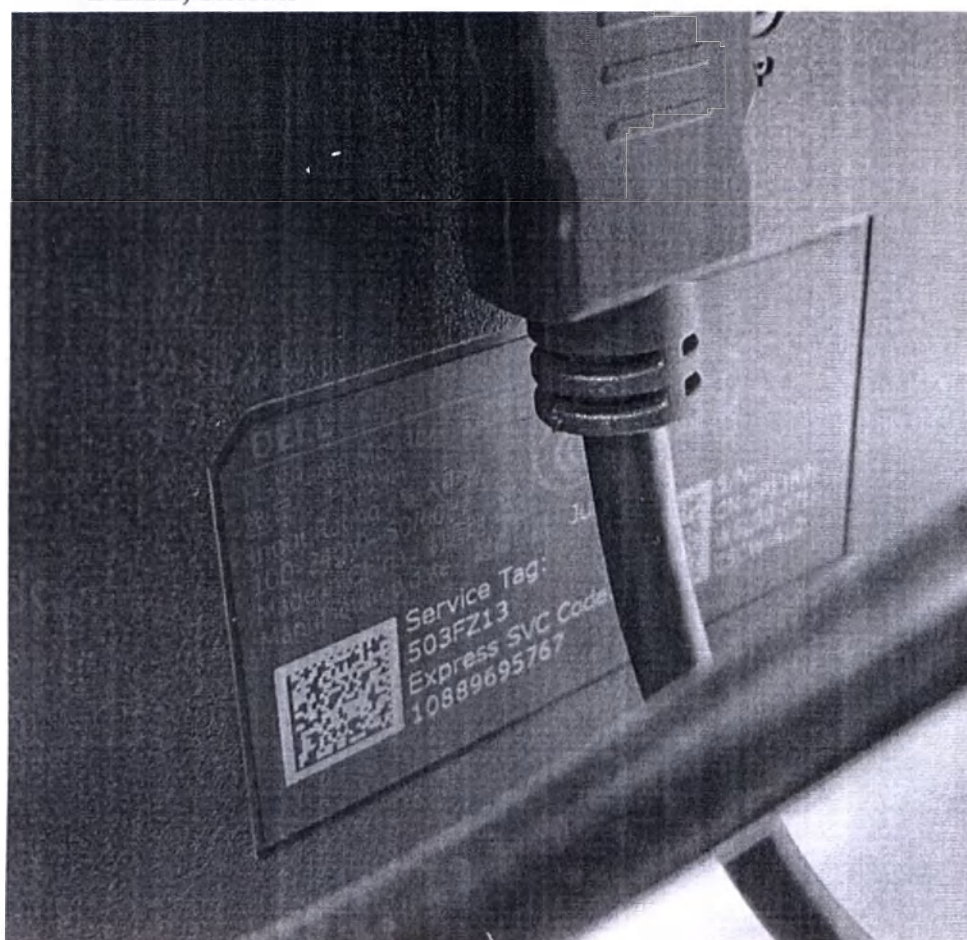


10.6 Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов Samsung, производства Samsung, Республика Корея




11 Радиологическая информационная система «ИнтеГРИС-МТ-Плюс», производства АО «МТЛ», Россия

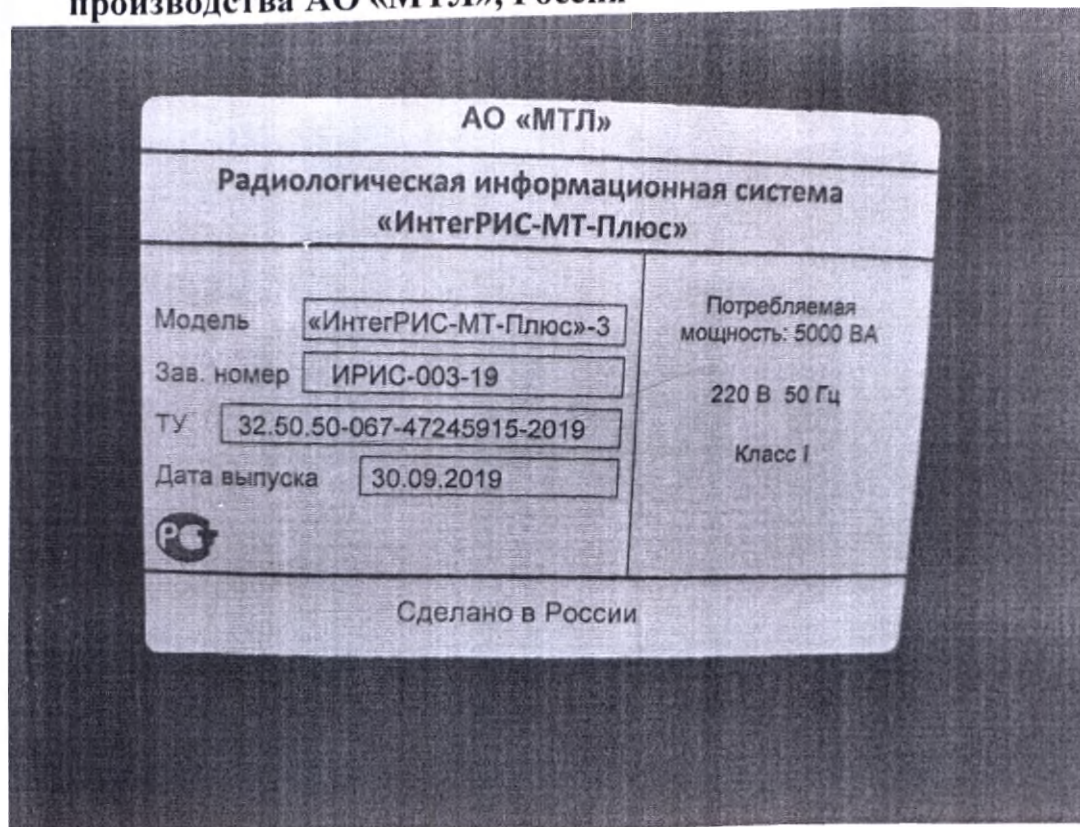

12 Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС» по ТУ 9398-010-21009821-2004, производства ЗАО «Ренекс», Россия

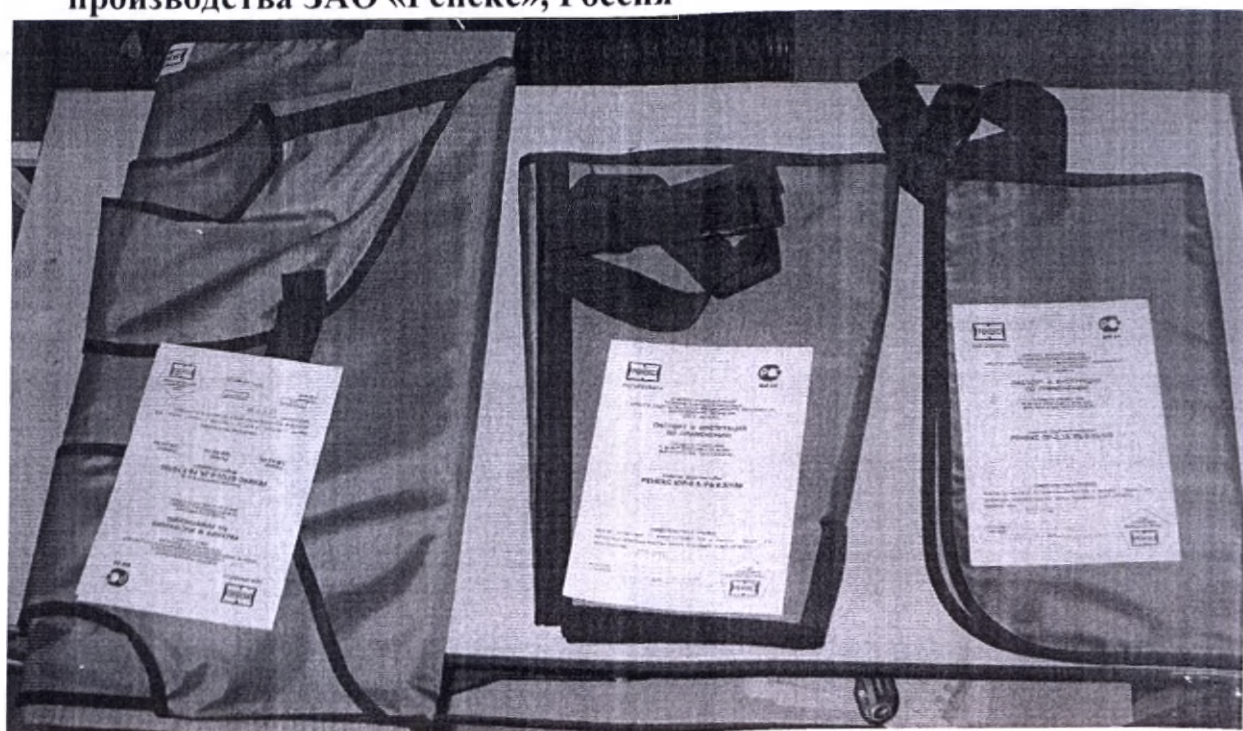

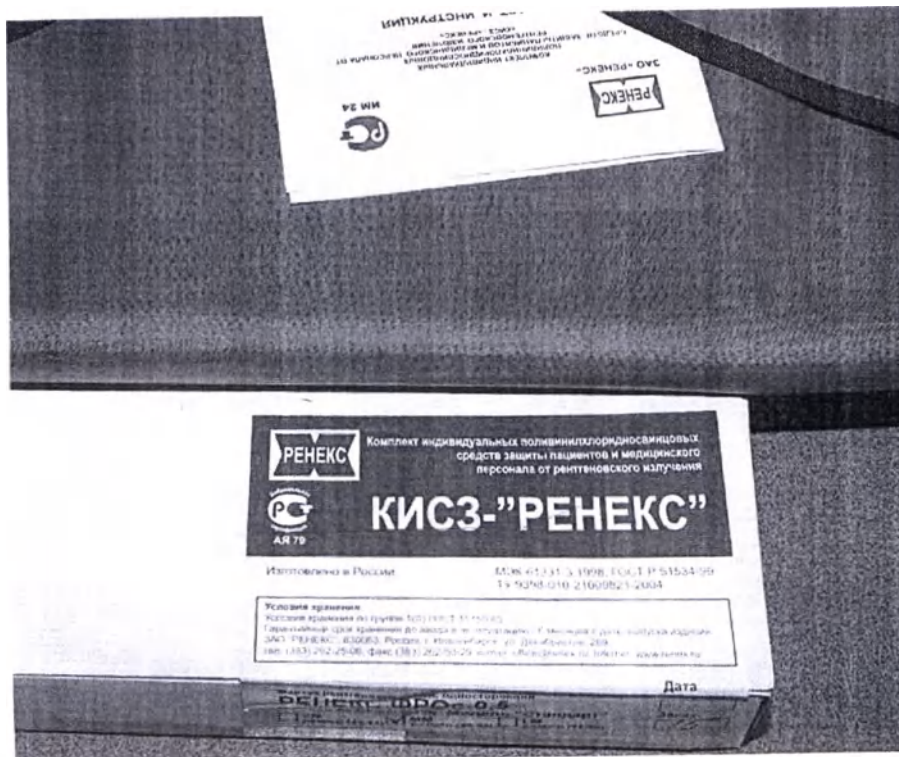


РЕНЕКС
Комплект индивидуальных поливинилхлоридосвинцовых
средств защиты пациентов и медицинского
персонала от рентгеновского излучения

КИС3-\"РЕНЕКС\"

Изготовлено в России
М.М. 41-231-3 1998, ЕОЛ.Т.П. 51534-99
Т. 5240-010 21009821-2004

Условия хранения:
Хранить в сухом, проветриваемом помещении при температуре от 5 до 25°C.
Средства защиты от рентгеновского излучения не должны подвергаться воздействию влаги, пыли, механических повреждений.
Срок годности: 5 лет со дня изготовления.
Место хранения: 600000, Россия, г. Ижевск, ул. 1-я Ижевская, 25А.
Тел: (8332) 472-47-00, Факс: (8332) 252-753-29, e-mail: info@re-nex.ru, website: www.re-nex.ru

- 13 Комплекты рентгенозащитных средств из материала резиносвинцового для индивидуальной защиты врача, пациента и для использования в микропедиатрии при рентгенодиагностических исследованиях КСИЗ-РС и КСИЗмп-РС по ТУ 9452-001-42879986-2006, производства ООО «МП НПФ «Гаммамед-П», Россия**

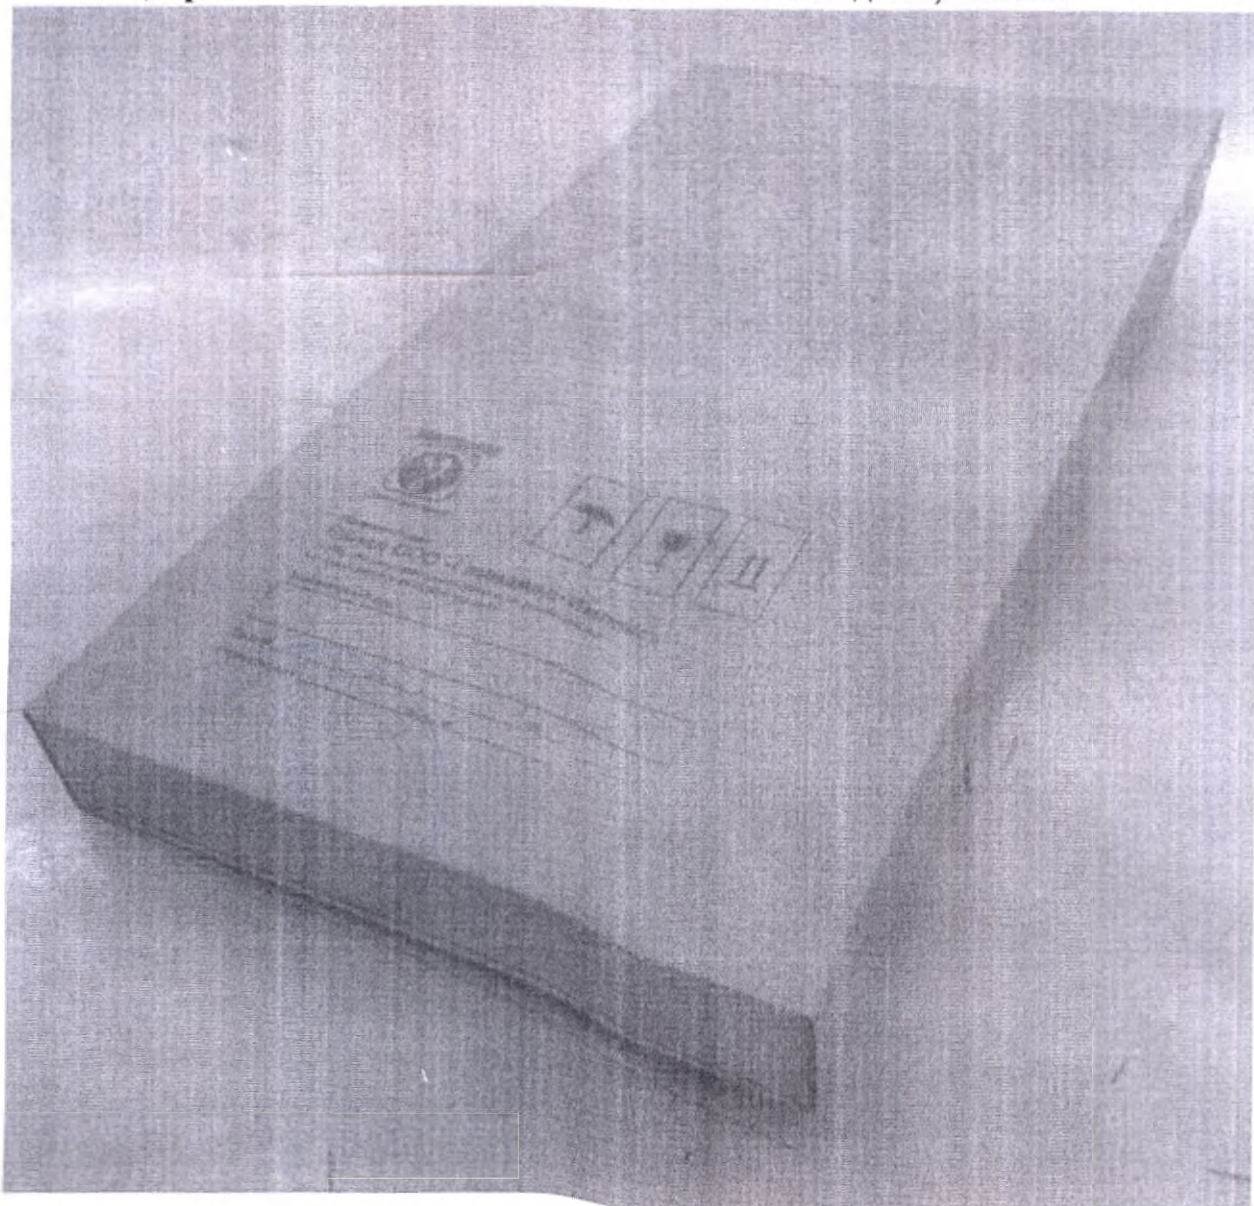

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 28

(двадцать восемь) листах

Генеральный директор
ООО «ВКО Медпром»



Мощеняков О.В.