

17, Krylatskaya str., bld. 2, Moscow, 121614
Tel.: (495) 580-77-77 Fax: (495) 580-78-78

121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 2
Тел.: (495) 580-77-77, Факс: (495) 580-78-78

УТВЕРЖДАЮ
Старший менеджер по регистрации



А.В. Фирстова

2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


медицинского изделия

Инструменты медицинские зондирующие, бужирующие для проведения
артроскопических операций


1. Канюли отводящие: диаметр 2,5 мм, FMS; диаметр 4,5 мм, FMS




2. Трубка переходная с одноходовым клапаном, FMS

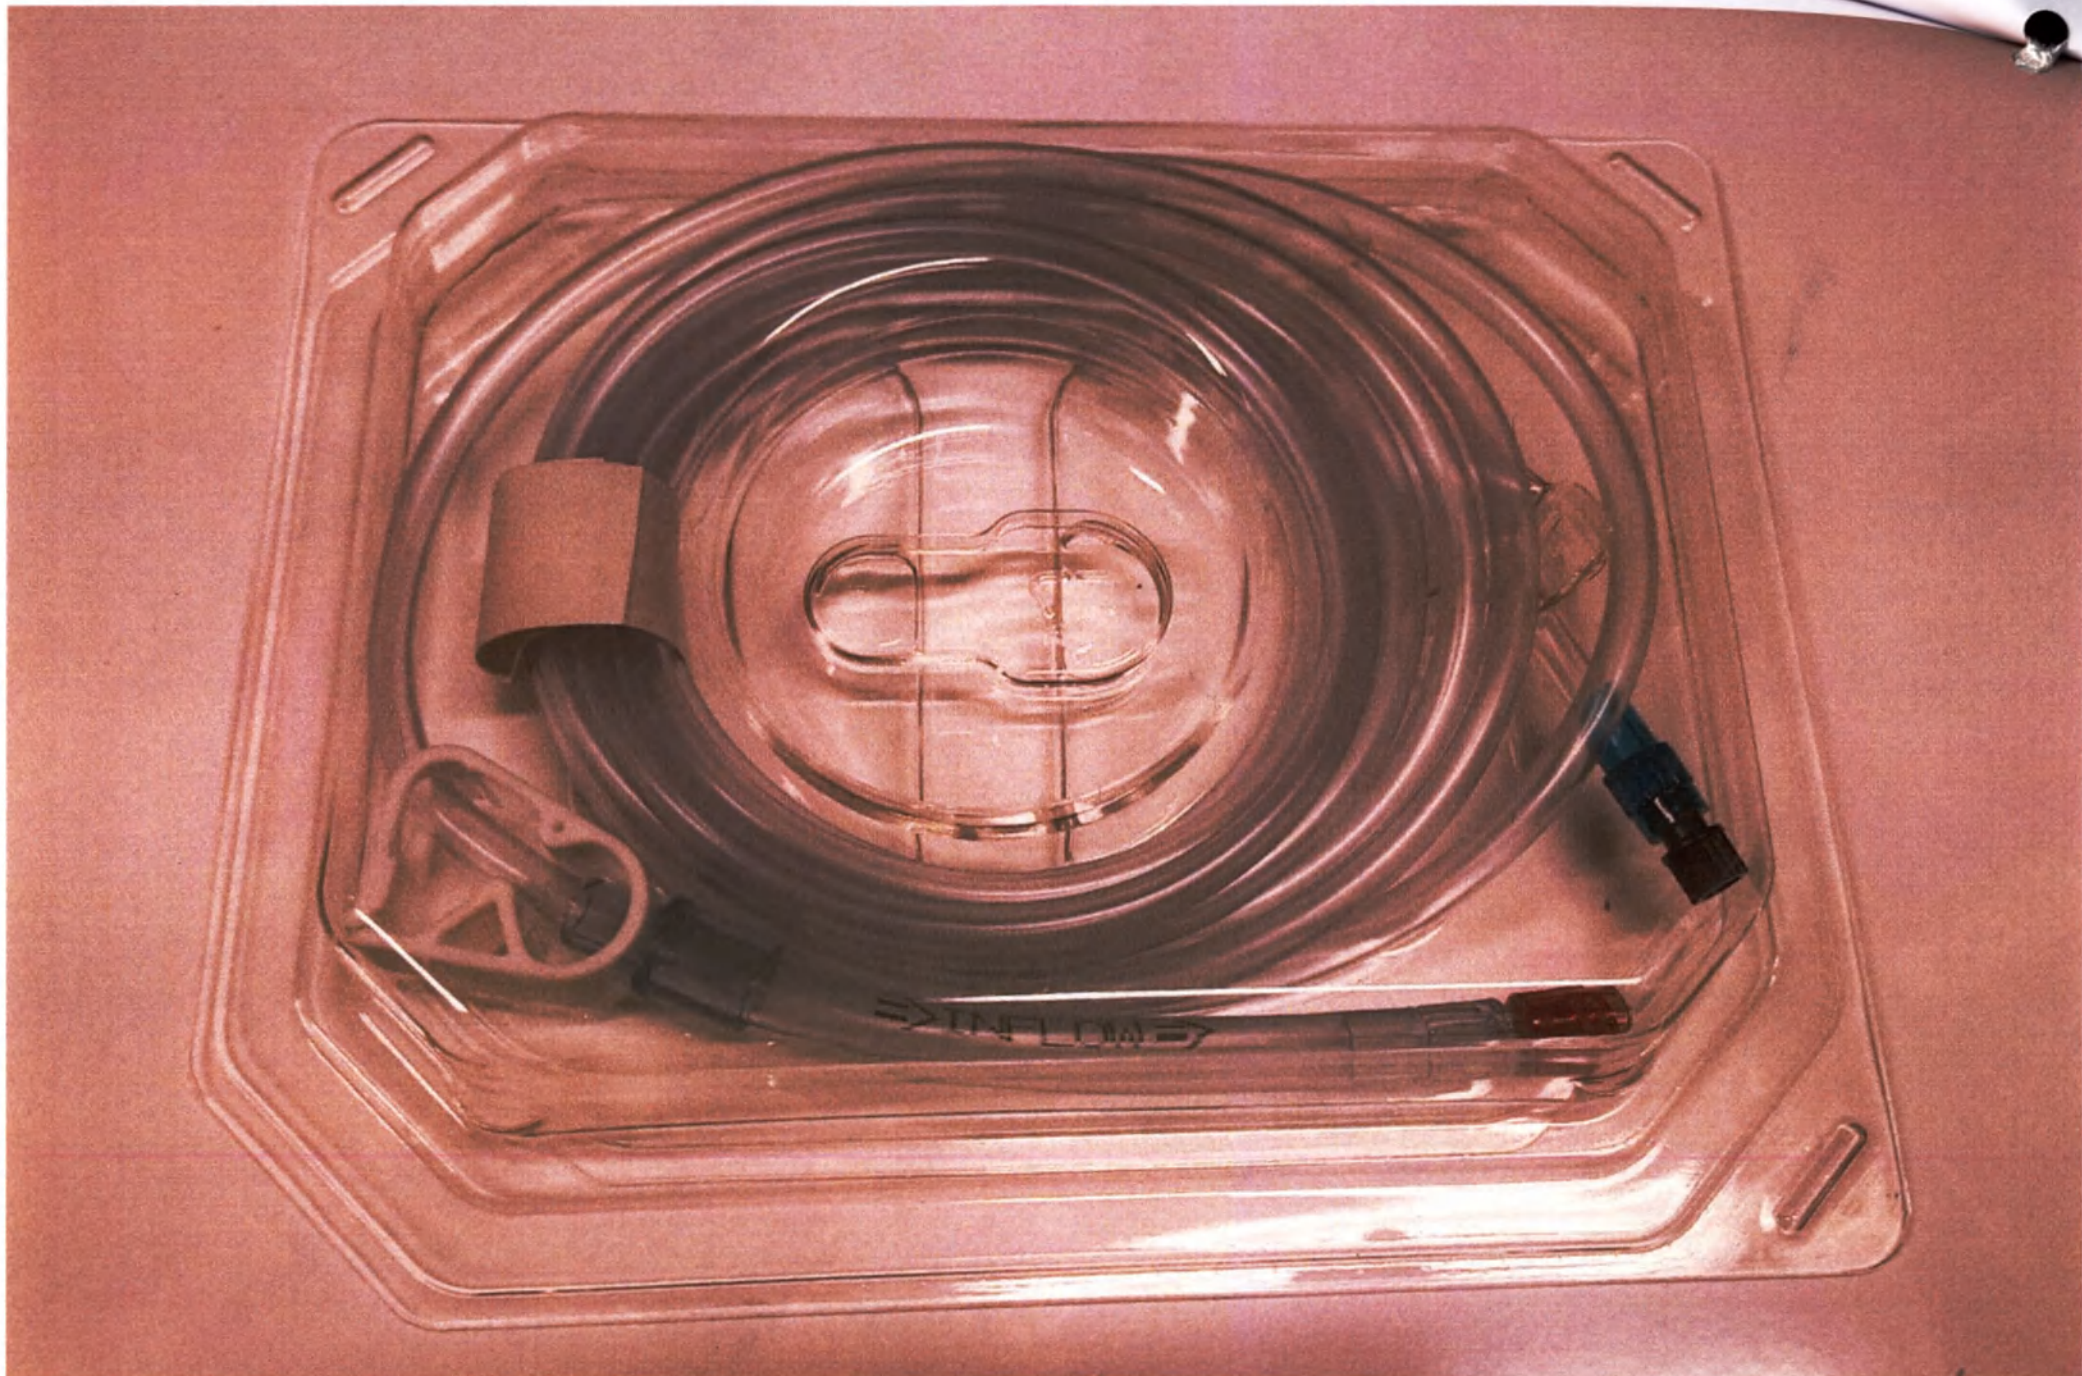


3. Трубка переходная без одноходового клапана, FMS

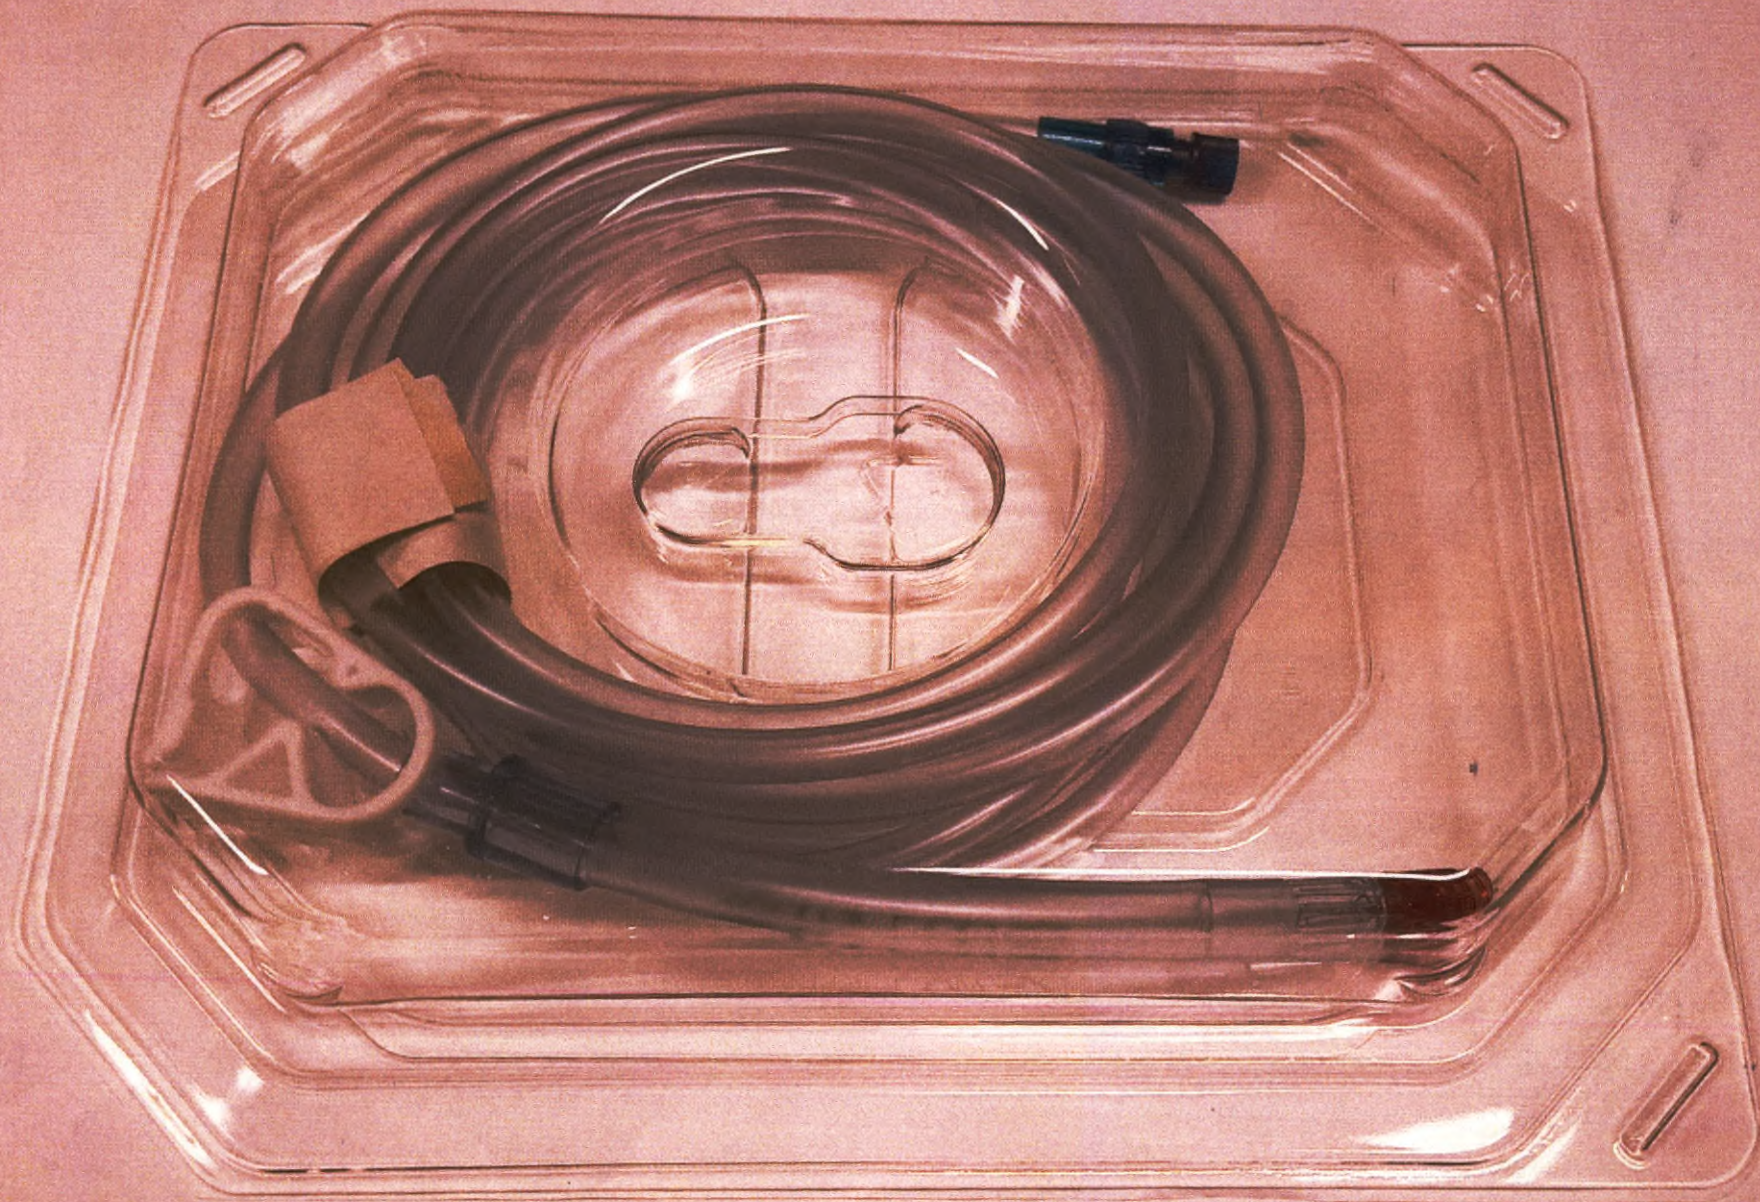

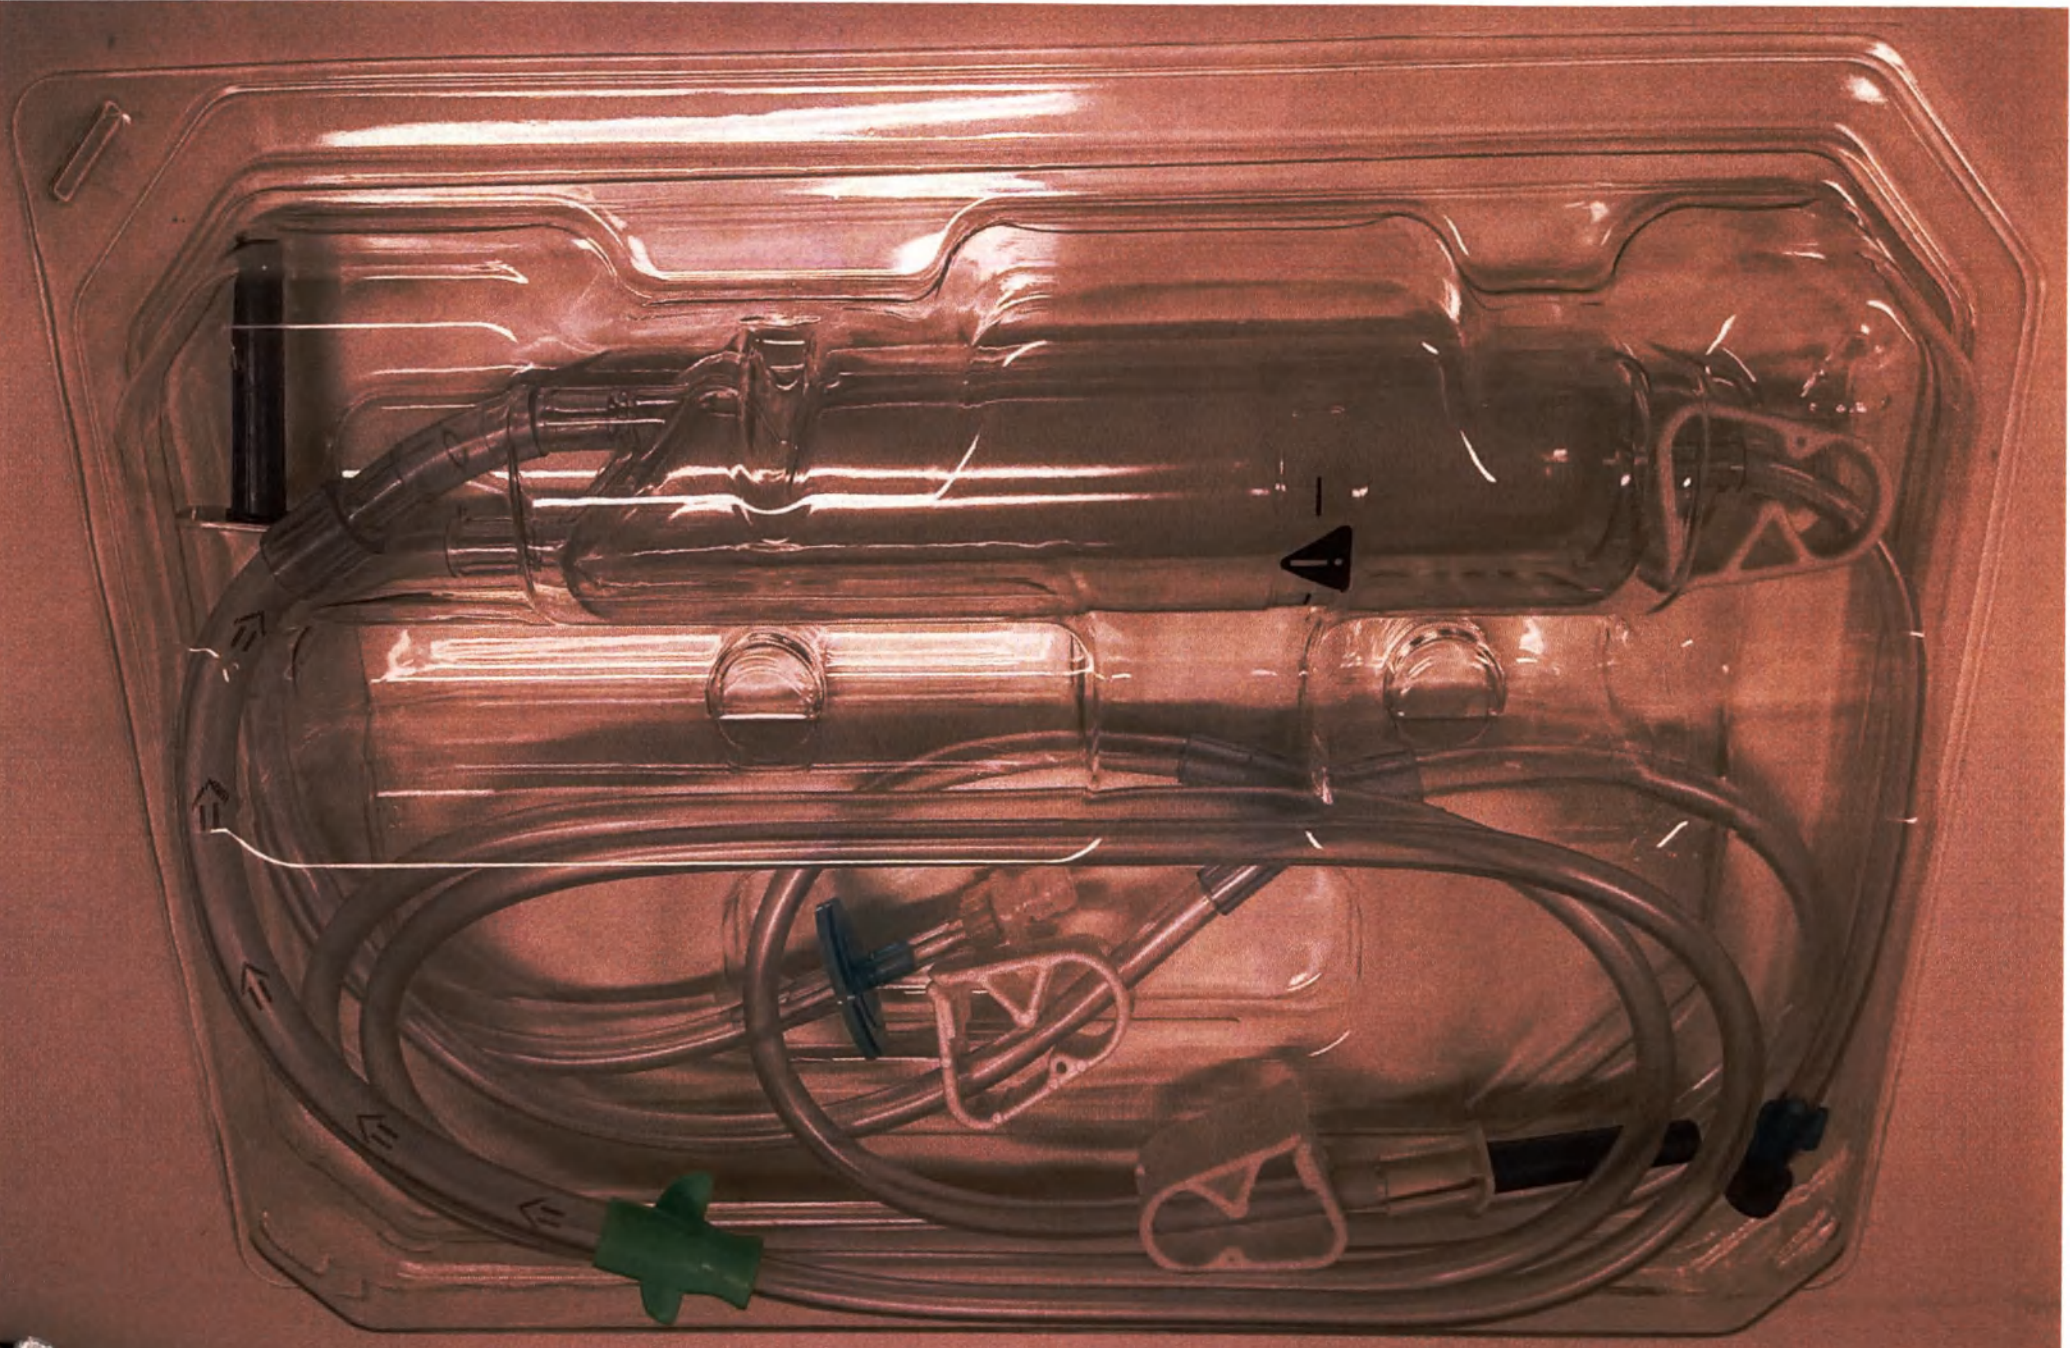


5. Трубка подающая, FMS DUO/FMS SOLO

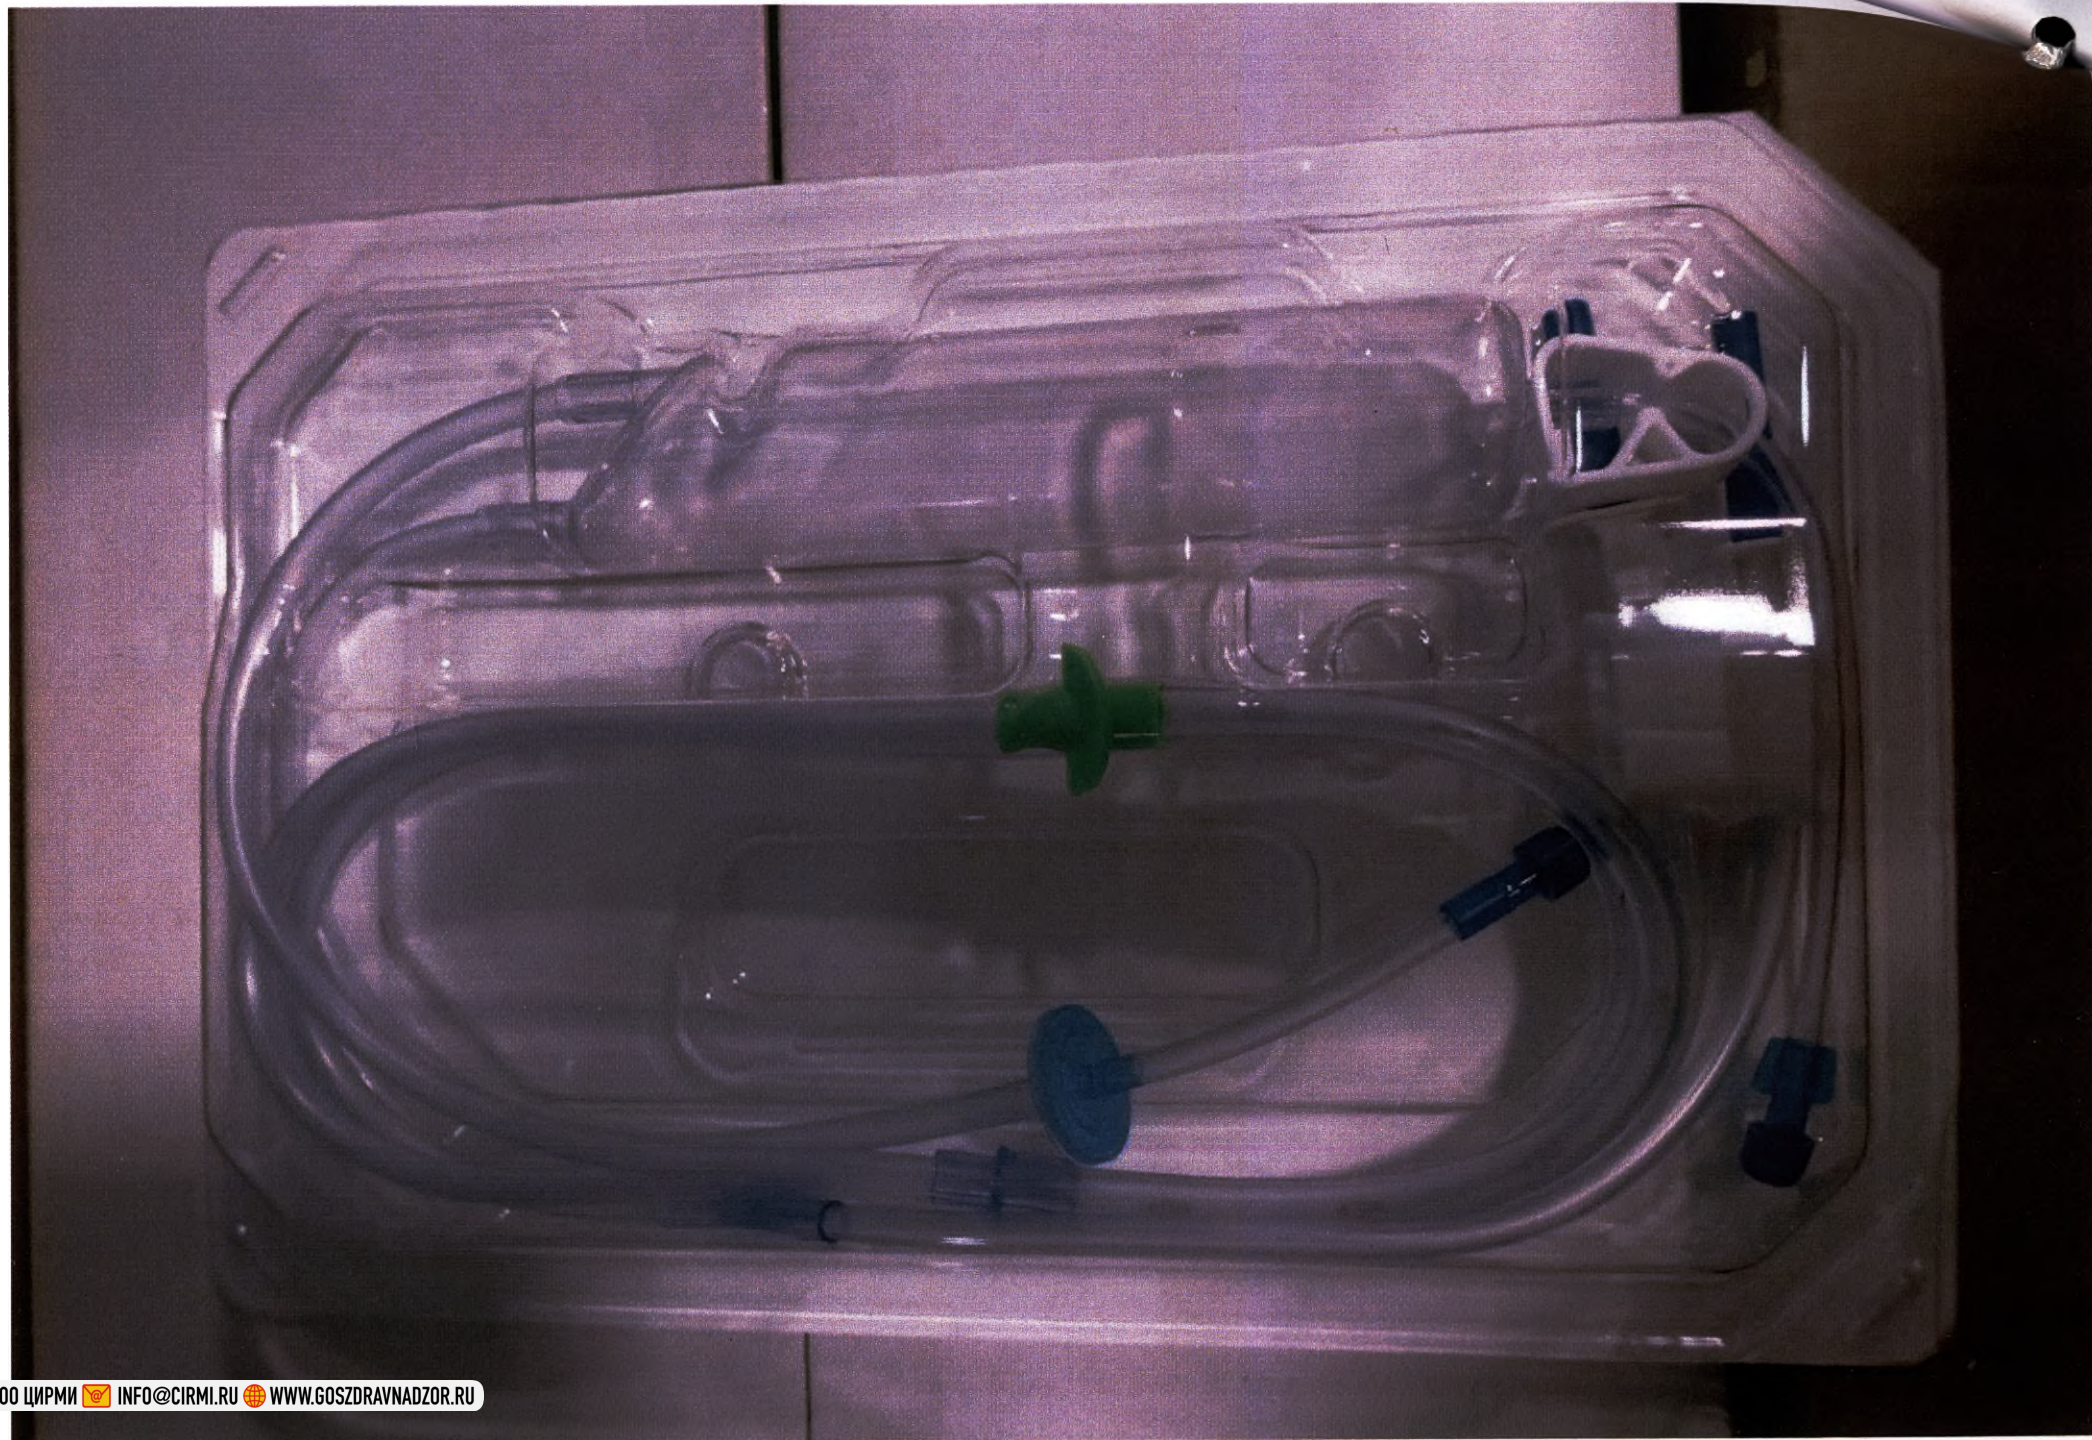


6. Трубка отводящая с одноходовым клапаном, FMS



7. Трубка отводящая без одноходового клапана, FMS VUE/FMS DUO

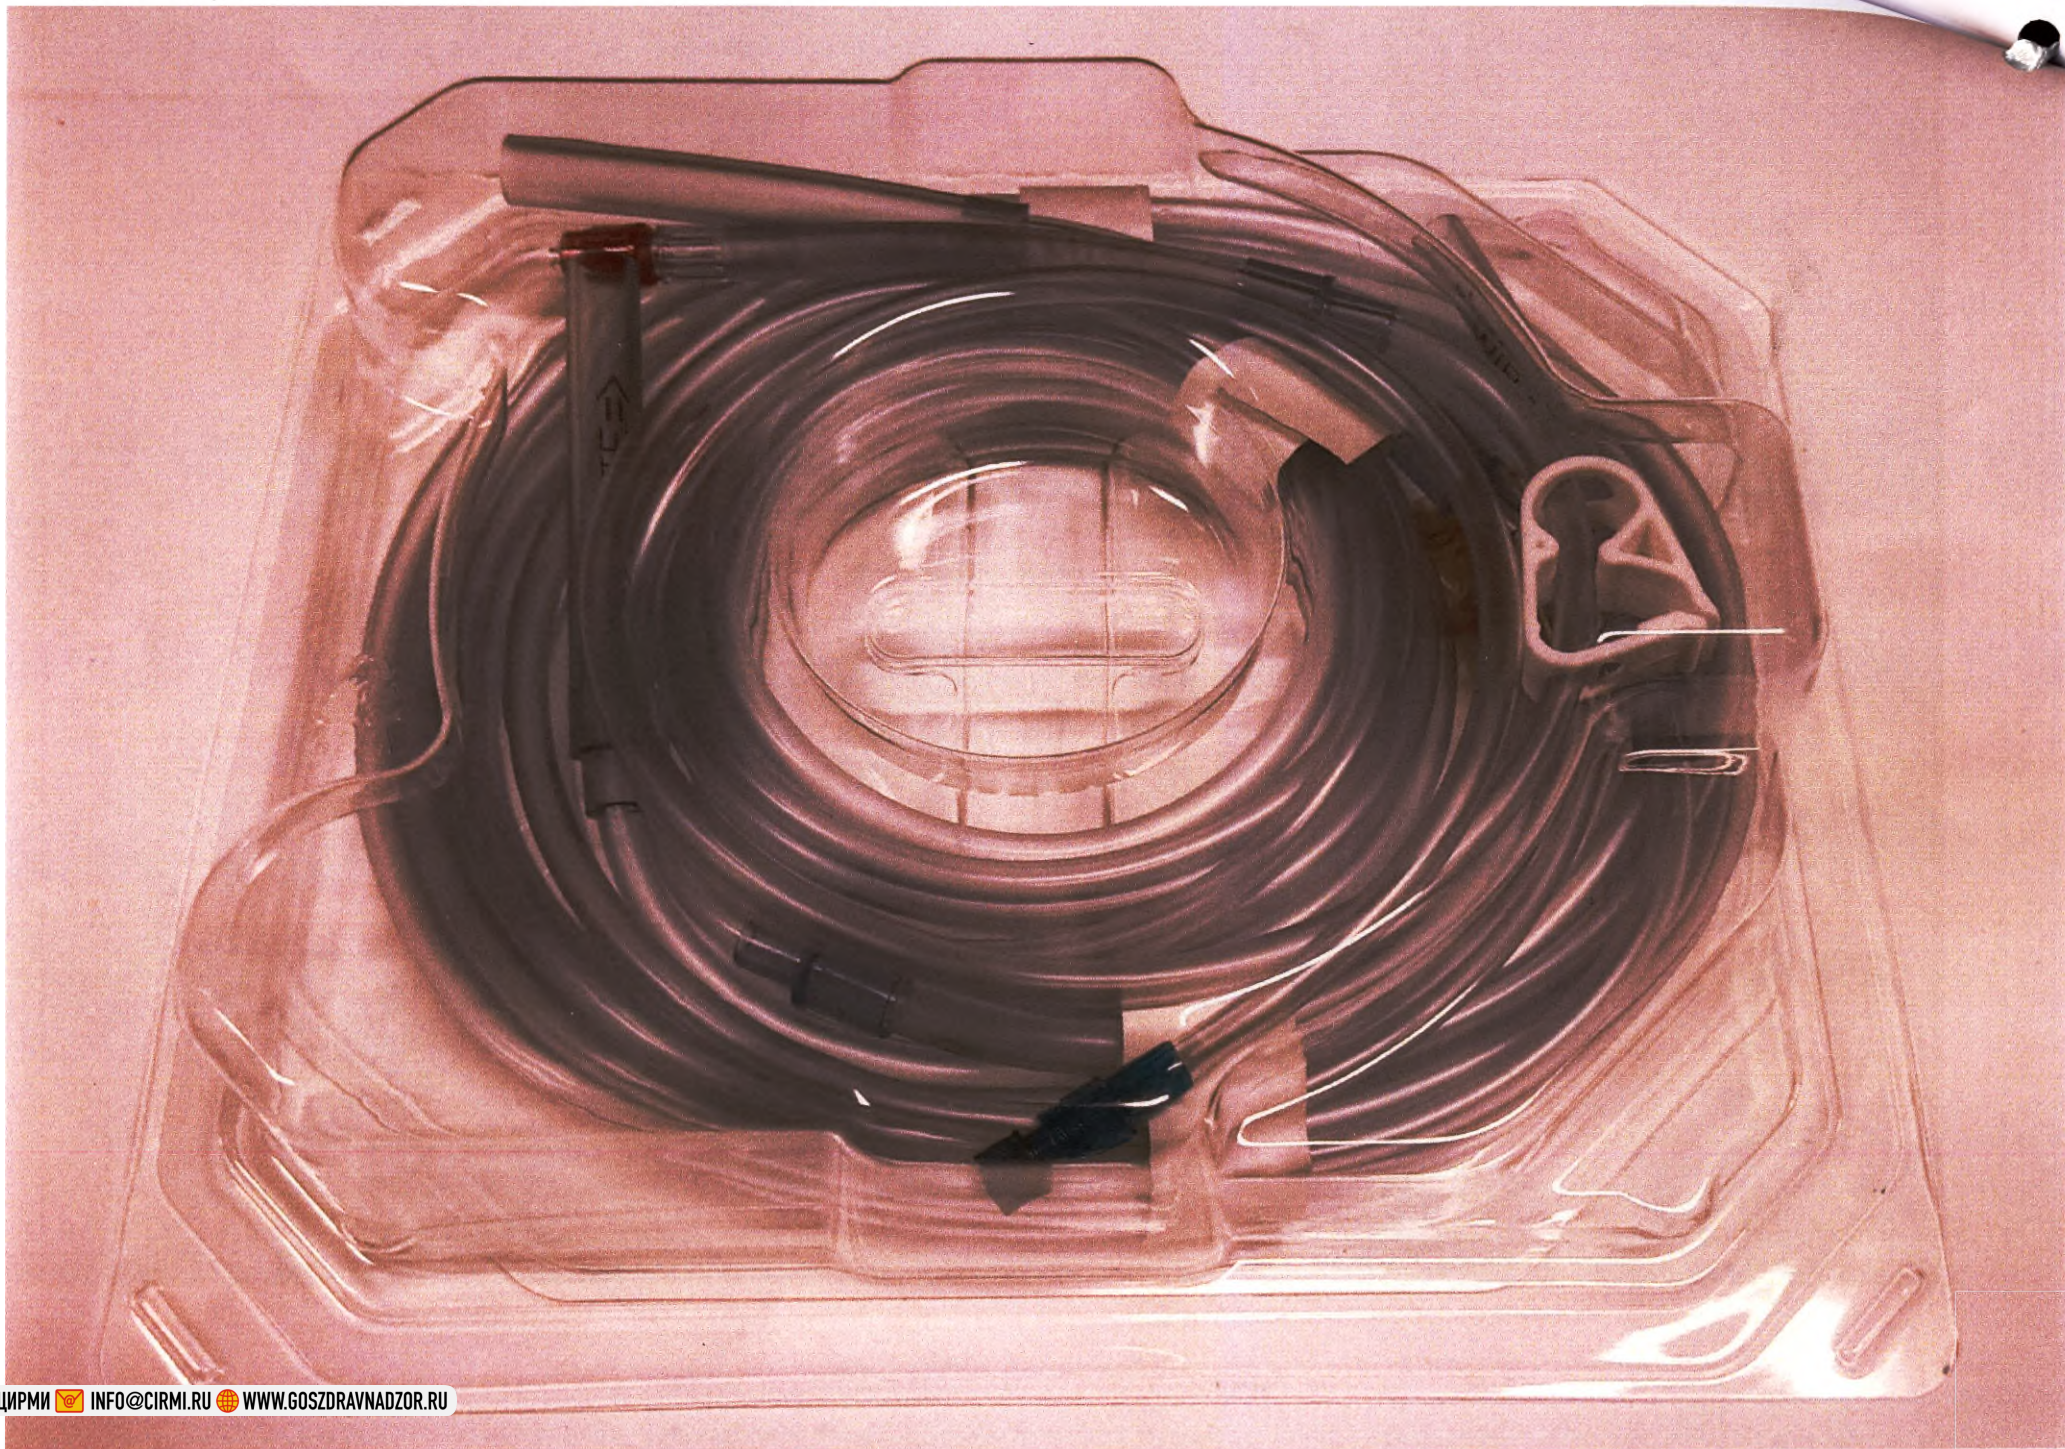

8. Пример стерильной упаковки и маркировки канюли отводящей

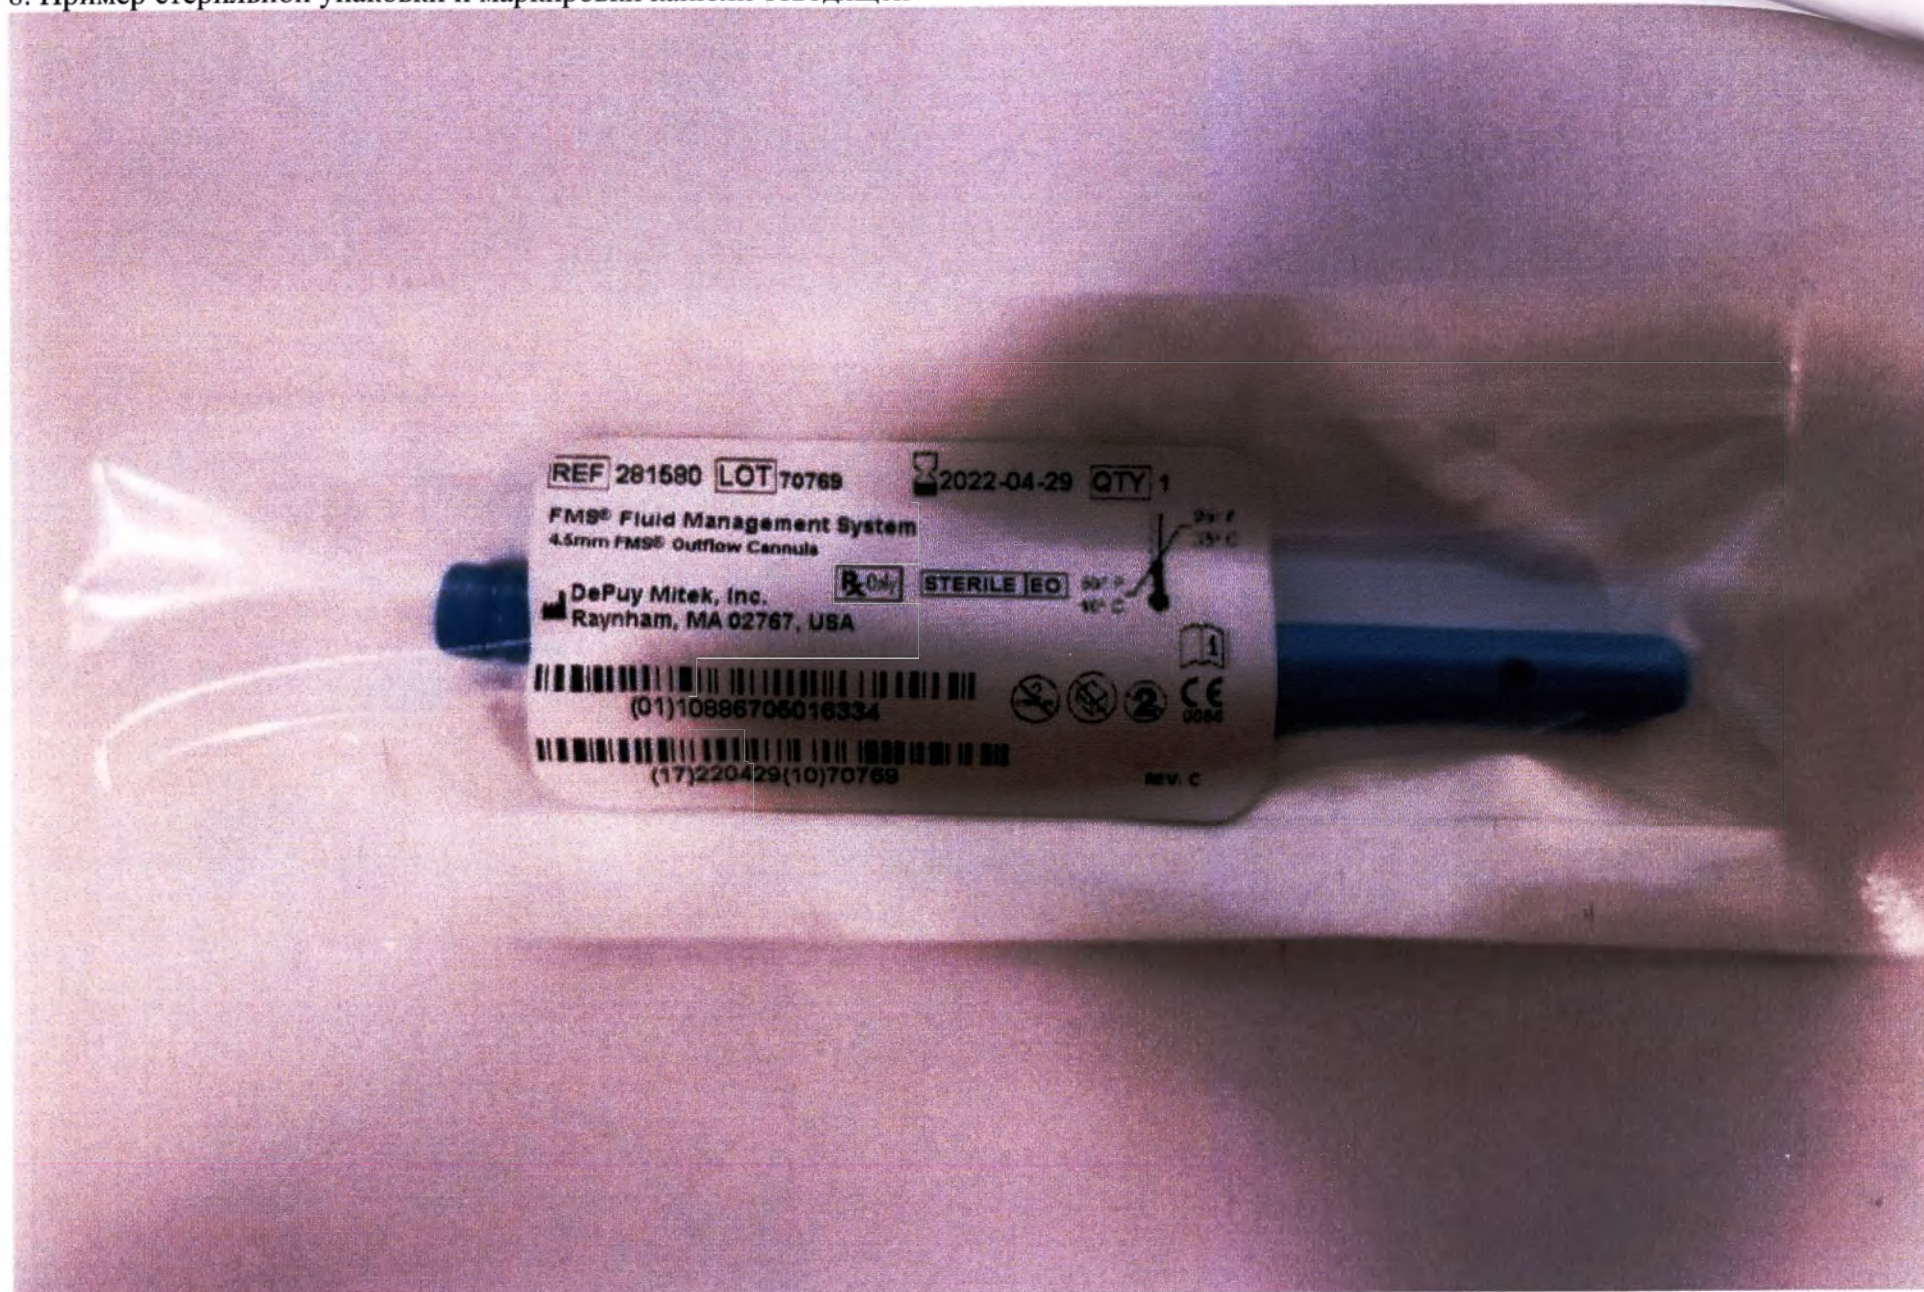




REF 281103 LOT 0598 2021-05-30 QTY 1
FA5[®] Fluid Management System
Intermediate Tubing without One-Way Valve
Dufay Medical, Inc.
Burlington, MA 02767, USA
STERILE EO
CE 0086
REV B



10. Пример стерильной упаковки и маркировки трубок

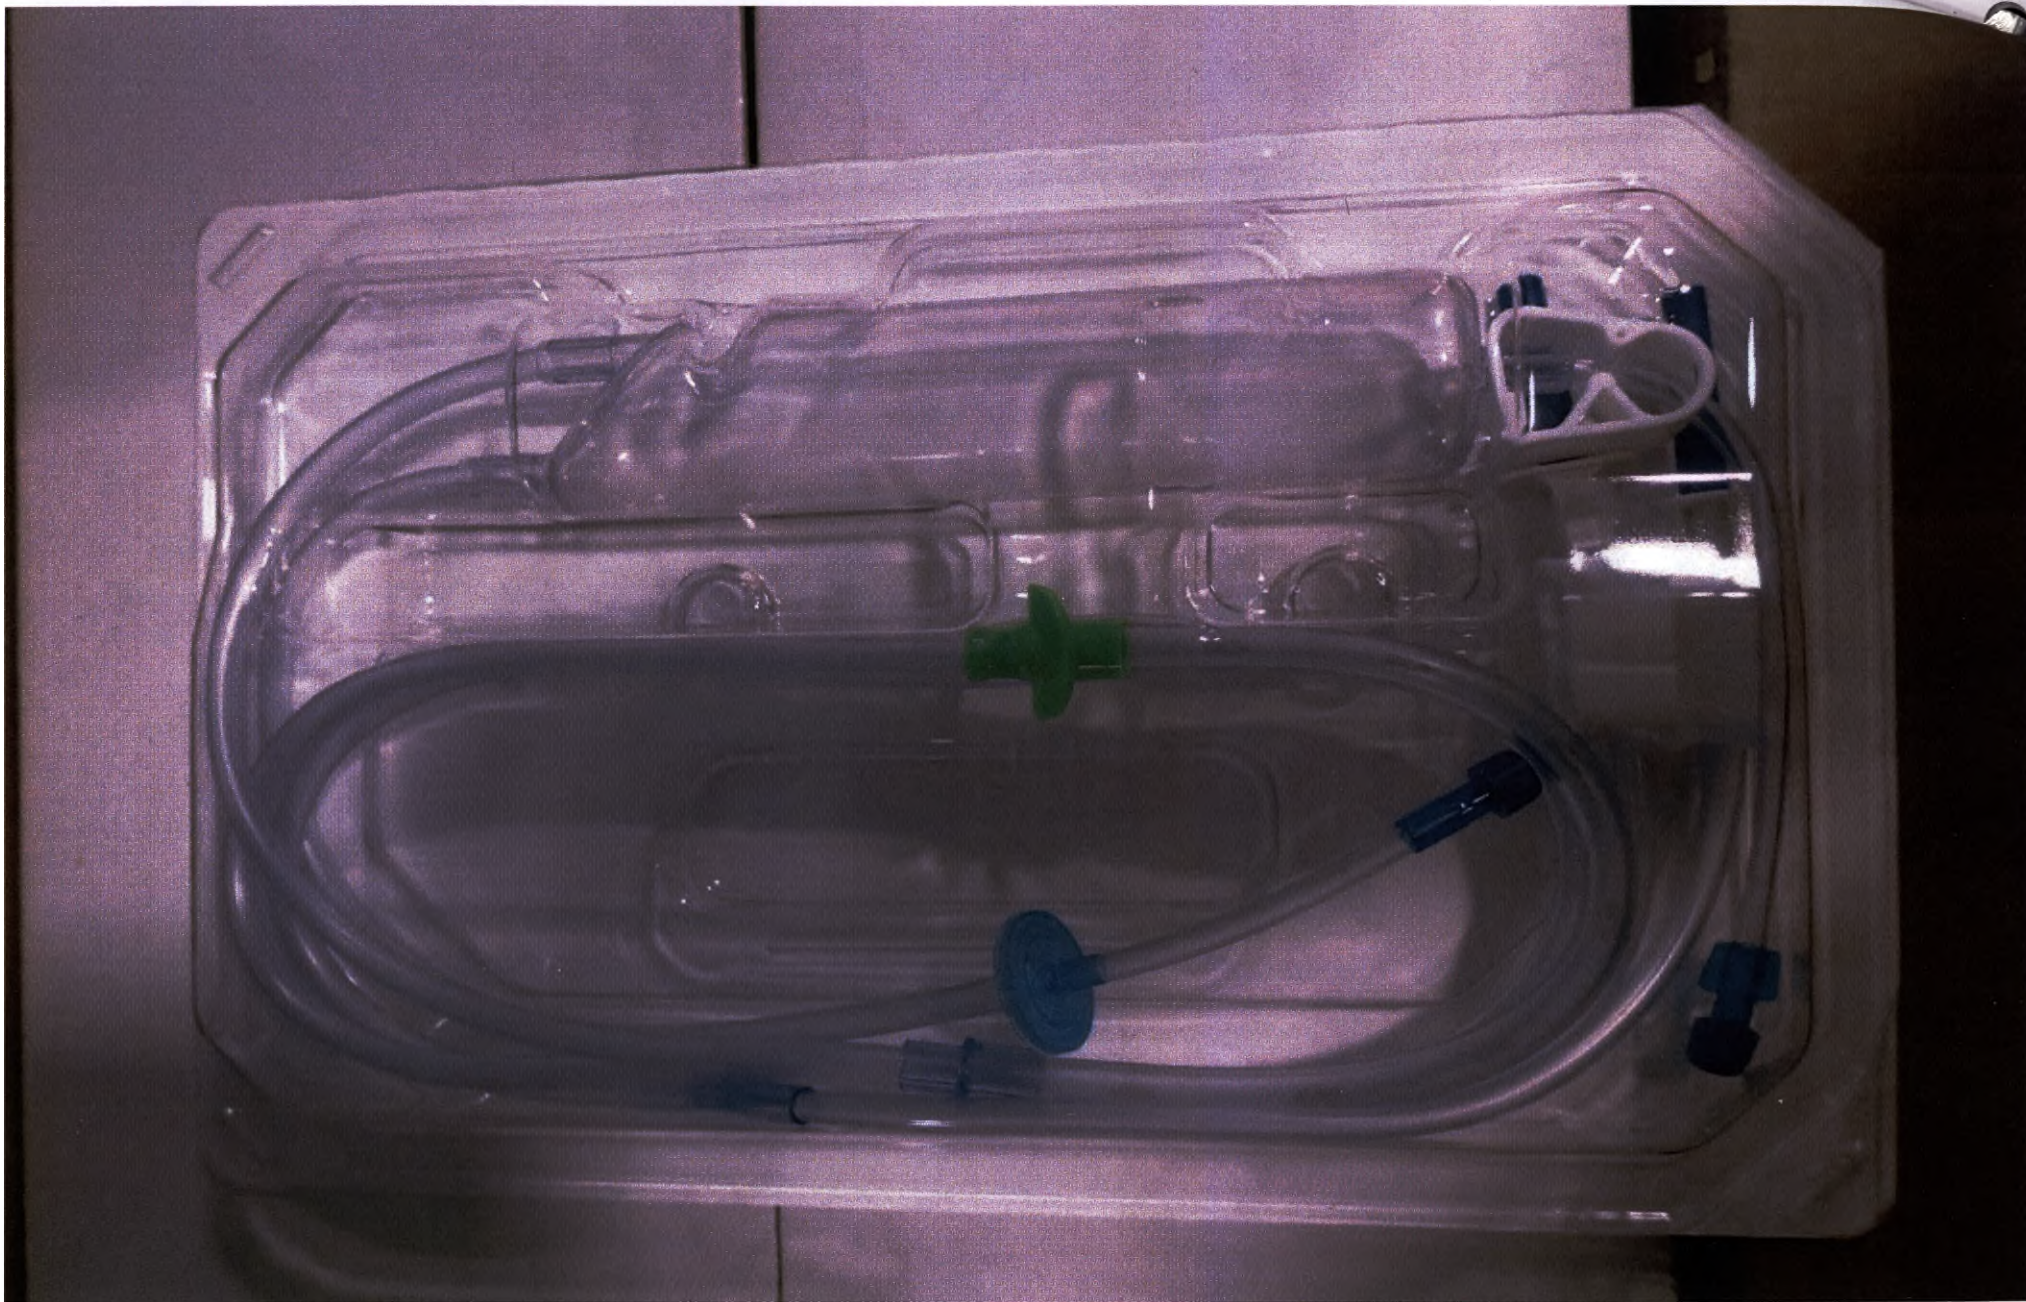



Старший менеджер
по регистрации
А.В. Фирсова

ОКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬ
ИЛИ ПОДПИСЬ