

Фотографическое изображение


**Набор реагентов для определения антител к *Treponema pallidum*
в сыворотке и/или плазме крови человека методом иммуноферментного
анализа - Syphilis Total Ab**

Обозначения:

1. R1 Микропланшет (Microplate), планшет (12 стрипов по 8 лунок)
2. R2 Концентрированный промывочный раствор (Concentrated washing solution) (20X)
3. R3 Отрицательный контрольный образец (Negative control)
4. R4 Положительный контрольный образец (Positive control)
5. R6 Конъюгат 1 (Conjugate 1)
6. R7 Конъюгат 2 (Conjugate 2)
7. R8 Субстратный буферный раствор (Substrate buffer)
8. R9 Хромоген: раствор ТМБ (Chromogen: TMB solution) (11X)
9. R10 Стоп-реагент (Stopping solution)

2021 г.


Syphilis Total Ab - 96 тестов

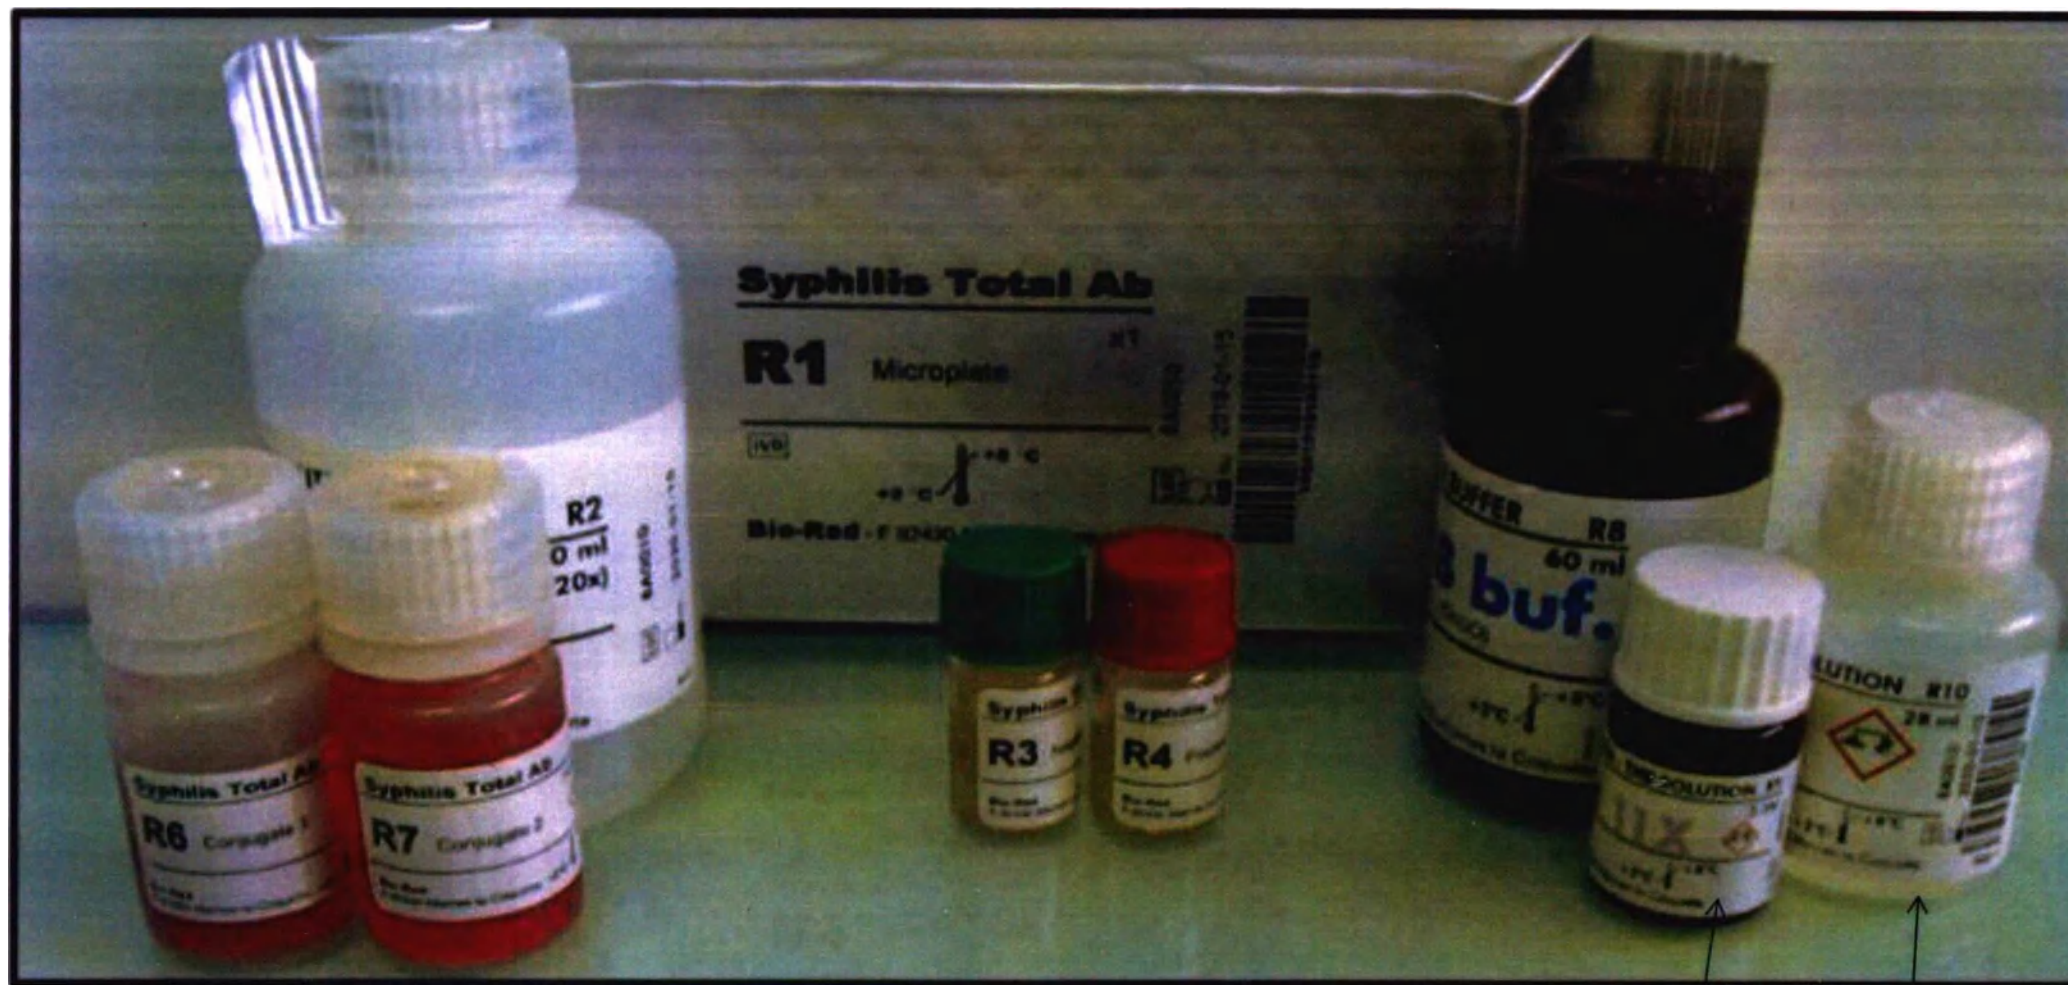

R9

R10

Syphilis Total Ab - 96 тестов (размещение во вторичной упаковке)

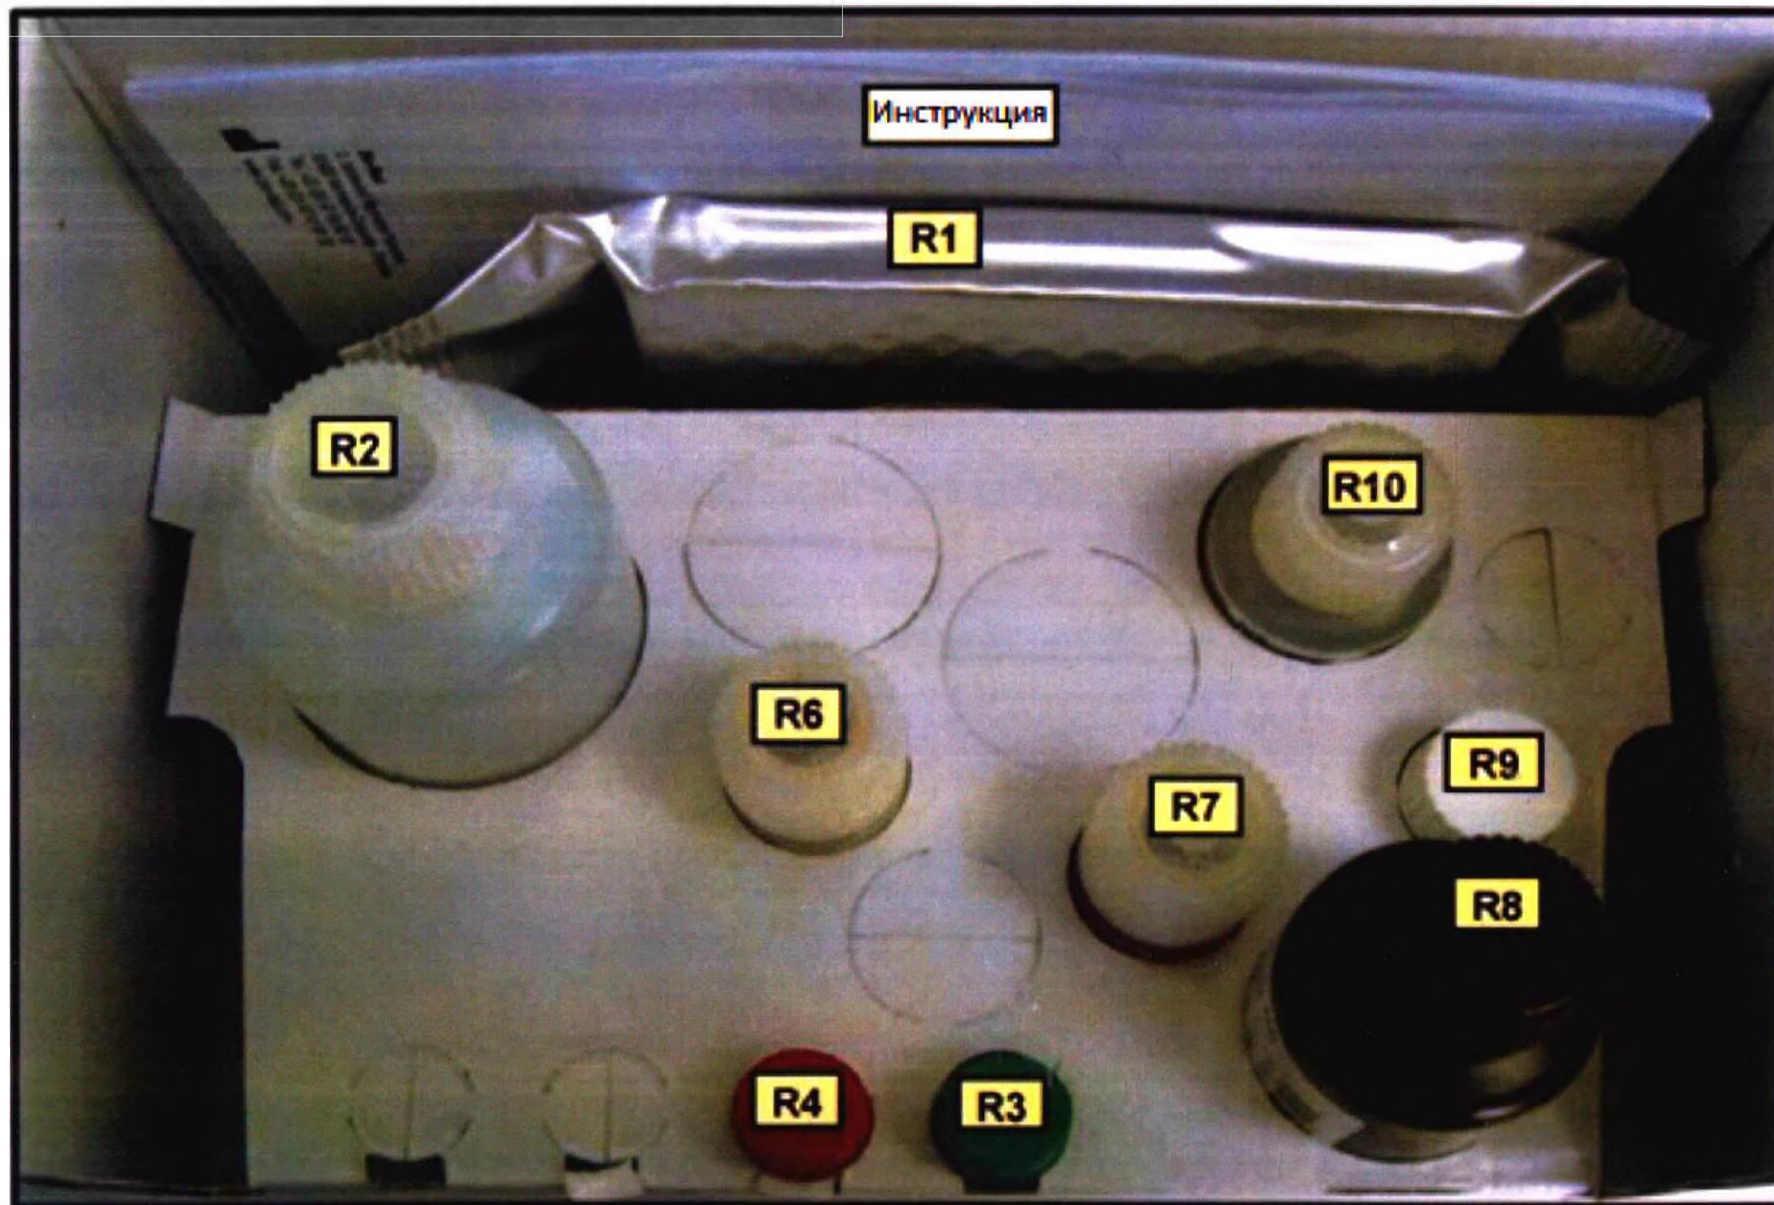

Syphilis Total Ab - 480 тестов




R9

R6

R10

Syphilis Total Ab - 480 тестов (размещение во вторичной упаковке)

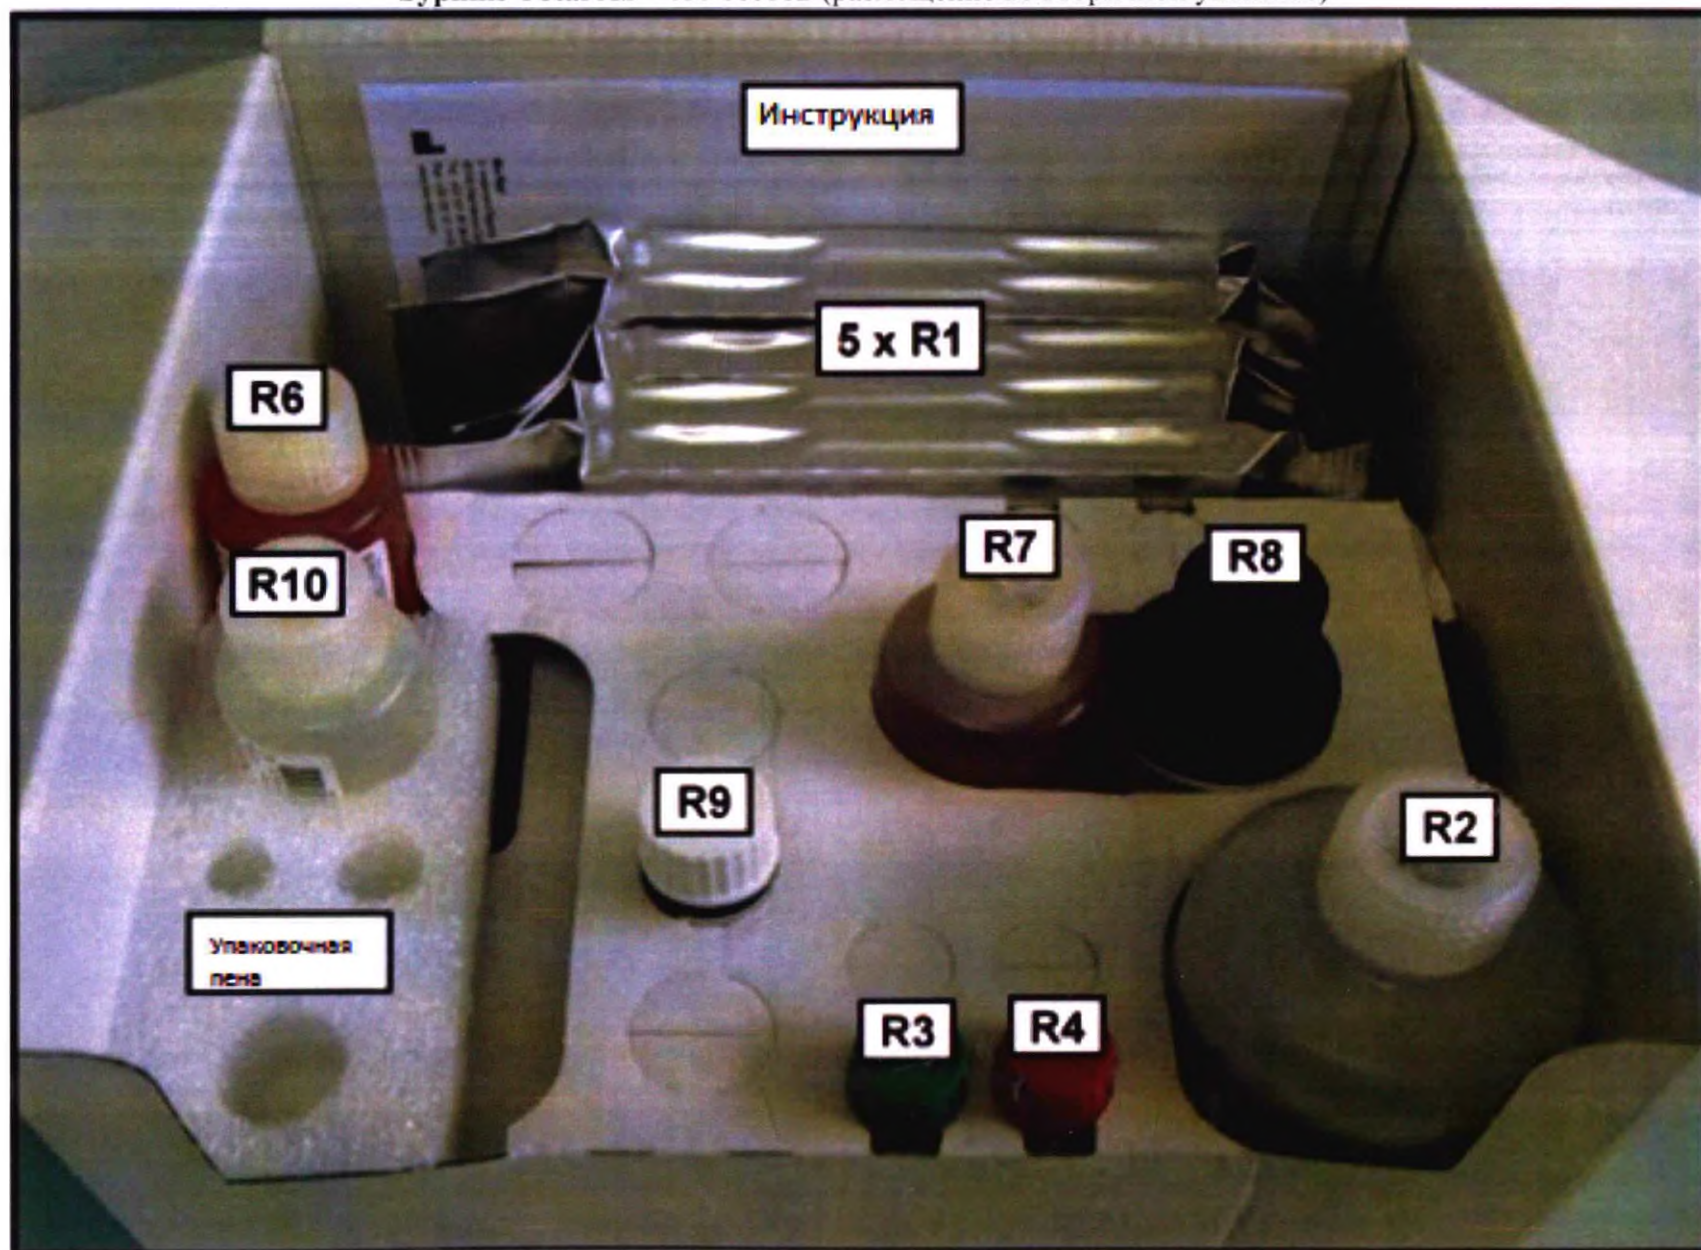

Макет маркировки на русском языке:

Вариант исполнения Syphilis Total Ab - 96 тестов

72530



Набор реагентов для определения антител к *Treponema pallidum* в сыворотке и/или плазме крови человека методом иммуноферментного анализа - Syphilis Total Ab

Syphilis Total Ab - 96 тестов.

в составе:

1. R1 Микропланшет (Microplate), планшет (12 стрипов по 8 лунок) – 1 шт.
2. R2 Концентрированный промывочный раствор (Concentrated washing solution) (20X), 70 мл/флакон – 1 шт.
3. R3 Отрицательный контрольный образец (Negative control), 2,1 мл/флакон – 1 шт.
4. R4 Положительный контрольный образец (Positive control), 1,6 мл/флакон – 1 шт.
5. R6 Конъюгат 1 (Conjugate 1), 8 мл/флакон – 1 шт.
6. R7 Конъюгат 2 (Conjugate 2), 14 мл/флакон – 1 шт.
7. R8 Субстратный буферный раствор (Substrate buffer), 60 мл/флакон – 1 шт.
8. R9 Хромоген: раствор ТМБ (Chromogen: TMB solution) (11X), 5 мл/флакон – 1 шт.
9. R10 Стоп-реагент (Stopping solution), 28 мл/флакон – 1 шт.
10. Инструкция по применению – 1 шт.

Только для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Номер серии, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке.



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Производитель: Био-Рад, Франция (Bio-Rad, 3, Boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette, France)

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, стр. 5А

Телефон: (495) 721 14 04

diag_support_rcis@bio-rad.com

www.bio-rad.com

Макет маркировки на русском языке:

Вариант исполнения Syphilis Total Ab - 480 тестов

72531



Набор реагентов для определения антител к *Treponema pallidum* в сыворотке или плазме крови человека методом иммуноферментного анализа - Syphilis Total Ab

Syphilis Total Ab - 480 тестов,

в составе:

1. R1 Микропланшет (Microplate), планшет (12 стрипов по 8 лунок) – 5 шт.
2. R2 Концентрированный промывочный раствор (Concentrated washing solution) (20X), 235 мл/флакон – 1 шт.
3. R3 Отрицательный контрольный образец (Negative control), 2,1 мл/флакон – 1 шт.
4. R4 Положительный контрольный образец (Positive control), 1,6 мл/флакон – 1 шт.
5. R6 Конъюгат 1 (Conjugate 1), 30 мл/флакон – 1 шт.
6. R7 Конъюгат 2 (Conjugate 2), 60 мл/флакон – 1 шт.
7. R8 Субстратный буферный раствор (Substrate buffer), 60 мл/флакон – 1 шт.
8. R9 Хромоген: раствор ТМБ (Chromogen: TMB solution) (11X), 5 мл/флакон – 1 шт.
9. R10 Стоп-реагент (Stopping solution), 28 мл/флакон – 1 шт.
10. Инструкция по применению – 1 шт.

Только для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Номер серии, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке.



- Антитела к ВИЧ 1.2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Производитель: Био-Рад, Франция (Bio-Rad, 3, Boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette, France)

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, стр. 5А

Телефон: (495) 721 14 04 diag_support_rds@bio-rad.com www.bio-rad.com

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 5 листов.

Генеральный директор
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Шестаков А.Я.

