

ООО «СМТраст»

125047, Москва г, Тверская-Ямская 4-Я ул, дом № 16, корпус 3, помещение 305, комната 1

ИНН 7710751195 КПП 771001001 тел. +7(499)250-26-21

Эл. почта: smtrust@yandex.ru Сайт: www.smtrust.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «СМТраст»**

«07» октября 2021 года

Попова Л.Р.

подпись печать



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

**«Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических,
цитологических и гистохимических окрашиваний на предметном стекле»**

производства

Diapath S.p.A. / Динапф С.п.А.

Италия



Фото 1.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических, цитологических и гистохимических окрашиваний на предметном стекле: 1. Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto арт. SDSGT9000



Фото 2.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических, цитологических и бактериальных окрашиваний на предметном стекле: 1. Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto арт. SDSGT9000 (сзади)

DIA PATH



Made in Italy

Via Savoldini, 71 -24057

Martinengo Bergamo ITALY

Tel(+39)0363.986.411

Fax(+39)0363.984.000

www.diapath.com

info@diapath.com

Model

Modèle: Giotto

Voltage

Tension: 115/230 V~

Power

Puissance: 250 VA

Frequency

Fréquence: 50-60 Hz

SN: 33459




Фото 3.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических, цитологических и гистохимических окрашиваний на предметном стекле: 1. Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto авт. SDSGT9000 (маркировка)

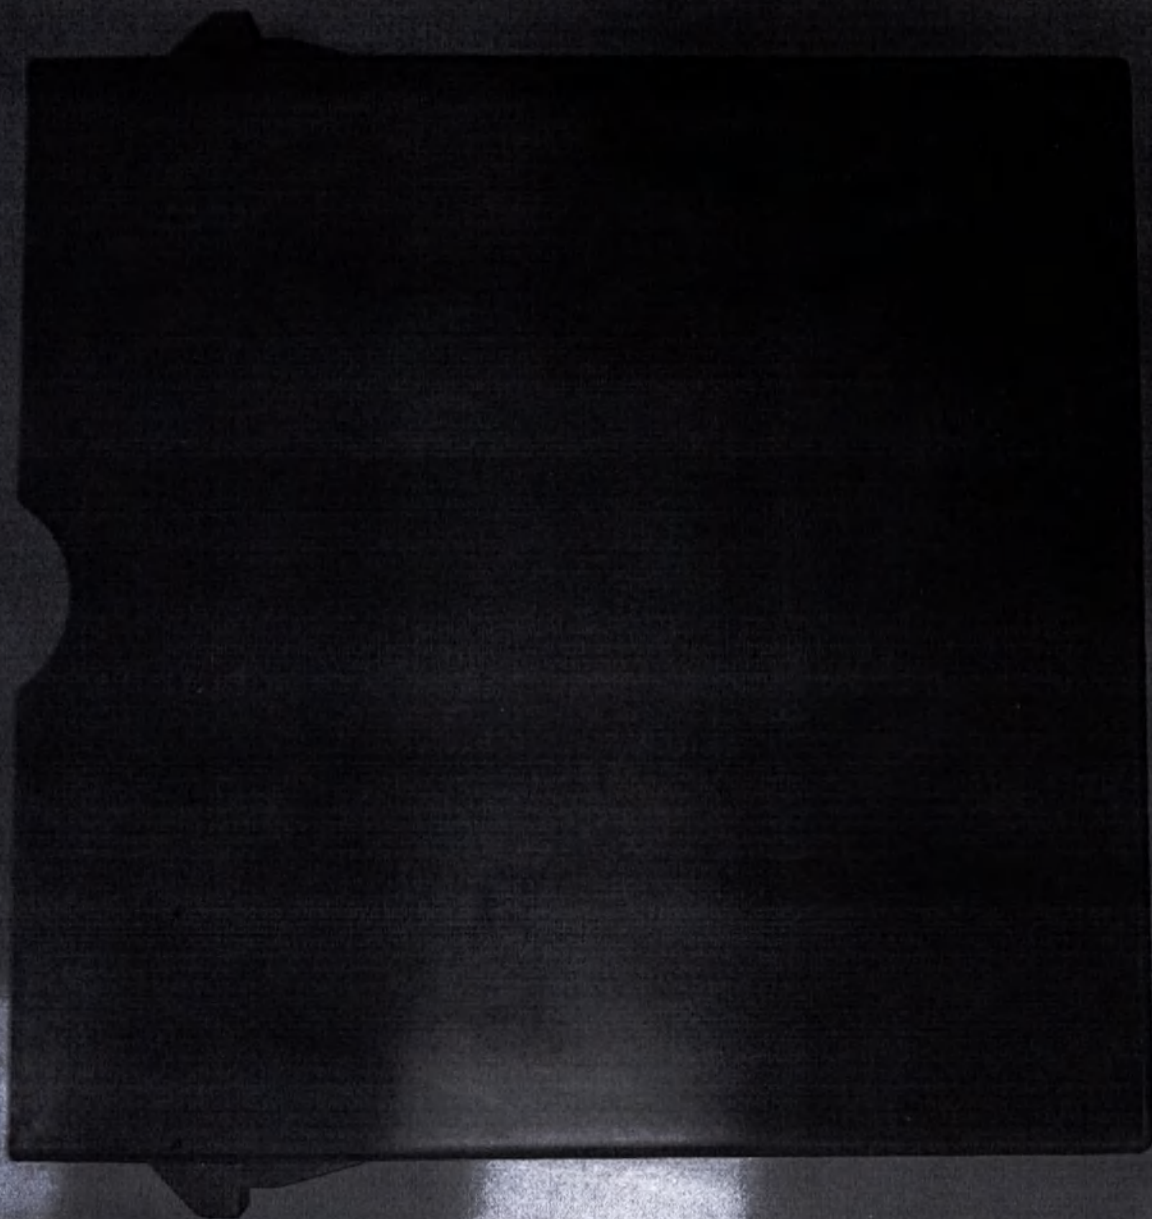


Фото 4.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических,

цитологических и гистохимических окрашиваний на предметном стекле: 2. Резервуар для

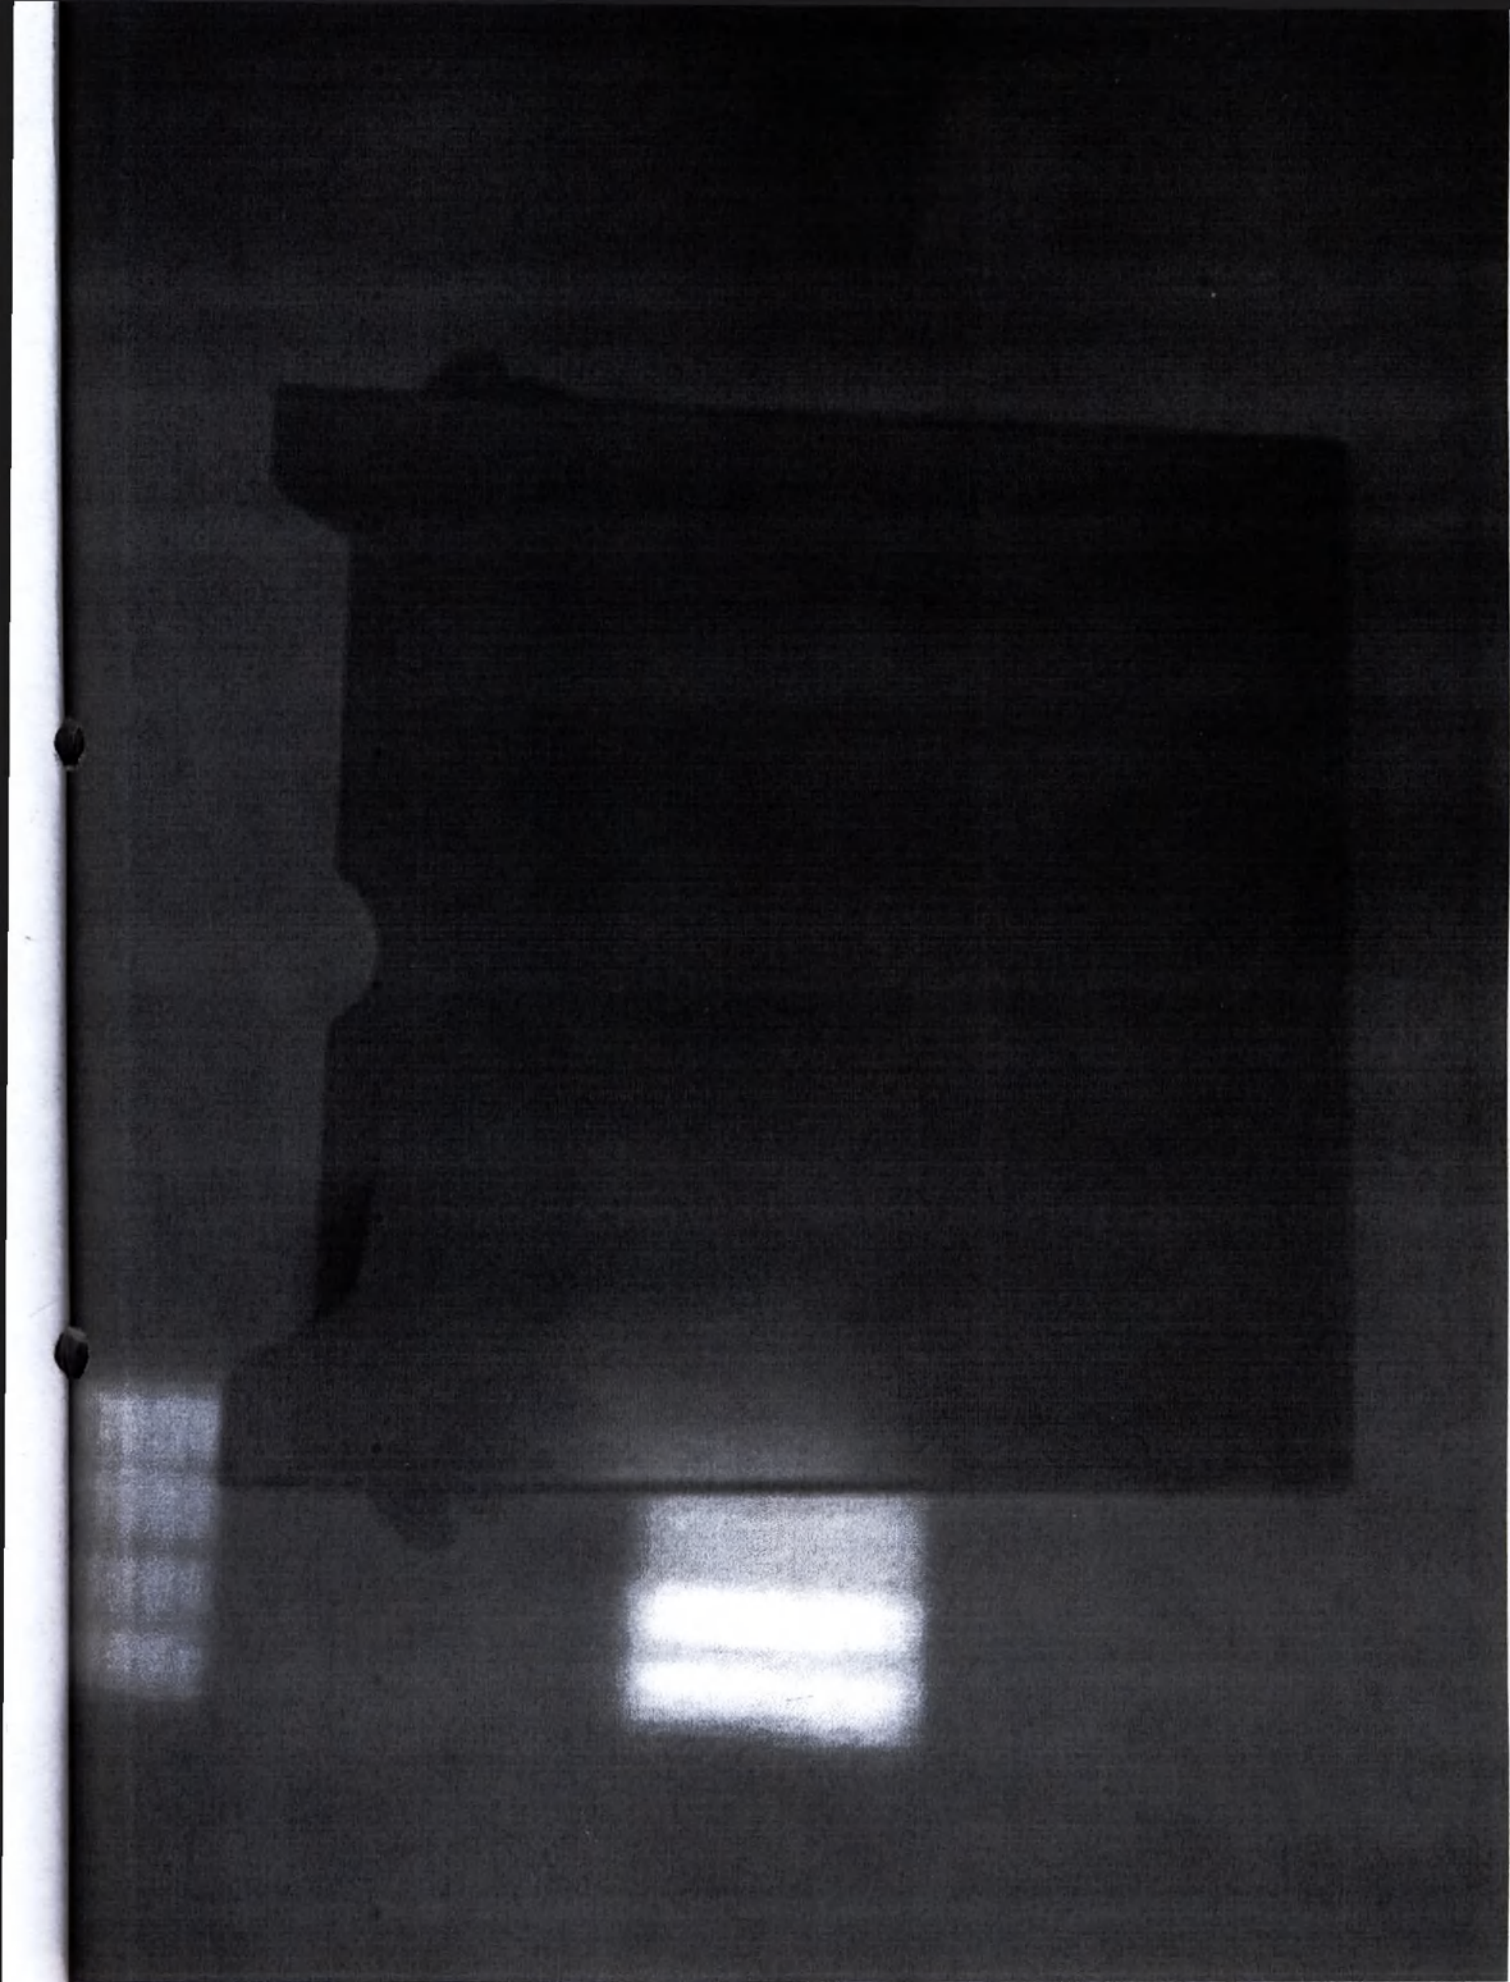


Фото 5.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических,

цитологических и гистохимических окрашиваний на предметном стекле: 3. Резервуар для

ООО ЦИРМИ  info@cirmi.ru  www.goszdravnadzor.ru

ВОДЫ 450 мл арт. SDSGT9035

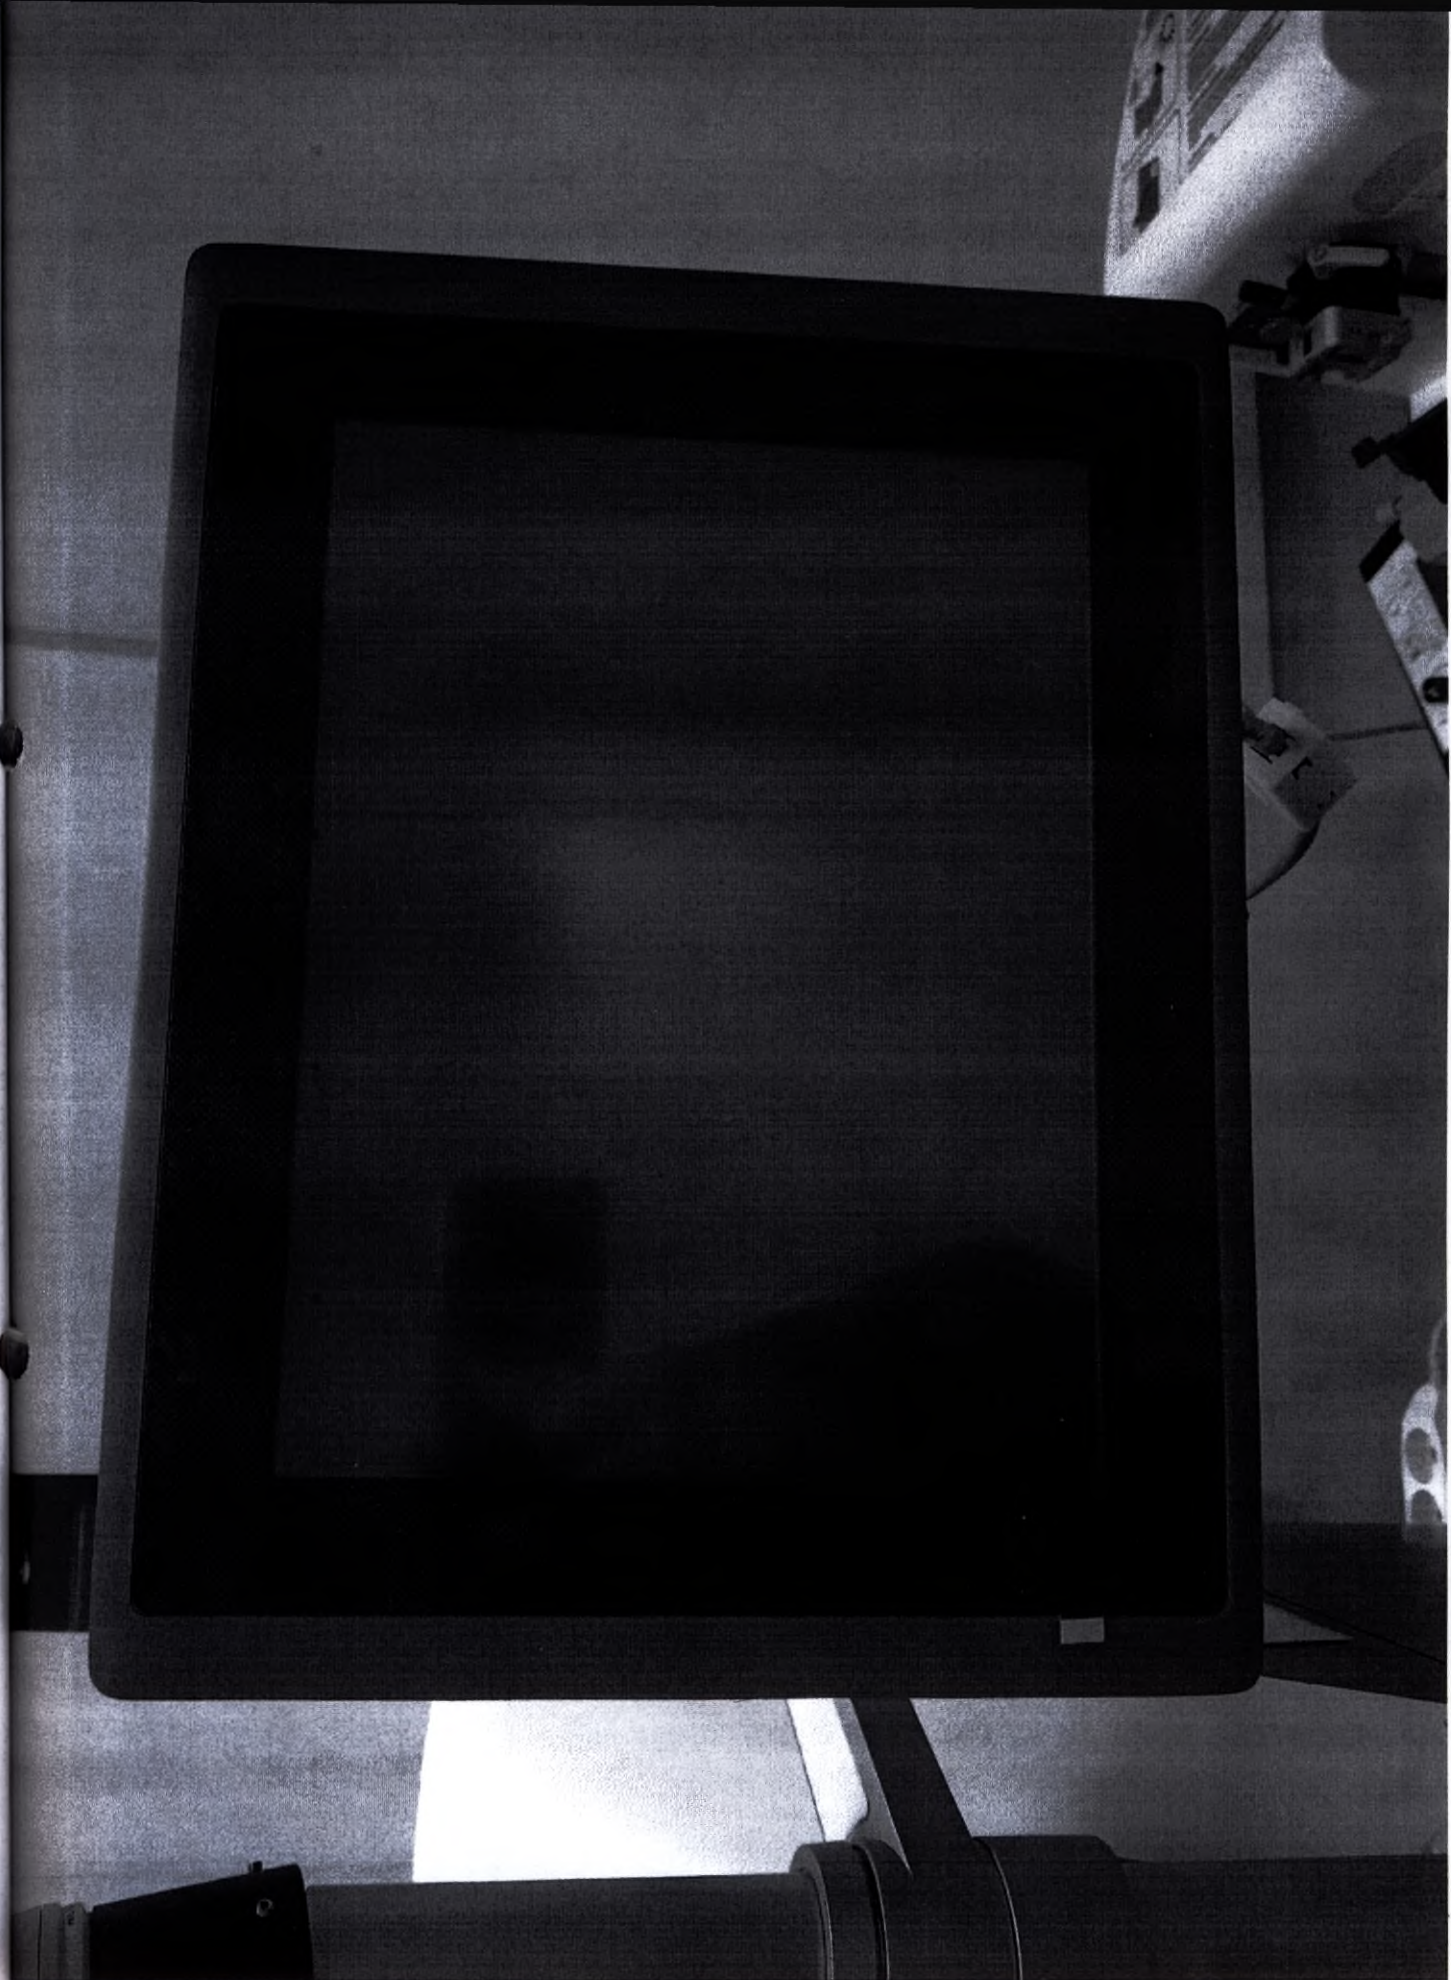


Фото 6.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических, цитологических и гистохимических окрашиваний на предметном стекле: 4. Сенсорный дисплей арт. SDXCE0109



Фото 7.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических, цитологических и гистохимических окрашиваний на предметном стекле: 5. Угольный фильтр арт. SDXFG0001



Фото 8.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических,

гистологических и гистохимических окрашиваний на предметном стекле: 6. Сетевой кабель
евро разъем длина 3 м



Фото 9.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических,

гистологических и гистохимических окрашиваний на предметном стекле: 7. Сетевой кабель

UL разъем длина 2 м



Фото 10.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических,

гистологических и гистохимических окрашиваний на предметном стекле: 8. Сетевой кабель
СН разъем длина 4 м



Фото 11.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических,

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU хих окрашиваний на предметном стекле: 9. Крышка для резервуаров арт. SDSGT0103



Фото 12.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических, ских окрашиваний на предметном стекле: 10. Корзина пластиковая на 30 стекол арт. 53CV30

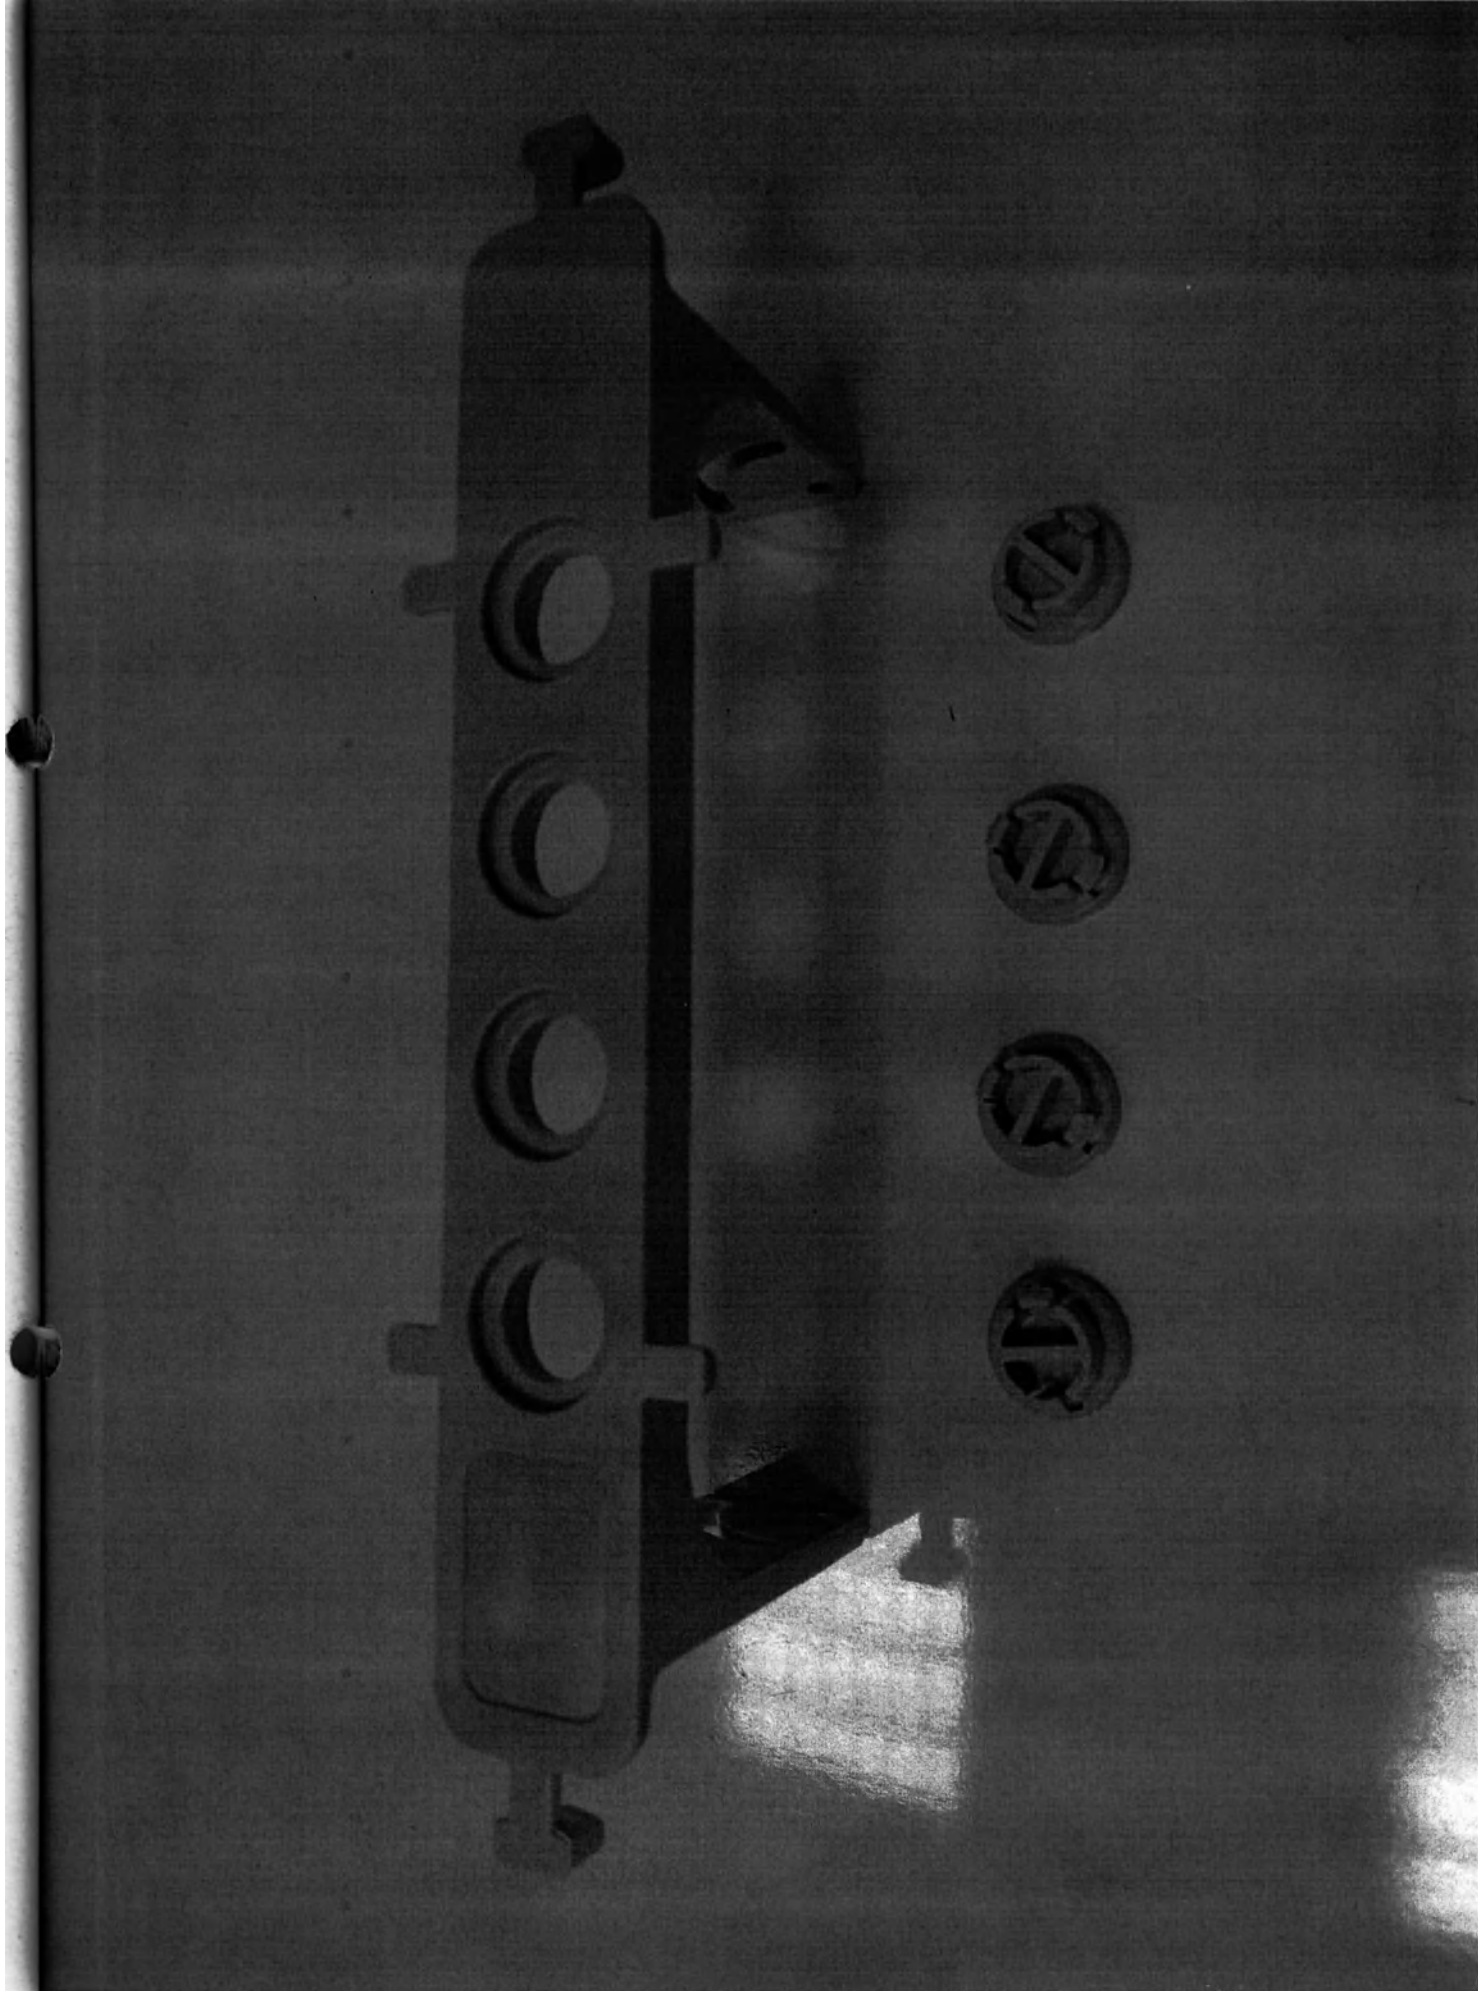


Фото 13.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических,

000 ЦИРМИ  info@cirmi.ru  www.goszdravnadzor.ru ких окрашиваний на предметном стекле: 11. Ручка для корзины на 30 стекол цвет белый арт. GP18114



Фото 14.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических,

их окрашиваний на предметном стекле: 12. Конвейер для дыма арт. SDSGT0042



Фото 15.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических,

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU жих окрашиваний на предметном стекле: 13. Ярлык для
ручек нумерованный от 1 до 10 (1 комплект = 40 шт.) арт. SDXET0020



Фото 16.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических, цитологических и гистохимических окрашиваний на предметном стекле: 14. Корзина вместимая с покровными стеклами Leica, арт. GP18200



Фото 17.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических,

ООО ЦИРМИ  info@cirmi.ru  www.goszdravnadzor.ru для окрашиваний на предметном стекле: 20. Адаптер для корзины на 20 стекол Sakura арт. SDSGT9085

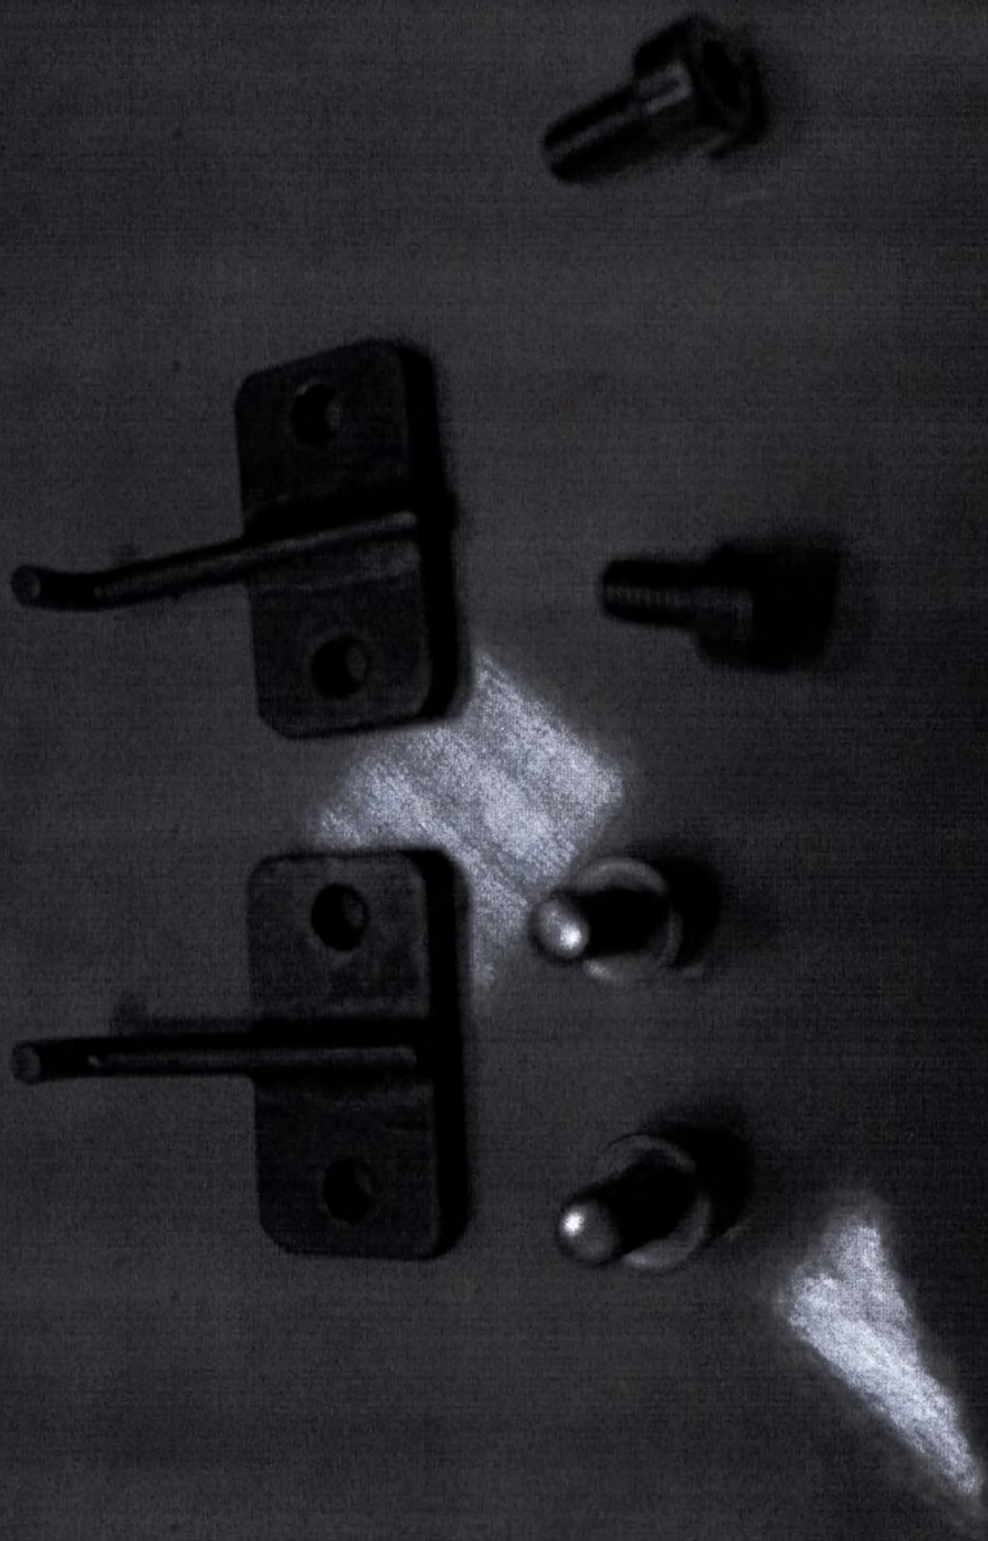


Фото 18.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических,

ООО ЦИРМИ  info@cirmi.ru  www.goszdravnadzor.ru

ких окрашиваний на предметном стекле: 21. Адаптер для
корзины на 30 стекол Thermo арт. SDSGT9086

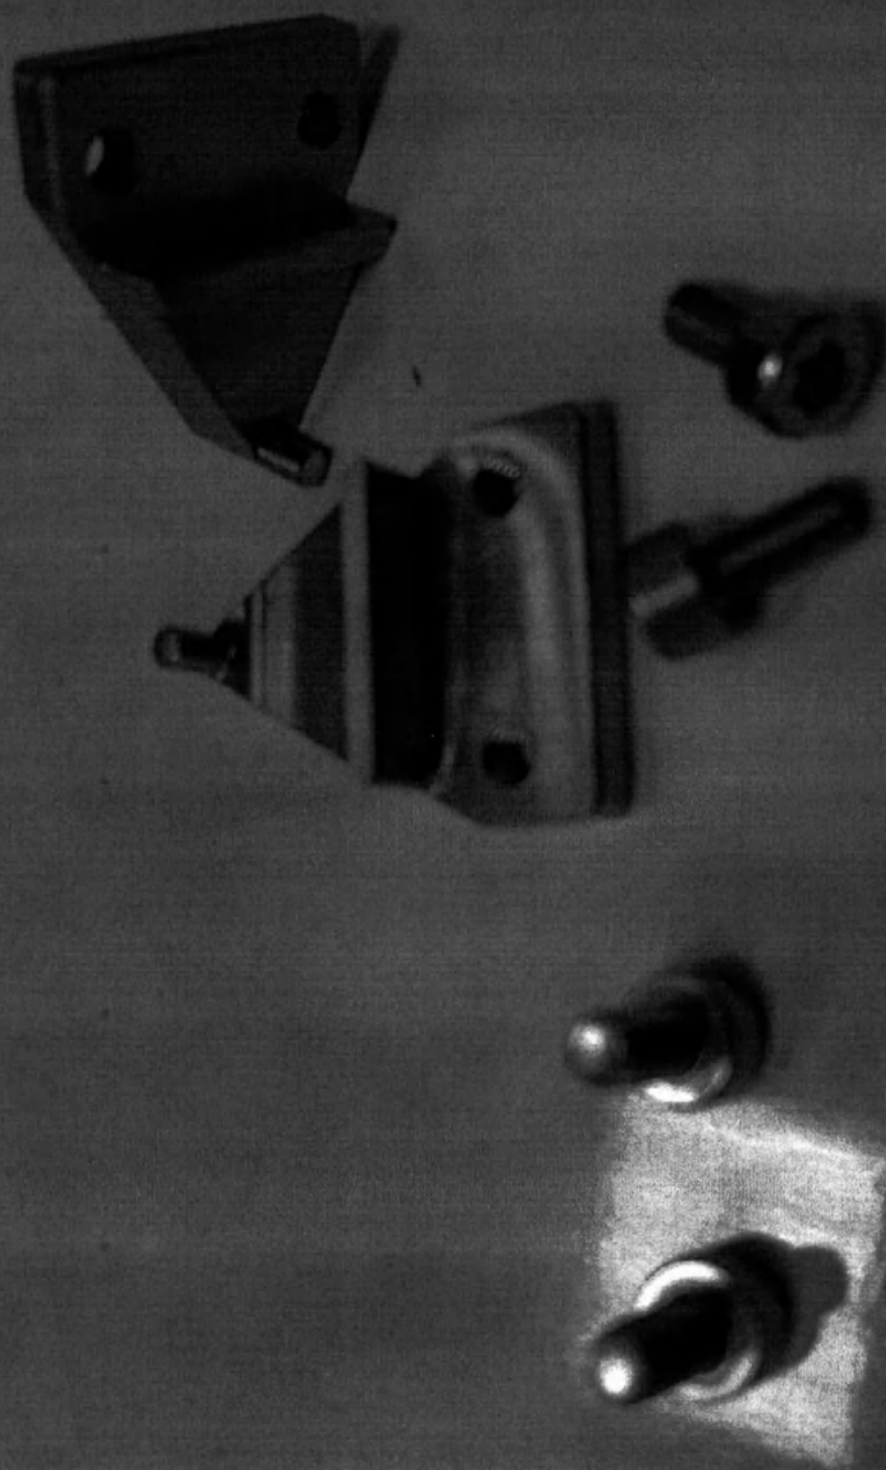


Фото 19.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических,

000 ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ких окрашиваний на предметном стекле: 22. Адаптер для корзины на 30 стекол Medite арт. SDSGT9087



Фото 20.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических, цитологических и бактериальных окрашиваний на предметном стекле: 23. Батарея аварийного питания арт. CRDEA901-III PRO

ООО ЦИРМИ  info@cirml.ru  www.goszdravnadzor.ru

Model: 1kVAS

Input: 208-240Vac 50/60Hz 1Φ

Output: 208-240Vac 50/60Hz 1Φ

Capacity: 1kVA/900W

S/N : 900012004010642



Before working on this circuit

- Isolate Uninterruptible Power System(UPS)
- Then check for Hazardous Voltage between all terminals including the protective earth.



Risk of Voltage Backfeed

Фото 21.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических,



Фото 22.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических, окрашиваний на предметном стекле: 24. Роутер для удаленной помощи арт. CBD-BT01N



Фото 23.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических,

ких окрашиваний на предметном стекле: 24. Роутер для удаленной помощи арт. CRD-RT01N (маркировка)



Фото 24.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических,

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU еских окрашиваний на предметном стекле: 25. Реагент

CRISTALLO- жидкое покровное стекло флакон 1 л. арт. LC001

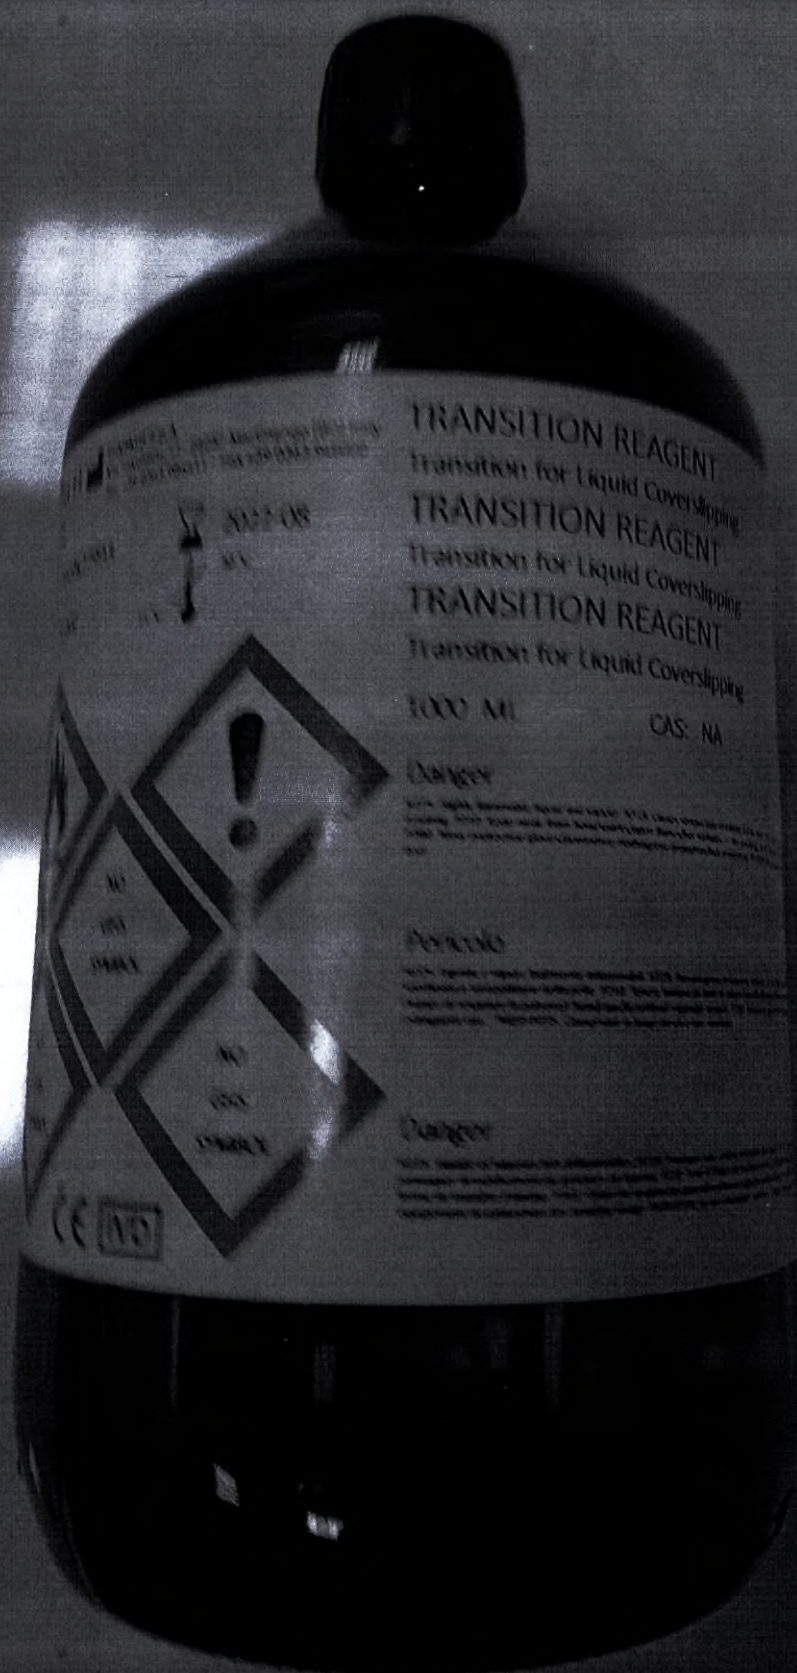


Фото 25.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических, цитологических и бактериальных окрашиваний на предметном стекле: 26. Транзитный реагент CRISTALLO флакон 1 л арт LC002

ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru

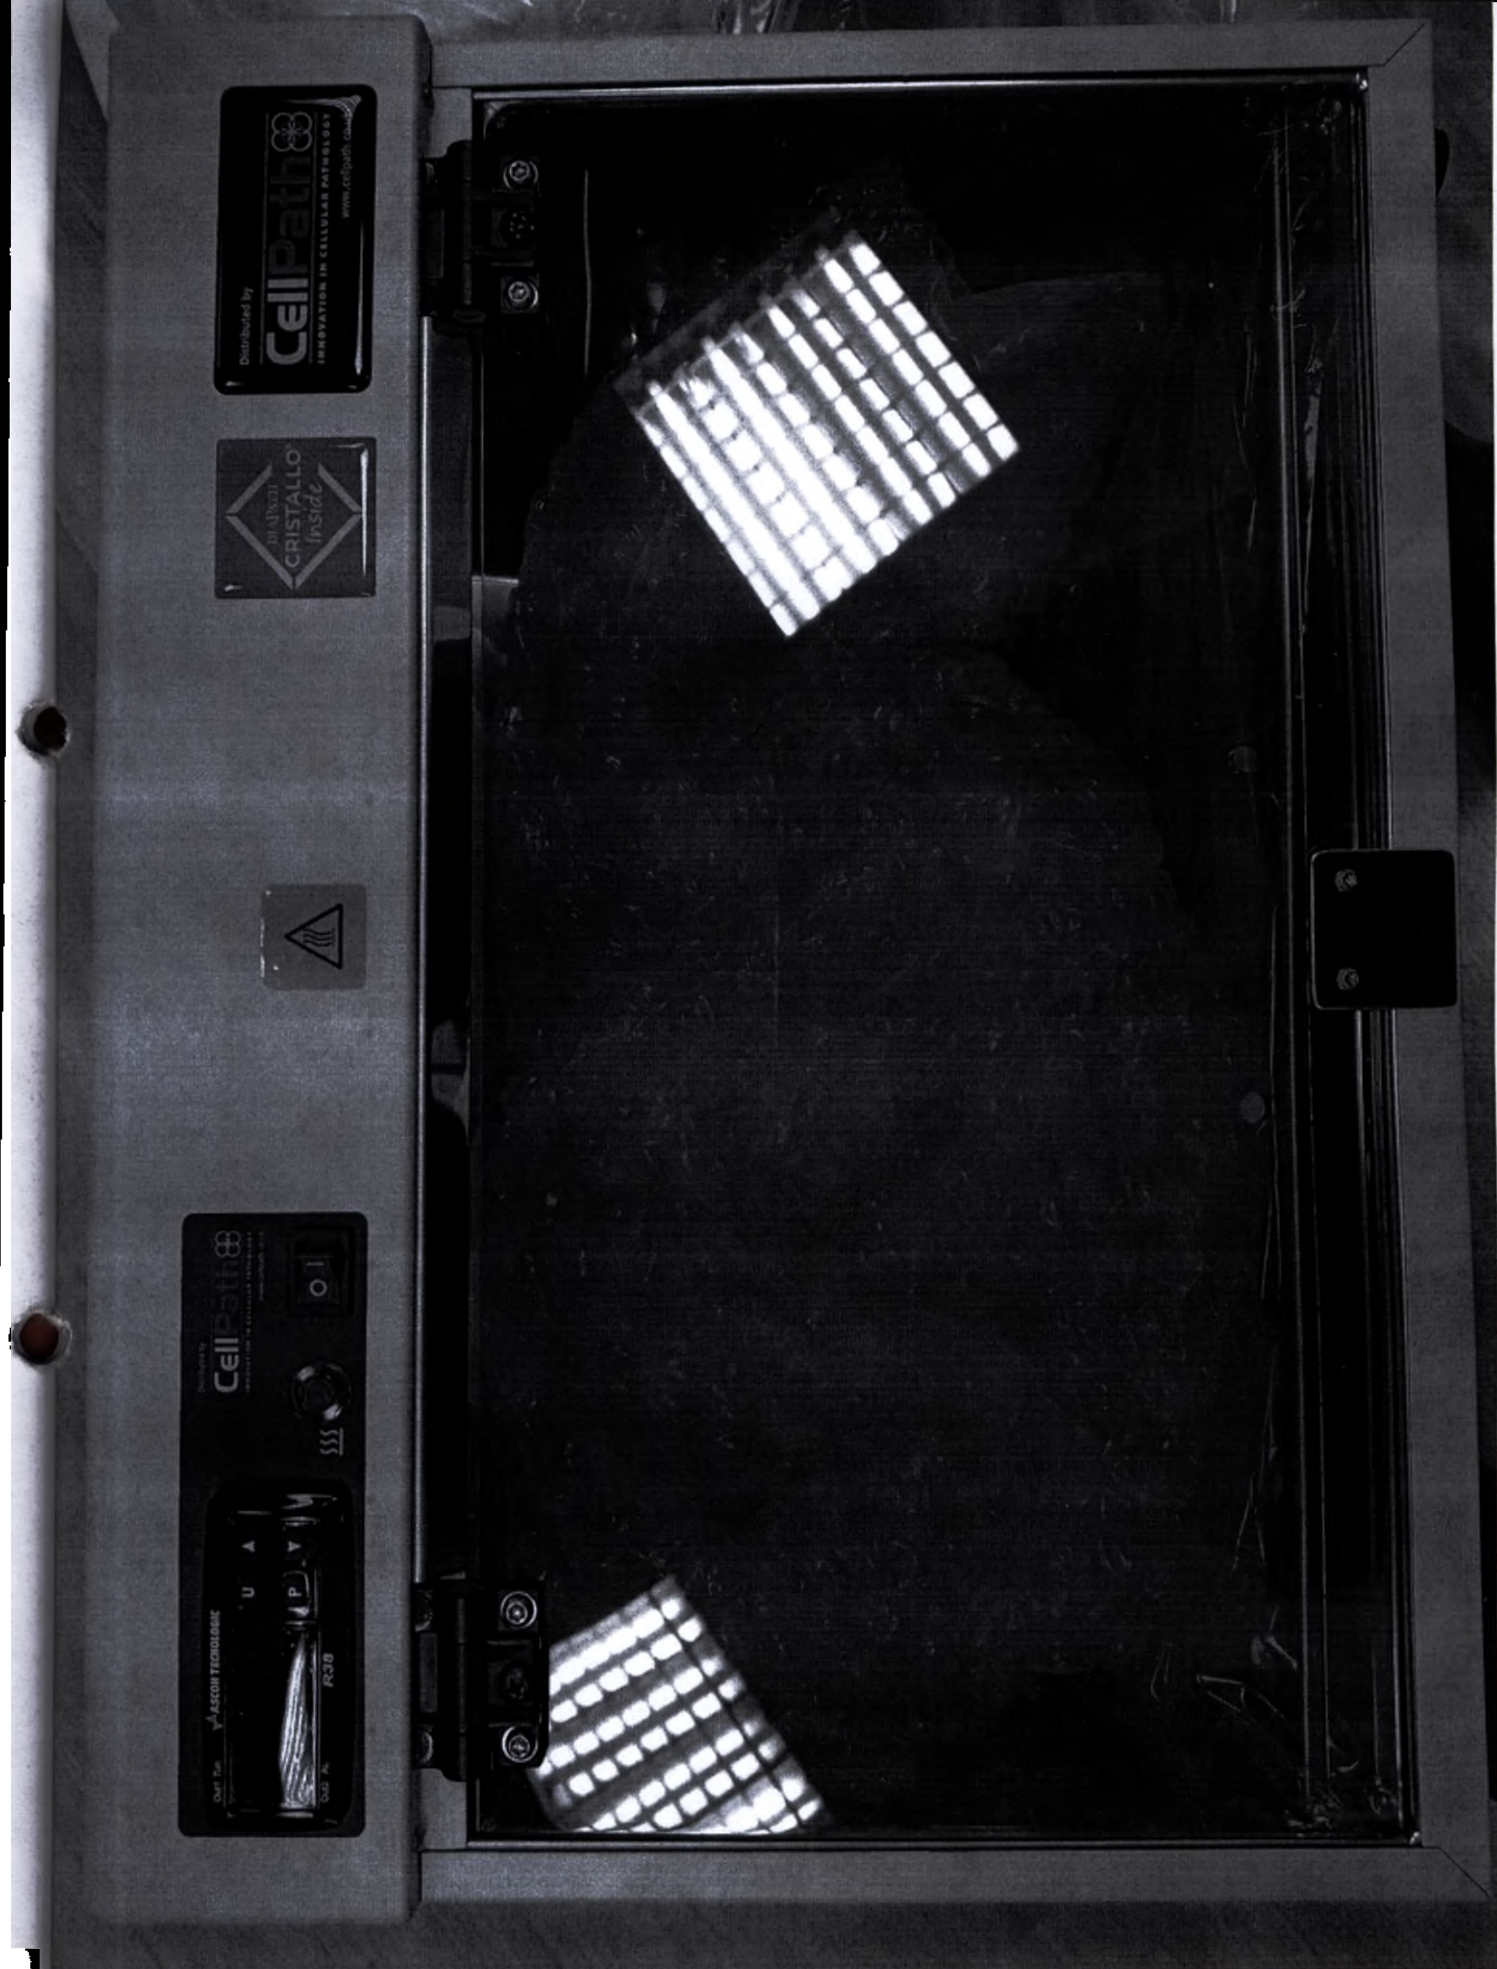


Фото 26.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических, цитологических и гистохимических окрашиваний на предметном стекле: 27. Сушилка

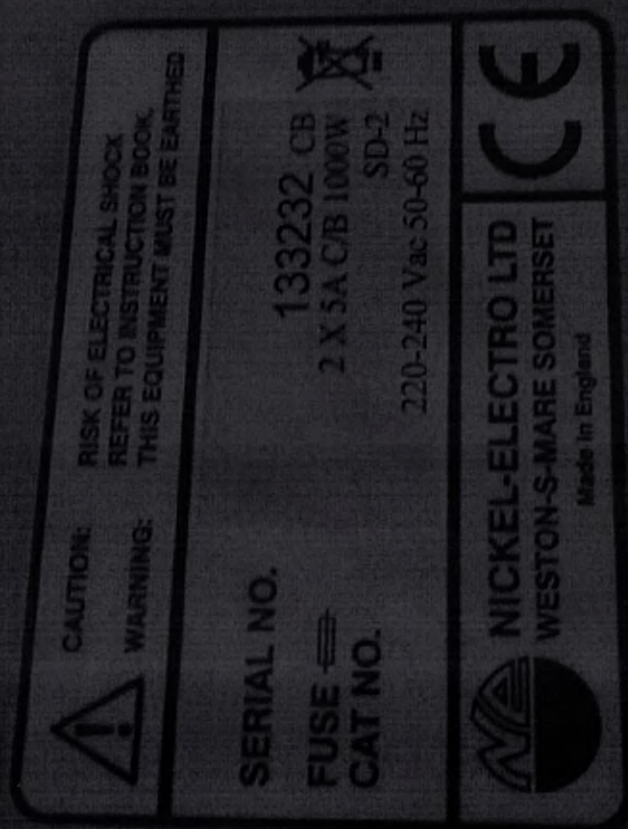


Фото 27.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических,

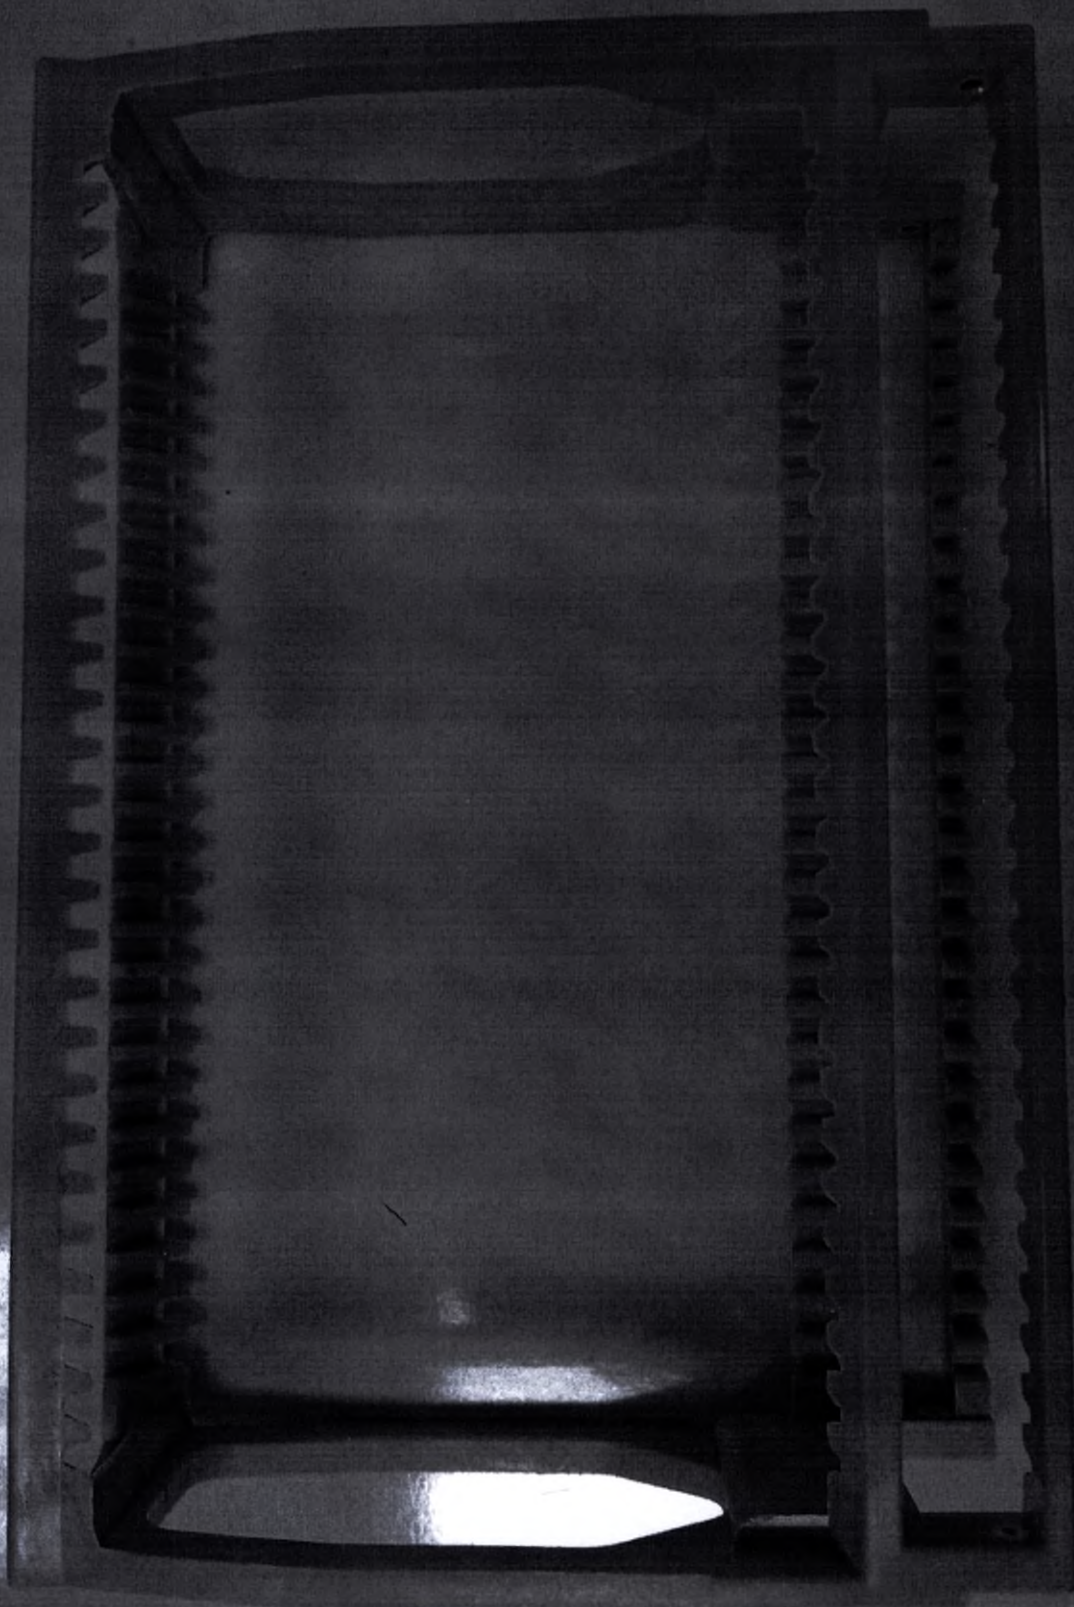


Фото 28.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических, химических окрашиваний на предметном стекле: 28. Корзина пластиковая CRISTALLO на 28 стекол арт. LC004

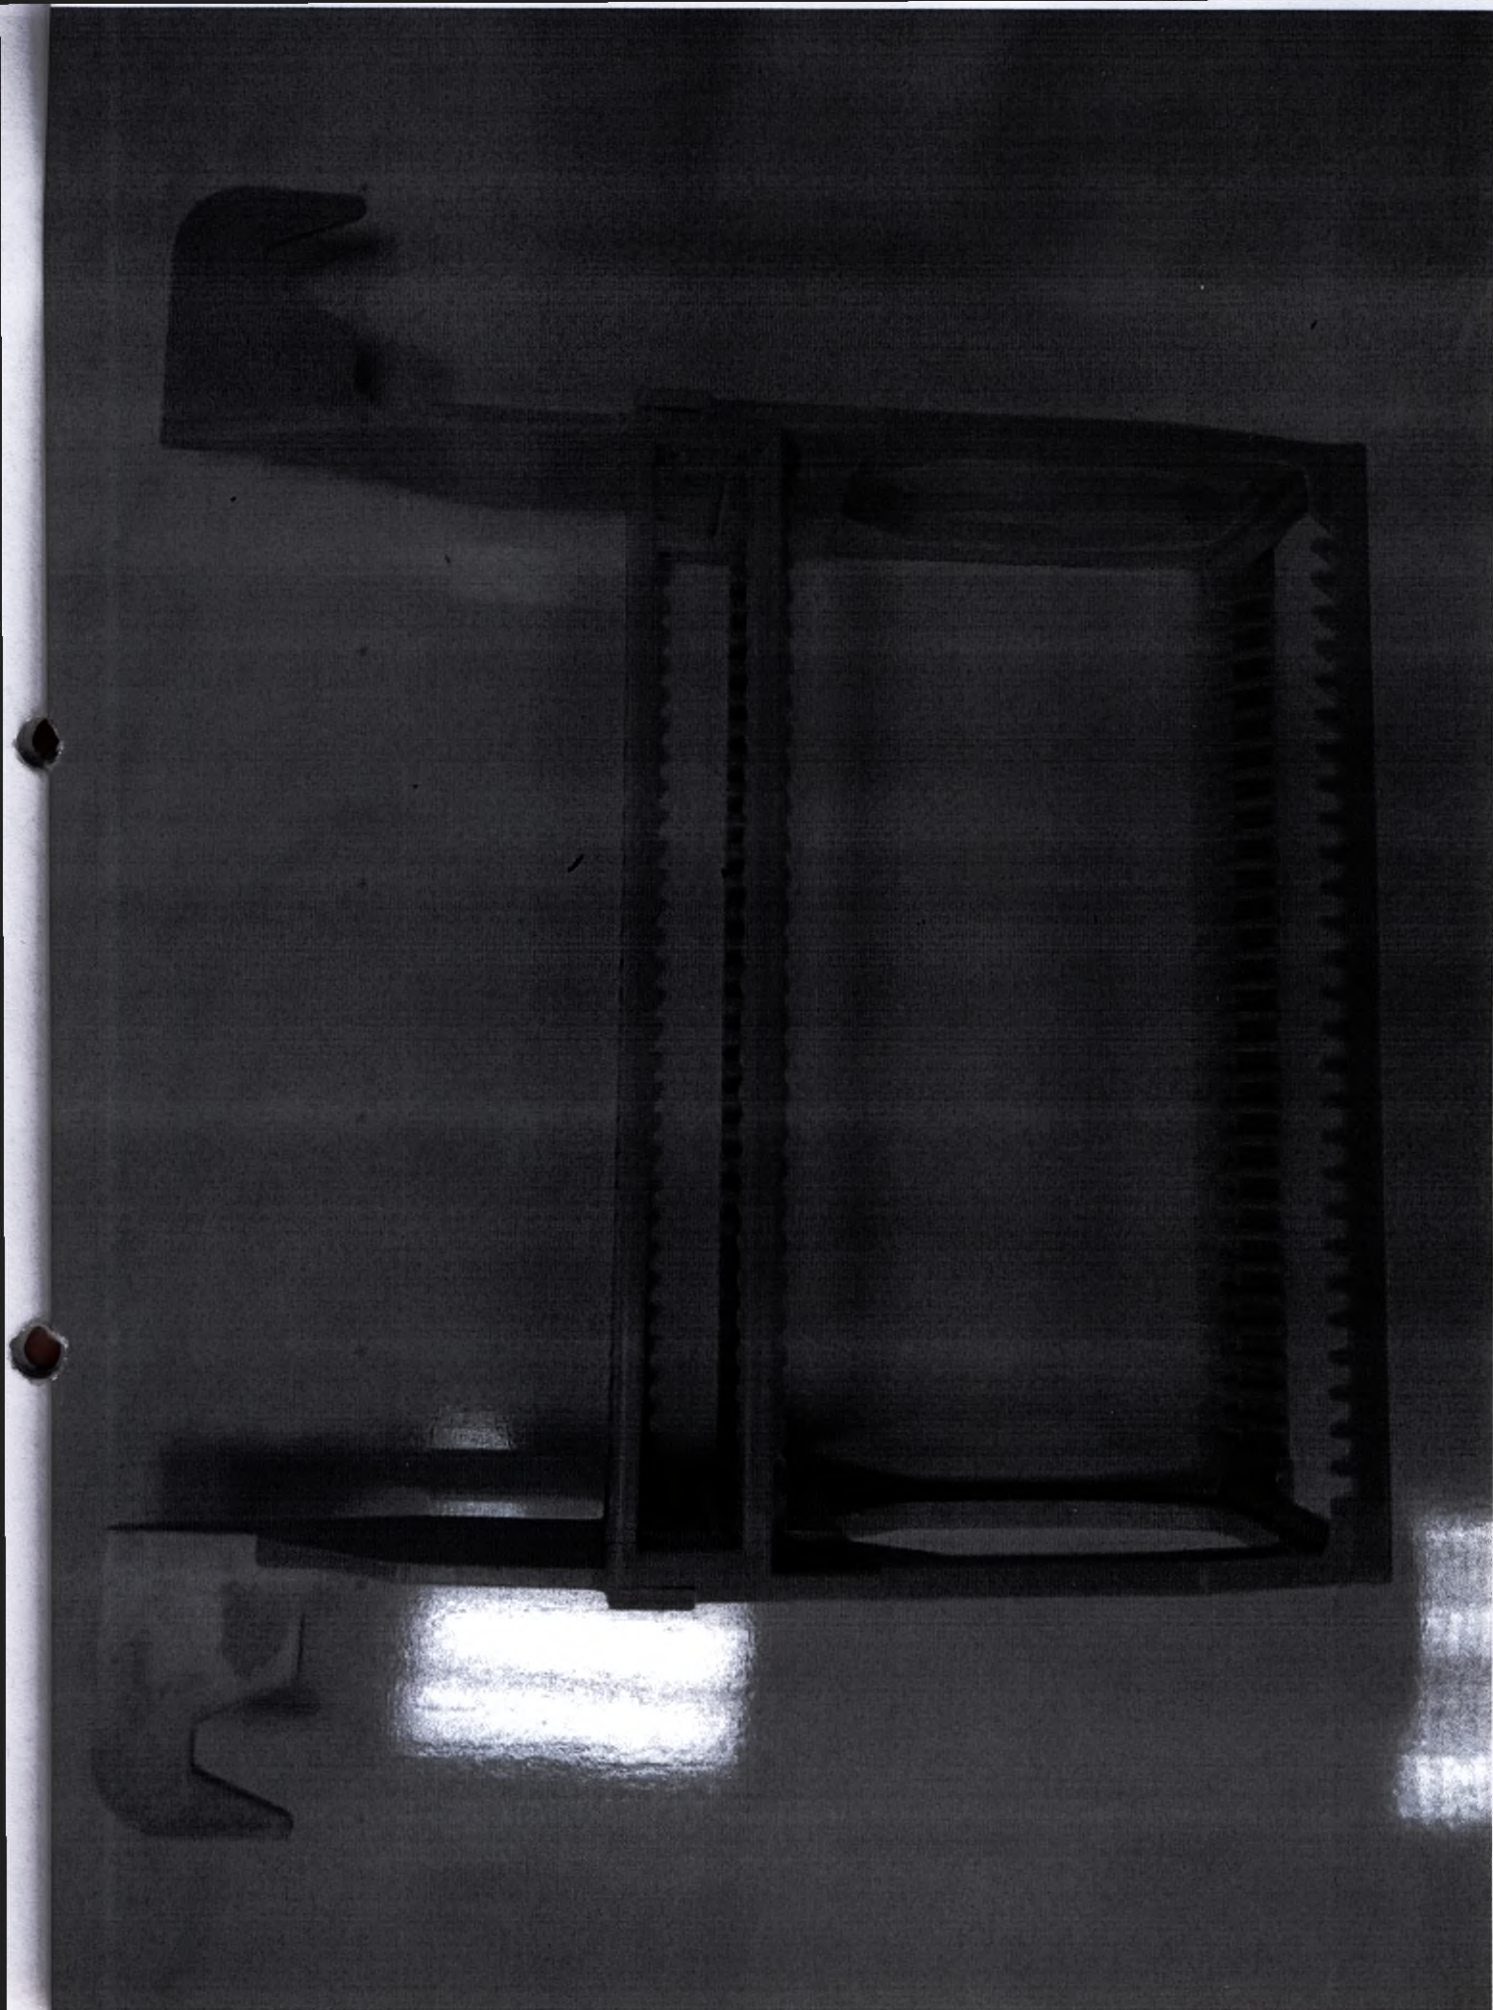


Фото 29.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических,
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ских окрашиваний на предметном стекле: 29. Корзина
пластиковая CRISTALLO на 28 стекол, совместимая с стейнером Leica арт. LC005



Фото 30.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических, цитологических и гистохимических окрашиваний на предметном стекле: 30. Прокладки абсорбирующие CRISTALLO (1 комплект = 50 шт.) арт. LC012

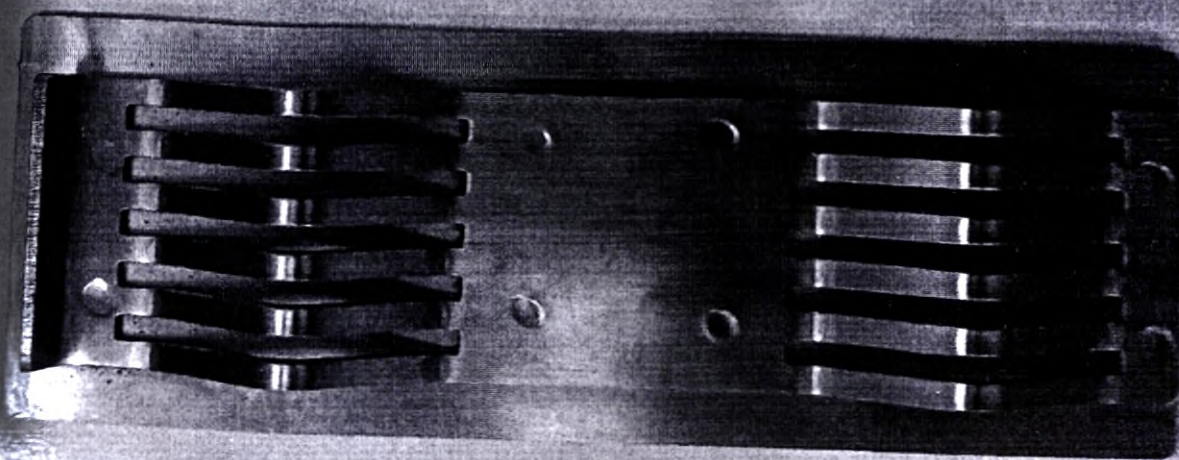
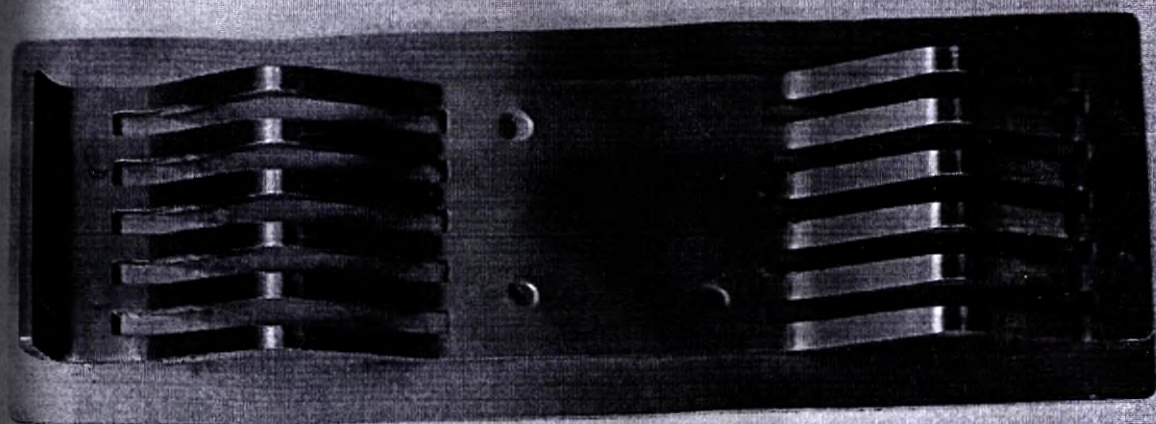


Фото 31.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Ciotto для гистологических,

окрашиваний на предметном стекле: 32. Адаптер для корзины для размещения больших стекол Mega Slide арт. LC014

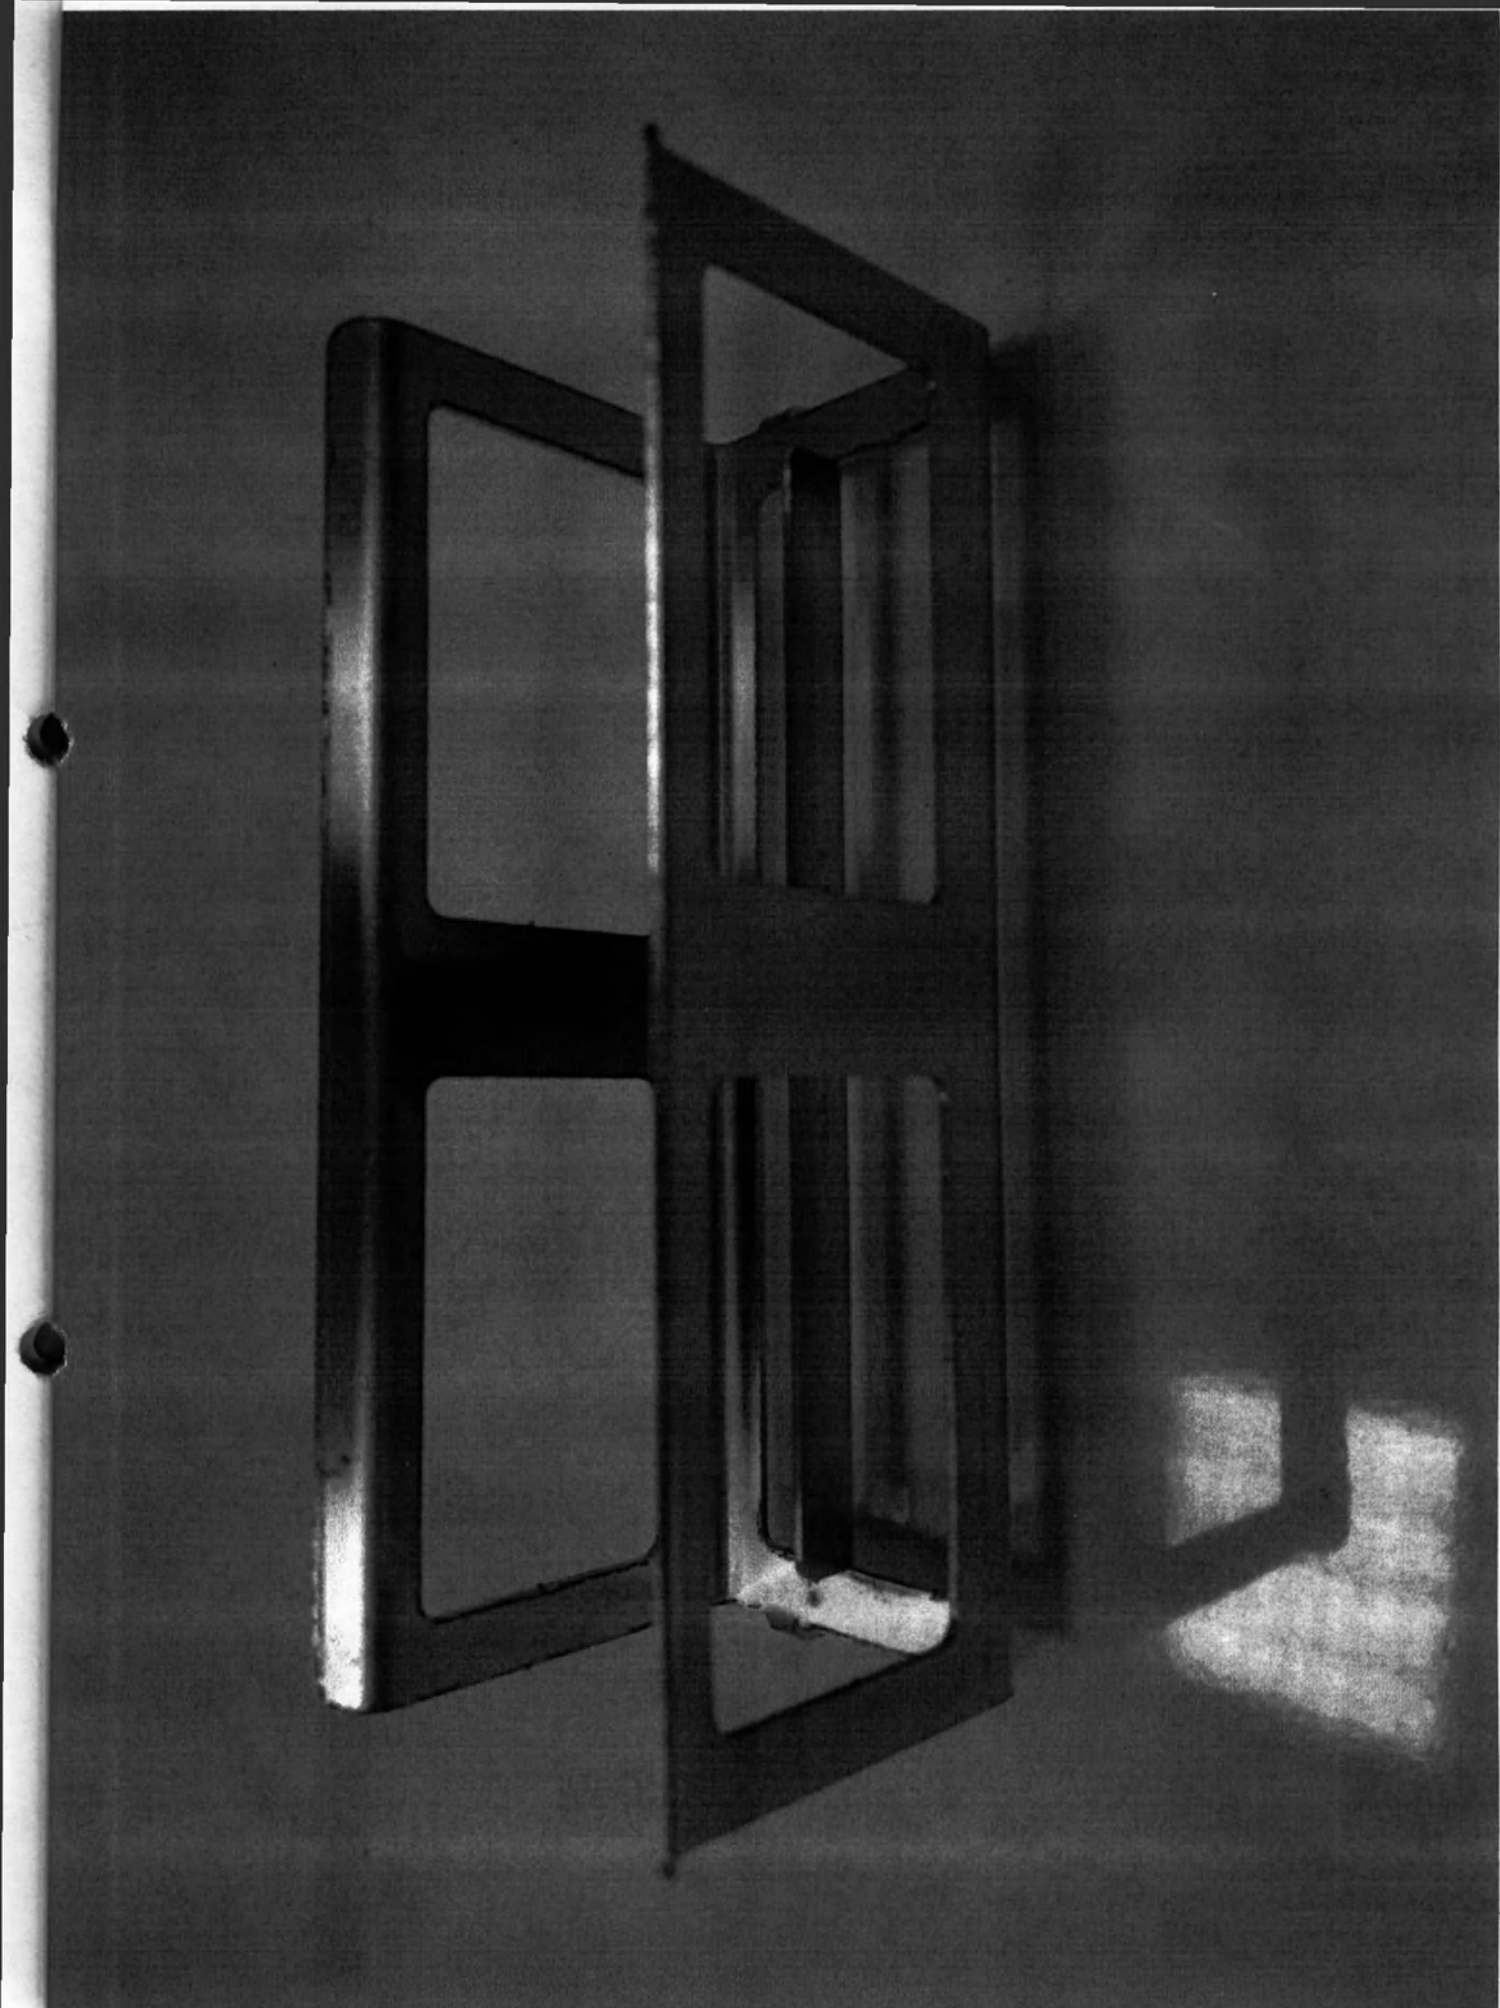


Фото 32.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических,

000 ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU их окрашиваний на предметном стекле: 32. Держатель для корзины Slide lifting support art. LC015



Фото 33.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических, цитологических и гистохимических окрашиваний на предметном стекле: 33. Держатель планшетов CRISTALLO art. LC016



Фото 34.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических,

ООО ЦИРМИ  info@cirmi.ru  www.goszdravnadzor.ru хих окрашиваний на предметном стекле: 34. Крышка для резервуаров для использования с реагентом CRISTALLO арт. LC017

DIAPATH



Martinengo, 29th June 2021

To be submitted to the Competent Health Authorities in Russian Federation

I herewith confirm that the content of **Instruction for use** for in vitro diagnostics medical device «Automatic device (steiner automatic) Giotto for histological, cytological and histochemical staining on a slide» is valid and true.

Diapath S.p.A. is the original manufacturer of the device mentioned in the document.

(Signature):

(Name, position): VLADIMIRO BERGAMINI, LEGAL REPRESENTATIVE

DIAPATH S.p.A.

Via Savoldini, 71

24057 Martinengo (BG)

Tel. 0363.986411 - Fax 0363.948000

P.A. IVA 02705540165

Diapath S.p.A.

Via Pietro Savoldini, 71 - 24057 Martinengo (BG) Italy

T. +39 0363 986411 F. +39 0363 948000

info@diapath.com | diapath.com

C.F./P. IVA 02705540165

Registro Imprese di Bergamo n. 02705540165

R.E.A. n. 317033 - Registro A.E.E. UD802000001060

Cap. Soc. € 2.400.000,00 i.v.




Фото 35.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических,

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU х окрашиваний на предметном стекле: 35. Руководство по эксплуатации



Фото 36.

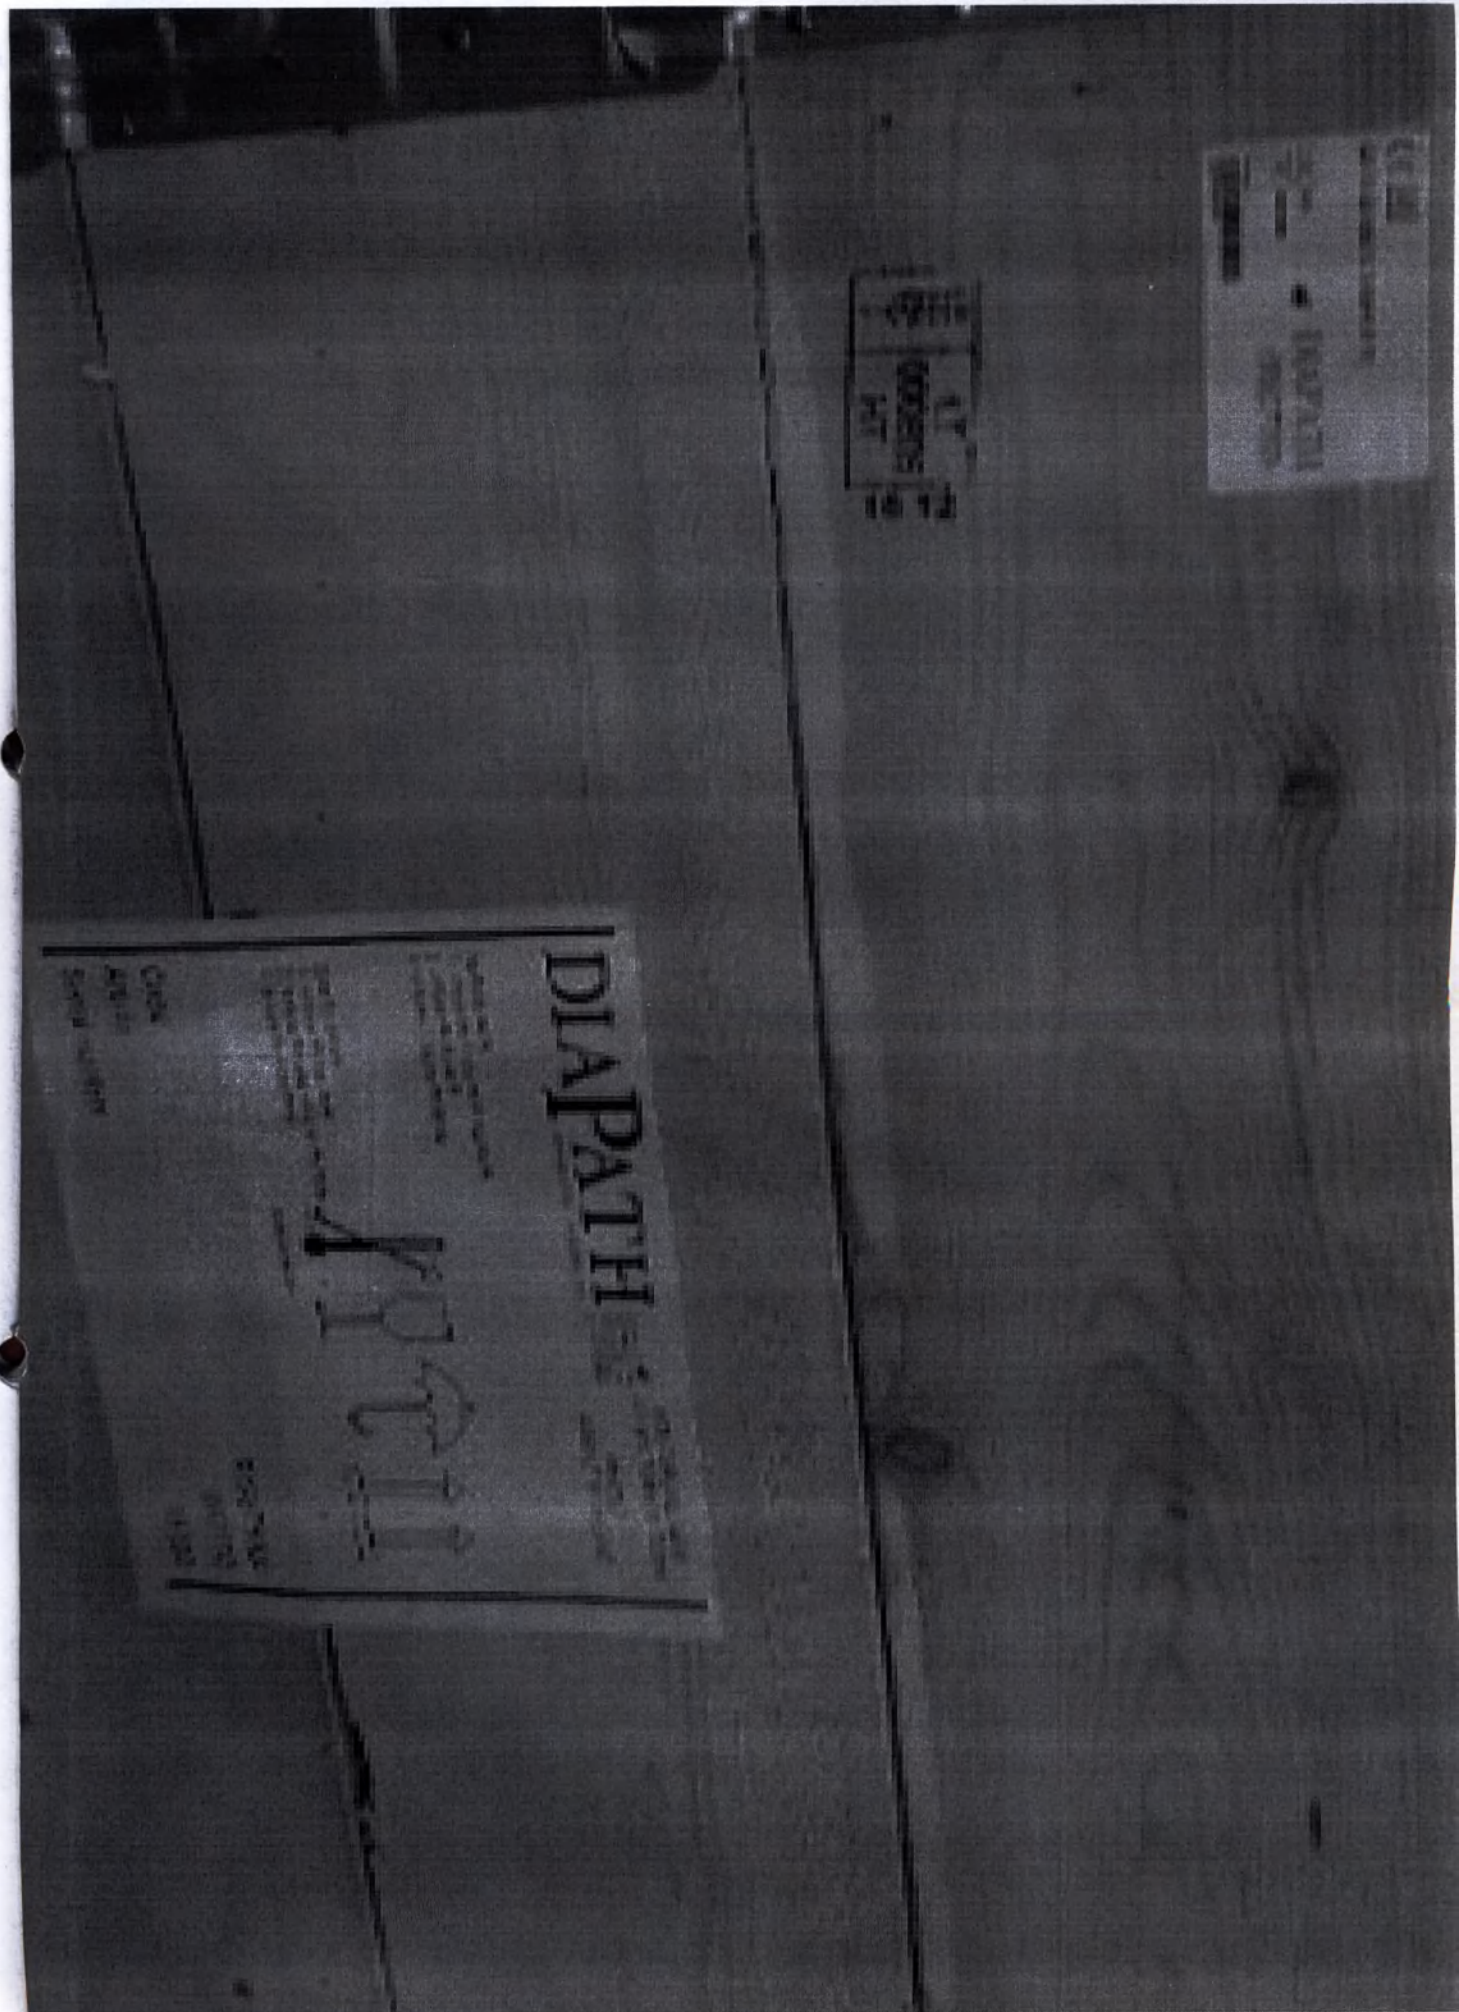


Фото 37.

Аппарат автоматический (стейнер автоматический) Giotto для гистологических, цитологических и гистохимических окрашиваний на предметном стекле (маркировка упаковки)

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО «СМТраст»

Итого в настоящем документе

38 листа(-ов)

Генеральный директор

Попова Л.Р.

МП

