

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «НПО «Татэлектромаш»



И.З. Исламов

«5» июля 2021 г.


**Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский
«ТЭМ» в вариантах исполнения**


ТУ 32.50.50-001-76305937-2021

Фотографические изображения медицинского изделия

Фотографические изображения определяющих внешний вид **ОБЛУЧАТЕЛЯ**, опорной стойки для **ОБЛУЧАТЕЛЯ** серии РП и РВ, мобильной опоры для **ОБЛУЧАТЕЛЯ** серии РВ и передвижной стойки для **ОБЛУЧАТЕЛЯ** серии РП и РВ.

1. Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский «ТЭМ» РП-30

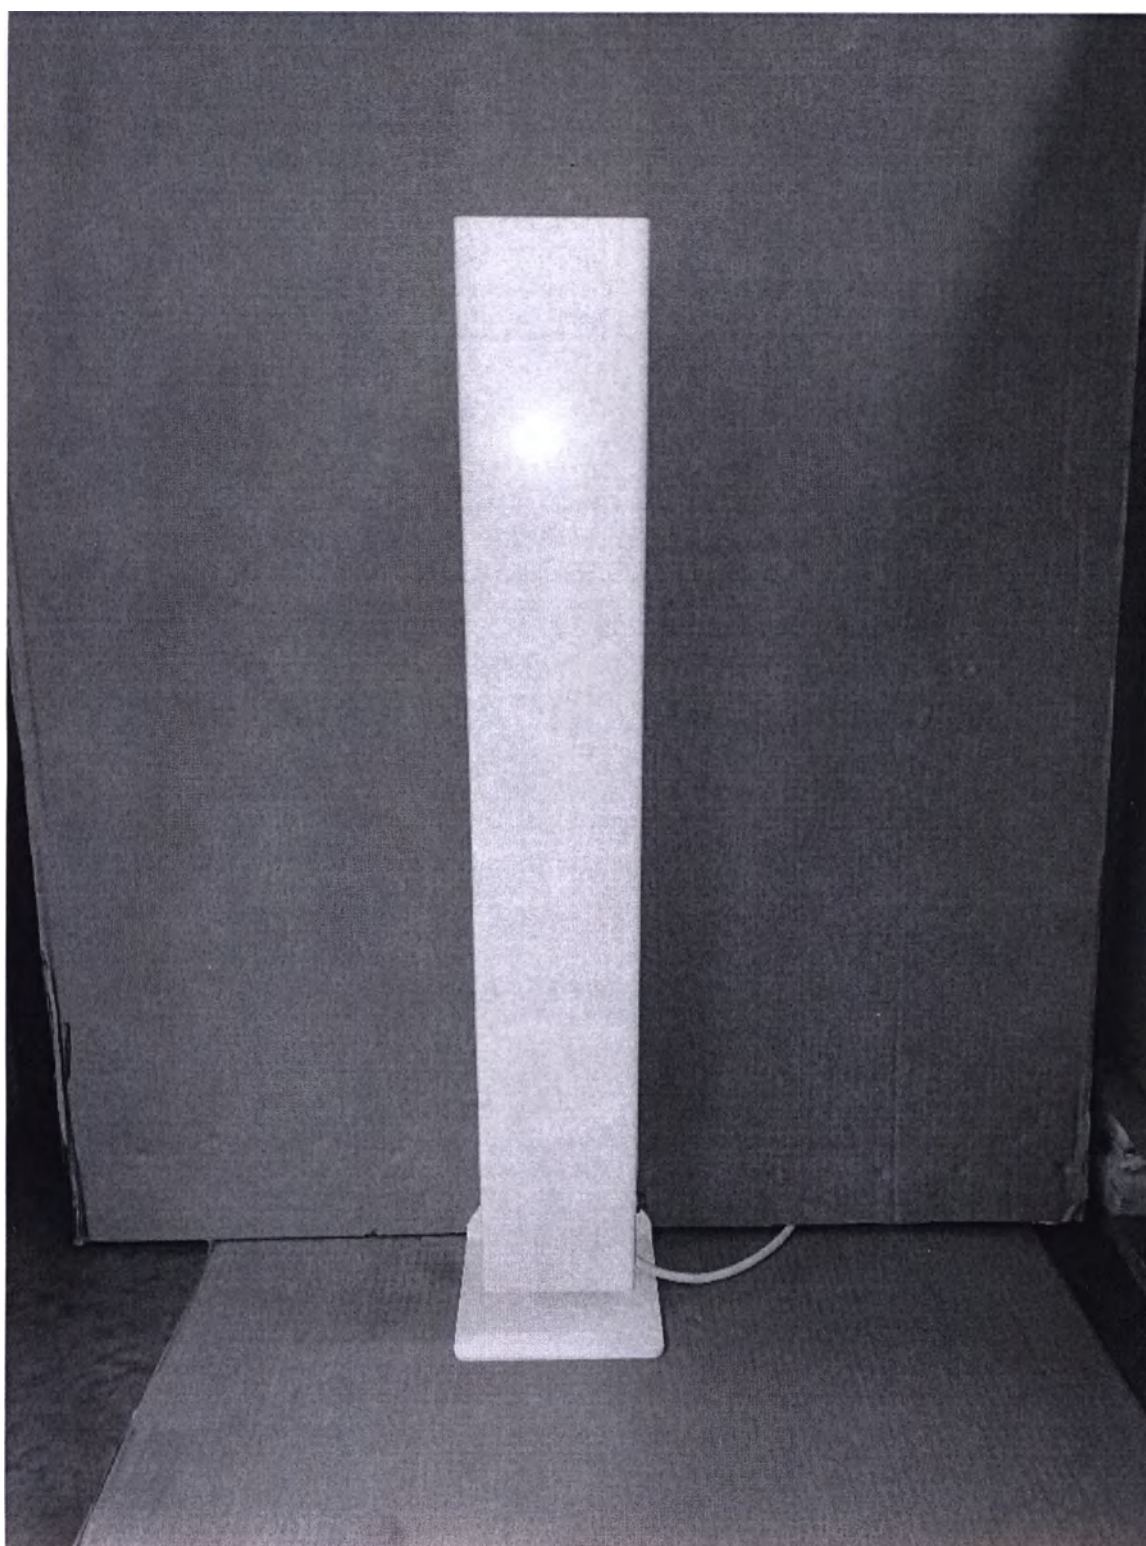

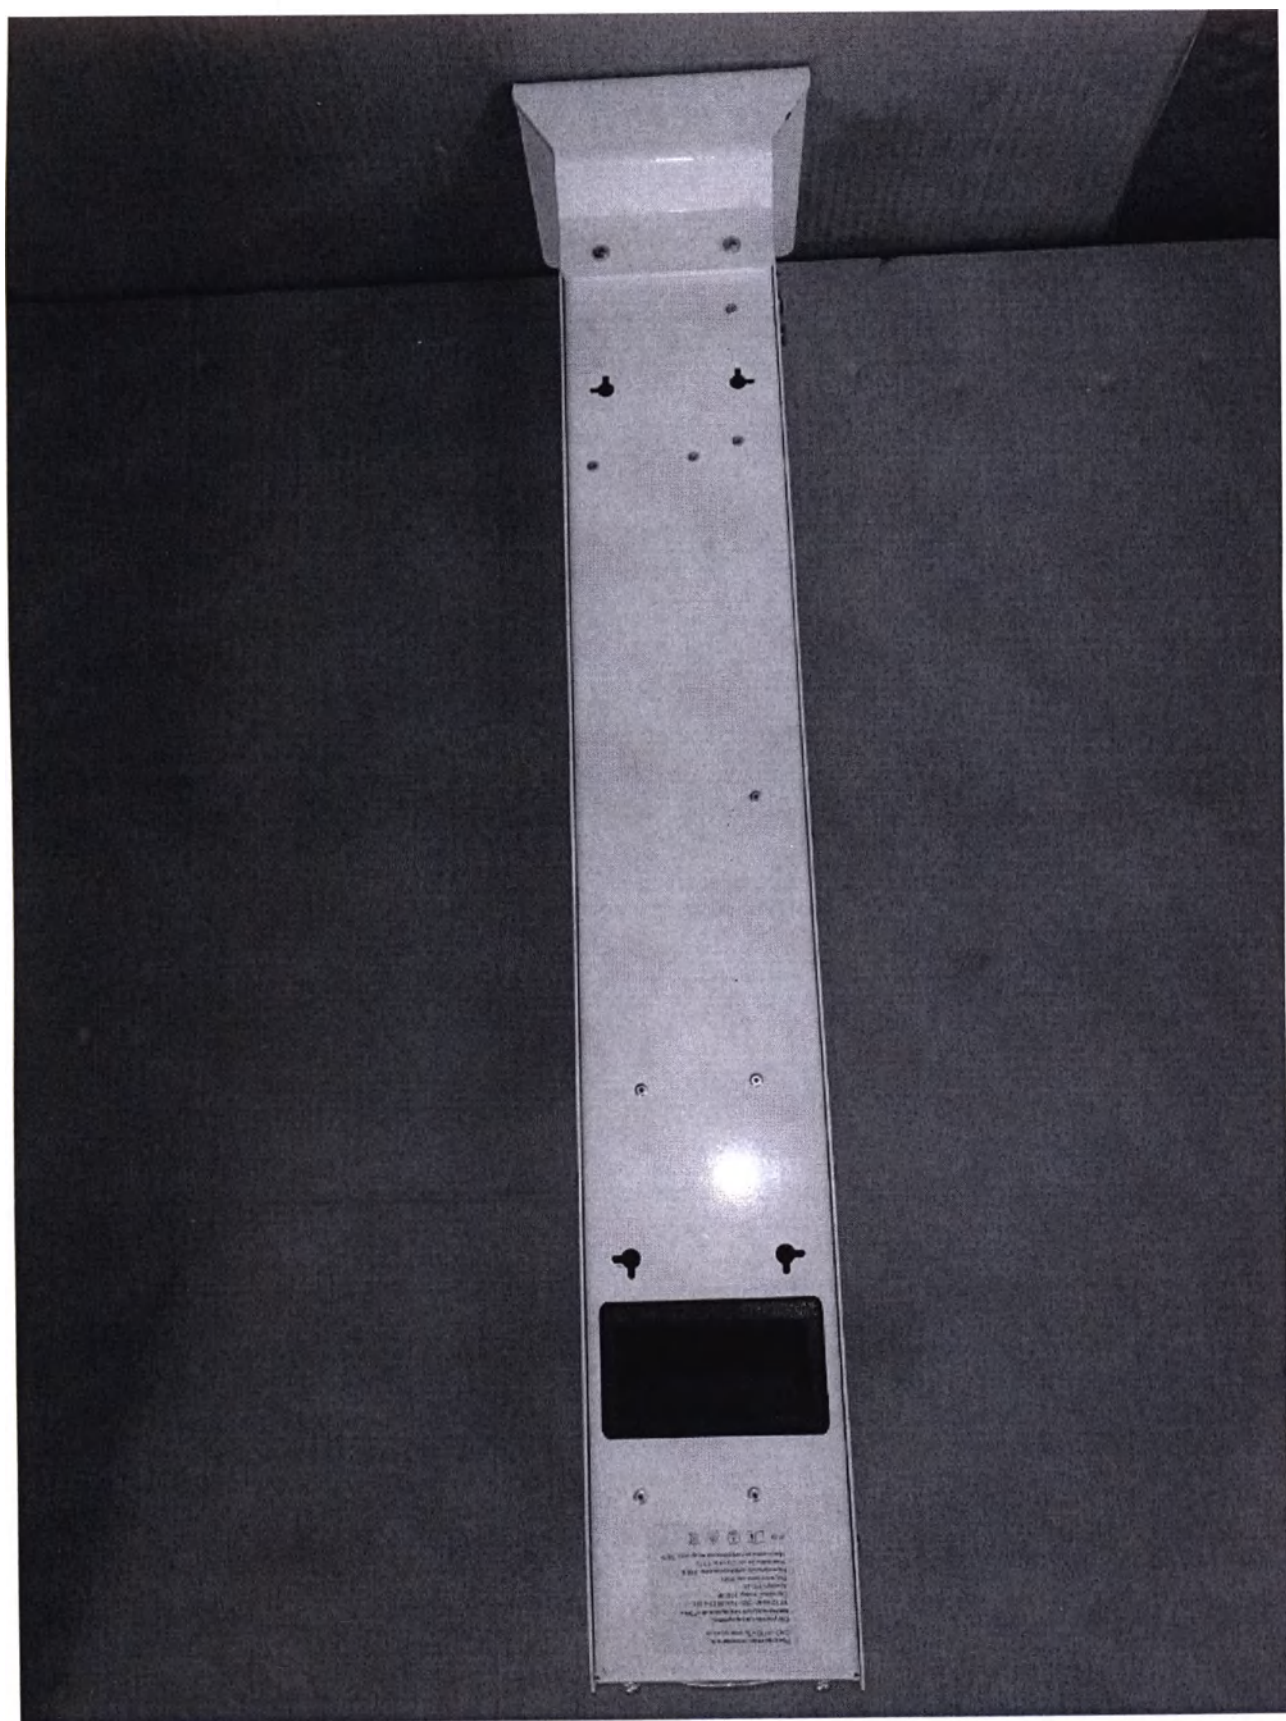

Предприятие-изготовитель
ОАО «НПО «Татэлектромаш»

Облучатель-рециркулятор
бактерицидный медицинский «ТЭМ»

ТУ 32.50.50-001-76305937-2021

Серийный номер: 110005

Артикул: РП-30

Год изготовления: 2021

Номинальное напряжение сети: 220 В


Номинальная частота сети: 50 Гц


Максимальная потребляемая мощность: 30 Вт


IP 20



2. Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский «ТЭМ» РП-40

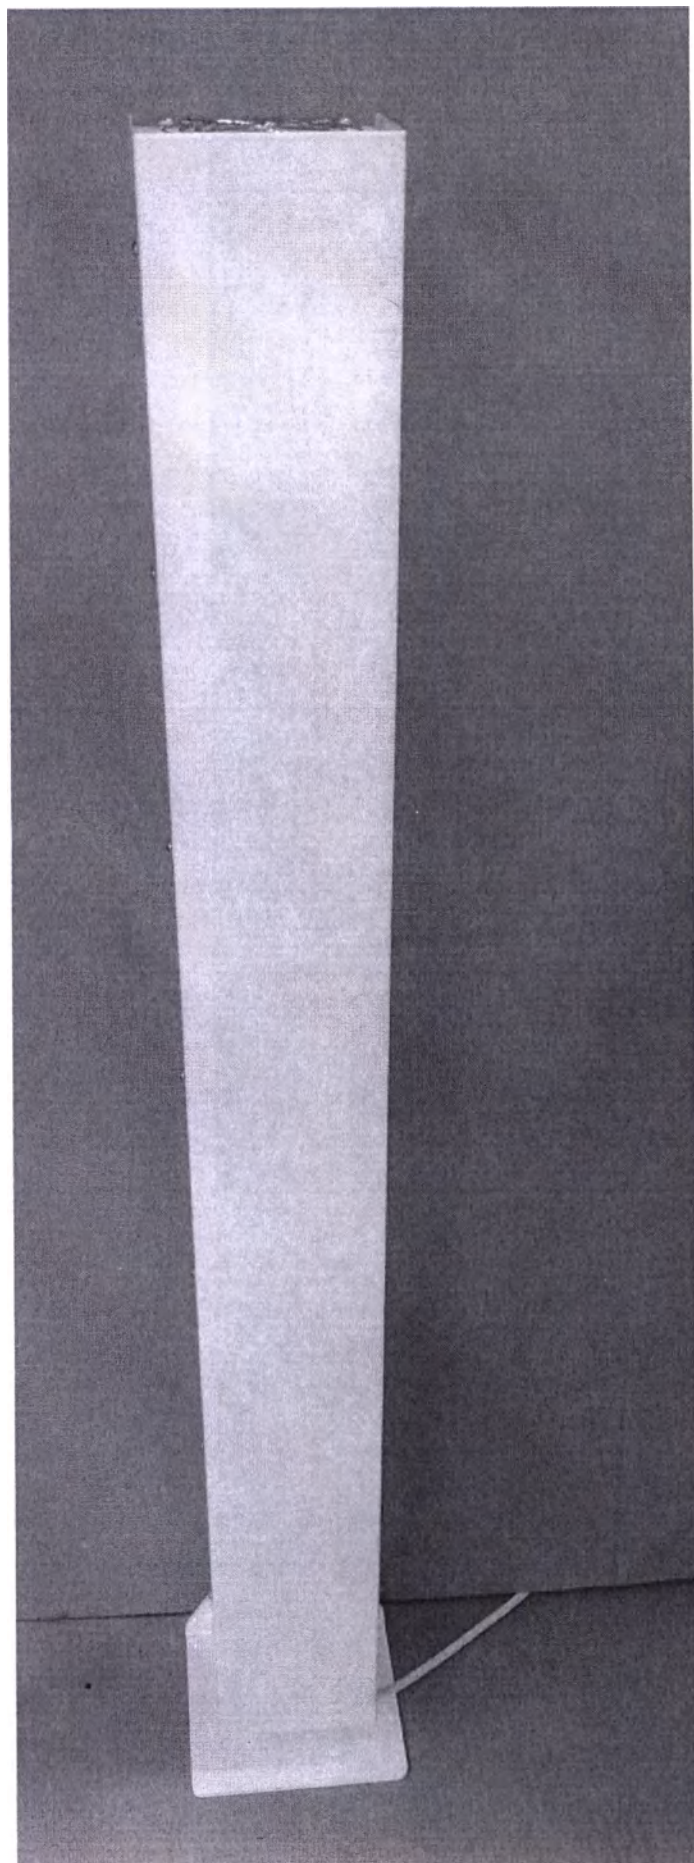

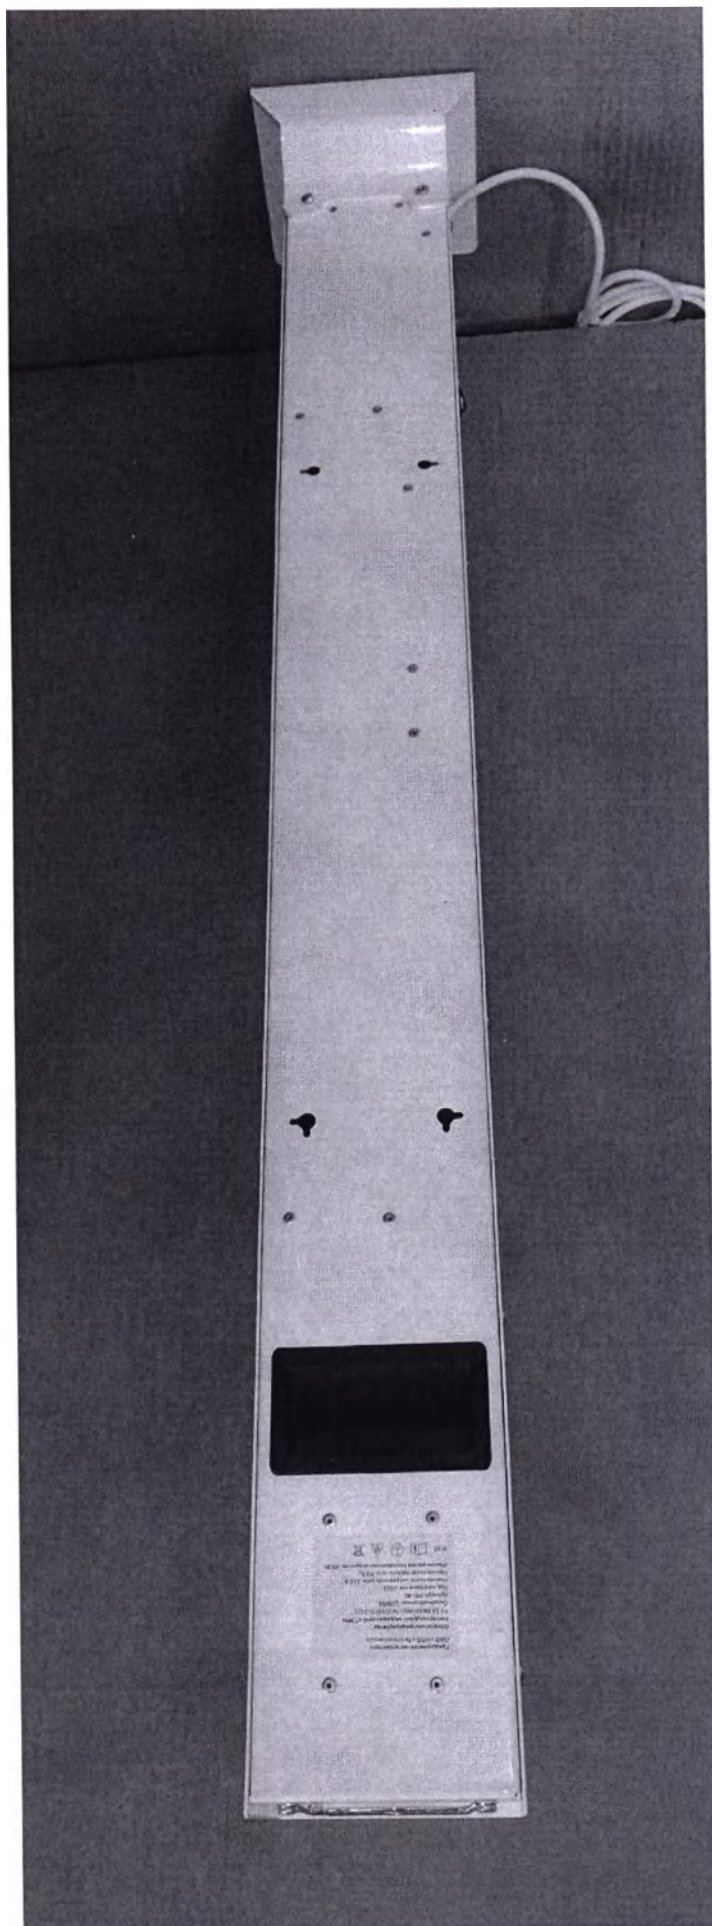


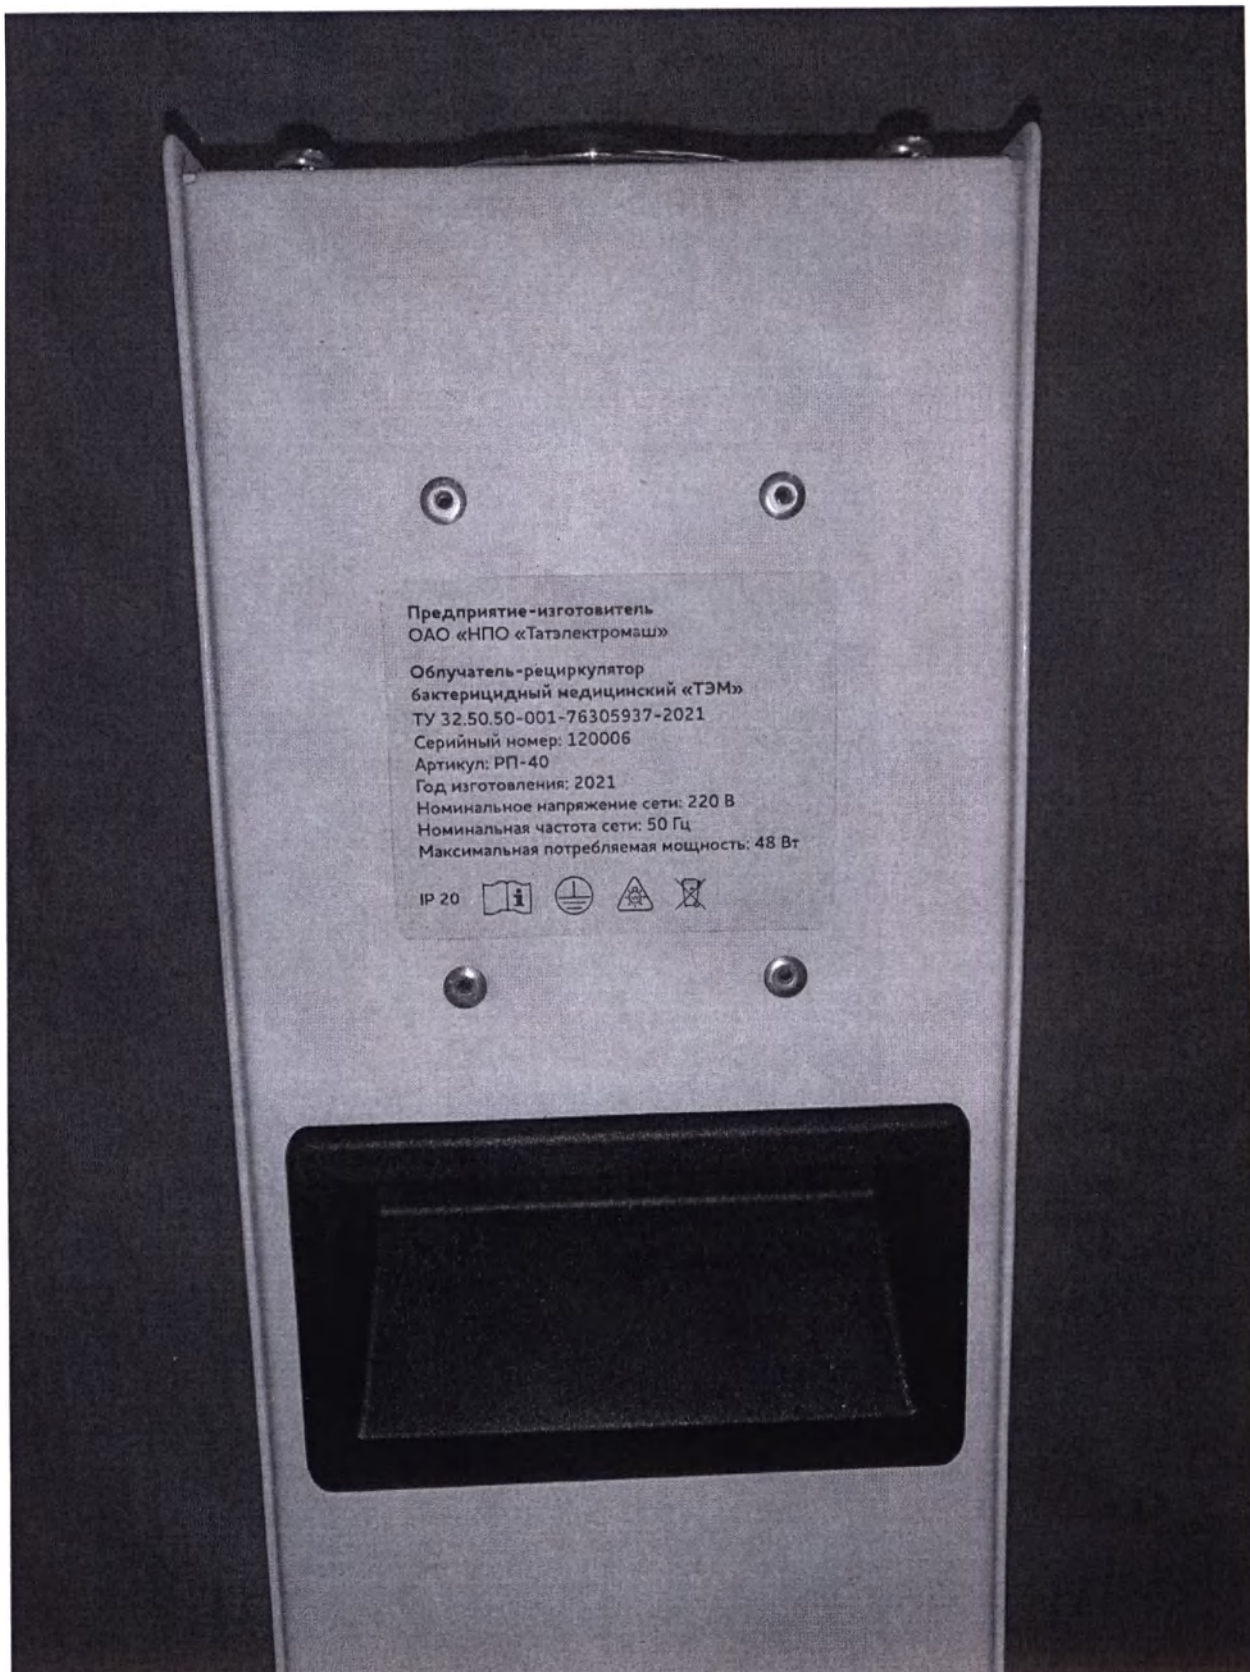



Предприятие-изготовитель
ОАО «НПО «Татэлектромаш»
Облучатель-рециркулятор
бактерицидный медицинский «ТЭМ»
ТУ 32.50.50-001-76305937-2021
Серийный номер: 120006
Артикул: РП-40
Год изготовления: 2021
Номинальное напряжение сети: 220 В
Номинальная частота сети: 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 48 Вт

IP 20    


3. Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский «ТЭМ» РП-60

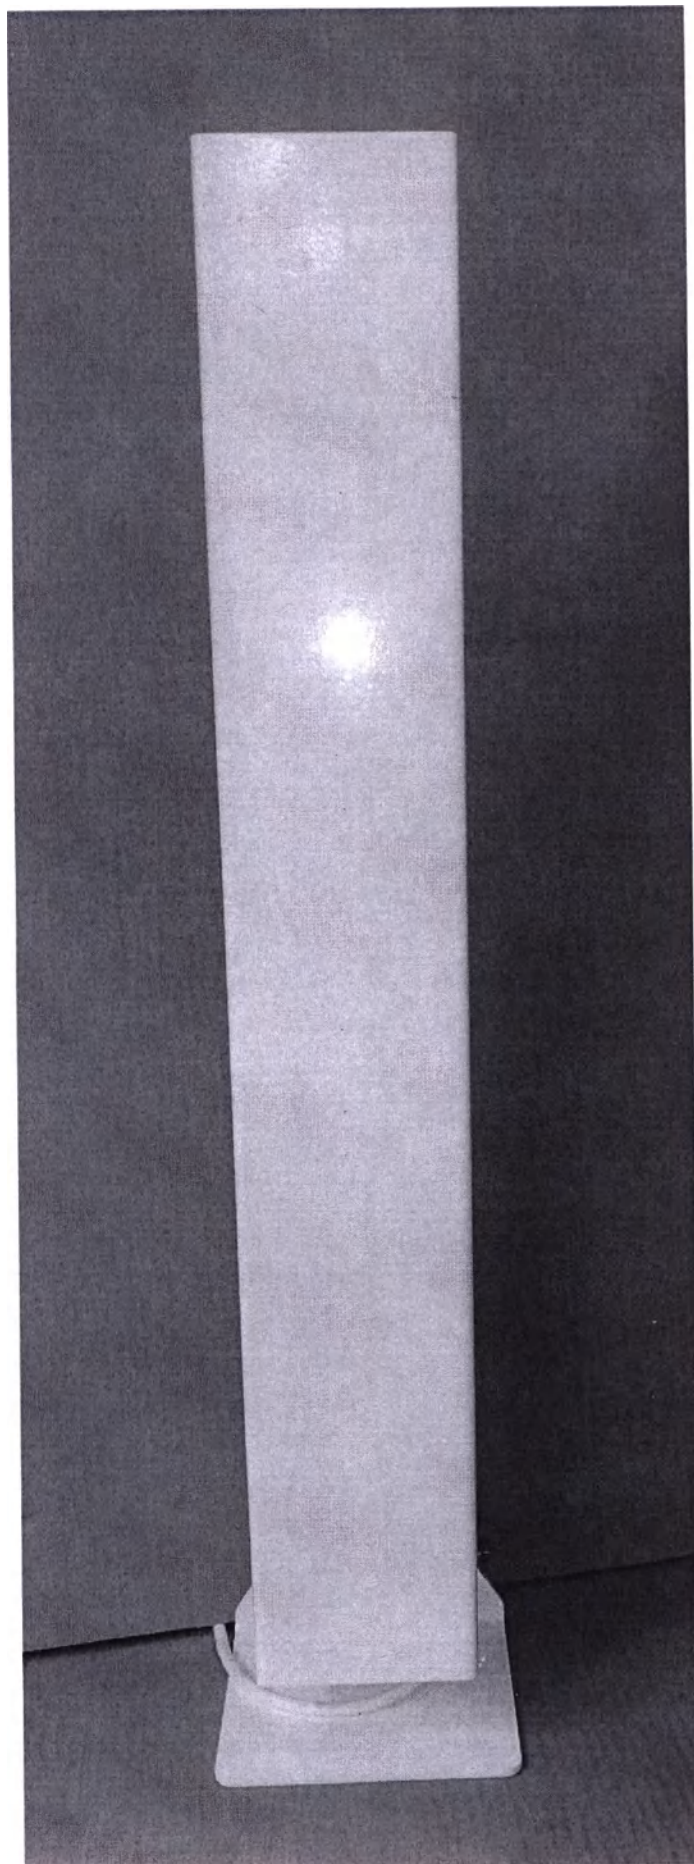


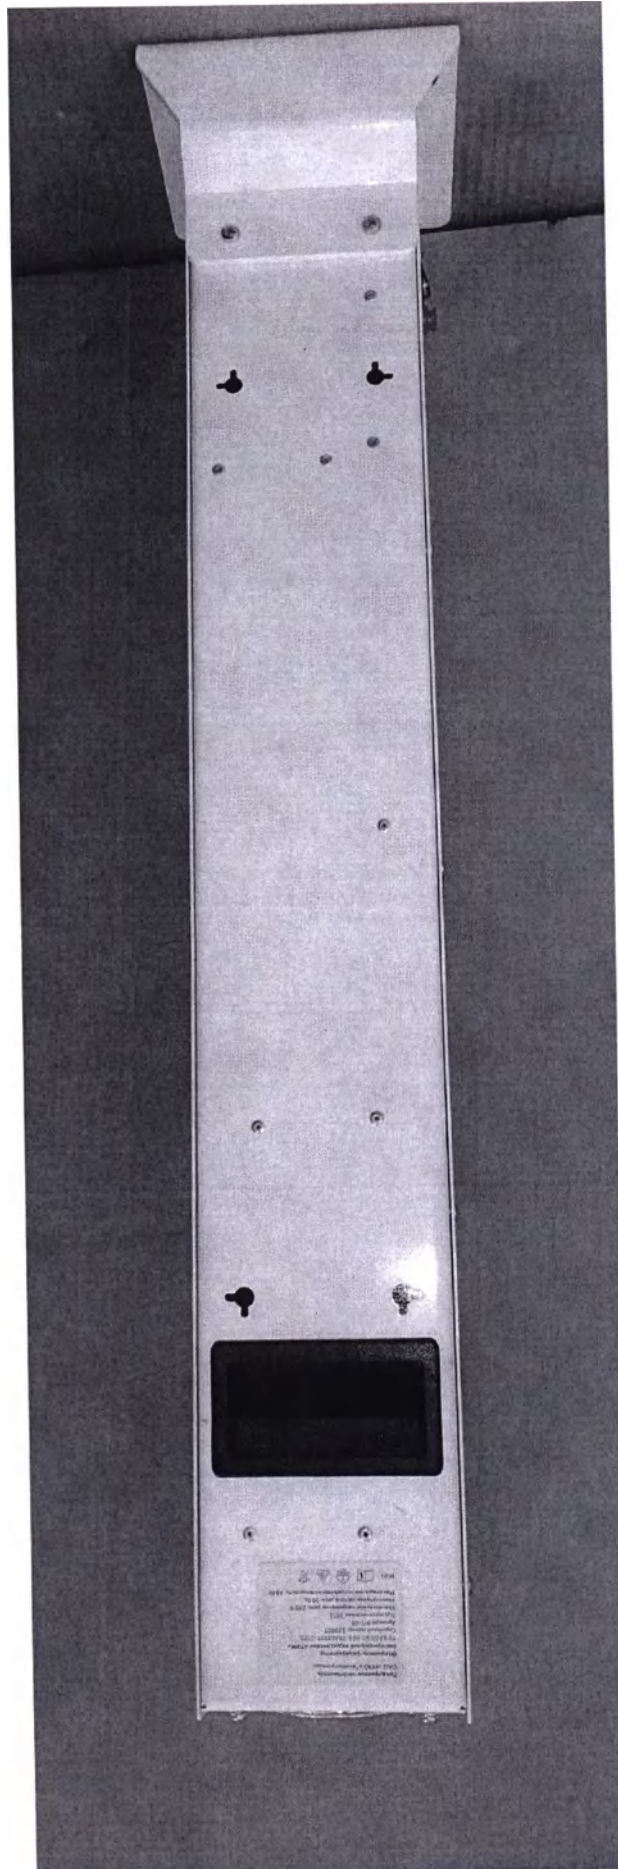


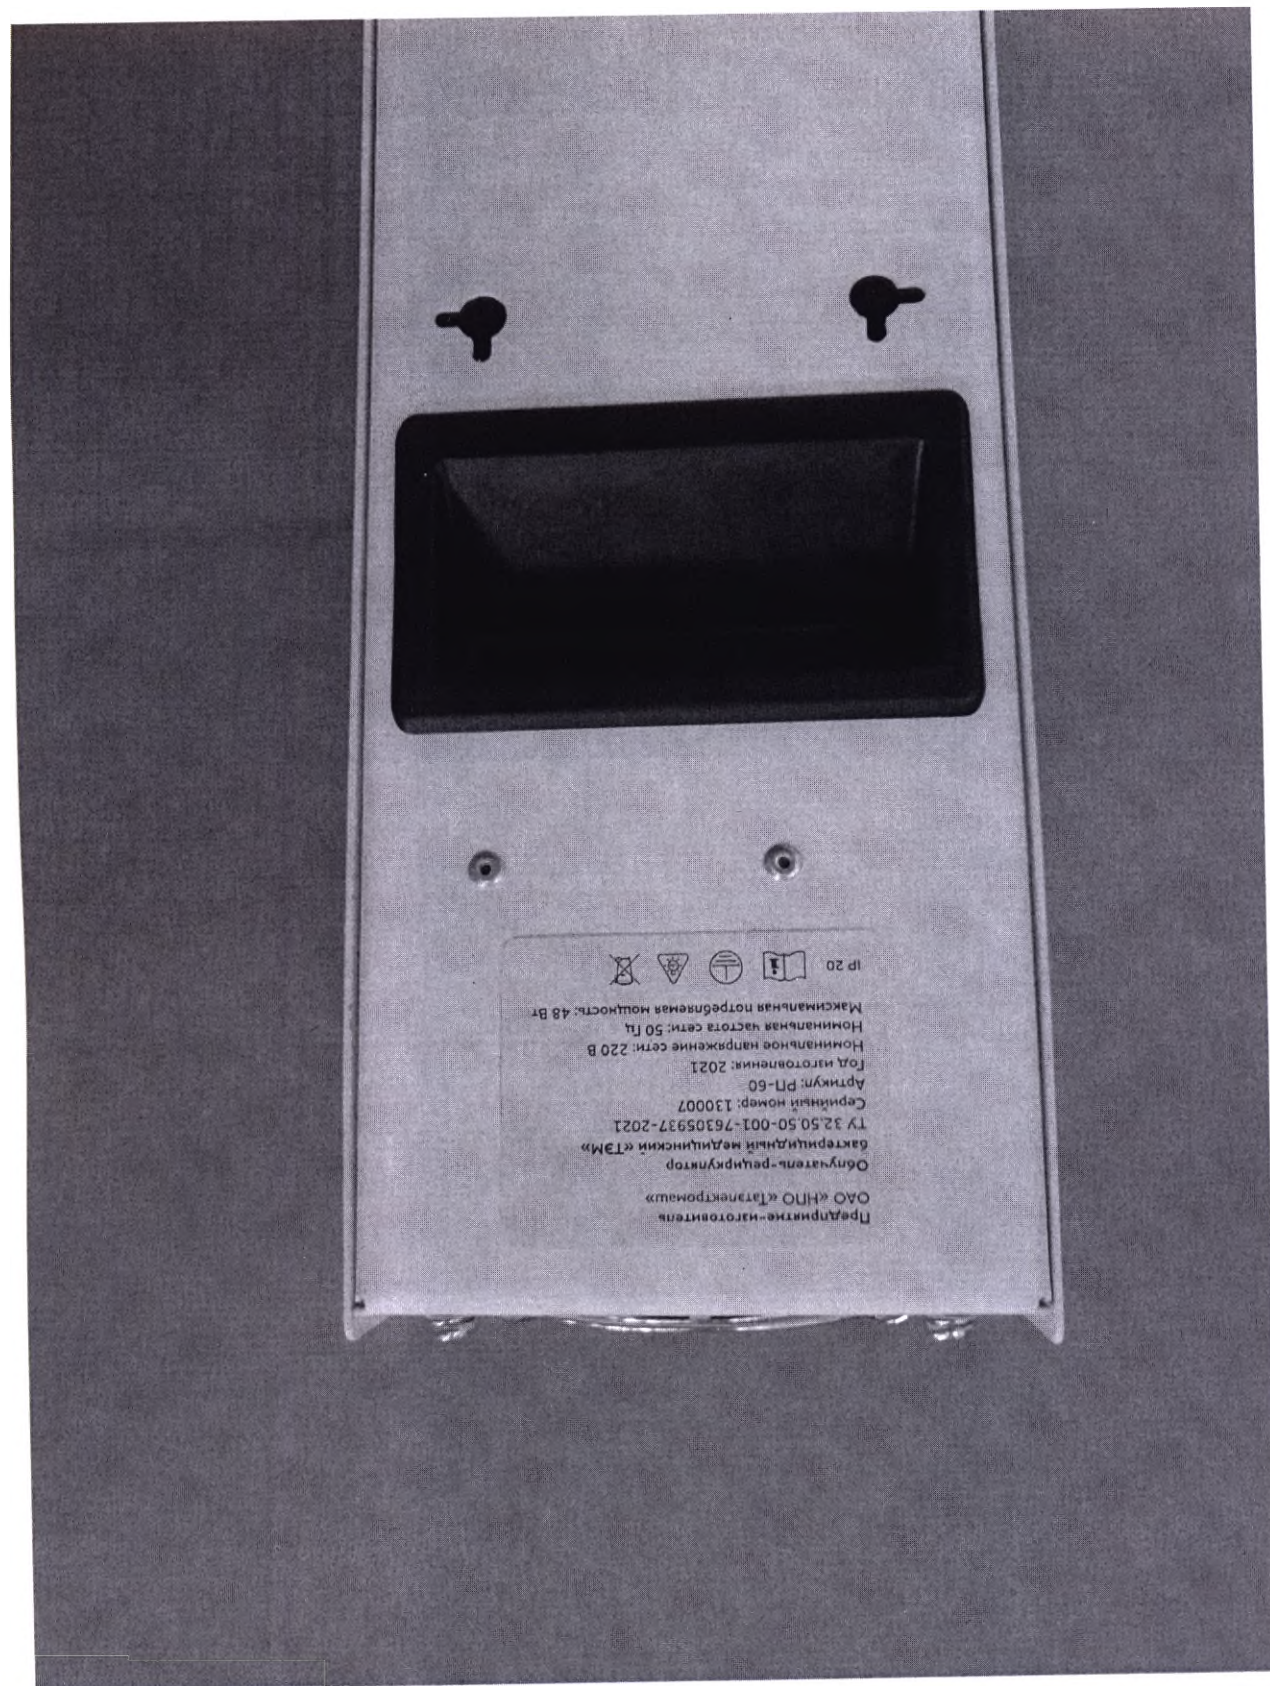


4. Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский «ТЭМ» РП-80


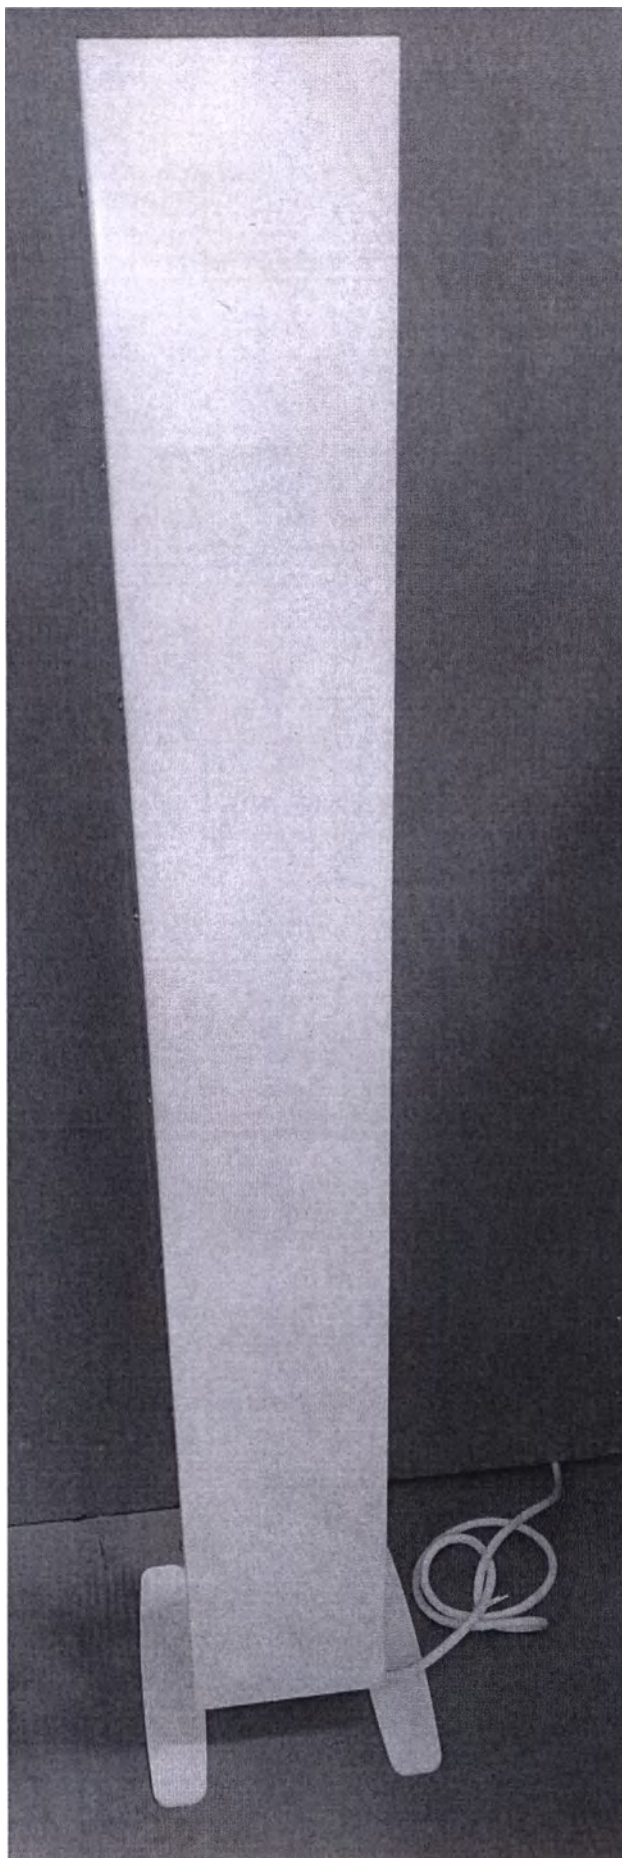


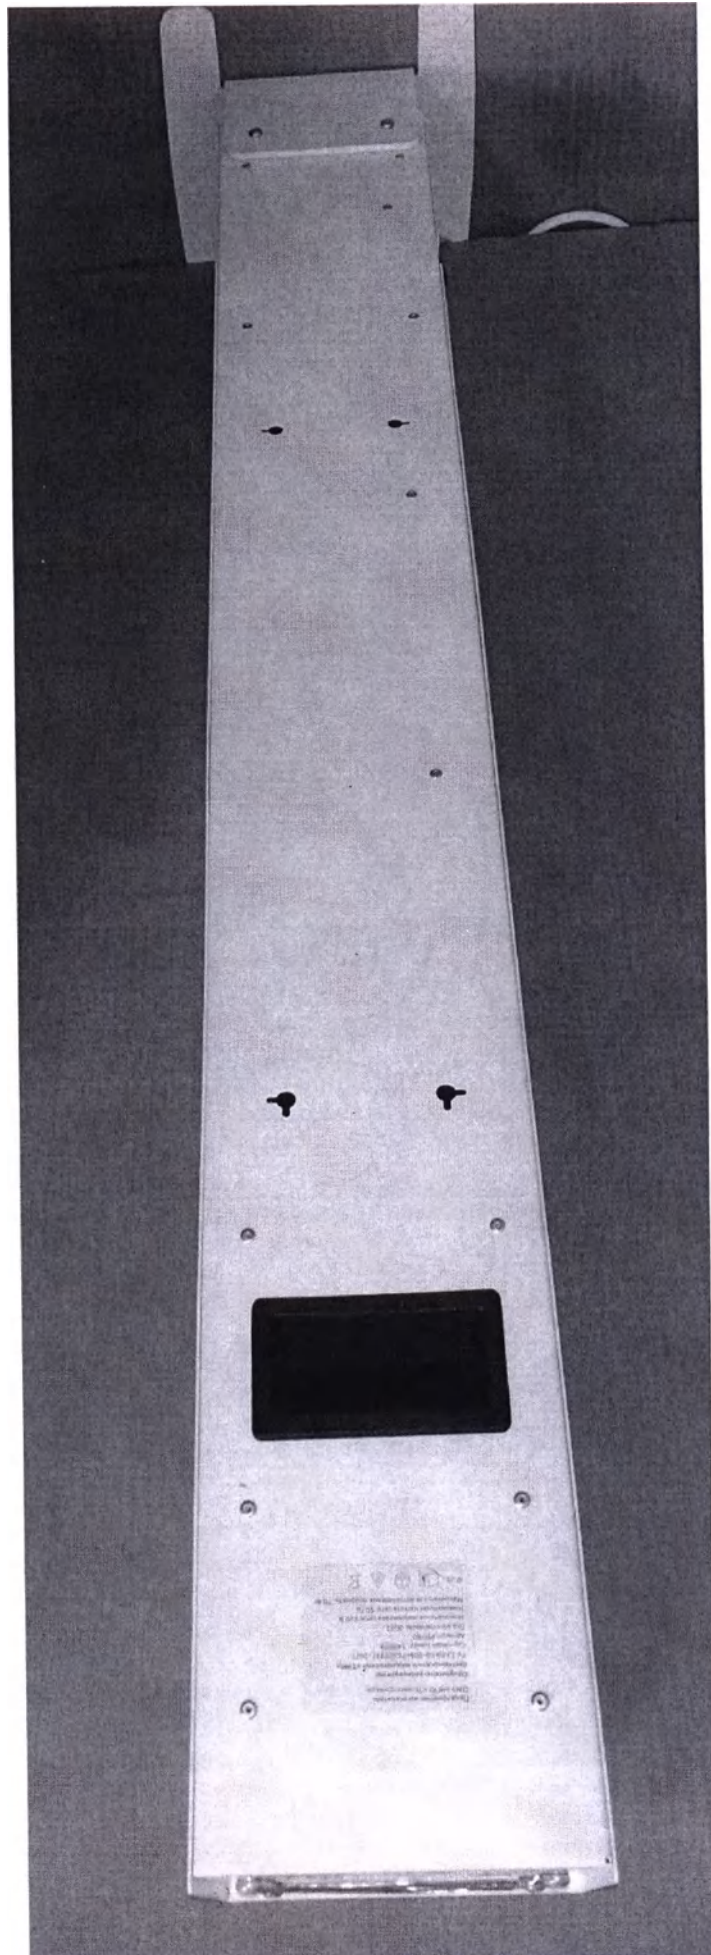

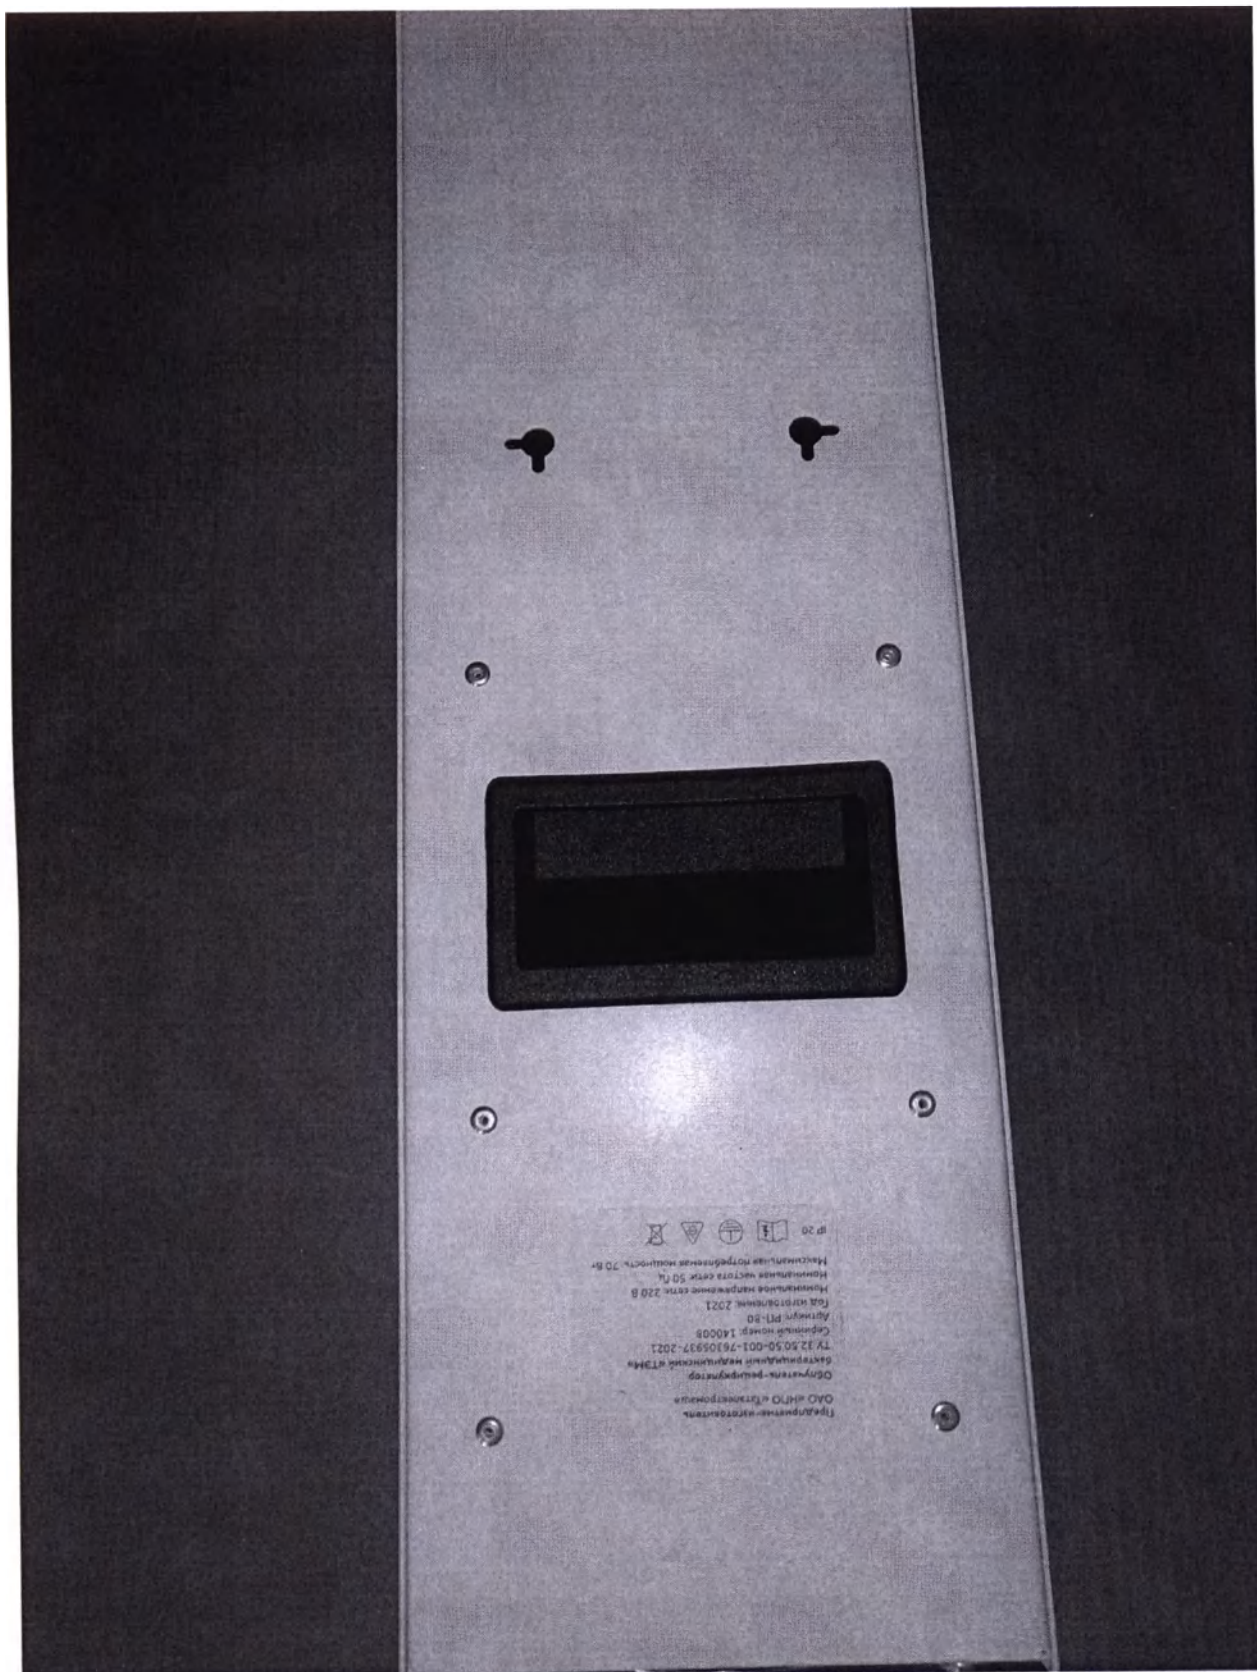



5. Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский «ТЭМ» РП-160

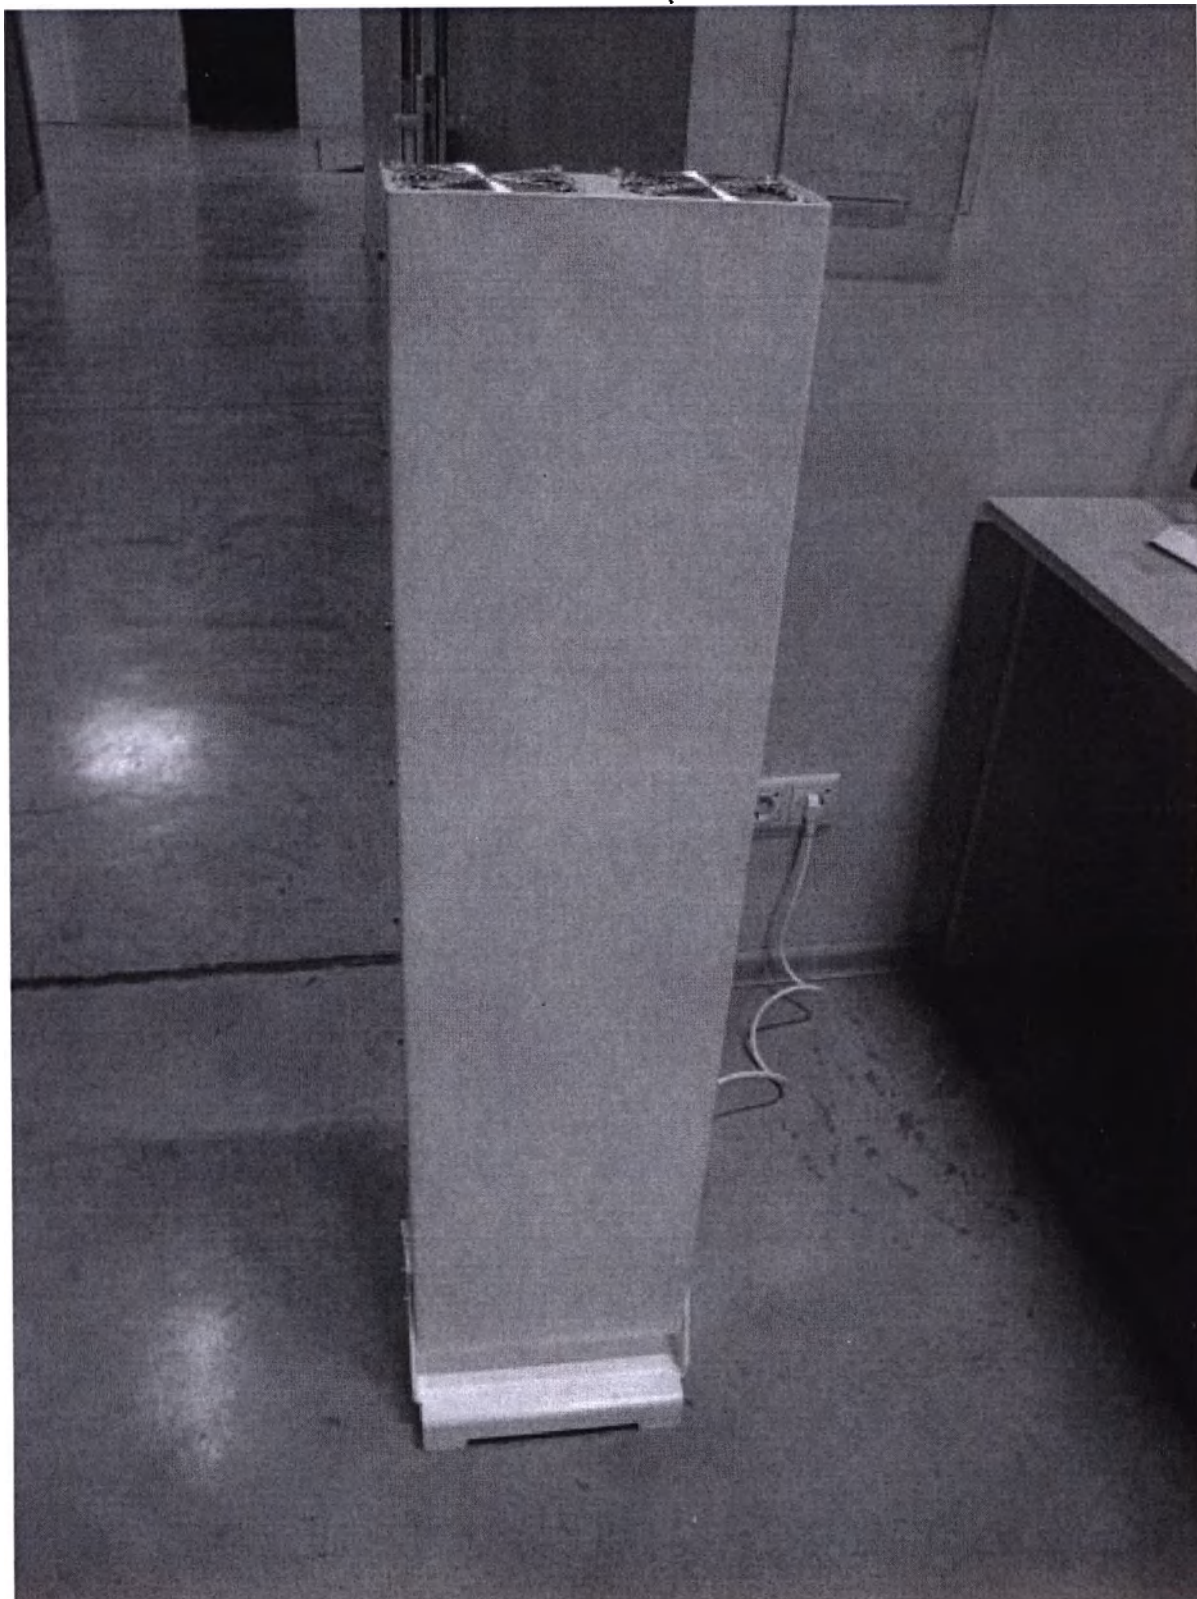

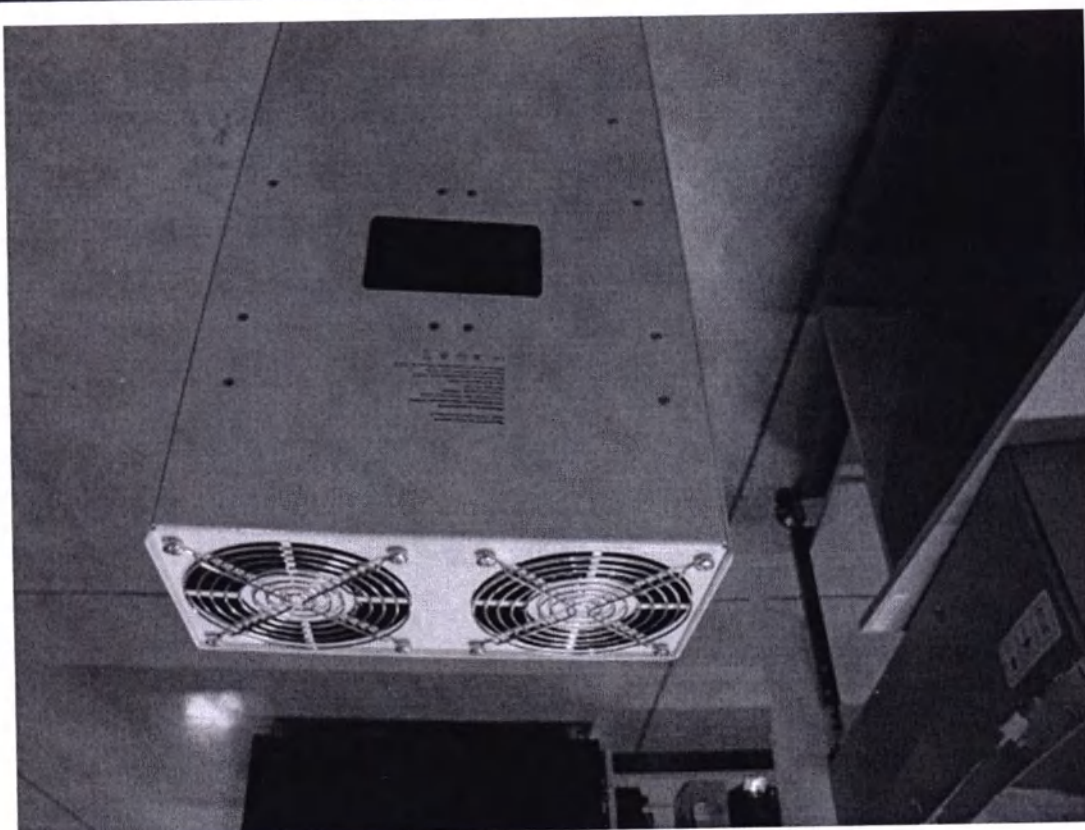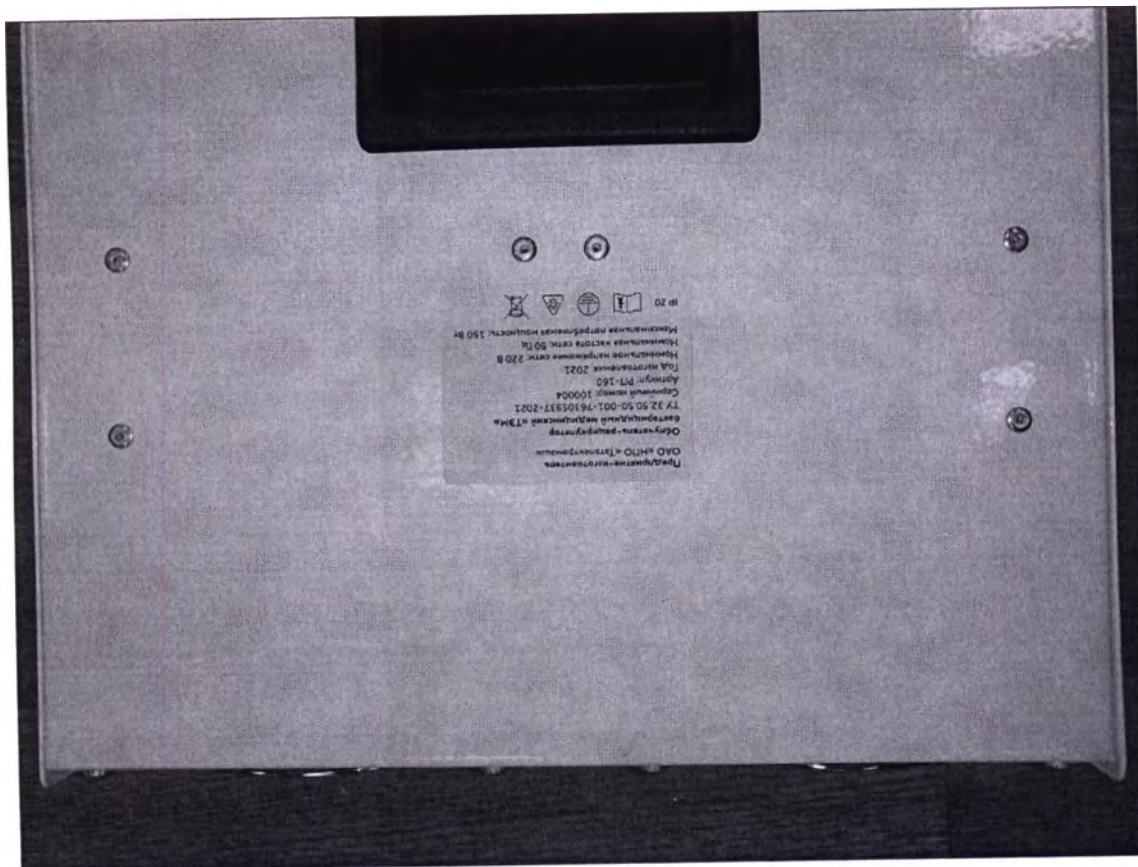


6. Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский «ТЭМ» РВ-30

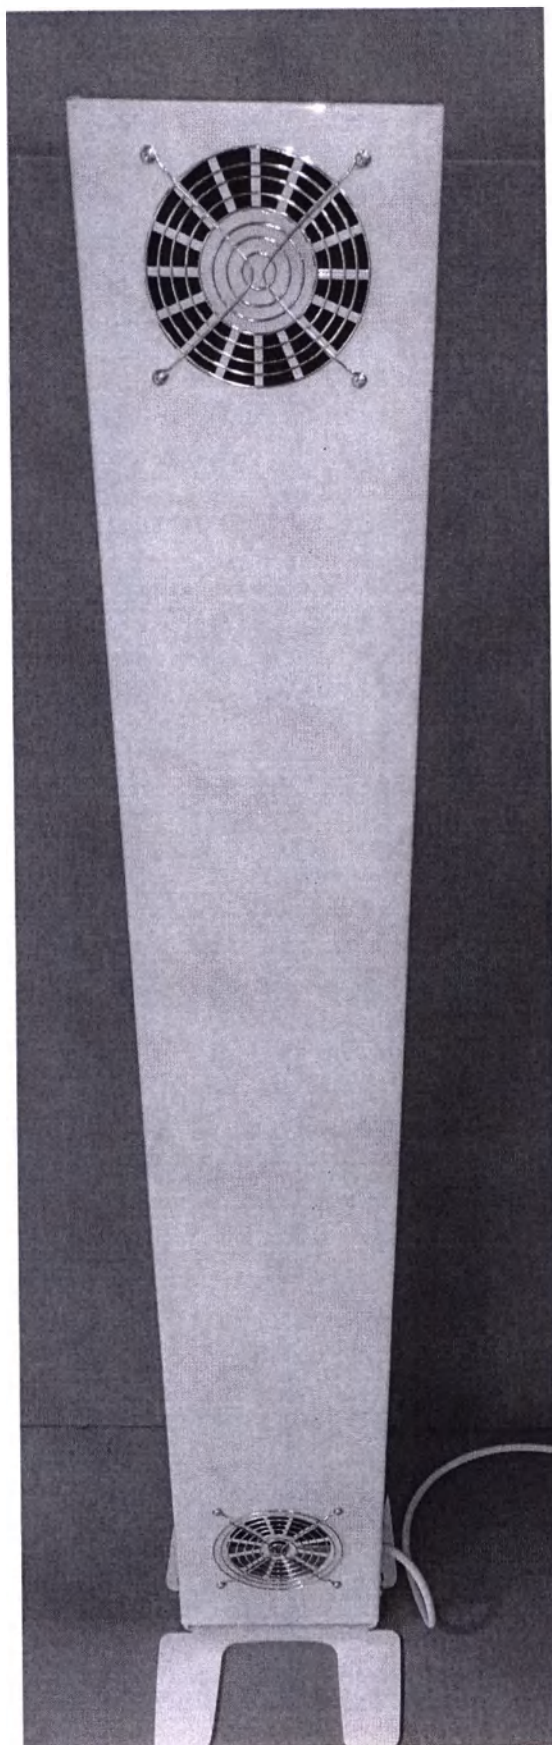


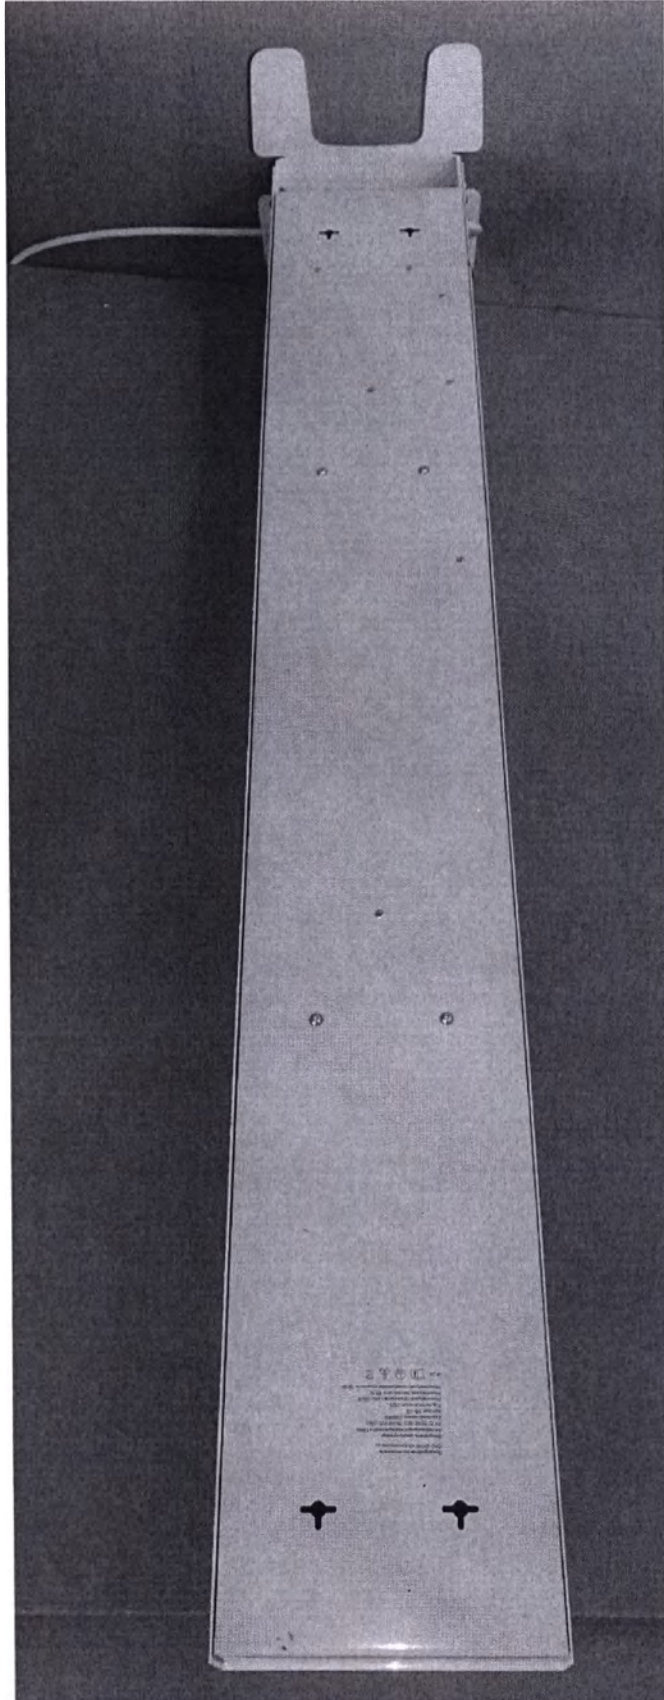



Предприятие-изготовитель
ОАО «НПО «Трансформаш»
Область «Рязань-Рязань»
базовый завод «ТЭМ»
ТВ 32 50 50-001-76305937-2021
Серийный номер: 150009
Артикул: РБ-30
Год изготовления: 2021
Номинальное напряжение сети: 220 В
Номинальная частота сети: 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 30 Вт
IP 20




7. Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский «ТЭМ» РВ-40

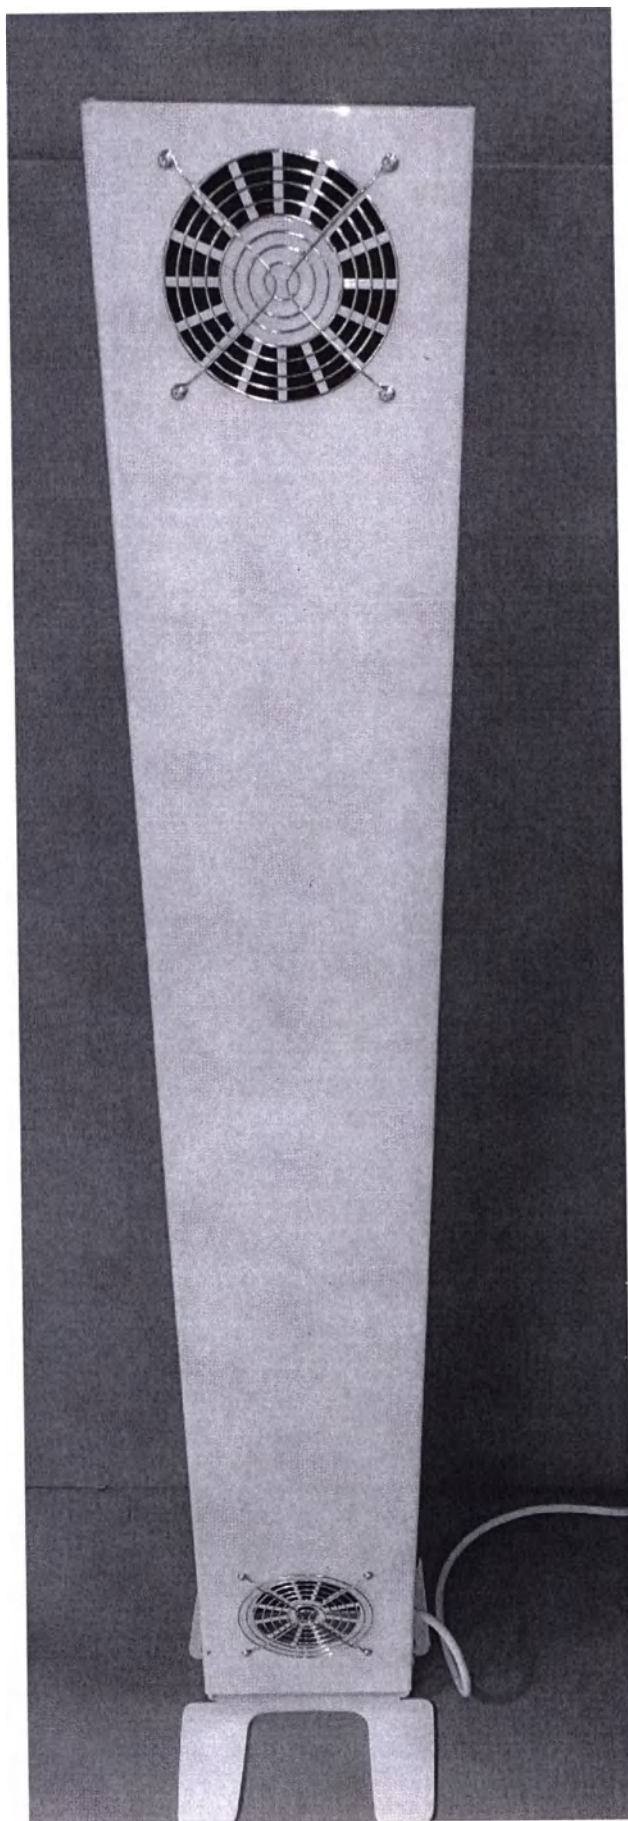


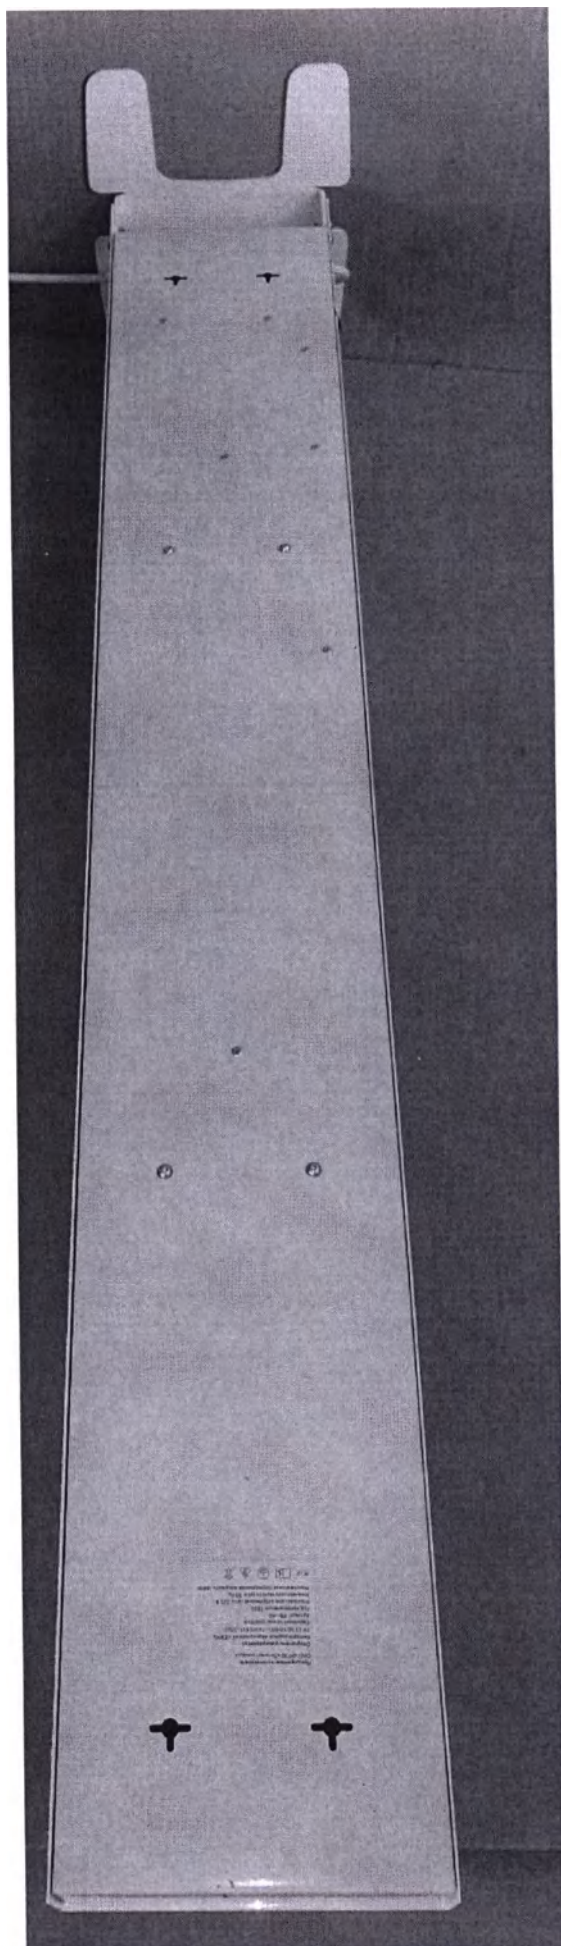


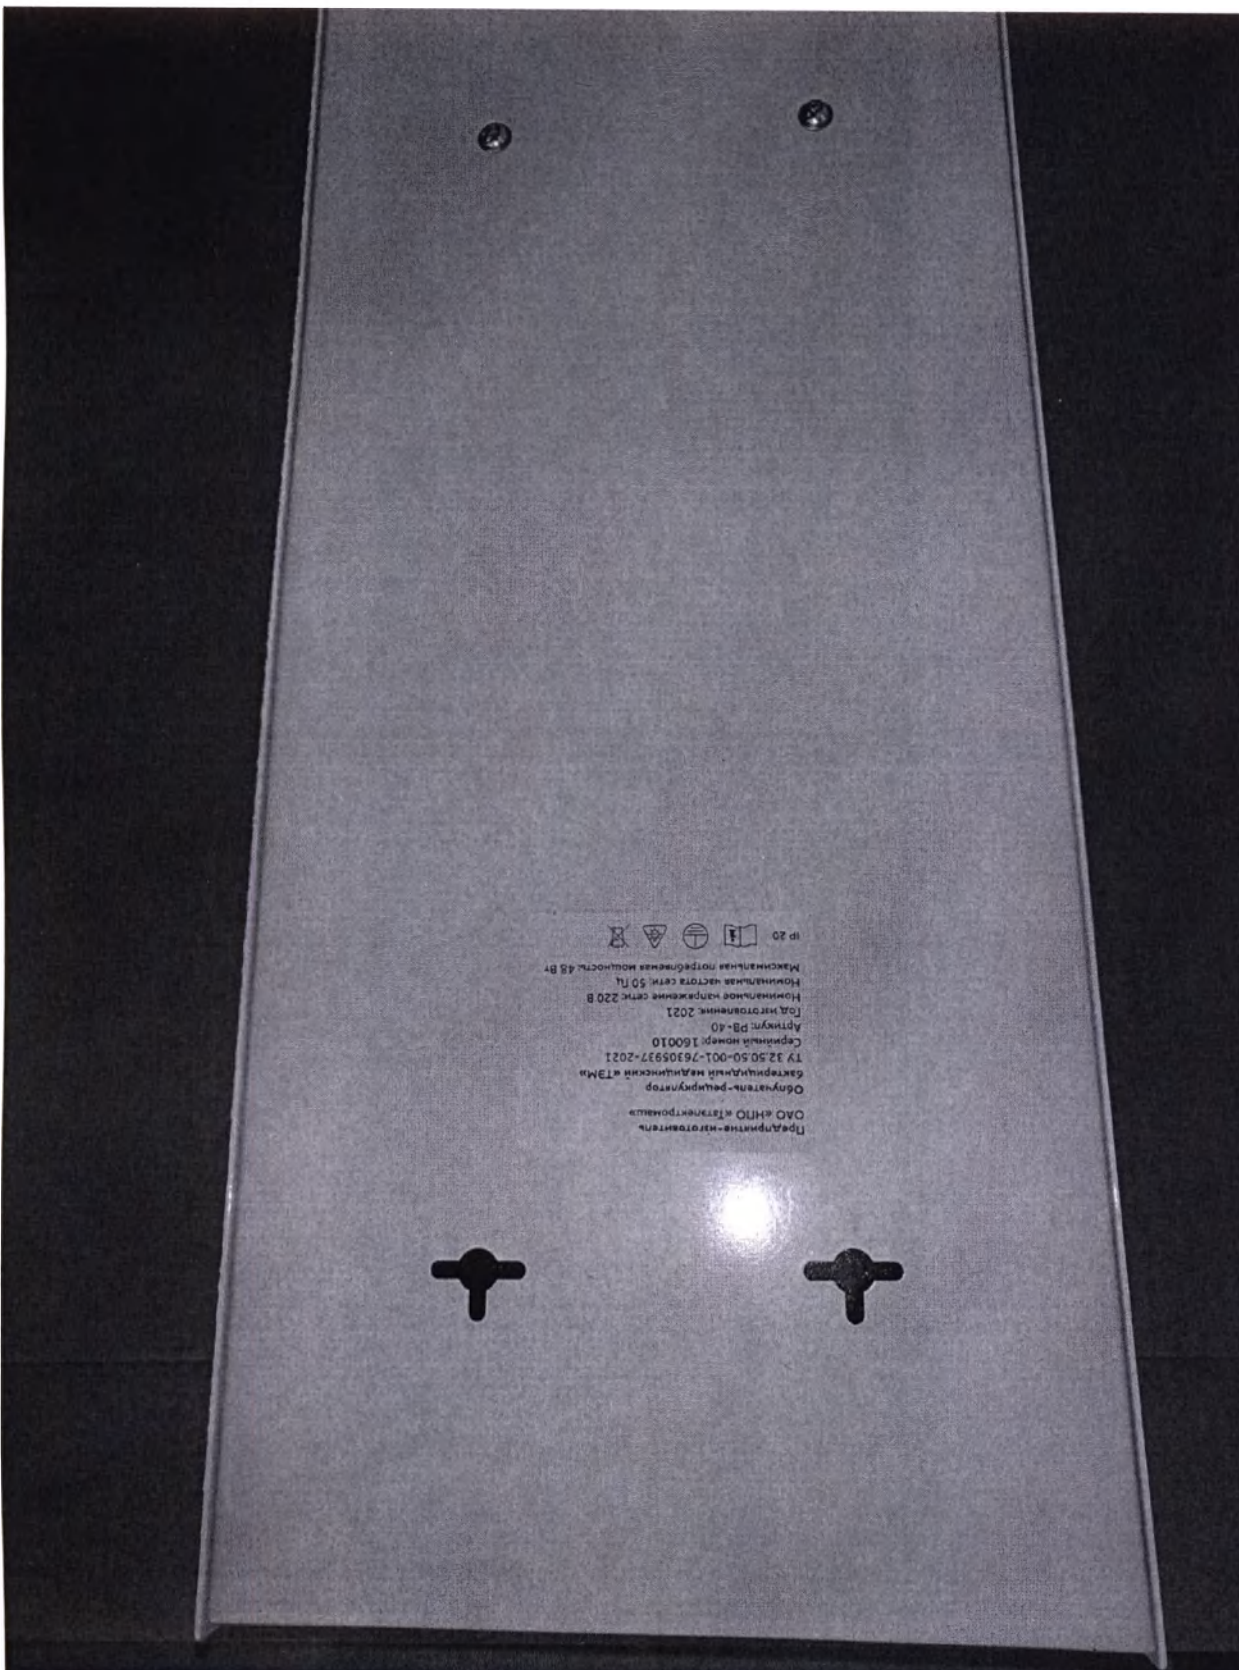

8. Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский «ТЭМ» РВ-80

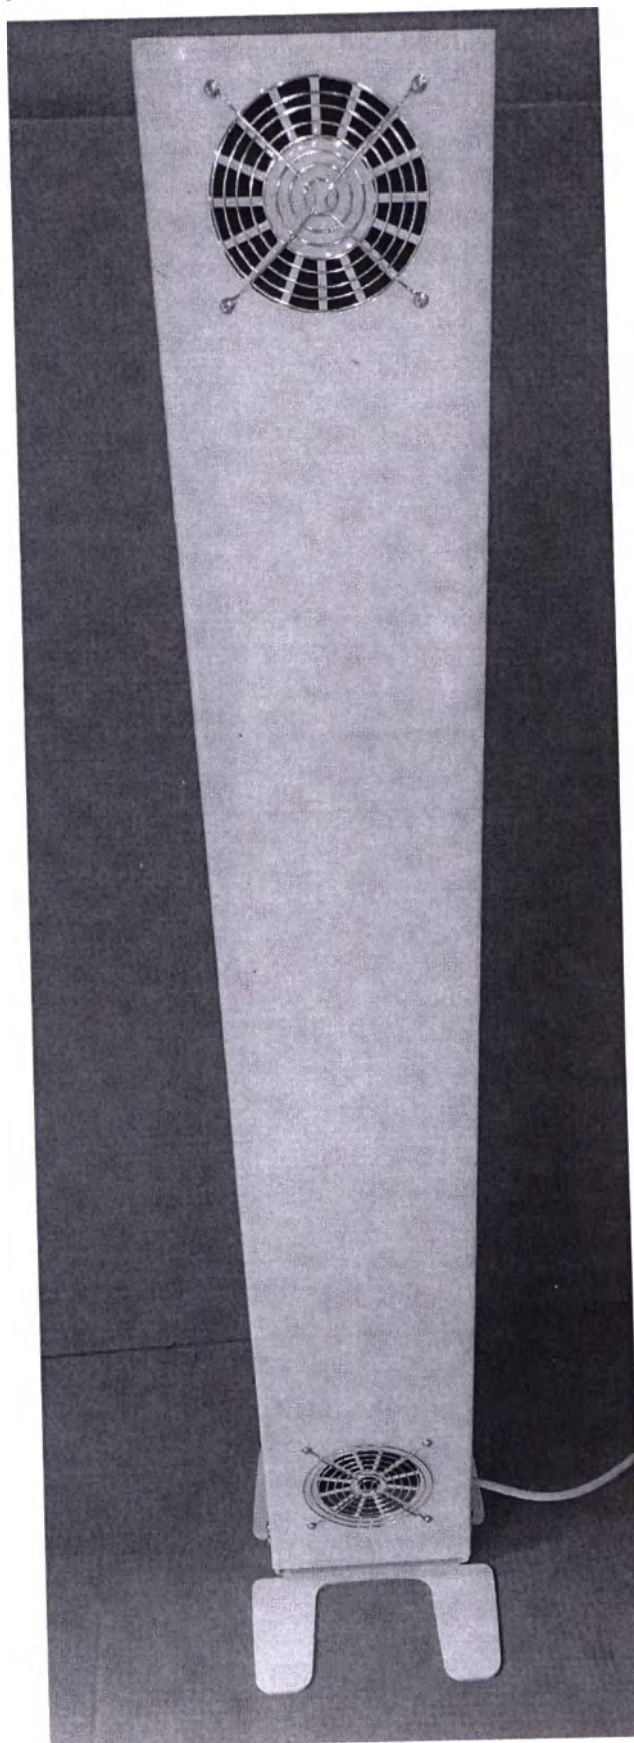

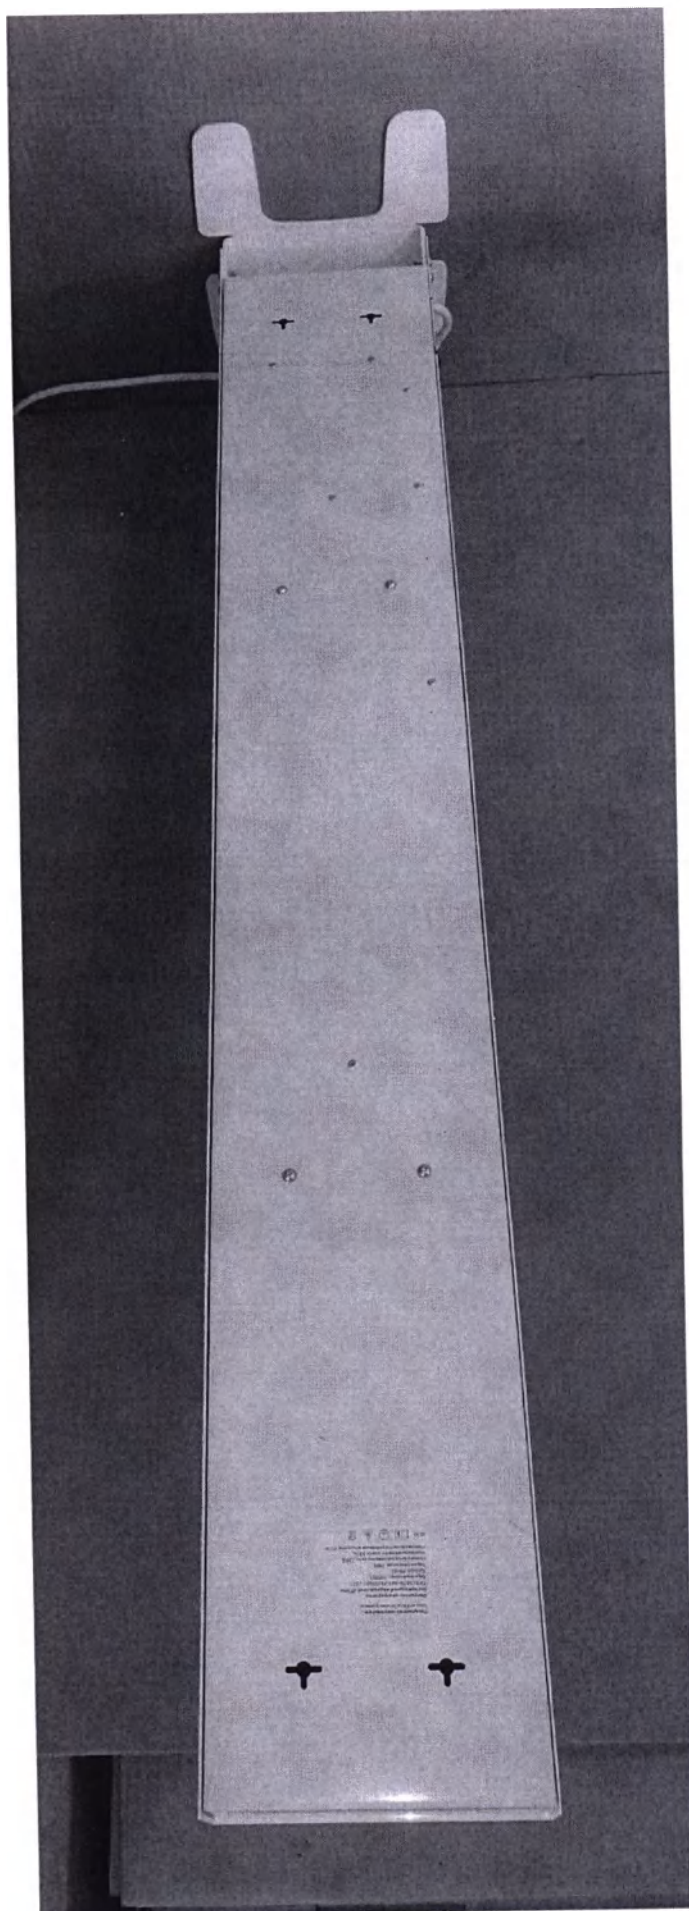

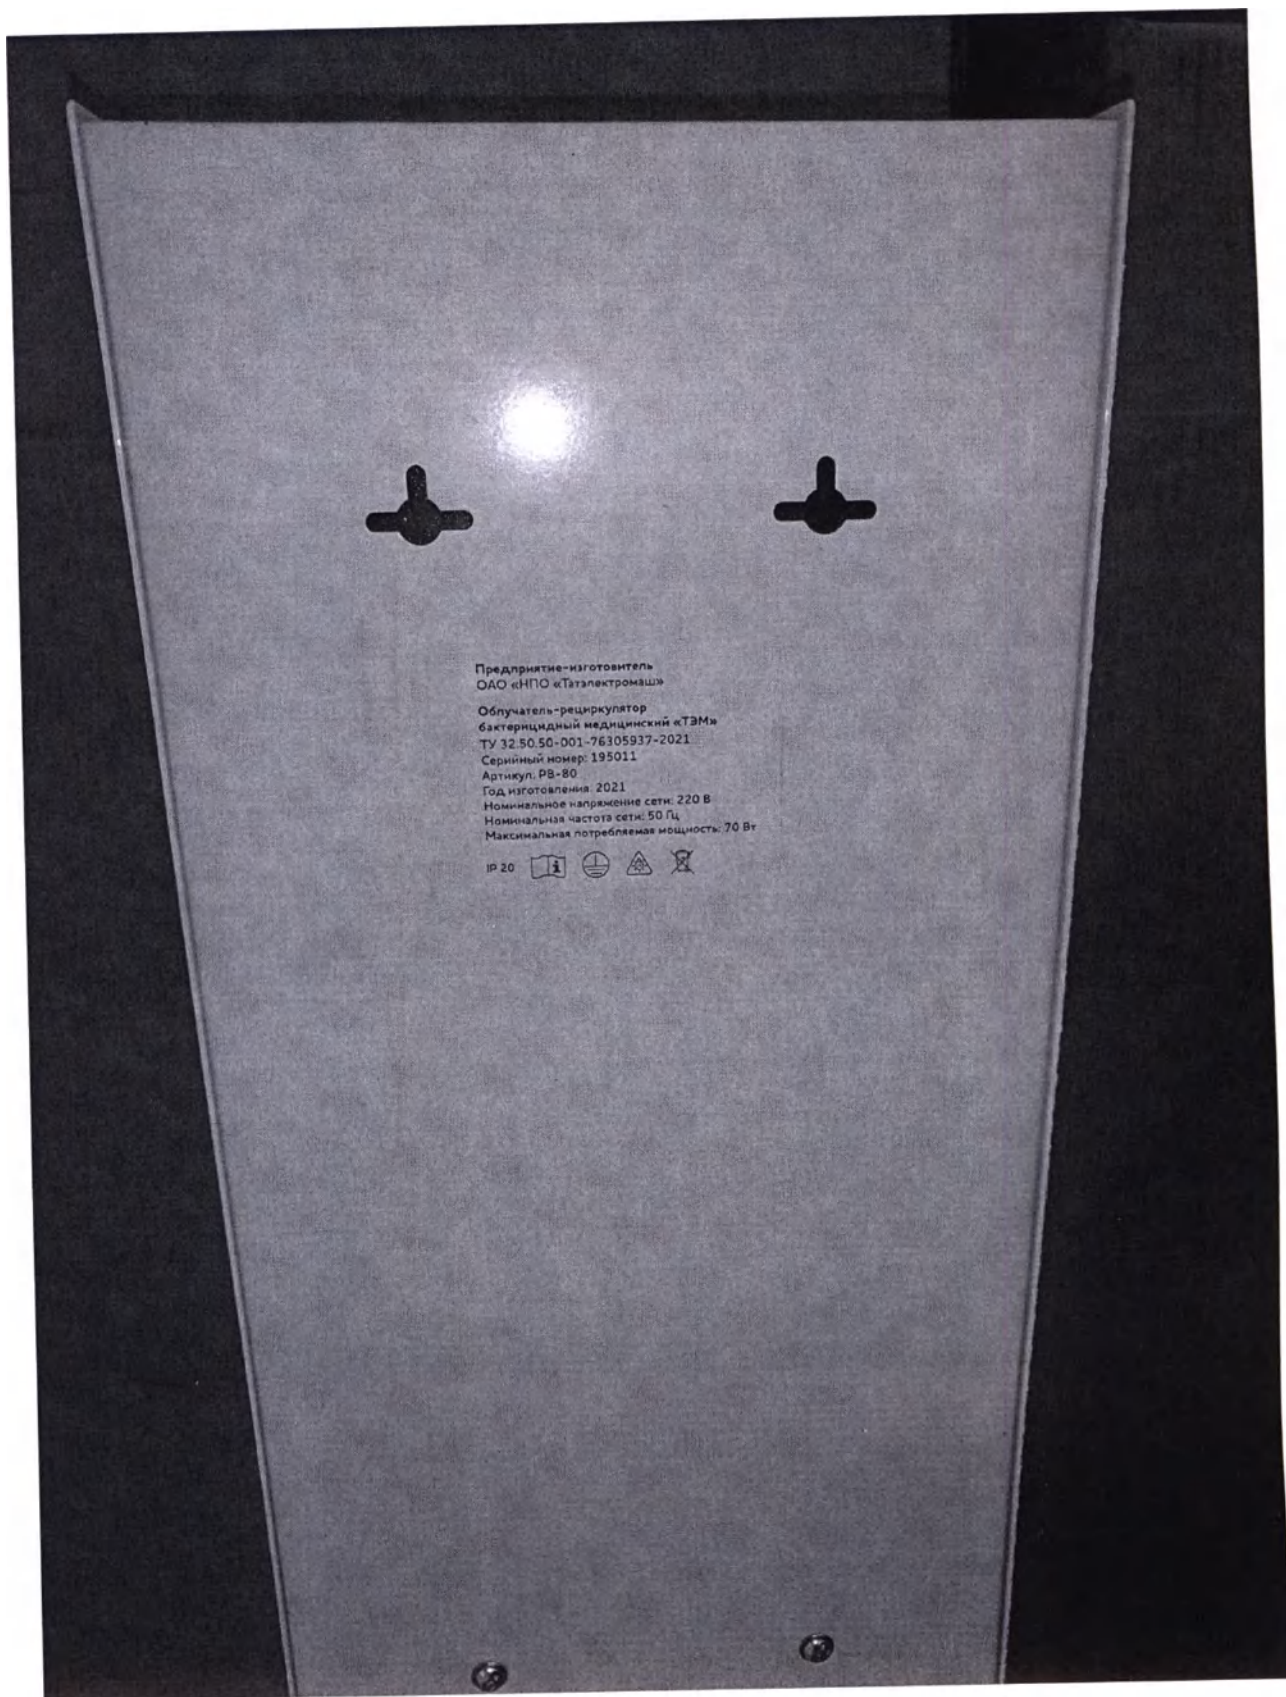



Предприятие-изготовитель
ОАО «НПО «Татэлектромаш»

Облучатель-рециркулятор
бактерицидный медицинский «ТЭМ»
ТУ 32.50.50-001-76305937-2021
Серийный номер: 195011
Артикул: РВ-80
Год изготовления: 2021
Номинальное напряжение сети: 220 В
Номинальная частота сети: 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 70 Вт

IP 20    

9. Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский «ТЭМ» РВ-100

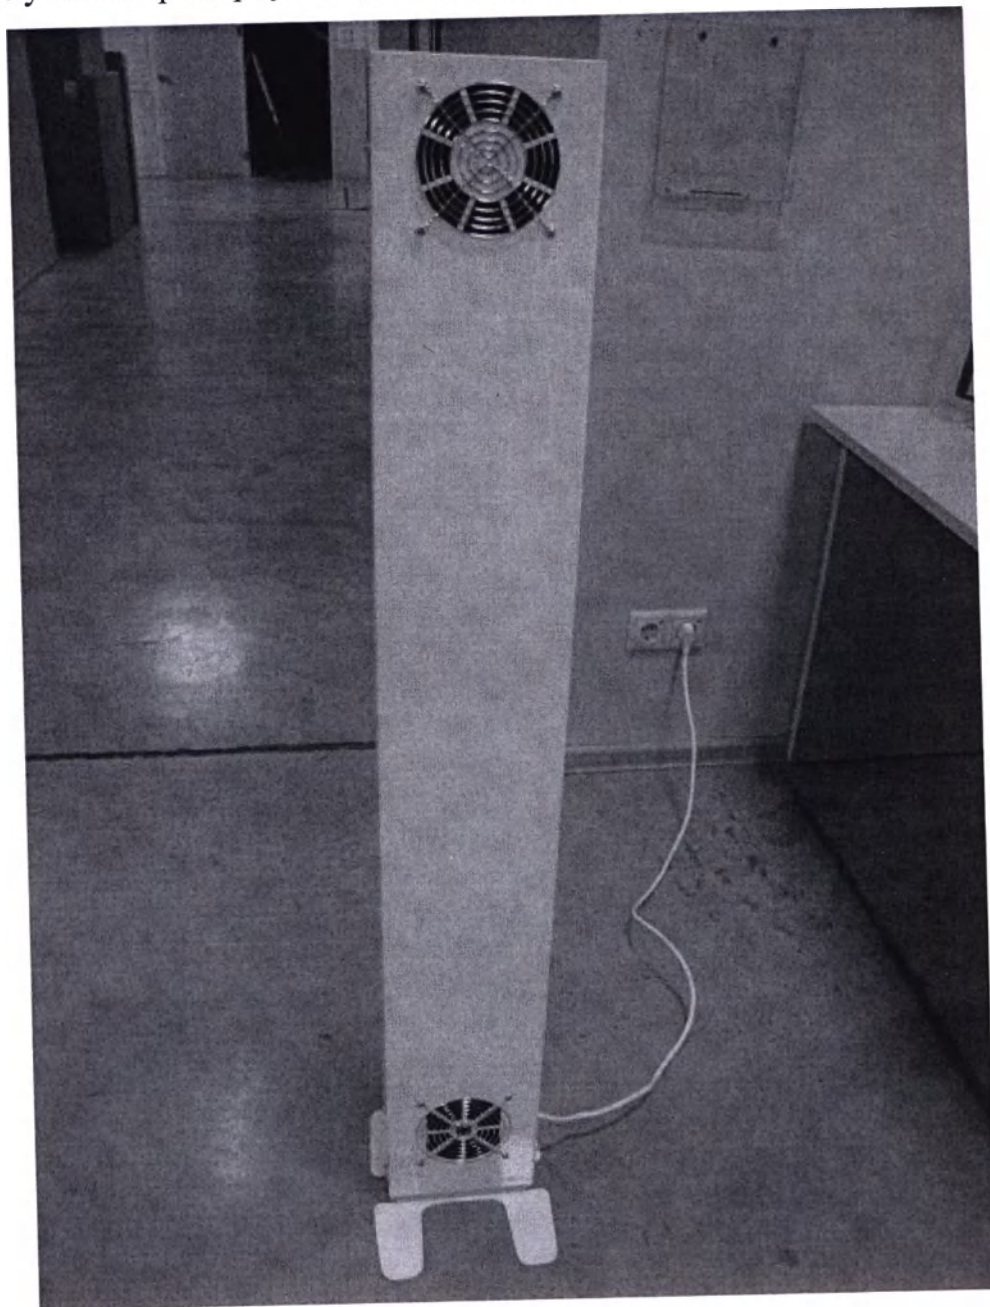


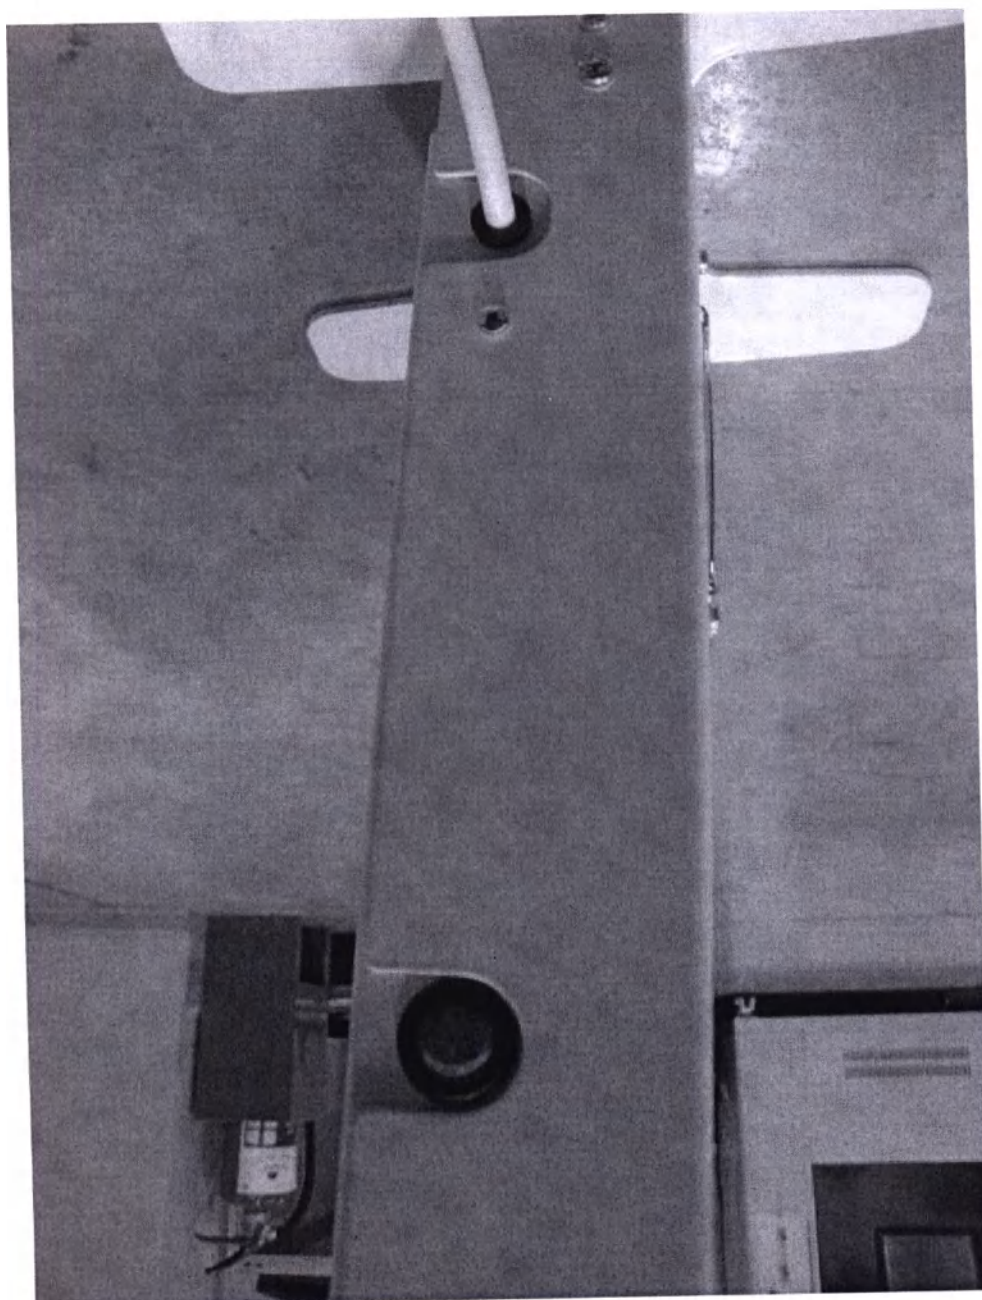


Предприятие-изготовитель
 ОАО «НПО «Татэлектромаш»
 Общественно-патриотический
 бактерицидный медиканский «ТМ»
 ТУ 32.50.50-001-76305937-2021
 Серийный номер: 100003
 Артикул: Р8-100
 Год изготовления: 2021
 Номинальное напряжение сети: 220 В
 Номинальная частота сети: 50 Гц
 Максимальная потребляемая мощность: 100 Вт




10. Передвижная стойка – принадлежность при необходимости

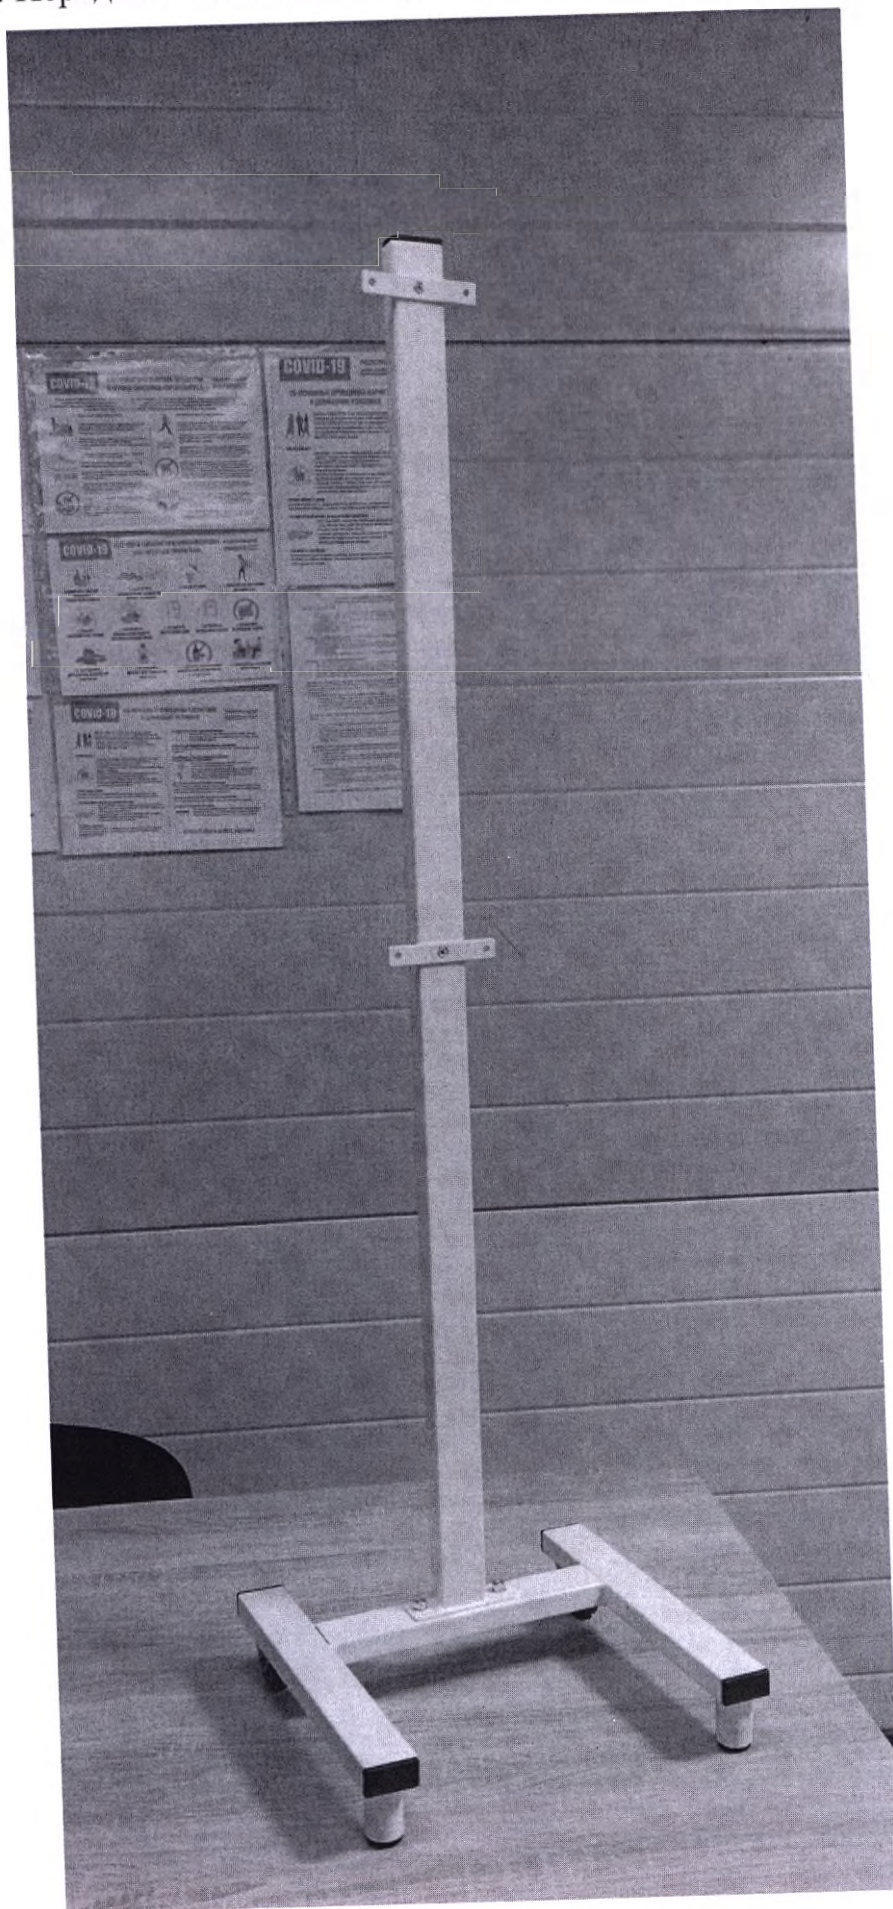


11. Мобильная опора для облучателя серии РВ- принадлежность при необходимости

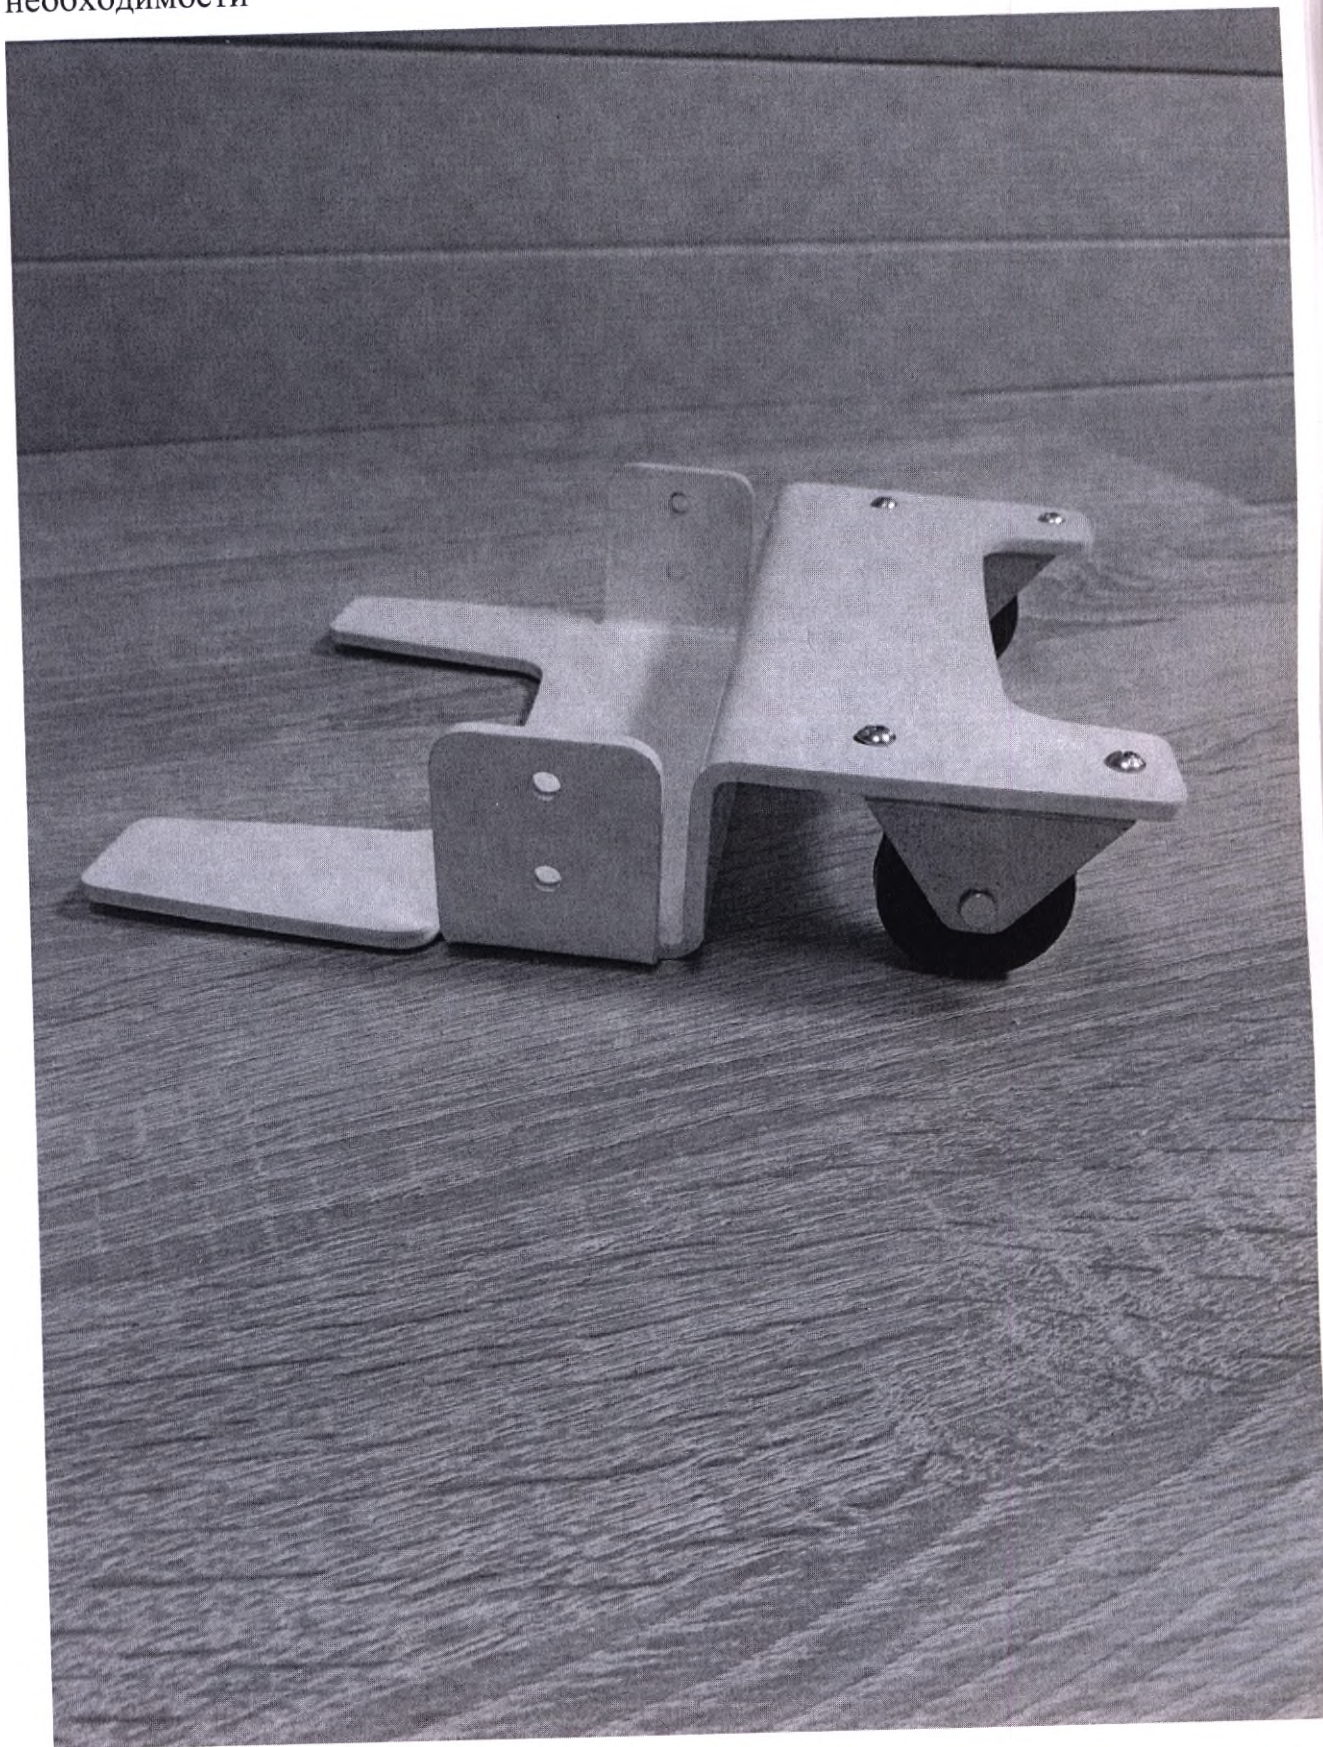


12. Ручка для облучателя серии РВ – принадлежность при необходимости

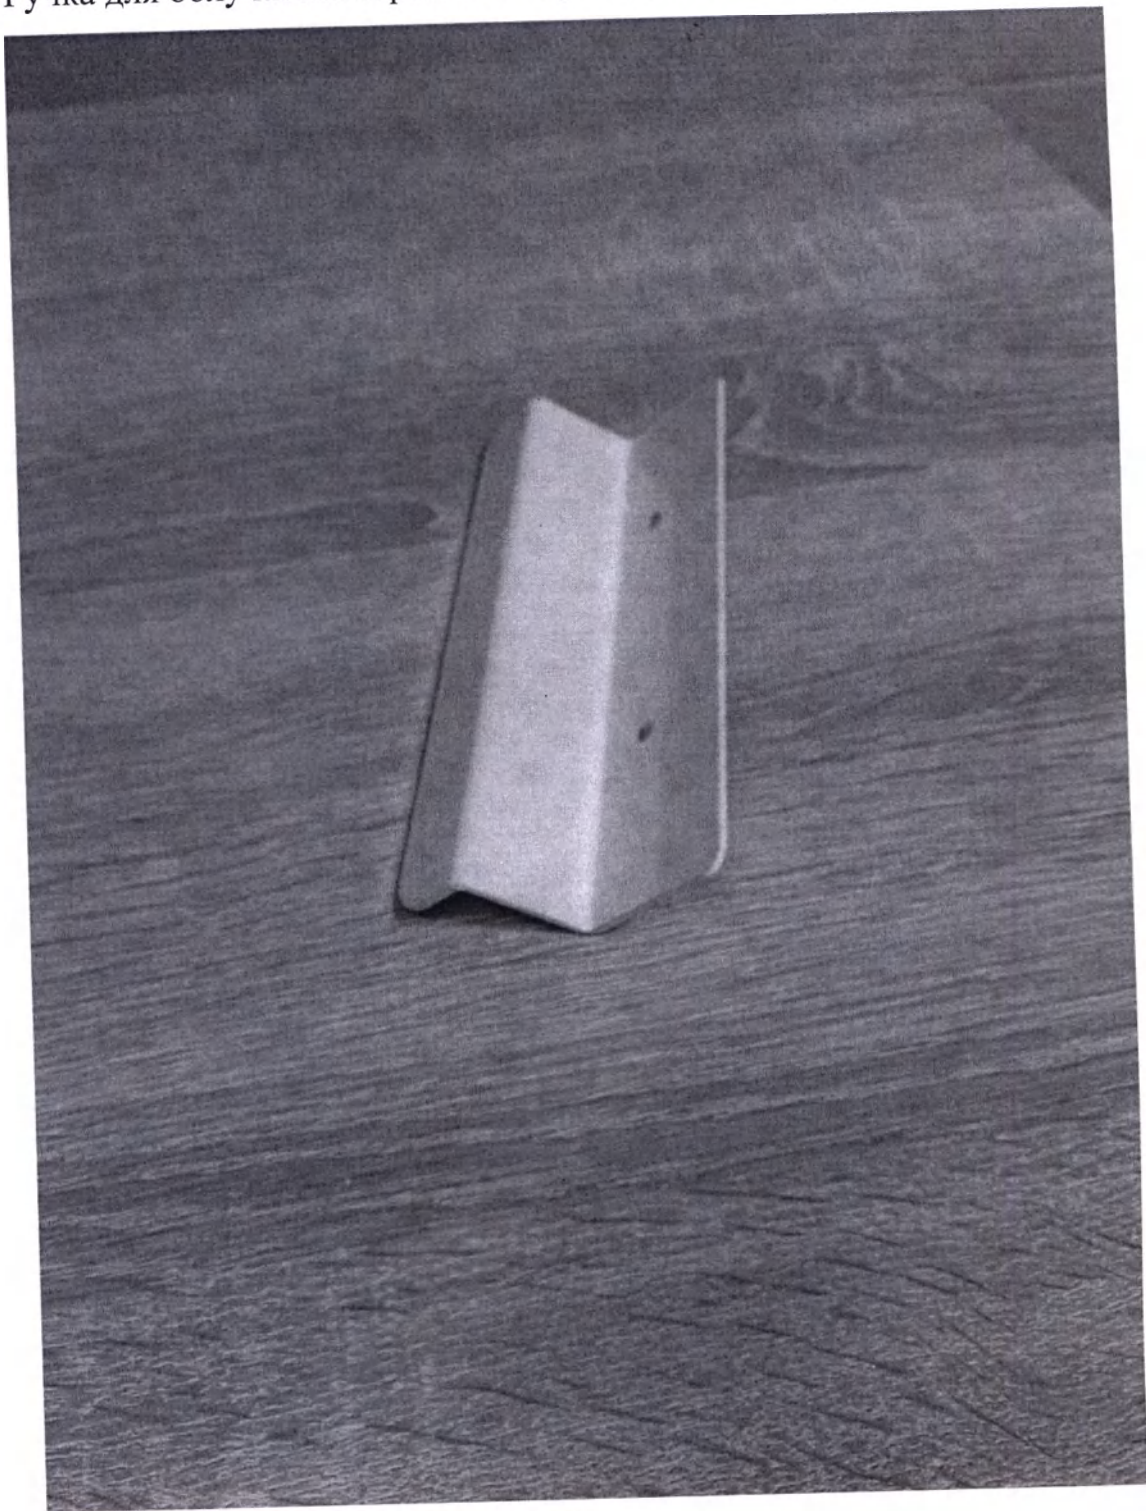

13. Опорная стойка облучателя серии РВ – принадлежность при необходимости

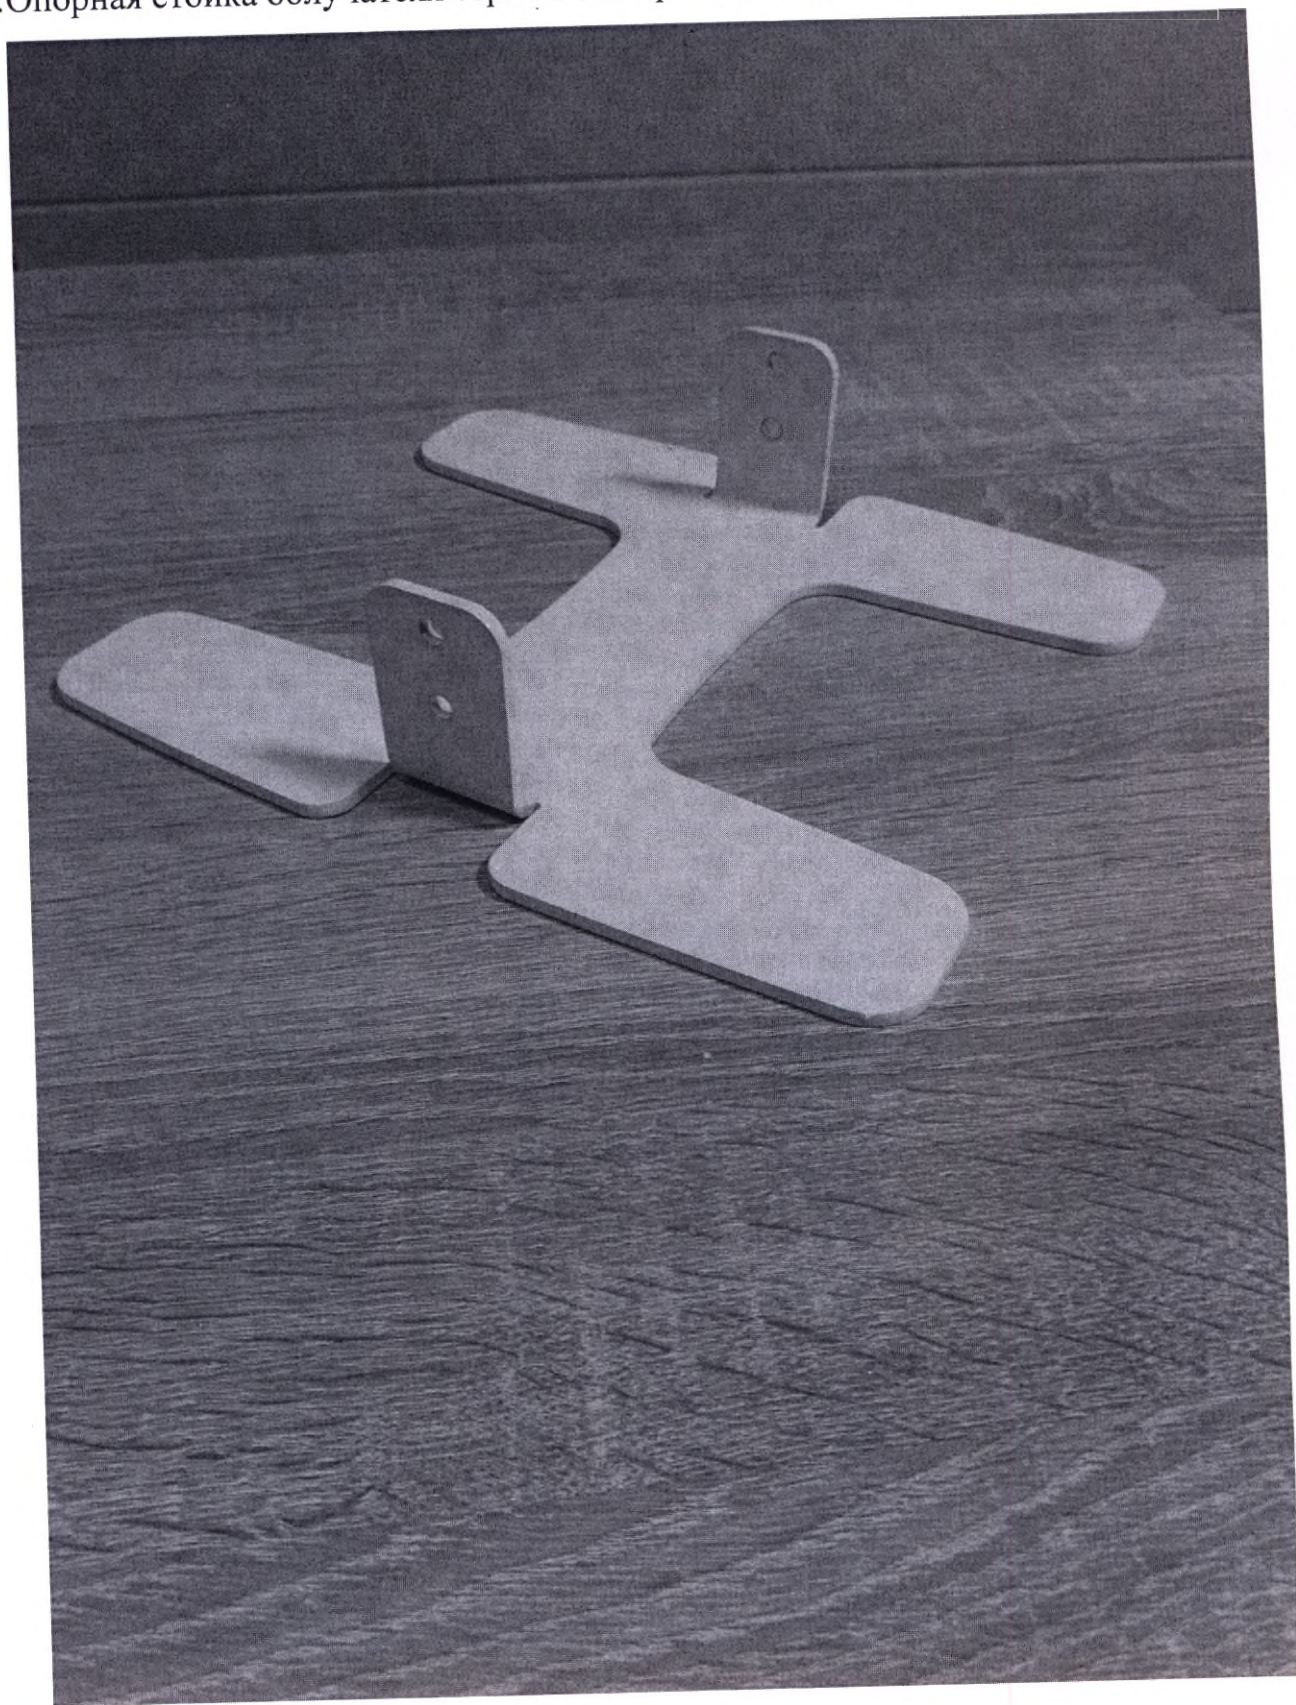


14. Опорная стойка облучателя РП – принадлежность при необходимости

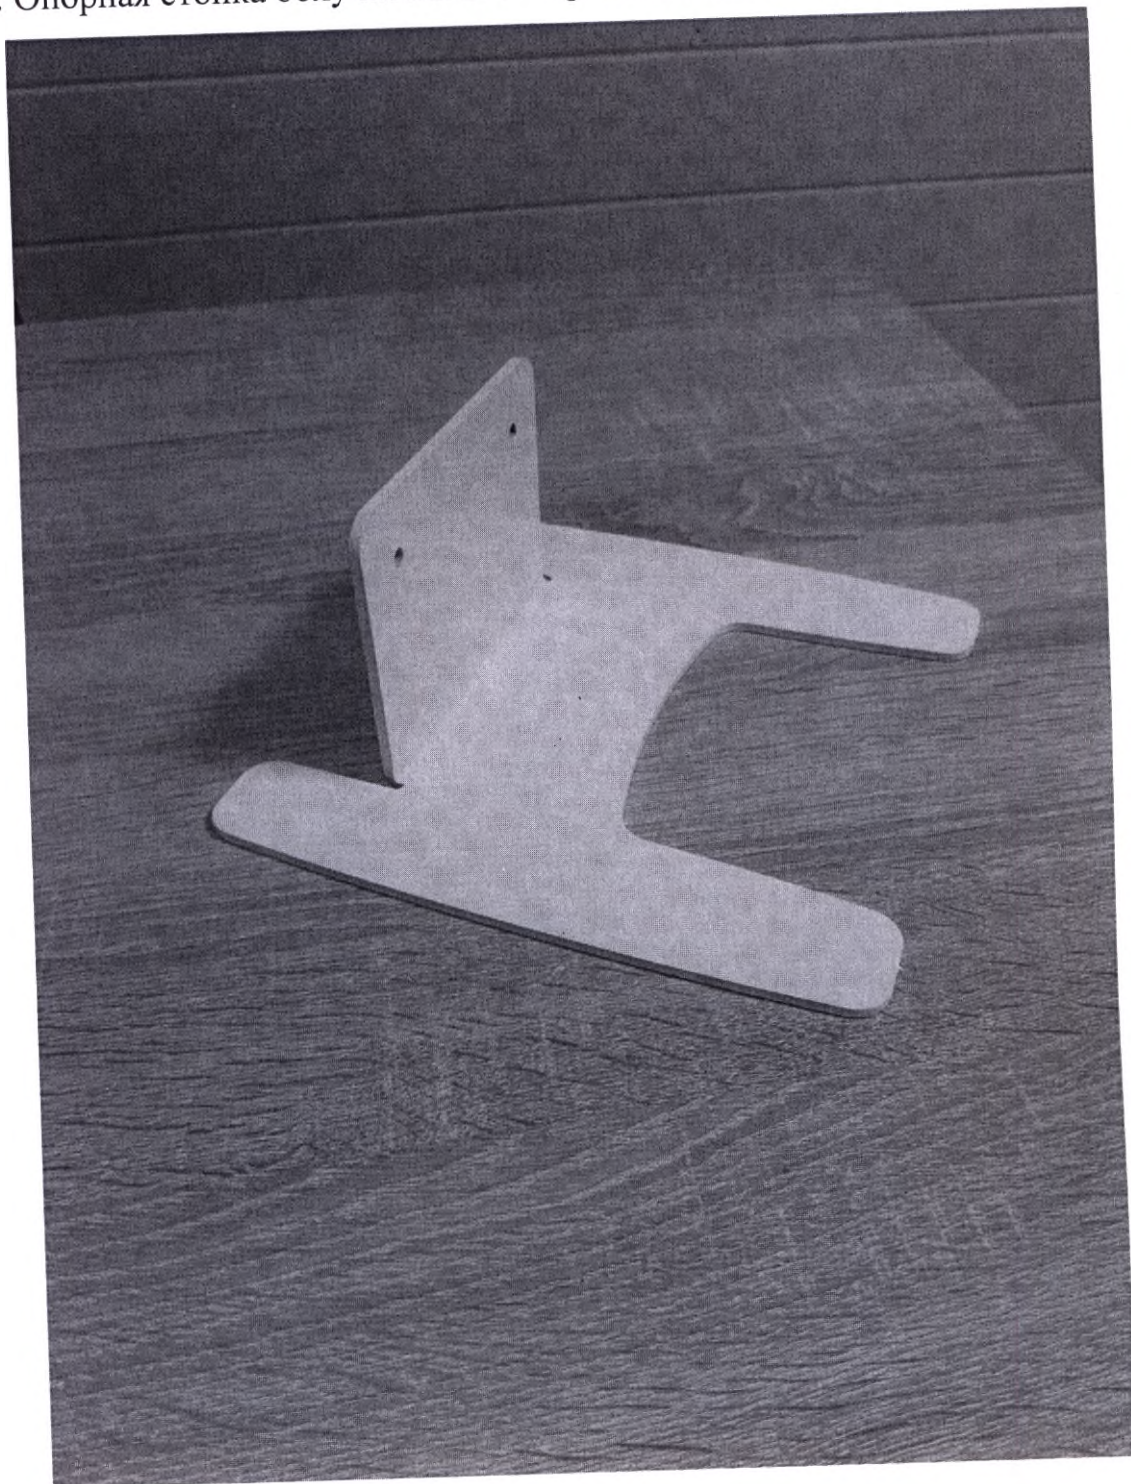


15. Упаковка облучателя-рециркулятора бактерицидного медицинского
«ТЭМ» серии РВ


15.1. Упаковка облучателя-рециркулятора РВ-30

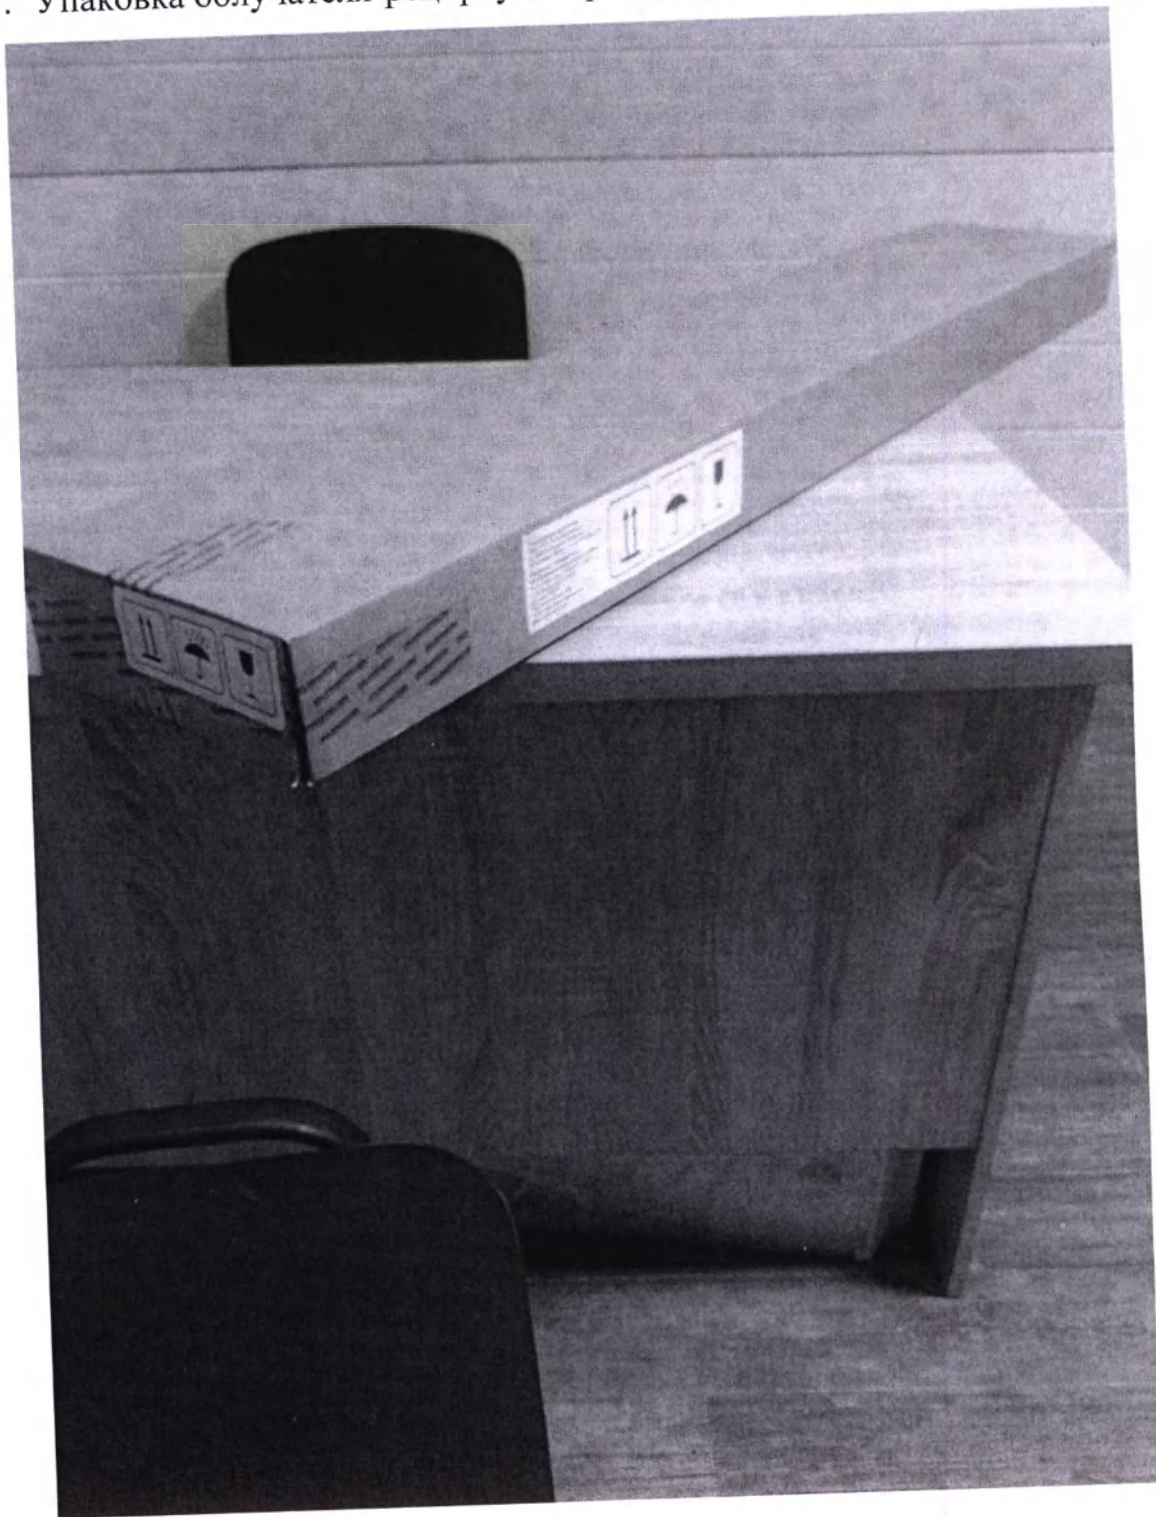



Предприятие-изготовитель
ОАО «НПО «Татэлектромаш»
423800, Республика Татарстан,
Набережные Челны, улица Моторная, 38
Облукатель-рециркулятор
багерицидний медиицинский «ТМ»
ТУ 32.50.50-001-76305937-2021
Серийный номер: 150009
Артыкул: РВ-30
Год изготовления: 2021
Условный номер упаковки:
Дата упаковки:




15.2. Упаковка облучателя-рециркулятора РВ-40

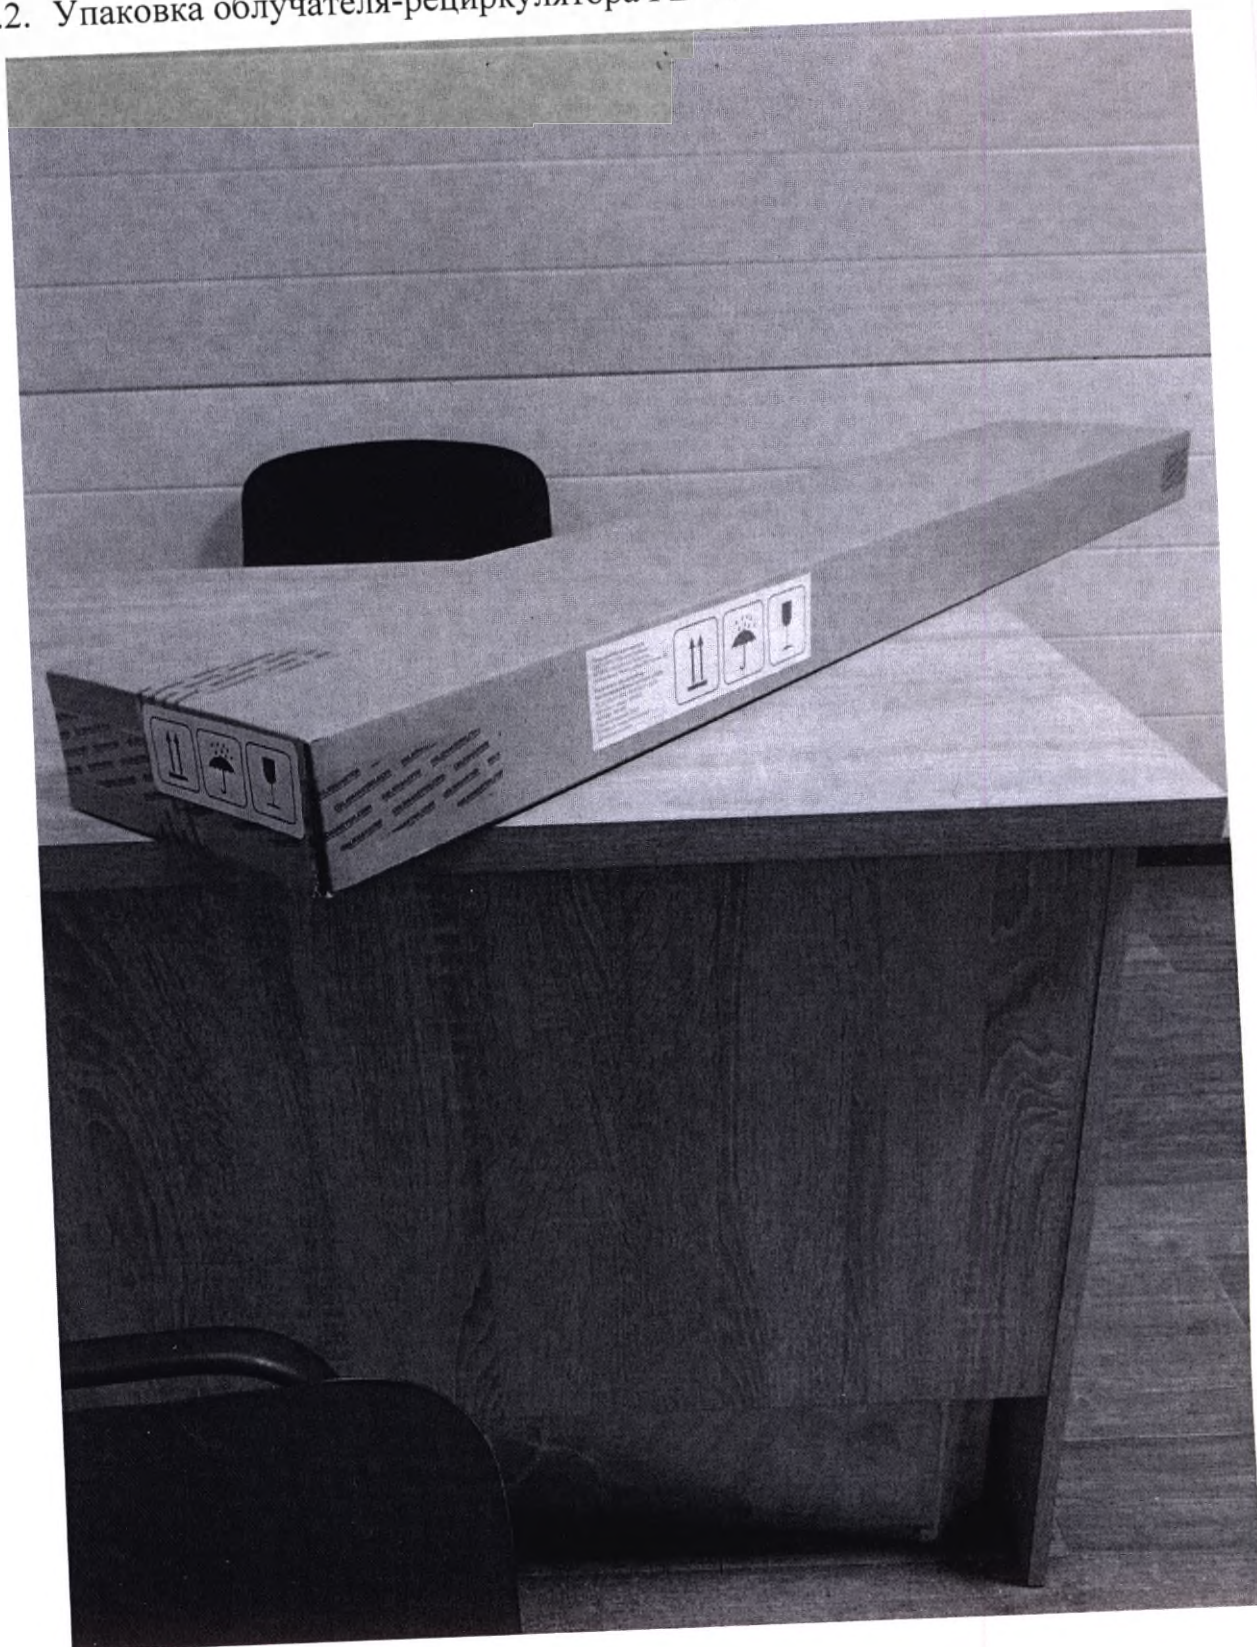


Предприятие-изготовитель
ОАО «НПО «Татэлектромаш»
423800, Республика Татарстан,
Набережные Челны, улица Моторная, 38
Облучатель-рециркулятор
бактерицидный медицинский «ТЭМ»
ТУ 32.50.50-001-76305937-2021
Серийный номер: 160010
Артикул: РВ-40
Год изготовления: 2021
Условный номер упаковщика: _____
Дата упаковывания: _____




15.3. Упаковка облучателя-рециркулятора РВ-80

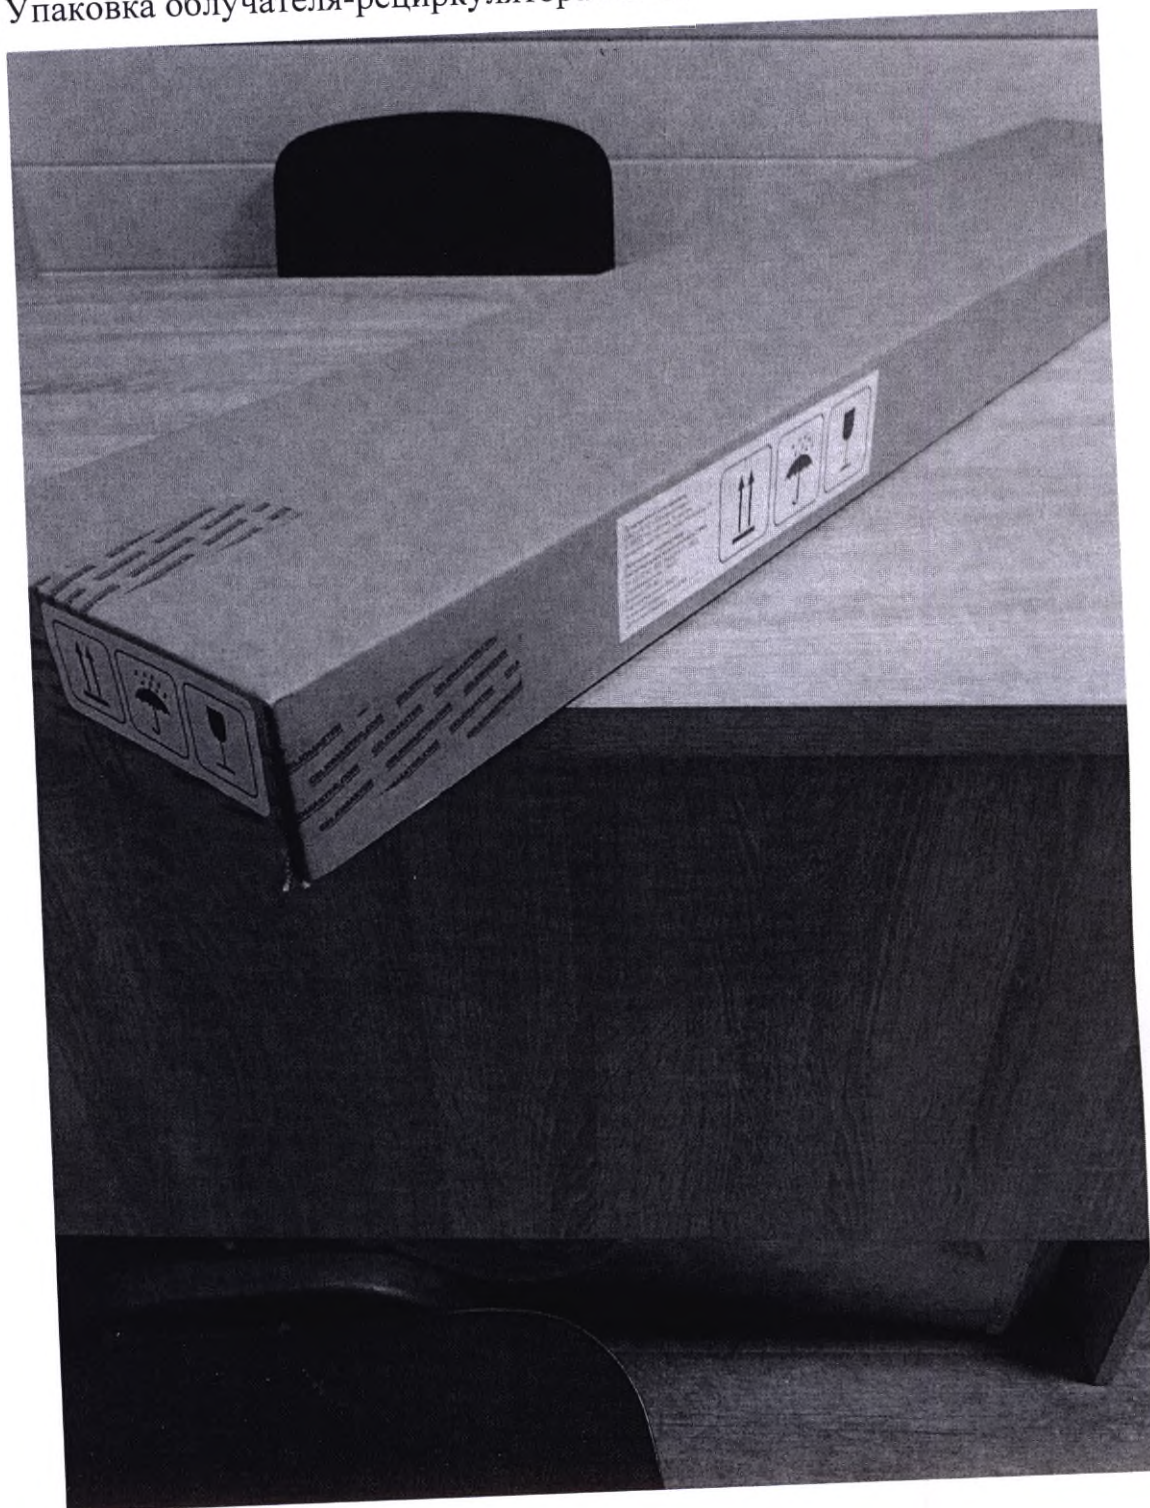


Предприятие-изготовитель
ОАО «НПО «Татэлектромаш»
423800, Республика Татарстан,
Набережные Челны, улица Моторная, 38
Облучатель-рециркулятор
бактерицидный медицинский «ТЭМ»
ТУ 32.50.50-001-76305937-2021
Серийный номер: 195011
Артикул: РВ-80
Год изготовления: 2021
Условный номер упаковщика: _____
Дата упаковывания: _____



15.4. Упаковка облучателя-рециркулятора РВ-100

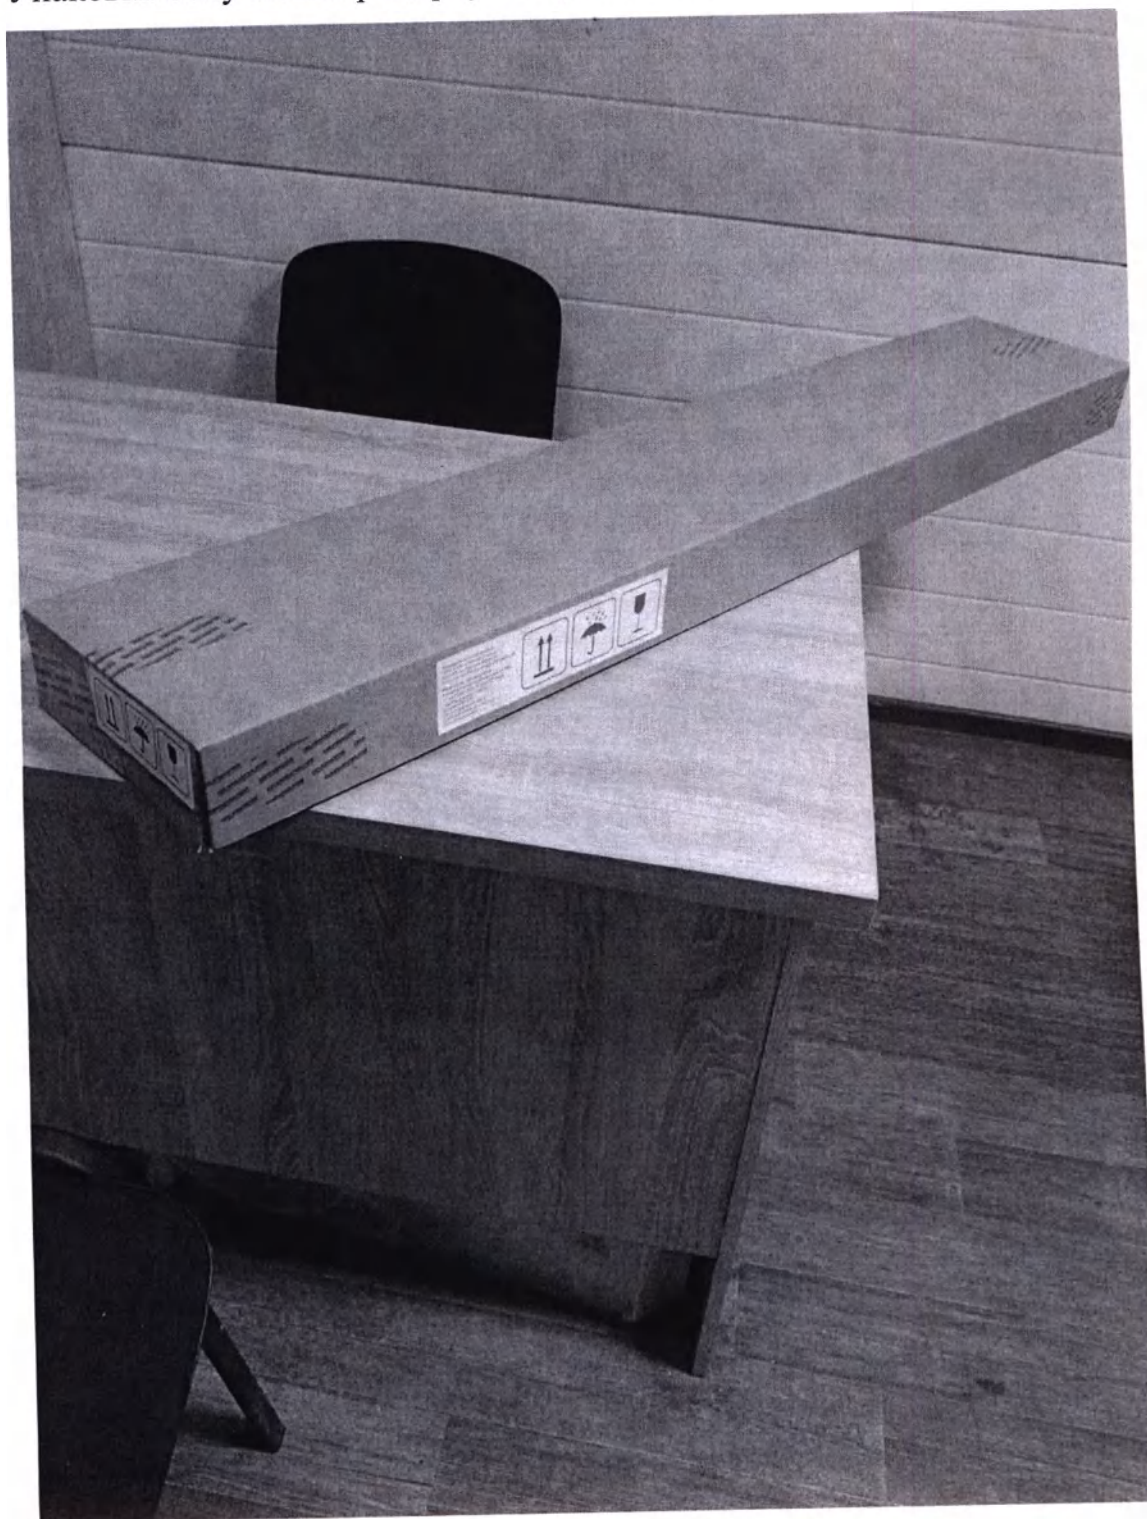


Предприятие-изготовитель
ОАО «НПО «Татэлектромаш»
423800, Республика Татарстан,
Набережные Челны, улица Моторная, 38
Облучатель-рециркулятор
бактерицидный медицинский «ТЭМ»
ТУ 32.50.50-001-76305937-2021
Серийный номер: 100003
Артикул: РВ-100
Год изготовления: 2021
Условный номер упаковщика: _____
Дата упаковки: _____




16. Упаковка облучателя-рециркулятора бактерицидного медицинского «ТЭМ» серии РП


16.1. Упаковка облучателя-рециркулятора РП-30

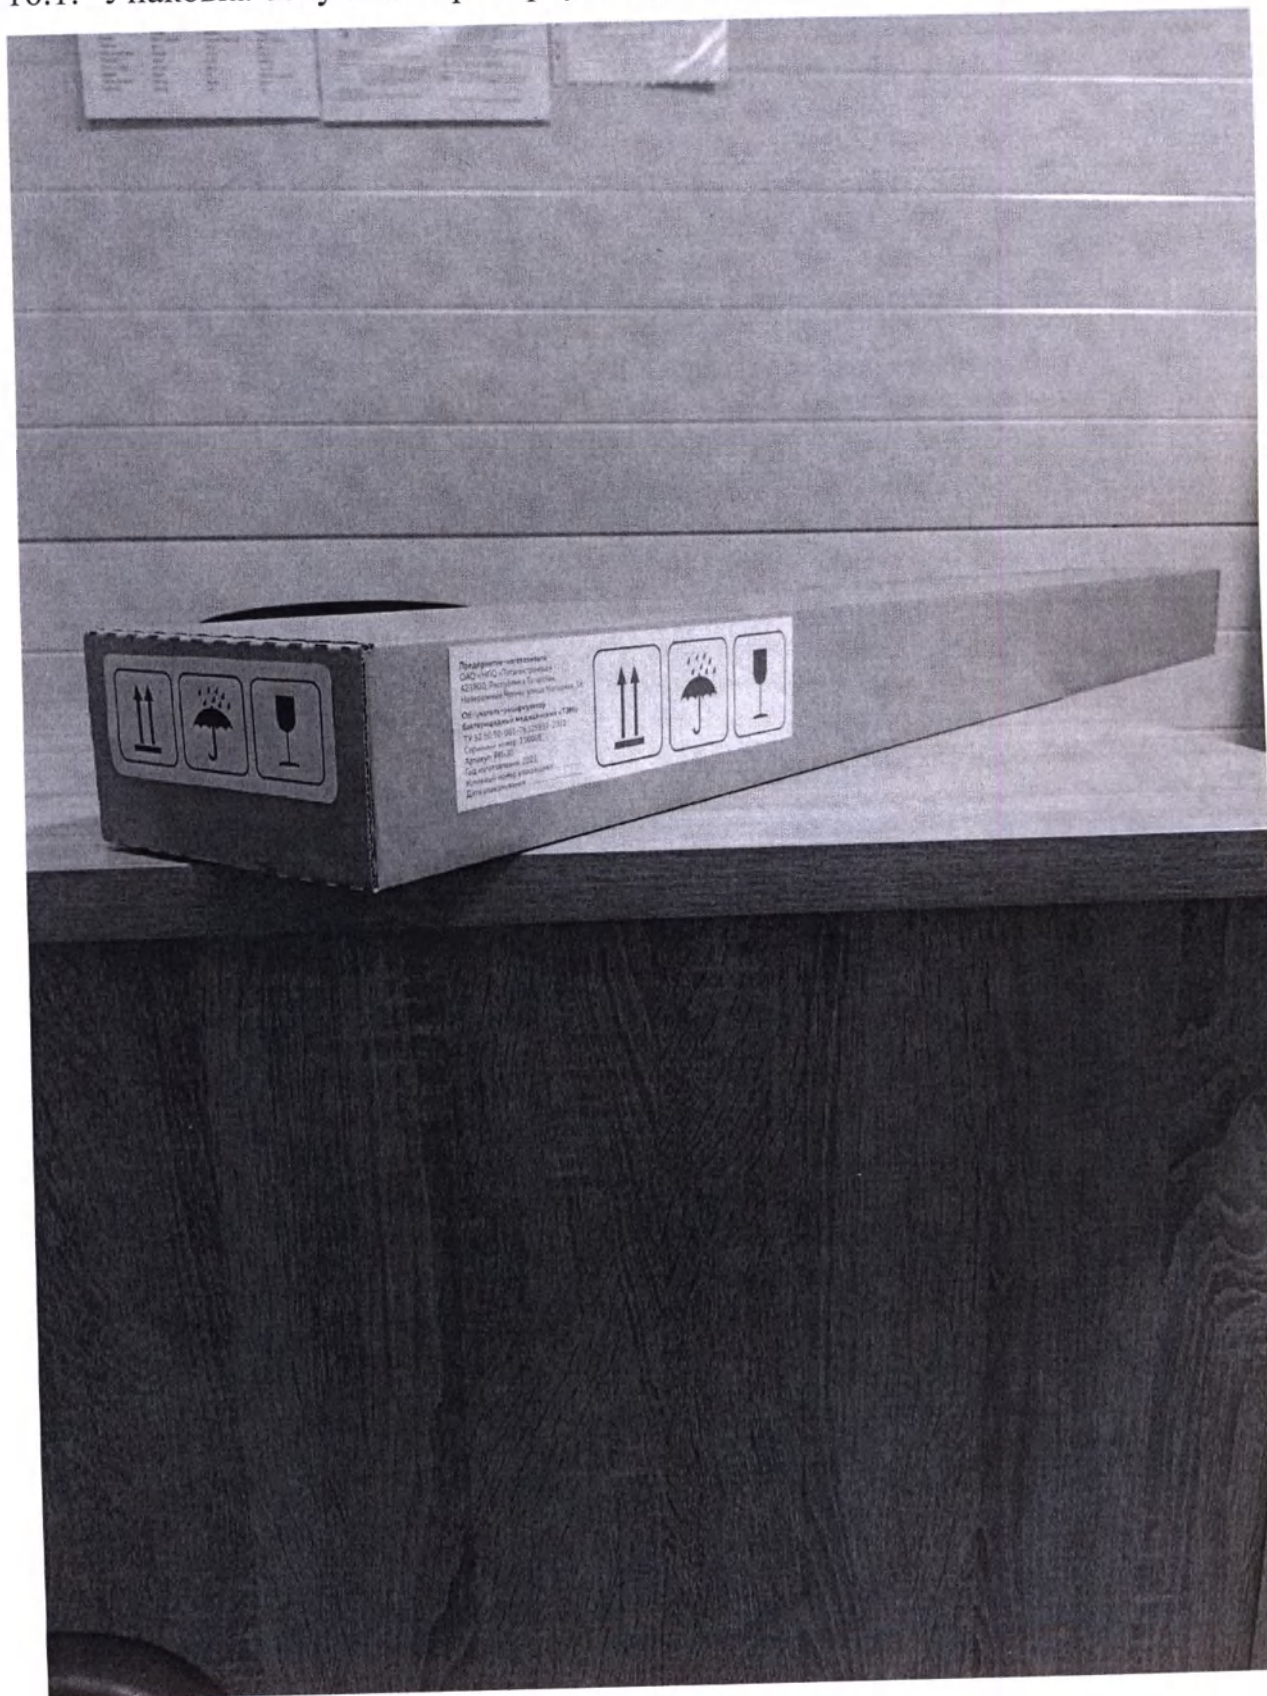


Предприятие-изготовитель
ОАО «НПО «Татэлектромаш»
423800, Республика Татарстан,
Набережные Челны, улица Моторная, 38
Облучатель-рециркулятор
бактерицидный медицинский «ТЭМ»
ТУ 32.50.50-001-76305937-2021
Серийный номер: 110005
Артикул: РП-30
Год изготовления: 2021
Условный номер упаковщика: _____
Дата упаковки: _____




16.2. Упаковка облучателя-рециркулятора РП-40

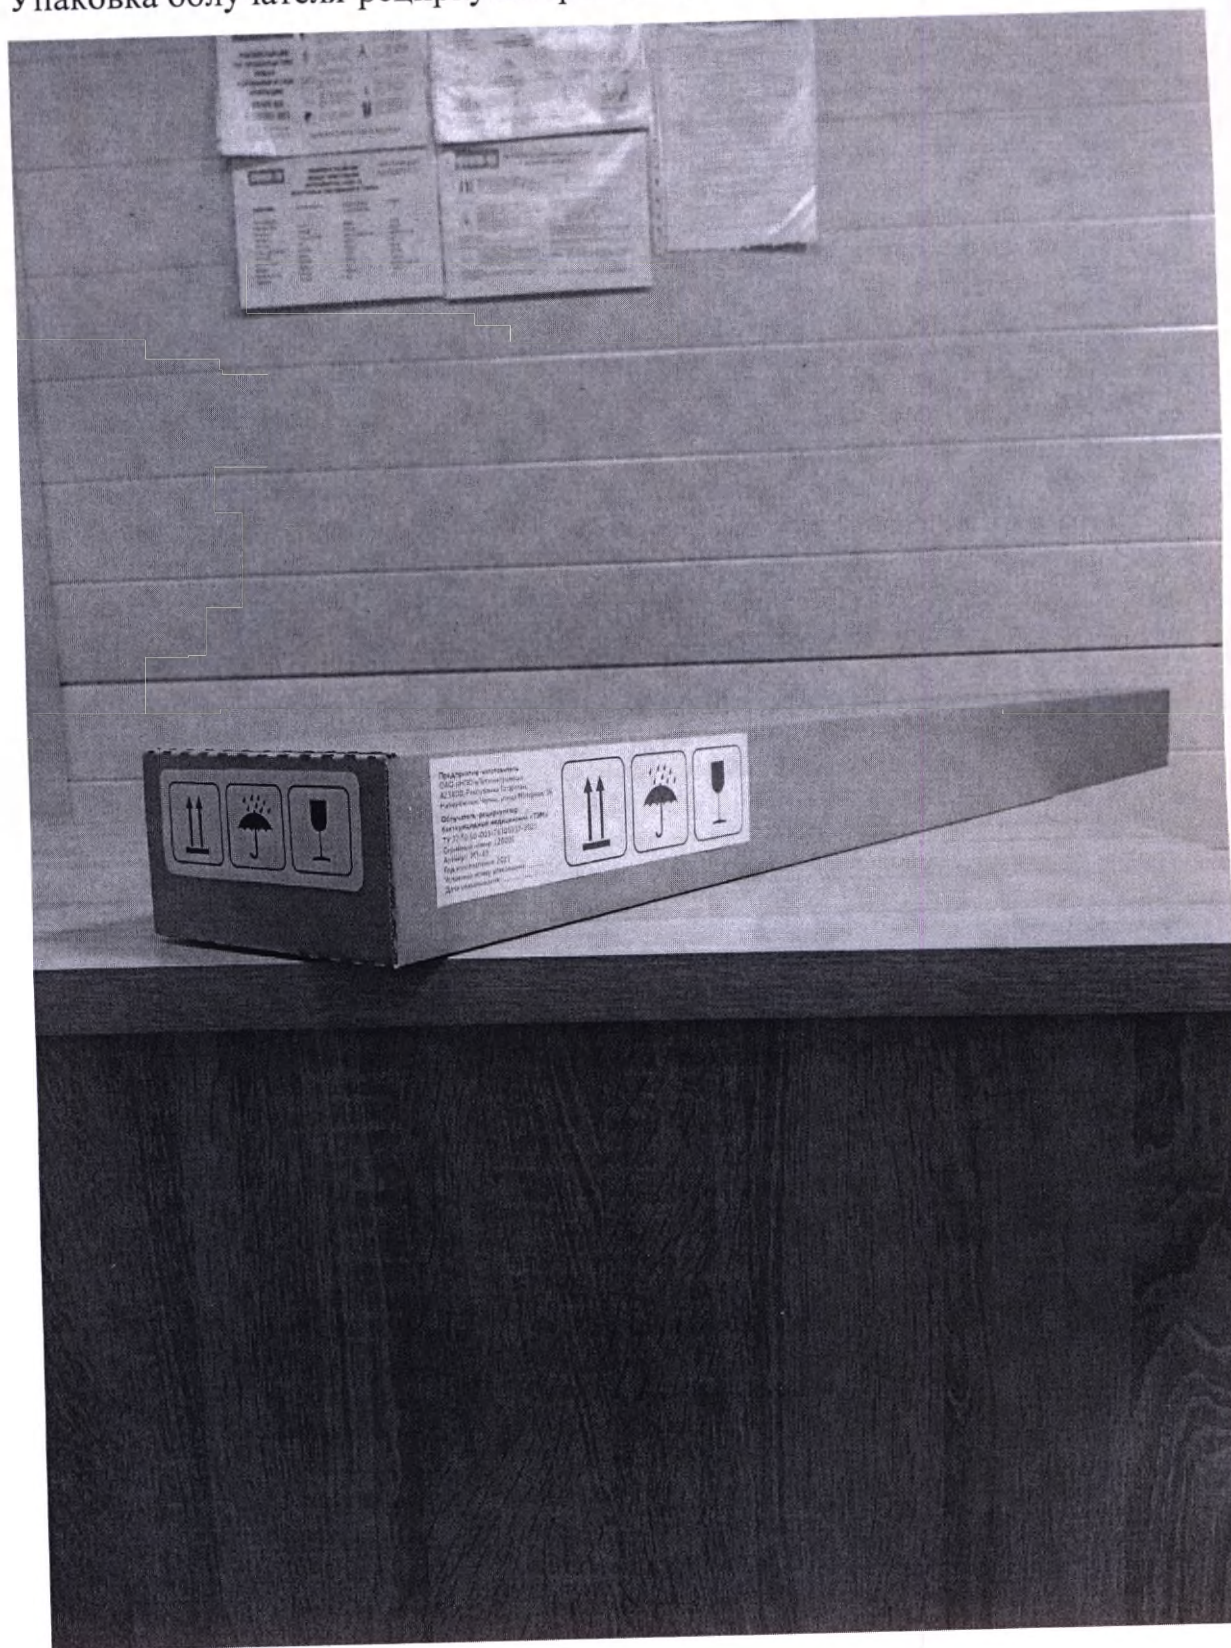


Предприятие-изготовитель
ОАО «НПО «Татэлектромаш»
423800, Республика Татарстан,
Набережные Челны, улица Моторная, 38
Облучатель-рециркулятор
бактерицидный медицинский «ТЭМ»
ТУ 32.50.50-001-76305937-2021
Серийный номер: 120006
Артикул: РП-40
Год изготовления: 2021
Условный номер упаковщика: _____
Дата упаковки: _____




16.3. Упаковка облучателя-рециркулятора РП-60

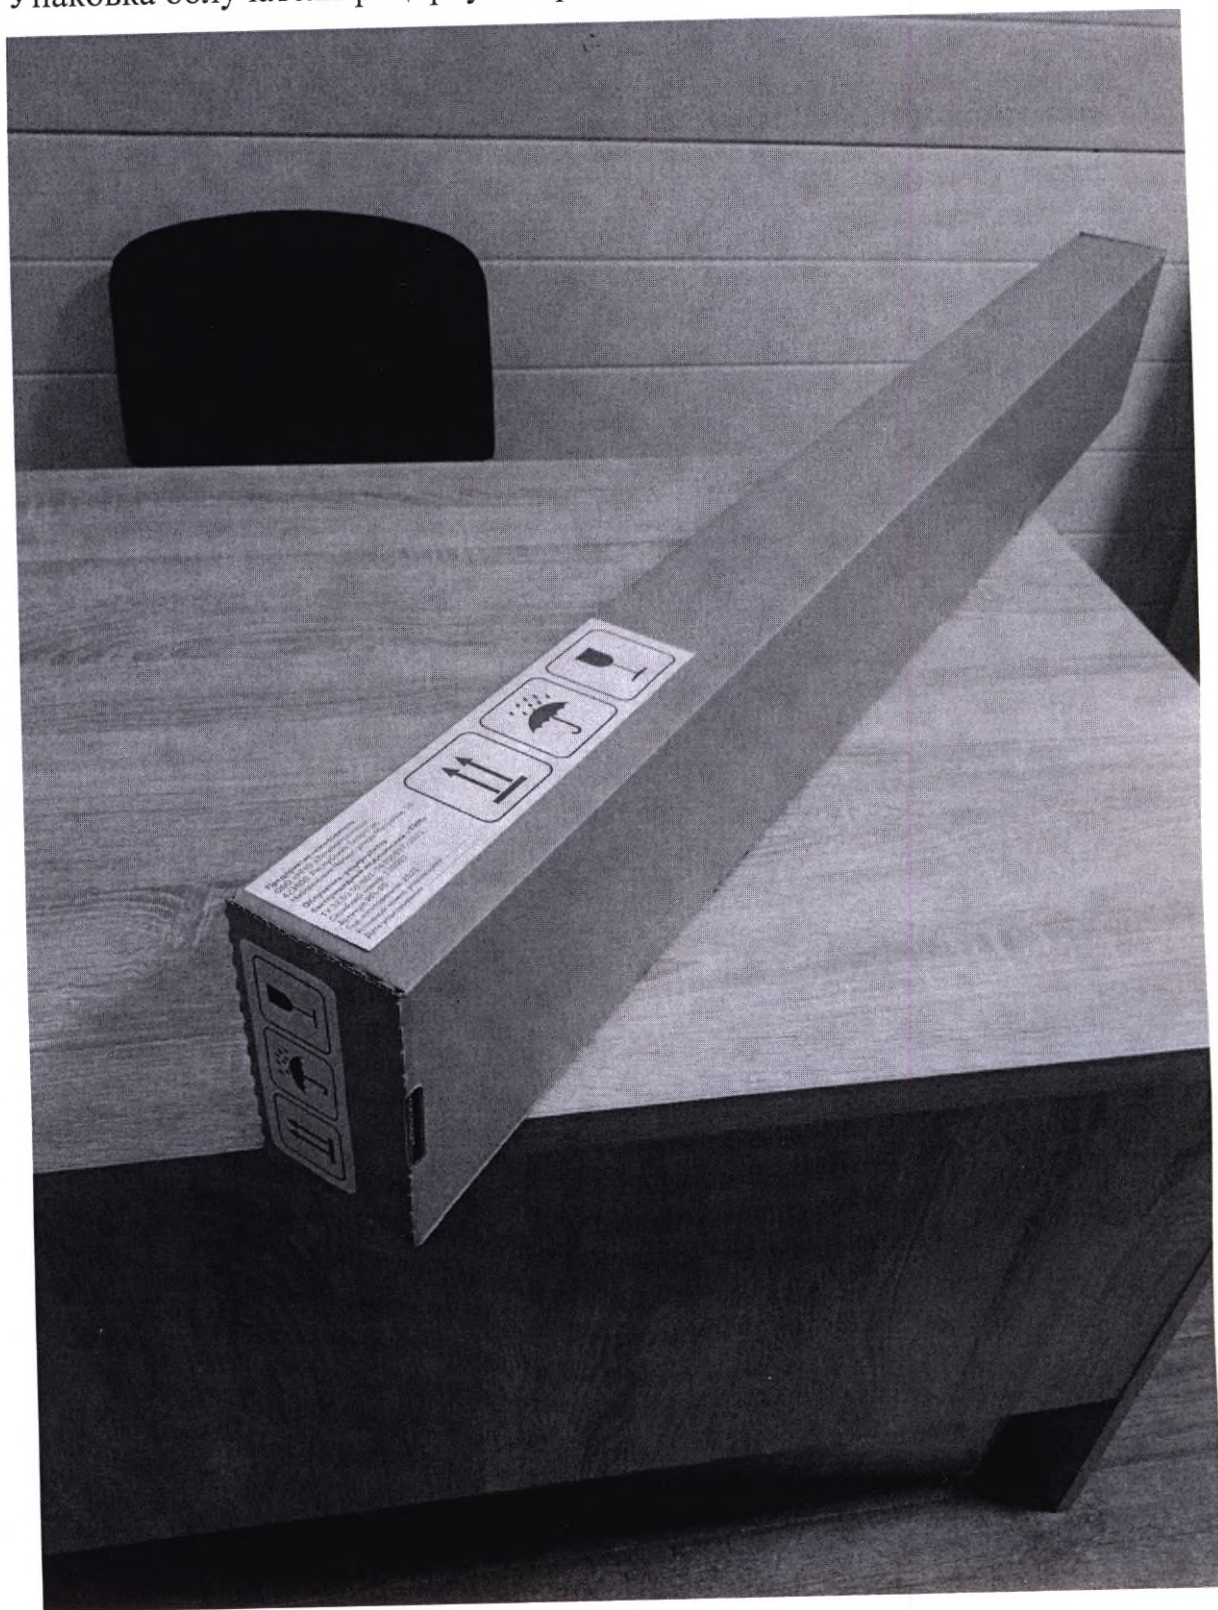


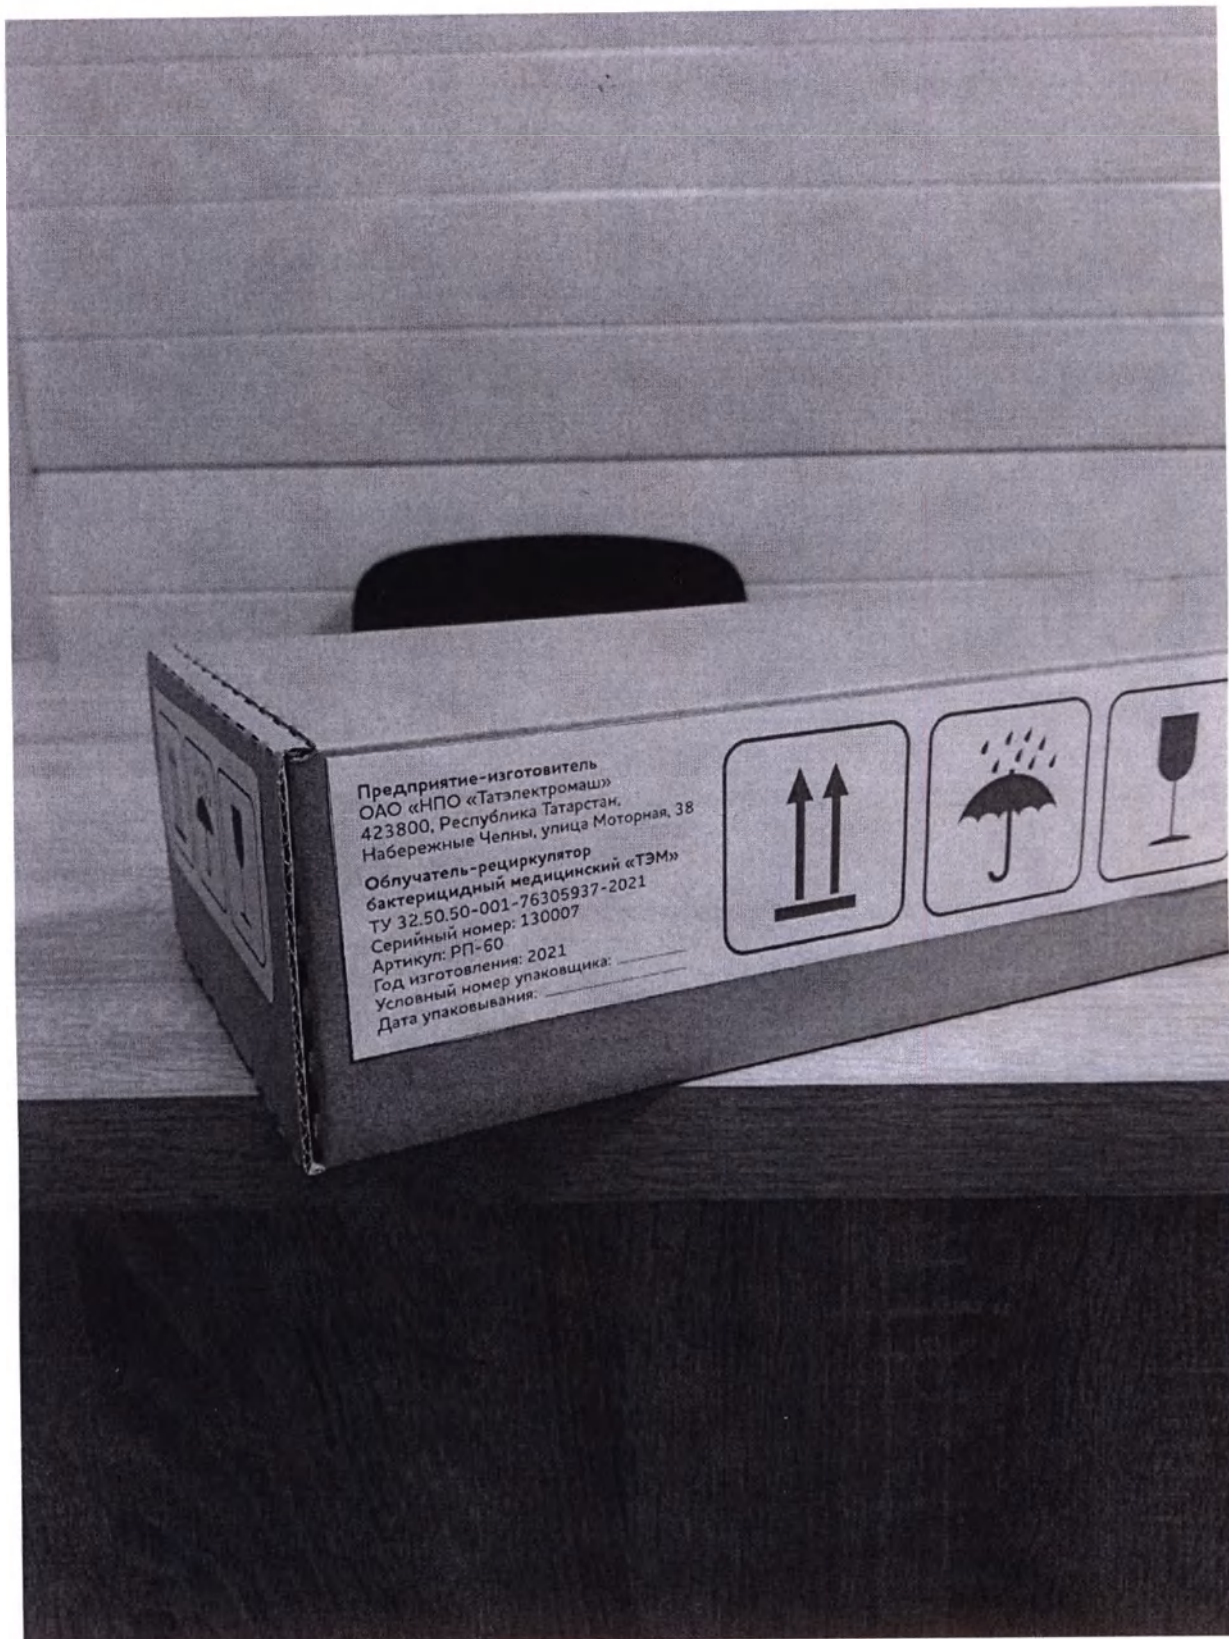

Предприятие-изготовитель
ОАО «НПО «Татэлектромаш»
423800, Республика Татарстан,
Набережные Челны, улица Моторная, 38
Облучатель-рециркулятор
бактерицидный медицинский «ТЭМ»
ТУ 32.50.50-001-76305937-2021
Серийный номер: 130007
Артикул: РП-60
Год изготовления: 2021
Условный номер упаковщика: _____
Дата упаковки: _____




16.4. Упаковка облучателя-рециркулятора РП-80

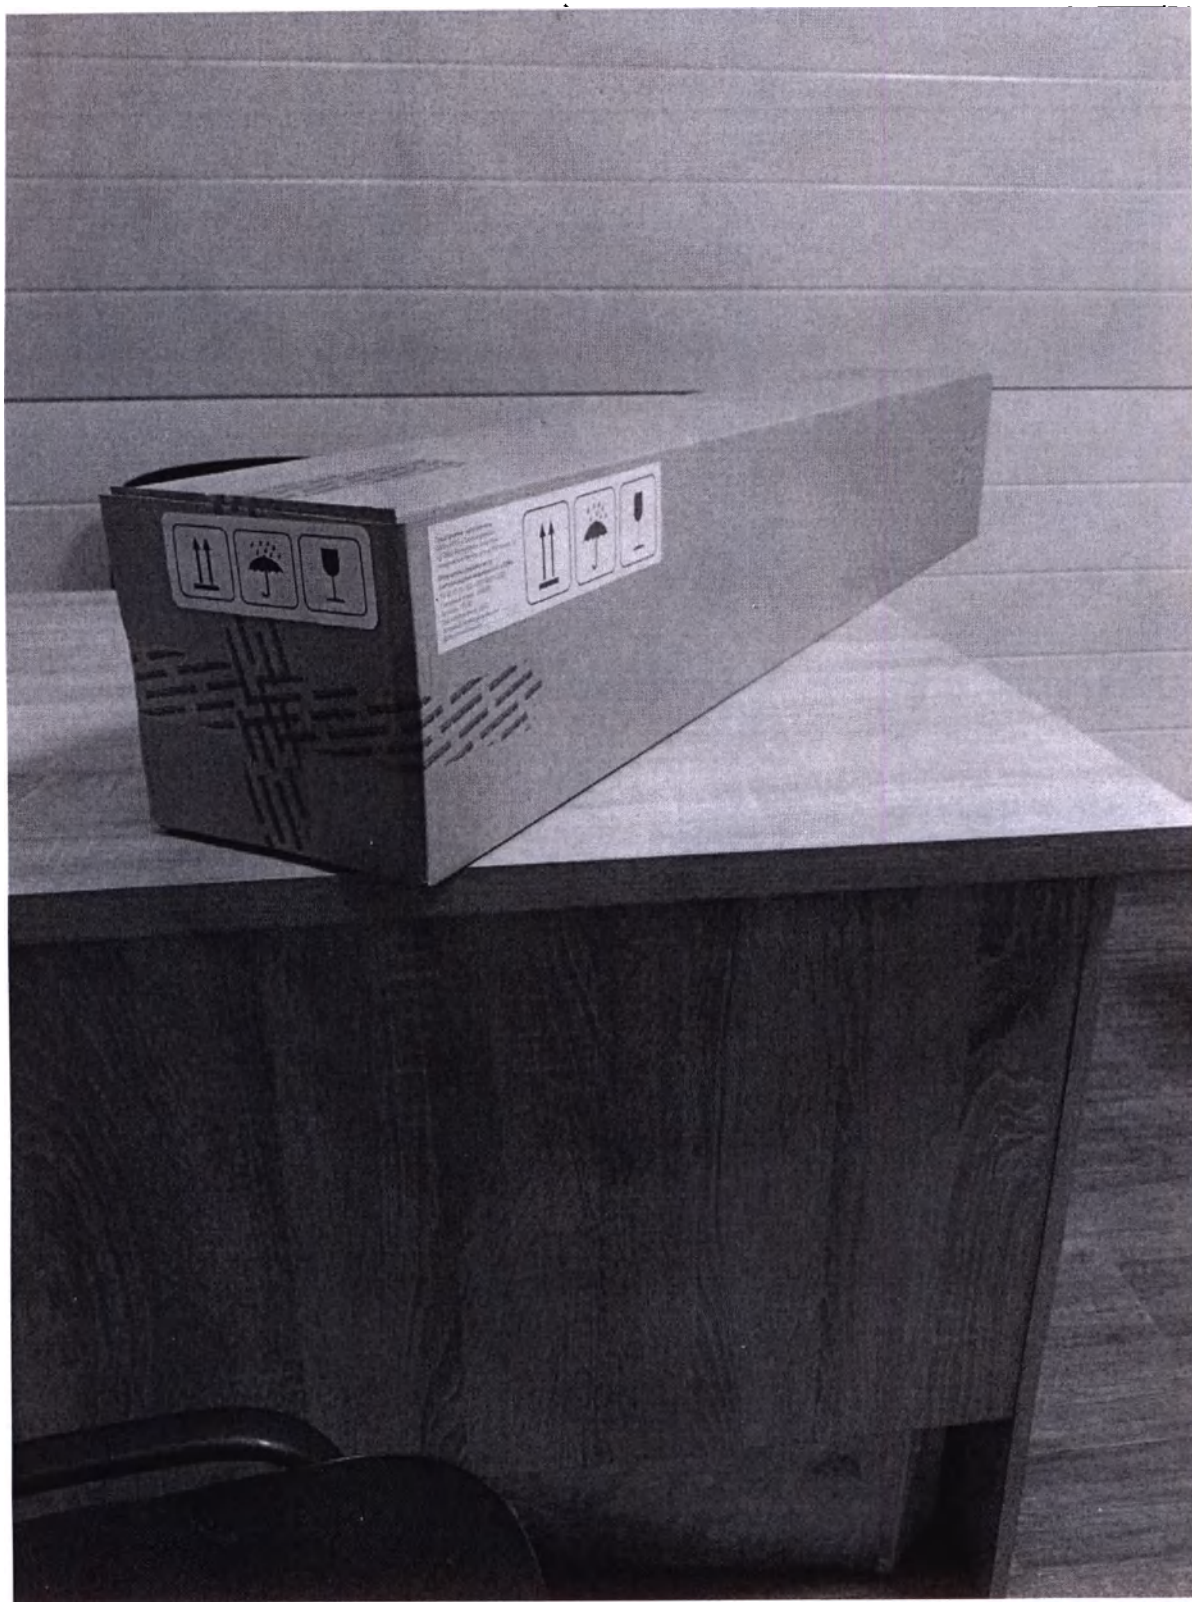


Предприятие-изготовитель
ОАО «НПО «Татэлектромаш»
423800, Республика Татарстан,
Набережные Челны, улица Моторная, 38

Облучатель-рециркулятор
бактерицидный медицинский «ТЭМ»
ТУ 32.50.50-001-76305937-2021
Серийный номер: 140008
Артикул: РП-80
Год изготовления: 2021
Условный номер упаковщика: _____
Дата упаковки: _____




CELKOMASTER.COM

16.5. Упаковка облучателя-рециркулятора РП-160

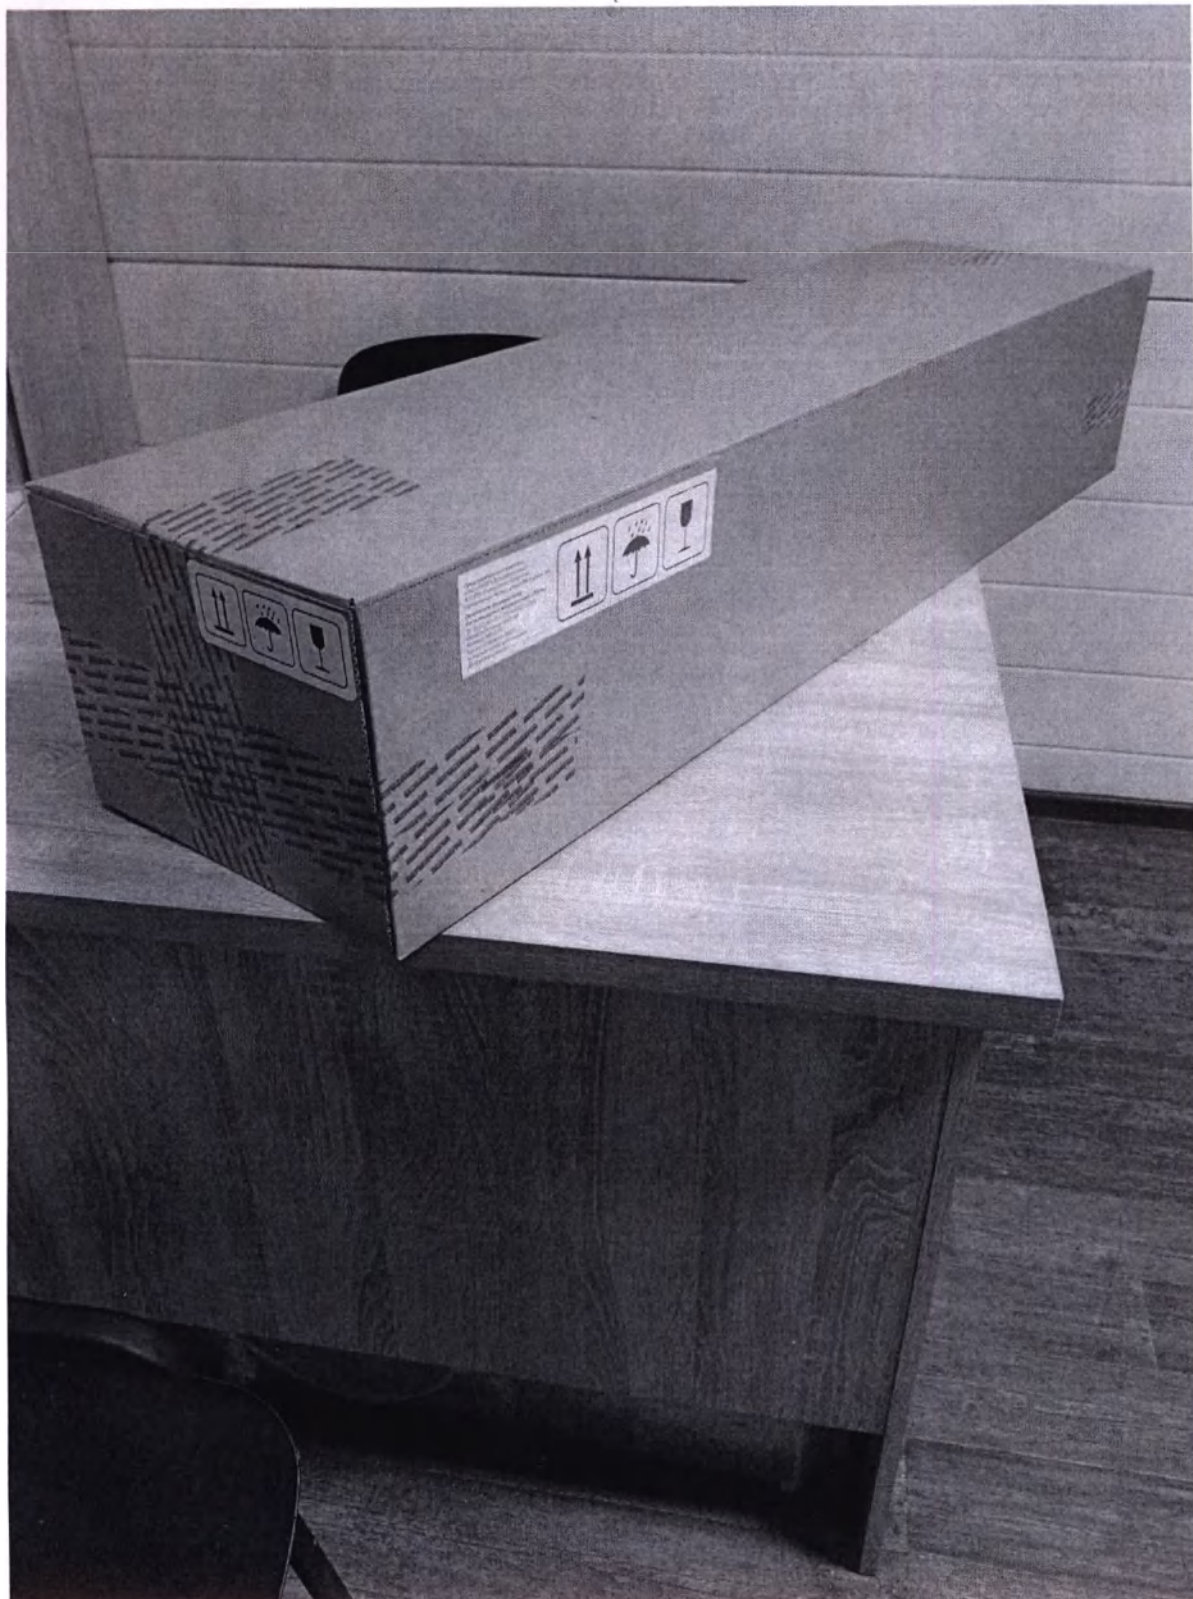

Предприятие-изготовитель
ОАО «НПО «Татэлектромаш»
423800, Республика Татарстан,
Набережные Челны, улица Моторная, 38
Облучатель-рециркулятор
бактерицидный медицинский «ТЭМ»
ТУ 32.50.50-001-76305937-2021
Серийный номер: 100004
Артикул: РП-160
Год изготовления: 2021
Условный номер упаковщика: _____
Дата упаковывания: _____



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

пятьдесят листа (ов)
прописью

Генеральный директор
ОАО НПО

ТАТЭЛЕКТРОМАШ _____ Исламов И.З.

личная подпись

