

Фотографические изображения общего вида
Набора реагентов «КовидЭк» для выделения
и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных
мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени, серия 03, серия 04.


Комплект №1 «РНК Экстракт» Серия 03 от 2021.09.23

Вид сверху открытой коробки набора реагентов





Фото коробки набора реагентов «КовидЭк» сер.03 и
коробки с реагентами для амплификации набора
реагентов «КовидЭк»
Серия 03 от 2021.09.23 (не в сборе)

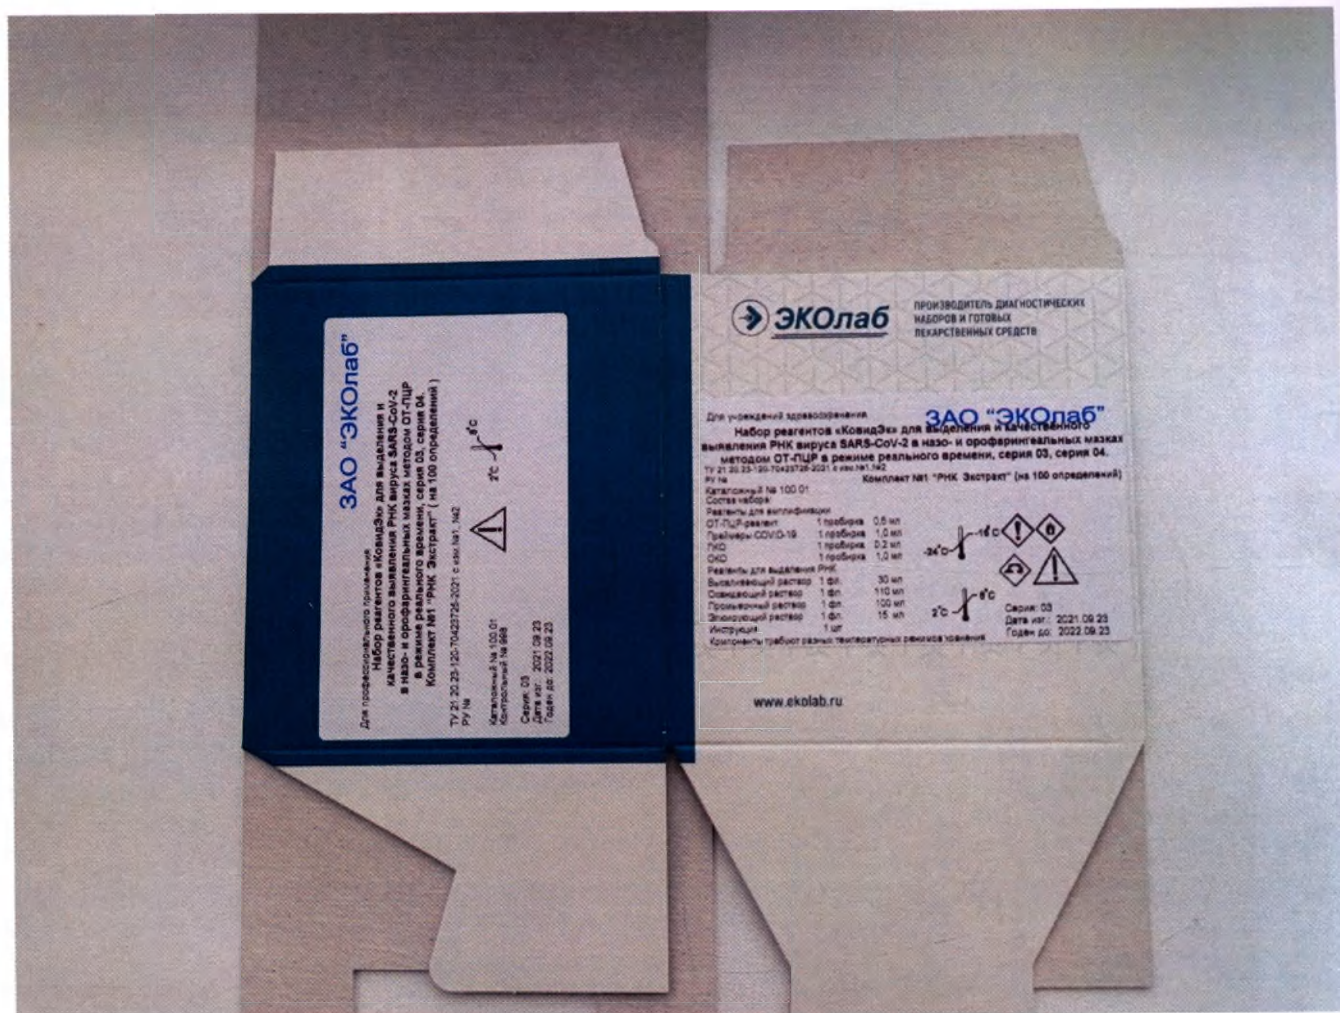



ЗАО "ЭКОлаб"

"КовидЭк" Комплект №1
"РНК Экстракт"

ТУ 21.20.23-120-70423725-2021 с изм. №1, №2
РУ №
Кат. № 100.01

Реагенты для амплификации:


ОТ-ПЦР-реагент	1 пробирка	0,5 мл
Праймеры COVID-19	1 пробирка	1,0 мл
ПКО	1 пробирка	0,2 мл
ОКО	1 пробирка	1,0 мл

Серия: 03

Годен до: 2022.09.23



-24 °C



-16 °C

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
НАБОРОВ И ГОТОВЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

ЭКОлаб

www.ekolab.ru

**Фото (вид сверху) коробки с реагентами для амплификации набора
реагентов «КовидЭк», серия 03 от 2021.09.23**

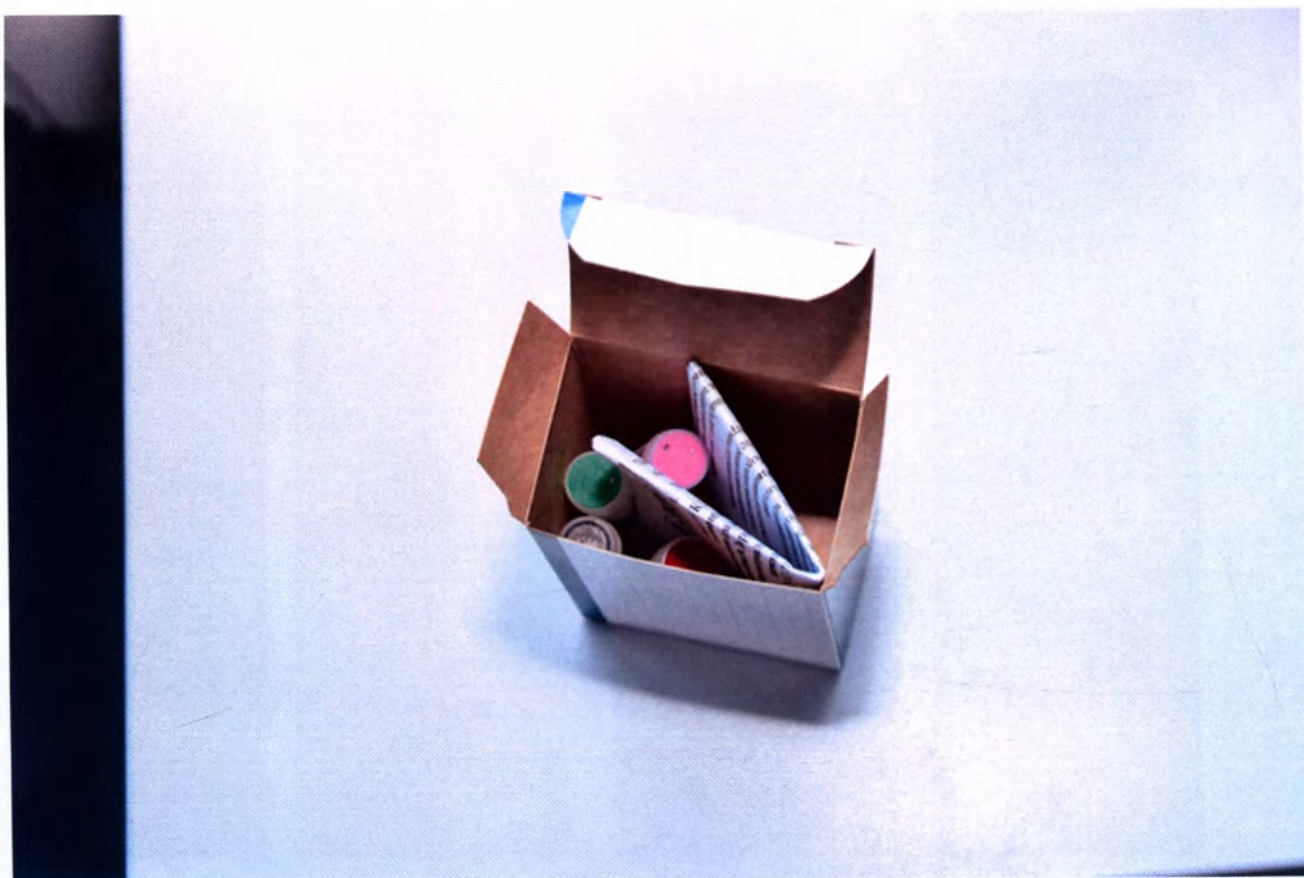


Фото пробирок с реагентами для амплификации
«КовидЭк», серия 01 от 2021.09.23

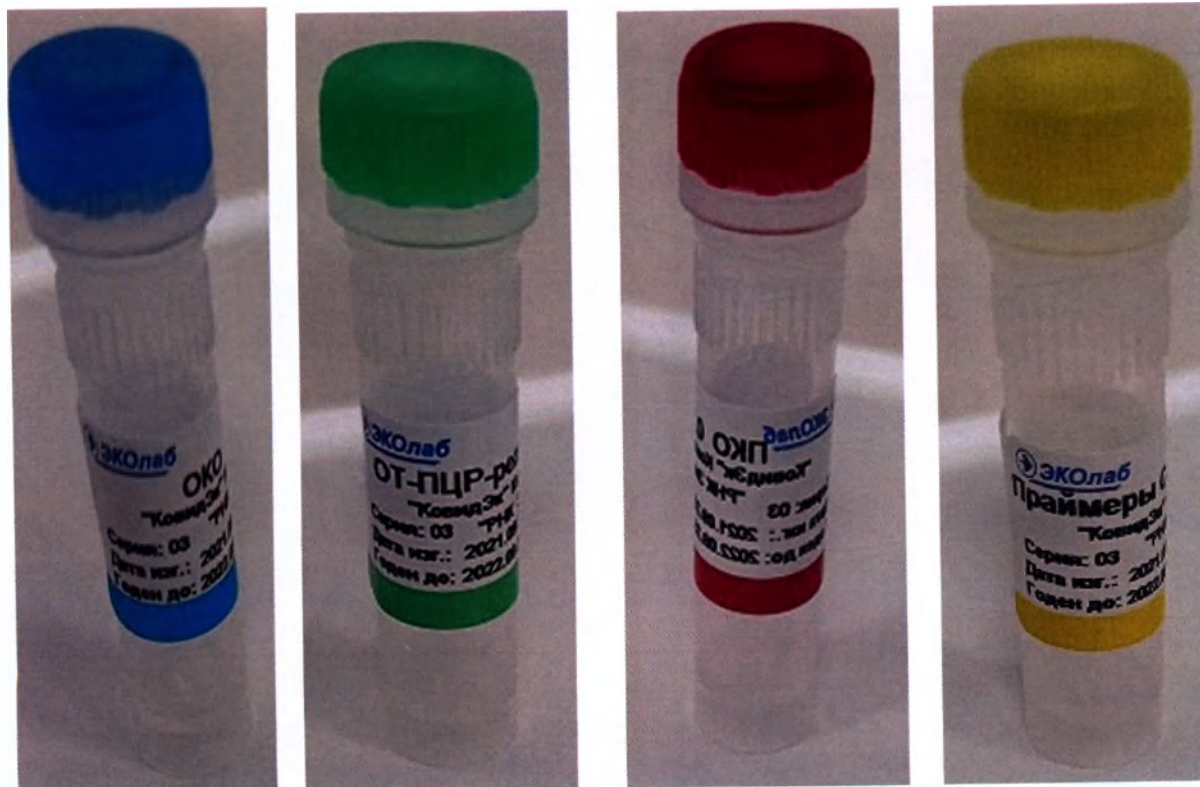


Фото флаконов с реагентами для выделения РНК «КовидЭк», серия 03
от 2021.09.23


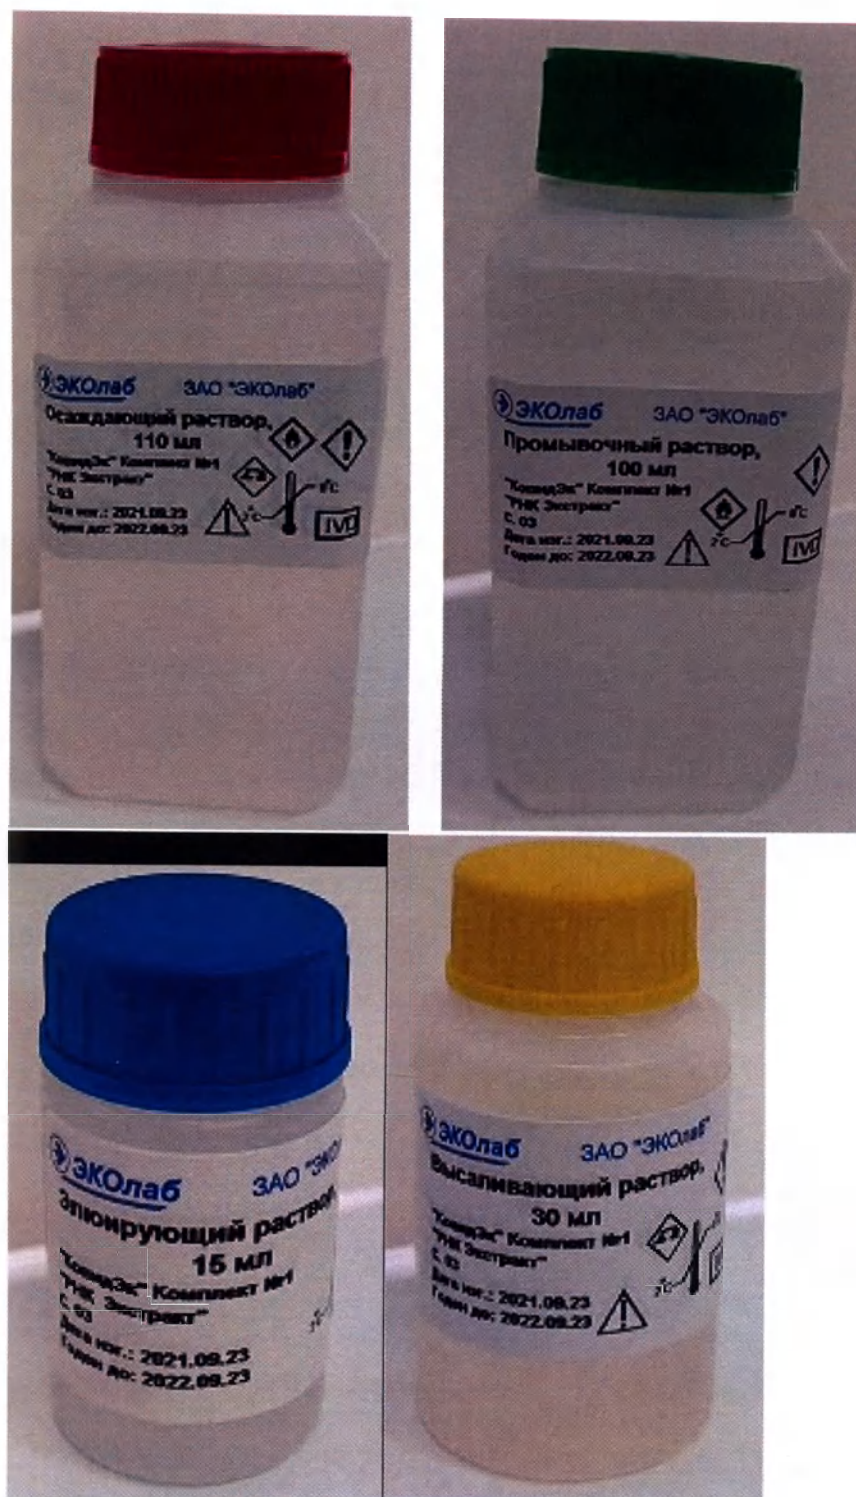


Фото общего вида набора реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени, серия 03.



Генеральный директор ЗАО «Эколаб»

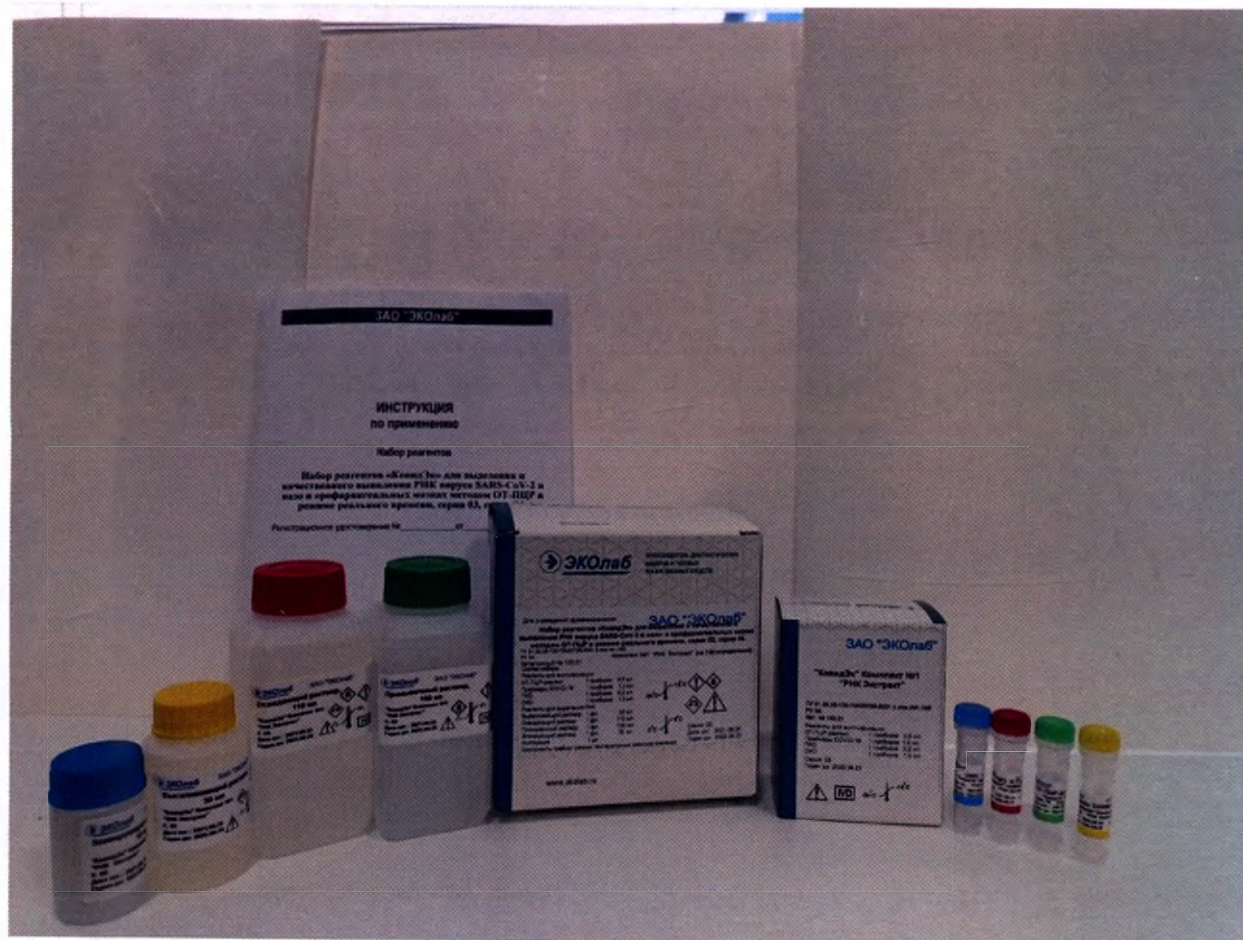

Борисов В.Ю.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 06

Зам. Ген. директора ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

"10" 2021 г.




**Фотографические изображения общего вида
Набора реагентов «КовидЭк» для выделения
и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и
орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени, серия
03, серия 04.**

Комплект №2 «РНК Магнит» Серия 04 от 2021.09.23

Вид сверху открытой коробки набора реагентов



Фото коробки набора реагентов «КовидЭк» сер.04 и коробки с реагентами для амплификации набора реагентов «КовидЭк»,
Серия 04 от 2021.09.23 (не в сборе)

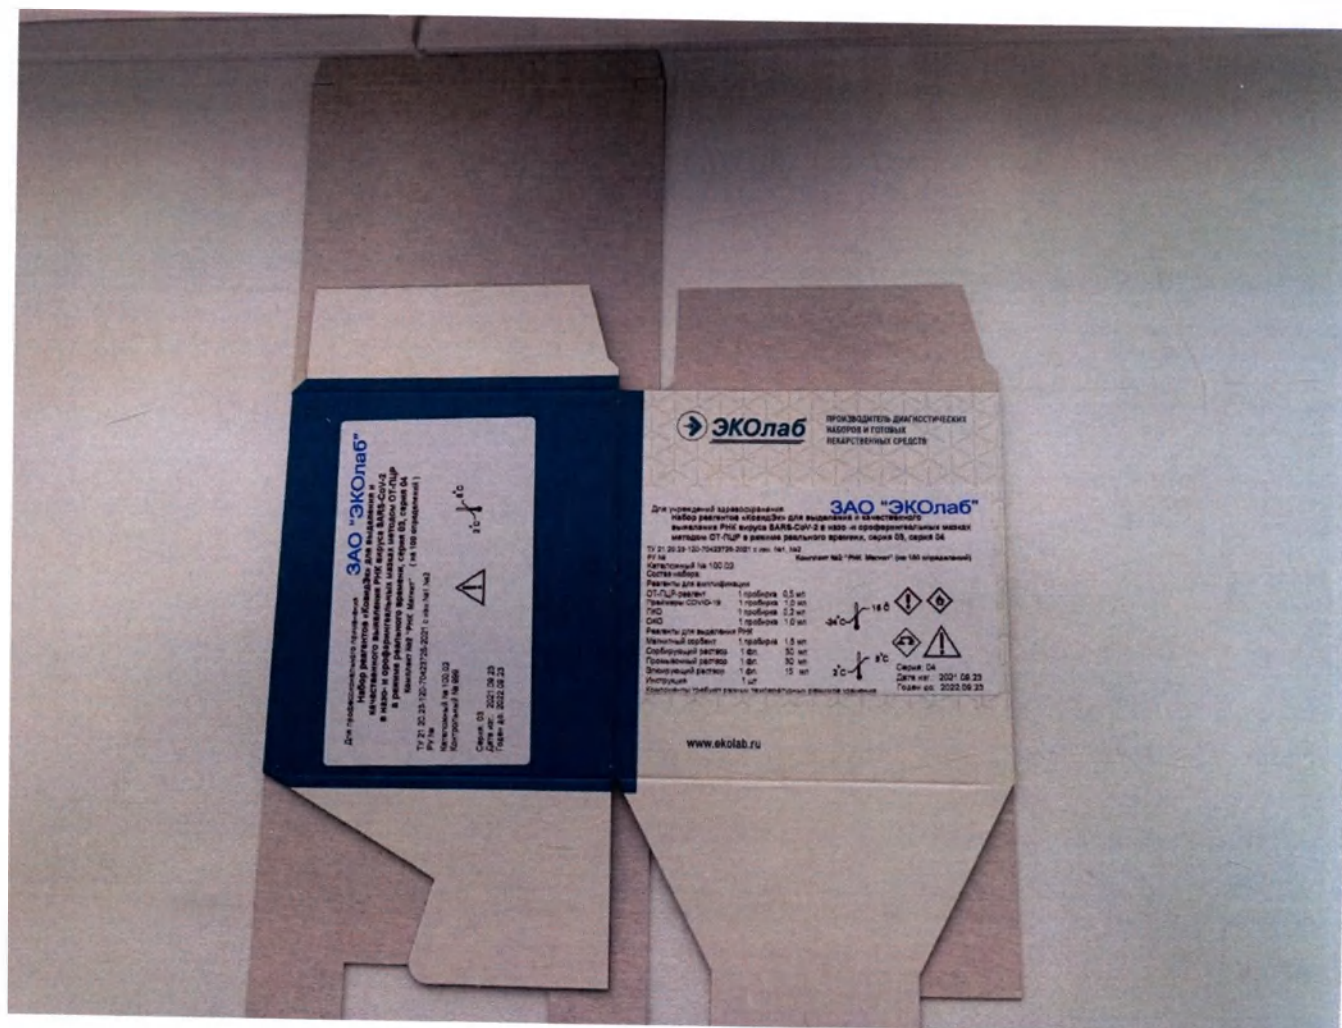



ЗАО "ЭКОлаб"

"КовидЭк" Комплект №2
"РНК Магнит"

ТУ 21.20.23-120-70423725-2021 с изм. №1, №2

РУ №

Кат. № 100.02

Реагенты для амплификации:


ОТ-ПЦР-реагент	1 пробирка	0,5 мл
Праймеры COVID-19	1 пробирка	1,0 мл
ПКО	1 пробирка	0,2 мл
ОКО	1 пробирка	1,0 мл

Серия: 04

Годен до: 2022.09.23



-24°C



-16°C

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НАБОРЫ И ГОТОВЫЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА



www.ekolab.ru

Фото (вид сверху) коробки с реагентами для амплификации набора реагентов «КовидЭк», серия 04 от 2021.09.23



Фото пробирок с реагентами для амплификации «КовидЭк»,
серия 04 от 2021.09.23

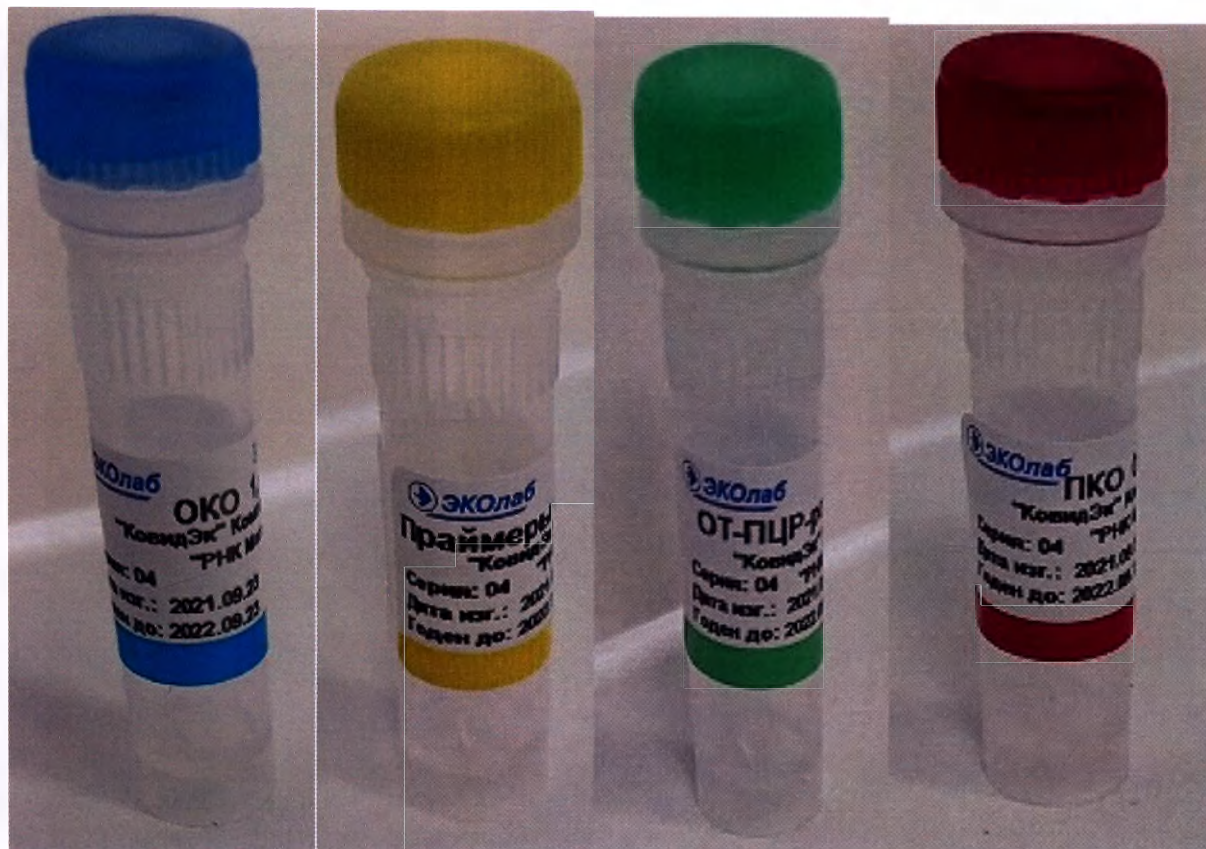


Фото флаконов с реагентами для выделения РНК «КовидЭк»,
серия 04 от 2021.09.23



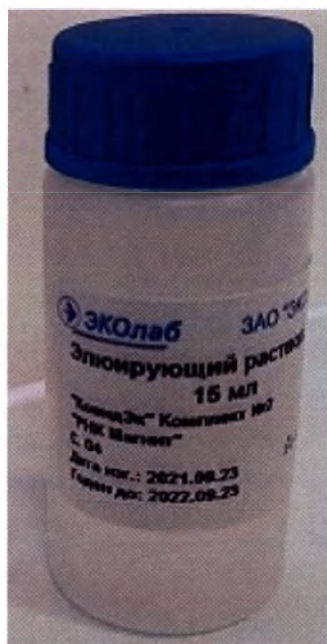


Фото общего вида набора реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени, серия 04.

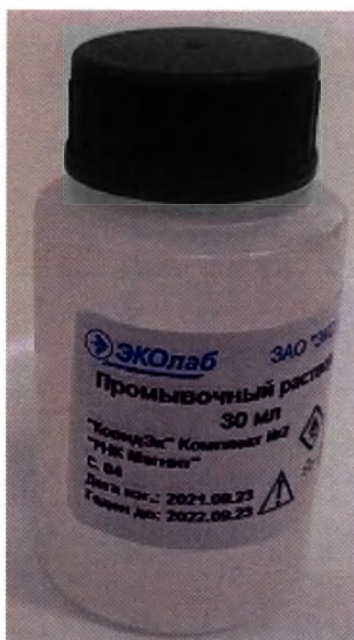

Генеральный директор ЗАО «Эколаб»

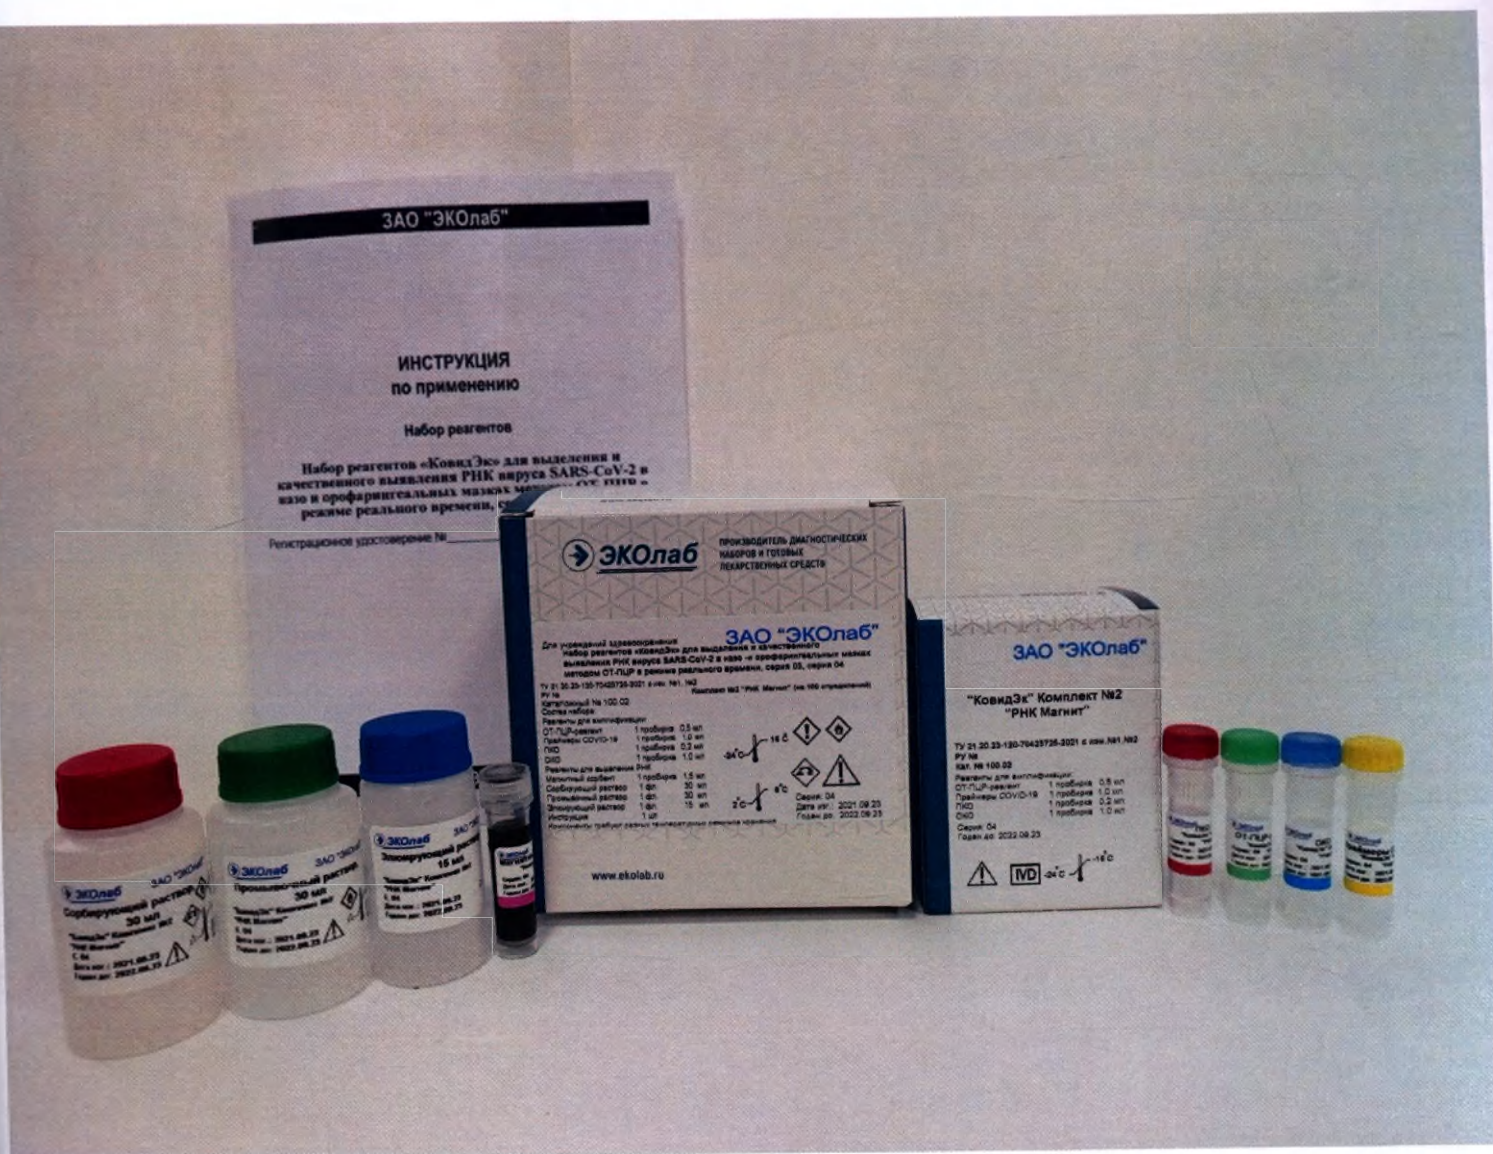

Борисов В.Ю.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

7 лист *ав*
Зам. Ген. директора ЗАО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю.
"15" 11 2021 г.