

Внешний вид (комплектаций по № РД-15000/79949 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови
(ХЛОРИДЫ ДДС)

Вариант 1, Комплектация 1



Внешний вид (комплектаций по № РД-15000/79949 от 22.12.2016)

Набора реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови
(ХЛОРИДЫ ДДС)

ант 1, Комплектация 2

ХЛОРИДЫ ДДС
Реагент 100 мл
Серия: 0010521
Годен до: 15.11.2022
15.11.2022
IVD IEC A
АО "ДИАКОН-ДС"

ХЛОРИДЫ ДДС
Реагент 100 мл
Серия: 0010521
Годен до: 15.11.2022
15.11.2022
IVD IEC A
АО "ДИАКОН-ДС"

ХЛОРИДЫ ДДС
Реагент 100 мл
Серия: 0010521
Годен до: 15.11.2022
15.11.2022
IVD IEC A
АО "ДИАКОН-ДС"

ХЛОРИДЫ ДДС
Серия 0010521
Изготовлено: 15.05.2021
Годен до: 15.11.2022

ХЛОРИДЫ ДДС
Набор реагентов для количественного определения
содержания хлоридов в сыворотке крови
(ХЛОРИДЫ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-015-48813770-2016
РУ № ФСР 2007/00440 от 15.11.2022

300 мл
Кат № 10 238
Серия 0010521

Реагент: 3 флакона (по 100 мл)
Калибратор: 2 флакона (по 3,0 мл)

CE IVD IEC A 15.11.2022

EC REP CEpartner4U, ESDOORN LAAN 13,
1951 DB MAAK, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.eu


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИАКОН-ДС" (АО "ДИАКОН-ДС"),
Россия, 142290, Московская область,
г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а

ХЛОРИДЫ ДДС
Калибратор
Серия 0010521
Годен до: 15.11.2022


ХЛОРИДЫ ДДС
Калибратор
Серия 0010521
Годен до: 15.11.2022

Внешний вид (комплектаций по № РД-15000/79949 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови
(ХЛОРИДЫ ДДС)

ант 1, Комплектация 3

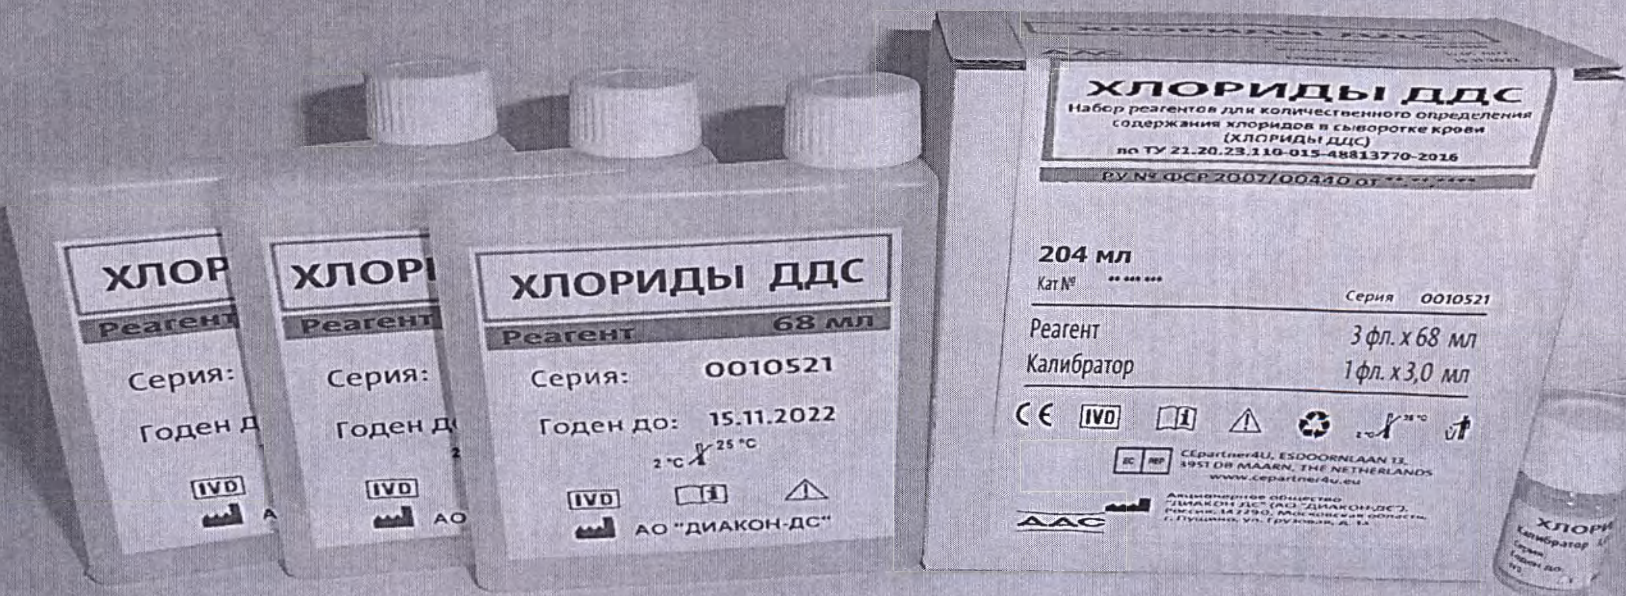


ант 1, Комплектація 4




Внешний вид (комплектаций по № РД-15000/79949 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови
(ХЛОРИДЫ ДДС)

лнт 1, Комплектация 5

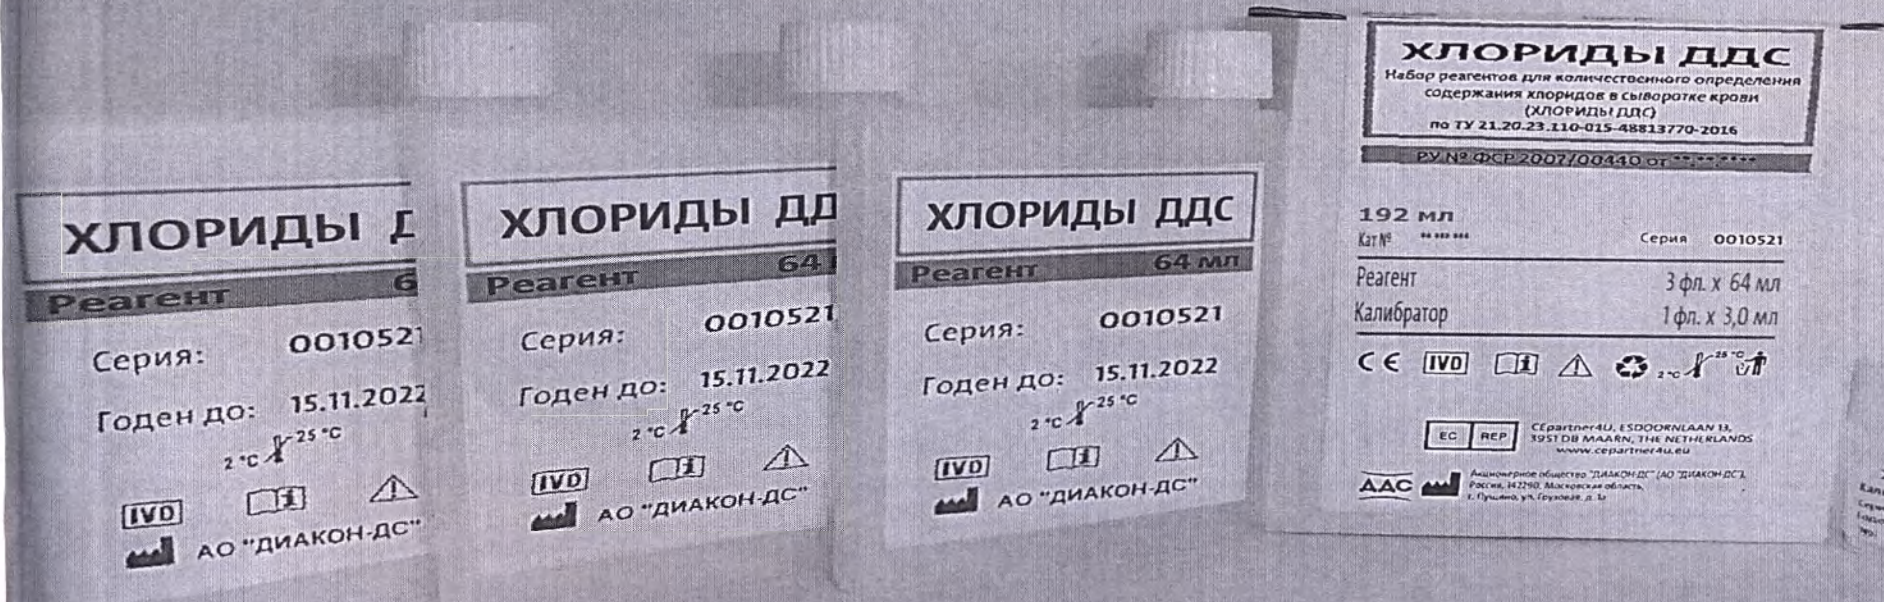


Внешний вид (комплектаций по № РД-15000/79949 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови
(ХЛОРИДЫ ДДС)

Вариант 1, Комплектация 6

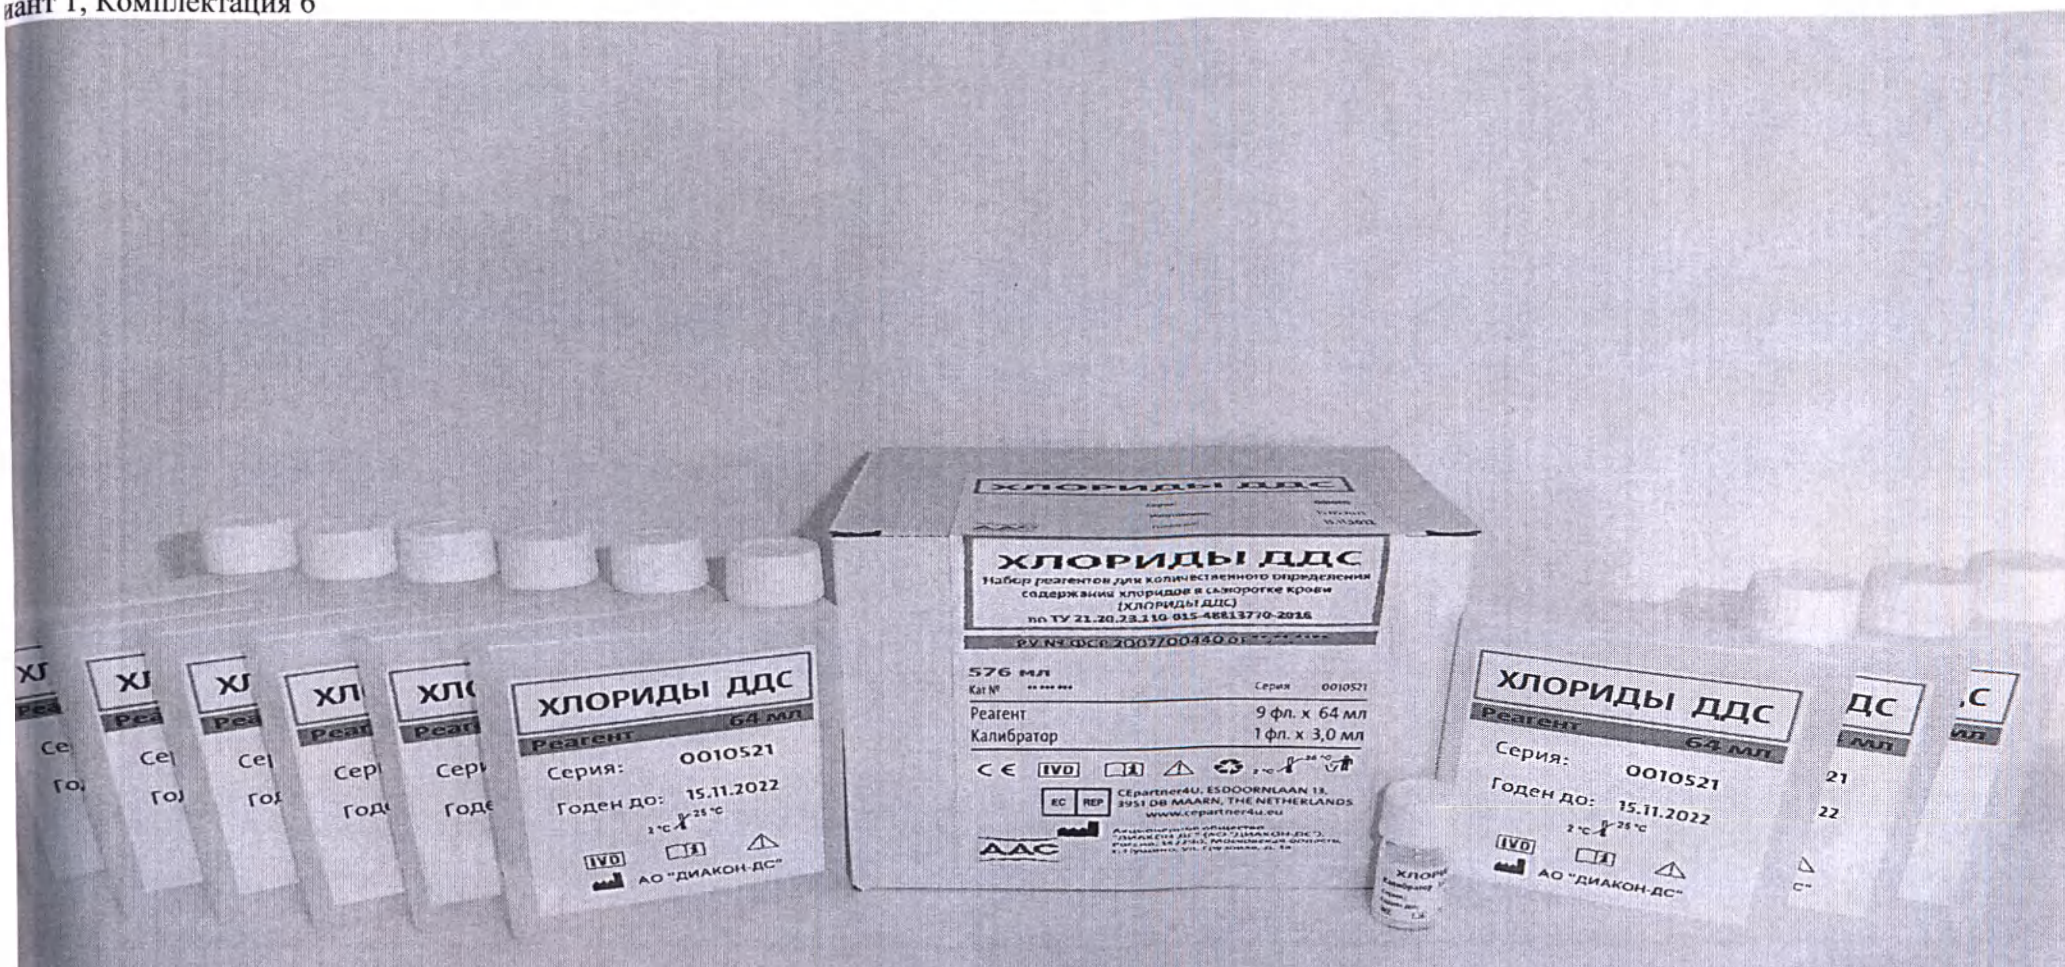

Внешний вид (комплектаций по № РД-15000/79949 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови
(ХЛОРИДЫ ДДС)

АНТ 1, Комплектация 7

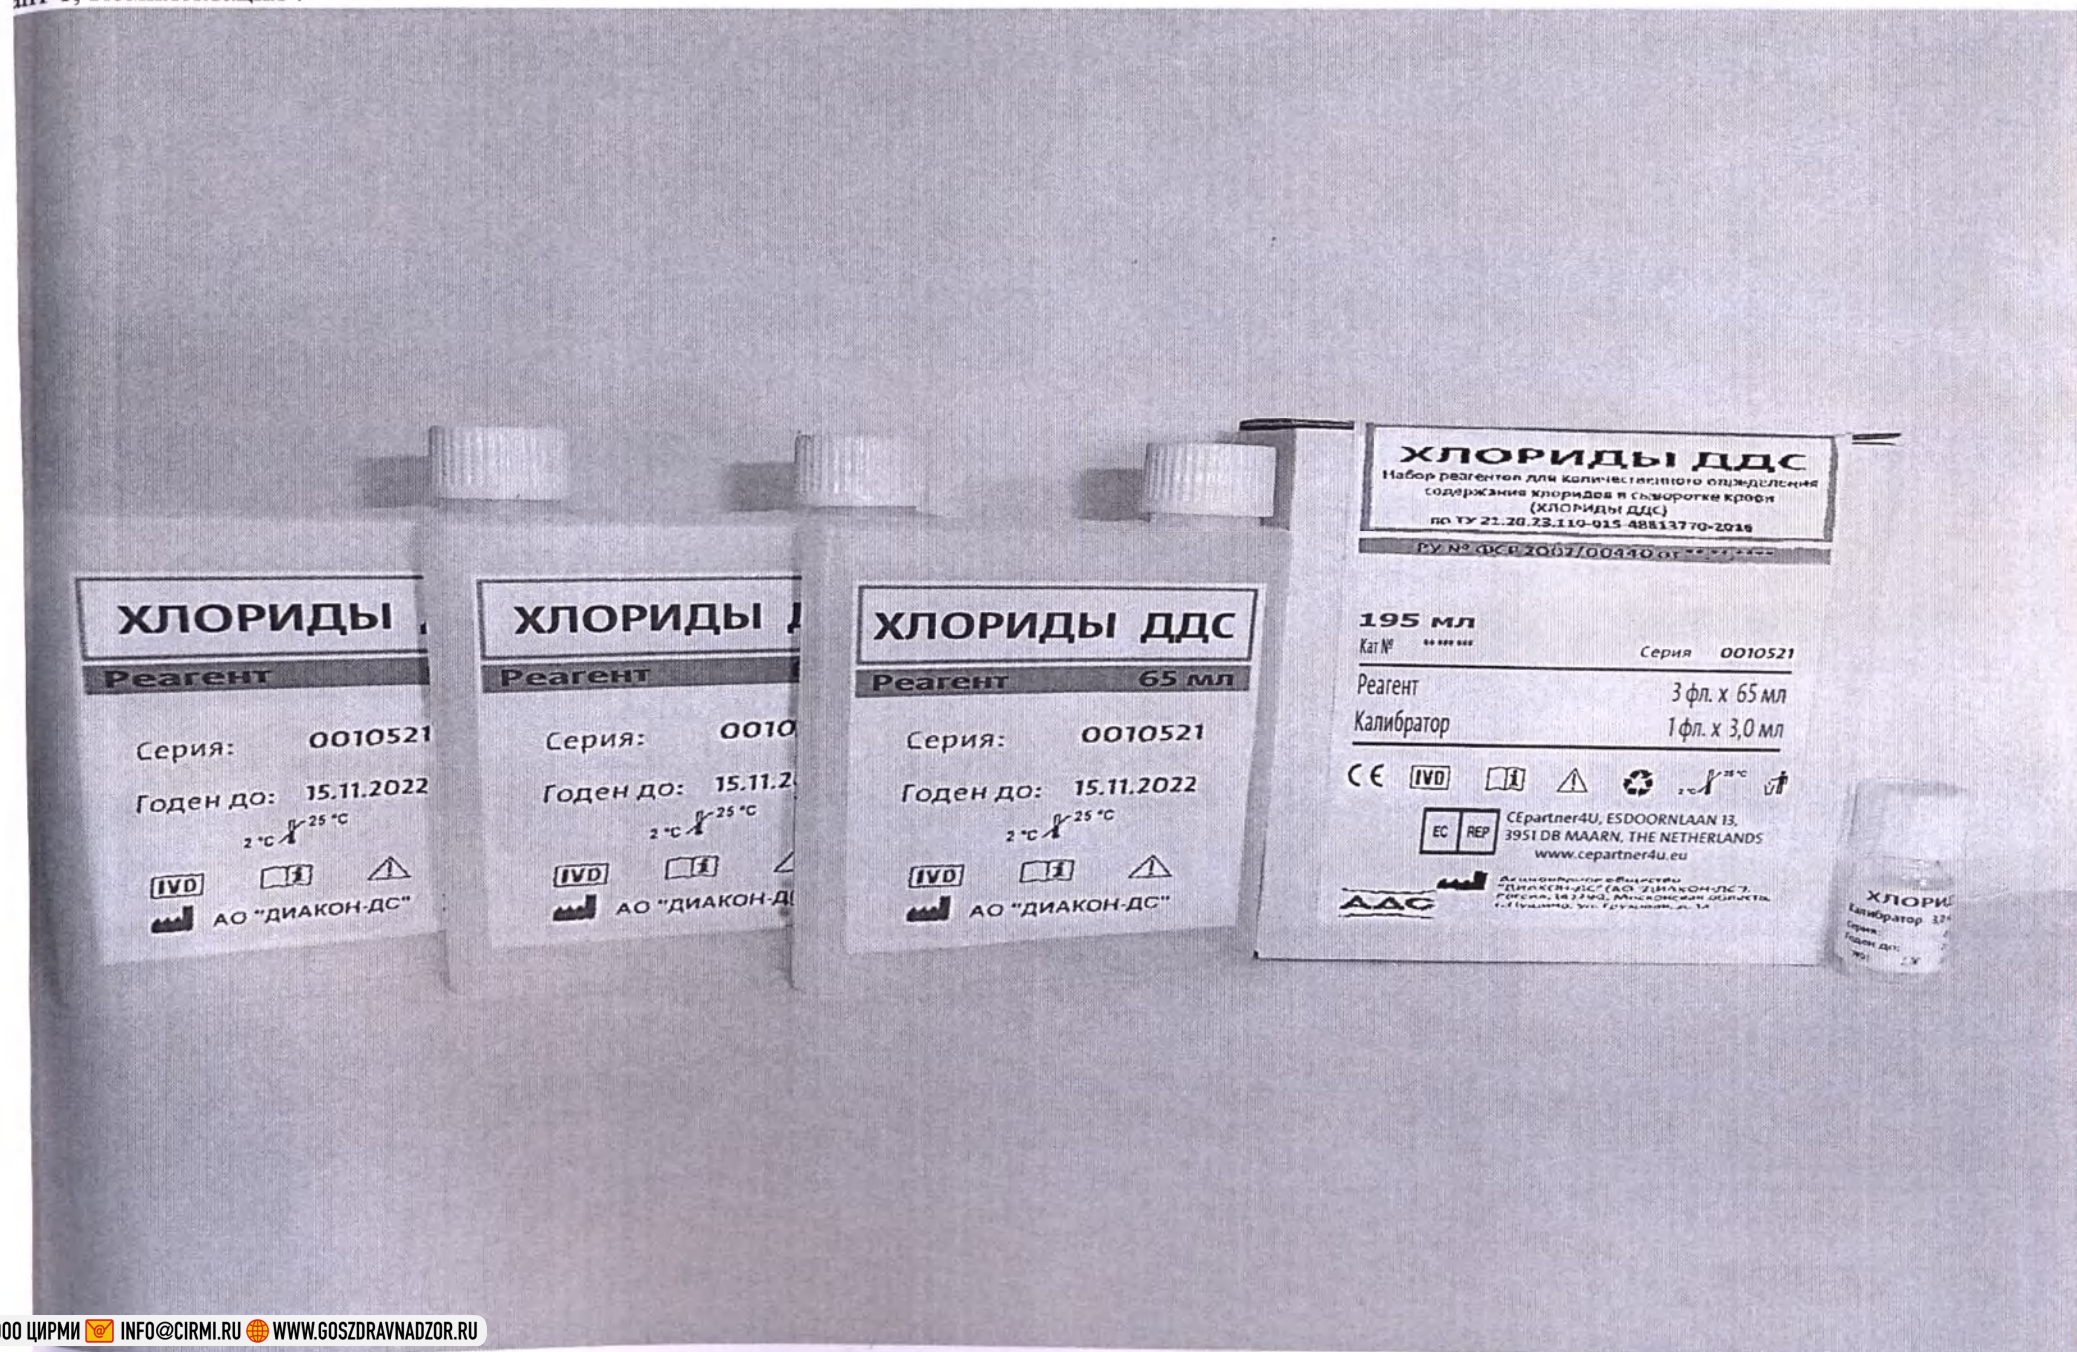


Внешний вид (комплектаций по № РД-15000/79949 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови
(ХЛОРИДЫ ДДС)

ИНТ 1, Комплектация 8



Внешний вид (комплектаций по № РД-15000/79949 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови
(ХЛОРИДЫ ДДС)

Вариант 1, Комплектация 9

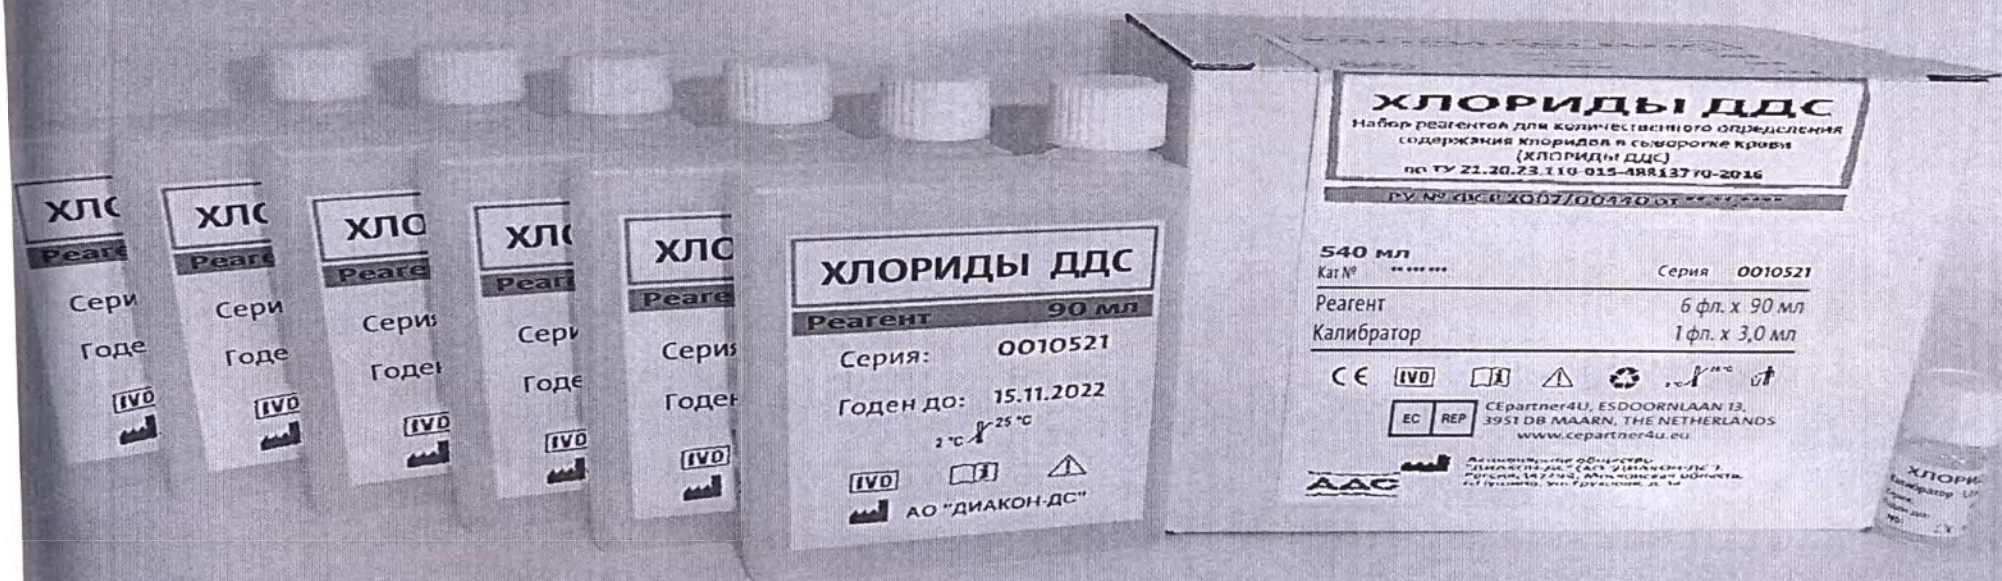

Внешний вид (комплектаций по № РД-15000/79949 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови
(ХЛОРИДЫ ДДС)

Лист 1, Комплектация 10

ХЛО
Реагент
Серия:
Годен до:

ХЛОРИДЫ ДДС
Реагент 66 мл
Серия: 0010521
Годен до: 15.11.2022
2°C - 25°C
IVD
АО "ДИАКОН-ДС"

ХЛОРИДЫ ДДС
Набор реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови (ХЛОРИДЫ ДДС) по ТУ 21.20.23.110-015-48813770-2016
RU № ФСР 2007/00440 от
264 мл
Кат. №
Серия 0010521
Реагент 4 фл. х 66 мл
Калибратор 1 фл. х 3,0 мл
CE IVD
Серия: 0010521
Годен до: 15.11.2022
IVD
АО "ДИАКОН-ДС"

ХЛОРИДЫ ДДС
Реагент 66 мл
Серия: 0010521
Годен до: 15.11.2022
2°C - 25°C
IVD
АО "ДИАКОН-ДС"

ДДС
66 мл
Серия: 0010521
Годен до: 15.11.2022
IVD
АО "ДИАКОН-ДС"

ХЛОРИДЫ ДДС
Калибратор 3,0 мл
Серия: 0010521
Годен до: 15.11.2022
IVD
АО "ДИАКОН-ДС"




Внешний вид (комплектаций по № РД-15000/79949 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови
(ХЛОРИДЫ ДДС)

риант 1, Комплектация 11




Внешний вид (комплектаций по № РД-15000/79949 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови
(ХЛОРИДЫ ДДС)

Вариант 1, Комплектация 12

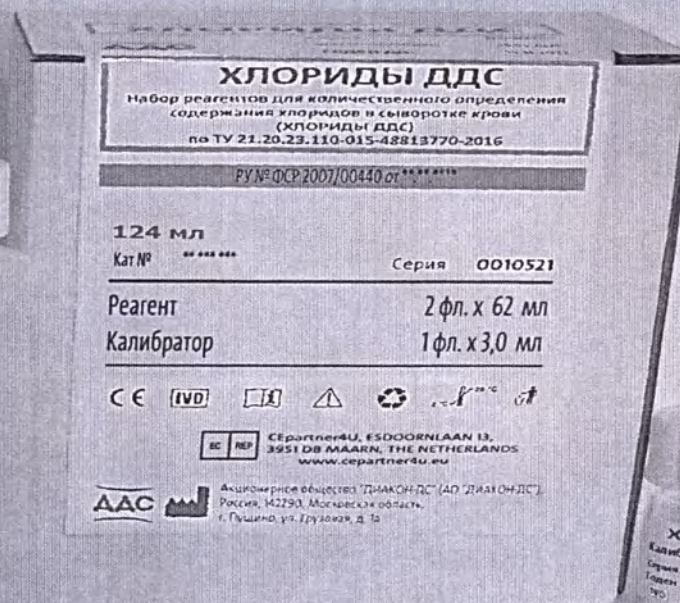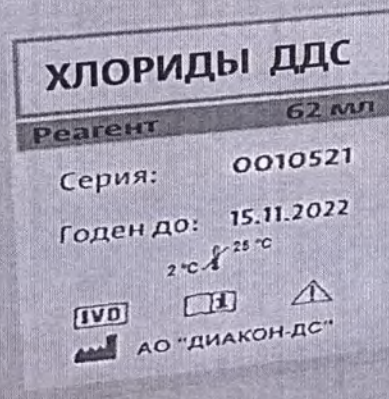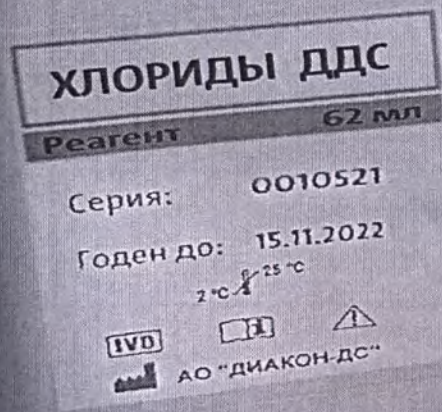


Внешний вид (комплектаций по № РД-15000/79949 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови
(ХЛОРИДЫ ДДС)

Вариант 1, Комплектация 13

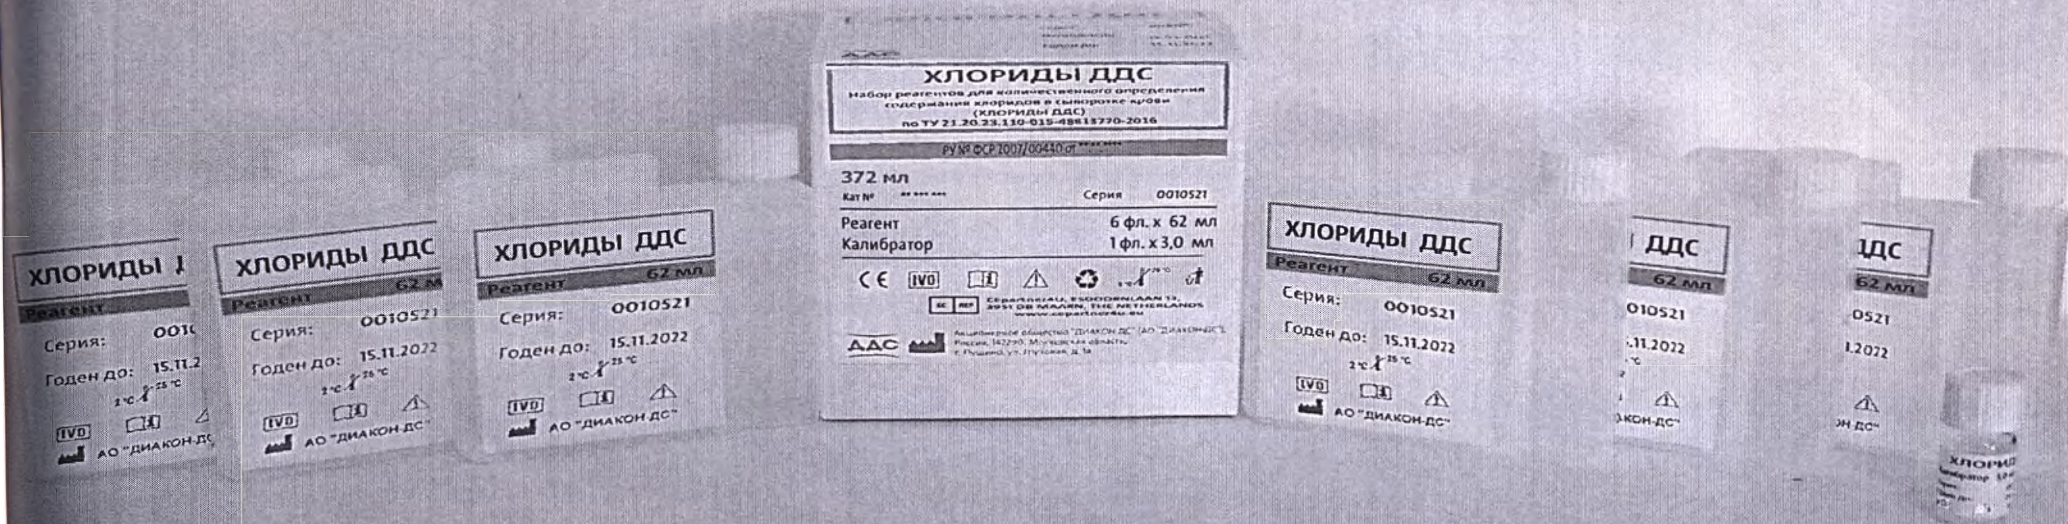

Внешний вид (комплектаций по № РД-15000/79949 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови
(ХЛОРИДЫ ДДС)

Вариант 1, Комплектация 14

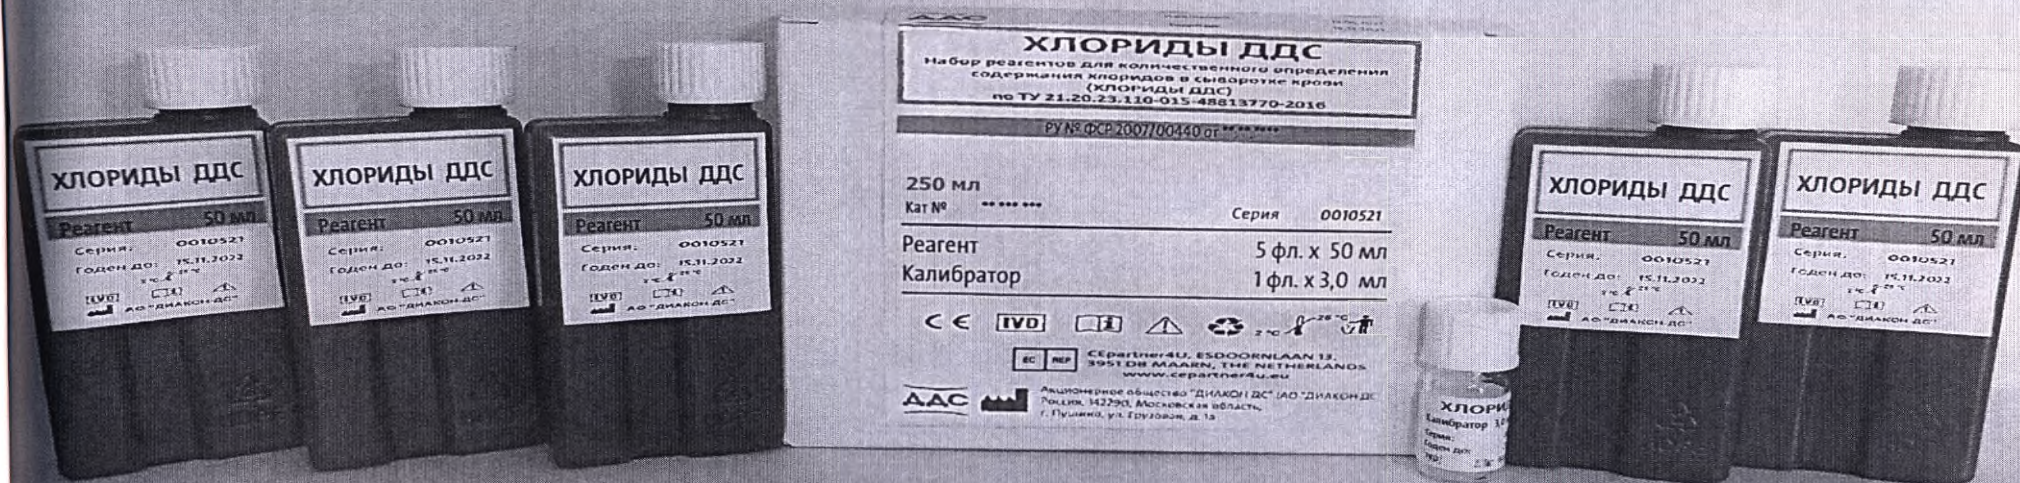

Внешний вид (комплектаций по № РД-15000/79949 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови
(ХЛОРИДЫ ДДС)

Вариант 1, Комплектация 15



Внешний вид (комплектаций по № РД-15000/79949 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови
(ХЛОРИДЫ ДДС)

риант 1, Комплектация 16




Внешний вид (комплектаций по № РД-15000/79949 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови
(ХЛОРИДЫ ДДС)

риант 1, Комплектация 17



Внешний вид (комплектаций по № РД-15000/79949 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови
(ХЛОРИДЫ ДДС)

вариант 1, Комплектация 18

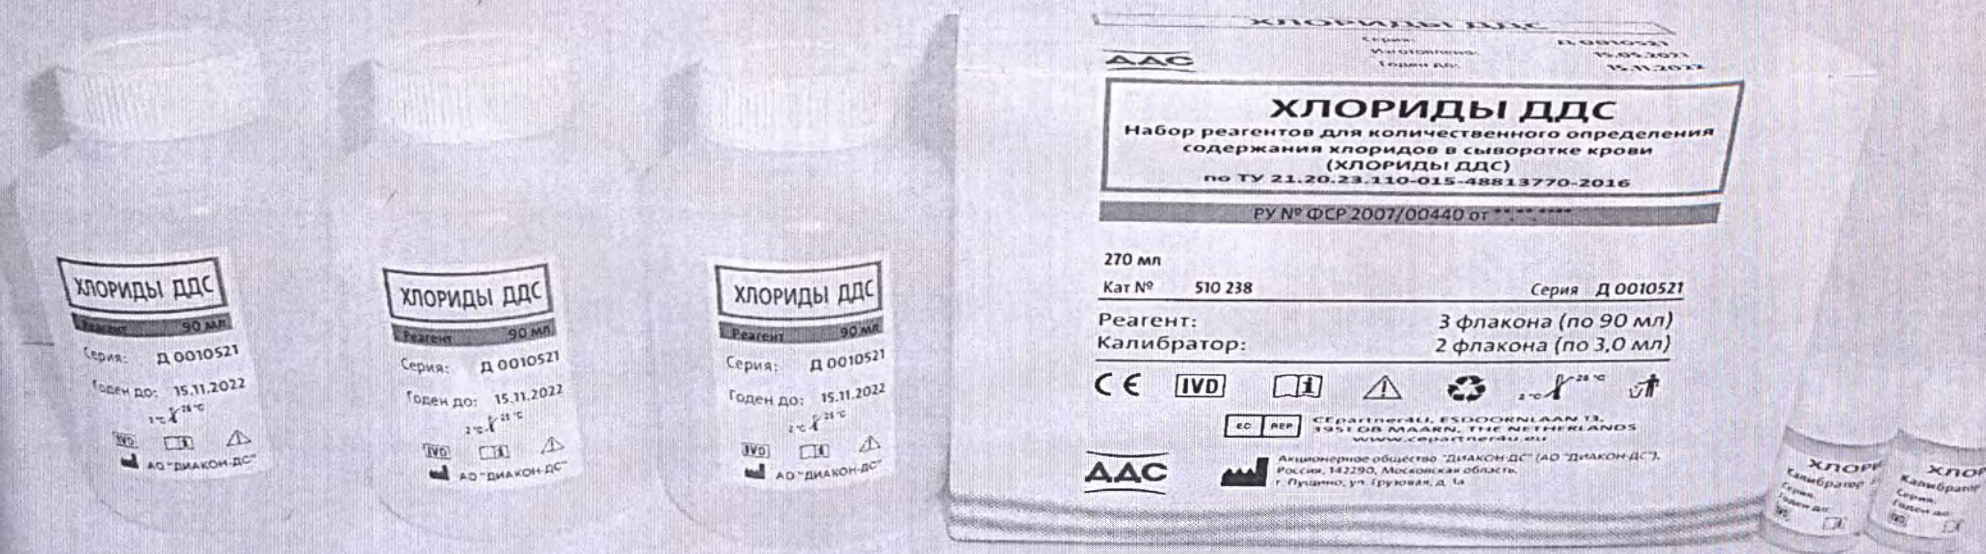


Внешний вид (комплектаций по № РД-15000/79949 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови
(ХЛОРИДЫ ДДС)

риант 1, Комплектация 19




Внешний вид (комплектаций по № РД-15000/79949 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови
(ХЛОРИДЫ ДДС)

риант 1, Комплектация 20

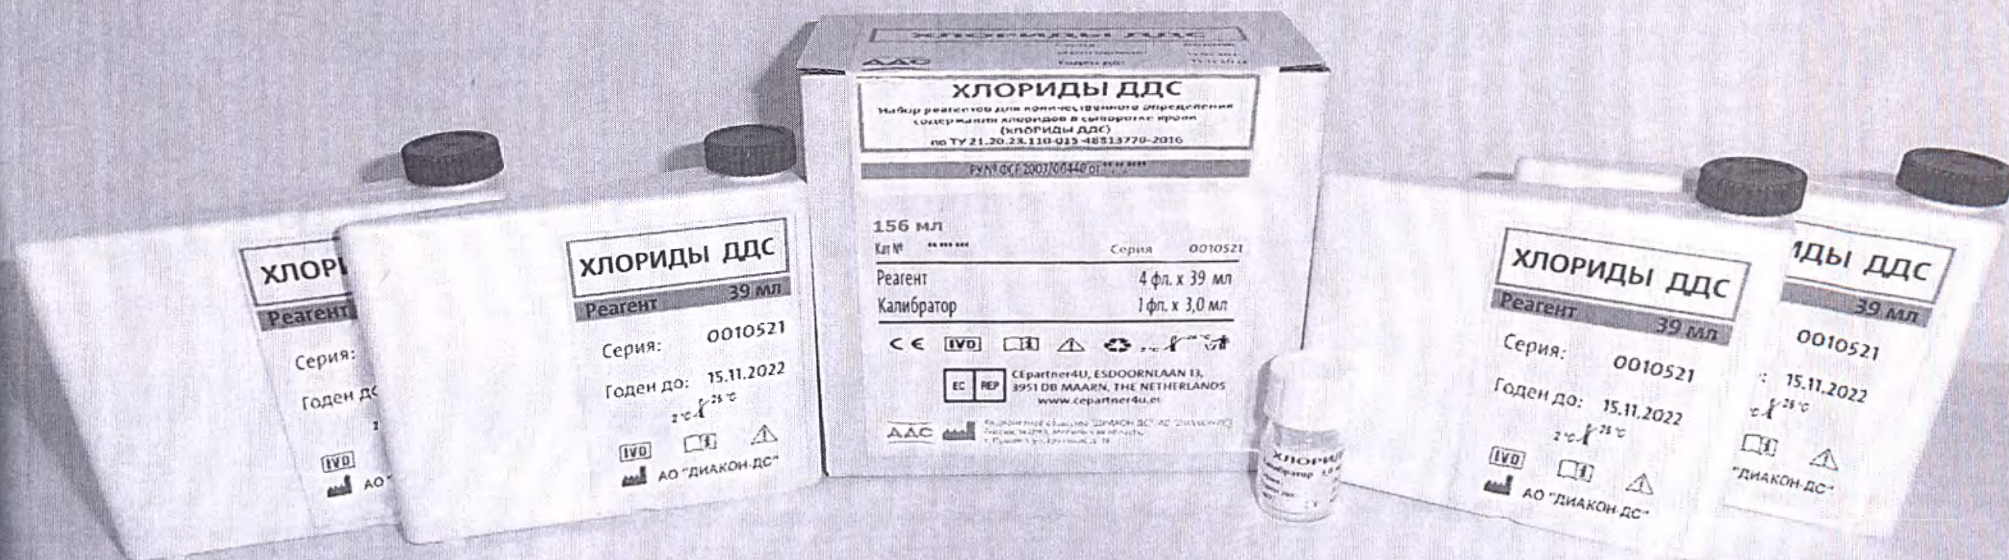

Внешний вид (комплектаций по № РД-15000/79949 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови
(ХЛОРИДЫ ДДС)

риант 1, Комплектация 21

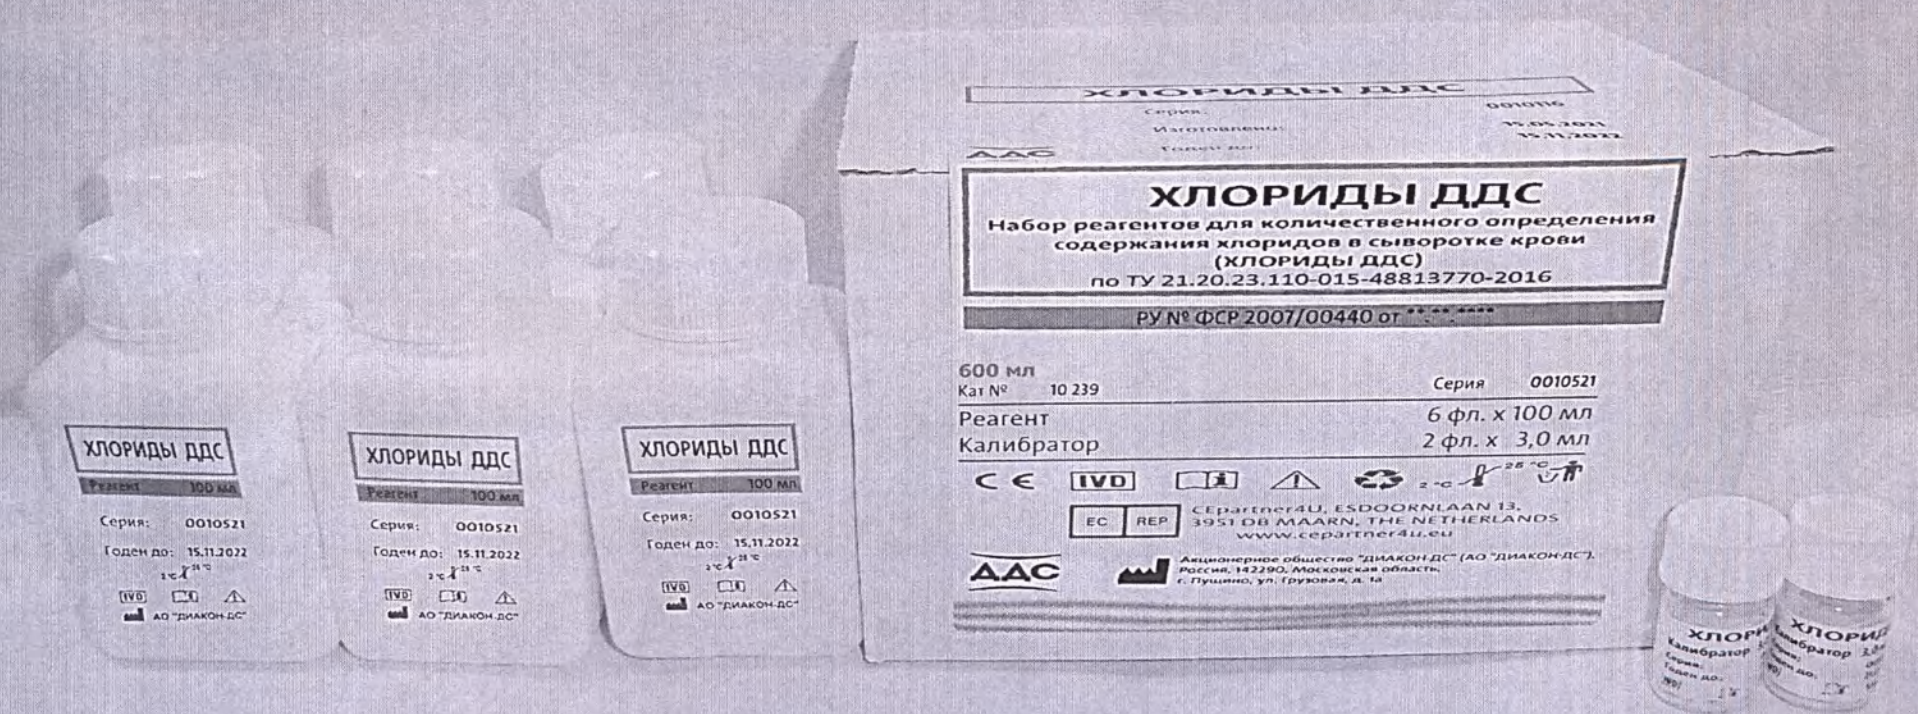

Внешний вид (комплектаций по № РД-15000/79949 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови
(ХЛОРИДЫ ДДС)

вариант 1, Комплектация 22



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 22
Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»




Т.Ю. Корзун

Внешний вид


Набора реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови (ХЛОРИДЫ ДДС)

Вариант 1, Комплектация 23

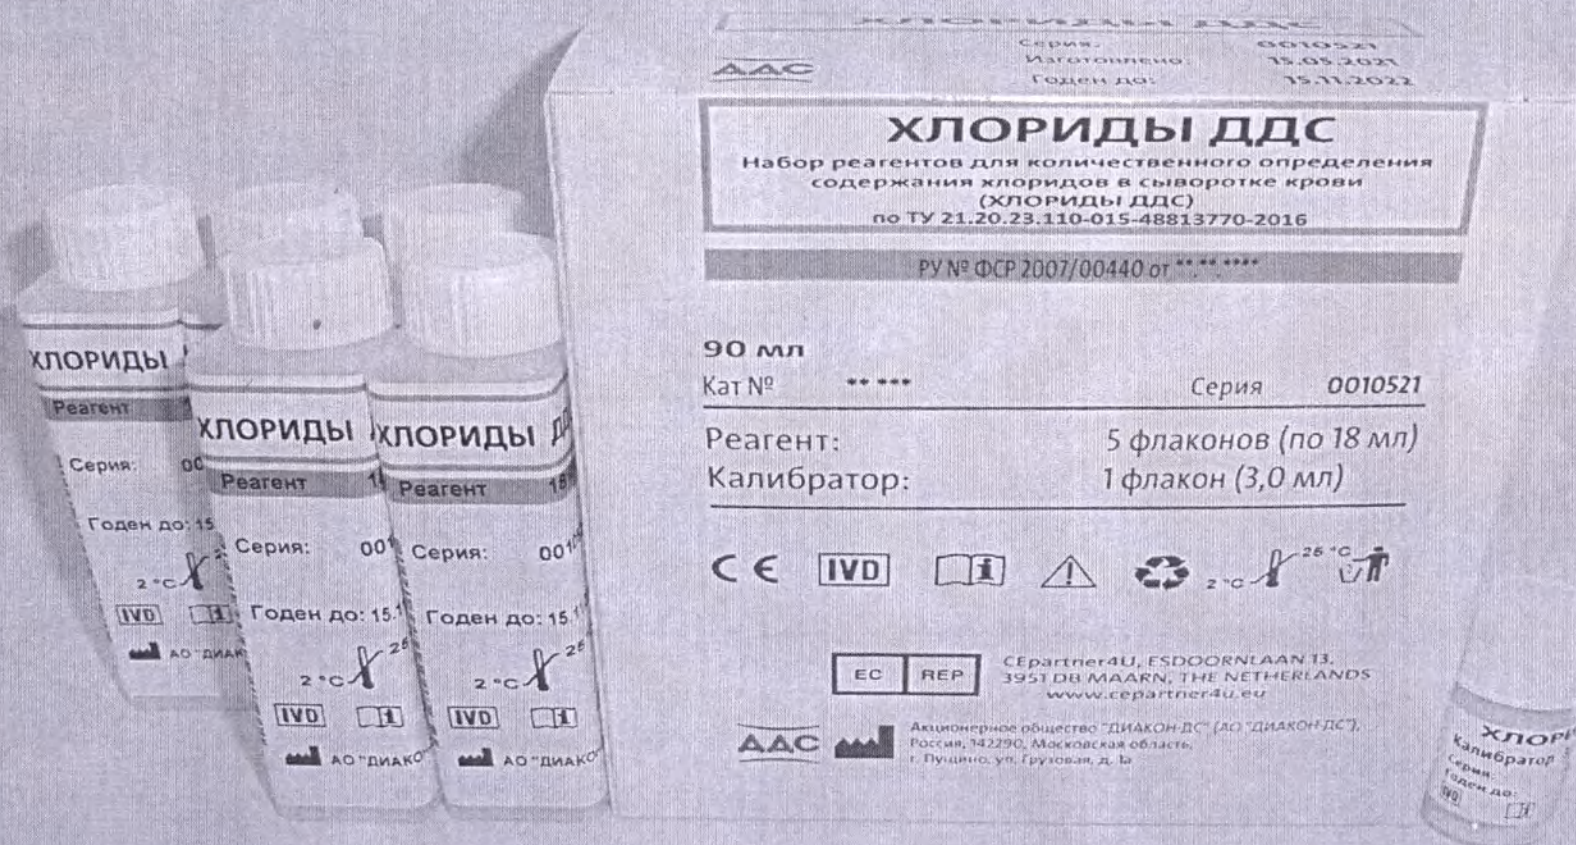


Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови
(ХЛОРИДЫ ДДС)

вариант 1, Комплектация 24

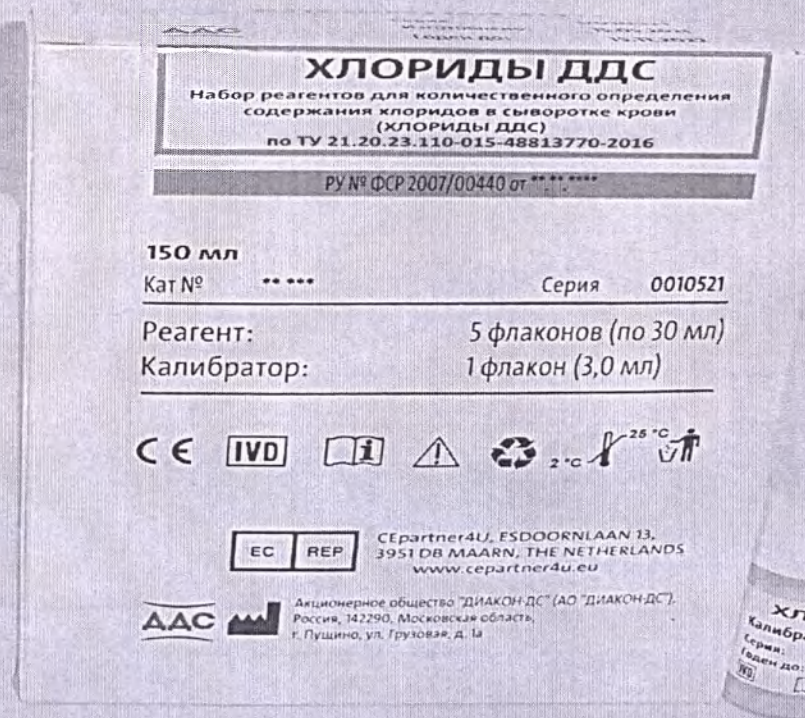


Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови
(ХЛОРИДЫ ДДС)


вариант 2, Комплектация 1

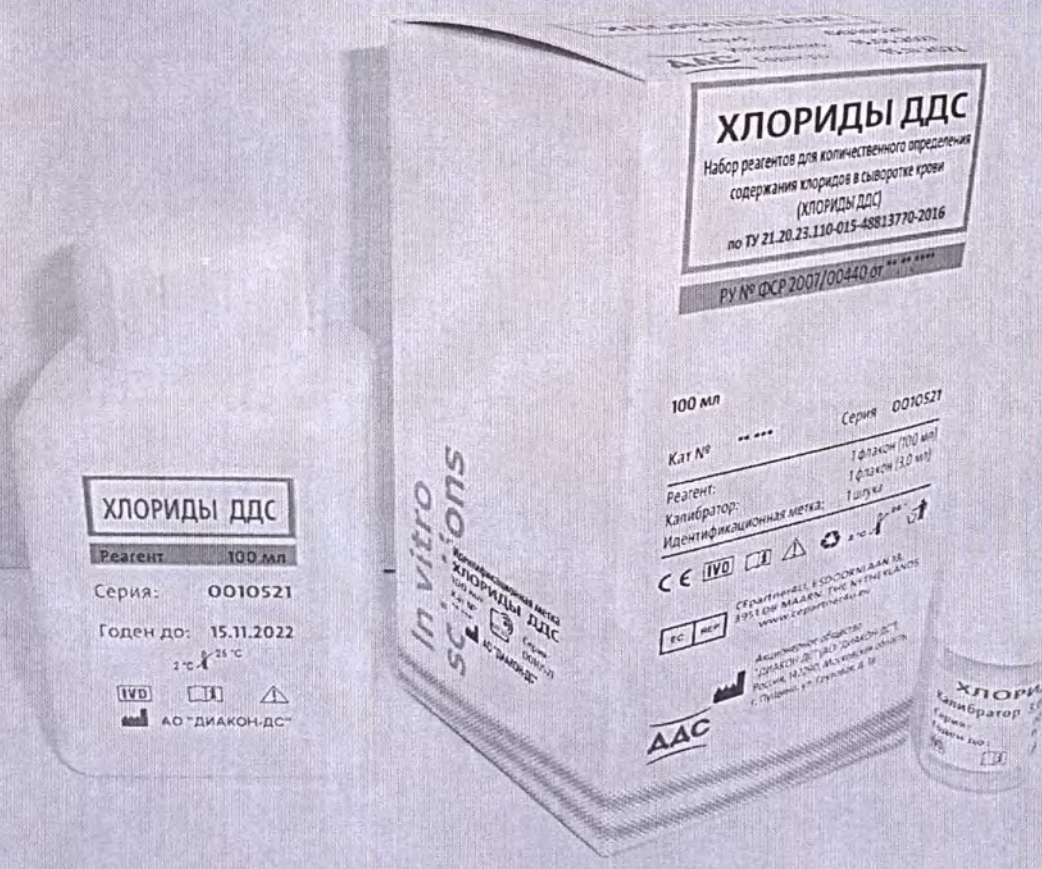

Внешний вид
Набора реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови
(ХЛОРИДЫ ДДС)

вариант 2, Комплектация 2

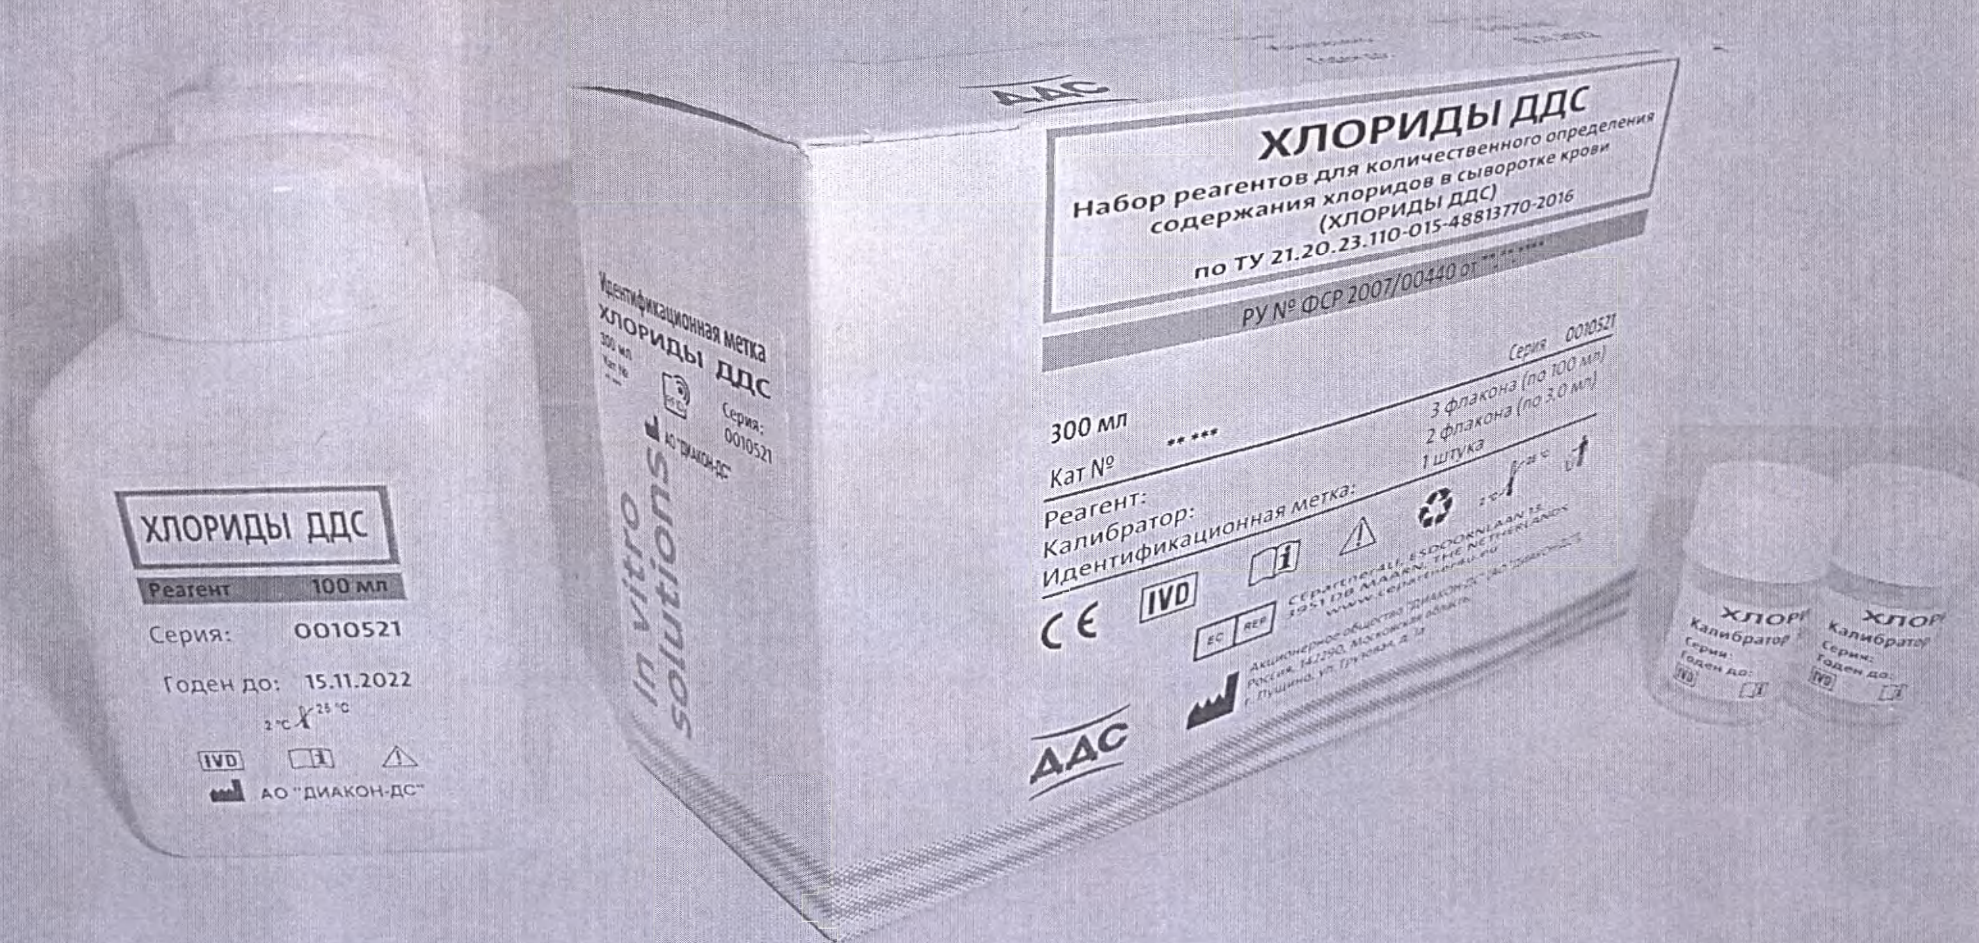

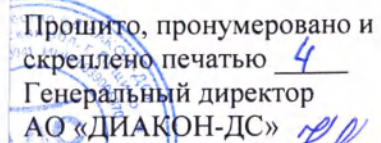

ООО ЦРПМ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU