



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 октября 2022 года № РЗН 2022/18698

На медицинское изделие

Эндоскопы жесткие PRECISION 4K

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Страйкер"

(ООО "Страйкер"), Россия,

125167, Москва, Ленинградский пр-кт, д. 39, стр. 80, этаж 3, ч. помещ. 1

Производитель

"Страйкер Эндоскопи", США,

Stryker Endoscopy, 5900 Optical Court, San Jose CA 95138, USA

Место производства медицинского изделия

Henke-Sass, Wolf GmbH, Keltenstrasse 1, 78532 Tuttlingen, Germany

Номер регистрационного досье № РД-45835/84508 от 06.12.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.13.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 12 листах



приказом Росздравнадзора от 31 октября 2022 года № 10295  
допущено к обращению на территории Российской Федерации  
Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0068567

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 октября 2022 года № РЗН 2022/18698

Лист 1

На медицинское изделие

**Эндоскопы жесткие PRECISION 4K**, варианты исполнения:

1. Артроскоп Precision IE 4K, варианты исполнения:

1.1. Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 1,9 мм х 0°, 58 мм,  
с J-образным фиксатором, в составе:

- Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 1,9 мм х 0°, 58 мм, с J-образным  
фиксатором - 1 шт.;

- Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;

- Адаптер Storz - 1 шт.;

- Адаптер ACMI - 1 шт.;

- Полировочная паста - 1 уп.;

- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

1.2. Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 1,9 мм х 30°, 58 мм,  
с J-образным фиксатором, в составе:

- Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 1,9 мм х 30°, 58 мм,  
с J-образным фиксатором - 1 шт.;

- Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;

- Адаптер Storz - 1 шт.;

- Адаптер ACMI - 1 шт.;

- Полировочная паста - 1 уп.;

- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

1.3. Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 1,9 мм х 30°, 58 мм, с фиксатором  
Speed-Lock, в составе:

- Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 1,9 мм х 30°, 58 мм с фиксатором  
Speed-Lock - 1 шт.;

- Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;

- Адаптер Storz - 1 шт.;

- Адаптер ACMI - 1 шт.;

- Полировочная паста - 1 уп.;

- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

1.4. Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,4 мм х 0°, 72 мм,  
с J-образным фиксатором, в составе:

- Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,4 мм х 0°, 72 мм, с J-образным  
фиксатором - 1 шт.;

- Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;

- Адаптер Storz - 1 шт.;

- Адаптер ACMI - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0110631

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 октября 2022 года № РЗН 2022/18698

Лист 2

- Полировочная паста - 1 уп.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 1.5. Артроскоп Precision IE 4К с С-образным креплением 2,4 мм x 30°, 72 мм, с J-образным фиксатором, в составе:
  - Артроскоп Precision IE 4К с С-образным креплением 2,4 мм x 30°, 72 мм, с J-образным фиксатором - 1 шт.;
  - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
  - Адаптер Storz - 1 шт.;
  - Адаптер ACMI - 1 шт.;
- Полировочная паста - 1 уп.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 1.6 Артроскоп Precision IE 4К с С-образным креплением 2,4 мм x 70°, 72 мм, с J-образным фиксатором, в составе:
  - Артроскоп Precision IE 4К с С-образным креплением 2,4 мм x 70°, 72 мм, с J-образным фиксатором - 1 шт.;
  - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
  - Адаптер Storz - 1 шт.;
  - Адаптер ACMI - 1 шт.;
- Полировочная паста - 1 уп.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 1.7 Артроскоп Precision IE 4К с С-образным креплением 2,4 мм x 30°, 72 мм, с J-образным фиксатором, с обратным наклоном, в составе:
  - Артроскоп Precision IE 4К с С-образным креплением 2,4 мм x 30°, 72 мм, с J-образным фиксатором, с обратным наклоном - 1 шт.
  - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.
  - Адаптер Storz - 1 шт.
  - Адаптер ACMI - 1 шт.
- Полировочная паста - 1 уп.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 1.8. Артроскоп Precision IE 4К с С-образным креплением 2,4 мм x 30°, 72 мм, с фиксатором Speed-Lock, в составе:
  - Артроскоп Precision IE 4К с С-образным креплением 2,4 мм x 30°, 72 мм, с фиксатором Speed-Lock - 1 шт.;
  - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
  - Адаптер Storz - 1 шт.;
  - Адаптер ACMI - 1 шт.;
- Полировочная паста - 1 уп.;

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0110632

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 октября 2022 года № РЗН 2022/18698

Лист 3

- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
  - 1.9. Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм х 0°, 120 мм, с фиксатором Speed-Lock, в составе:
    - Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм х 0°, 120 мм, с фиксатором Speed-Lock - 1 шт.
    - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
    - Адаптер Storz - 1 шт.;
    - Адаптер ACMI - 1 шт.;
    - Полировочная паста - 1 уп.;
    - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
  - 1.10. Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм х 30°, 120 мм, с фиксатором Speed-Lock, в составе:
    - Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм х 30°, 120 мм, с фиксатором Speed-Lock - 1 шт.
    - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
    - Адаптер Storz - 1 шт.;
    - Адаптер ACMI - 1 шт.;
    - Полировочная паста - 1 уп.;
    - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
  - 1.11. Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм х 70°, 120 мм, с фиксатором Speed-Lock, в составе:
    - Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм х 70°, 120 мм, с фиксатором Speed-Lock - 1 шт.;
    - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
    - Адаптер Storz - 1 шт.;
    - Адаптер ACMI - 1 шт.;
    - Полировочная паста - 1 уп.;
    - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
  - 1.12. Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм х 0°, 75 мм, с J-образным фиксатором, в составе:
    - Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм х 0°, 75 мм, с J-образным фиксатором - 1 шт.;
    - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
    - Адаптер Storz - 1 шт.;
    - Адаптер ACMI - 1 шт.;
    - Полировочная паста - 1 уп.;
    - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0110633

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 октября 2022 года № РЗН 2022/18698

Лист 4

1.13. Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм x 30°, 75 мм, с J-образным фиксатором, в составе:

- Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм x 30°, 75 мм, с J-образным фиксатором - 1 шт.;
- Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
- Адаптер Storz - 1 шт.;
- Адаптер ACMI - 1 шт.;
- Полировочная паста - 1 уп.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

1.14. Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм x 70°, 75 мм, с J-образным фиксатором, в составе:

- Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм x 70°, 75 мм, с J-образным фиксатором - 1 шт.;
- Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
- Адаптер Storz - 1 шт.;
- Адаптер ACMI - 1 шт.;
- Полировочная паста - 1 уп.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

1.15. Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм x 30°, 75 мм, с J-образным фиксатором, с обратным наклоном, в составе:

- Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм x 30°, 75 мм, с J-образным фиксатором, с обратным наклоном - 1 шт.;
- Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
- Адаптер Storz - 1 шт.;
- Адаптер ACMI - 1 шт.;
- Полировочная паста - 1 уп.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

1.16. Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм x 30°, 75 мм, с фиксатором Speed-Lock, в составе:

- Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм x 30°, 75 мм, с фиксатором Speed-Lock - 1 шт.;
- Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
- Адаптер Storz - 1 шт.;
- Адаптер ACMI - 1 шт.;
- Полировочная паста - 1 уп.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

1.17. Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм x 70°, 75 мм, с фиксатором

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0110634

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 октября 2022 года № РЗН 2022/18698

Лист 5

Speed-Lock, в составе:

Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,7 мм х 70°, 75 мм, с фиксатором Speed-Lock - 1 шт.

- Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;

- Адаптер Storz - 1 шт.;

- Адаптер ACMI - 1 шт.;

- Полировочная паста - 1 уп.;

- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

1.18. Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,9 мм х 30°, 200 мм, с фиксатором Speed-Lock, в составе:

- Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 2,9 мм х 30°, 200 мм, с фиксатором Speed-Lock - 1 шт.;

- Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;

- Адаптер Storz - 1 шт.;

- Адаптер ACMI - 1 шт.;

- Полировочная паста - 1 уп.;

- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

1.19. Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 4 мм х 0°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock, в составе:

- Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 4 мм х 0°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock - 1 шт.;

- Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;

- Адаптер Storz - 1 шт.;

- Адаптер ACMI - 1 шт.;

- Полировочная паста - 1 уп.;

- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

1.20. Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 4 мм х 30°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock, в составе:

- Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 4 мм х 30°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock - 1 шт.;

- Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;

- Адаптер Storz - 1 шт.;

- Адаптер ACMI - 1 шт.;

- Полировочная паста - 1 уп.;

- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

1.21. Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 4 мм х 70°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock, в составе:

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0110635

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 октября 2022 года № РЗН 2022/18698

Лист 6

- Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 4 мм x 70°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock - 1 шт.;
  - Адаптер Wolf для конца эндоскопа (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
  - Адаптер Storz для конца эндоскопа - 1 шт.;
  - Адаптер ACMI для конца эндоскопа - 1 шт.;
  - Полировочная паста - 1 уп.;
  - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 1.22. Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 4 мм x 30°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock, с обратным наклоном, в составе:
- Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 4 мм x 30°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock, с обратным наклоном - 1 шт.;
  - Адаптер Wolf для конца эндоскопа (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
  - Адаптер Storz для конца эндоскопа - 1 шт.;
  - Адаптер ACMI для конца эндоскопа - 1 шт.;
  - Полировочная паста - 1 уп.;
  - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 1.23. Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 4 мм x 30°, 165 мм, с фиксатором Speed-Lock, в составе:
- Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 4 мм x 30°, 165 мм, с фиксатором Speed-Lock - 1 шт.;
  - Адаптер Wolf для конца эндоскопа (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
  - Адаптер Storz для конца эндоскопа - 1 шт.;
  - Адаптер ACMI для конца эндоскопа - 1 шт.;
  - Полировочная паста - 1 уп.;
  - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 1.24. Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 4 мм x 70°, 165 мм, с фиксатором Speed-Lock, в составе:
- Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 4 мм x 70°, 165 мм, с фиксатором Speed-Lock - 1 шт.;
  - Адаптер Wolf для конца эндоскопа (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
  - Адаптер Storz для конца эндоскопа - 1 шт.;
  - Адаптер ACMI для конца эндоскопа - 1 шт.;
  - Полировочная паста - 1 уп.;
  - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 1.25. Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 4 мм x 30°, 165 мм, с фиксатором Speed-Lock, с обратным наклоном, в составе:
- Артроскоп Precision IE 4K с С-образным креплением 4 мм x 30°, 165 мм, с фиксатором Speed-Lock, с обратным наклоном - 1 шт.;
- Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0116207

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 октября 2022 года № РЗН 2022/18698

Лист 7

- Speed-Lock, с обратным наклоном - 1 шт.;
- Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
  - Адаптер Storz - 1 шт.;
  - Адаптер ACMI - 1 шт.;
  - Полировочная паста - 1 уп.;
  - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

1.26. Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм x 0°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock, в составе:

- Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм x 0°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock - 1 шт.;
- Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
- Адаптер Storz - 1 шт.;
- Адаптер ACMI для - 1 шт.;
- Полировочная паста - 1 уп.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

1.27. Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм x 30°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock, в составе:

- Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм x 30°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock - 1 шт.;
- Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
- Адаптер Storz - 1 шт.;
- Адаптер ACMI - 1 шт.;
- Полировочная паста - 1 уп.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

1.28. Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм x 45°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock, в составе:

- Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм x 45°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock - 1 шт.;
- Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
- Адаптер Storz - 1 шт.;
- Адаптер ACMI - 1 шт.;
- Полировочная паста - 1 уп.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

1.29. Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм x 70°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock, в составе:

- Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм x 70°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock - 1 шт.;
- Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
- Адаптер Storz - 1 шт.;
- Адаптер ACMI - 1 шт.;
- Полировочная паста - 1 уп.;

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0110637

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 октября 2022 года № РЗН 2022/18698

Лист 8

- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
  - 1.30. Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм x 30°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock, с обратным наклоном, в составе:
    - Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм x 30°, 140 мм, с фиксатором Speed-Lock, с обратным наклоном - 1 шт.;
    - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
    - Адаптер Storz - 1 шт.;
    - Адаптер ACMI - 1 шт.;
    - Полировочная паста - 1 уп.;
    - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
  - 1.31. Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм x 0°, 165 мм, с фиксатором Speed-Lock, в составе:
    - Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм x 0°, 165 мм, с фиксатором Speed-Lock - 1 шт.;
    - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
    - Адаптер Storz - 1 шт.;
    - Адаптер ACMI - 1 шт.;
    - Полировочная паста - 1 уп.;
    - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
  - 1.32. Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм x 30°, 165 мм, с фиксатором Speed-Lock, в составе:
    - Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм x 30°, 165 мм, с фиксатором Speed-Lock - 1 шт.;
    - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
    - Адаптер Storz - 1 шт.;
    - Адаптер ACMI - 1 шт.;
    - Полировочная паста - 1 уп.;
    - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
  - 1.33. Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм x 70°, 165 мм, с фиксатором Speed-Lock, в составе:
    - Артроскоп Precision IE 4K с окуляром 4 мм x 70°, 165 мм, с фиксатором Speed-Lock - 1 шт.;
    - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
    - Адаптер Storz - 1 шт.;
    - Адаптер ACMI - 1 шт.;
    - Полировочная паста - 1 уп.;
    - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
  - 2. Синускоп Precision S 4K, варианты исполнения:
    - 2.1. Синускоп Precision S 4K 3,1 мм x 0°, 170 мм, в составе:
      - Синускоп Precision S 4K 3,1 мм x 0°, 170 мм - 1 шт.;
- Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0110638


**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 октября 2022 года № РЗН 2022/18698

Лист 9

- Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
  - Адаптер Storz - 1 шт.;
  - Адаптер АСМІ - 1 шт.;
  - Полировочная паста - 1 уп.;
  - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.2. Синускоп Precision S 4К 3,1 мм x 30°, 170 мм, в составе:
- Синускоп Precision S 4К 3,1 мм x 30°, 170 мм - 1 шт.;
  - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
  - Адаптер Storz - 1 шт.;
  - Адаптер АСМІ - 1 шт.;
  - Полировочная паста - 1 уп.;
  - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.3. Синускоп Precision S 4К 3,1 мм x 45°, 170 мм, в составе:
- Синускоп Precision S 4К 3,1 мм x 45°, 170 мм - 1 шт.;
  - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
  - Адаптер Storz - 1 шт.;
  - Адаптер АСМІ - 1 шт.;
  - Полировочная паста - 1 уп.;
  - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.4. Синускоп Precision S 4К 3,1 мм x 70°, 170 мм, в составе:
- Синускоп Precision S 4К 3,1 мм x 70°, 170 мм - 1 шт.;
  - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
  - Адаптер Storz - 1 шт.;
  - Адаптер АСМІ - 1 шт.;
  - Полировочная паста - 1 уп.;
  - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.5. Синускоп Precision S 4К 3,1 мм x 30°, 170 мм, с обратным наклоном, в составе:
- Синускоп Precision S 4К 3,1 мм x 30°, 170 мм, с обратным наклоном - 1 шт.;
  - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
  - Адаптер Storz - 1 шт.;
  - Адаптер АСМІ - 1 шт.;
  - Полировочная паста - 1 уп.;
  - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.6. Синускоп Precision S 4К 3,1 мм x 45°, 170 мм, с обратным наклоном, в составе:
- Синускоп Precision S 4К 3,1 мм x 45°, 170 мм, с обратным наклоном - 1 шт.;
  - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
  - Адаптер Storz - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

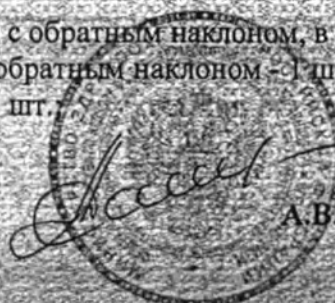

А.В. Самойлова

0110639

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**№ РЗН 2022/18698**

**Лист 10**

- Адаптер ACMI - 1 шт.;
  - Полировочная паста - 1 уп.;
  - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
  - 2.7. Синускоп Precision S 4K 3,1 мм x 70°, 170 мм, с обратным наклоном, в составе:
    - Синускоп Precision S 4K 3,1 мм x 70°, 170 мм, с обратным наклоном - 1 шт.;
    - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
    - Адаптер Storz - 1 шт.;
    - Адаптер ACMI - 1 шт.;
    - Полировочная паста - 1 уп.;
    - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
  - 2.8. Синускоп Precision S 4K 3,1 мм x 0°, 125 мм, в составе:
    - Синускоп Precision S 4K 3,1 мм x 0°, 125 мм - 1 шт.;
    - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
    - Адаптер Storz - 1 шт.;
    - Адаптер ACMI - 1 шт.;
    - Полировочная паста - 1 уп.;
    - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
  - 2.9. Синускоп Precision S 4K 3,1 мм x 30°, 125 мм, в составе:
    - Синускоп Precision S 4K 3,1 мм x 30°, 125 мм - 1 шт.;
    - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
    - Адаптер Storz - 1 шт.;
    - Адаптер ACMI - 1 шт.;
    - Полировочная паста - 1 уп.;
    - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
  - 2.10. Синускоп Precision S 4K 3,1 мм x 30°, 125 мм, с обратным наклоном, в составе:
    - Синускоп Precision S 4K 3,1 мм x 30°, 125 мм, с обратным клапаном - 1 шт.;
    - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
    - Адаптер Storz - 1 шт.;
    - Адаптер ACMI - 1 шт.;
    - Полировочная паста - 1 уп.;
    - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
  - 2.11. Синускоп Precision S 4K 4 мм x 0°, 155 мм, в составе:
    - Синускоп Precision S 4K 4 мм x 0°, 155 мм - 1 шт.;
    - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
    - Адаптер Storz - 1 шт.;
    - Адаптер ACMI - 1 шт.;
    - Полировочная паста - 1 уп.;
- Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0117040**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 октября 2022 года № РЗН 2022/18698

Лист 11

- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.12. Синускоп Precision S 4К 4 мм х 30°, 155 мм, в составе:
  - Синускоп Precision S 4К 4 мм х 30°, 155 мм - 1 шт.;
  - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
  - Адаптер Storz - 1 шт.;
  - Адаптер ACMI - 1 шт.;
  - Полировочная паста - 1 уп.;
  - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.13. Синускоп Precision S 4К 4 мм х 45°, 155 мм, в составе:
  - Синускоп Precision S 4К 4 мм х 45°, 155 мм - 1 шт.;
  - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
  - Адаптер Storz - 1 шт.;
  - Адаптер ACMI - 1 шт.;
  - Полировочная паста - 1 уп.;
  - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.14. Синускоп Precision S 4К 4 мм х 70°, 155 мм, в составе:
  - Синускоп Precision S 4К 4 мм х 70°, 155 мм - 1 шт.;
  - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
  - Адаптер Storz - 1 шт.;
  - Адаптер ACMI - 1 шт.;
  - Полировочная паста - 1 уп.;
  - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.15. Синускоп Precision S 4К 4 мм х 30°, 155 мм, с обратным наклоном, в составе:
  - Синускоп Precision S 4К 4 мм х 30°, 155 мм, с обратным наклоном - 1 шт.;
  - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
  - Адаптер Storz - 1 шт.;
  - Адаптер ACMI - 1 шт.;
  - Полировочная паста - 1 уп.;
  - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.16. Синускоп Precision S 4К 4 мм х 45°, 155 мм, с обратным наклоном, в составе:
  - Синускоп Precision S 4К 4 мм х 45°, 155 мм, с обратным наклоном - 1 шт.;
  - Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
  - Адаптер Storz - 1 шт.;
  - Адаптер ACMI - 1 шт.;
  - Полировочная паста - 1 уп.;
  - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 2.17. Синускоп Precision S 4К 4 мм х 70°, 155 мм, с обратным наклоном, в составе:

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0110641

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 октября 2022 года № РЗН 2022/18698

Лист 12

- Синускоп Precision S 4K 4 мм x 70°, 155 мм, с обратным наклоном - 1 шт.;
- Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
- Адаптер Storz - 1 шт.;
- Адаптер ACMI - 1 шт.;
- Полировочная паста - 1 уп.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

2.18. Синускоп Precision S 4K 4 мм x 0°, 180 мм, в составе:

- Синускоп Precision S 4K 4 мм x 0°, 180 мм - 1 шт.;
- Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
- Адаптер Storz - 1 шт.;
- Адаптер ACMI - 1 шт.;
- Полировочная паста - 1 уп.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

2.19. Синускоп Precision S 4K 4 мм x 30°, 180 мм, в составе:

- Синускоп Precision S 4K 4 мм x 30°, 180 мм - 1 шт.;
- Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
- Адаптер Storz - 1 шт.;
- Адаптер ACMI - 1 шт.;
- Полировочная паста - 1 уп.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

2.20. Синускоп Precision S 4K 4 мм x 30°, 180 мм, с обратным наклоном, в составе:

- Синускоп Precision S 4K 4 мм x 30°, 180 мм, с обратным наклоном - 1 шт.;
- Адаптер Wolf (предустановлен на эндоскопе) - 1 шт.;
- Адаптер Storz - 1 шт.;
- Адаптер ACMI - 1 шт.;
- Полировочная паста - 1 уп.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

*И*

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0110642