

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО Компания «Эталон»





Поторокин О.А.
2019 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Расходные материалы к глюкометру АйЧек:

тест-полоски АйЧек (вид 248900), ланцеты (вид 164390), контрольный раствор (вид 248950), ручка для прокалывания (вид 216340)

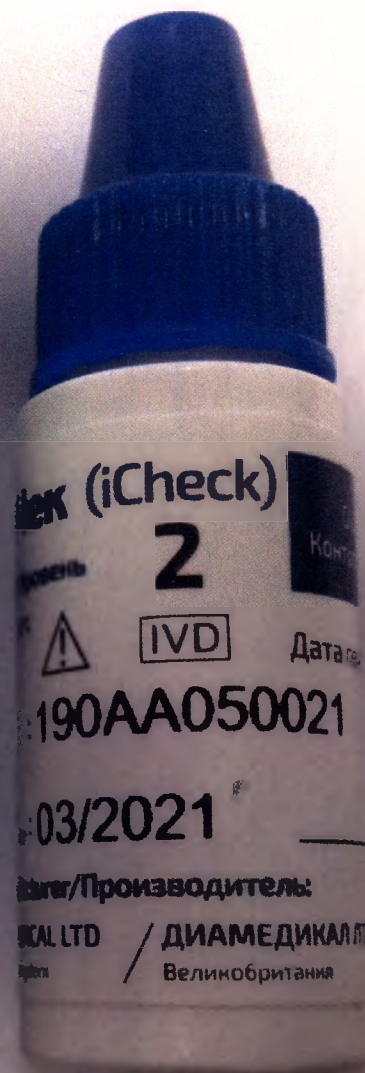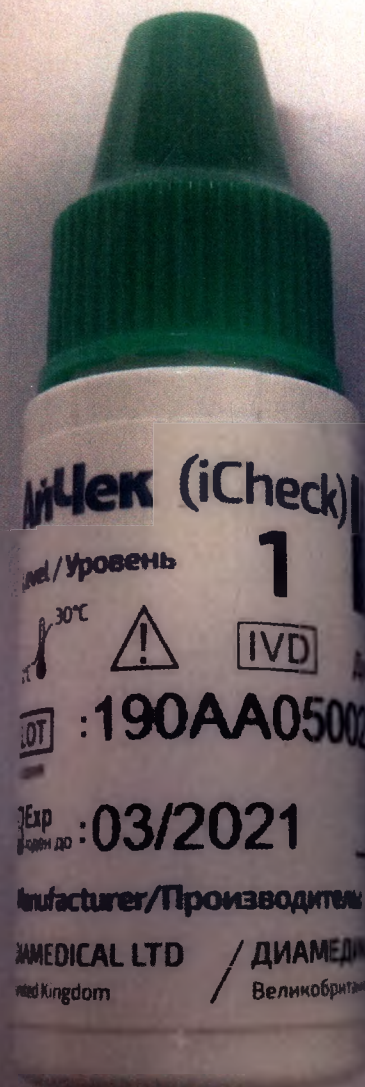

M

S

АйЧек

ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

*Для использования с глюкометром АйЧек

АйЧек



50 + 50
тест-полосок ланцетов

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

АйЧек


Ланцеты стерильные 30G, 25 шт.

LOT : 17111050-01
серия

Exp : 2022-11-10
год-мес-дн

 Не использовать дважды!

STERILE EO

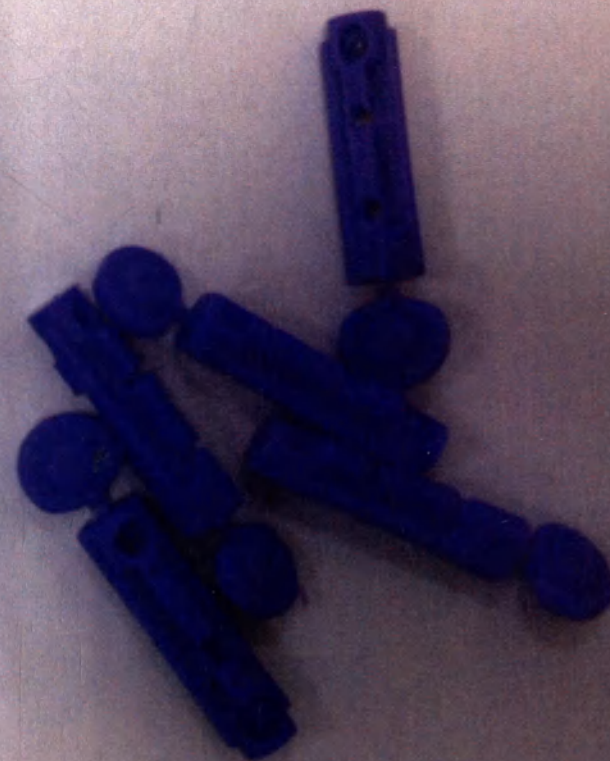



АйЧек

ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

 09/2019
дата изготовления

LOT 199AB030032

CODE:998

 **EXP** 02/2021

АйЧек

ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ


 09/2019
дата изготовления

LOT 199AB030032

CODE:998

 **EXP** 02/2021



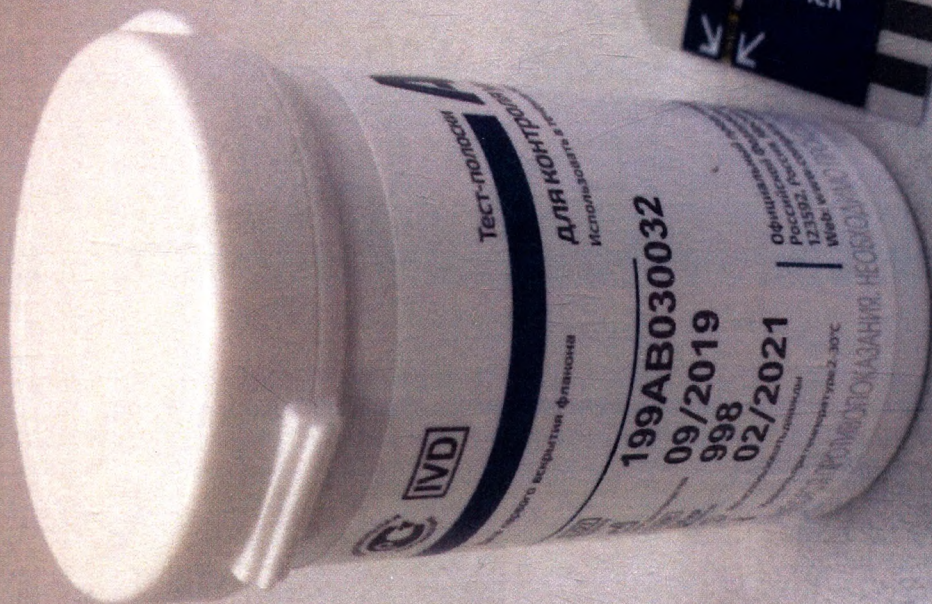

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

8 из 8 листов

Генеральный директор
ООО «Компания «Эталон»

О.А. Поторокин

