

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
**Директор**  
**ООО «Бизнес Технологии»**

  
Н.К. Назарова  
« 7 »  2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**Система ультразвуковая диагностическая E-CUBE i7 с принадлежностями**

**2021**



**Фото 1. Система ультразвуковой визуализации E-CUBE i7 на тележке . Вид  
спереди**



**Фото 2. Система ультразвуковой визуализации E-CUBE i7 на тележке. Вид сзади**



**Фото 3. Система ультразвуковой визуализации E-CUBE i7. Вид спереди**



Фото 4. Адаптер переменного тока



**Фото 5.Кабель питания**



# ECUBE i7

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

70002045 Rev. 0 (RUS)

**ALPINION**

MEDICAL SYSTEMS

[www.alpinion.com](http://www.alpinion.com)

Фото 6. Краткое руководство пользователя


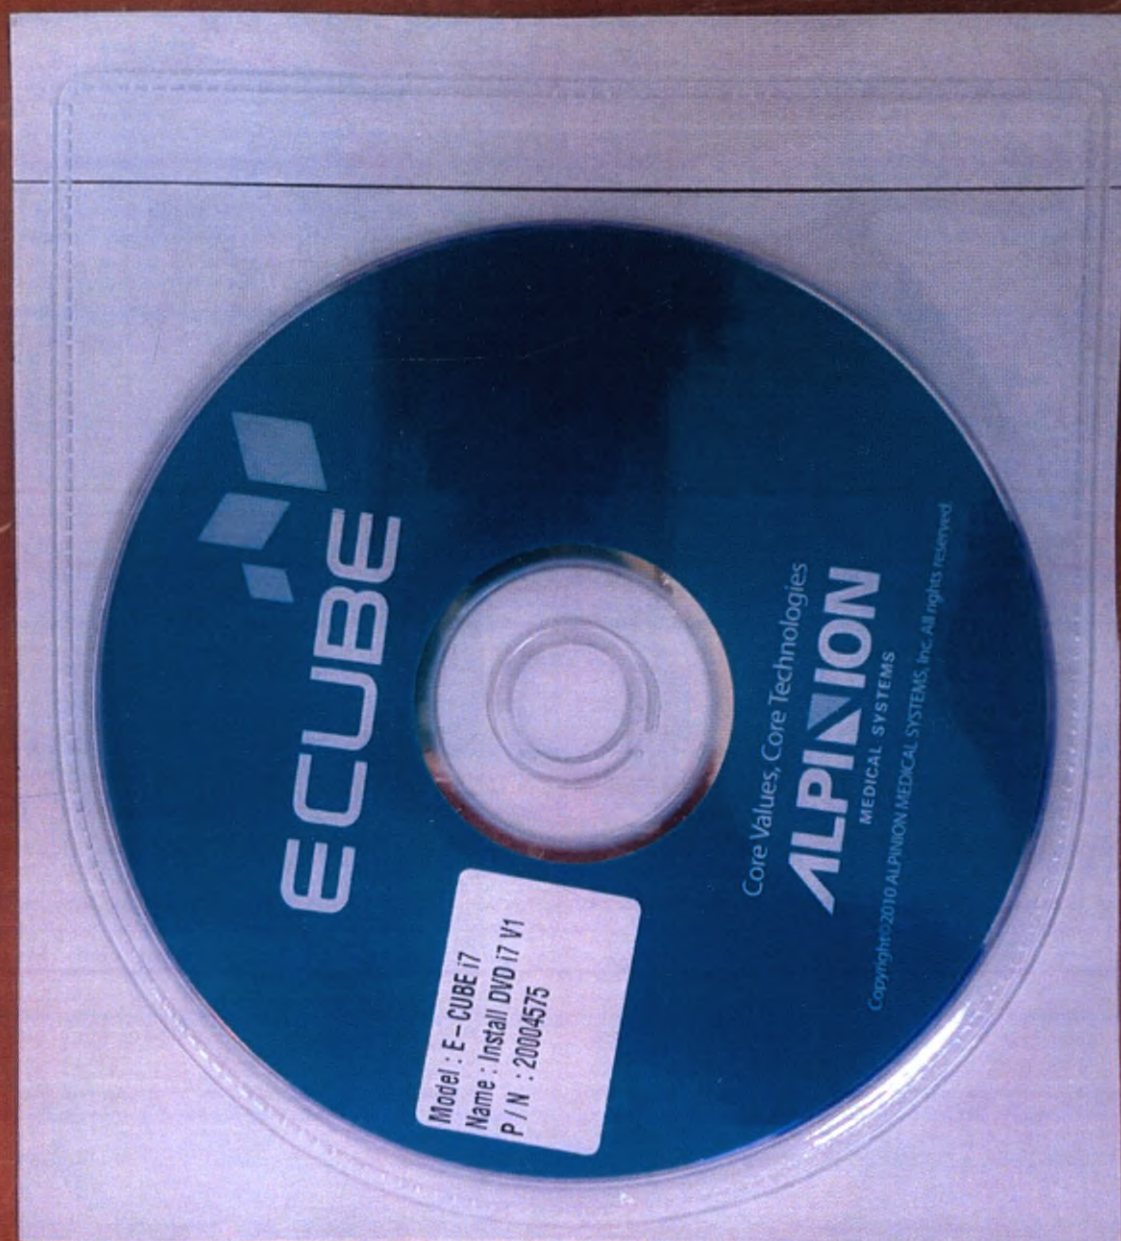


Фото 7. Установочный DVD-диск



**Фото 8 . Аккумуляторная батарея**

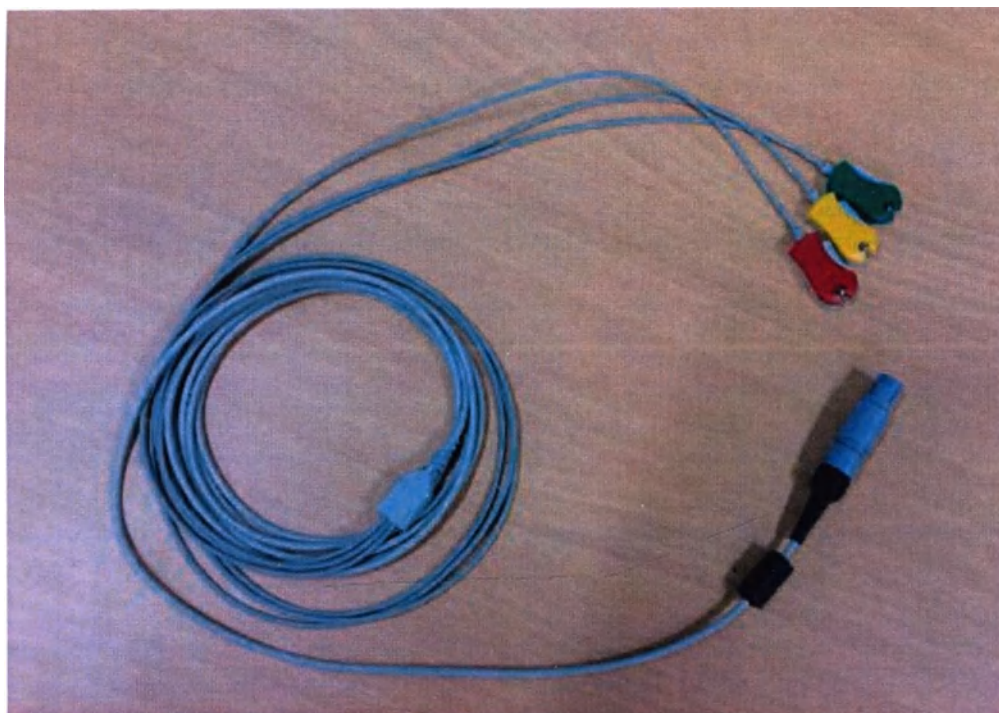

**Фото 9. Модуль ЭКГ (Блок ввода электрокардиографических сигналов)**



**Фото 10. Датчик ультразвуковой конвексный высокочастотный  
внутриполостной серии EV "EV3-10T"**



Фото 12. Датчик ультразвуковой конвексный серии С"С1-6Т"




**Фото 13. Датчик ультразвуковой конвексный серии С "C5-8NT"**



**Фото 14 Датчик ультразвуковой линейный интраоперационный серии IO 108 17T"**



Фото 15. Датчик ультразвуковой линейный серии L "L3-12T"

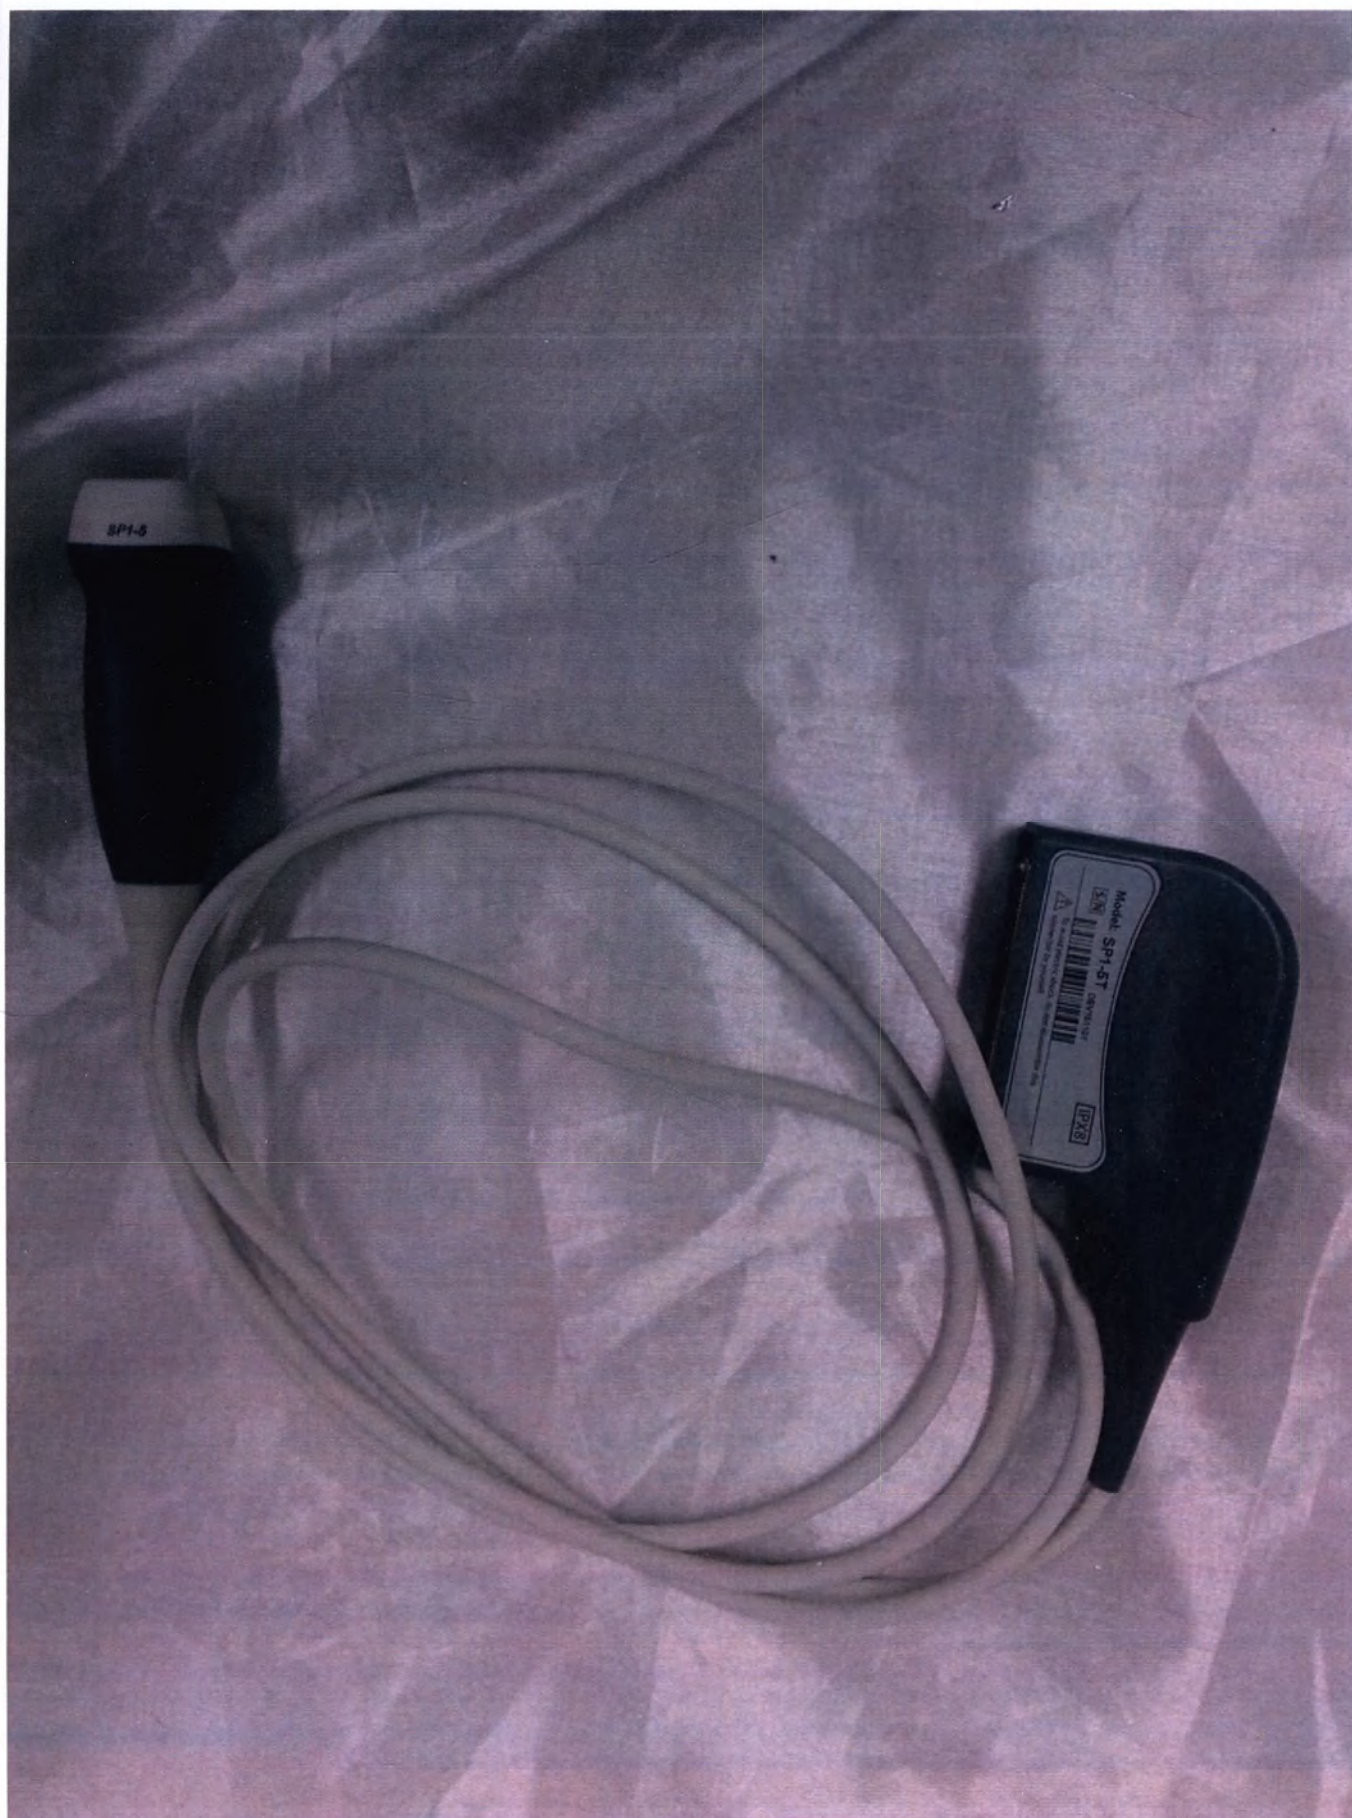

**Фото 16. Датчик ультразвуковой секторный монокристаллический серии SP "SP1-5T"**



**Фото 17 Датчик ультразвуковой секторный монокристаллический серии SP  
"SP3-8T"**



**Фото 18. Кейс для перевозки**

## Программное обеспечение

Модуль автоматического измерения комплекса нитима-медиа

Модуль автоматической оптимизации изображения

Модуль анатомического М-режима

Модуль инверсной тканевой гармоники

Модуль кардиологических исследований

Модуль панорамного сканирования

Модуль передачи медицинских данных DICOM

Модуль подавления зернистости базовый

Модуль подавления зернистости расширенный

Модуль подключения внешних устройств и проведения видеоконференций

Модуль проведения измерений базовый

Модуль проведения измерений расширенный

Модуль составления кардиологических медицинских отчетов DICOM

Модуль составления медицинских отчетов DICOM

Модуль составного многолучевого сканирования

Модуль тканевого доплера

Модуль улучшения визуализации биопсийной иглы базовый

Модуль улучшения визуализации биопсийной иглы расширенный

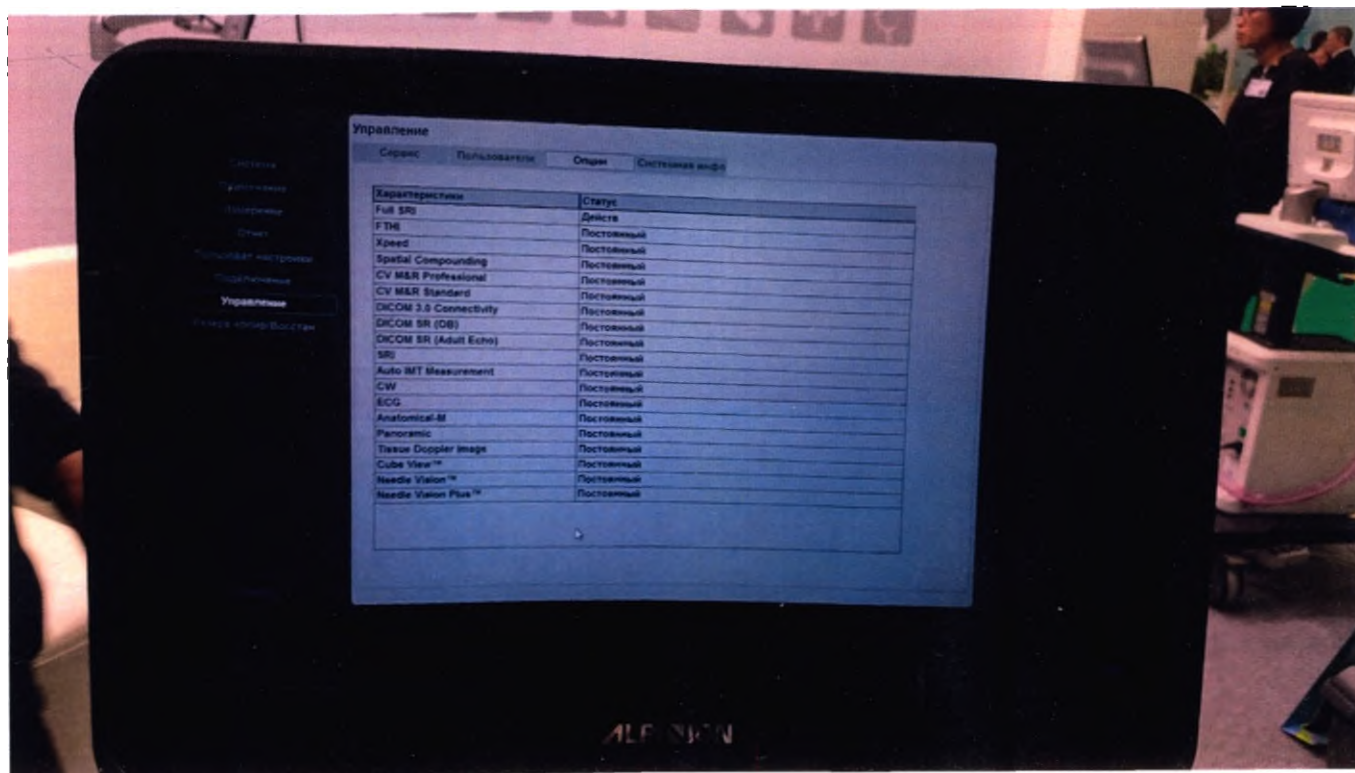




Фото 19. Переключатель ножной

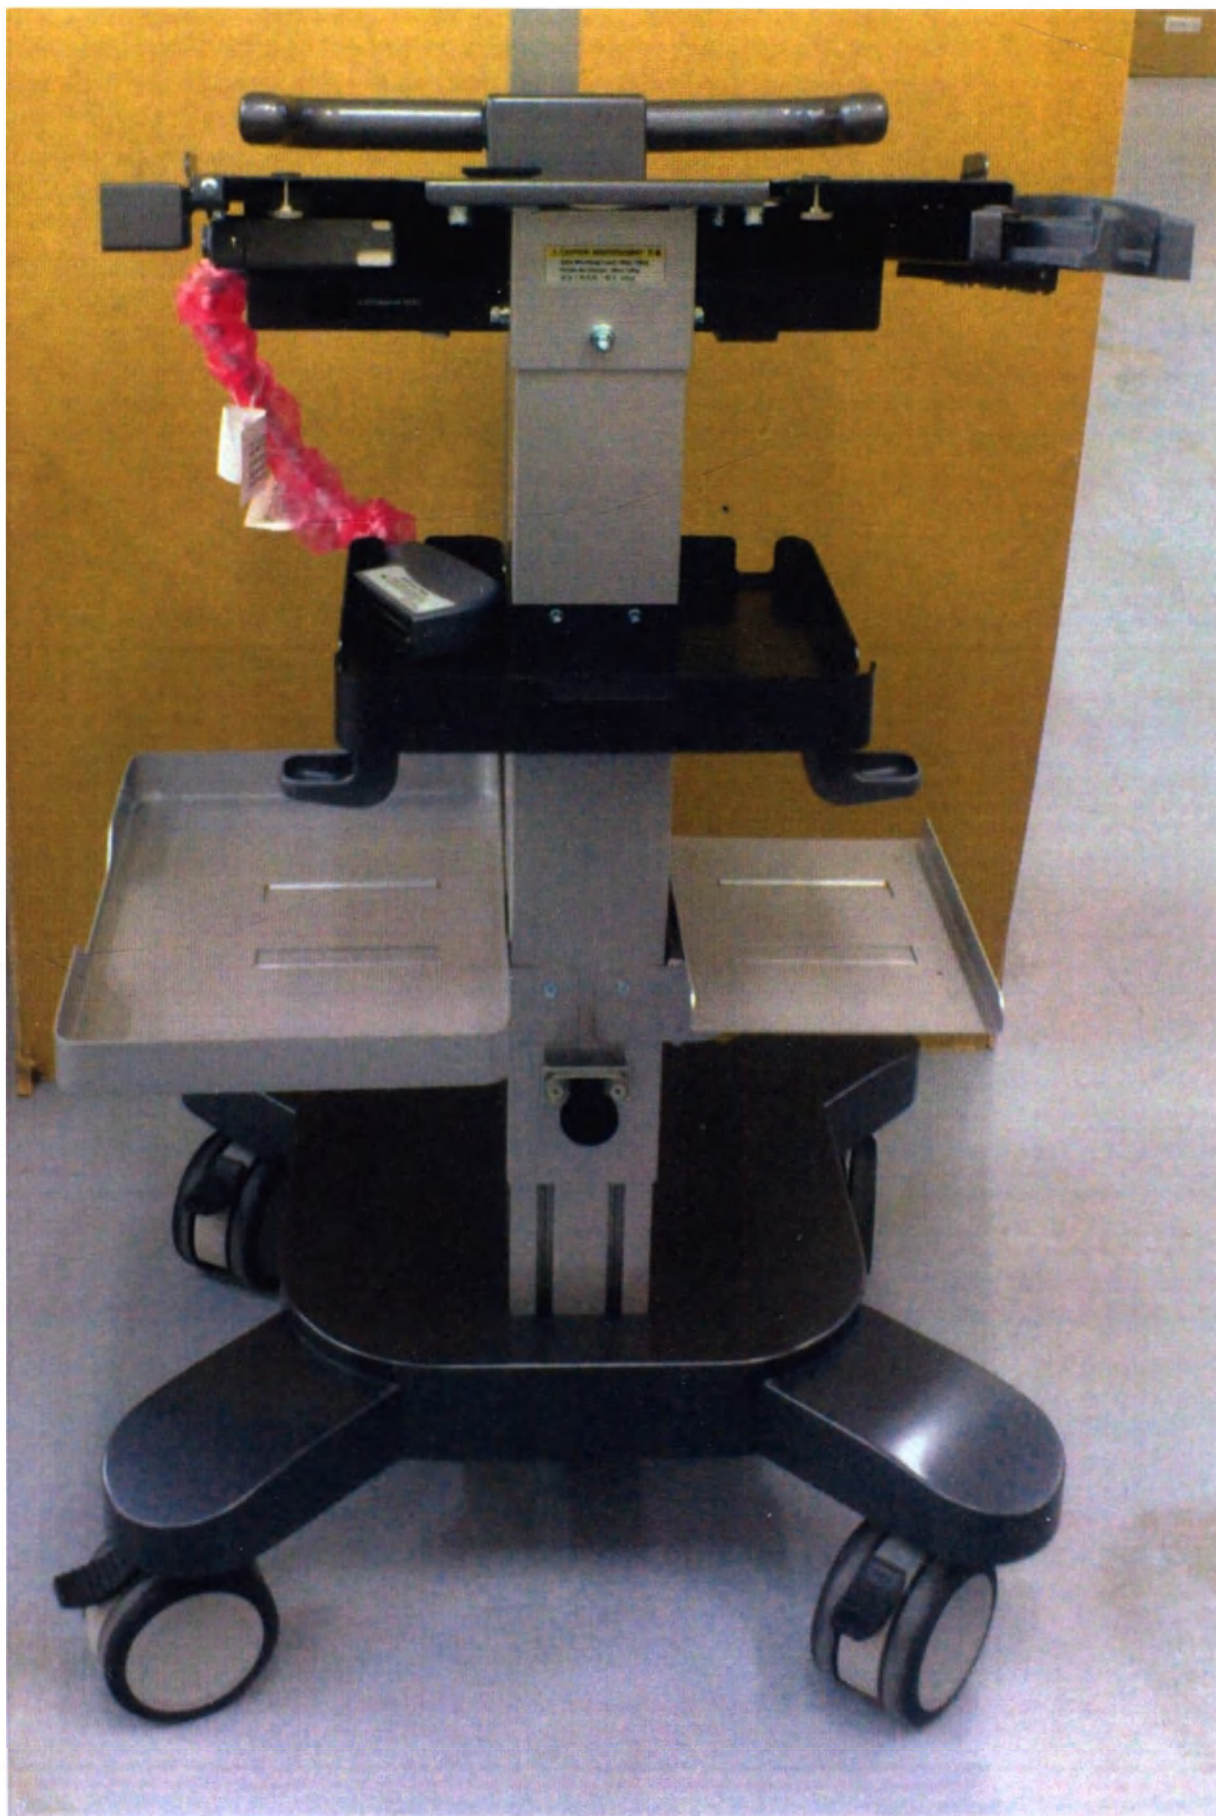





Фото 21.Тележка специализированная. Вид спереди



**Фото 22 .Тележка специализированная. Вид сбоку**



**Фото 23. Тележка специализированная. Вид сзади**

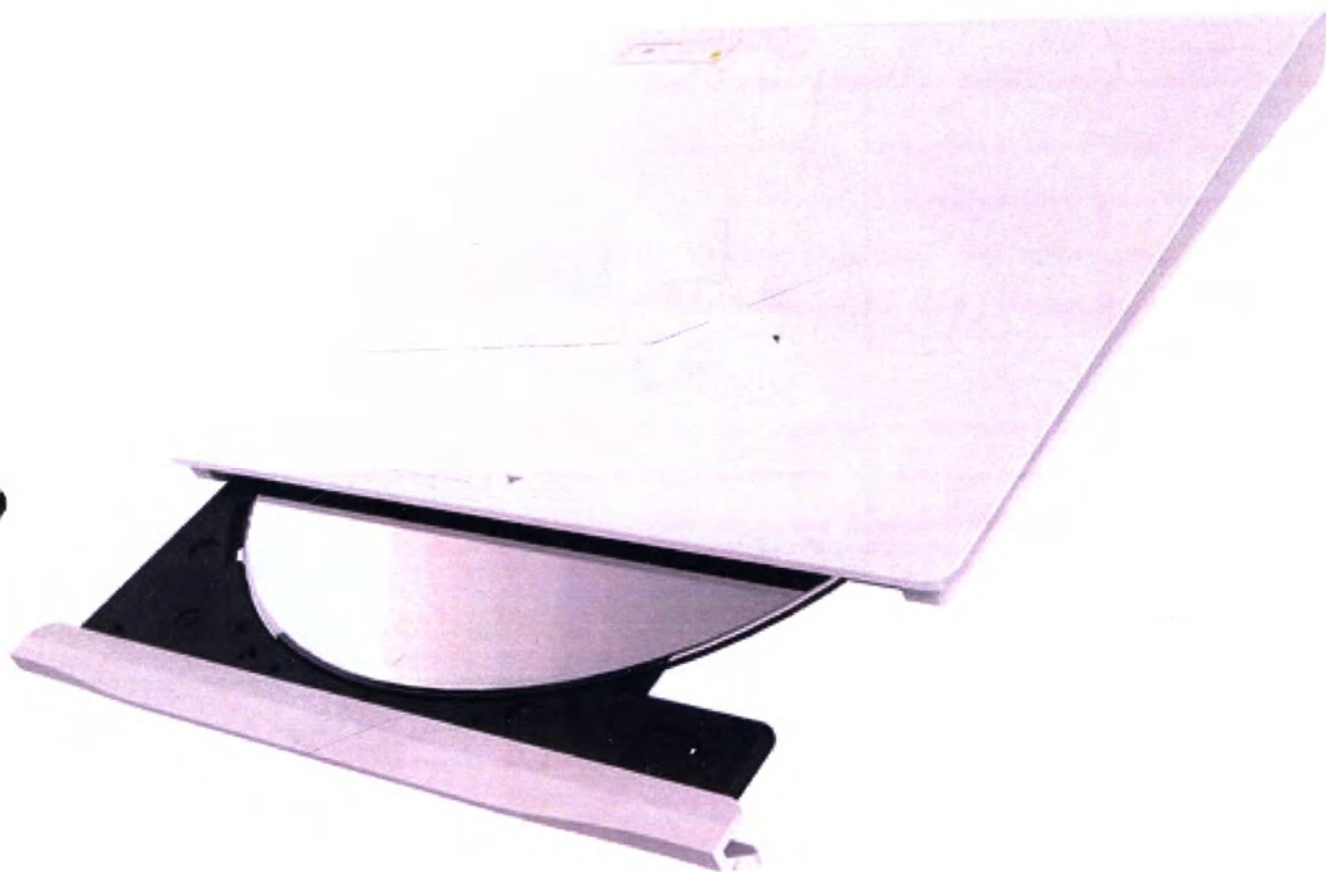

**Фото 24. Устройство записи на DVD с кронштейном**

## Маркировка на задней части сканера

### Система ультразвуковая диагностическая

ALPINION MEDICAL SYSTEMS Co., Ltd.

Алпинион Медикал Системс Ко., Лтд.

5FL, 1 Dong, 77, Heungan-daero 81 beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si,  
Gyeonggi-do, Republic of Korea



Модель: E-Cube i7

Вес: 7.2 кг

Электропитание: 19В-, 10.5А



\*\*\*\*\*



2015 .05



Во избежание электрического удара, не разбирайте  
самостоятельно данный разъем

СДЕЛАНО В КОРЕЕ

## Маркировка на задней части монитора



Не прикладывать  
нагрузки к  
монитору

Соблюдать  
осторожность при  
вращении

Не толкать при  
фиксированных  
колесах

## Маркировка датчиков

Датчик ультразвуковой

Модель:



ALPINION MEDICAL SYSTEMS Co., Ltd.

Алпинион Медикал Системс Ко., Лтд.

5FL, 1 Dong, 77, Heungan-daero 81 beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si,  
Gyeonggi-do, Republic of Korea



Во избежание электрического удара, не разбирайте  
самостоятельно данный разъем

Маркировка на задней части монитора



Маркировка на задней части сканера



Этикетка

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Система ультразвуковая                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| диагностическая E-CUBE i7                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>Производитель</b><br>ALPINION MEDICAL SYSTEMS Co., Ltd.<br>Алпинион Медикал Системс Ко., Лтд.<br>5FL, 1 Dong, 77, Heungan-daero 81 beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea                                                                                   |             |
| <b>Уполномоченный представитель производителя</b><br>Общество с ограниченной ответственностью<br>«Бизнес Технологии»<br>(ООО «Бизнес Технологии»)<br>117198, Российская Федерация,<br>г. Москва, ул.Саморы Машела, д. 8, стр.2<br>тел.: 8(495)232-02-13, эл.почта: info@intermedica.ru |             |
| Перед использованием прочитайте инструкцию по применению                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Утилизация согласно руководству пользователя и требованиям местного законодательства                                                                                                                                                                                                   |             |
| Электропитание: 19В-, 10.5А                                                                                                                                                                                                                                                            | Вес: 7,2 кг |
| Регистрационное удостоверение № РЗН ****/****<br>Дата ** * * * * *                                                                                                                                                                                                                     |             |

## **РАЗРАБОТЧИК**

Alpinion Medical Systems Co., Ltd.

«Алпинион Медикал Системз Ко., Лтд.»

5FL, I Dong, 77, Heungan-daero 81 beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do,  
Republic of Korea

Тел. 82-2-3282-0900; 82-2-851-5591; e-mail: [international@alpinion.com](mailto:international@alpinion.com)

## **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Alpinion Medical Systems Co., Ltd.

«Алпинион Медикал Системз Ко., Лтд.»

5FL, I Dong, 77, Heungan-daero 81 beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do,  
Republic of Korea

Тел. 82-2-3282-0900; 82-2-851-5591; e-mail: [international@alpinion.com](mailto:international@alpinion.com)

## **УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Технологии», 117198,  
Российская Федерация, г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 8, стр. 2. Тел +7(495) 232-02-  
13, адрес электронной почты: [info@intermedica.ru](mailto:info@intermedica.ru) ИНН 7728711740

Сброшюровано и прошито 31 листов  
« 7 » сентября 2021 г.

Директор  
ООО «Бизнес Технологии»  
\_\_\_\_\_ Н.И. Назарова

