



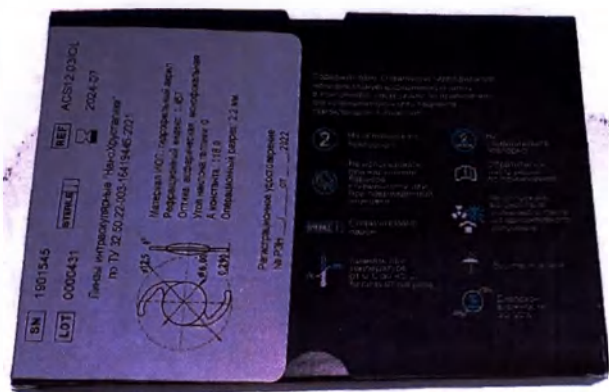

Защитная упаковка - коробка для линз Аквамарин и Цитрин (155x105x18)

Линзы интраокулярные НаноХрусталики
по ТУ 32.50.22-003-16419445-2021 в вариантах исполнения
Фотографические изображения.

Име. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

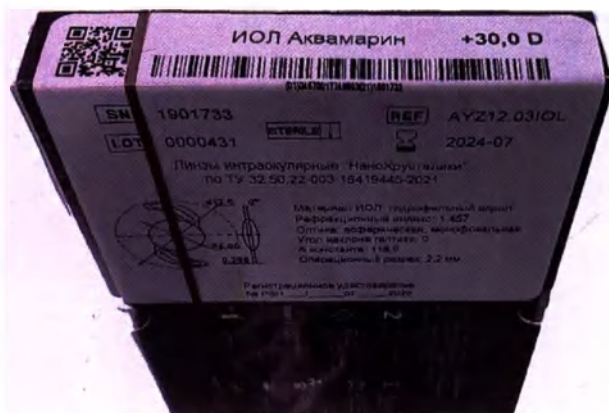

Защитная упаковка - коробка для линз Аквамарин и Цитрин в варианте исполнения с устройством для введения интраокулярных Гидрофолд (155x105x18)

Линзы интраокулярные НаноХрусталики
по ТУ 32.50.22-003-16419445-2021 в вариантах исполнения
Фотографические изображения.

Лист

3

Изм. Лист № докв Подп. Ламб

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

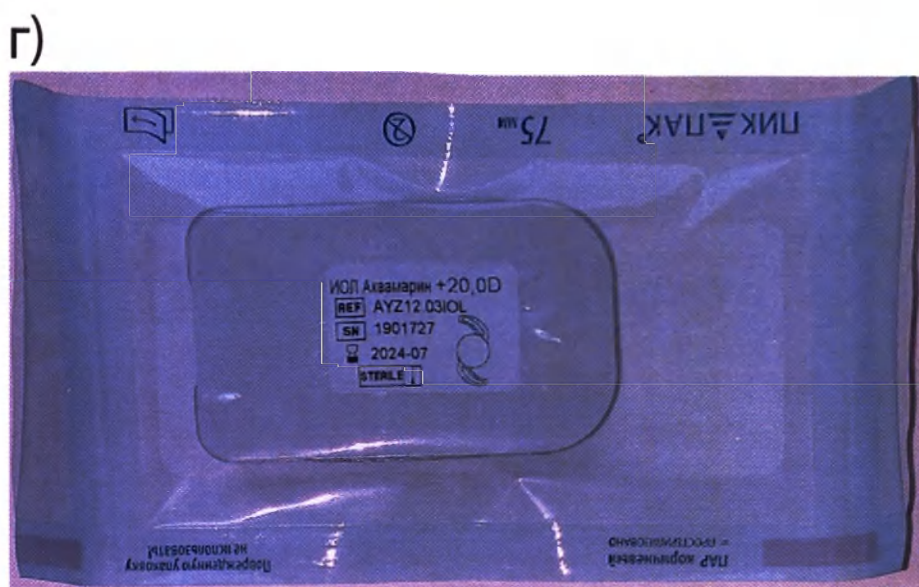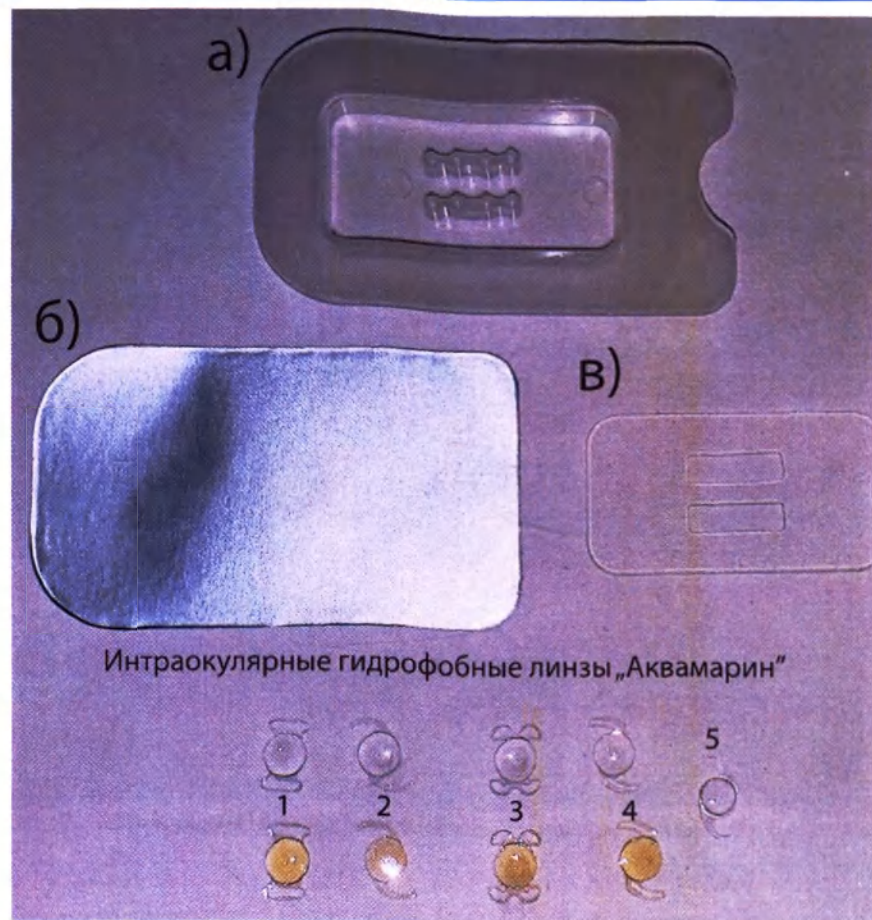

Элементы барьерной системы для стерилизации ИОЛ Аквамарин: а) контейнер; б) крышка фольгированная для приварки к контейнеру; в) защитная крышка; г) комбинированный пакет для стерилизации „бумага-пленка”

Варианты исполнения ИОЛ „Аквамарин”: 1) ACO11.03IOL/ACY11.03IOL/ACO11.03KIT/ACY11.03KIT; 2) ACS12.03IOL/AYS12.03IOL/ACS12.03KIT/AYS12.03KIT; 3) ACQ11.03IOL/AYQ11.03IOL/ACQ11.03KIT/AYQ11.03KIT; 4) ACZ12.03IOL/AYZ12.03IOL/ACZ12.03KIT/AYZ12.03KIT; 5) ACS12.05IOL/ACS12.05KIT.

Линзы интраокулярные НаноХрусталики
по ТУ 32.50.22-003-16419445-2021 в вариантах исполнения
Фотографические изображения.

Лист

4

Подпись и дата

Име. № дубл.

Взам. име. №


Подпись и дата

Име. № подл.

000 ЦИРМИ

INFO@CIRMI.RU

WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

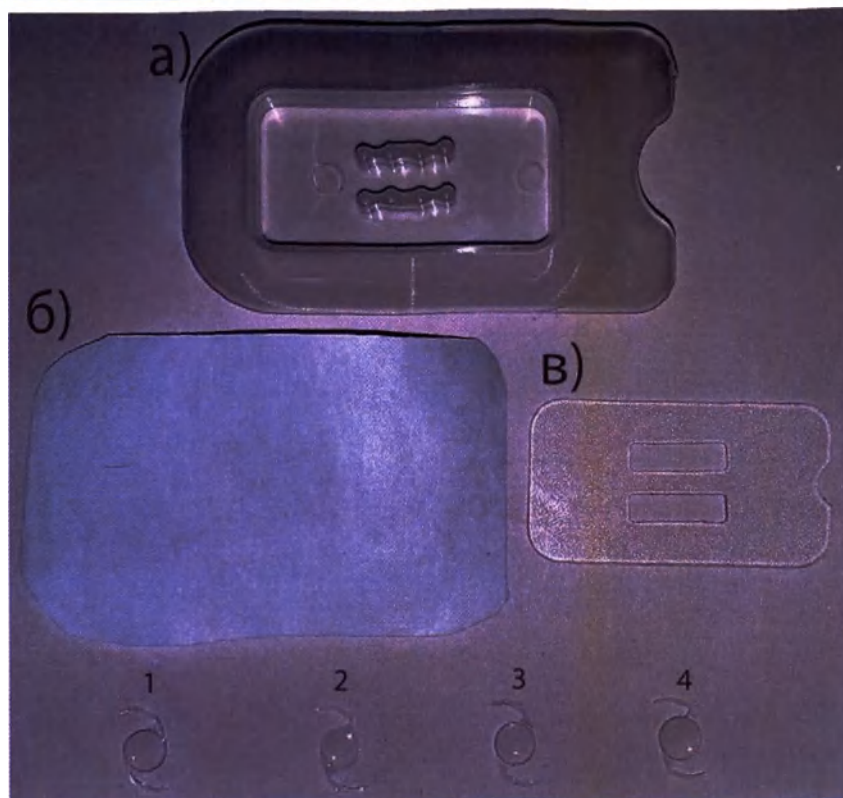

Интраокулярные гидрофобные линзы „Цитрин”



Элементы барьерной системы для стерилизации ИОЛ Цитрин: а) контейнер; б) крышка для приварки к контейнеру из материала Тайвек с адгезивным покрытием; в) защитная крышка; г) комбинированный пакет для стерилизации „тайвек-пленка”

Варианты исполнения ИОЛ „Цитрин”: 1) CCL13.03IOL/CCL13.03KIT; 2) CCS12.05IOL/CCS12.05KIT; 3) CCS13.03IOL/CCS13.03KIT; 4) CCS13.02IOL/CCS13.02KIT.

Линзы интраокулярные НаноХрусталики
по ТУ 32.50.22-003-16419445-2021 в вариантах исполнения
Фотографические изображения.

Лист

5


Подпись и дата

Име. № дубл.

Взам. име. №

Подпись и дата

Име. № подл.

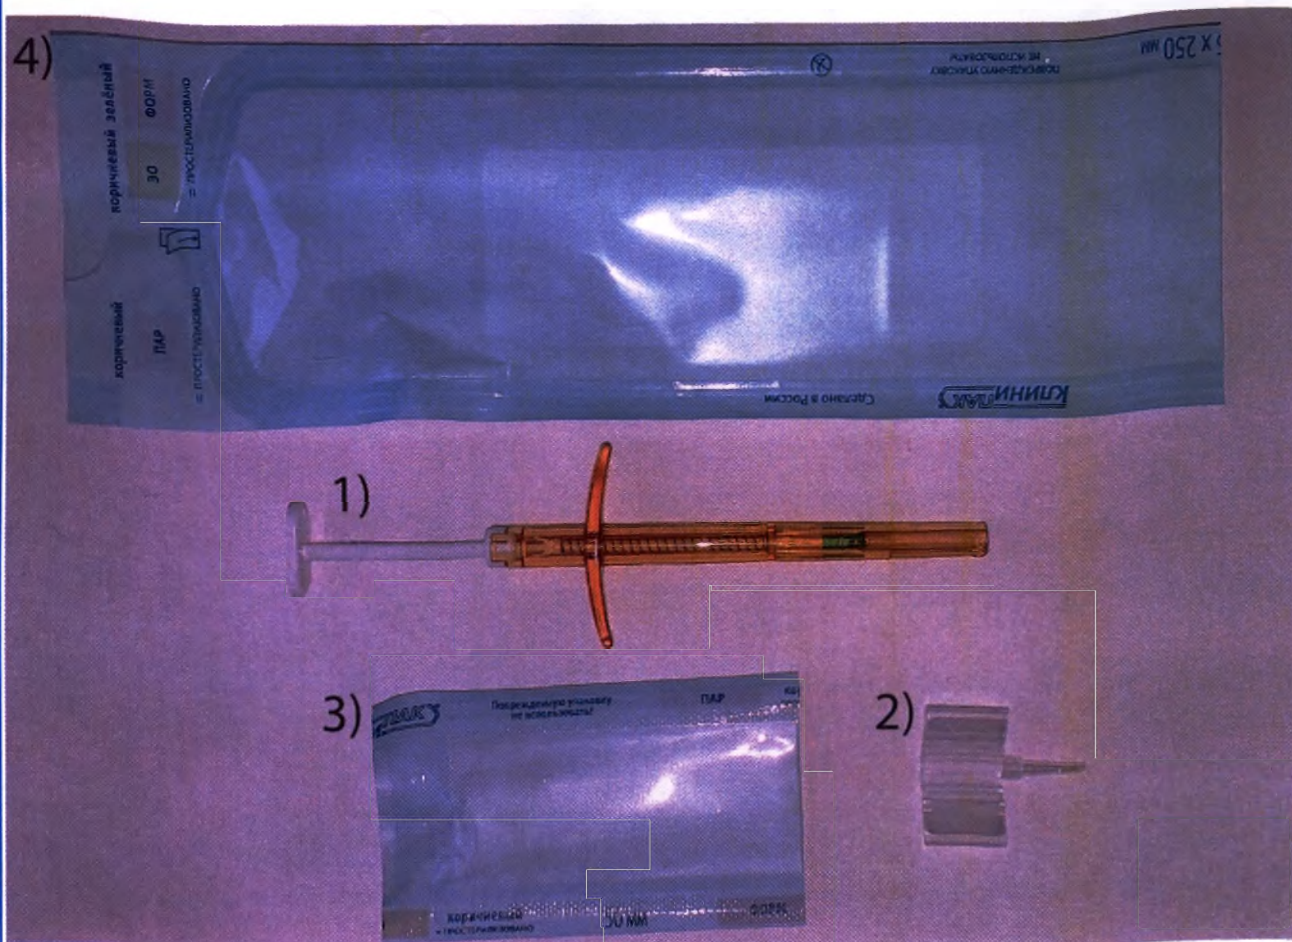

Устройство для введения интраокулярных линз „Гидрофолд“ из комплекта поставки в варианте исполнения „KIT“: 1- инжектор Гидрофолд; 2- картридж для инжектора; 3- комбинированный индивидуальный пакет „бумага-пленка“ для картриджа; 4- комбинированный пакет „бумага-пленка“ для инжектора и вложенного в него индивидуально упакованного картриджа.

Линзы интраокулярные НаноХрусталики
по ТУ 32.50.22-003-16419445-2021 в вариантах исполнения
Фотографические изображения.

Лист

6

Подпись и дата

Име. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Име. № подл.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

6

листа (ов).

Генеральный директор

Иванов И.И.

Подпись



Маркировка потребительской упаковки (защитная упаковка) для ИОЛ Аквамарин



ИОЛ Аквамарин АСО11.03IOL +XX,X D



(01)04670017749993(21)XXXXXX


SN XXXXXXXX

STERILE !

LOT XXXXXXXX

XXXX-XX

**Линзы интраокулярные «НаноХрусталики»
по ТУ 32.50.22-003-16419445-2021**

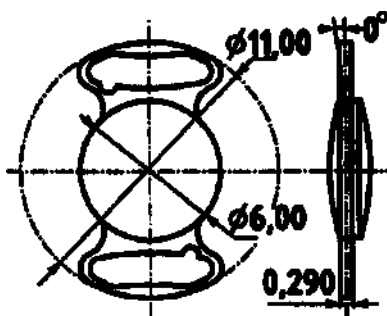

Материал ИОЛ: гидрофильный акрил
Рефракционный индекс: 1,497
Оптика: асферическая, монофокальная
Угол наклона гаптики: 0
А-константа: 118,0
Операционный разрез: 2,2 мм.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН ____/____ от __.__.2021

* Символы на этикетках в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации.

Линзы интраокулярные НаноХрусталики
по ТУ 32.50.22-003-16419445-2021 в вариантах исполнения.
Макет маркировки медицинского изделия.

Лист

2

Подпись и дата

Име. № дубл.

Взам. име. №

Подпись и дата

Име. № подл.

000 ЦИРМИ

INFO@CIRMI.RU

WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Маркировка потребительской упаковки (защитная упаковка)
для ИОЛ Аквамарин в комплекте с устройством для введения
интраокулярных линз „Гидрофолд“




ИОЛ Аквамарин АСО11.03KIT +XX,X D



(01)04670017749993(21)XXXXXX

SN XXXXXXXX **LOT** XXXXXXXX **STERILE** XXXX-XX

Линзы интраокулярные «НаноХрусталики»
по ТУ 32.50.22-003-16419445-2021
(в комплекте с инъектором)

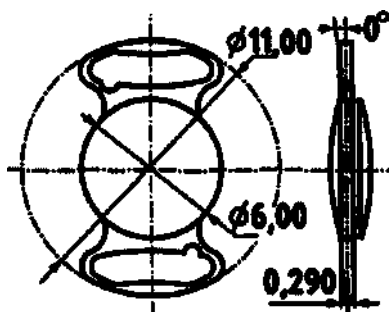

Материал ИОЛ: гидрофильный акрил
Рефракционный индекс: 1,497
Оптика: асферическая, монофокальная
Угол наклона гаптики: 0°
А-константа: 118,0
Операционный разрез: 2,2 мм.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН ____/____ от _____.2021

* Символы на этикетках в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации.

Линзы интраокулярные НаноХрусталики
по ТУ 32.50.22-003-16419445-2021 в вариантах исполнения.
Макет маркировки медицинского изделия.

Лист

3

Подпись и дата

Имя, № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Имя, № подл.

000 ЦИРМИ

INFO@CIRMI.RU

WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Маркировка потребительской упаковки (защитная упаковка)
для ИОЛ Цитрин в комплекте с устройством для введения
интраокулярных линз „Гидрофолд“





ИОЛ Цитрин CCS13.02KIT +XX,X D



(01)04670017749993(21)XXXXXX

SN XXXXXXXX **LOT** XXXXXXXX **STERILE** XXXX-XX

Линзы интраокулярные «НаноХрусталики»
по ТУ 32.50.22-003-16419445-2021
(в комплекте с инжектором)

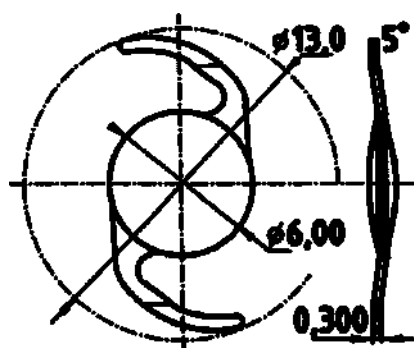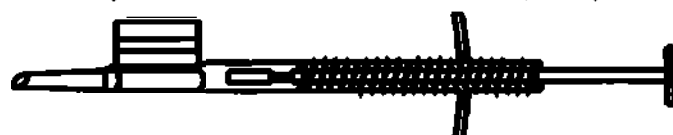

Материал ИОЛ: гидрофобный акрил
Рефракционный индекс: 1,497
Оптика: асферическая, монофокальная
Угол наклона галтики: 5
А-константа: 118,5
Операционный разрез: 2,2 мм.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН ____/____ от _____.2021

* Символы на этикетках в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации.

Линзы интраокулярные НаноХрусталики
по ТУ 32.50.22-003-16419445-2021 в вариантах исполнения.
Макет маркировки медицинского изделия.

Лист

4

Подпись и дата

Име. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Име. № подл.

Маркировка потребительской упаковки
(защитная упаковка) для ИОЛ Цитрин.



ИОЛ Цитрин CCS13.02IOL +XX,X D



(01)04670017749993(21)XXXXXX


SN XXXXXXXX

STERILEEO

LOT XXXXXXXX

XXXX-XX

Линзы интраокулярные «НаноХрусталики»
по ТУ 32.50.22-003-16419445-2021

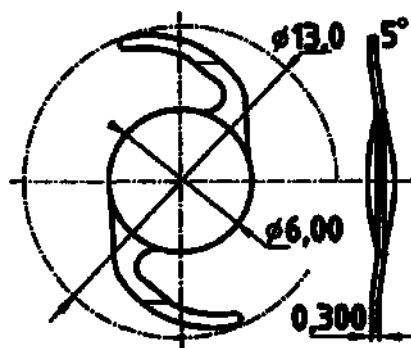

Материал ИОЛ: гидрофобный акрил
Рефракционный индекс: 1,497
Оптика: асферическая, монофокальная
Угол наклона гаптики: 5°
А-константа: 118,5
Операционный разрез: 2,2 мм.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН ____ / ____ от ____ 2021

* Символы на этикетках в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации.

Линзы интраокулярные НаноХрусталики
по ТУ 32.50.22-003-16419445-2021 в вариантах исполнения.
Макет маркировки медицинского изделия.

Лист

5

Подпись и дата

Име. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата


Име. № подл.

000 ЦИРМИ



INFO@CIRMI.RU

WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Маркировка барьерной системы для стерилизации
(индивидуальной упаковки) для ИОЛ Аквамарин и Цитрин.

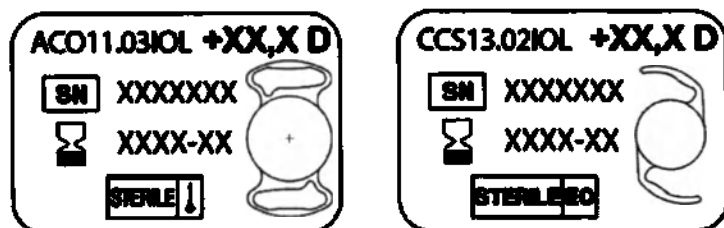

Этикетка на контейнер. Размер 30x20 мм.

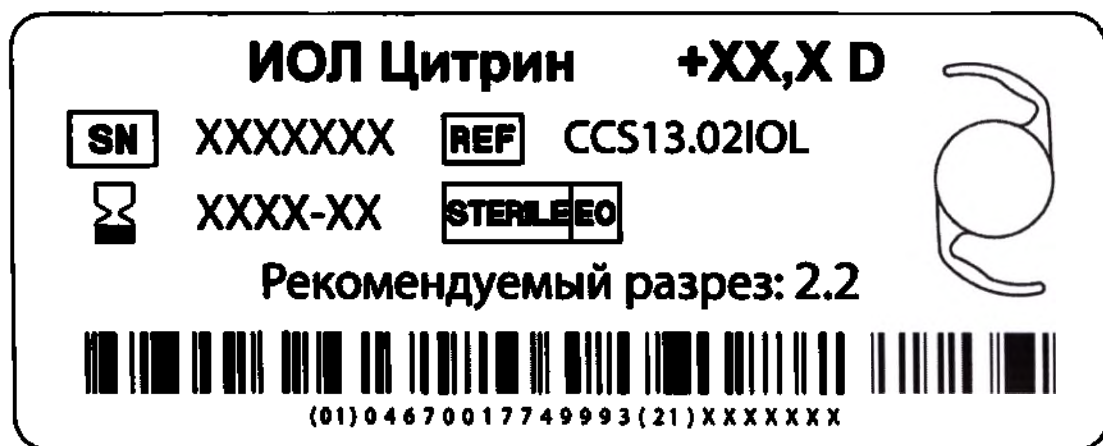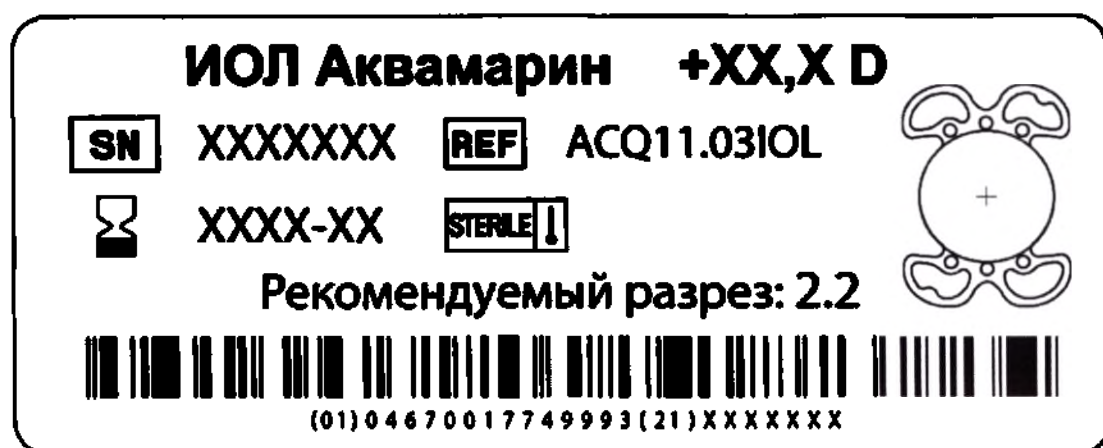

Этикетка на комбинированный пакет для стерилизации.
Для ИОЛ Аквамарин - „бумага-пленка“. Для ИОЛ Цитрин - „тайвек-пленка“
Размер 100x40 мм.

* Символы на этикетках в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации.

ИОЛ Аквамарин +20,0 D

SN 0100030 LOT 0100300

2023-06 REF ACQ11.03IOL



(01)0467001774993(21)0100030

ИОЛ Цитрин +20,0 D

SN 0100030 LOT 0100300

2023-06 REF CCS13.02IOL



(01)0467001774993(21)0100030

Самоклеющаяся этикетка вкладьш (стикер).Размер 60х30 мм.



NANOVISION

ООО НАНОПТИКА

Регистрационная карта

www.nanoptika.ru

Пациент _____

Врач _____

Учреждение _____

Оперированный
глаз

R L

Дата
имплантации
//

Место для стикера


Регистрационная карта пациента.

Устройство для введения
интраокулярных линз «Гидрофолд»

SN XXXXXXXX LOT XXXXXXXX XXXX-XX

STERILE EO

Рекомендуемый разрез: 2.2



(01)04670017749993(21)XXXXXXXX

Маркировка наносимая на комбинированный пакет для стерилизации
устройства для введения интраокулярных линз „Гидрофолд”
Размер 100х40 мм.

* Символы на этикетках в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации.

Линзы интраокулярные НаноХрусталики
по ТУ 32.50.22-003-16419445-2021 в вариантах исполнения.
Макет маркировки медицинского изделия.

Лист

7

Подпись и дата

Име. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Име. № подл.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU 18

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

7
_____ листа (ов).

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Ключников Д. П.

Подпись

