




МАКЕТ МАРКИРОВКИ

Реагент для выявления антигена А1 системы АВО(Н) на эритроцитах человека


(ЭРИТРОТЕСТ™ - Анти-А1 лектин),

по ТУ 21.20.23-003-27575295-2020


Этикетка на флакон

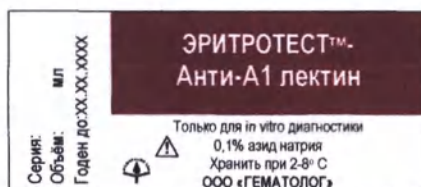


Этикетка на коробку

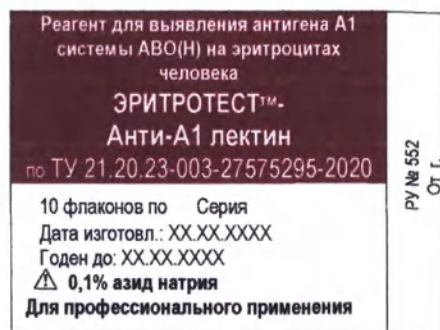


Макет коробки с этикеткой

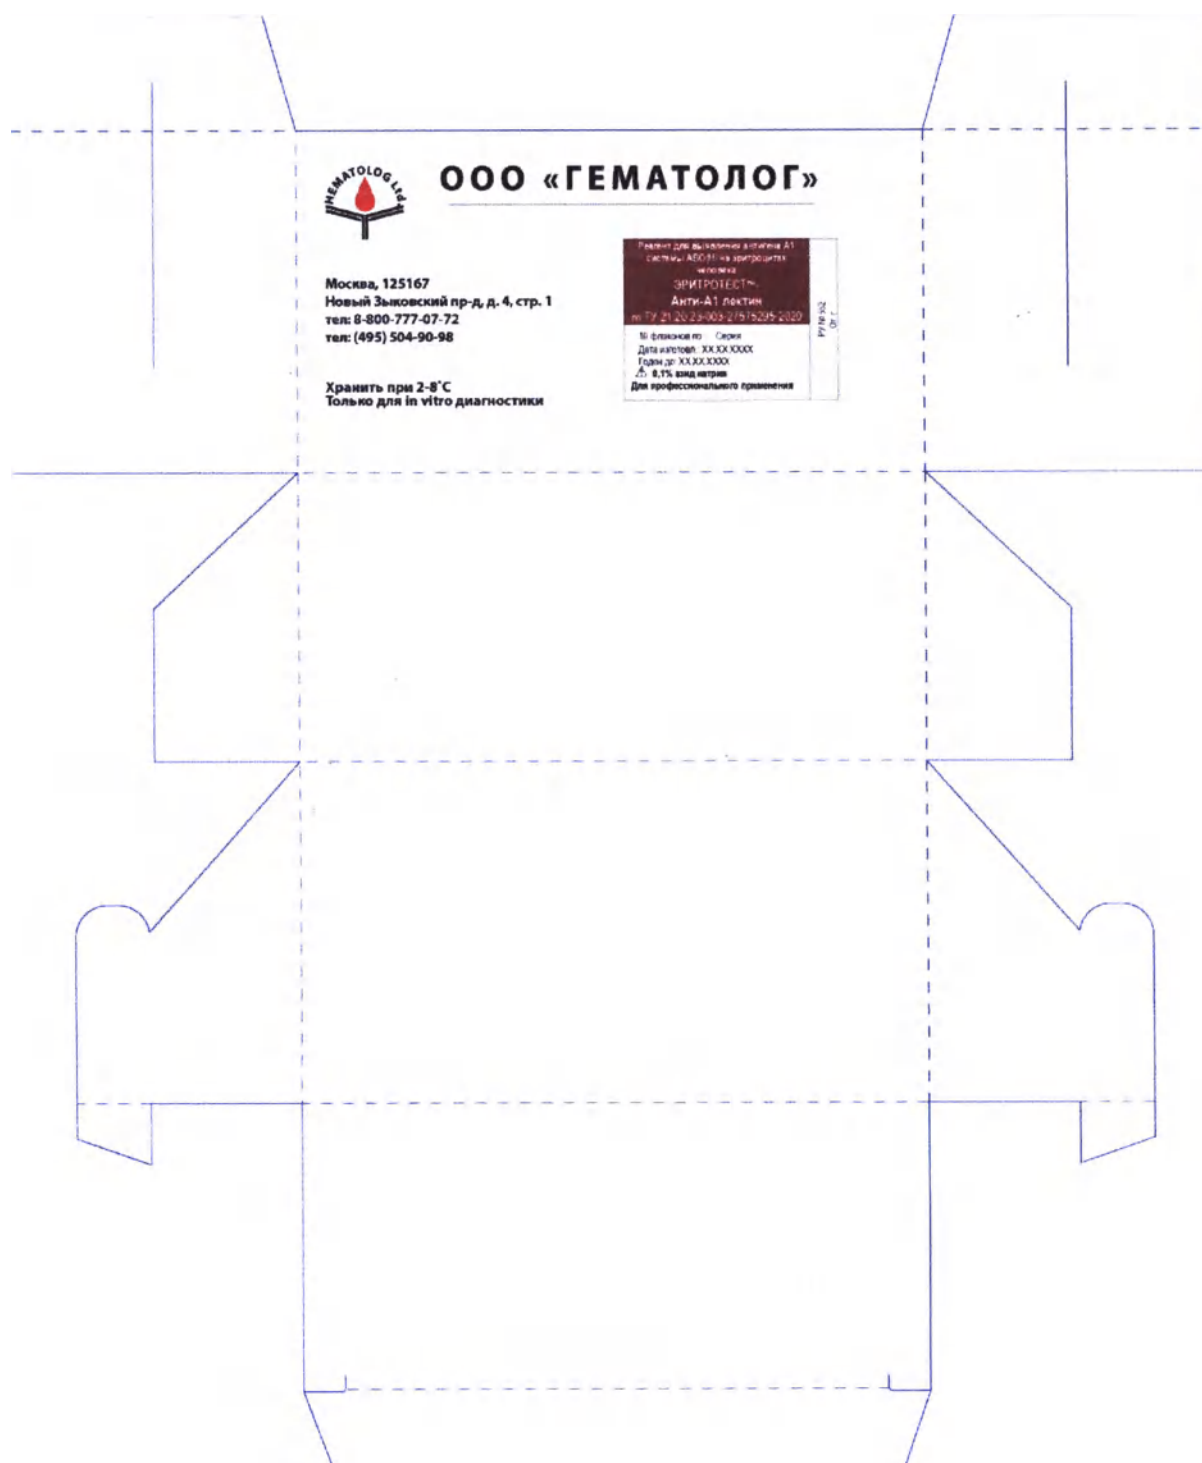


Маркировка транспортной тары



 +8°C +2°C	 Общество с ограниченной ответственностью "ГЕМАТОЛОГ" 125167 Москва, Новый Зыковский пр-д, д. 4 стр. 1 Тел. (485) 504-90-88, 8-800-777-07-72 Реагент для выявления антигена A1 системы ABO(H) на эритроцитах человека ЭРИТРОТЕСТ™- Анти-A1 лектин по ТУ 21.20.23-003-27575295-2020
	Серия: Количество: Масса нетто: Масса брутто: Масса нетто потребительской упаковки:  XXXX.XX  XXXX.XX 
	

Макет транспортной тары с маркировкой

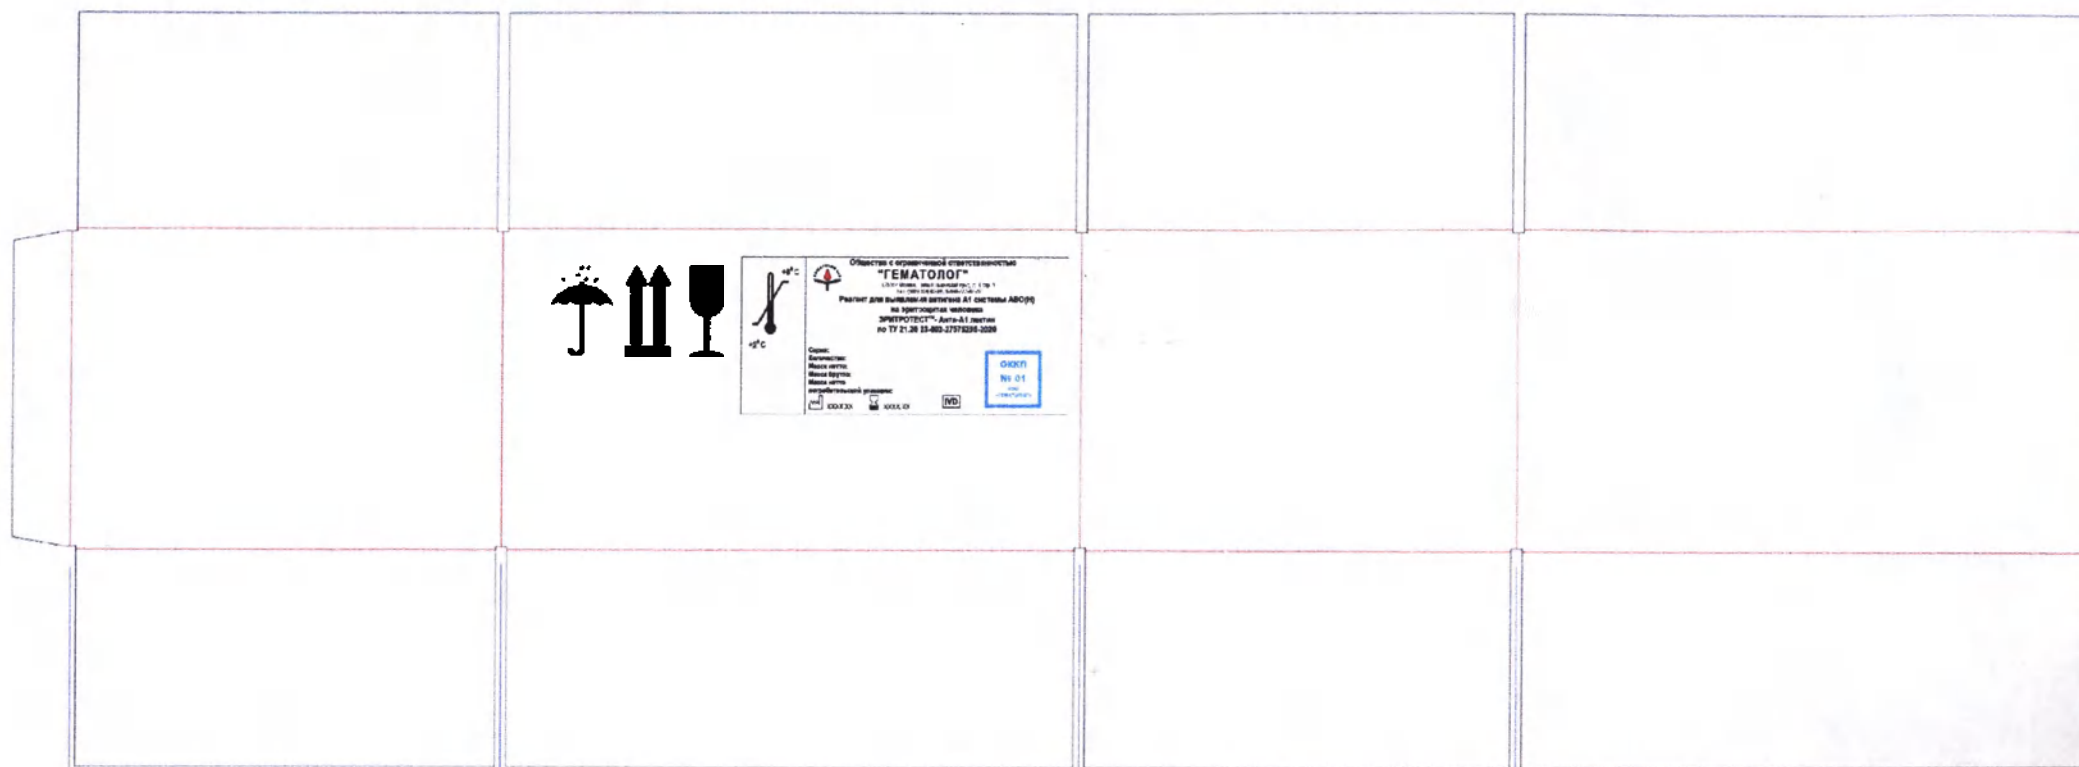

Прошито и пронумеровано

листов

Директор ООО «ГЕМАТОЛОГ»



Митерев Г.Ю.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ГЕМАТОЛОГ»



Митерев Г.Ю.

2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Реагент для выявления антигена А1 системы АВО(Н) на эритроцитах человека (ЭРИТРОТЕСТ™ – Анти-А1 лектин),

по ТУ 21.20.23-003-27575295-2020

Варианты исполнения:

- 5 мл во флаконе, флаконы из нейтрального стекла с завинчивающимися крышками с капельницами – 10 флаконов стр. 2-3
- 5 мл во флаконе, пластиковые флаконы-капельницы - 10 флаконов стр. 4-5
- 10 мл во флаконе, пластиковые флаконы-капельницы - 10 флаконов стр. 6-7




**Реагент для выявления антигена A1 системы ABO(H) на эритроцитах человека (ЭРИТРОТЕСТ™ – Анти-A1 лектин),
10 флаконов по 5 мл в стеклянный флакон объемом 10 мл**



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167
Новый Зыковский пр-д
тел: 8-800-777-07-72
тел: (495) 504-90-98

Хранить при 2-8°C
Только для in vitro ди

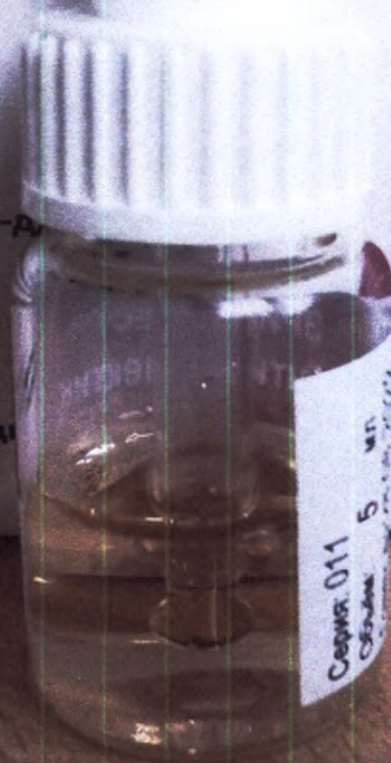

Реагент для выявления
антигена А1 системы АВО(Н)
на эритроцитах человека

ЭРИТРОТЕСТ™

Анти-А1 лектин

по ТУ 21.20.23-003-27575295-2020

РУ №
01

10 флаконов по 5 мл Серия: 011

Дата изготвл.: 28.08.2020

Годен до: 28.08.2022

⚠ 0,1% азид натрия

Для профессионального применения

Реагент для выявления антигена А1 системы АВО(Н) на эритроцитах человека (ЭРИТРОТЕСТ™ – Анти-А1 лектин),
10 флаконов по 5 мл в стеклянный флакон объемом 10 мл



**Реагент для выявления антигена А1 системы АВО(Н) на эритроцитах человека (ЭРИТРОТЕСТ™ – Анти-А1 лектин),
10 флаконов по 5 мл в ФКП объемом 5 мл**



Реагент для выявления антигена А1 системы АВО(Н) на эритроцитах человека (ЭРИТРОТЕСТ™ – Анти-А1 лектин),
10 флаконов по 5 мл в ФКП объемом 5 мл





Москва, 125167

Новый Зыковский пр-д, д. 1

тел: 8-800-777-07-72

тел: (495) 504-90-98

Хранить при 2-8°C

Только для in vitro диагностики

ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Реагент для выявления
антигена А1 системы АВО(Н)
на эритроцитах человека
ЭРИТРОТЕСТ™

Анти-А1 лектин

по ТУ 21.20.23-003-27575295-2020

10 флаконов по 10 мл Серия: 013

Дата изготовл.: 28.08.2020

Годен до: 28.08.2022

⚠ 0,1% азид натрия

Для профессионального применения

РУ № 5

Серия: 013

Объем: 10 мл

Реагент для выявления антигена А1 системы АВО(Н) на эритроцитах человека (ЭРИТРОТЕСТ™ – Анти-А1 лектин),

10 флаконов по 10 мл в ФКП объемом 10 мл

Прошито и пронумеровано

листов

Директор ООО «ГЕМАТОЛОГ»



Митерев Г.Ю.